

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

27.11.2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Тропонин I» для количественного определения тропонина I (Troponin I, TnI) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-275-65614693-2022»


2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур Тропонин I» для количественного определения тропонина I (Troponin I, TnI) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-275-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:




- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Тропонин I

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



ProCin 300

01.07.2023

LOT 20230701 01.07.2024 REF C89243

Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Тропонин I» для количественного определения тропонина I (Troponin I, TnI) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-275-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Тропонин I

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



ProCin 300

01.07.2023

LOT 20230701 01.07.2024 REF C89243

Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Тропонин I» для количественного определения тропонина I (Tropoin I, Tni) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-275-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Тропонин I

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO



01.07.2023

LOT 20230701 01.07.2024 REF C89243

Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Пароизоляция крышки – 40 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Тропонин I» для количественного определения тропонина I (Tropoin I, Tni) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-275-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Тропонин I

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO



01.07.2023

LOT 20230701 01.07.2024 REF C89243

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Пароизоляция крышки – 80 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YNLO**

Лидлаб Амур Тропонин I

3,5 мл 4,0 мл

R 1 R 2

LOT 20230701 01.07.2024

IVD   ProClin 300  

2°C 8°C $\Sigma 1 \times 50$

9031 1017

лидкор

Лидлаб Амур Тропонин I

Калибратор инактивирован

ProClin 300

2°C 8°C IVD    

1,0 мл LOT 20230701

CAL 1 01.07.2024

REF C89243

лидкор

Лидлаб Амур Тропонин I

Калибратор инактивирован

ProClin 300

2°C 8°C IVD    

1,0 мл LOT 20230701

CAL 2 01.07.2024

REF C89243

лидкор

Лидлаб Амур Тропонин I

Калибратор инактивирован

ProClin 300

2°C 8°C IVD    

1,0 мл LOT 20230701

CAL 3 01.07.2024

REF C89243

лидкор

Лидлаб Амур Тропонин I

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701

IVD



01.07.2024


REF C89243



Лидлаб Амур Тропонин I



LOT 20230701 EXP 01.07.2024

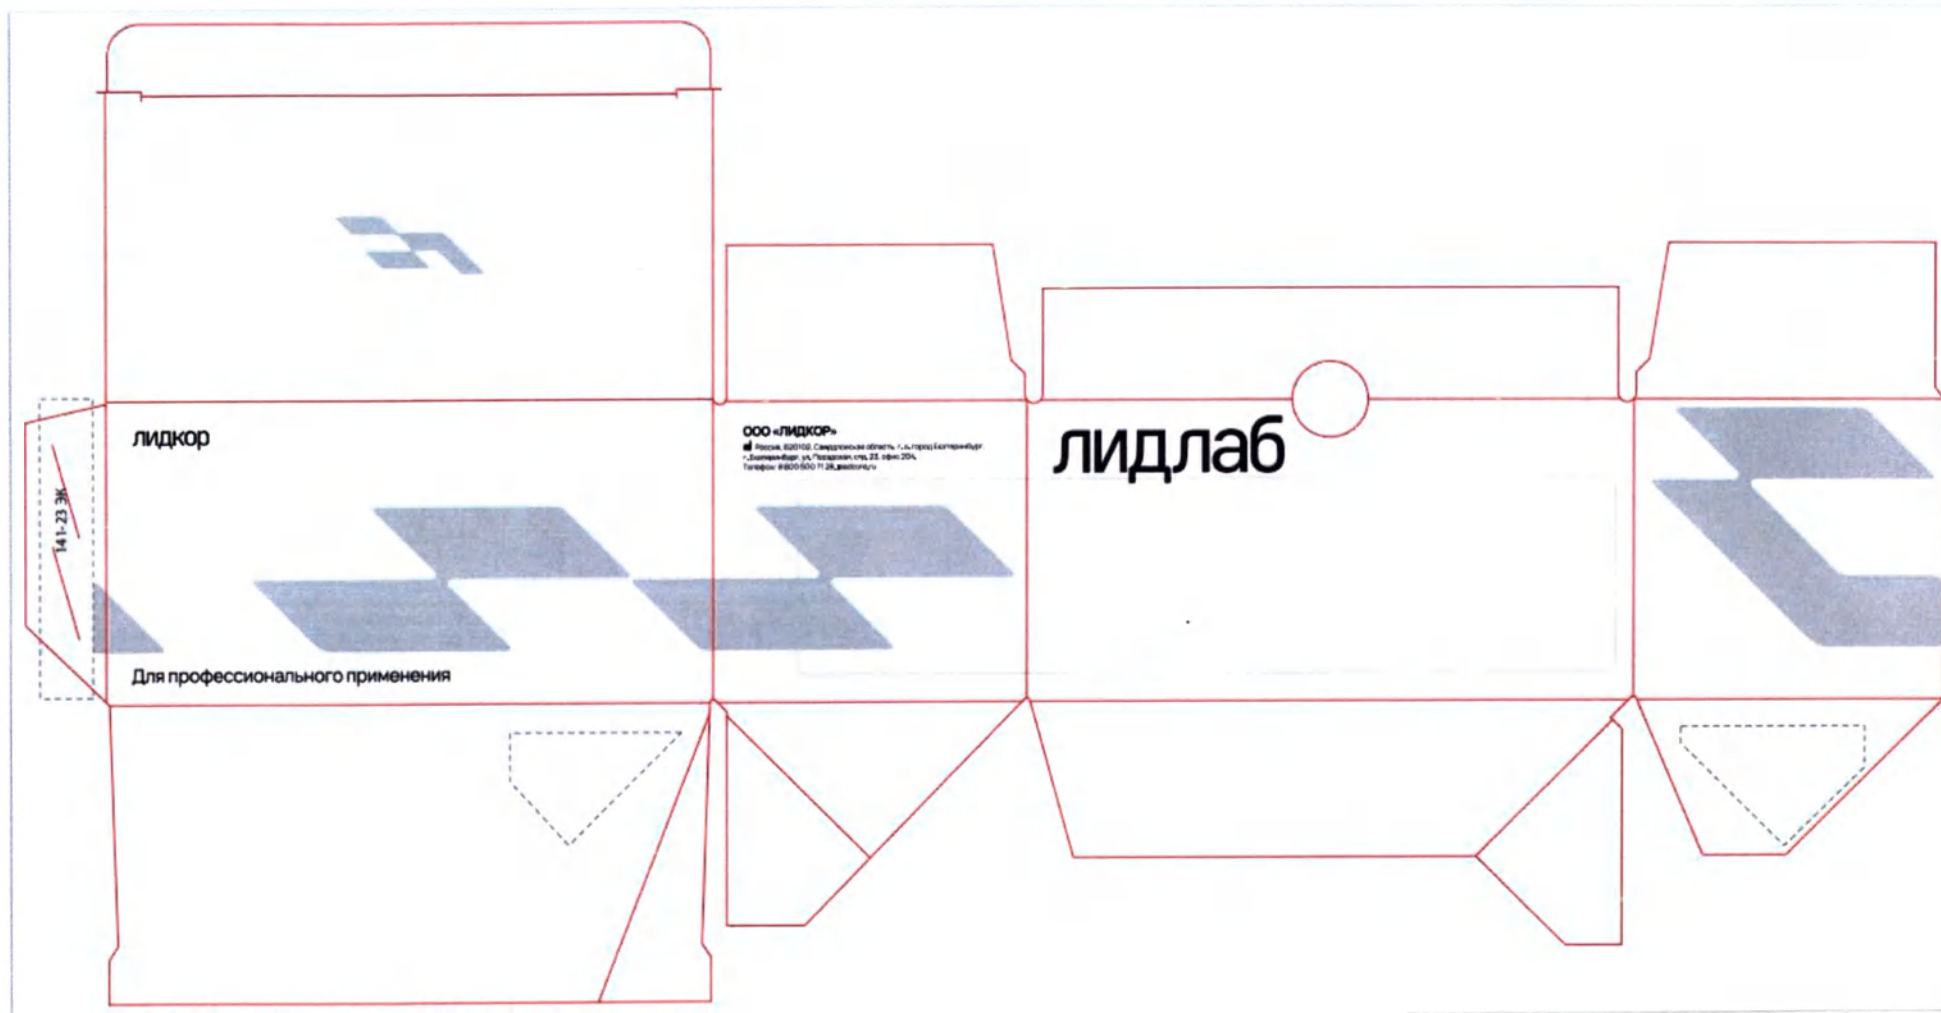

Макет транспортной маркировки




Набор реагентов «Лидлаб Амур Тропонин I» для количественного определения тропонина I (Troponin I, TnI) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-275-65614693-2022











Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024
REF	C89243		

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (Смб) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

27.11.2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Тропонин I» для количественного определения тропонина I (Troponin I, TnI) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-275-65614693-2022»


2023





Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)



Калибратор I (CAL1)

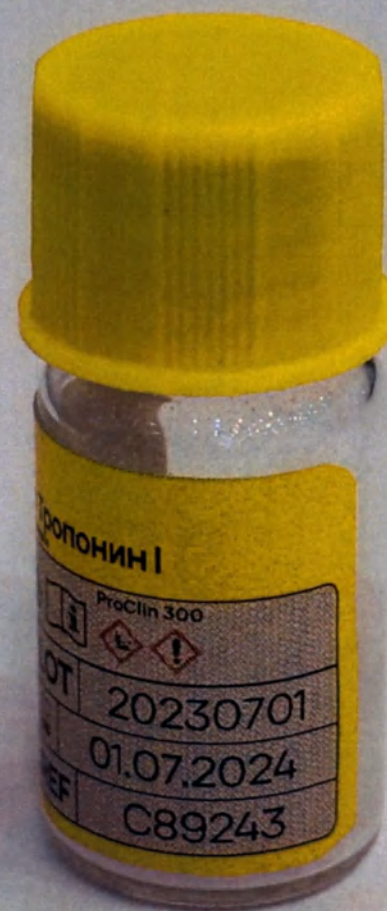

Калибратор 2 (CAL2)

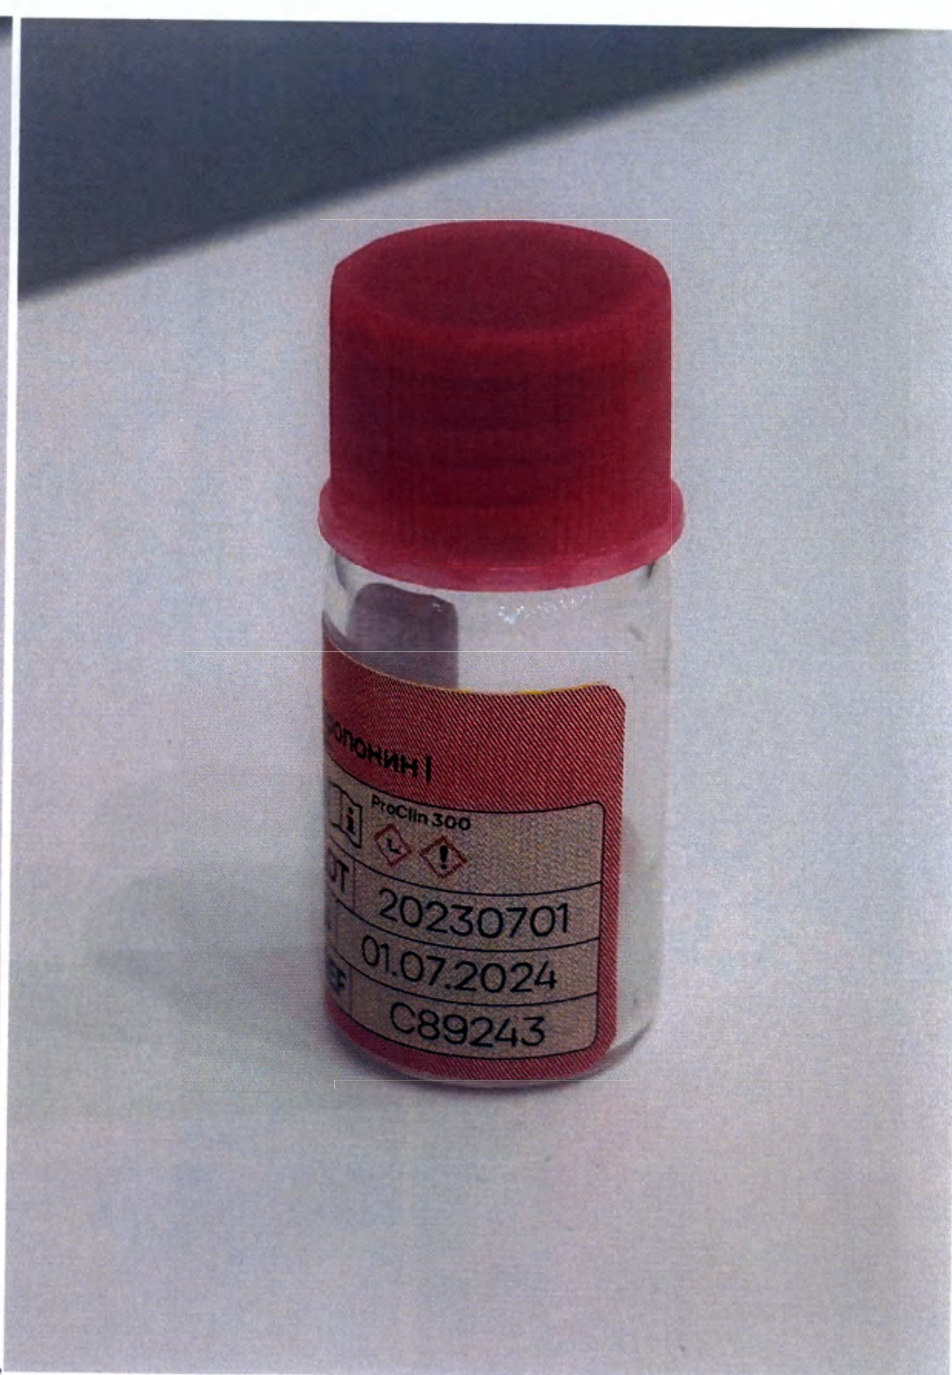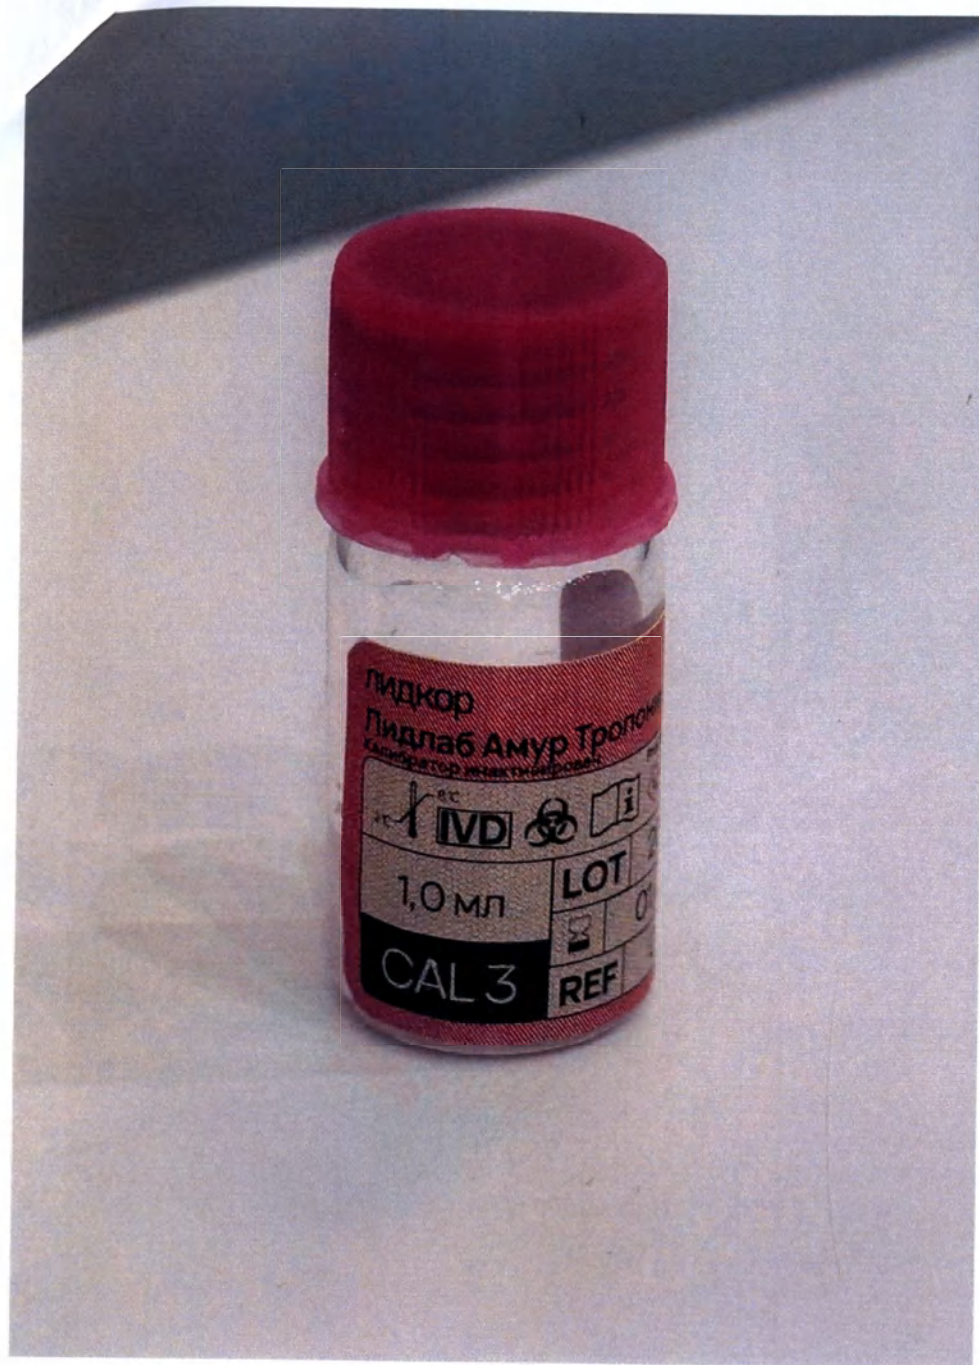

Калибратор 3 (CAL3)



Набор реагентов на 100 тестов

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru


Набор реагентов «Лидлаб Амур Тропонин I»
для количественного определения тропонина I
(Troponin I, TnI) в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-275-65614693-
2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела
к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Набор реагентов на 100 тестов (другая сторона коробки)

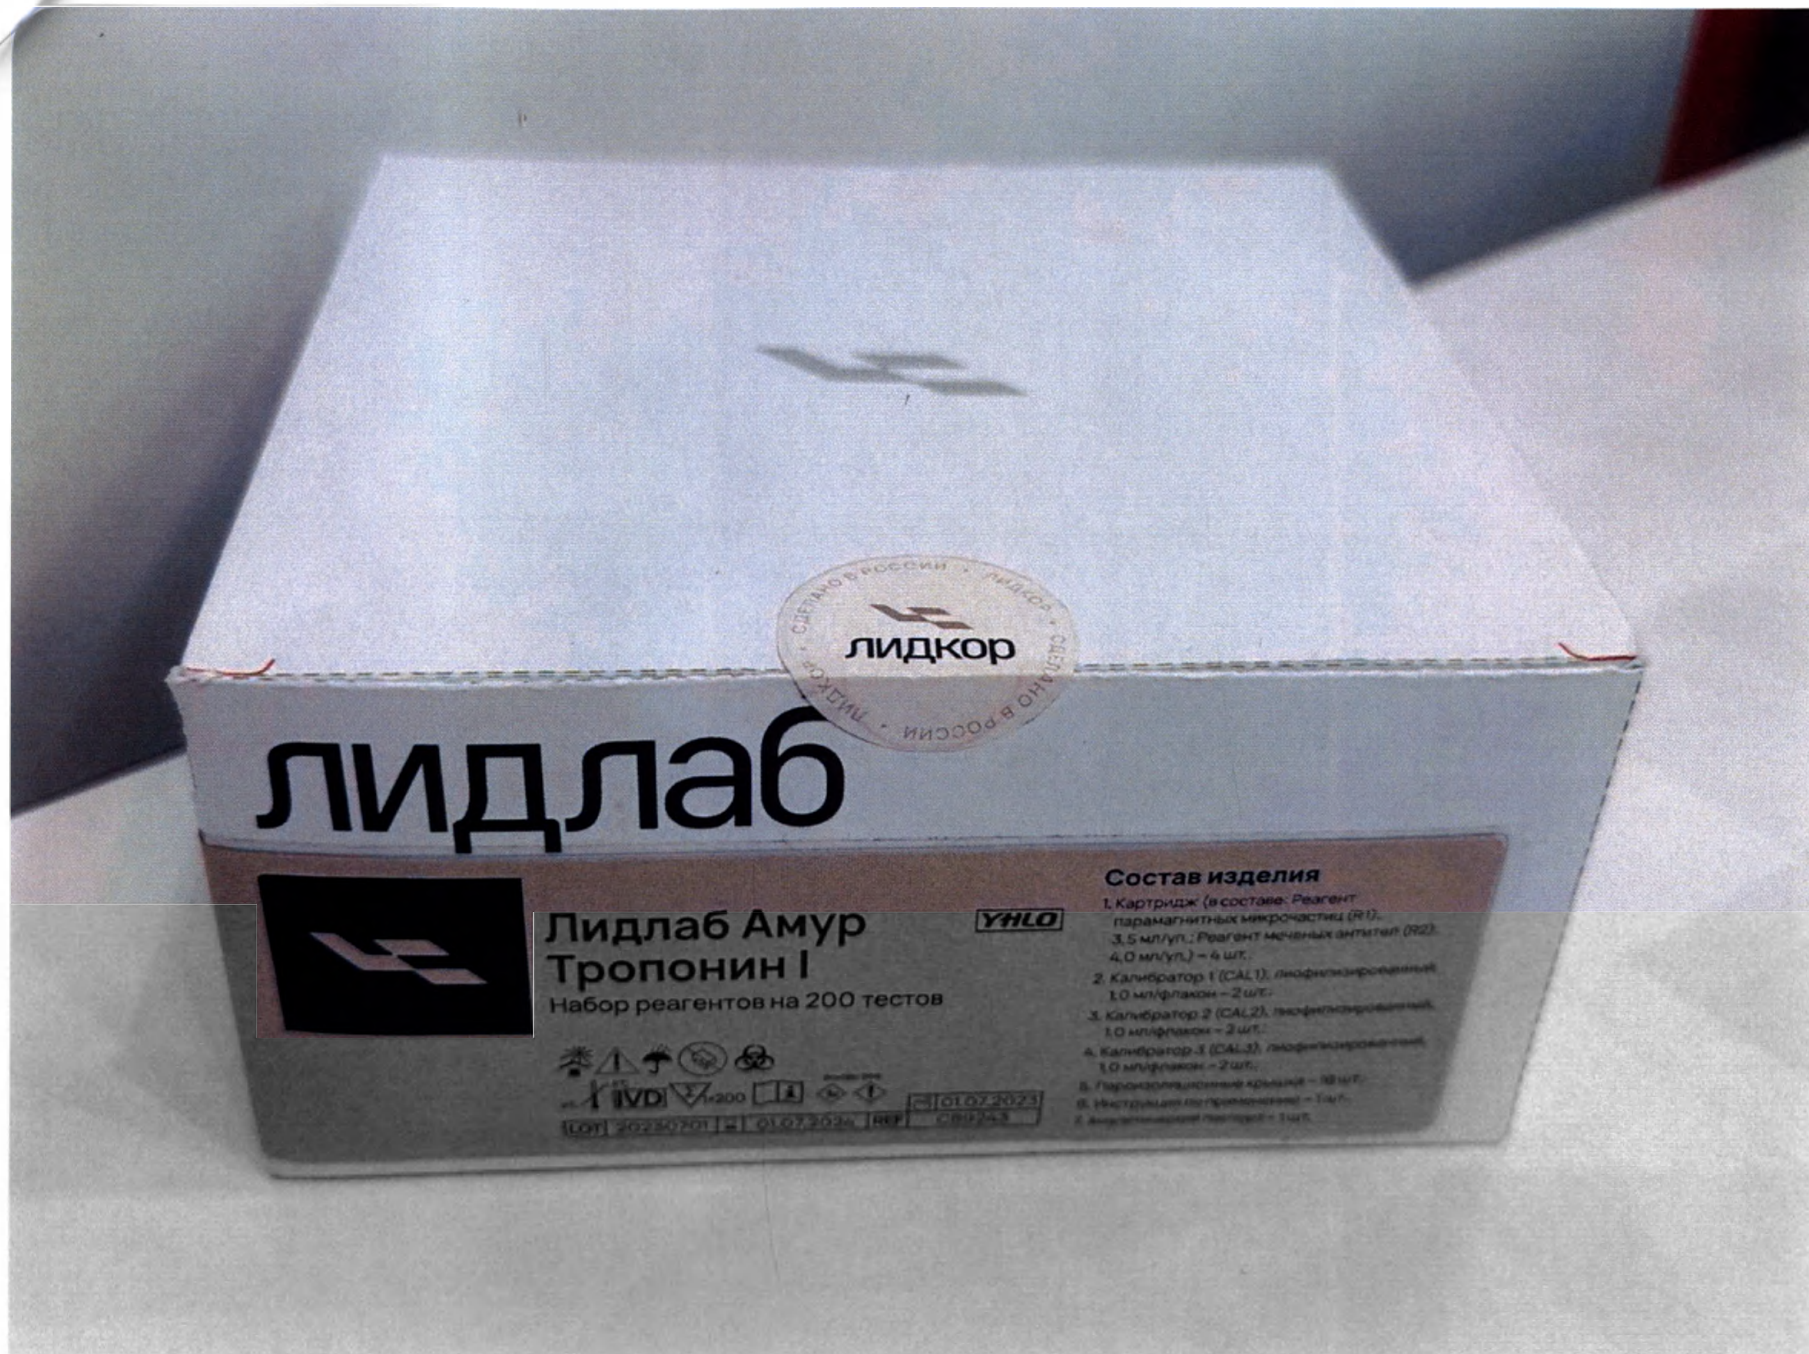

Набор реагентов на 200 тестов

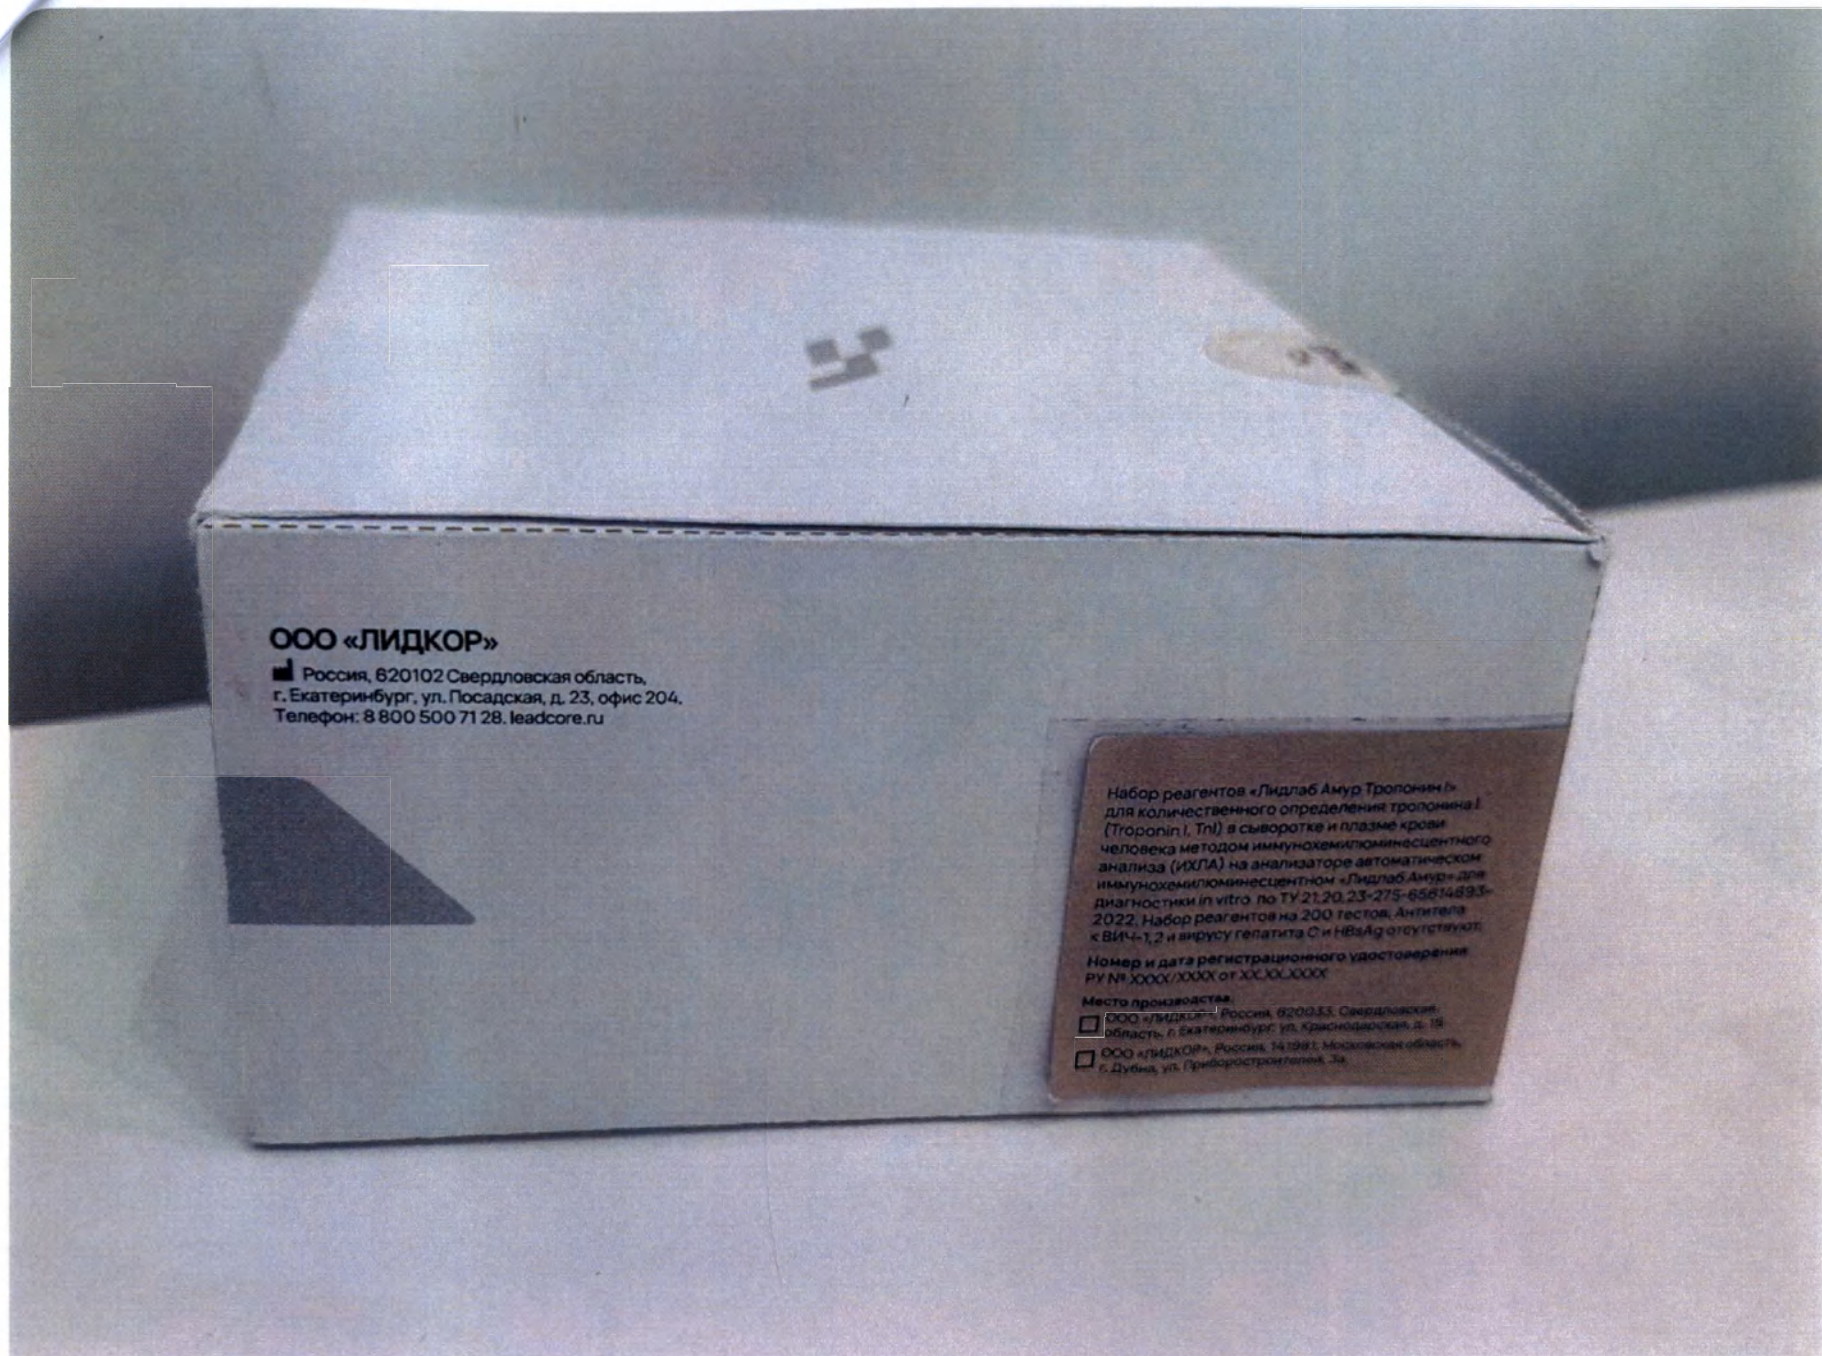

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102 Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru


Набор реагентов «Лидлаб Амур Тропонин I»
для количественного определения тропонина I
(Troponin I, TnI) в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-275-65814893-
2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела
к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «Лидкор», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 19
☐ ООО «Лидкор», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроительная, 3а

Набор реагентов на 200 тестов (другая сторона коробки)

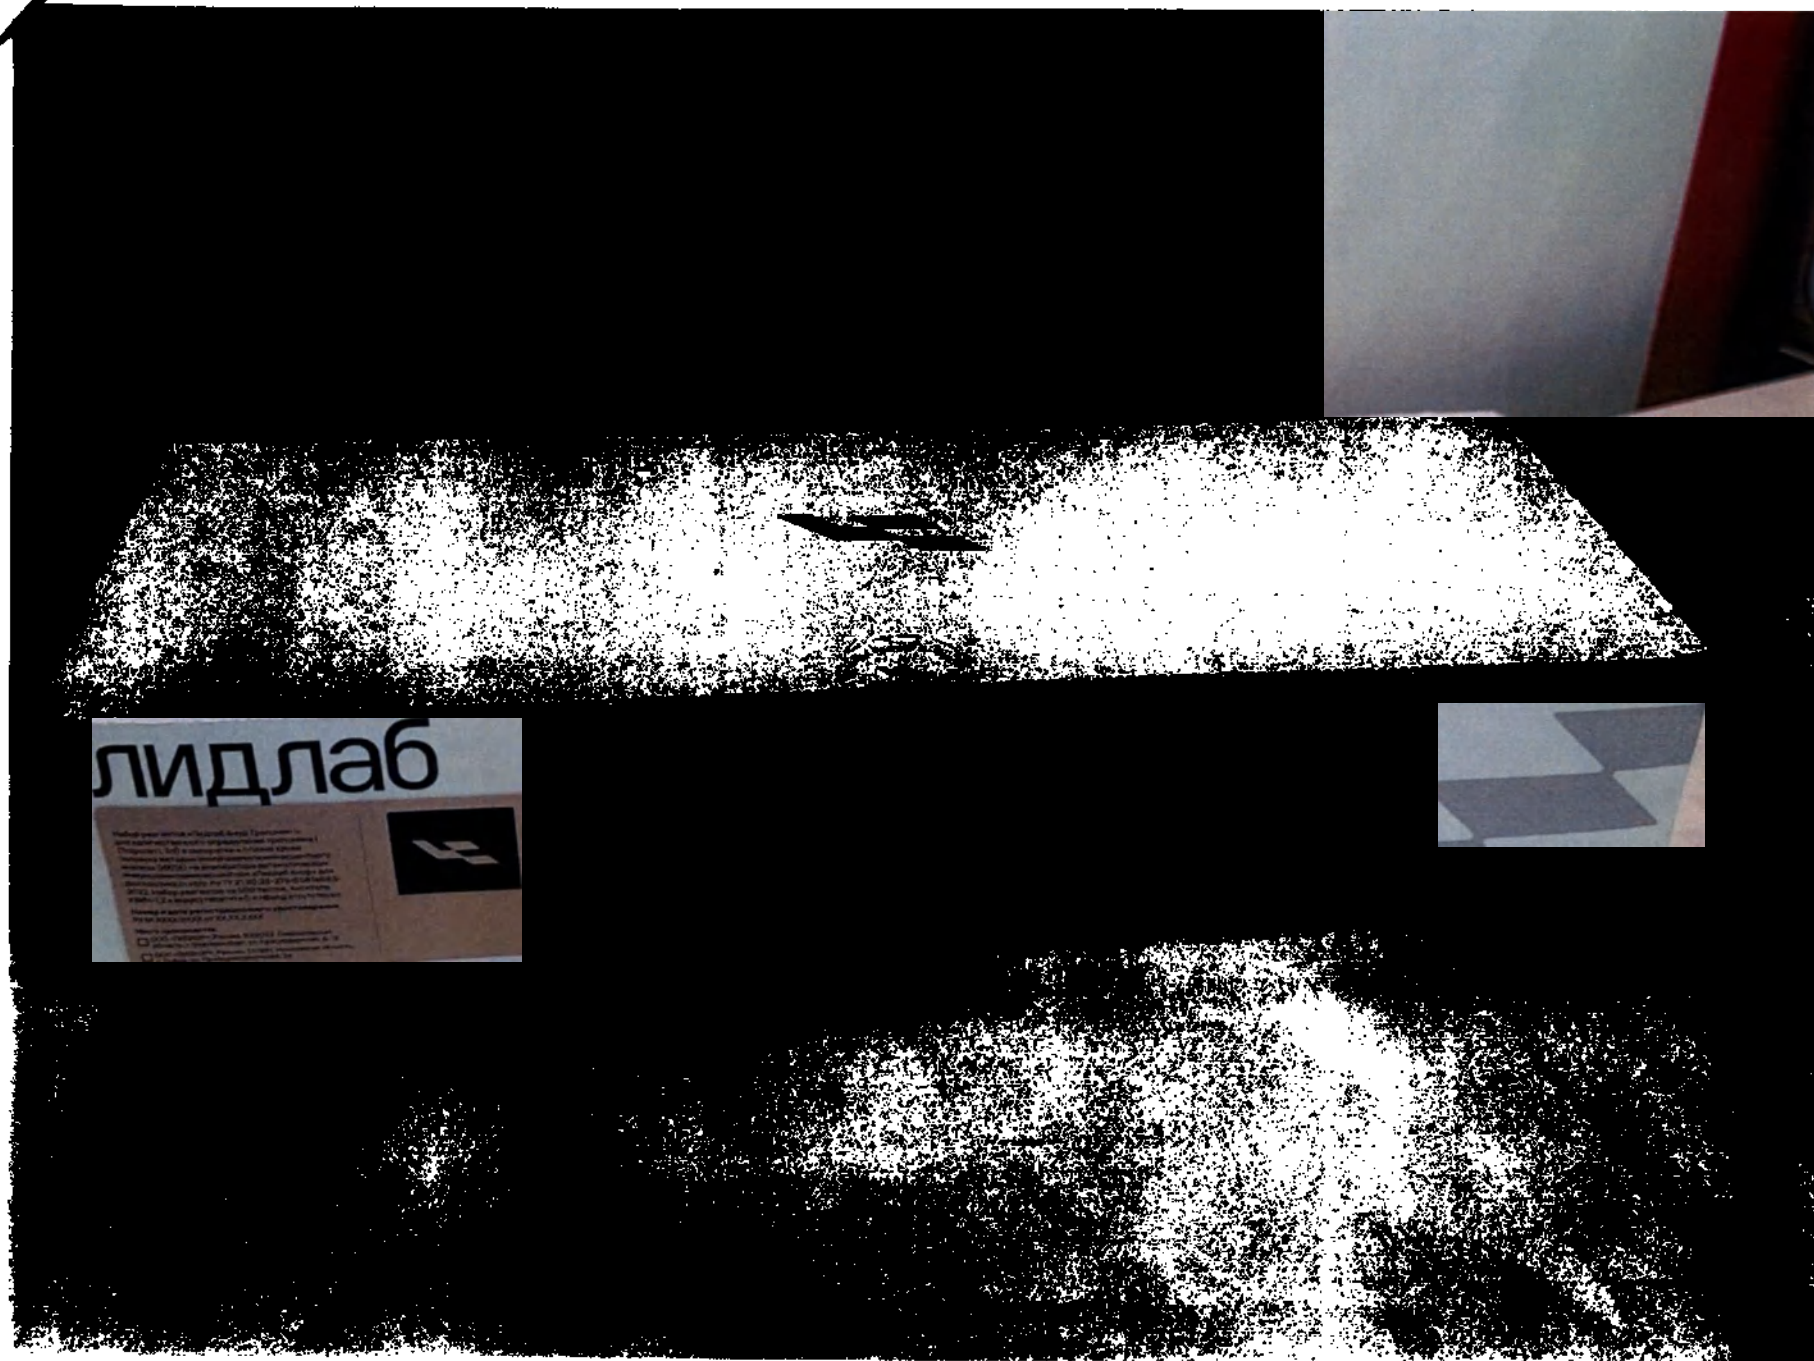

Набор реагентов на 500 тестов

лидлаб

Лидлаб Амур Тропонин I
Набор реагентов на 1000 тестов

Состав изделия

- 1. Растворитель (100 мл) - 100 мл
- 2. Растворитель (100 мл) - 100 мл
- 3. Растворитель (100 мл) - 100 мл
- 4. Растворитель (100 мл) - 100 мл
- 5. Растворитель (100 мл) - 100 мл
- 6. Растворитель (100 мл) - 100 мл
- 7. Растворитель (100 мл) - 100 мл
- 8. Растворитель (100 мл) - 100 мл
- 9. Растворитель (100 мл) - 100 мл
- 10. Растворитель (100 мл) - 100 мл

ООО ЦИРМИ
ИНФО@ЦИРМИ.РУ
WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Набор реагентов на 1000 тестов



Пароизоляционные крышки



Набор реагентов «Лидлаб Амур Тропонин I» для количественного определения тропонина I (Troponin I, TnI) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-275-65614693-2022



IVD

Σ 100



Для профессионального применения

 ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		 01.07.2023	
LOT	20230701	 01.07.2024	REF C89243

Транспортная тара и ее маркировка



Набор реагентов «Лидлаб Амур Тропонин I» для количественного определения тропонина I (Troponin I, TnI) в сыворотке и плазме крови человека методом

иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-275-65614693-

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ;полнения: Набор реагентов на 100 тестов; Набор реагентов на 200 тестов; Набор реагентов на 500 тестов; Набор реагентов на 1000 тестов

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

14 (Подписанная) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

