

## **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов**

**производства Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan  
Road,Hi-tech Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China**



Общий вид МИ «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов»



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид спереди «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов»



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов»

迈克生物股份有限公司  
住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号  
电话: +86 28 8782 6777  
传真: +86 28 8782 5783  
邮编: 611731  
邮箱: maccura@maccura.com




Maccura Biotechnology Co., Ltd.  
Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731  
Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
Tel: +86 28 8782 6777  
Fax: +86 28 8782 5783  
E-mail: maccura@maccura.com

[www.maccura.com](http://www.maccura.com)




Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сзади «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов»

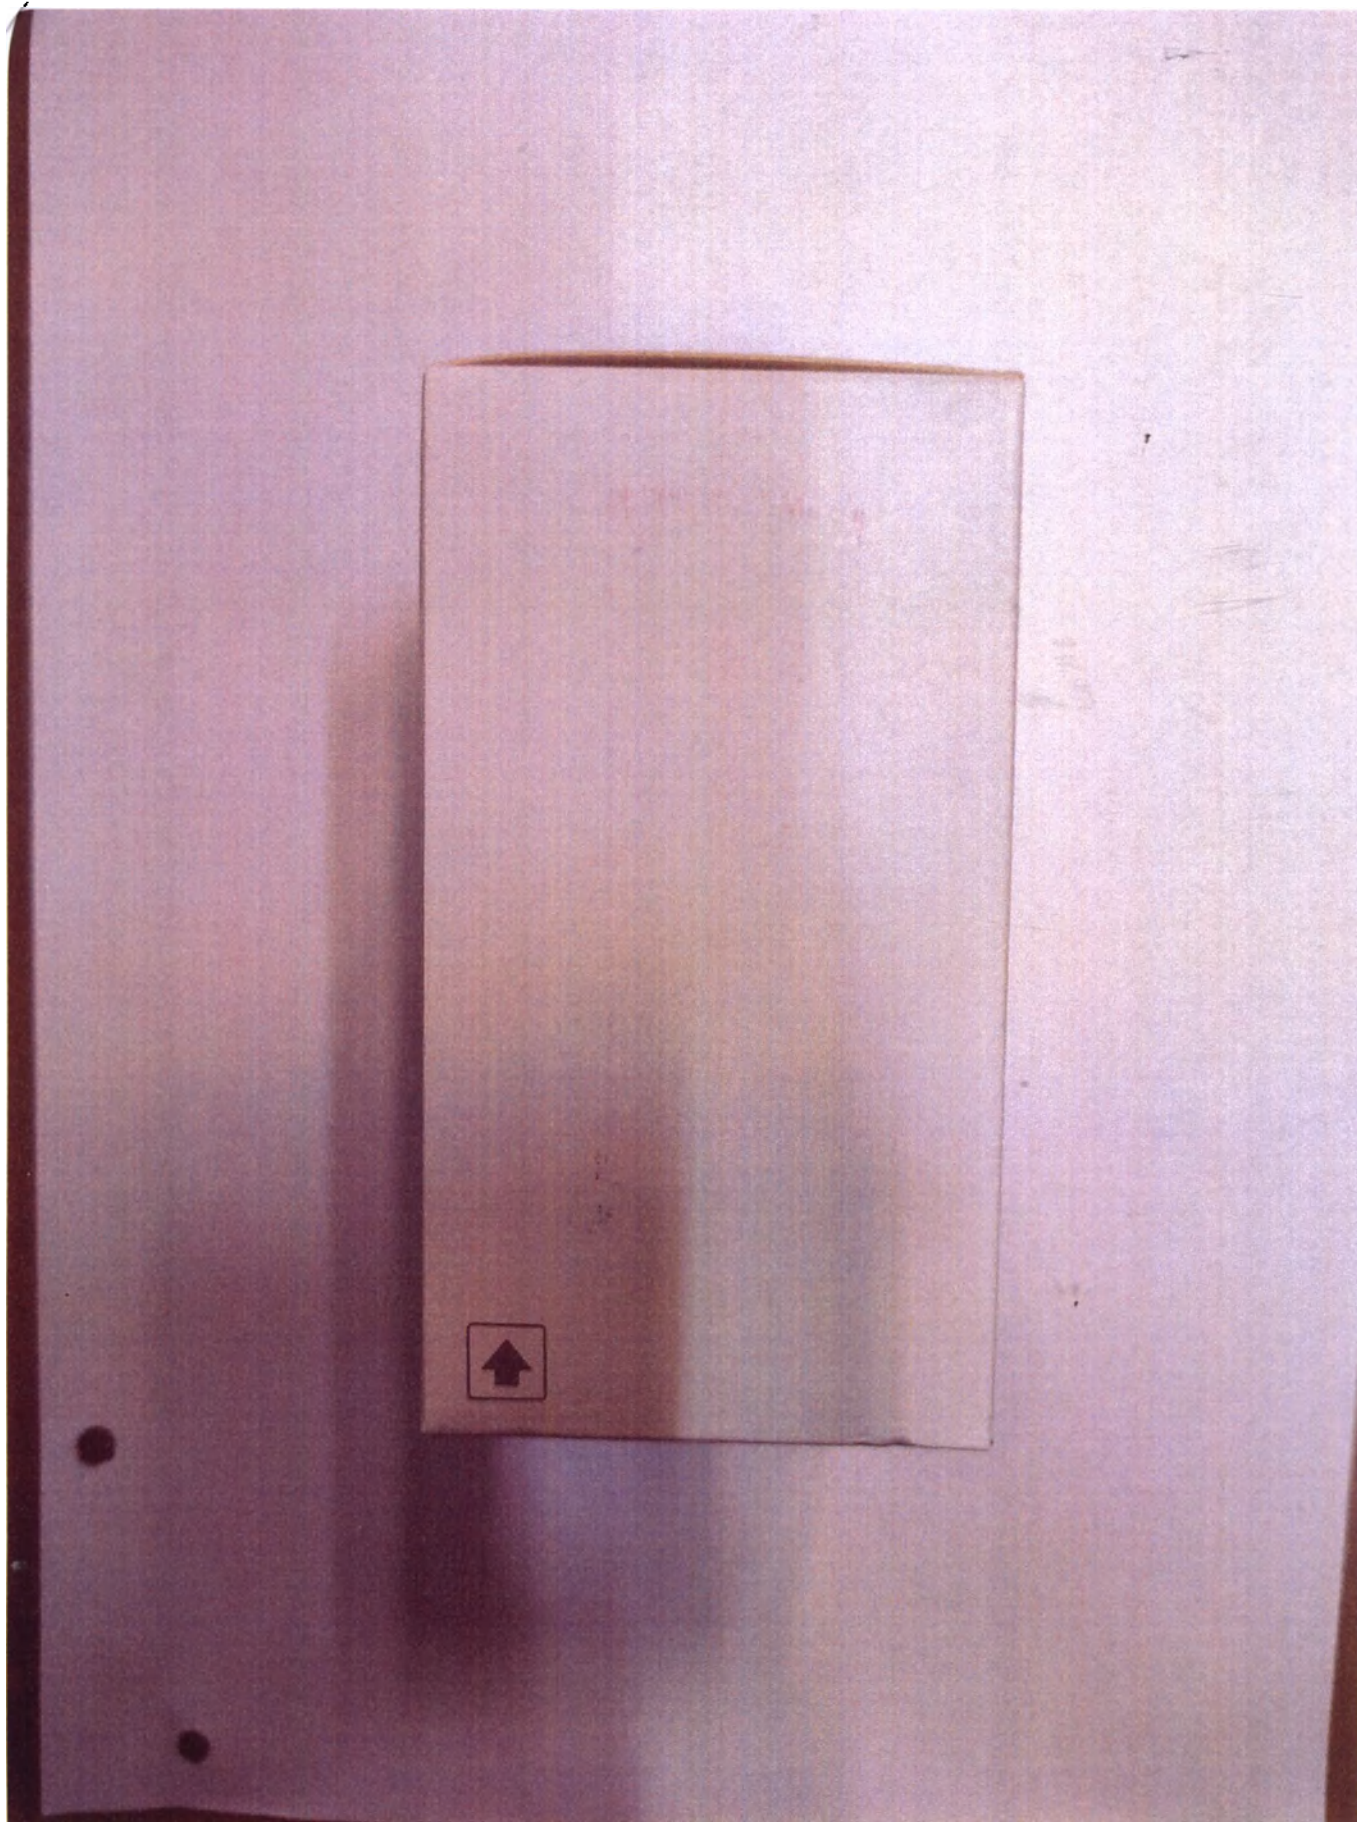


**Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Massura i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов»**




Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сверху «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов»

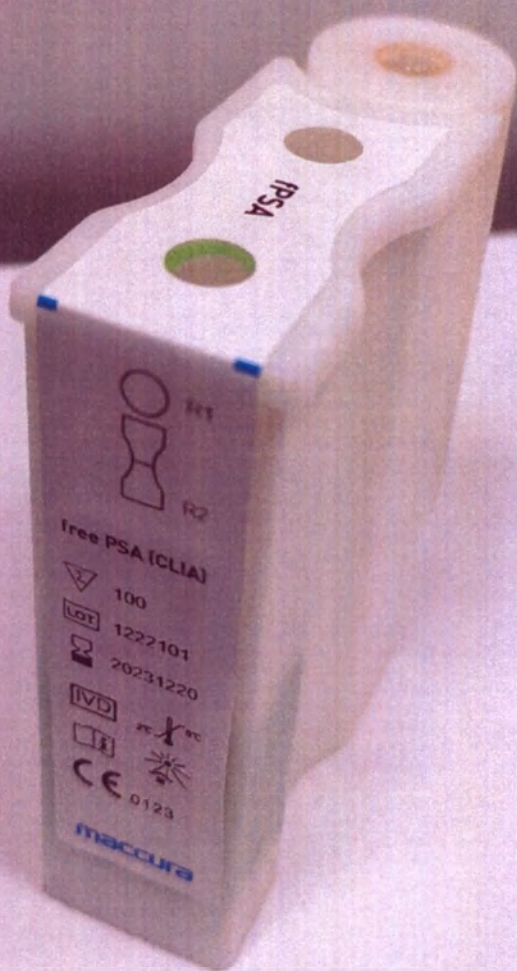

Внешний вид Картриджа с реагентом R1, R2 «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов»

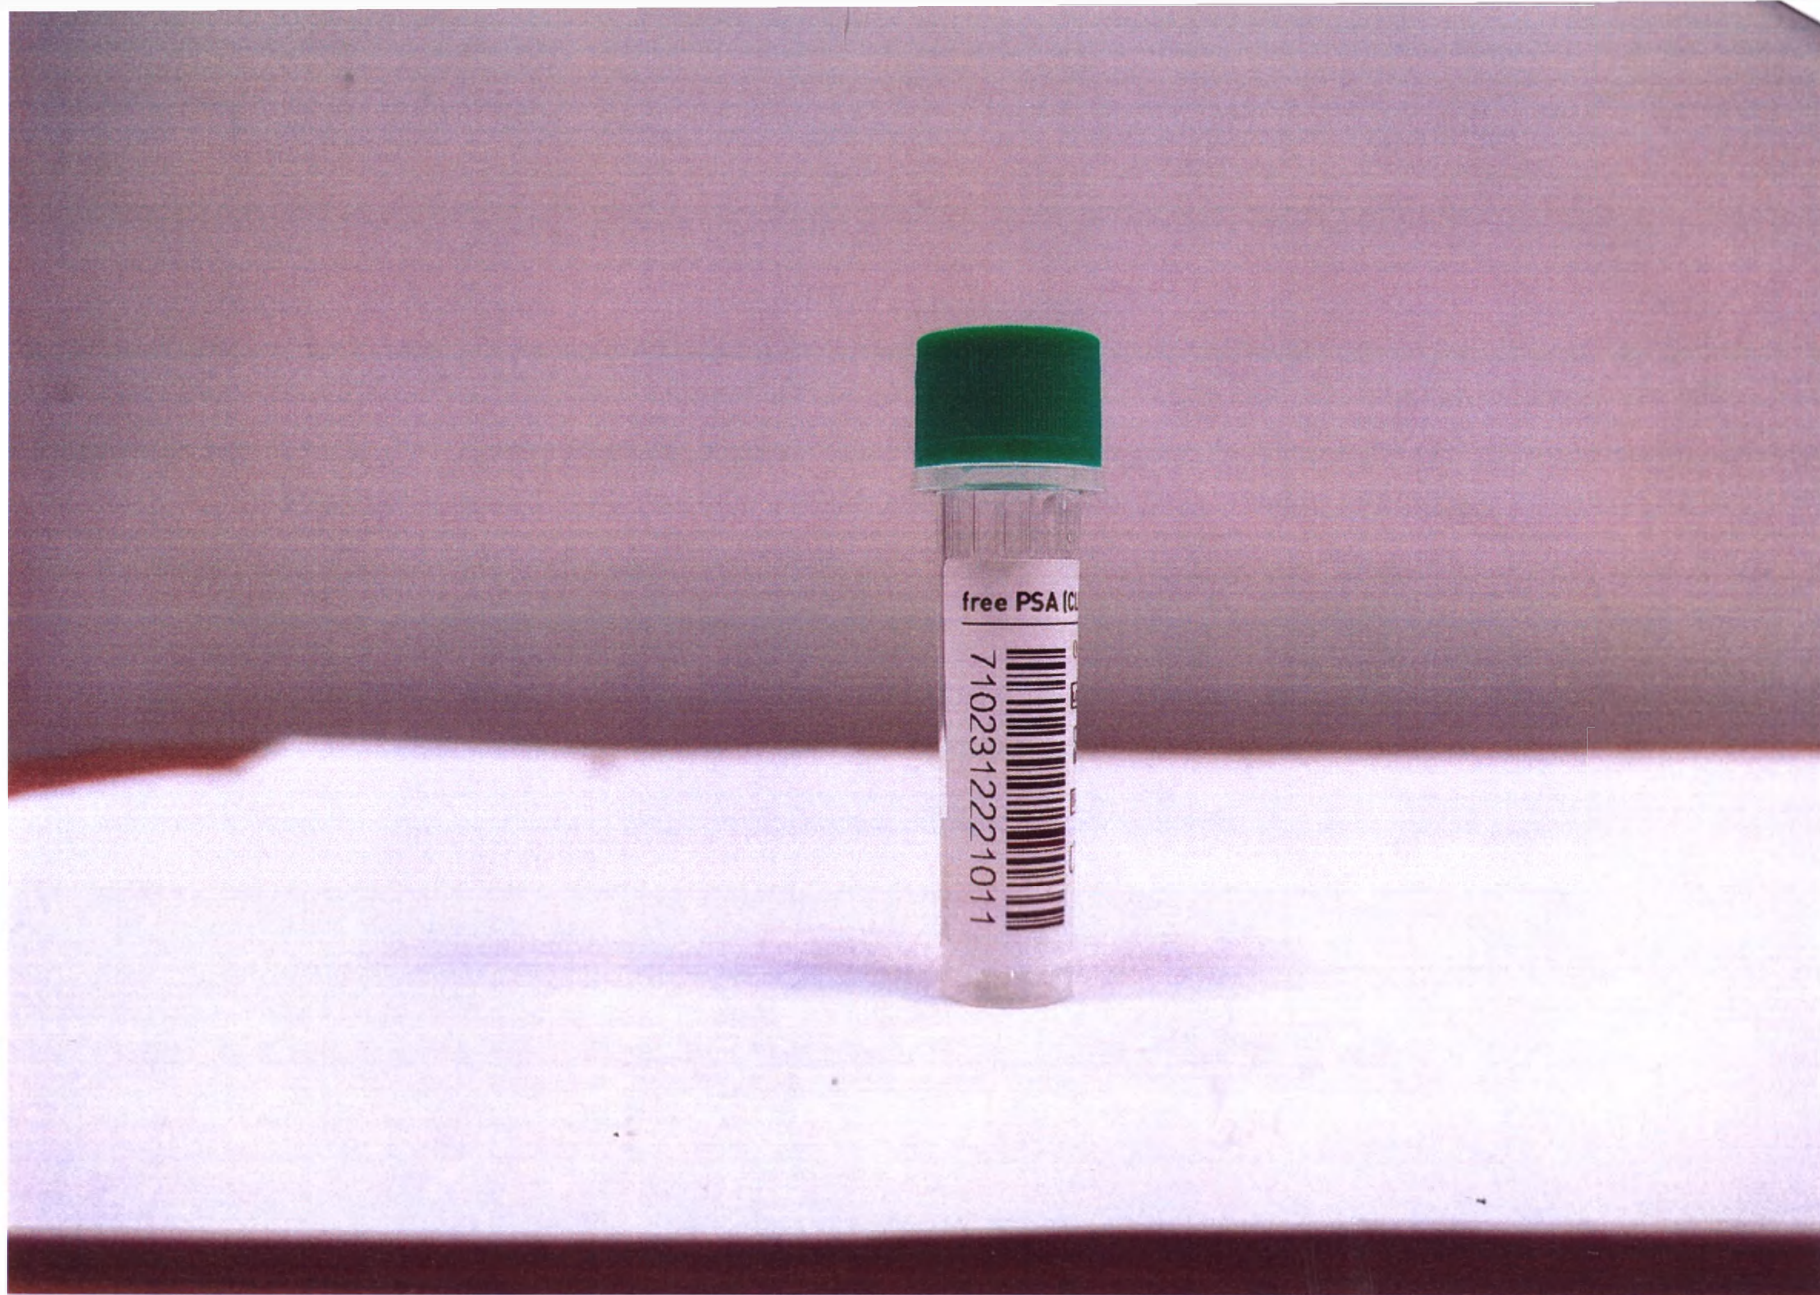

Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

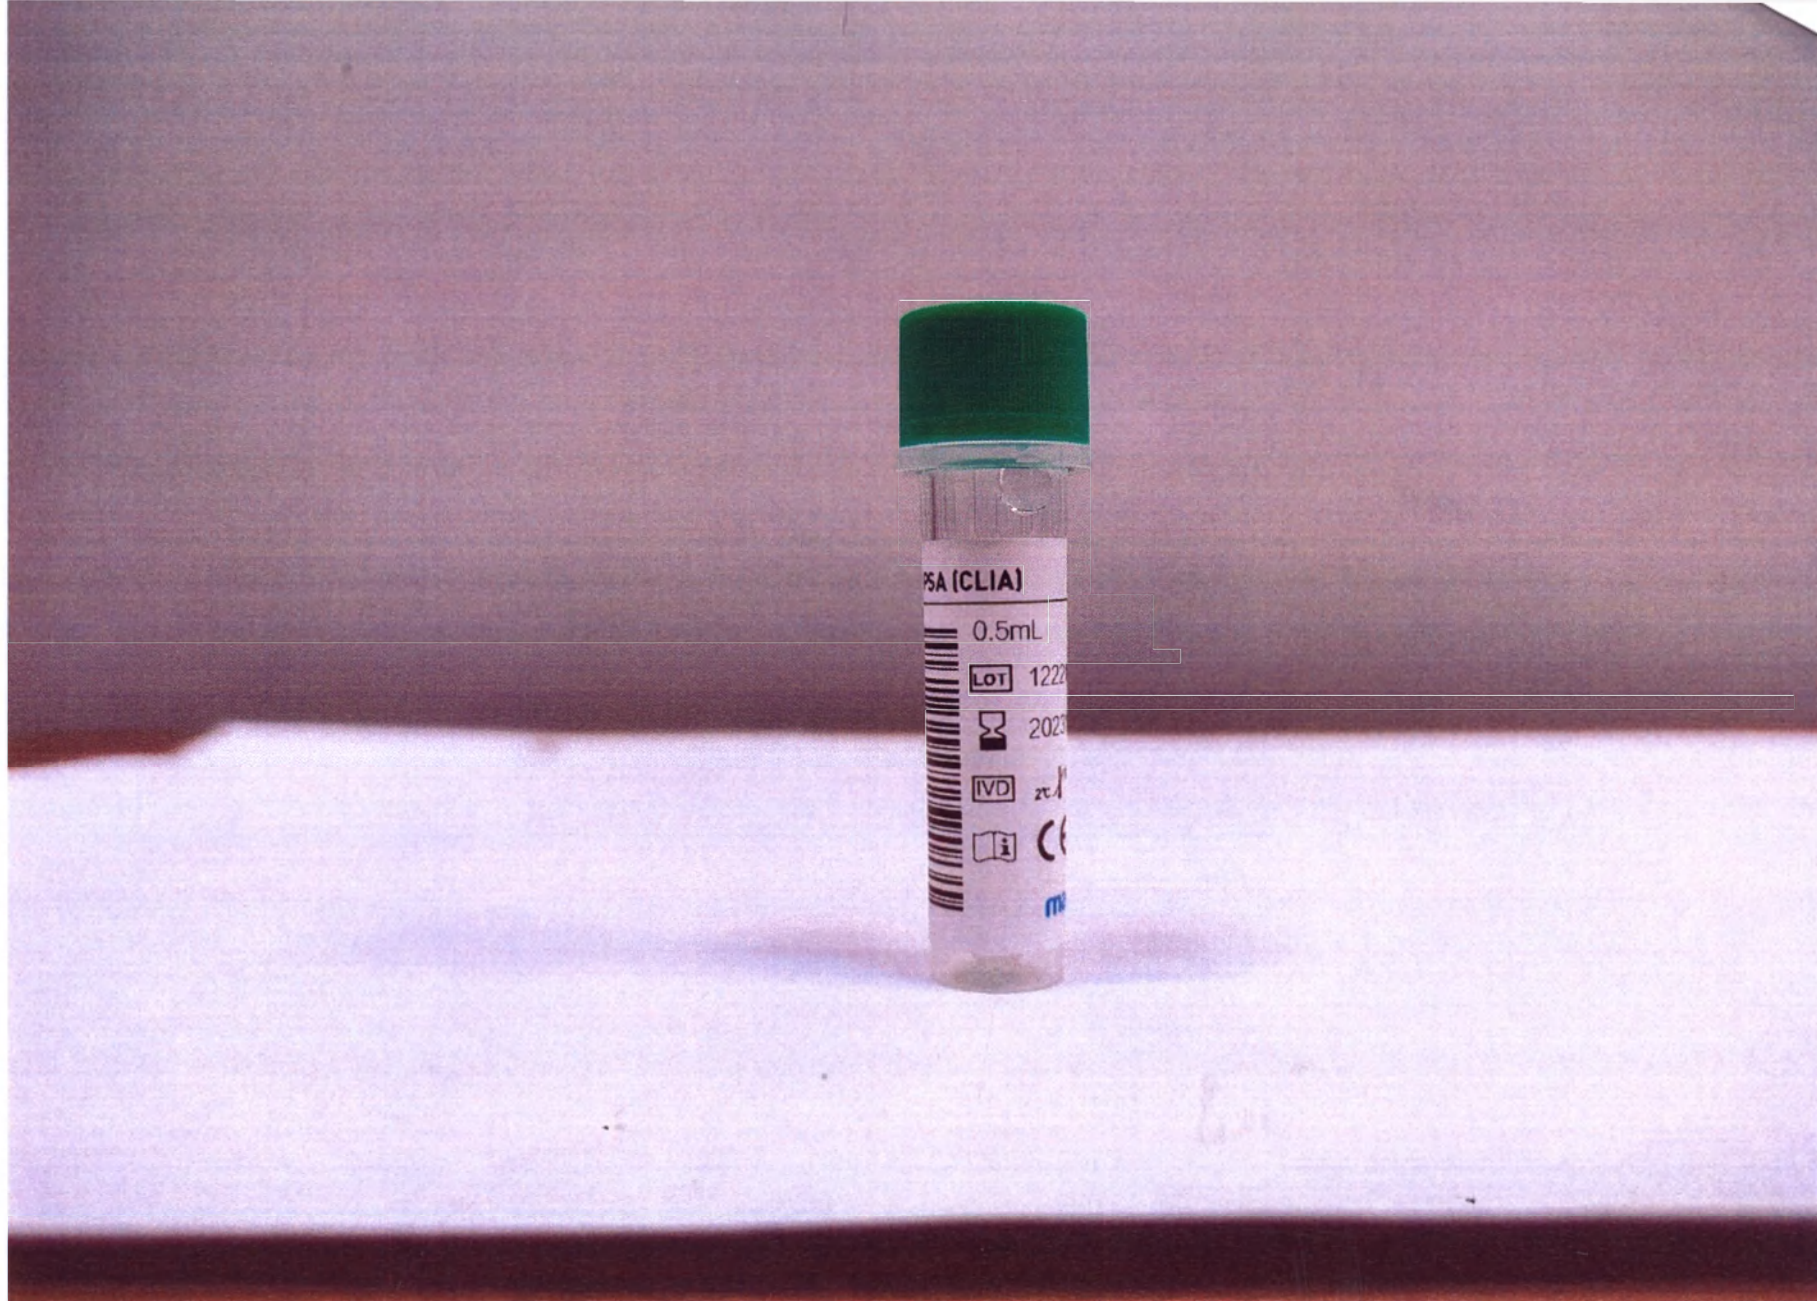


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2



Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов»,сторона 3



Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

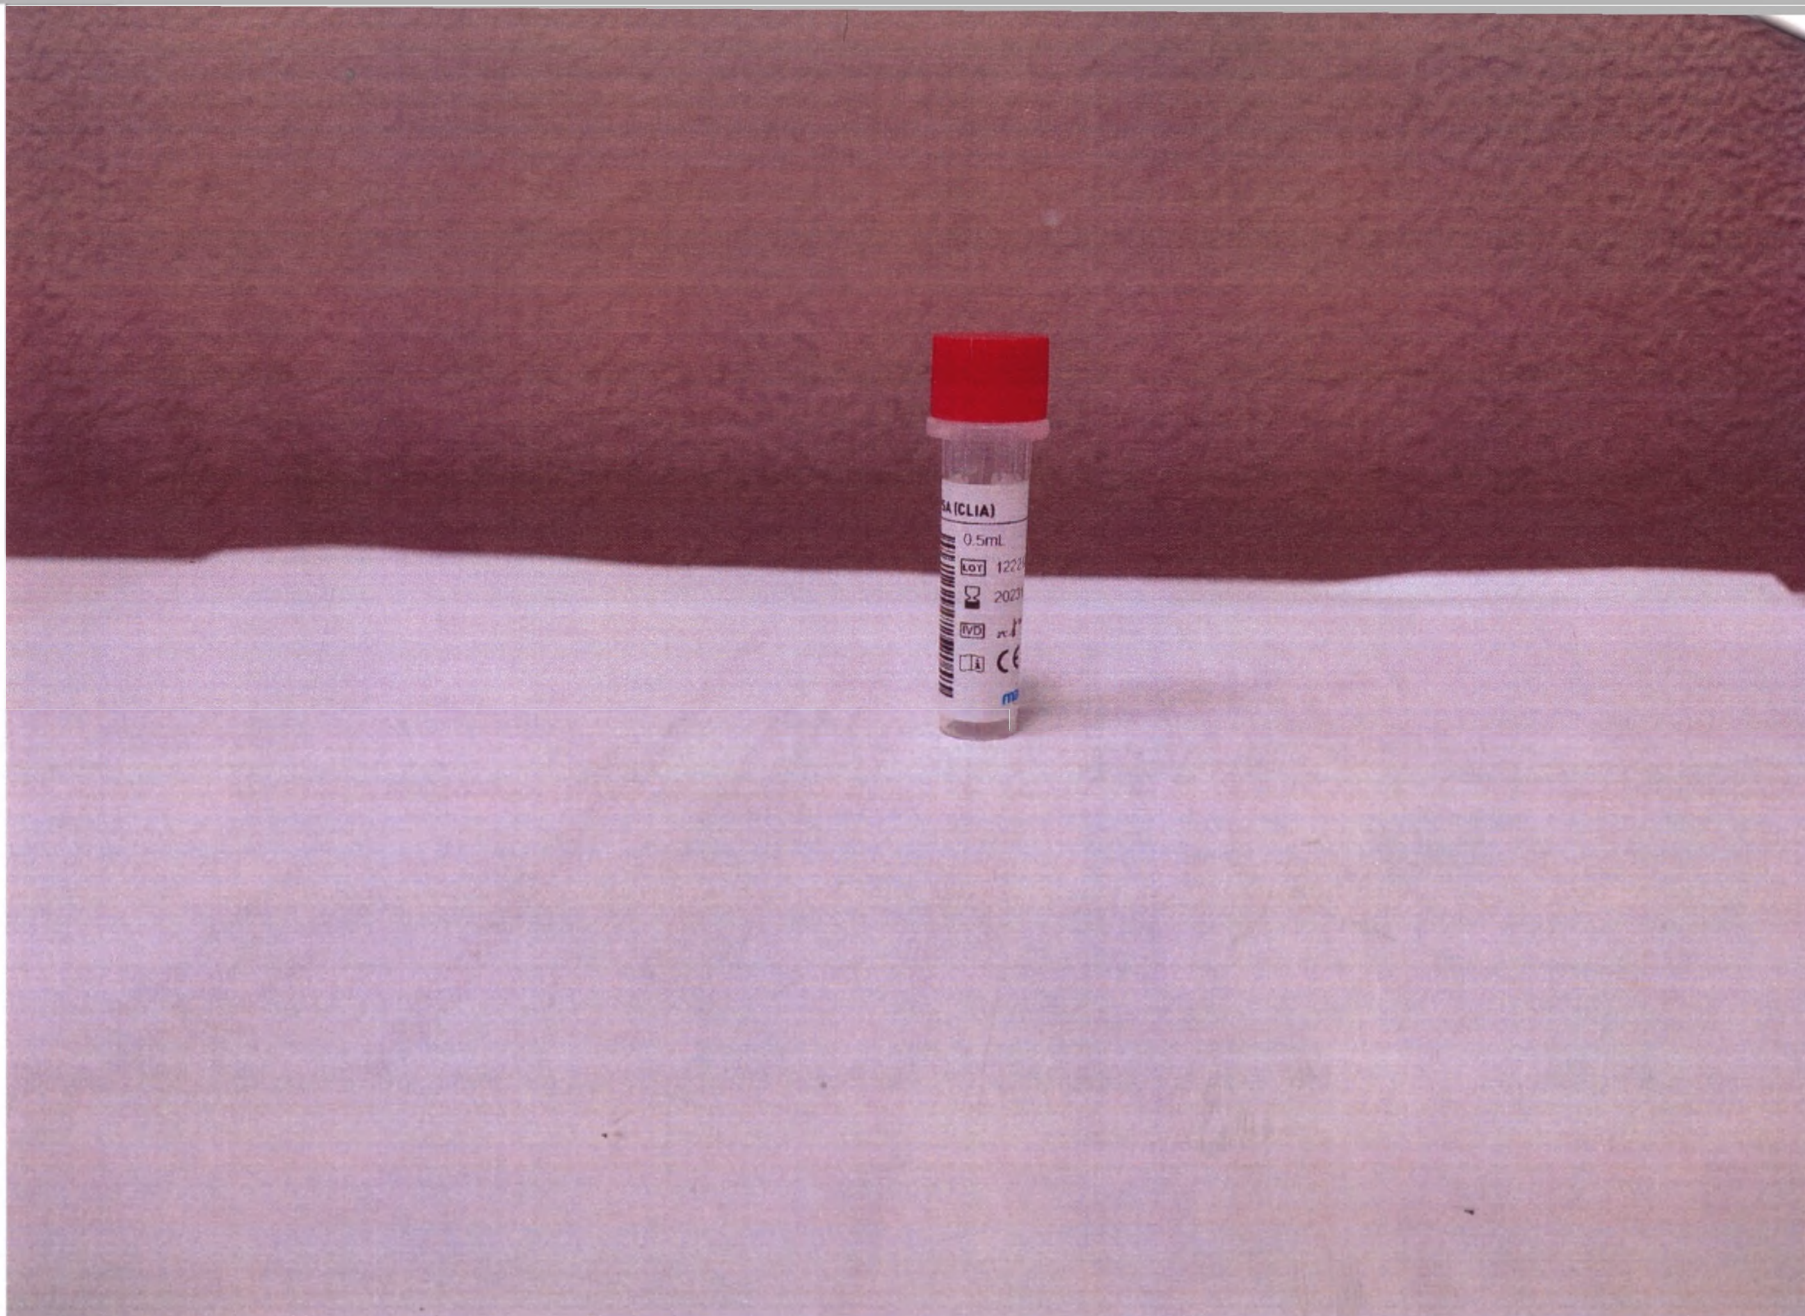

Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Massura i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2



Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Масскура i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3



**Внешний вид Инструмента для вскрытия картриджа «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения простатического специфического антигена свободного (ПСА свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Massura i (free PSA (CLIA)), набор на 200 тестов»**



Фото транспортной упаковки

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 16 листов

Р.К. Мелконьянц  
Директор ООО «Эвопром»

