

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Диатест»
Н.И. Сулягина
2023 г.






ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тест-полоски EasyTouch® для количественного определения общего холестерина в капиллярной крови человека на анализаторе крови портативном биохимическом EasyTouch® («Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch®»)

Вариант исполнения 1:

- Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch® - 25 шт.;
- Кодовая пластина - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.

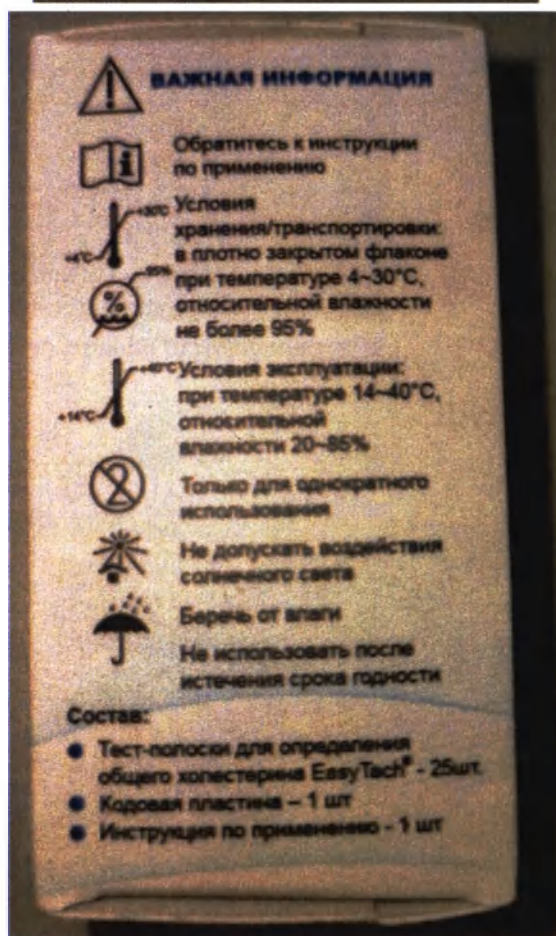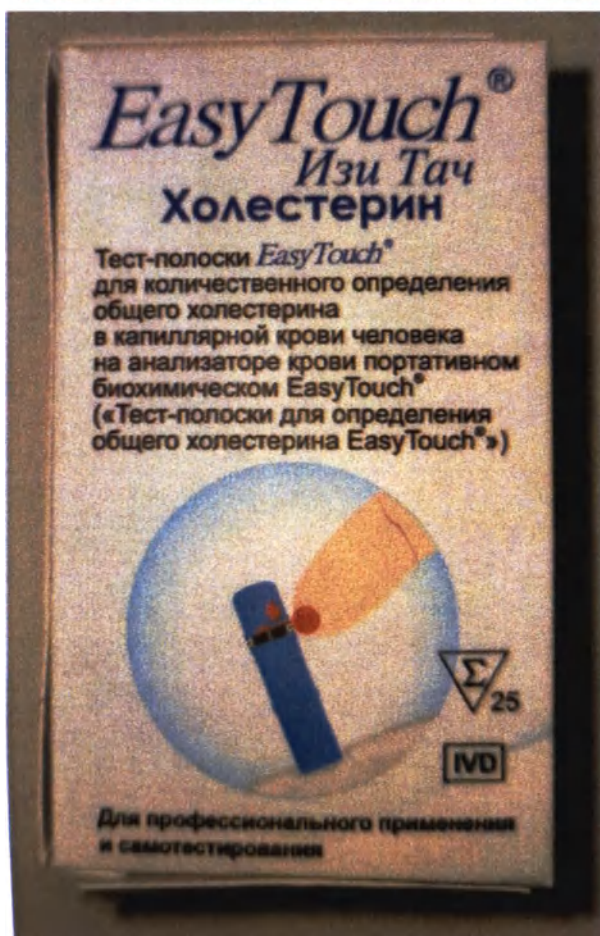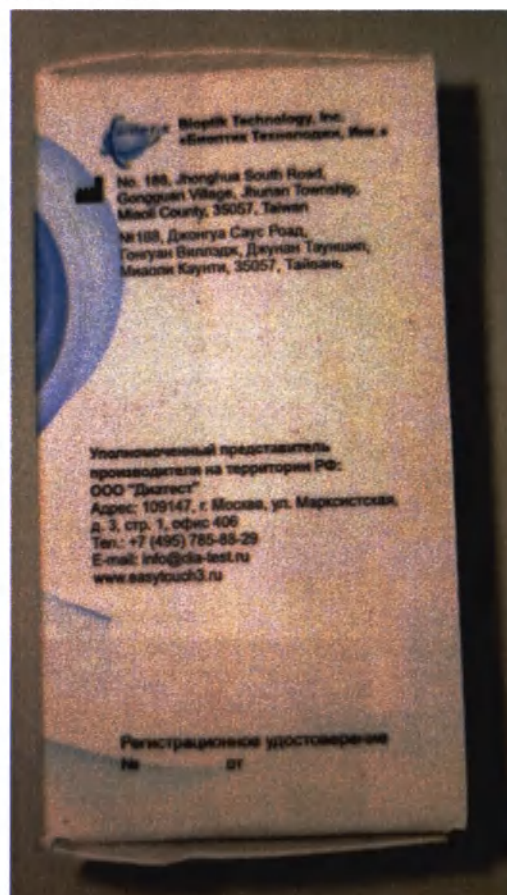


Общий вид и маркировка внешней упаковки

Вариант исполнения 1:

- Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch® - 25 шт.;
- Кодовая пластина - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.




Общий вид и маркировка внешней упаковки

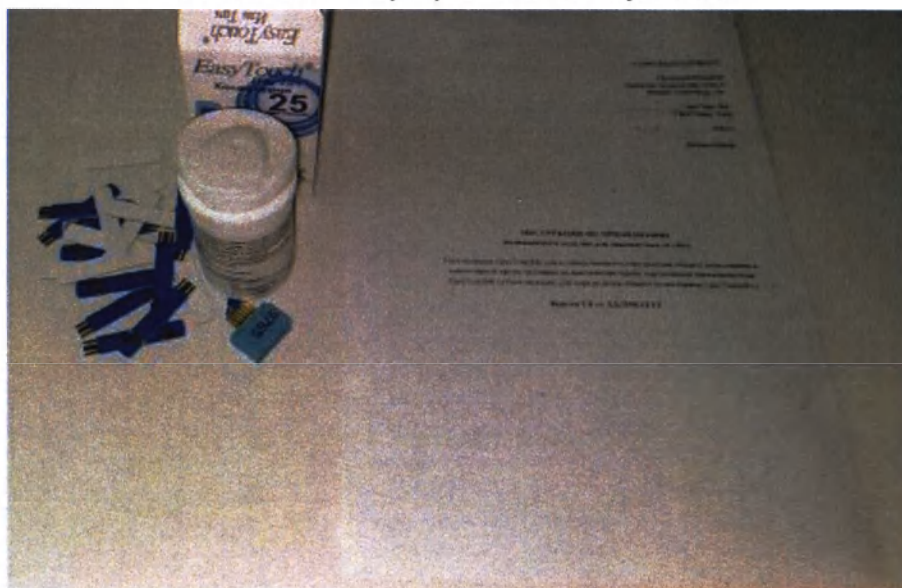


Содержимое внешней упаковки и инструкция по применению

Вариант исполнения 1:



- Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch® - 25 шт.;
- Кодовая пластина - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.

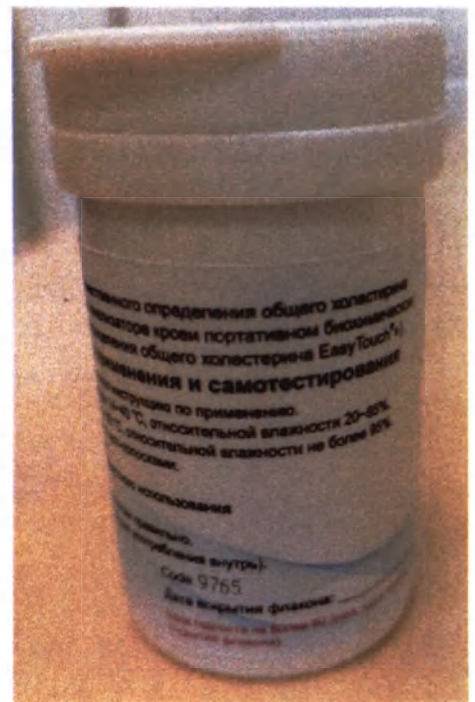

Маркировка флакона с тест-полосками

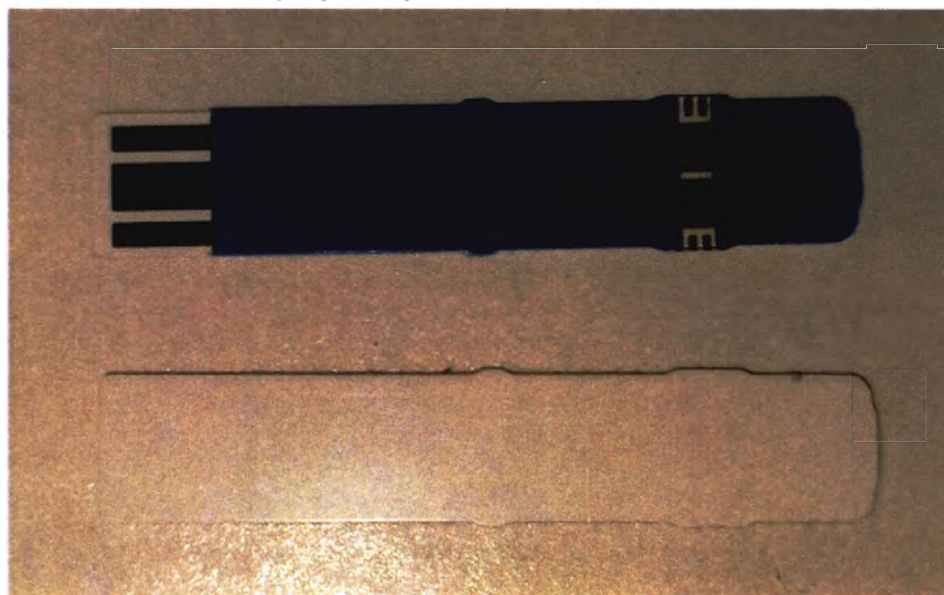

Внешний вид тест-полоски

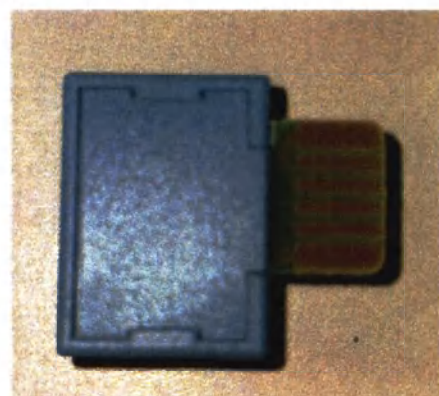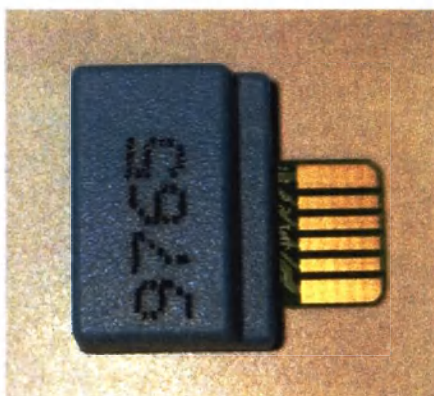

Внешний вид кодовой пластины

Вариант исполнения 2:

- Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch® - 10 шт.;
- Кодовая пластина - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.



Общий вид и маркировка внешней упаковки

Вариант исполнения 2:

- Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch® - 10 шт.;

- Кодовая пластина - 1 шт.;

- Инструкция по применению - 1 шт.



Общий вид и маркировка внешней упаковки

Вариант исполнения 2:

- Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch® - 10 шт.;
- Кодовая пластина - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.




Содержимое внешней упаковки




Маркировка и содержимое упаковки тестовой кассеты

Вариант исполнения 2:


- Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch® - 10 шт.;
- Кодовая пластина - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.

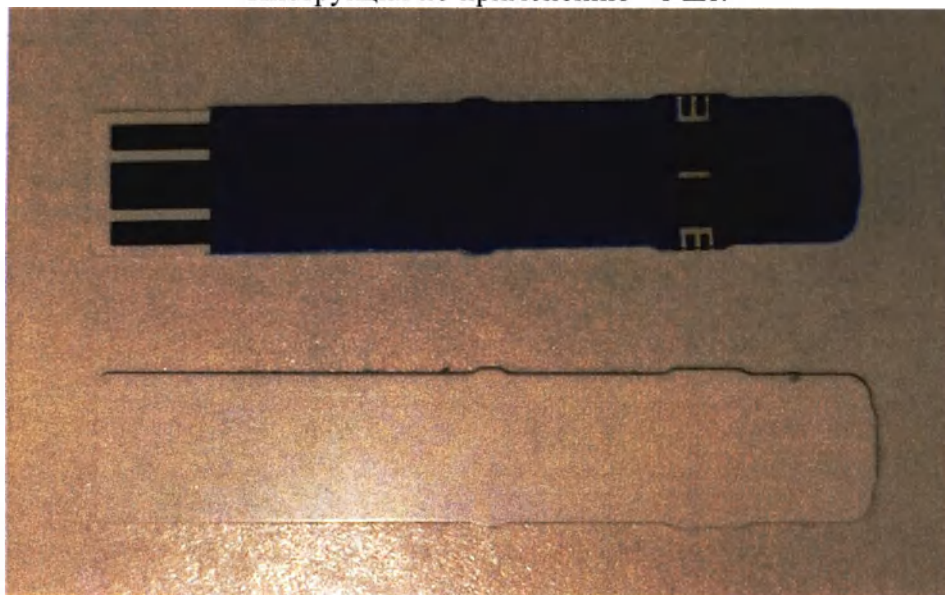

Внешний вид тестовой кассеты

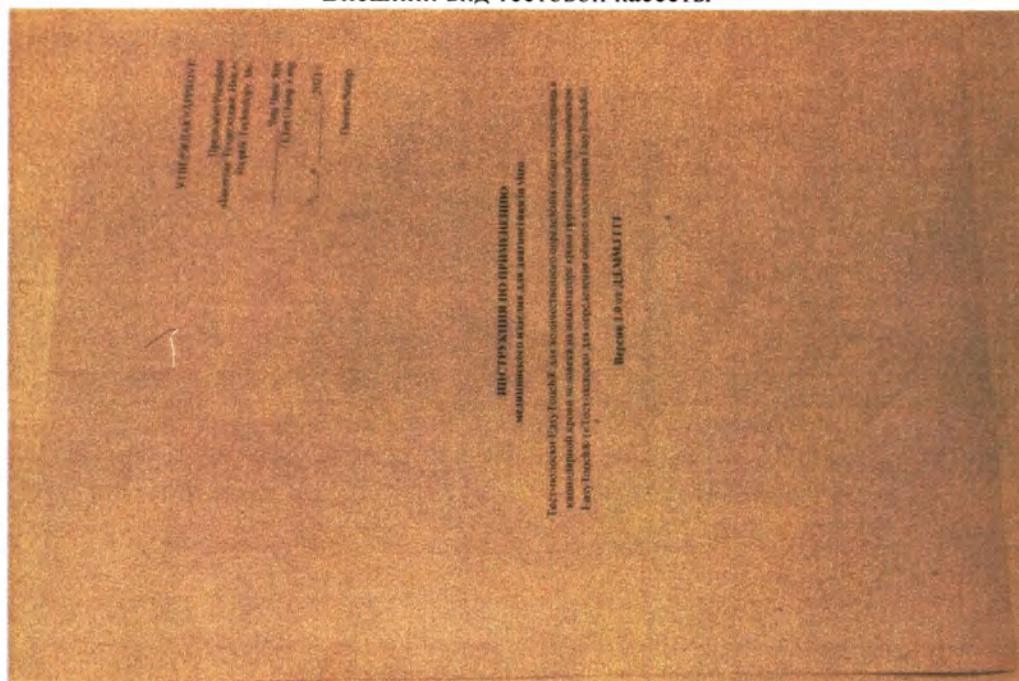

Инструкция по применению

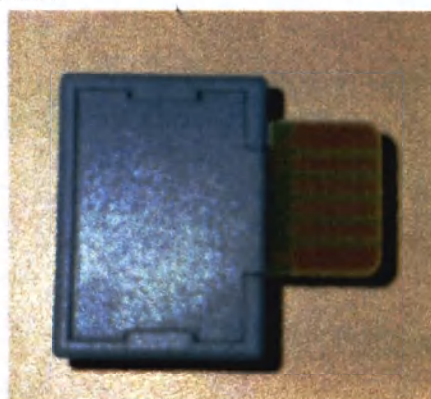

Внешний вид кодовой пластины

Вариант исполнения 3:


- Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch® - 5 шт.;
- Кодовая пластина - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.



Общий вид и маркировка внешней упаковки

Вариант исполнения 3:

- Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch® - 5 шт.;
- Кодовая пластина - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.

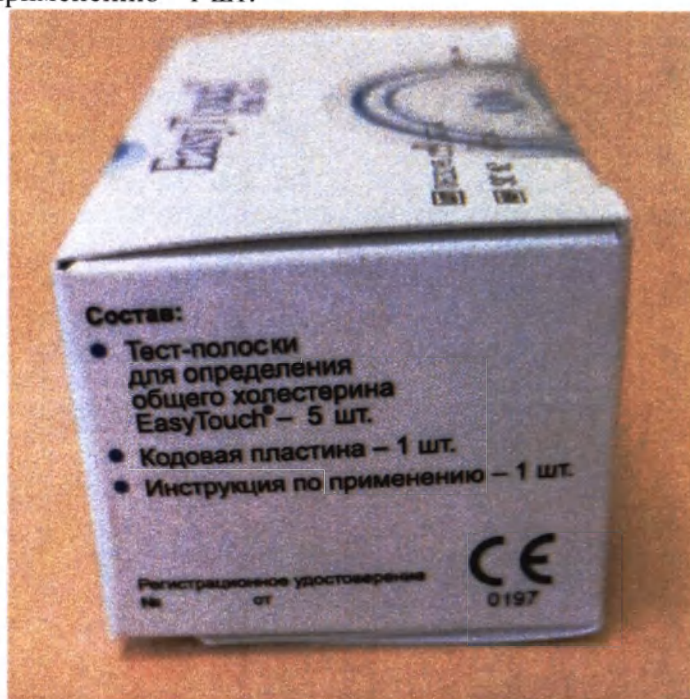


Общий вид и маркировка внешней упаковки

- Вариант исполнения 3:
- Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch® - 5 шт.;
 - Кодовая пластина - 1 шт.;
 - Инструкция по применению - 1 шт.




Содержимое внешней упаковки

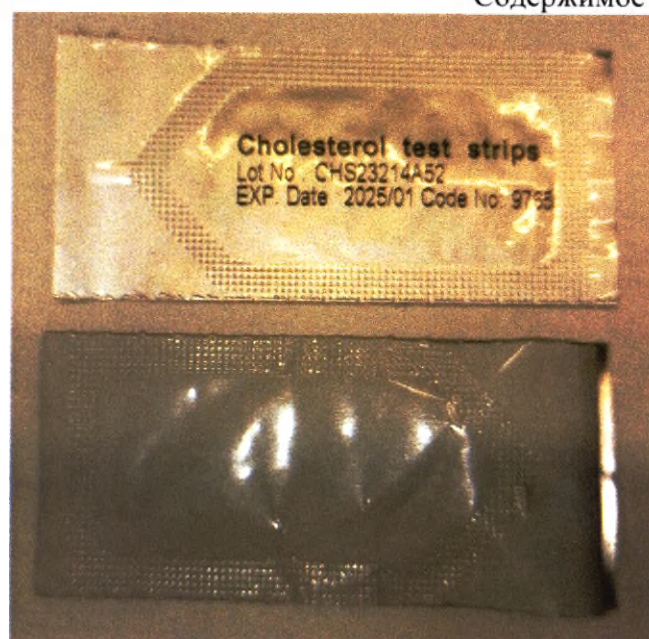


Маркировка и содержимое упаковки тестовой кассеты

Вариант исполнения 3:


- Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch® - 5 шт.;
- Кодовая пластина - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.

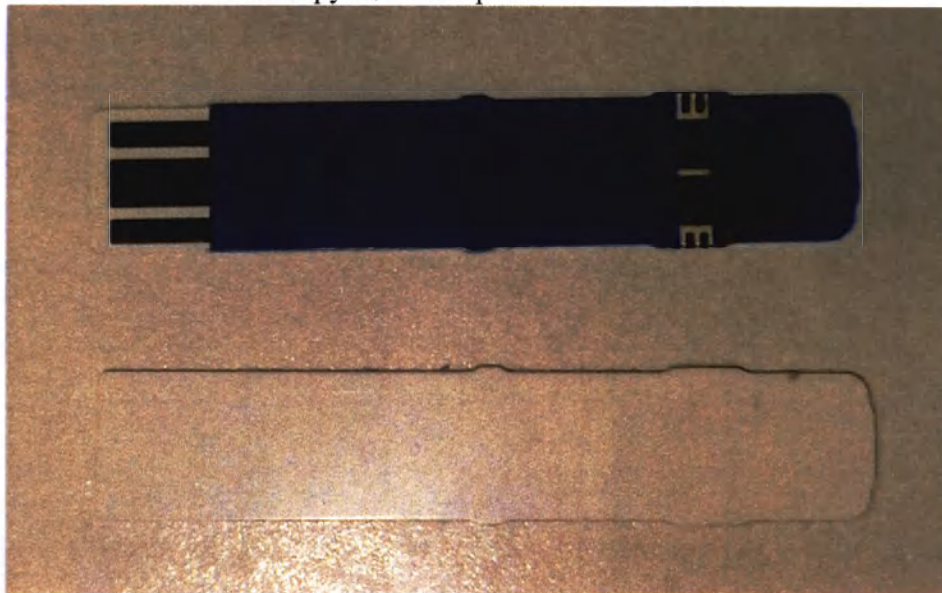

Внешний вид тестовой кассеты

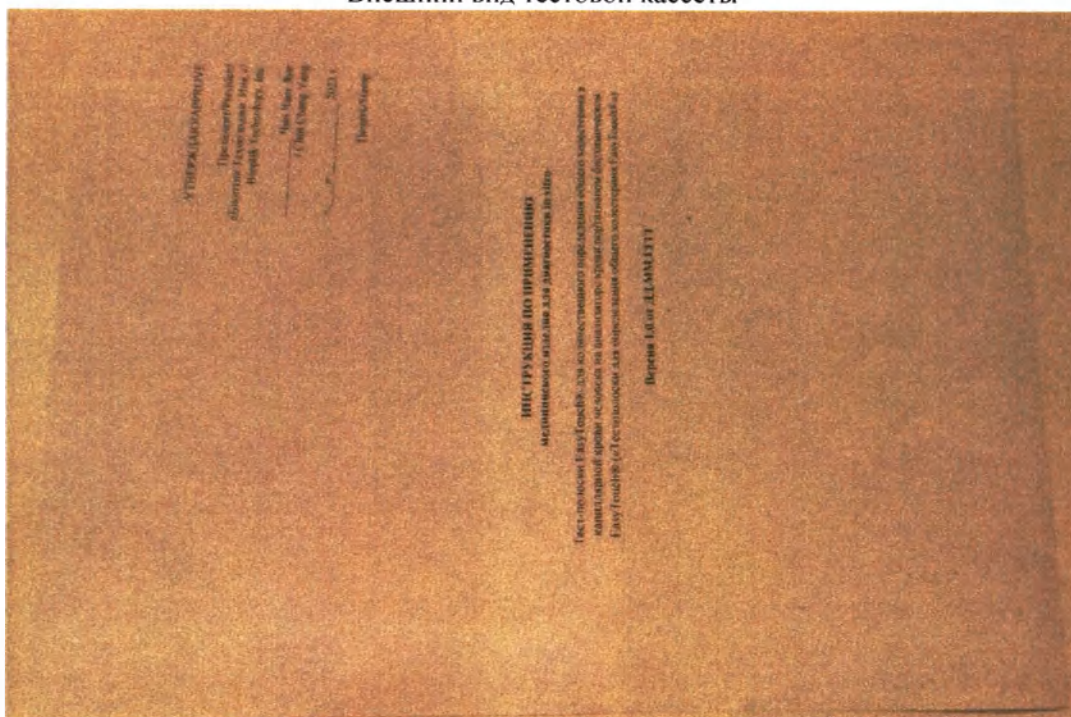




Инструкция по применению

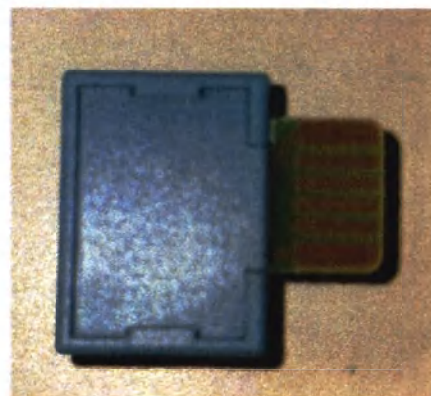

Внешний вид кодовой пластины

Вариант исполнения 4:

- Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch® - 2 шт.;
- Кодовая пластина - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.

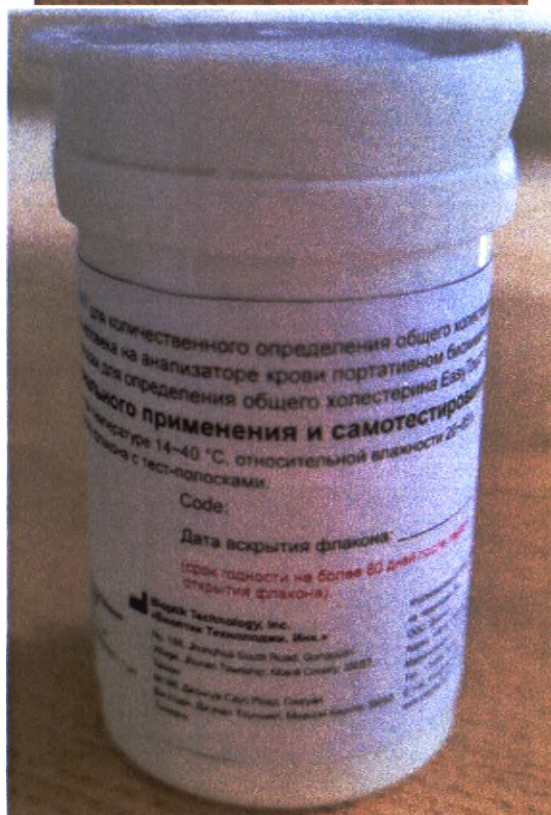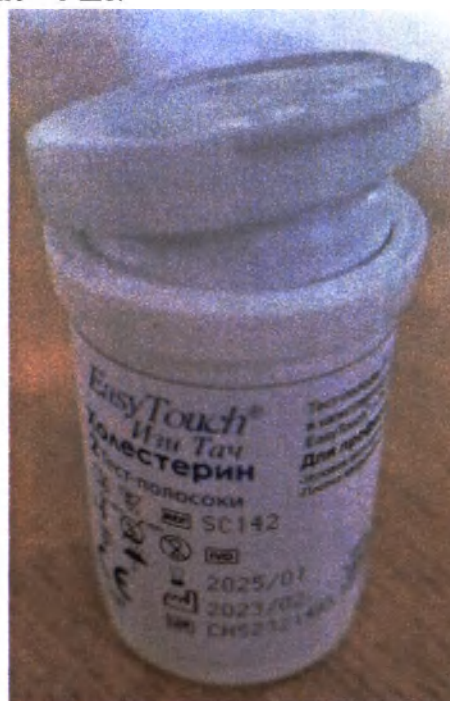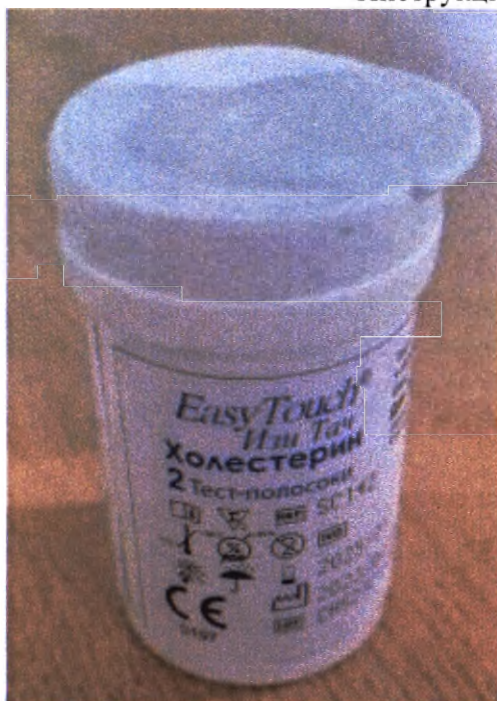


Общий вид и маркировка внешней упаковки

Вариант исполнения 4:

- Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch® - 2 шт.;
- Кодовая пластина - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.




Содержимое внешней упаковки

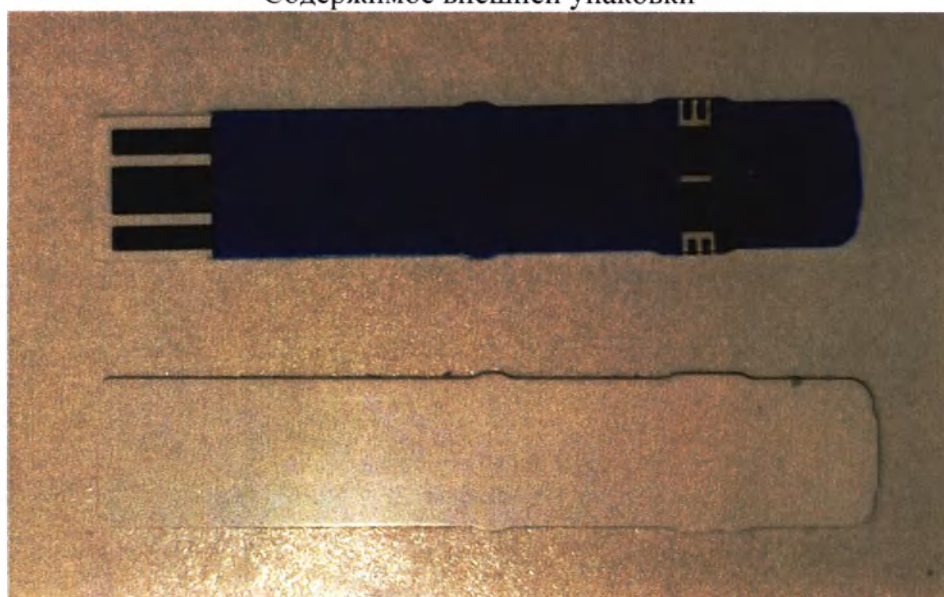


Внешний вид тестовой кассеты

Вариант исполнения 4:

- Тест-полоски для определения общего холестерина EasyTouch® - 2 шт.;
- Кодовая пластина - 1 шт.;
- Инструкция по применению - 1 шт.

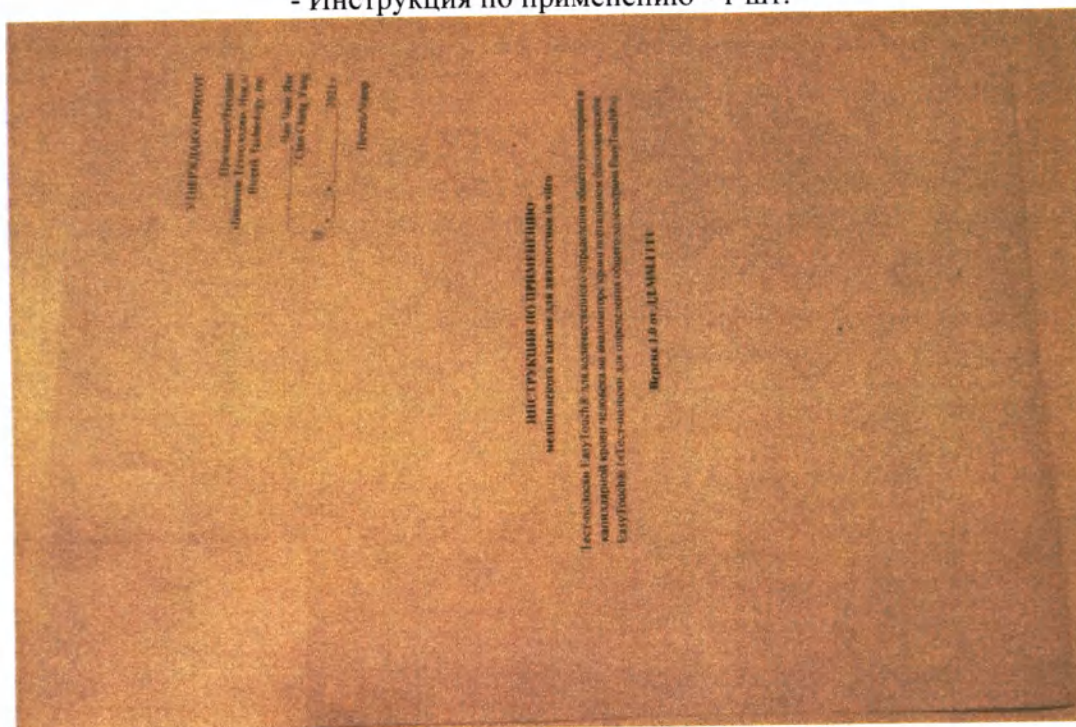

Инструкция по применению

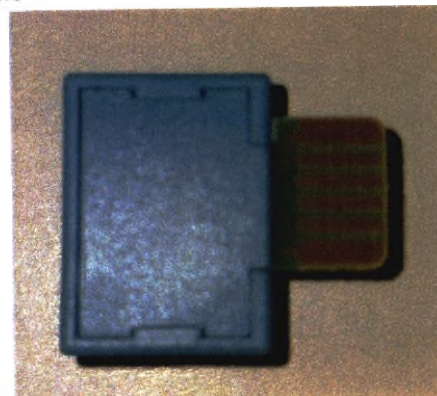

Внешний вид кодовой пластины

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью ООО «Диатест» 15

(пятидесятъ) листов

Генеральный директор

Сутягина Н.И.

