

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПКМед»

Е.В. Кузьмина

« 01 » декабря 2020 г.



ЭТИКЕТКА

Маркер для визуализации местоположения опухоли «ПКМед» одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-001-43254975-2020 в составе:

- 1. Игла 22G/150 с предустановленным в нее маркером - 1 шт.**
- 2. Ручка иглы - 1 шт.**
- 3. Ограничитель иглы - 1 шт.**
- 4. Мандрен - 1 шт.**
- 5. Ручка мандрена - 1 шт.**
- 6. Ограничитель маркера - 1 шт.**
- 7. Защитная трубка - 1 шт.**

Индивидуальная/Стерилизационная упаковка
Маркер для визуализации местоположения опухоли
«ПКМед» одноразовый стерильный

ТУ 32.50.50-001-43254975-2020

Маркер «ПКМед», в составе:

1. Игла 22G/150 с предустановленным в нее маркером - 1 шт.
2. Ручка иглы - 1 шт.
3. Ограничитель иглы - 1 шт.
4. Мандрен - 1 шт.
5. Ручка мандрена - 1 шт.
6. Ограничитель маркера - 1 шт.
7. Защитная трубка - 1 шт.

Регистрационное удостоверение №.....от.....

Стерильно. Не токсично.



LOT



Годен до :

Штамп ОТК

Сделано в России

ООО «ПКМед» 347360 Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск ул. 30 лет Победы 20. Оф. 314

E-mail: pkmed@yandex.ru

Тел: +79888942193



Условия хранения: Хранить при температуре от 0 до +40 °C и относительной влажности не выше 80%.

Утилизация и уничтожение: Маркер, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, утилизируется по классу Б, СанПиН 2.1.7.2790. Неиспользованные маркеры по классу А по СанПиН 2.1.7.2790). Предварительно должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твёрдые бытовые отходы.

Сделано в России

ООО "ПКМед"

**Маркер для визуализации
местоположения опухоли
"ПКМед"**

одноразовый стерильный

ТУ 32.50.50-001-43254975-2020

Регистрационное удостоверение №.....от....

Стерильно, нетоксично.

Не использовать после окончания срока
годности.



LOT

1

STERILE R



03.2020

Штамп ОТК 01

Годен до: 03.2023г.

Маркер «ПКМед», в составе:

1. Игла 22G/150 с предустановленным в нее маркером - 1 шт.
2. Ручка иглы - 1 шт.
3. Ограничитель иглы - 1 шт.
4. Мандрен - 1 шт.
5. Ручка мандрена - 1 шт.
6. Ограничитель маркера - 1 шт.
7. Защитная трубка - 1 шт.

Утилизация и уничтожение: Маркер, имевший контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, утилизируется по классу Б, СанПиН 2.1.7.2790. Неиспользованные маркеры по классу А по СанПиН 2.1.7.2790).

Предварительно должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.

ООО "ПКМед" 347360, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск ул. 30 лет Победы 20. оф. 314



Условия хранения: Хранить при температуре от +0 до +40 °C и относительной влажности не выше 80%.

ООО "ПКМед" 347360, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск ул. 30 лет Победы 20. оф. 314

Групповая упаковка

Маркер для визуализации местоположения опухоли «ПКМед» одноразовый стерильный

ТУ 32.50.50-001-43254975-2020

Маркер «ПКМед» в составе:

1. Игла 22G/150 с предустановленным в нее маркером - 1 шт.
2. Ручка иглы - 1 шт.
3. Ограничитель иглы - 1 шт.
4. Мандрен - 1 шт.
5. Ручка мандрена - 1 шт.
6. Ограничитель маркера - 1 шт.
7. Защитная трубка - 1 шт.

Регистрационное удостоверение №.....от.....

Количество: 4 шт.

Стерильно. Не токсично.



LOT



Годен до :

Штамп ОТК

Сделано в России

ООО «ПКМед» 347360 Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск ул. 30 лет Победы 20. Оф. 314

E-mail: pkmed@yandex.ru

Тел: +79888942193



Условия хранения: Хранить при температуре от 0 до +40 °C и относительной влажности не выше 80%.

Утилизация и уничтожение: Маркер, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, утилизируется по классу Б, СанПиН 2.1.7.2790. Неиспользованные маркеры по классу А по СанПиН 2.1.7.2790). Предварительно должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твёрдые бытовые отходы.

МАРКЕР ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОПУХОЛИ «ПКМЕД»


одноразовый стерильный

Количество
4 шт.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Маркер «ПКМед», в составе:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Игла 22G/150 с предустановленным в нее маркером - 1 шт. | 4. Мандрен - 1 шт. |
| 2. Ручка иглы - 1 шт. | 5. Ручка мандрена - 1 шт. |
| 3. Ограничитель иглы - 1 шт. | 6. Ограничитель маркера - 1 шт. |
| | 7. Защитная трубка - 1 шт. |



Не использовать, если не
окончана трубка голубой из




Условия хранения: Хранить при температуре от +0° до +40°С и относительной влажности не выше 80%.

Утилизация и уничтожение: Маркер, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, утилизируется по классу Б, СанПиН 2.1.7.2790. Неиспользованные маркеры по классу А по СанПиН 2.1.7.2790. Предварительно должны быть разрезаны с целью предотвращения их неадекватного применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.

Условия транспортирования:

Транспортировать при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не выше 100%.



Стерильно. Не токсично.

ТУ 32.50.50-001-43754975-2030 Регистрационное удостоверение № 0000000 от 00.00.000000.0000 г.

ООО «ПКМед»

547560 Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 20, офис 314.
Телефон +7-988-894-21-93 • E-mail: pkmed@yandex.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

Транспортная упаковка

Маркер для визуализации местоположения опухоли «ПКМед» одноразовый стерильный

ТУ 32.50.50-001-43254975-2020



LOT

Кол-во упаковок — _____ шт

Кол-во изделий — _____ шт

Срок годности 3 года.



Годен до :

ООО «ПКМед» 347360 Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск ул. 30 лет Победы 20. Оф. 314

E-mail: pkmed@yandex.ru, Тел: +79888942193

Условия хранения: Хранить при температуре от 0 до +40 °C и относительной влажности не выше 80%.

Транспортировать при температуре от минус 50°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 100%

**Маркер для визуализации местоположения опухоли «ПКМед»
одноразовый стерильный ТУ 32.50.50-001-43254975-2020**



количество групповых упаковок – 5 уп.
общее количество изделий – 20 шт.

LOT

1



03.2020

Годен до : 03.2023

STERILE


R

ООО «ПКМед» 347360 Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск ул. 30 лет Победы 20. Оф. 314
E-mail: pkmed@yandex.ru , Тел: +79888942193


Условия хранения: Хранить при температуре от +0 до +40 С и относительной влажности не выше 80%.

Транспортировать при температуре от -50С до +50С и относительной влажности не выше 100%.

Сшито и заверено печатью 9
(Северная) лист ев
000
ДИРЕКТОР ООО «ПКМЕД»
Кузьмина Е.В.

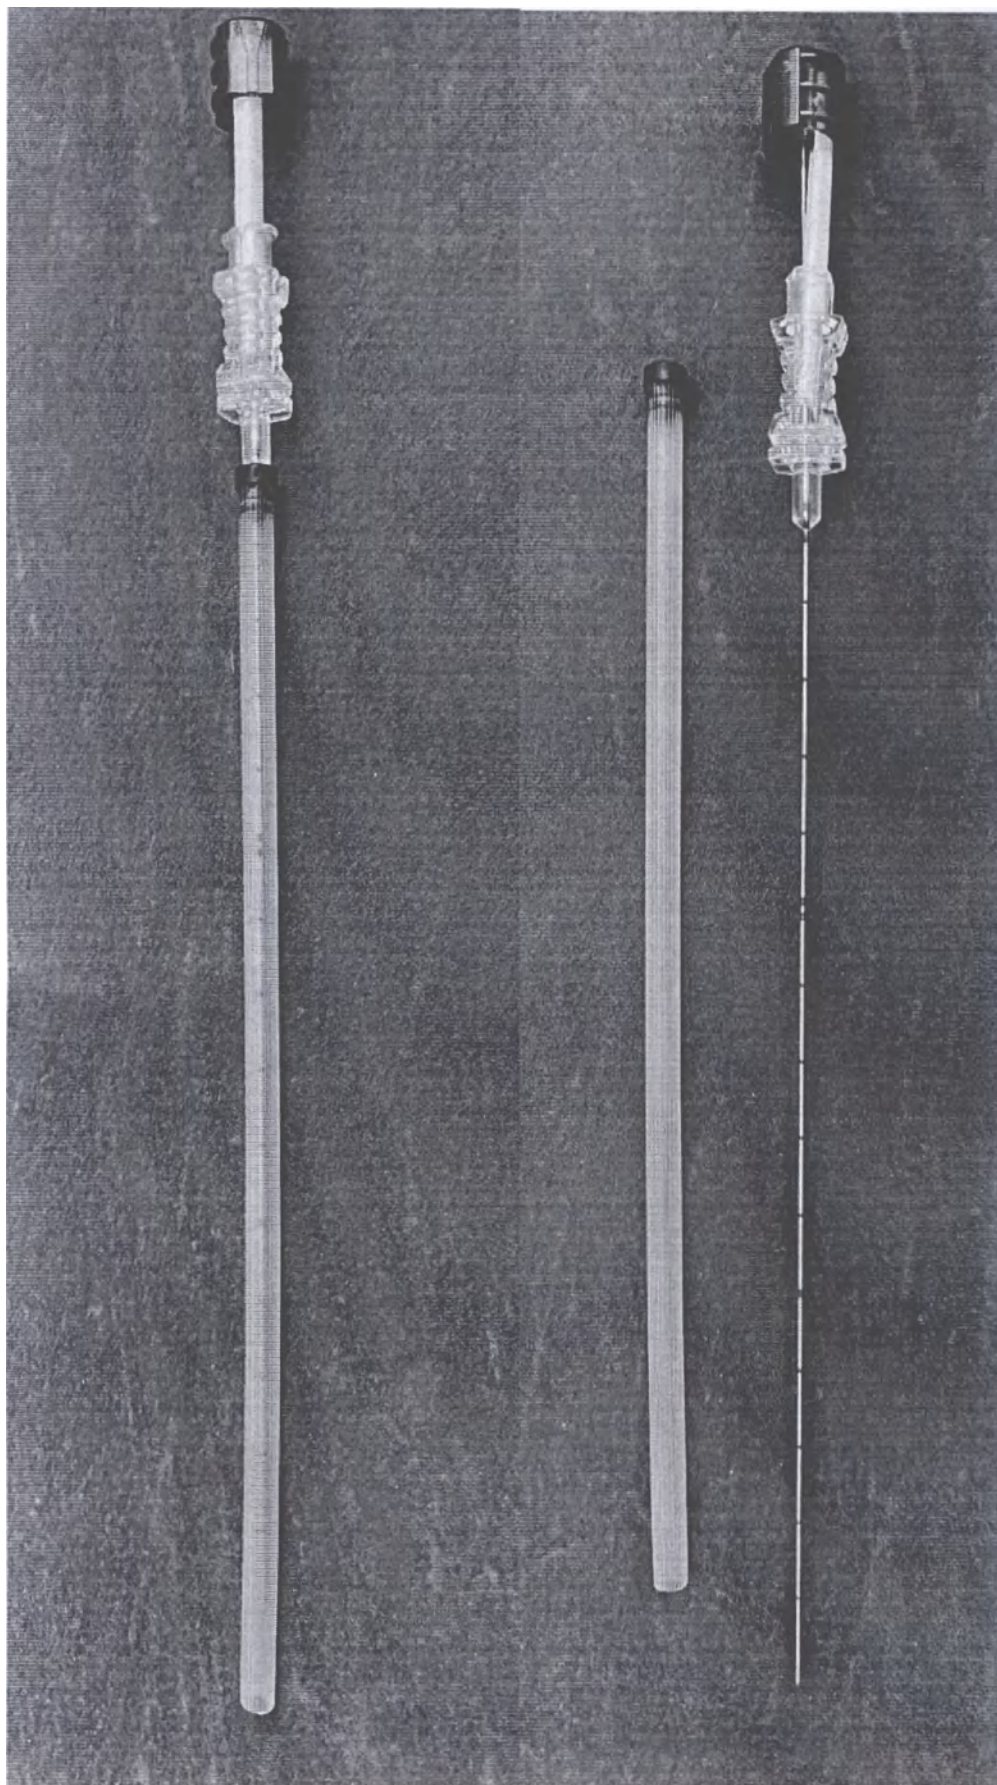


Общий вид медицинского изделия: Маркер для визуализации местоположения опухоли «ПКМед» одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-001-43254975-2020

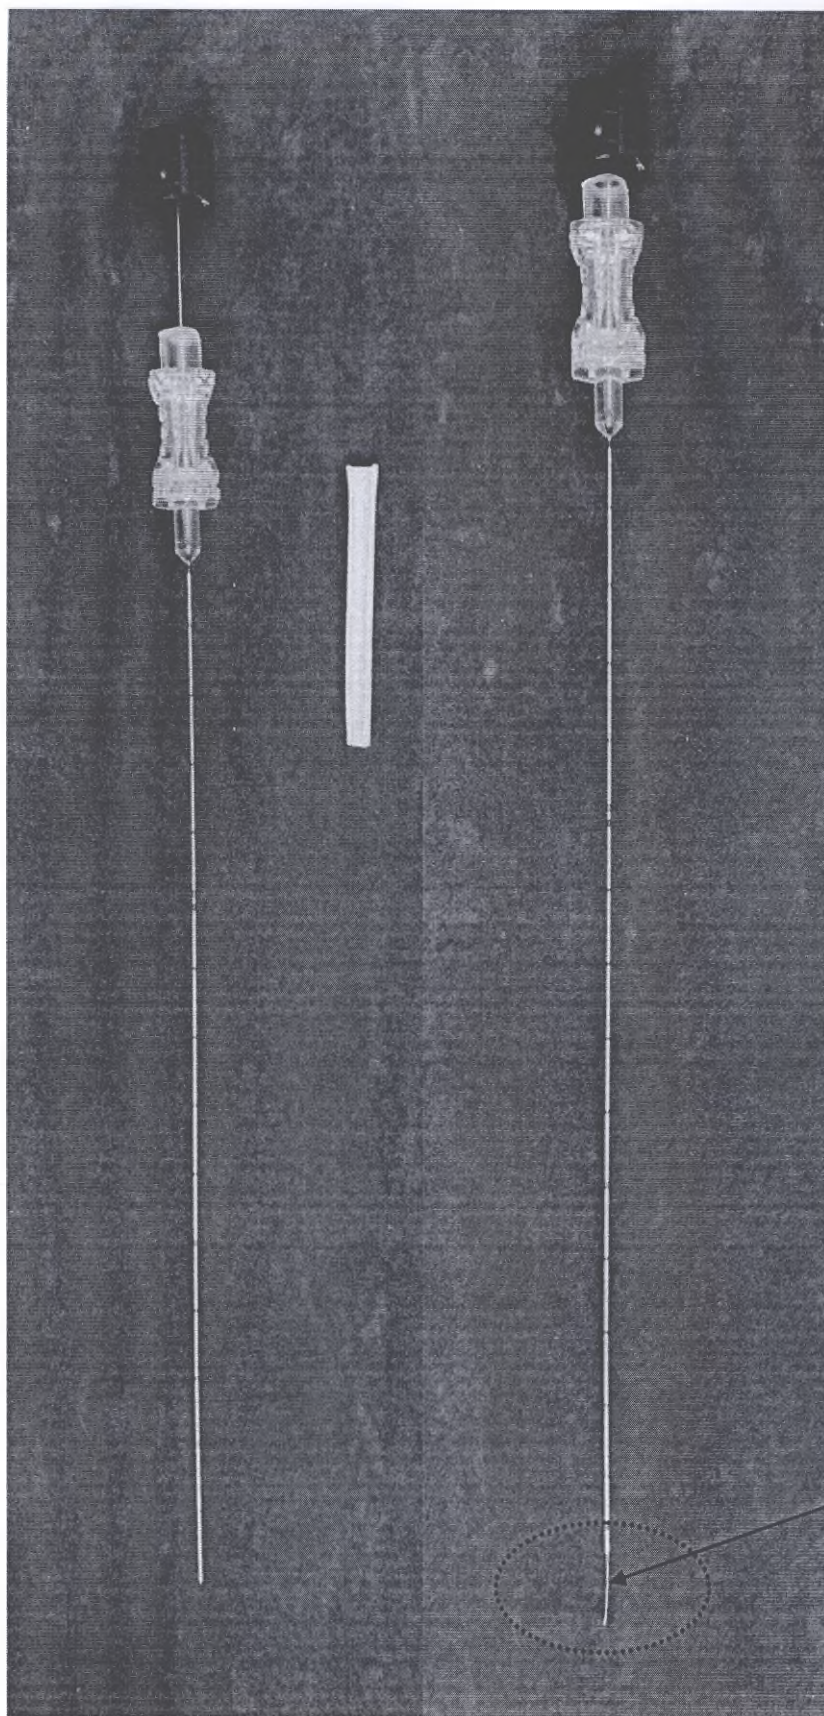


маркер

*Общий вид медицинского изделия: Маркер для визуализации местоположения опухоли
«ПКМед» одноразовый стерильный по TV 32.50.50-001-43254975-2020*

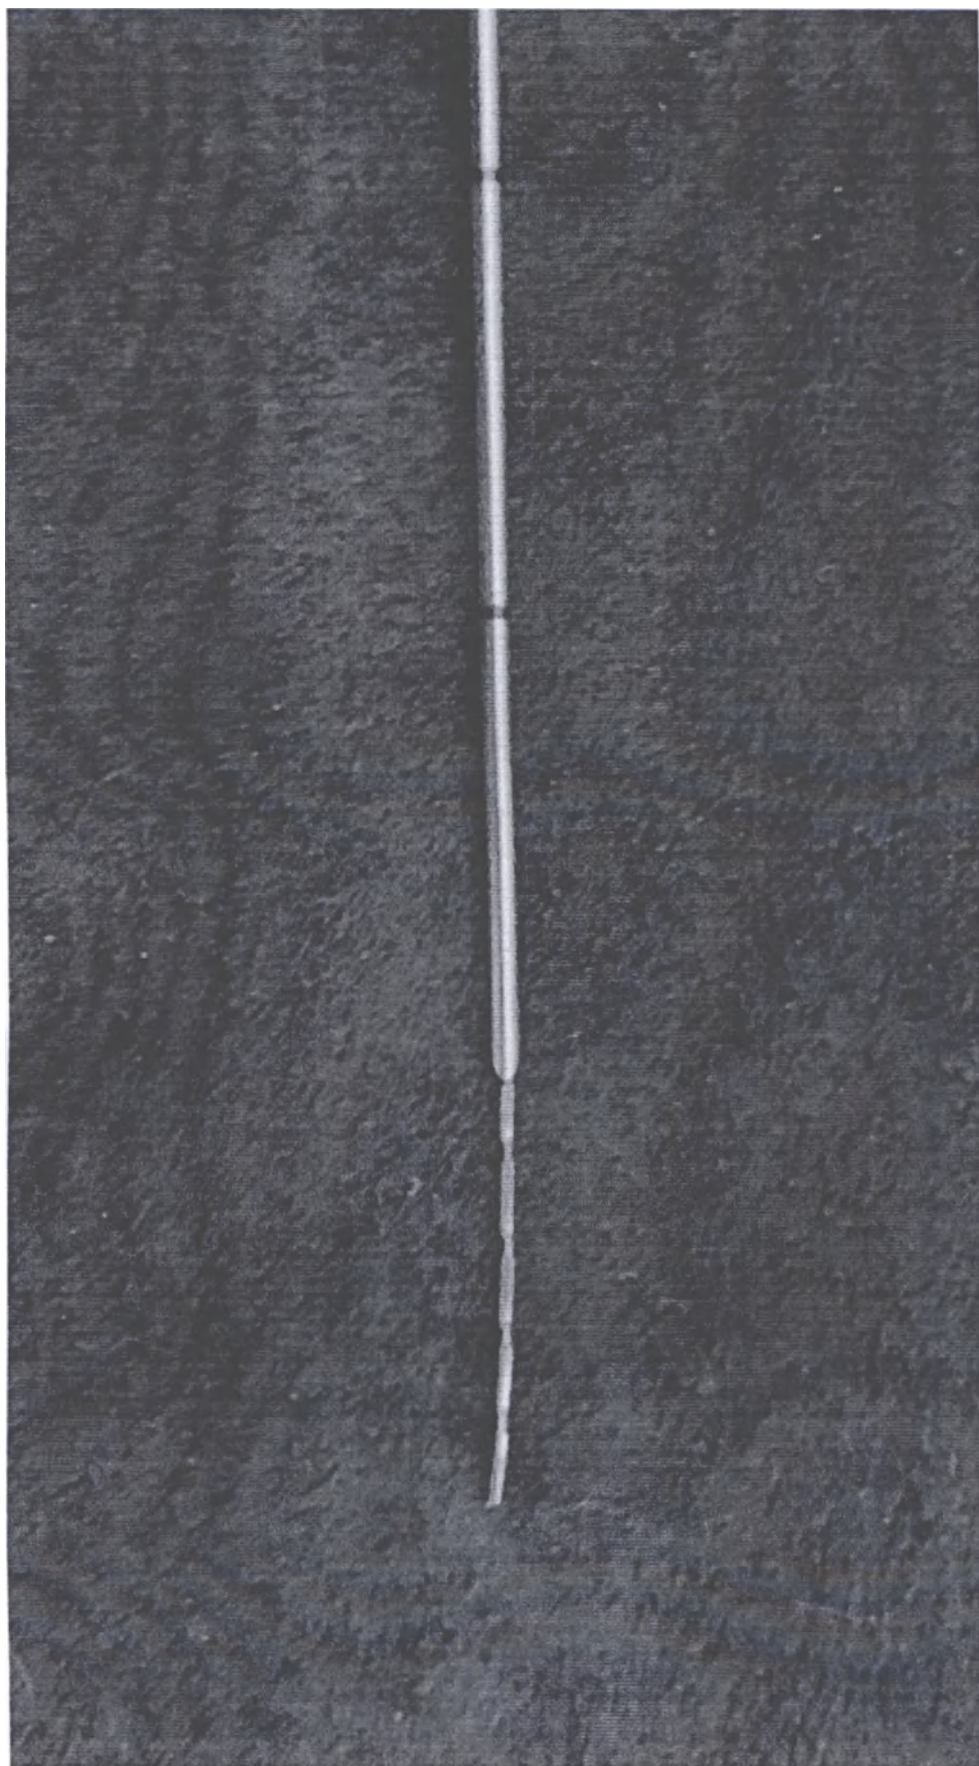

Общий вид медицинского изделия: Маркер для визуализации местоположения опухоли «ПКМед» одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-001-43254975-2020 (игла с маркером)

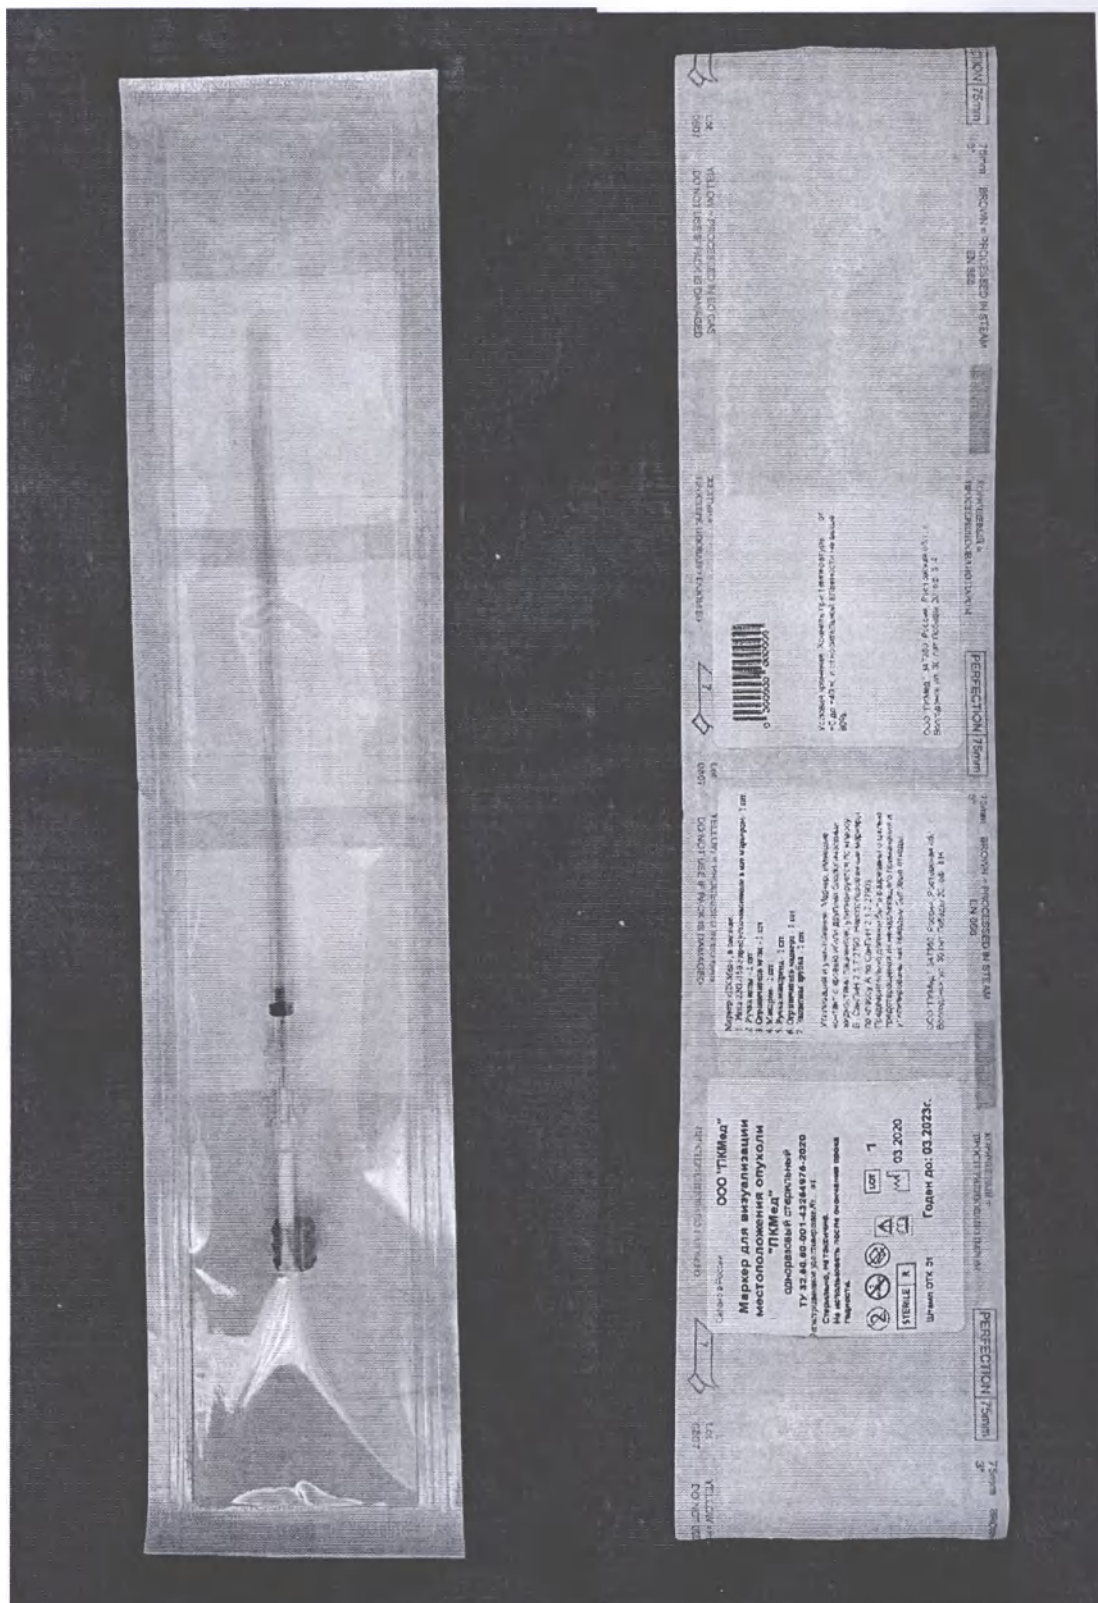

Общий вид стерилизационной упаковки медицинского изделия: Маркер для визуализации местоположения опухоли «ПКМед» одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-001-43254975-2020

Сделано в России

ООО "ПКМед"

**Маркер для визуализации
местоположения опухоли
"ПКМед"**

одноразовый стерильный

ТУ 32.50.50-001-43254975-2020

Регистрационное удостоверение №.....от....

Стерильно, нетоксично.

Не использовать после окончания срока
годности.



LOT

1

STERILE R



03.2020

Штамп ОТК 01

Годен до: 03.2023г.

Маркер «ПКМед», в составе:

1. Игла 22G/150 с предустановленным в нее маркером - 1 шт.
2. Ручка иглы - 1 шт.
3. Ограничитель иглы - 1 шт.
4. Мандрен - 1 шт.
5. Ручка мандрена - 1 шт.
6. Ограничитель маркера - 1 шт.
7. Защитная трубка - 1 шт.

Утилизация и уничтожение: Маркер, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, утилизируется по классу Б, СанПиН 2.1.7.2790. Неиспользованные маркеры по классу А по СанПиН 2.1.7.2790). Предварительно должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.

ООО "ПКМед" 347360, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск ул. 30 лет Победы 20. оф. 314



Условия хранения: Хранить при температуре от +0 до +40 °C и относительной влажности не выше 80%.

ООО "ПКМед" 347360, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск ул. 30 лет Победы 20. оф. 314

Маркировки стерилизационной упаковки медицинского изделия:

*Маркер для визуализации местоположения опухоли «ПКМед» одноразовый стерильный по
ТУ 32.50.50-001-43254975-2020*

МАРКЕР ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОПУХОЛИ «ПКМЕД»


одноразовый стерильный

Количество
4 шт.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Маркер «ПКМед», в составе:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Игла 22G/150 с предустановленным
в нее маркером - 1 шт. | 4. Мандрен - 1 шт. |
| 2. Ручка иглы - 1 шт. | 5. Ручка мандрена - 1 шт. |
| 3. Ограничитель иглы - 1 шт. | 6. Ограничитель маркера - 1 шт. |
| | 7. Защитная трубка - 1 шт. |



Не использовать после
окончания срока годности.




Условия хранения: Хранить при температуре от +0° до +40°С и относительной влажности не выше 80%.

Утилизация и уничтожение: Маркер, имевший контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, утилизируется по классу Б, СанПиН 2.1.7.2790. Неиспользованные маркеры по классу А по СанПиН 2.1.7.2790. Предварительно должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.

Условия транспортирования:

Транспортировать при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не выше 100%.



Стерильно. Не токсично.


ТУ 32.50.50-001-43254975-2020 Регистрационное удостоверение № 00000000 от 00.00.000000.0000 г.

ООО «ПКМед»

547500 Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 50 лет Победы, 20, офис 514.
Телефон +7-988-894-21-93 • E-mail: pkmed@yandex.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

Общий вид групповой упаковки медицинского изделия: Маркер для визуализации местоположения опухоли «ПКМед» одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-001-43254975-2020

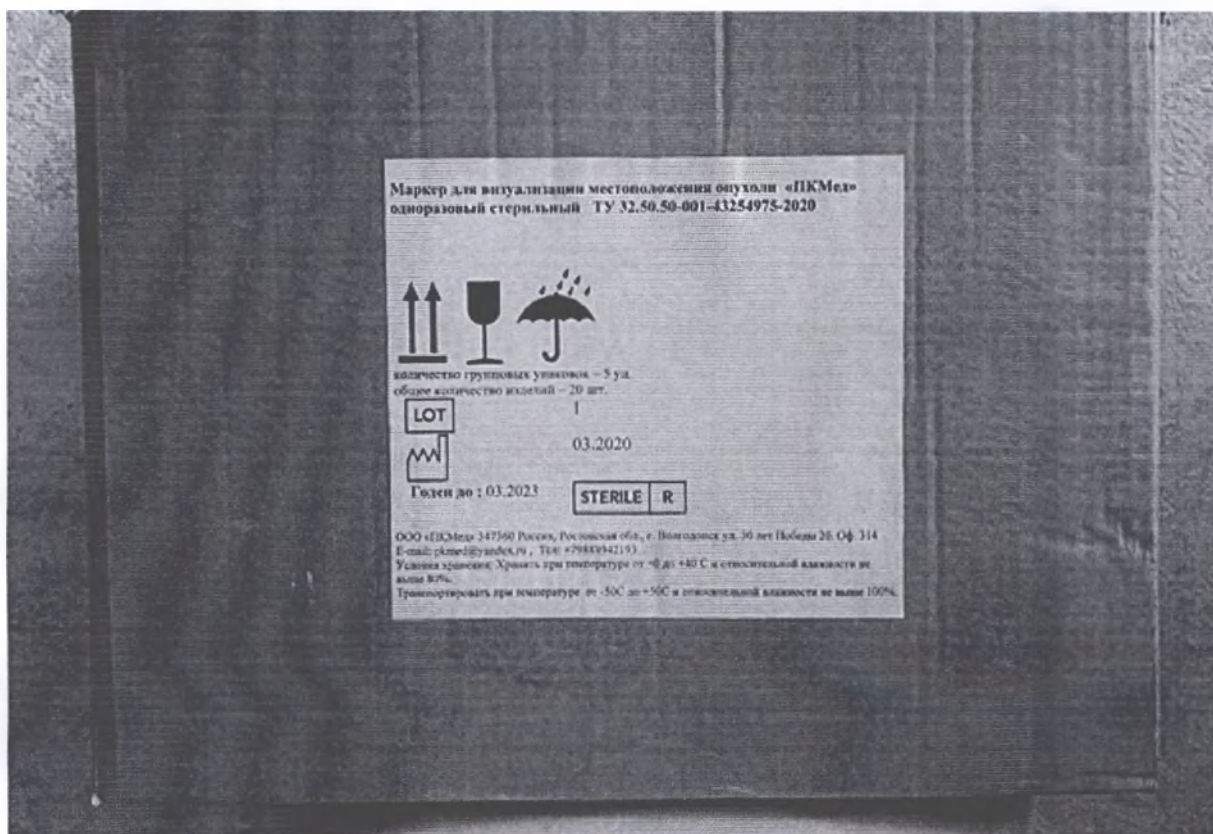

Общий вид транспортной упаковки медицинского изделия: Маркер для визуализации местоположения опухоли «ПКМед» одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-001-43254975-2020

**Маркер для визуализации местоположения опухоли «ПКМед»
одноразовый стерильный ТУ 32.50.50-001-43254975-2020**



количество групповых упаковок – 5 уп.
общее количество изделий – 20 шт.

LOT

1



03.2020

Гожен до : 03.2023

STERILE	R
---------	---

ООО «ПКМед» 347360 Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск ул. 30 лет Победы 20. Оф. 314
E-mail: pkmed@yandex.ru , Тел: +79888942193

Условия хранения: Хранить при температуре от +0 до +40 С и относительной влажности не выше 80%.

Транспортировать при температуре от -50С до +50С и относительной влажности не выше 100%.

Маркировки транспортной упаковки медицинского изделия:

*Маркер для визуализации местоположения опухоли «ПКМед» одноразовый стерильный по
ТУ 32.50.50-001-43254975-2020*

Сшито и заверено печатью 8
(Беска) лист 6



ДИРЕКТОР ООО «ПКМЕД»
Кузьмина Е. В.