




**Фотографические изображения
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**«Набор реагентов для определения антигенов
Клостридиум диффициле глутаматдегидрогеназы + Токсина А + Токсина В
в образцах кала человека
методом иммунохроматографии
“CoproStrip Clostridium difficile GDH+ToxinA+ToxinB”».**

Производитель: «Савион Диагностикас Лтд.», Израиль.

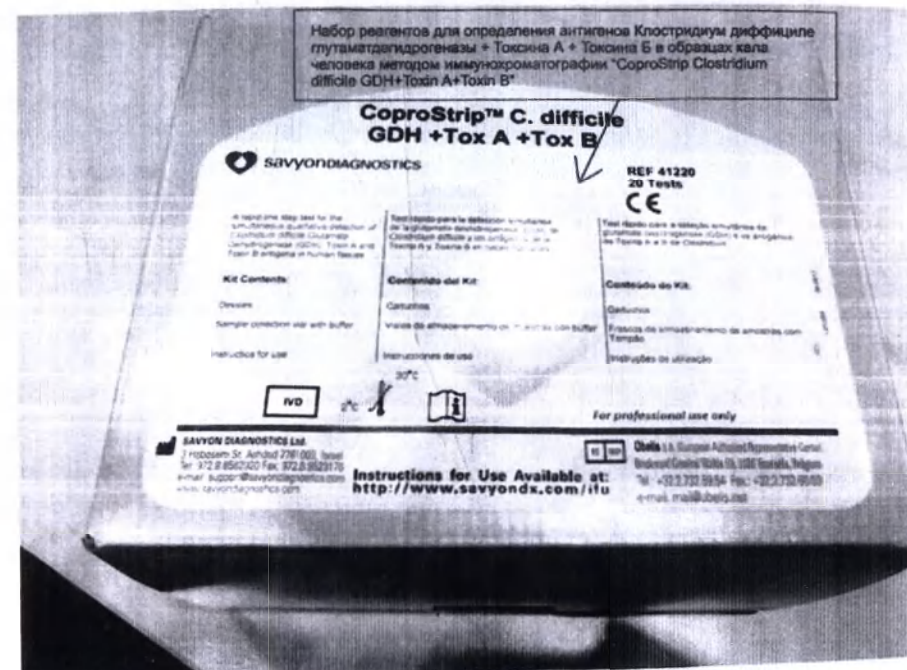

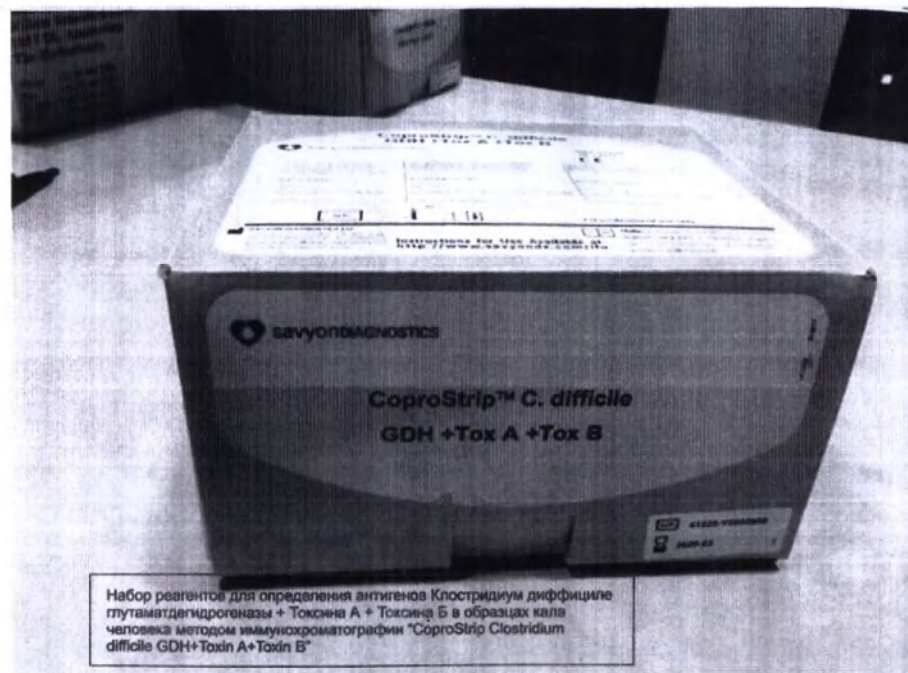

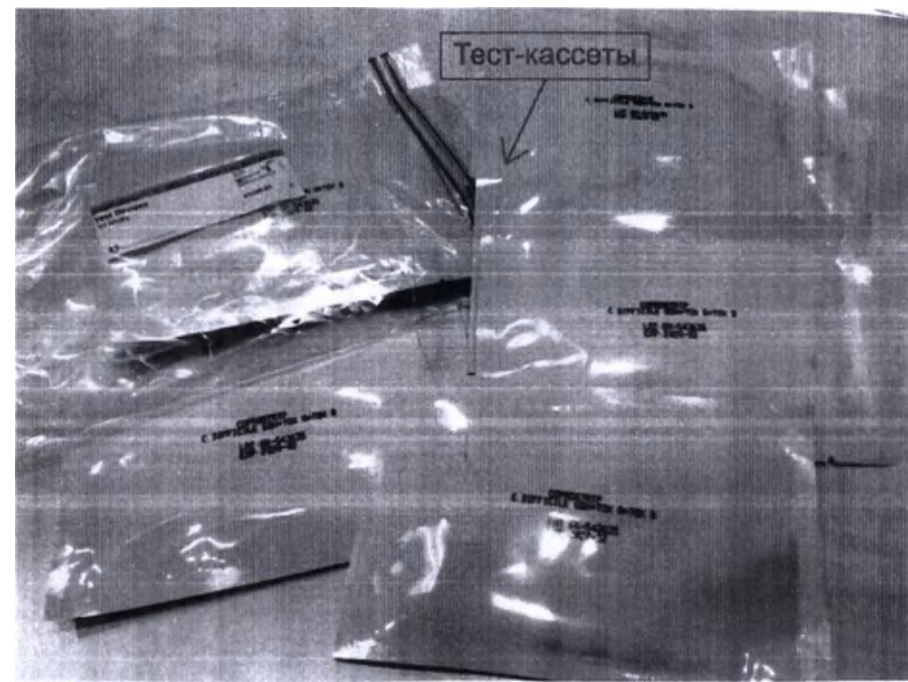

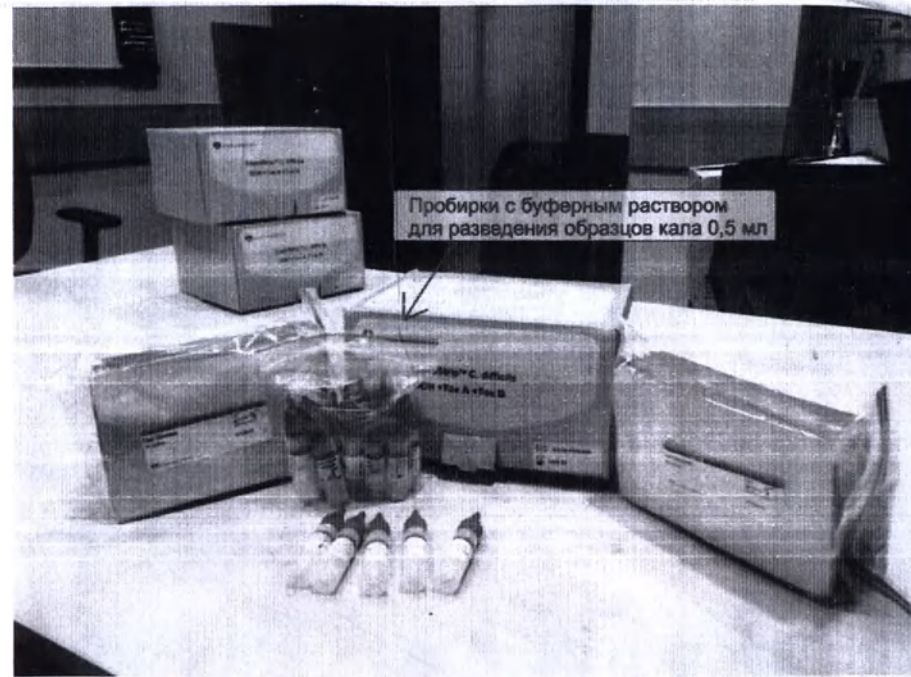

Тест-кассеты

C. difficile

GDH	Toxin A	Toxin B

0,78 u/cm
1 u/cm
1,56 u/cm

C. difficile

GDH	Toxin A	Toxin B

1,56 u/cm
2 u/cm
3,12 u/cm

Всего прошито и пронумеровано

11 листов
Генеральный директор

ЗАО "ВорхимМак"

Тамбовская область

г. Тамбов

г. Тамбов

г. Тамбов

г. Тамбов

г. Тамбов