

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ»
Морозов А.А.

"22" 04 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

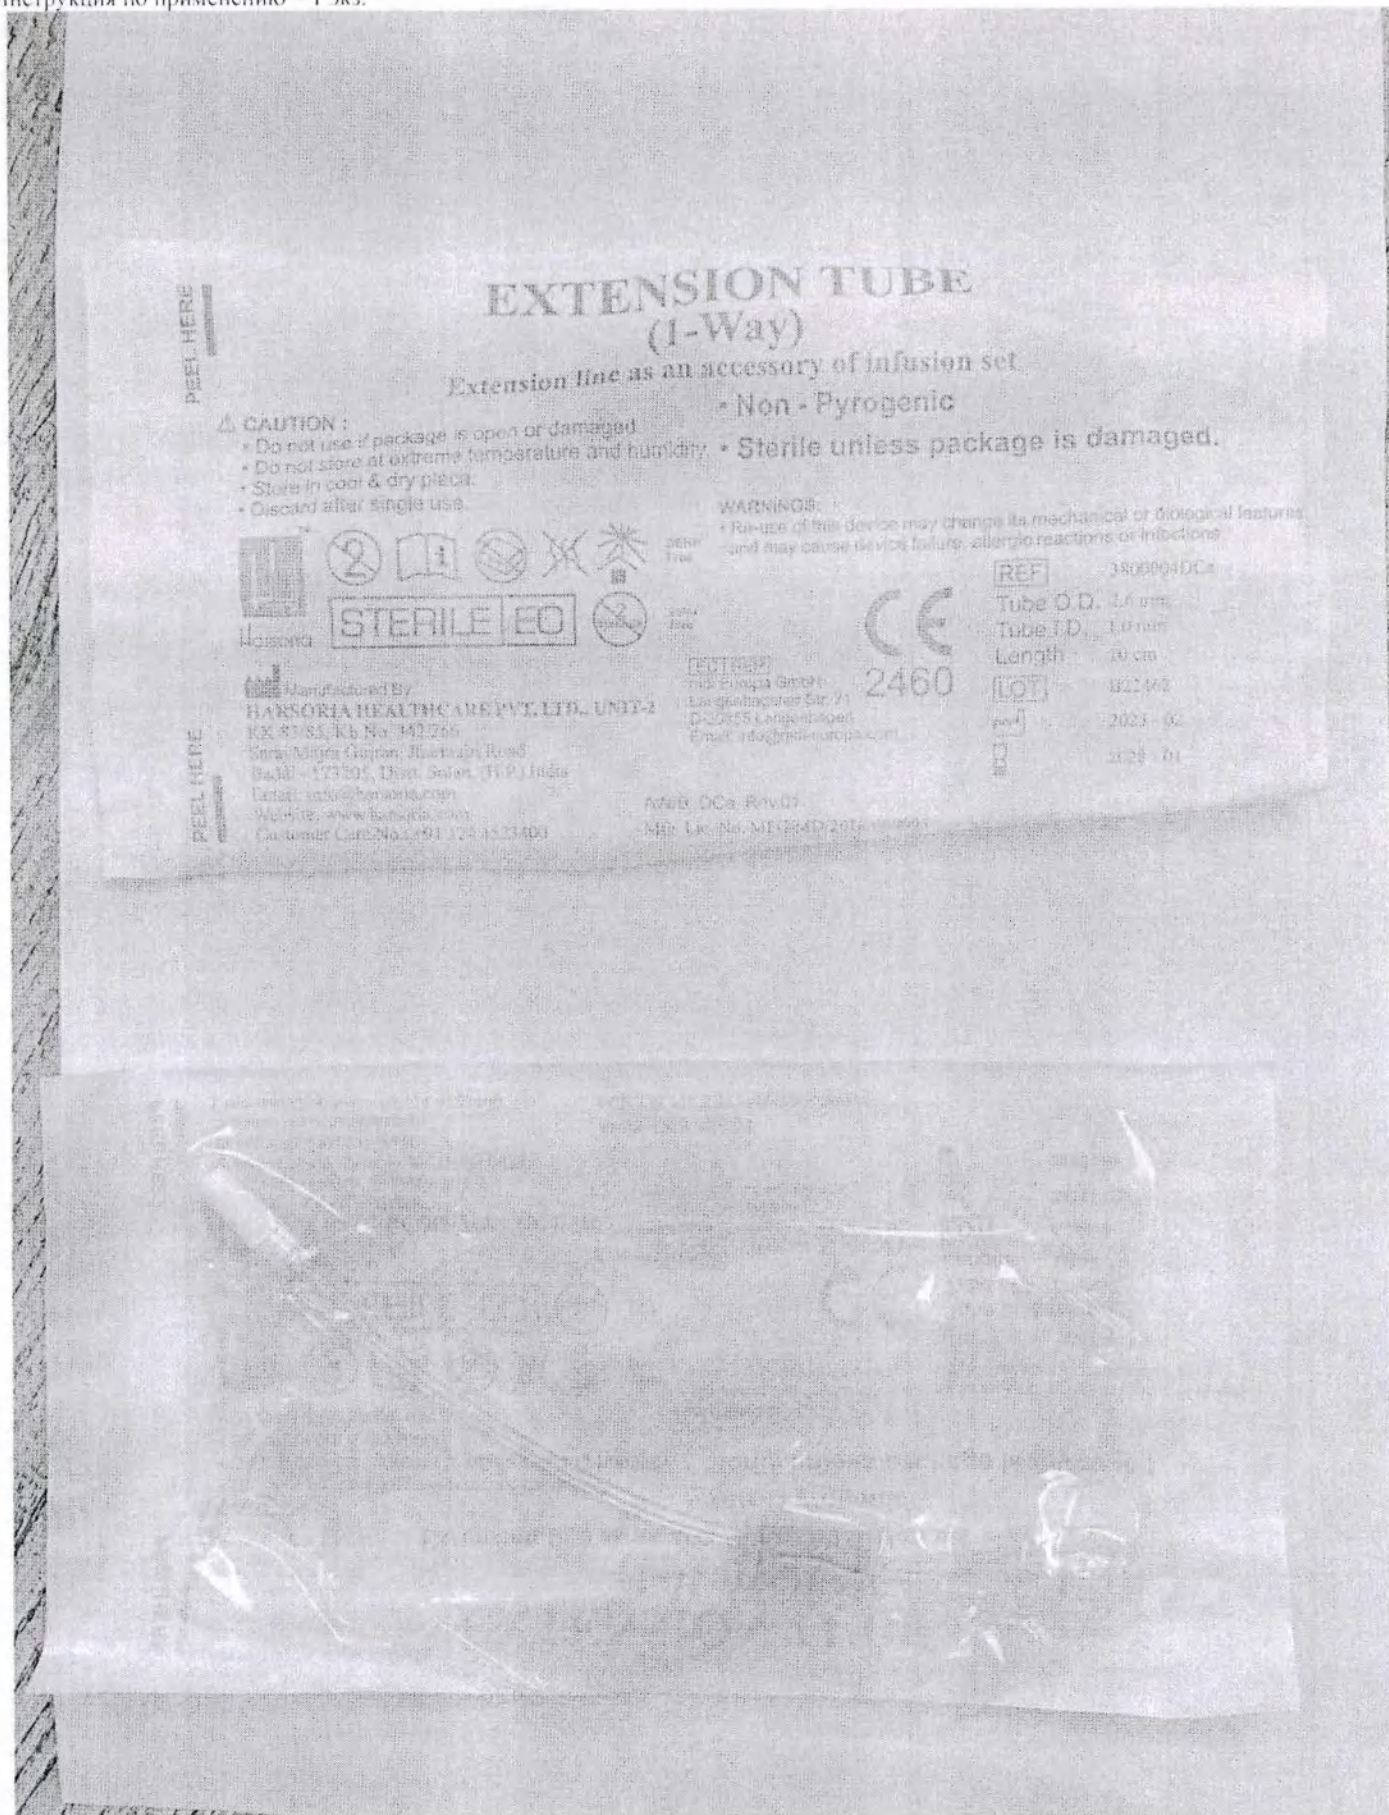
«Линия проводящая инфузионная, в вариантах исполнения»
Производитель: Harsoria Healthcare Pvt. Ltd.
Харсория Хеалткере ПВТ. ЛТД. (Индия)

Линия проводящая инфузионная, в вариантах исполнения

1. Линия проводящая инфузионная с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см Ø 2.6 x 1.0 мм, в составе:

1.1. Линия проводящая инфузионная с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

1.2. Инструкция по применению – 1 экз.



EXTENSION TUBE (1-Way)

Extension line as an accessory of infusion set

CAUTION:

- Do not use if package is open or damaged
- Do not store at extreme temperature and humidity
- Store in cool & dry place
- Discard after single use

• Non - Pyrogenic

• Sterile unless package is damaged.

WARNING:

- Re-use of this device may change its mechanical or biological features and may cause device failure, allergic reactions or infections



HANSONIA

Manufactured By
HANSONIA HEALTHCARE PVT. LTD. UNIT-2
EX-87/81, Kd No. 142/265
Sri Mitha Complex, Bhatinda Road
Baddi - 173201, Dist. Solan (H.P.) India
Contact: info@hansonia.com
Website: www.hansonia.com
Customer Care: 24x7 091 1744533403

STERILE EO



REGISTRATION
HANSONIA GROUP
Largest Manufacturer of IV
Devices in India
Email: info@hansonia.com

CE
2460

REF	3800004DC2
Tube O.D.	2.6 mm
Tube I.D.	1.0 mm
Length	10 cm
LOT	821462
EXP	2023-06
EXP	2023-01

ANB DCa Rev01

Mfr. Lic. No. ME12345678901234567890

ВСКРЫТЬ ТУТ

ВСКРЫТЬ ТУТ

Линия проводящая инфузионная с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см Ø 2.6 x 1.0 мм

Предостережения:

- Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена
- Не хранить при высокой температуре и влажности
- Хранить в прохладном сухом месте
- Утилизировать после использования

• АПИРОГЕННО
• Стерильно, если упаковка не повреждена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- При использовании изделия, изделие может повредиться, что приведет к повреждению пациента. Если изделие повреждено, немедленно прекратить использование и заменить изделие на новое.



LEC | REP |
mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30856 Langenhagen
Email: info@mdi-europa.com

Не содержит латексы Не содержит бисфенола А

Производитель:
MDI Europa GmbH, D-30856 Langenhagen, Germany
www.mdi-europa.com



REF
Внешний диаметр трубки
Внутренний диаметр трубки
Длина
LOT

XXXX

AW xxxxxxxx Rev. xxxx Mfg. Lot No. xxxxxxxx

XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Макет этикетки групповой упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см Ø 2.6 x 1.0 мм»

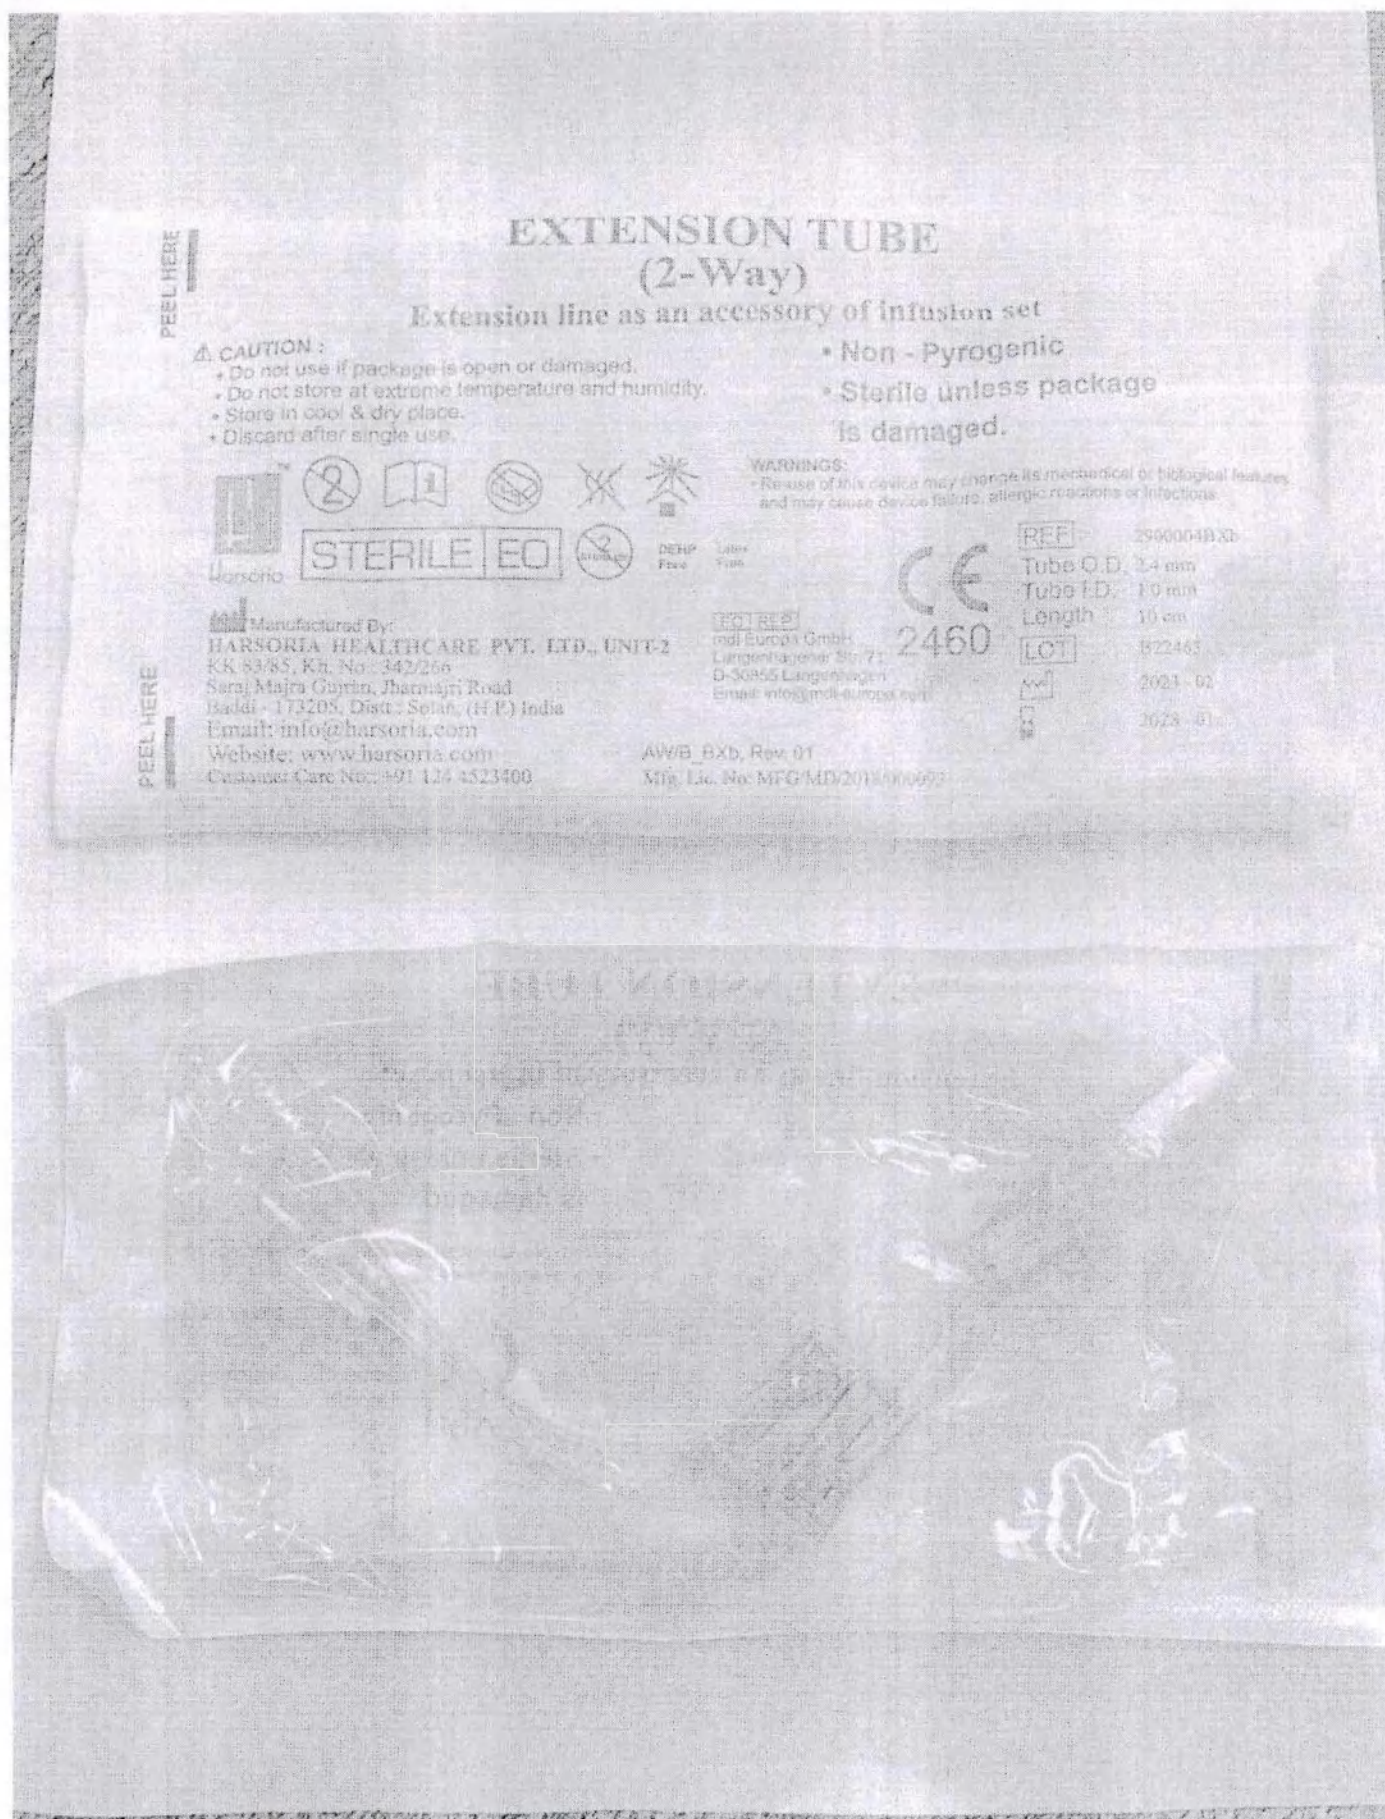
	Линия проводящая инфузионная с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см Ø 2.6 x 1.0 мм	
АПИРОГЕННО STERILE EO для одноразового использования ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com CE XXXX ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5...+30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%	
REF	дата производства 	Внешний диаметр трубки
LOT	срок годности 	Внутренний диаметр трубки
Длина		
ШТ. XX	 Не содержит латекс Не содержит фталаты Нетоксично AW/xxxxxxxxx, Rev.xxxx Mfg.Lic. No.: XXXXXXXXXXXX	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ПАЙП САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватулина дом 71, офис 107, +7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03 info@medpipe.kz RU № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.
SPACE FOR BARCODE		

 Harsoria	Линия проводящая инфузионная с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см Ø 2.6 x 1.0 мм	
АПИРОГЕННО ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		СТЕРИЛЕ EO ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/26th Saraj Majra, Gurran, Baddi-Jharmajra Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5...+30°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%	 XXXX
REF	дата производства	Внешний диаметр трубки
LOT	срок годности	Внутренний диаметр трубки
ШТ. XXX	Длина Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Колтушина, дом 71, офис 107, +7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03 info@medlife.ru Р/Ч № XXX XXXX-XXXX от XX.XX.XXXX	
AW/xxxxxxxx, Rev.xxxx Mfg.Lic. No.: XXXXXXXXXXXX SPACE FOR BARCODE		

2. Линия проводящая инфузионная двухходовая с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см. Ø 2.4 x 1.0 мм, в составе:

2.1. Линия проводящая инфузионная двухходовая с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

2.2. Инструкция по применению - 1 экз.



Макет индивидуальной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная двухходовая с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см, Ø 2.4 x 1.0 мм»

ВСКРЫТЬ ТУТ

Линия проводящая инфузионная двухходовая с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см, Ø 2.4 x 1.0 мм

Предостережения:

- Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена
- Не хранить при высокой температуре и влажности
- Хранить в прохладном, сухом месте
- Утилизировать после использования

• АПЕРИГЕННО

- Стерильно, если упаковка не повреждена

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Повторное использование данного изделия может привести к механическим или функциональным характеристикам, что может привести к неадекватности изделия, аллергическим реакциям или инфекции



STERILE

EO

Не содержит латекса

Не содержит латекса

Микробы

EC REP

Med Europe GmbH

Langerhansstr. 11

D-30559 Langerhans

Germany



REF

Внешний

диаметр трубки

Внутренний

диаметр трубки

Длина

[LOT]

[MFG]

[EXP]

[EXP]

[EXP]

[EXP]

ВСКРЫТЬ ТУТ

Импортер:

HARSORIA HEALTHCARE PVT LTD UNIT 2

Ka No 85, Km No 342-236 Surajpur

Garh, Baidi-Jhamsari Road, Dist. Sonar

Hanahel Pradesh, Baidi 173205, India

Email: info@harsoria.com

Website: www.harsoria.com

Customer Care No: +91 124 4573450

Адрес: КАКТАРА, Республика

Импортёр: КАКТАРА, Республика

Срок годности: 12 месяцев

Срок годности: 12 месяцев

Макет этикетки групповой упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная двухходовая с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см, Ø 2.4 x 1.0 мм»

	Линия проводящая инфузионная двухходовая с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см, Ø 2.4 x 1.0 мм	
АПИРОГЕННО		STERILE EO
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Siroa, Mayra, Gurran, Baddi-Jhamraji Road, Distt. Solan Himachal Pradesh, Baddi- 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com	
ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%		
REF	дата производства 	Внешний диаметр трубки
LOT	срок годности 	Внутренний диаметр трубки
ШТ. XX	 2 Не содержит латекс Не содержит фталаты  3 Нетоксично AW/xxxxxxx, Rev. xxx Mfg Lic No XXXXXXXXXX	
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙО САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Ватулина д. 71 офис 107 +7 953 778 11 01 +7 953 778 10 03 info@medlaid.ru РУ № XXX XXXX-XXXX от XX XX XXXX г.		

Макет стикера транспортной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная двухходовая с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см, Ø 2.4 x 1.0 мм»

 Harsoria	Линия проводящая инфузионная двухходовая с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см, Ø 2.4 x 1.0 мм	
АПИРОГЕННО		STERILE EO
ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		
 Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com	 XXXX
ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%		
REF	дата производства 	Внешний диаметр трубки
LOT	срок годности 	Внутренний диаметр трубки
ШТ. XXX		Длина
AW/xxxxxxxx, Rev.xxxx Mfg.Lic. No.: XXXXXXXXXX		Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Батурина, дом 71, офис 107. +7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03 info@medlife.kz РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

3. Линия проводящая инфузионная трехходовая с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см. Ø 2.4 x 1.0 мм, в составе:

3.1. Линия проводящая инфузионная трехходовая с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

3.2. Инструкция по применению - 1 экз

PEEL HERE

EXTENSION TUBE (3-Way)

Extension line as an accessory of infusion set

CAUTION:

- Do not use if package is open or damaged.
- Do not store at extreme temperature and humidity.
- Store in cool & dry place.
- Discard after single use.

• Non - Pyrogenic

• Sterile unless package
is damaged.



Harsoria

STERILE EO

XX

DEHP Free Latex Free

WARNINGS:

- Re-use of this device may change its mechanical or biological features and may cause device failure, allergic reactions or infections

Manufactured By:
HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2
KK 83/85, Kh. No. 1342/266
Saraj Maja Gnjran, Ibarbajri Road
Baddi - 171205, Dist. Solan, (H.P.) India
Email: info@harsoria.com
Website: www.harsoria.com
Customer Care No. : +91 124 4523400


CE
2460
MDI Europe GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30699 Langenhagen
Email: info@mdi-europe.com

REF 3000045-YB
Tube O.D. 2.4 mm
Tube I.D. 1.0 mm
Length 10 cm
LOT B22M64
2023-02
2028-01

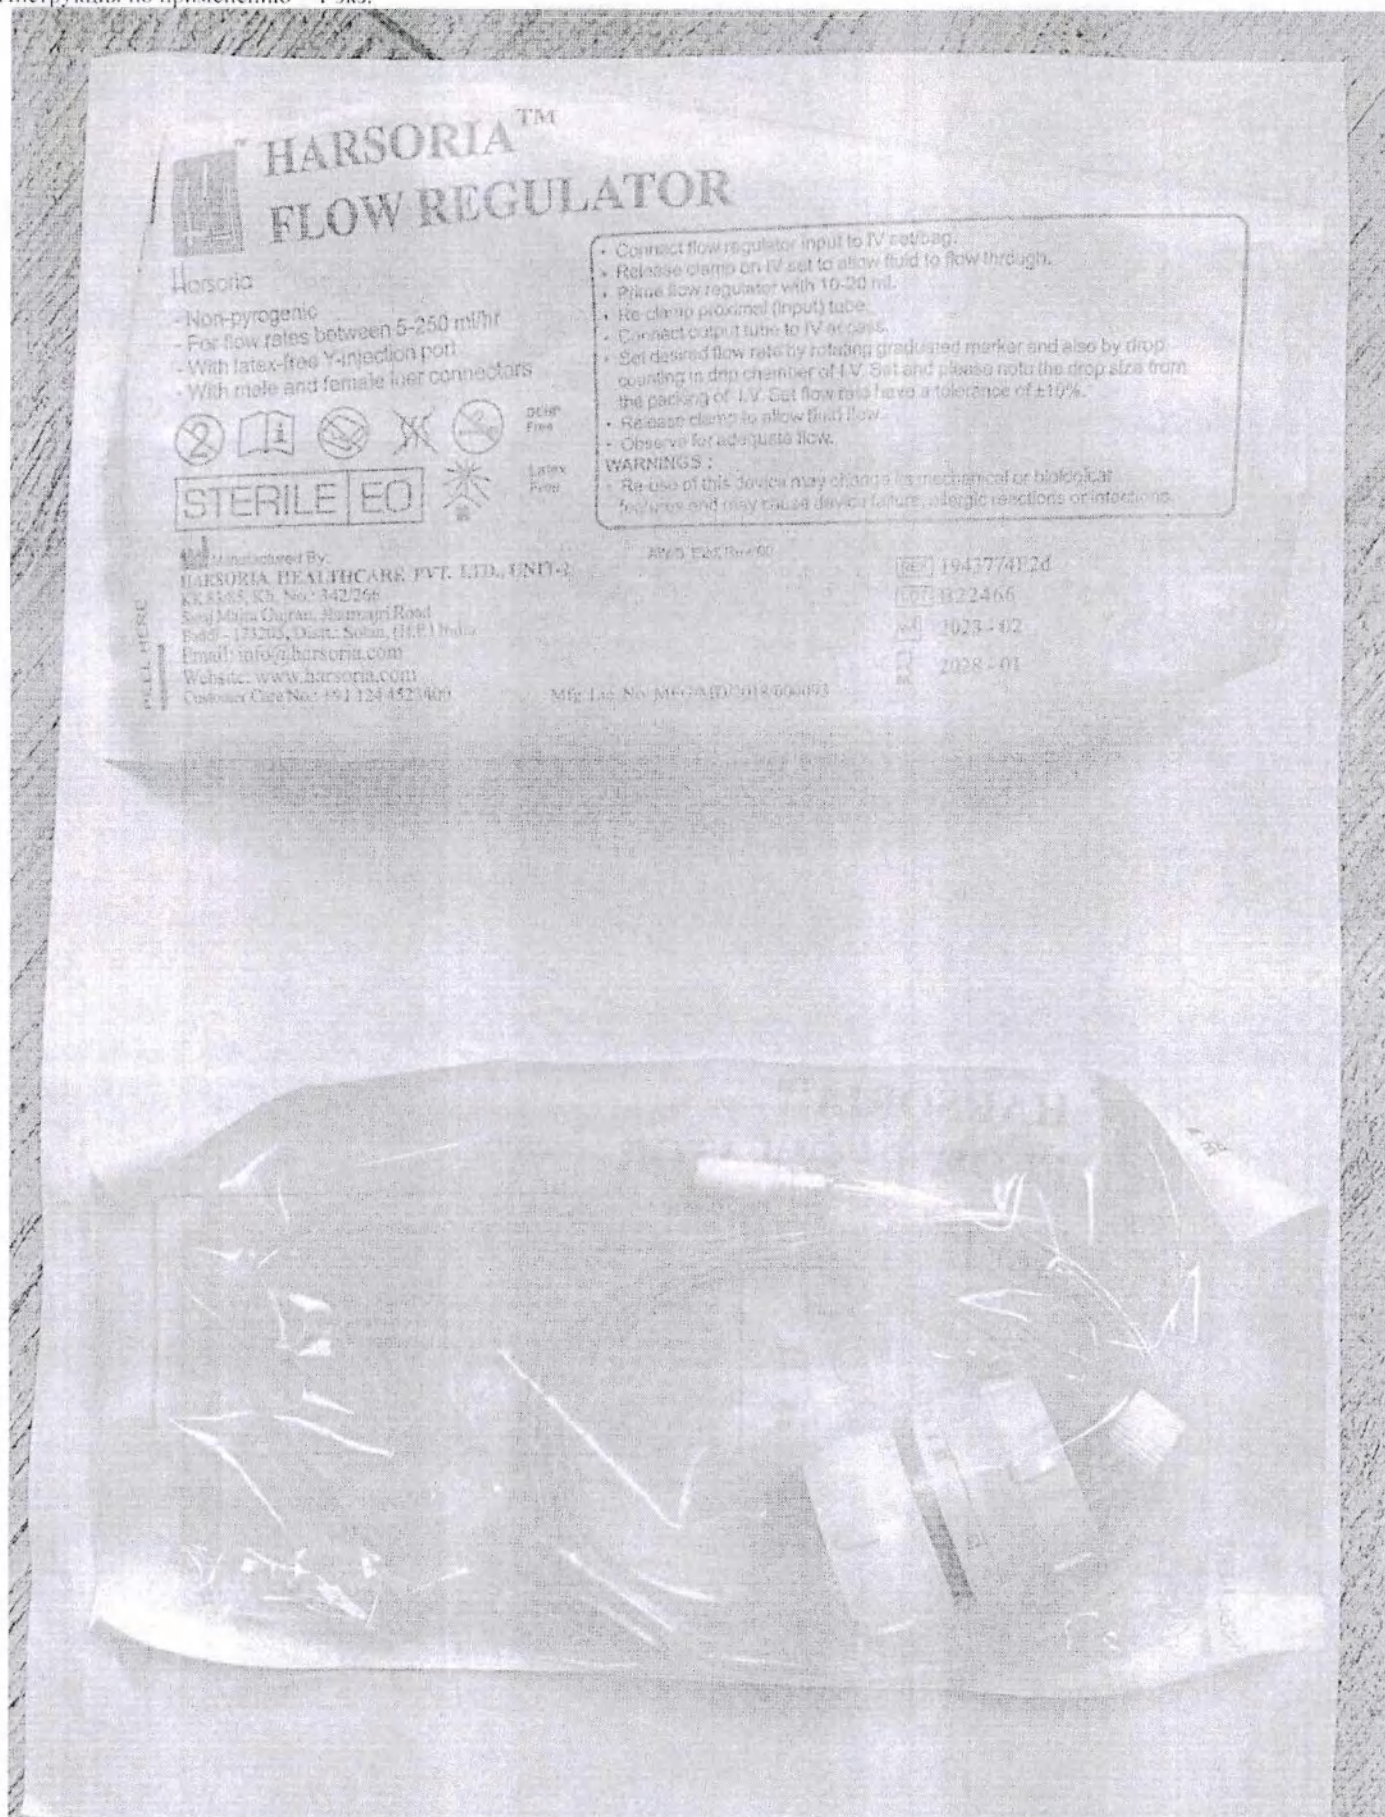
AWB_Bye: Rev 01
Mfg. Lic. No: MFG/MD/2018/000093

	Линия проводящая инфузионная трехходовая с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см, Ø 2.4 x 1.0 мм				
АПИРОГЕННО STERILE EO ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		для одноразового использования			
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85 Kh No. 342/2bi Saraj Maya, Gurgaon, Baddi-Jharmay, Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, India 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No. +91 124 4523400	ECT/REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%				
REF LOT	дата производства срок годности	Внешний диаметр трубки Внутренний диаметр трубки Длина			
<table border="0"> <tr> <td data-bbox="350 931 531 1128"> ШТ. XX </td> <td data-bbox="531 931 886 1128">       Не содержит латекс Нетоксично Не содержит фталаты AW/xxxxxxx, Rev. xxxx Mfg Lic No. XXXXXXXXXX </td> <td data-bbox="886 931 1284 1128"> Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ПАЙФ САЙНСЕЗ» 830087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватулина, дом 71, офис 107 +7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03 info@medpipe.ru RU No XXX XXX.X XXXX от XX XX XXXX г. </td> </tr> </table>			ШТ. XX	      Не содержит латекс Нетоксично Не содержит фталаты AW/xxxxxxx, Rev. xxxx Mfg Lic No. XXXXXXXXXX	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ПАЙФ САЙНСЕЗ» 830087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватулина, дом 71, офис 107 +7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03 info@medpipe.ru RU No XXX XXX.X XXXX от XX XX XXXX г.
ШТ. XX	      Не содержит латекс Нетоксично Не содержит фталаты AW/xxxxxxx, Rev. xxxx Mfg Lic No. XXXXXXXXXX	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ПАЙФ САЙНСЕЗ» 830087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватулина, дом 71, офис 107 +7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03 info@medpipe.ru RU No XXX XXX.X XXXX от XX XX XXXX г.			

Макет стикера транспортной унаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная трехходовая с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см. Ø 2.4 x 1.0 мм»

 Harsoria	Линия проводящая инфузионная трехходовая с коннектором Люэра тип male и безыгольным коннектором Люэра тип female 10 см, Ø 2.4 x 1.0 мм		
АПИРОГЕННО		STERILE EO	для одноразового использования
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ			
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Maja, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400		EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%	
REF		 дата производства	Внешний диаметр трубки
LOT		 срок годности	Внутренний диаметр трубки
ШТ. XXX			Длина
AW/xxxxxxxx, Rev.xxxx Mfg Lic. No.: XXXXXXXXXXXX		Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ПАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 71, офис 107. +7 953 778 11 01 +7 953 778 10 03 info@medlife.kz РУ № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.	

4. Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока и с Y-образным портом, с коннектором Люэра тип male и с коннектором Люэра тип female 450 мм, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:
- 4.1. Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока и с Y-образным портом, с коннектором Люэра тип male и с коннектором Люэра тип female в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 20 шт.
- 4.2. Инструкция по применению - 1 экз.



Макет индивидуальной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока и с Y-образным портом, с коннектором Люэра тип male и с коннектором Люэра тип female 450 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм»

ВСКРЫТЬ ТУТ



Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока и с Y-образным портом, с коннектором Люэра тип male и с коннектором Люэра тип female 450 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм

Harsoria

- Алирогенно
- Для скорости потока от 5 до 250 мл/час
- С безлатексным Y-образным портом
- С коннекторами Люэра тип male и female



STERILE EO

Не содержит латекс,
не содержит фталаты,
Безопасно

ВСКРЫТЬ ТУТ

Производитель:

HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD. UNIT-2
KK 83-85, Kh. No. 342/266 Saraj Majra
Gurran, Baridi-Jharmajra Road, Distt. Solan
Himachal Pradesh, Baddi 173205, India
Email: info@harsoria.com
Website: www.harsoria.com
Customer Care No: +91 124 4501300

AW:XXXXXXXX, Rev:XXXX

Mfg Lic. No. XXXXXXXXXX

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации
ООО «МЕД ПАЙФ САЙНЦЕЗ»
630087, Новосибирская область, г. Новосибирск
ул. Батурина, дом 71, офис 107
+7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03
info@medinfo.kz
РП № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

REF

LOT



ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5...+30°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%

Соедините проводящую инфузионную линию с контейнером с раствором.

Пропустите через регулятор потока объем 10-20мл.

Снова зажмите проксимальную (выходную) трубку.

Подсоедините выходную трубку к внутривенному доступу.

Установите желаемую скорость потока, вращая градуированный маркер.

Регулятор потока имеет отклонение ± 10%.

Следите за достаточностью потока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Повторное использование данного изделия может изменить его механические или биологические характеристики и может привести к неисправности изделия, аллергическим реакциям или инфекции.


 ООО ЦИРМИ
 
 INFO@CIRMI.RU
 
 WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет этикетки групповой упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока и с Y-образным портом, с коннектором Льюэра тип male и с коннектором Льюэра тип female -450 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм»

 Harsoria	Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока и с Y-образным портом, с коннектором Льюэра тип male и с коннектором Льюэра тип female 450 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм		
АПИРОГЕННО		STERILE EO	ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ			
 Производитель HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No. +91 124 4523400		Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 71, офис 107 +7 953 778 11 01 +7 953 778 10 03 info@medlife.kz РУ № XXX XXXX XXXXX от XX XX XXXX г.	
REF	 дата производства	ДЛИНА	
LOT	 срок годности		
ШТ. XX		ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 70%      XXXX Не содержит латекс Нетоксично Не содержит фталаты AW/xxxxxxxxx, Rev. xxxxx Mfg.Lic. No.: XXXXXXXXXXXX	

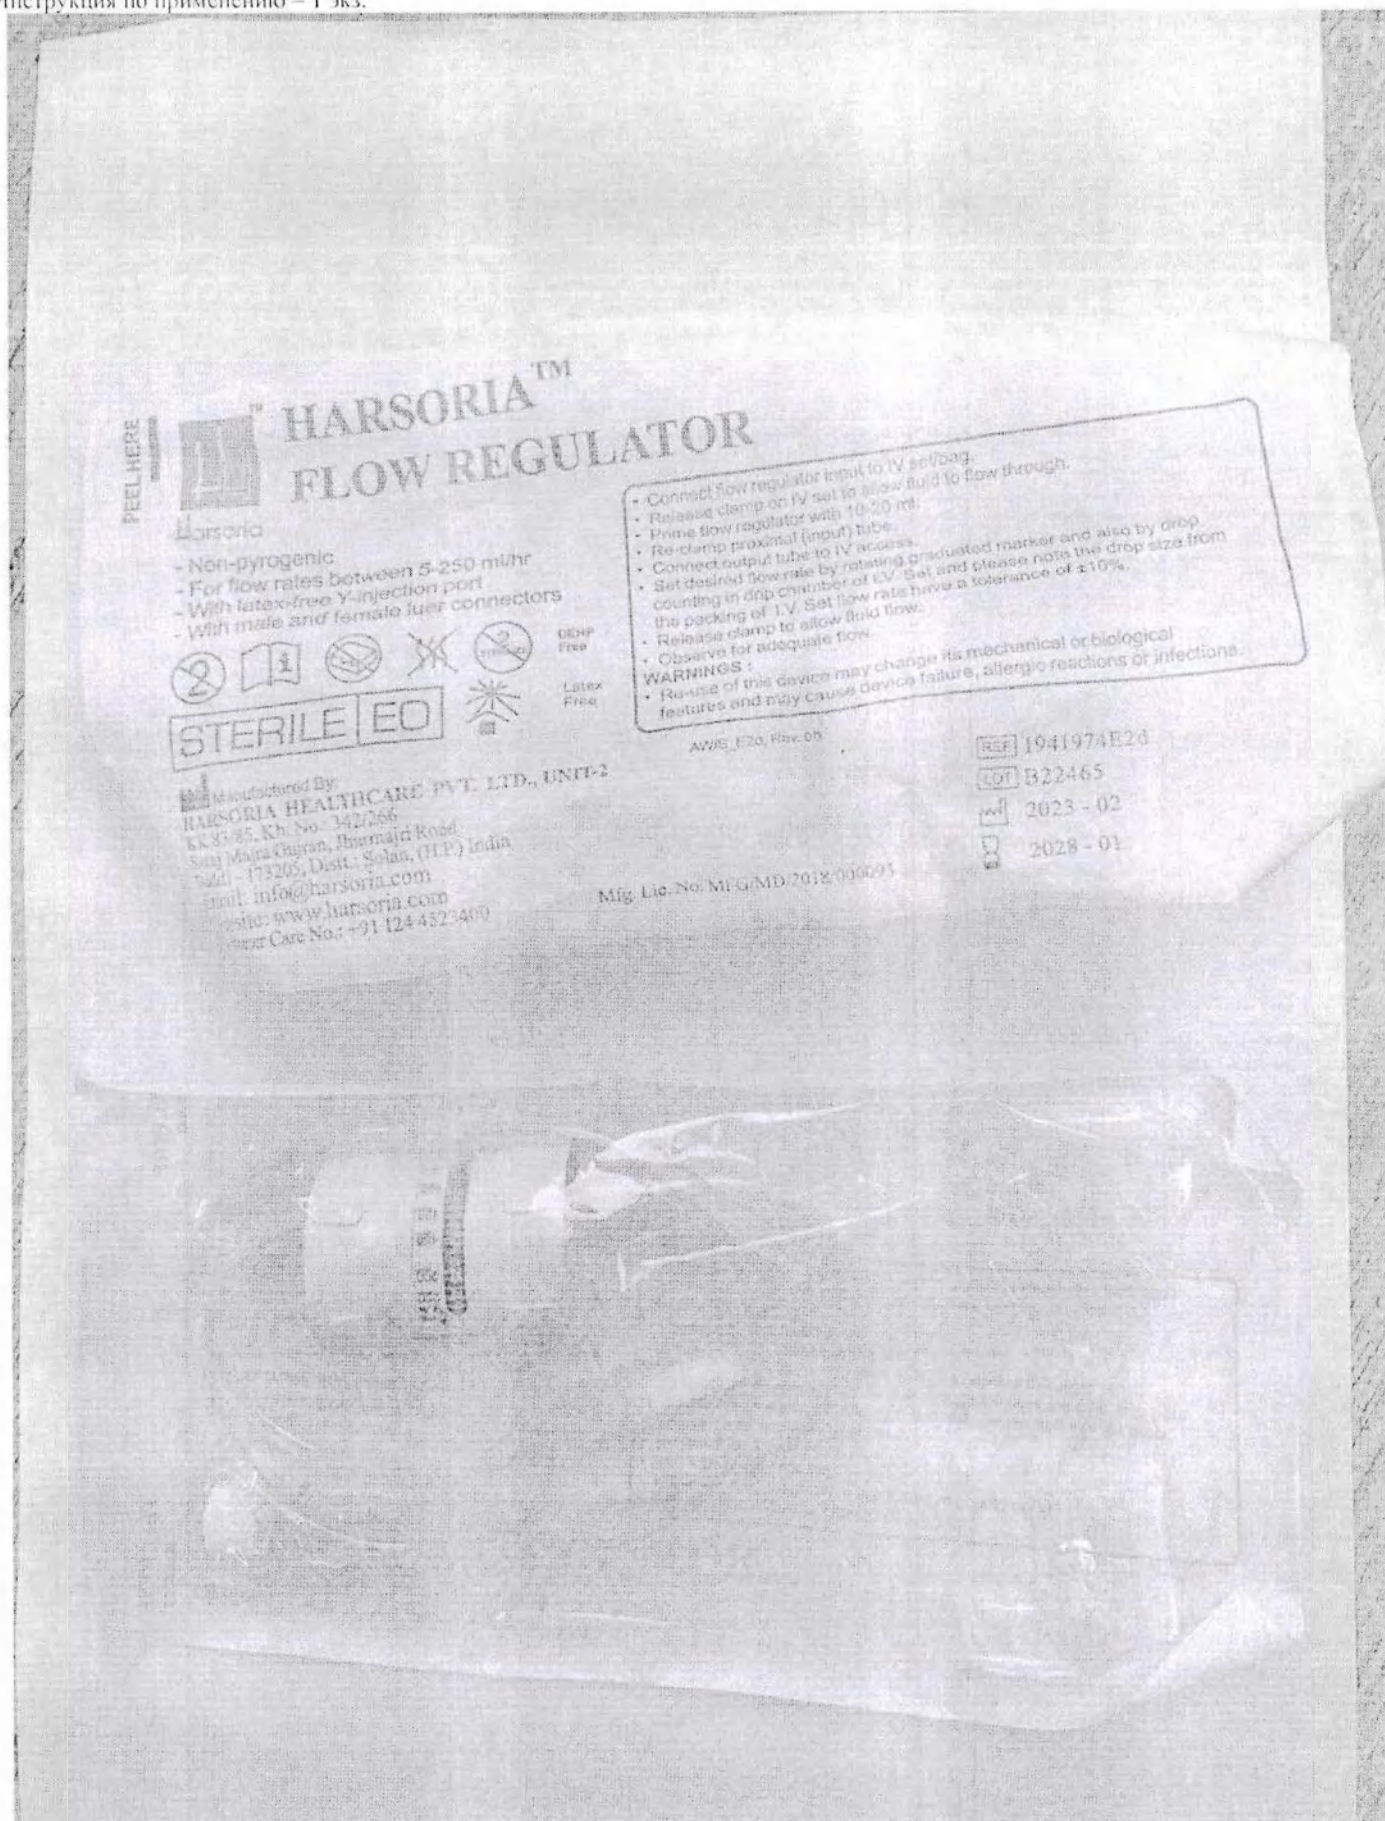
Макет этикетки транспортной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока и с Y-образным портом, с коннектором Льюэра тип male и с коннектором Льюэра тип female 450 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм»

	Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока и с Y-образным портом, с коннектором Льюэра тип male и с коннектором Льюэра тип female 450 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм
АПИРОГЕННО STERILE EO ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ	
 Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 71, офис 107. +7 953 778 11 01 +7 953 778 10 03 info@medlife.kz РПУ № XXX XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.
REF	 дата производства
	ДЛИНА
	срок годности
LOT	
ШТ. XXX	ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5...+30°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%
AW/xxxxxxxx, Rev.xxxx Mfg.Lic. No.: XXXXXXXXXX	


5. Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока и с Y-образным портом, с вращающимся коннектором Льюэра тип male и с коннектором Льюэра тип female 450 мм, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:

5.1. Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока и с Y-образным портом, с вращающимся коннектором Льюэра тип male и с коннектором Льюэра тип female в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 20 шт.


5.2. Инструкция по применению - 1 экз.



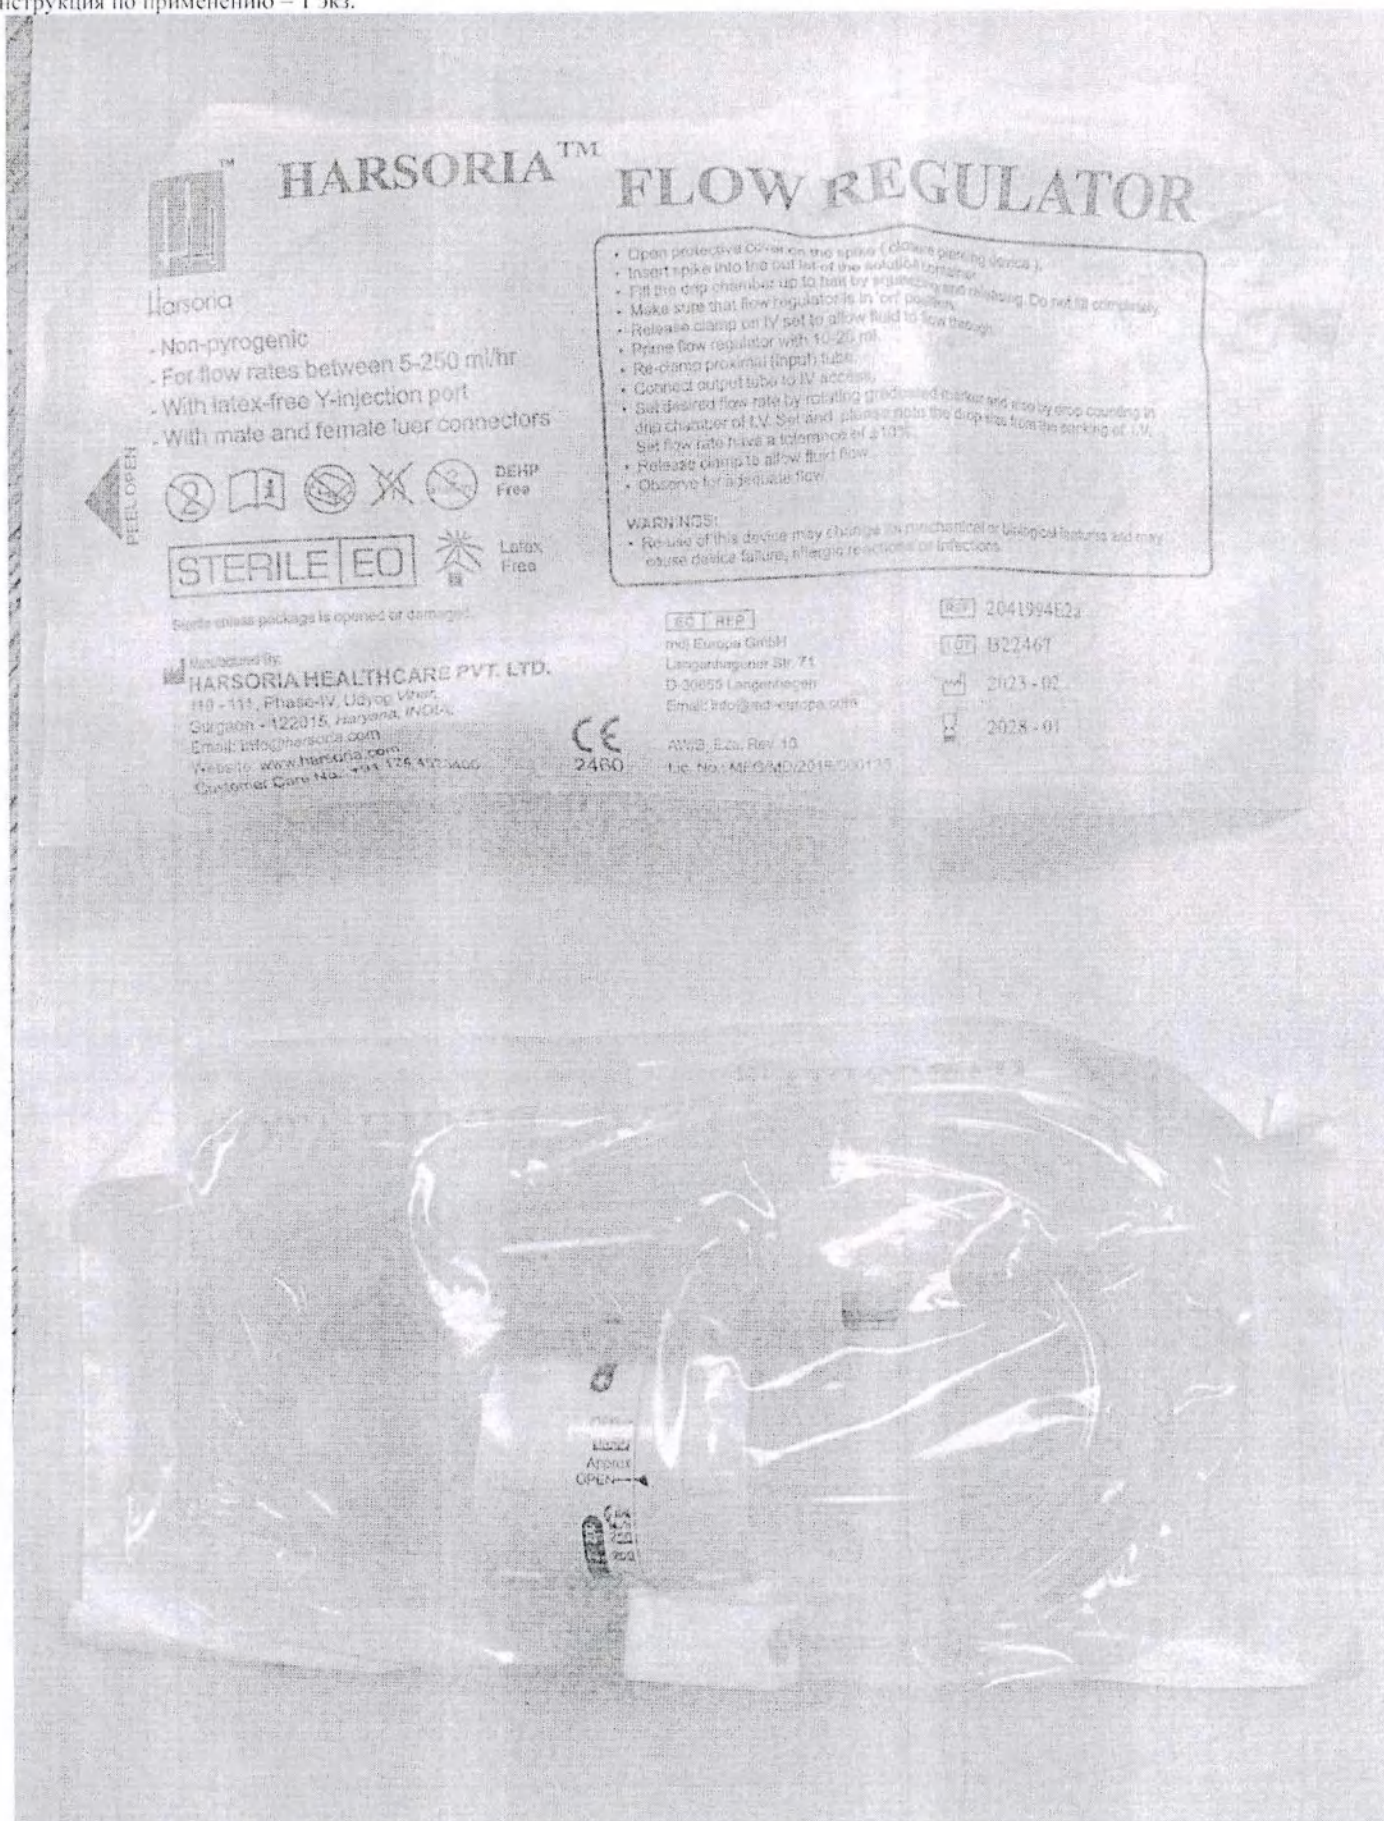
Макет этикетки групповой упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока и с Y-образным портом, с вращающимся коннектором Люэра тип male и с коннектором Люэра тип female 450 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм»

	Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока и с Y-образным портом, с вращающимся коннектором Люэра тип male и с коннектором Люэра тип female 450 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО		STERILE EO
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		
Производитель HARSONIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsona.com Website: www.harsona.com Customer Care No.: +91 124 4523400	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 71, офис 107. +7 953 778 11 01 +7 953 778 10 03 info@medlife.kz РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.	
REF	 дата производства	ДЛИНА
LOT	 срок годности	
ШТ. XX	ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%.  XXXX      Не содержит латекс Нетоксично Не содержит фталаты AW/xxxxxxxx, Rev.xxxx Mfg.Lic. No.: XXXXXXXXXX	

Макет этикетки транспортной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока и с Y-образным портом, с вращающимся коннектором Люэра тип male и с коннектором Люэра тип female 450 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм»

 Harsoria	Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока и с Y-образным портом, с вращающимся коннектором Люэра тип male и с коннектором Люэра тип female 450 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм		
АПИРОГЕННО		STERILE EO	ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ			
 Производитель HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jhamajr Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400		Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 71, офис 107. +7 953 778 11 01 +7 953 778 10 03 info@medlife.kz РРУ № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.	
REF	 дата производства	ДЛИНА	
LOT	 срок годности		
ШТ. XXX		ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30 С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%	
AW/xxxxxxxx, Rev.xxxx Mfg.Lic. No.: XXXXXXXXXXXX			

6. Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока, с капельной камерой, с Y-образным портом и с коннектором Люэра тип male 1700 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:
- 6.1. Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока, с капельной камерой, с Y-образным портом и с коннектором Люэра тип male в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 20 шт.
- 6.2. Инструкция по применению – 1 экз.



Макет индивидуальной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока, с капельной камерой, с Y-образным портом и с коннектором Льюэра тип male 1700 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм»



Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока, с капельной камерой, с Y-образным портом и с коннектором Люэра тип male 1700 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм

Уполномоченный представительства «Медлайф» на территории Российской Федерации
ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНС»
630067, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Вагюлина, дом 7/1, офис 307
+7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03
info@medlife.kz
Р/Ч № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXXг.

Только гравитационная подмена

60 капель, что эквивалентно 1

Для скорости потока от 5 до 250 м/час
5-6 оборотов в мин. (об/мин) вращением.

С. С. Дроздовым

С коннектором ЛЮЗРА (Luzra)



STERILE	EO
---------	----

Не содержит плагиат

Не содержит фталаты

Не токсично

Стерильно, если упаковка не повреждена

 Производитель.

HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT 2

KK 83/85, Kf. No. 342/266, Saraj Majra

Gupar, Badli, Jharna Road, Distt. Solan,
Himachal Pradesh, India. 171305

Email: info@parsona.com

Website: www.harsonia.com

[illegible]

and Europa Group.

Langenhagen 39 71
3. 1985 Langenhagen

Test of significance

AN/XXXXXXXXX Rev XXXX



25


2. 2001

19

2

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5...+20°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%

Макет стикера групповой упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока, с капельной камерой, с Y-образным портом и с коннектором Люэра тип male 1700 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм»

 Harsoria	Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока, с капельной камерой, с Y-образным портом и с коннектором Люэра тип male 1700 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО		STERILE EO
ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com	 XXXX
ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%		
REF	data производства	ДЛИНА
LOT	срок годности	
G		
ШТ. XXX	     Не содержит латекс Нетоксично Не содержит фталаты AW/xxxxxxxx, Rev.xxxx Mfg.Lic. No.: XXXXXXXXXXXX	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 71, офис 107. +7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03 info@medlife.kz ПУ № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.
SPACE FOR BARCODE		

Макет этикетки транспортной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока, с капельной камерой, с Y-образным портом и с коннектором Люэра тип male 1700 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм»

 Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока, с капельной камерой, с Y-образным портом и с коннектором Люэра тип male 1700 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО STERILE EO ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ	
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%
CE XXXX	
REF	дата производства
LOT	срок годности
ШТ. XXX	уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 71, офис 107 +7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03 info@medlife.kz РУ № XXX XXXX/XXXX от XX XX XXXX г
AW/xxxxxxxx, Rev.xxxx Mfg. Lot. No.: XXXXXXXXXXXX	

7.2. Инструкция по применению – 1 экз



Макет индивидуальной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока, с капельной камерой, с Y-образным портом и с вращающимся коннектором Люэра тип male 1700 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм»



ВСКРЫТЬ ТУТ

STERILE EO

Стерильно, если упаковка не повреждена

Производитель:
HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2
KK 83/R5, Kt. No. 342/266 Said Mala
Gujran, Badli Jhamain Road, Dist. Solan
Himachal Pradesh, Badli 171205, India
Email: info@harsoria.com
Website: www.harsoria.com
Customer Care No.: +91 124 4523400

**Линия проводящая инфузионная
с регулятором скорости потока,
с капельной камерой, с Y-образным портом
и с вращающимся коннектором Люэра тип male
1700 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм**

- Апиrogenно
- Только гравитационная подача
- 60 капель, что эквивалентно $1 \pm 0,1$ мл
- Для скорости потока от 5 до 250 мл/час
- С безлатексным Y-образным портом
- С коннектором Люэра тип male

Не содержит латекса
Не содержит фталаты
Нетоксично

Уполномоченный представитель производителя
на территории Российской Федерации
ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ»
630037, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Ватулина, дом 71, офис 107
+7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03
info@medlife.kz
Р/Ч № XXX XXXX/XXXX от XXX XXXX

• Соедините изделие с контейнером для инфузии, камера должна быть направлена для правильной работы

• Вращайте шарик в камере, чтобы изменить количество капель с раствором

• Заполните камеру раствором, используя шприц или спринцовку. Не добавляйте никаких других

• Убедитесь, что регулятор потока находится в положении «выключено»

• Ослабьте зажимы и удалите для предотвращения инфекции, чтобы избежать риска заражения

• Пропустите через регулятор скорость потока 10-20 мл

• Если вы видите признаки закупорки, обратитесь к врачу

• Подвержены воздействию ультрафиолетового излучения

• Активируйте индикатор скорости потока, чтобы предупредить о низком уровне раствора

• Проверьте наличие индикатора скорости потока, чтобы предупредить о низком уровне раствора

• Отсутствие шума, чтобы избежать риска заражения

• Следите за достаточностью потока

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

• Повторное использование данного изделия может изменить его свойства и не его безопасность

• Характеристики и может привести к снижению эффективности, аллергическим реакциям и к другим


EC REP
med Europa GmbH
Langerhansstr. 24
D-30555 Langenhagen
Email: info@med-europa.com

AWXXXXXXXX, Rev. XXXX
Mfg. Lic. No.: XXXXXXXXXX


CE
XXXX

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%

Макет стикера групповой упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока, с капельной камерой, с Y-образным портом и с вращающимся коннектором Люэра тип male 1700 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм»

	Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока, с капельной камерой, с Y - образным портом и с вращающимся коннектором Люэра тип male 1700 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		STERILE EO
ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com	 XXXX
ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%		
REF	 дата производства	ДЛИНА
LOT	 срок годности	
G		
ШТ. XXX	      Не содержит латекс Нетоксично Не содержит фталаты AW/xxxxxxxxx, Rev.xxxx Mfg.Lic. No.: XXXXXXXXXXXX Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 71, офис 107. +7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03 info@medlife.kz РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.	
SPACE FOR BARCODE		

Макет стикера транспортной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока, с капельной камерой, с Y-образным портом и с вращающимся коннектором Люэра тип male 1700 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм»

	Линия проводящая инфузионная с регулятором скорости потока, с капельной камерой, с Y - образным портом и с вращающимся коннектором Люэра тип male 1700 мм, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО		STERILE EO
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%
REF		дата производства
LOT		срок годности
ШТ. XXX	AW/xxxxxxxx, Rev.xxxx Mfg.Lic. No.: XXXXXXXXXXXX	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ ЛАЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 71, офис 107 +7 953 778 11 01 +7 953 778 10 03 info@medlife.kz РУ № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX XXXX г

8. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим 10 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе¹:

8.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

8.2. Инструкция по применению - 1 экз.

9. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим 25 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

9.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

9.2. Инструкция по применению - 1 экз.

10. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим 50 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

10.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

10.2. Инструкция по применению - 1 экз.

11. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим 75 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

11.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

11.2. Инструкция по применению - 1 экз.

12. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим 100 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

12.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

12.2. Инструкция по применению - 1 экз.

13. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим 150 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

13.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

13.2. Инструкция по применению - 1 экз.

14. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим 200 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

14.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

14.2. Инструкция по применению - 1 экз.

15. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим 250 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

15.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

15.2. Инструкция по применению - 1 экз.

¹ Представлена фотография данного образца

0339

- Do not use if package is open or damaged.
- Do not store at extreme temperature and humidity.
- Store in cool & dry place.
- Discard after single use.

- Peel open the blister.
- Unscrew the protective cap from female luer.
- Connect male portion of I.V. Set / bag with female luer of tubing.
- Remove protective cap from male luer side of tubing.
- Hold male portion upright and open clamp of I.V. Set / bag and allow the solution to displace air entirely from tubing.
- Close clamp.
- Connect male portion of tubing to venipuncture device.

WARNINGS:

* Re-use of this device may change its mechanical or biological features and may cause device failure, allergic reactions or infections.



STERILE EO




Manufactured By:
HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2
 K.K. 85, K.B. No. 342/266
 Saraj Majra Chusian, Bhambaj Road
 Baddi - 173205, Distt : Solan, (H.P.) India
 Email: info@harsoria.com
 Website: www.harsoria.com
 Customer Care No. +91-124-4521400

Indi Europa GmbH
Langenburger Str. 71
D-30855 Langenhagen
Email: info@indi-europa.com

AVW/B B7E, Rev. 01

Mfg. Lic. No. MFC/MD/2018/000903



[REF] 1840694B76

LOT B22469

Length 10 cm

2023-02

2028-01

- АПИРОГЕННО

- Стерильно, если упаковка не повреждена

- **Wiederholungsfragen:**
 - Was ist die Funktion des Zellkerns?
 - Welche Aufgaben haben Mitochondrien?
 - Wie wird die DNA in der Zelle gespeichert?
 - Was ist die Rolle von Ribosomen?
 - Wie wird die Zellteilung reguliert?
 - Welche Faktoren beeinflussen die Zellalterung?
 - Wie wird die Zellkommunikation ermöglicht?
 - Was ist die Bedeutung von Signalwegen?
 - Wie wird die Zellantwort auf Stress reguliert?
 - Welche Rolle spielen Hormone in der Zellregulation?
 - Wie wird die Zellapoptose kontrolliert?
 - Welche Faktoren beeinflussen die Zellproliferation?
 - Wie wird die Zellmigration reguliert?
 - Welche Rolle spielen Zytokine in der Zellkommunikation?
 - Wie wird die Zellantwort auf Infektionen reguliert?
 - Welche Faktoren beeinflussen die Zellviabilität?
 - Wie wird die Zellantwort auf Schädigung reguliert?
 - Welche Rolle spielen Antikörper in der Immunantwort?
 - Wie wird die Zellantwort auf Stress reguliert?
 - Welche Faktoren beeinflussen die Zellproliferation?
 - Wie wird die Zellmigration reguliert?
 - Welche Rolle spielen Zytokine in der Zellkommunikation?
 - Wie wird die Zellantwort auf Infektionen reguliert?
 - Welche Faktoren beeinflussen die Zellviabilität?
 - Wie wird die Zellantwort auf Schädigung reguliert?
 - Welche Rolle spielen Antikörper in der Immunantwort?



effort to provide a more complete picture of the impact of the program on the health of the community. The program has been successful in reducing the incidence of disease and improving the health of the community. The program has been successful in reducing the incidence of disease and improving the health of the community. The program has been successful in reducing the incidence of disease and improving the health of the community.

CE REF
XXXX LOI
Датум:


[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

Макет стикера групповой упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм»

	Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО STERILE EO для одноразового использования ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%	
REF	дата производства	ДЛИНА
LOT	срок годности	
ШТ. XXX	      Не содержит латекс Нетоксично Не содержит фталаты	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 71, офис 107. +7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03 info@medlife.kz РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.
Mfg.Lic. No.: XXXXXXXXXX	AW/xxxxxxxxx, Rev. xxxx	

Макет стикера транспортной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм»

 Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО STERILE EO для однократового использования ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ	
Производитель HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh No 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5...+30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%
REF	ДЛИНА
LOT	срок годности
ШТ. XXX	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Ватутина, дом 71, офис 107 +7 953 778 11 01 +7 953 778 10 03 info@medlife-sciences.ru
Mfg Lic No: XXXXXXXXXXXX	AW/XXXXXXXXX Rev XXXX
PV № XXX XXXX XXXX от XX XX XXXX	

16. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным 10 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:
- 16.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 16.2. Инструкция по применению - 1 экз.
17. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным 25 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:
- 17.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 17.2. Инструкция по применению - 1 экз.
18. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным 50 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:
- 18.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 18.2. Инструкция по применению - 1 экз.
19. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным 75 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:
- 19.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 19.2. Инструкция по применению - 1 экз.
20. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным 100 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:
- 20.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 20.2. Инструкция по применению - 1 экз.
21. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным 150 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:
- 21.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 21.2. Инструкция по применению - 1 экз.
22. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным 200 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:
- 22.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 22.2. Инструкция по применению - 1 экз.
23. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным 250 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе²:
- 23.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 23.2. Инструкция по применению - 1 экз.

² Представлена фотография данного образца

PEEL HERE

3 WAY STOP COCK WITH EXTENSION TUBE

• Non - Pyrogenic • Sterile unless package is damaged.

CAUTION :

- Do not use if package is open or damaged.
- Do not store at extreme temperature and humidity.
- Store in cool & dry place.
- Discard after single use.

- Peel open the blister.
- Unscrew the protective cap from female luer.
- Connect male portion of LV Set / bag with female luer of tubing.
- Remove protective cap from male luer side of tubing.
- Hold male portion upright and open clamp of LV Set / bag and allow the solution to displace air entirely from tubing.
- Close clamp.
- Connect male portion of tubing to venipuncture device.

WARNINGS:

- Re-use of this device may change its mechanical or biological features and may cause device failure, allergic reactions or infections.



DEHP Free
Latex Free



Manufactured By:
HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2
KK 83/85, Kh. No.: 342/266
Saraj Magra Gajner, Jharmajri Road
Baddi - 173205, Distt : Solan, (H.P.) India
Email: info@harsoria.com
Website: www.harsoria.com
Customer Care No.: 491 124 4323 400

ECI/REP

mdt Europe GmbH
Langerhagener Str. 71
D-30655 Langerhagen
Email: info@mdt-europe.com

CE 2460

REF 1843294B7F
LOT B22472
Length 250 cm
2023 - 02
2028 - 01

AW/B_ B7f, Rev.01

Mfg. Lic. No: MFG/MD/2018/000093

PEEL HERE



ИСКРЯТЫЕ ТУТ

**Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником
красным XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм**

- **АПИРОГЕННО**
- **Стерильно, если упаковка не повреждена**

Предостережения:

- Не использовать, если упаковка не целая или повреждена
- Не хранить при высокой температуре и влажности.
- Хранить в прохладном сухом месте
- Не употреблять после истечения срока



Abstract

Производитель

PARSONS+HARCARE PVT LTD UNIT 2
 KK-444, Kt No. 342/266 Sarai Maqsood
 Sector-14, Indira Nagar Road, Distt. Gurgaon
 Haryana-122001, India
 Email: info@parsona.com
 Website: www.parsona.com
 Customer Care No. +91 124 452344

- [illegible]

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- [illegible]

ED, REF.
 001 2000 00001
 1000000000 00001
 U-30855 1000000000
 Free info/india-00001



1. The first step is to identify the main topic of the document.


● 2010年10月10日

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Макет этикетки групповой упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм»

 Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО STERILE EO для однократного использования ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ	
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh No. 342/266 Saraj Majra, Gurgaon, Baddi-Jharmajra Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi-173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No. +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%
REF	дата производства
LOT	срок годности
ШТ. XXX	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕДЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватулина дом 71, офис 107 +7 953 778 11 00 +7 953 778 10 03 info@medlife.ru RU № XXX.XXX.XXXX от XX.XX.XXXX
Mig Lic. No.: XXXXXXXXXX	AW/xxxxxxxx, Rev xxxx

Макет этикетки транспортной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм»

 Harsoria	Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО STERILE EO для одноразового использования		
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		
 Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Majra, Gujran Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi-173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%	 XXXX
REF	 дата производства	ДЛИНА
LOT	 срок годности	()
ШТ. XXX	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 71, офис 107 +7 953 778 10 03 +7 953 778 10 03 info@medlife.ru ПУ № XXX XXXXXXXX от XX.XX.XXXX	
Mfg.Lot. No XXXXXXXXXX	AW:xxxxxxxxx Rev:xxxx	

24. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым 10 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:
- 24.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 24.2. Инструкция по применению – 1 экз.
25. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым 25 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:
- 25.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 25.2. Инструкция по применению – 1 экз.
26. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым 50 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:
- 26.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 26.2. Инструкция по применению – 1 экз.
27. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым 75 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:
- 27.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 27.2. Инструкция по применению – 1 экз.
28. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым 100 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:
- 28.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 28.2. Инструкция по применению – 1 экз.
29. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым 150 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:
- 29.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 29.2. Инструкция по применению – 1 экз.
30. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым 200 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:
- 30.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 30.2. Инструкция по применению – 1 экз.
31. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым 250 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе³:
- 31.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.
- 31.2. Инструкция по применению – 1 экз.

³ Представлена фотография данного образца

3 WAY STOP COCK WITH EXTENSION TUBE

• Non - Pyrogenic • Sterile unless package is damaged.

CAUTION :

- Do not use if package is open or damaged.
- Do not store at extreme temperature and humidity.
- Store in cool & dry place.
- Discard after single use.



Manufactured By:

HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2

KK 83 85, K8 No. 342/266
Sangli Maharashtra, Bhamburda Road
Bamburda - 173205, Distt. Solapur (H.P.) India

Email: info@harsoria.com

Website: www.harsoria.com

Customer Care No.: 091 124 4523 400

ISO 13485

Multi Europe GmbH

Langerhansstr. 71

D-30855 Langerhagen

Email: info@multi-europe.com



2460

REF 1841034B77

LOT B22474

Length 250 cm

2023-02

2028-01

- Connect male portion of tubing to venipuncture device.


WARNINGS:

- Re-use of this device may change its mechanical or biological features and may cause device failure, allergic reactions or infections.


3 WAY STOP COCK WITH EXTENSION TUBE



Макет стикера групповой упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм»

 Harsoria	Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО STERILE EO для одноразового использования ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh No. 342/266 Saraj Maya, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi: 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP: mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%	 XXXX
REF	 дата производства	ДЛИНА
LOT	 срок годности	
ШТ. XXX	      Не подвергать воздействию огня Не подвергать воздействию окислителей	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕДИКАЛ-САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина д. 71, офис 107 +7 953 778 11 91, +7 953 778 10 03 info@medika-sa.ru ПУ № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.
Mfg.Lic. No.: XXXXXXXXXX	AW/XXXXXXXX, Rev.XXXX	

Макет стикера транспортной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм»

 Harsoria	Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО STERILE EO для одноразового использования		
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/286 Saraj Majra, Gyran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%	 XXXX
REF	 дата производства	ДЛИНА
LOT	 срок годности	
ШТ. XXX	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 71, офис 107. +7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03 info@med-ls.kz	
Mfg. Lot No.: XXXXXXXXXX	AW/XXXXXXX, Rev. XXXX	PV № XXX XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

32. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом 10 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

32.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (б.номер) - 1 шт. или 25 шт.

32.2. Инструкция по применению - 1 экз.

33. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом 25 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

33.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (б.номер) - 1 шт. или 25 шт.

33.2. Инструкция по применению - 1 экз.

34. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом 50 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

34.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (б.номер) - 1 шт. или 25 шт.

34.2. Инструкция по применению - 1 экз.

35. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом 75 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

35.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (б.номер) - 1 шт. или 25 шт.

35.2. Инструкция по применению - 1 экз.

36. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом 100 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

36.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (б.номер) - 1 шт. или 25 шт.

36.2. Инструкция по применению - 1 экз.

37. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом 150 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

37.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (б.номер) - 1 шт. или 25 шт.

37.2. Инструкция по применению - 1 экз.

38. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом 200 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (б.номер) - 1 шт. или 25 шт.

38.2. Инструкция по применению - 1 экз.

39. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом 250 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

39.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (б.номер) - 1 шт. или 25 шт.

39.2. Инструкция по применению - 1 экз.

¹ Представлена фотография данного образца

3 WAY STOP COCK WITH EXTENSION TUBE

• Non - Pyrogenic • Sterile unless package is damaged.

CAUTION :

- Do not use if package is open or damaged.
- Do not store at extreme temperature and humidity.
- Store in cool & dry place.
- Discard after single use.

- 1. Peel open the blister.
- 2. Withdraw the protective cap from female luer.
- 3. Connect male portion of I.V. Set / bag with female luer of tubing.
- 4. Remove protective cap from male luer side of tubing.
- 5. Hold male portion upright and open clamp of I.V. Set / bag and allow the solution to displace air entirely from tubing.
- 6. Close clamp.
- 7. Connect male portion of tubing to venipuncture device.

WARNINGS:

- Re-use of this device may change its mechanical or biological features and may cause device failure, allergic reactions or infections.

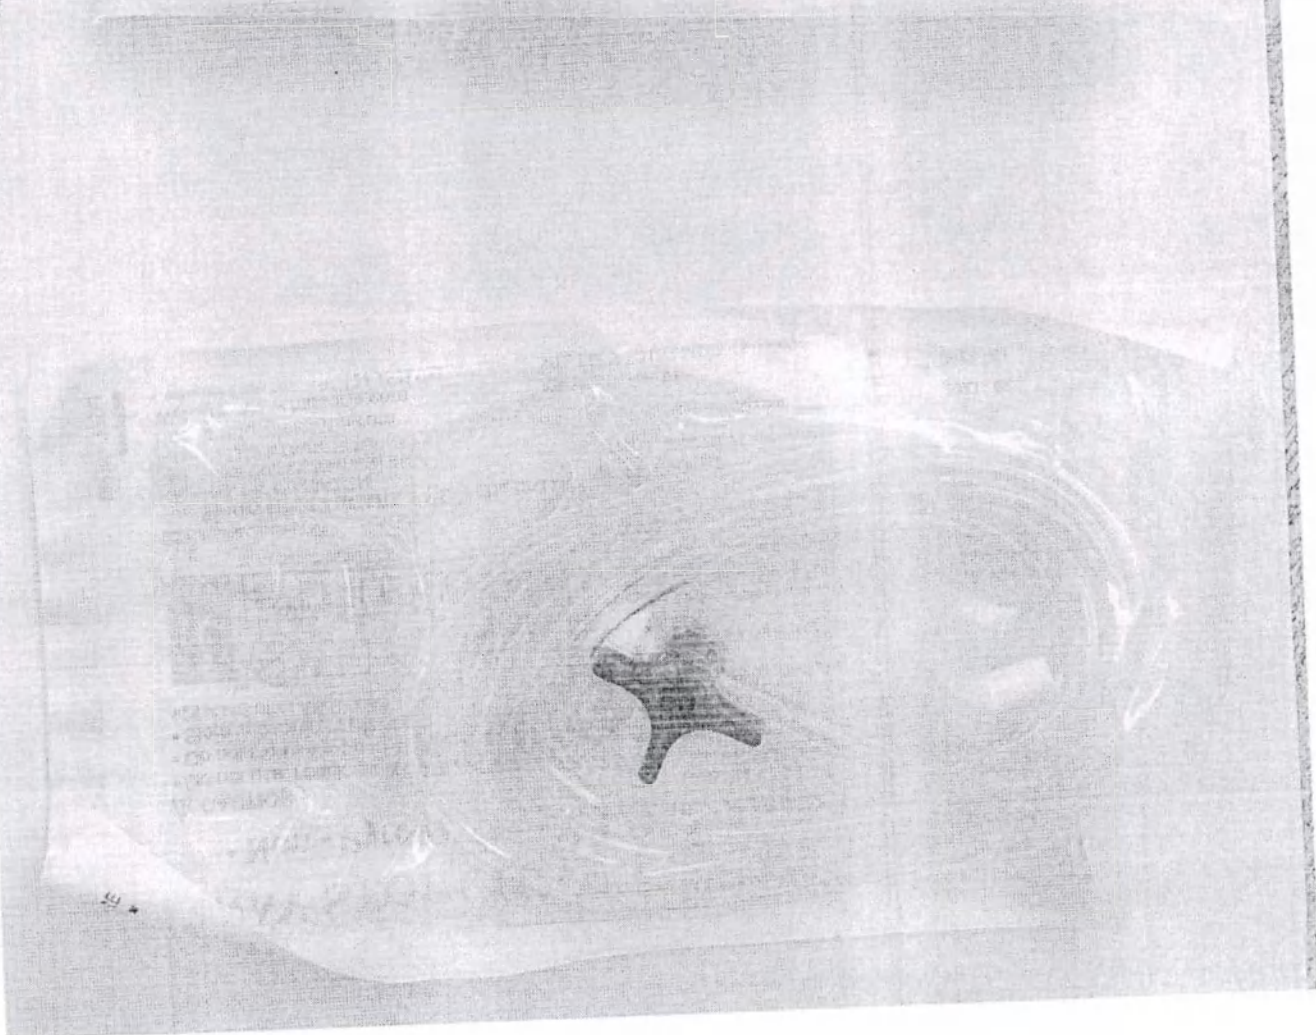


Manufactured By:
HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2
KK 83/85, Kh. No.: 342/266
Sang Majra Gujran, Jharmajra Road
Baddi - 173205, Distt.: Solan, (H.P.) India
Email: info@harsoria.com
Website: www.harsoria.com
Customer Care No.: +91 124 4523400


CE
2460
EC REP
mdt Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Langenhagen
Email: info@mdt-europe.com

REF 1843614B37
LOT B32476
Length 250 cm
2023-02
2024-01


AWB, B7f, Rev.01
Mfg. Lic. No: MFG/MD/2018/000093



Макет этикетки групповой упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм»

	Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО STERILE EO для одноразового использования ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		
Производитель HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 Kk. 83/85, Kh. No. 342/266 Saraj Majra, Gufran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%	
REF	 дата производства	ДЛИНА
LOT	 срок годности	
ШТ. XXX	      Не содержит токсичных веществ Не содержит фталаты	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д.м. 71, офис 107 +7 953 778 10 01 +7 953 778 10 03 info@medlife.kz РУ № XXX XXXX XXXX от XX.XX.XXXX
Mfg Lic. No. XXXXXXXXXXXX	AW/xxxxxxxxxx, Rev xxxxx	

Макет стикера транспортной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм»

 Harsoria	Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником синим и с Y-образным портом XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО STERILE EO для одноразового использования ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jhamejri Road, Distt Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%  XXXX	
REF	 дата производства	ДЛИНА
LOT	 срок годности	
ШТ. XXX	Уполномоченный представитель производства на территории Российской Федерации ООО «МЕД ПАЙП САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 71, офис 107, +7 953 778 11 01 +7 953 778 10 03 info@medpipe.kz РУ № XXX XXXX-XXXX от XX.XX XXXX .	
Mfg.Lic. No : XXXXXXXXXX	AW/xxxxxxxx, Rev.xxxx	

40. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом 10 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

40.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

40.2. Инструкция по применению - 1 экз.

41. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом 25 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

41.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

41.2. Инструкция по применению - 1 экз.

42. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом 50 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

42.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

42.2. Инструкция по применению - 1 экз.

43. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом 75 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

43.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

43.2. Инструкция по применению - 1 экз.

44. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом 100 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

44.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

44.2. Инструкция по применению - 1 экз.

45. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом 150 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

45.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

45.2. Инструкция по применению - 1 экз.

46. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом 200 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

46.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

46.2. Инструкция по применению - 1 экз.

47. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом 250 см, Ø 4.1 x 3.0 мм, в составе:

47.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (блистер) - 1 шт. или 25 шт.

47.2. Инструкция по применению - 1 экз.

* Представлена фотография данного образца

PEEL HERE

3 WAY STOP COCK WITH EXTENSION TUBE

• Non - Pyrogenic • Sterile unless package is damaged.

CAUTION :

- Do not use if package is open or damaged.
- Do not store at extreme temperature and humidity.
- Store in cool & dry place.
- Discard after single use.



Harsonia



DEHP Free
Latex Free

- Peel open the blister.
- Unscrew the protective cap from female luer.
- Connect male portion of I.V. Set / bag with female luer of tubing.
- Remove protective cap from male luer side of tubing.
- Hold male portion upright and open clamp of I.V. Set / bag and allow the solution to displace air entirely from tubing.
- Close clamp.
- Connect male portion of tubing to venipuncture device.

WARNINGS:

- Re-use of this device may change its mechanical or biological features and may cause device failure, allergic reactions or infections.



REF	1843624B7E
LOT	B22477
Length	10 cm
	2023-02
	2023-01

Manufactured By:
HARSONIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2
Kk-85-85, Kk-85, 342/266
Surya Maitra Gurnai, Jharanaji Road
Haddi-173205, Distt: Solan, (H.P.) India
Email: info@harsonia.com
Website: www.harsonia.com
Customer Care No.: +91 124 4523400

Indi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Langerhagen
Email: info@indi-europa.com

AWB_B7I, Rev 01
Mfg. Lic. No: MFG/MD2018/000093

PEEL HERE

ВСКРЫТЬ ТУТ

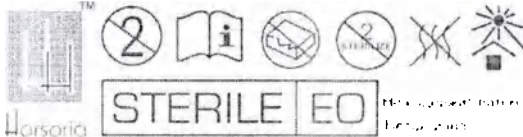
Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y- образным портом XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм

- АПИРОГЕННО

- Стерильно, если упаковка не повреждена

† Предостережения:

- лечение в зависимости от метода утилизации отходов (интерпретация)
- для хранения при высоком давлении, отсутствии опасности
- хранение в прокладочном сухом месте
- утилизировать после использования



Производитель

HARSORA HEALTHCARE PVT. LTD. **Unit-2**
 KK-8/25, Kf- No. 34/22F, Saraj, Mayapuri
 Gurgaon, Badli-Jharna Road, Dist. Gurgaon
 Haryana Pradesh, India-173205 India
 Email: info@harsora.com
 Website: www.harsora.com
 Customer Care No: +91 124 4523190

* *Journal of Management Education* 25(10):1133-1144, 2001.

1. *What is the purpose of this document?*
 2. *What are the main findings of the study?*
 3. *What are the implications of these findings for practice?*
 4. *What are the limitations of the study?*
 5. *What are the conclusions of the study?*
 6. *What are the recommendations for future research?*
 7. *What are the key words for this document?*
 8. *What are the references for this document?*
 9. *What are the acknowledgements for this document?*
 10. *What are the contact details for the author?*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- © The copyright in this article rests with its author(s). Reproduction by any means without the author's permission is prohibited.


RECEIVED
 October 2, 1990
 Accepted for publication
 November 1, 1990
 Copyright © 1991 by W.B. Saunders Company



• ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОГО
ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ВАСИЛИСКИНОВ ВВЕДЕНИ
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ В РАЙОН
000 (МЕД ЛАЙФ САЙТ) 000
630087. НОВОСИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УЛ. ВОЛКОВА, Д. 71, С. 100, 107
• 70512741101 - 70512781101
ПРОФИЛЬ НАС

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Макет этикетки групповой упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм»

 Harsoria TM	Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм
АПИРОГЕННО STERILE EO для одноразового использования	
ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ	
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jharmajri Road Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%.  XXXX
REF LOT ШТ. XXX  Не содержит латекса: Натворичит  Не содержит фрагменты  дата производства  срок годности   ДЛИНА	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вагучкина, дом 71, офис 107, +7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03 info@medlife.kz РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.
Mfg.Lic. No.: XXXXXXXXXXXX AW/XXXXXXXXXX, Rev.XXXX	

Макет этикетки транспортной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм»

 Harsoria	Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником красным и с Y-образным портом XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО STERILE EO для одноразового использования ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Maja, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205 India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%	 XXXX
REF		дата производства
LOT		срок годности
ШТ. XXX	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ПАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватулина дом 71, офис 107, +7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03 info@med-pipe.ru RU № XXX XXX XXXXX от XX.XX.XXXX	
Mfg Lic. No. XXXXXXXXXXXX	AW/XXXXXXXXX Ров XXXX	

48. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом 10 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:

48.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (близетер) - 1 шт. или 25 шт.

48.2. Инструкция по применению - 1 экз.

49. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом 25 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:

49.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (близетер) - 1 шт. или 25 шт.

49.2. Инструкция по применению - 1 экз.

50. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом 50 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:

50.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (близетер) - 1 шт. или 25 шт.

50.2. Инструкция по применению - 1 экз.

51. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом 75 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:

51.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (близетер) - 1 шт. или 25 шт.

51.2. Инструкция по применению - 1 экз.

52. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом 100 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:

52.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (близетер) - 1 шт. или 25 шт.

52.2. Инструкция по применению - 1 экз.

53. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом 150 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:

53.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (близетер) - 1 шт. или 25 шт.

53.2. Инструкция по применению - 1 экз.

54. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом 200 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе:

54.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (близетер) - 1 шт. или 25 шт.

54.2. Инструкция по применению - 1 экз.

55. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом 250 см, Ø 4,1 x 3,0 мм, в составе*:

55.1. Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом в индивидуальной упаковке (близетер) - 1 шт. или 25 шт.

55.2. Инструкция по применению - 1 экз.

* Представлена фотография данного образца

3 WAY STOP COCK WITH EXTENSION TUBE

• Non - Pyrogenic • Sterile unless package is damaged.

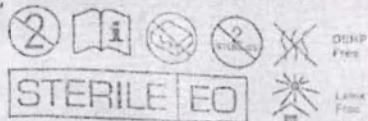
CAUTION :

- Do not use if package is open or damaged.
- Do not store at extreme temperature and humidity.
- Store in cool & dry place.
- Discard after single use.

- Peel open the blister.
- Unscrew the protective cap from female luer.
- Connect male portion of I.V. Set / bag with female luer of tubing.
- Remove protective cap from male luer side of tubing.
- Hold male portion upright and open clamp of I.V. Set / bag and allow the solution to displace air entirely from tubing.
- Close clamp.
- Connect male portion of tubing to venipuncture device.

WARNINGS:

- Re-use of this device may change its mechanical or biological features and may cause device failure, allergic reactions or infections.



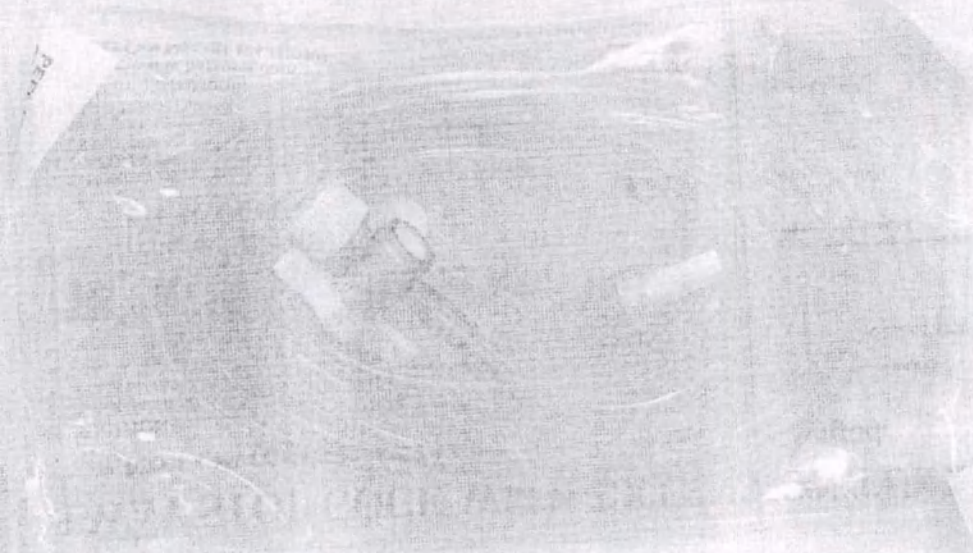
Manufactured By:
HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2
KK 83/85, Kt. No. 342/266
Sang Majra Guirao, Jharmajri Road
Baddi - 173205, Distt.: Solan, (H.P.) India
Email: info@harsoria.com
Website: www.harsoria.com
Phone No. +91-154-3523400

EC REP
mdt Europa GmbH
Langenflügener Str. 71
D-30853 Langenhagen
Email: info@mdt-europe.com

CE
2460

REF 1843764B71
LOT R22480
Length 250 cm
2023 - 02
2028 - 01

AWB_B7I_Rev.01
Mfg. Lot No. MFG/MD2018/000/01



ВСКРЫТЬ ТУТ


Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y- образным портом XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм

• АПИРОГЕННО

• Стерильно, если упаковка не повреждена

Предостережения:

- Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена
- Не хранить при высокой температуре и влажности
- Хранить в прохладном сухом месте
- Утилизировать после использования



STERILE EO

Не содержит латекс
Никотинкина



Производитель:

NAKACIYA HEALINGCARE PVT LTD UNIT 2

KK 13, P. 13, No. 542/266 Saraj, Malaya

Gelang Badd-Johore Bahru Road, Dist. Johor

Hindia Jaya, Baidi 173205 India

Email: info@harsona.com

Website: www.harsona.com

Customer Care No. +91 124 4523400

Модель №: XXXXXXXXXX AWXXXXXX Реализация

• Вскрыть Бокс/Бес

• Проверить целостность упаковки и маркировку

• Следовать инструкции по применению, прилагаемой к изделию

• Работать в стерильной среде

• Проверить, чтобы изделие было правильно установлено

• Проверить, чтобы изделие было правильно установлено

• Проверить, чтобы изделие было правильно установлено

• Проверить, чтобы изделие было правильно установлено

• Проверить, чтобы изделие было правильно установлено

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не использовать изделие, если упаковка повреждена
- Не использовать изделие, если упаковка повреждена
- Не использовать изделие, если упаковка повреждена

REF

Lot: Europa GmbH

Langenhagen Str. 71

D-30855 Langenhagen

E-mail: info@langenhagen.com



XXXX


Длина



ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5...+25 °C
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 30...70 %

ВСКРЫТЬ ТУТ

Макет стикера групповой упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным -портом XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм»

 Harsoria	Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО STERILE EO для одноразового использования ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh. No. 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No.: +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +5 - +30°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%  XXXX	
REF	 дата производства	ДЛИНА
LOT	 срок годности	
ШТ. XXX	      Не содержит латекс Нетоксично Не содержит фталаты	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, дом 71, офис 107. +7 953 778 11 01. +7 953 778 10 03 info@medlife.kz Мфг. Lic. No.: XXXXXXXXXX AW/xxxxxxxx, Rev. xxx РУ № XXX XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Макет этикетки транспортной упаковки на русском языке для медицинского изделия «Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным -портом XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм»

 Harsoria	Линия проводящая инфузионная с трехходовым запорным краником белым и с Y-образным портом XXX см, Ø 4.1 x 3.0 мм	
АПИРОГЕННО STERILE FO для однократного использования ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ		
Производитель: HARSORIA HEALTHCARE PVT. LTD., UNIT-2 KK 83/85, Kh.No. 342/266 Saraj Majra, Gujran, Baddi-Jharmajri Road, Distt. Solan, Himachal Pradesh, Baddi 173205, India Email: info@harsoria.com Website: www.harsoria.com Customer Care No. +91 124 4523400	EC REP mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Langenhagen Email: info@mdi-europa.com ХРАНИТЬ ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ +5...+30 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 75%	 XXXX
REF	 дата производства	ДЛИНА
LOT	 срок годности	
ШТ. XXX	Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации ООО «МЕД ЛАЙФ САЙНСЕЗ» 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск ул. Ватутина, дом 71, офис 107. +7 953 778 11 01, +7 953 778 10 03 info@medlife.kz	
Mfg Lic. No. XXXXXXXXXXXX	AW:xxxxxx Rev:xxxx	Рy № ХХХ XXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

ВСЕГО
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
59 ЛИСТА(ОВ)

