

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Сюнь Вэй.
«11» 2023 г.



ПО ДОЗЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СЫСОВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Автоматический анализатор коагуляции серии СХ



Рисунок 1. Внешний вид изделия Автоматический анализатор коагуляции CX-6000

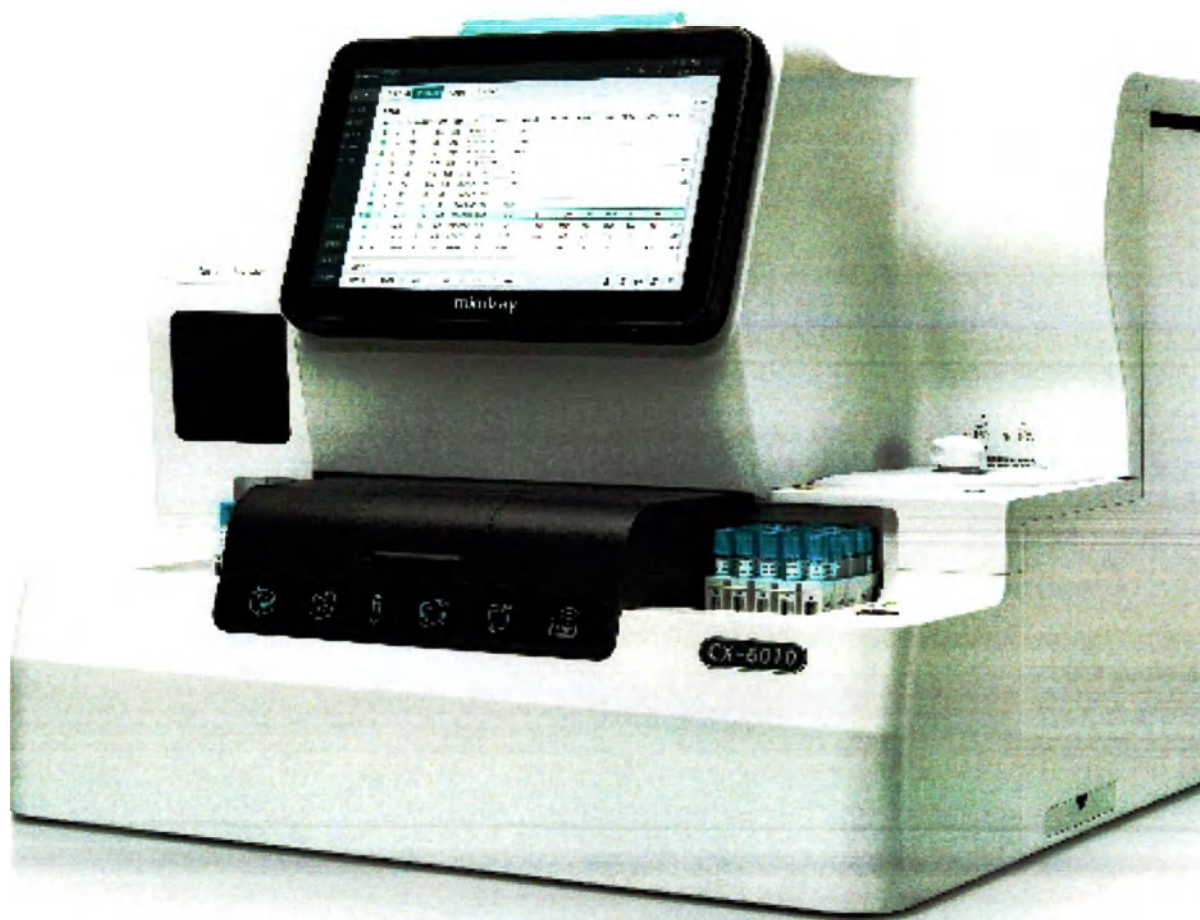


Рисунок 2. Внешний вид изделия Автоматический анализатор коагуляции CX-6010



Рисунок 3. Внешний вид изделия
Автоматический анализатор коагуляции CX-9010)



Рисунок 4. Внешний вид изделия Автоматический анализатор коагуляции CX-9000 (вид 1)

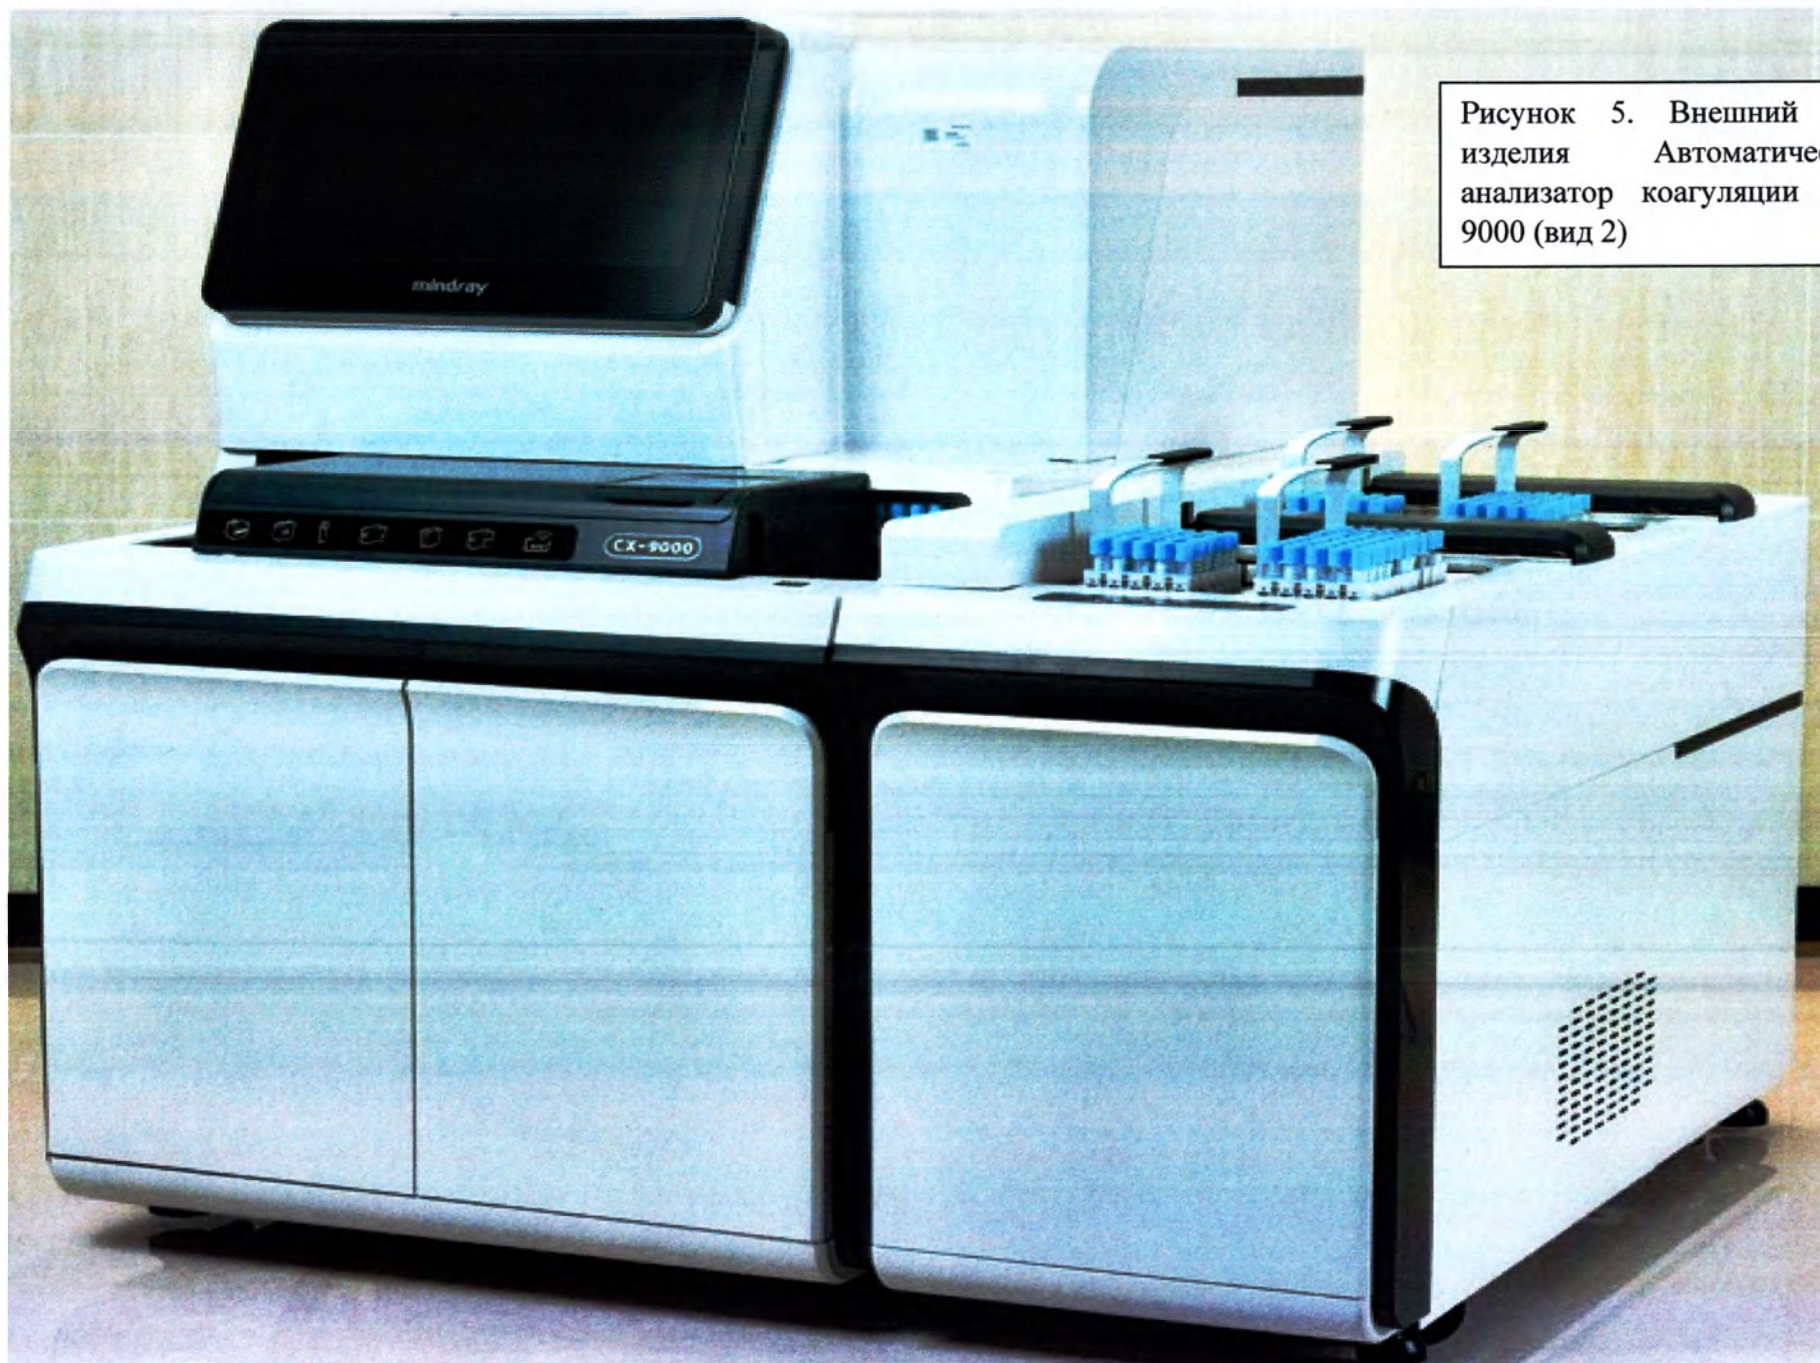


Рисунок 5. Внешний вид изделия Автоматический анализатор коагуляции CX-9000 (вид 2)

CX-6000/CX-6010

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗАТОР КООГУЛЯЦИИ**

Руководство оператора

Телефон технической поддержки пользователей
(звонок по России бесплатный)

8-800-333-5323

(Пн.-Пт., 9:00-18:00)

E-mail: ruservice@mindray.com

mindray

Рисунок 6. Руководство оператора автоматического анализатора коагуляции CX-6000/CX-6010

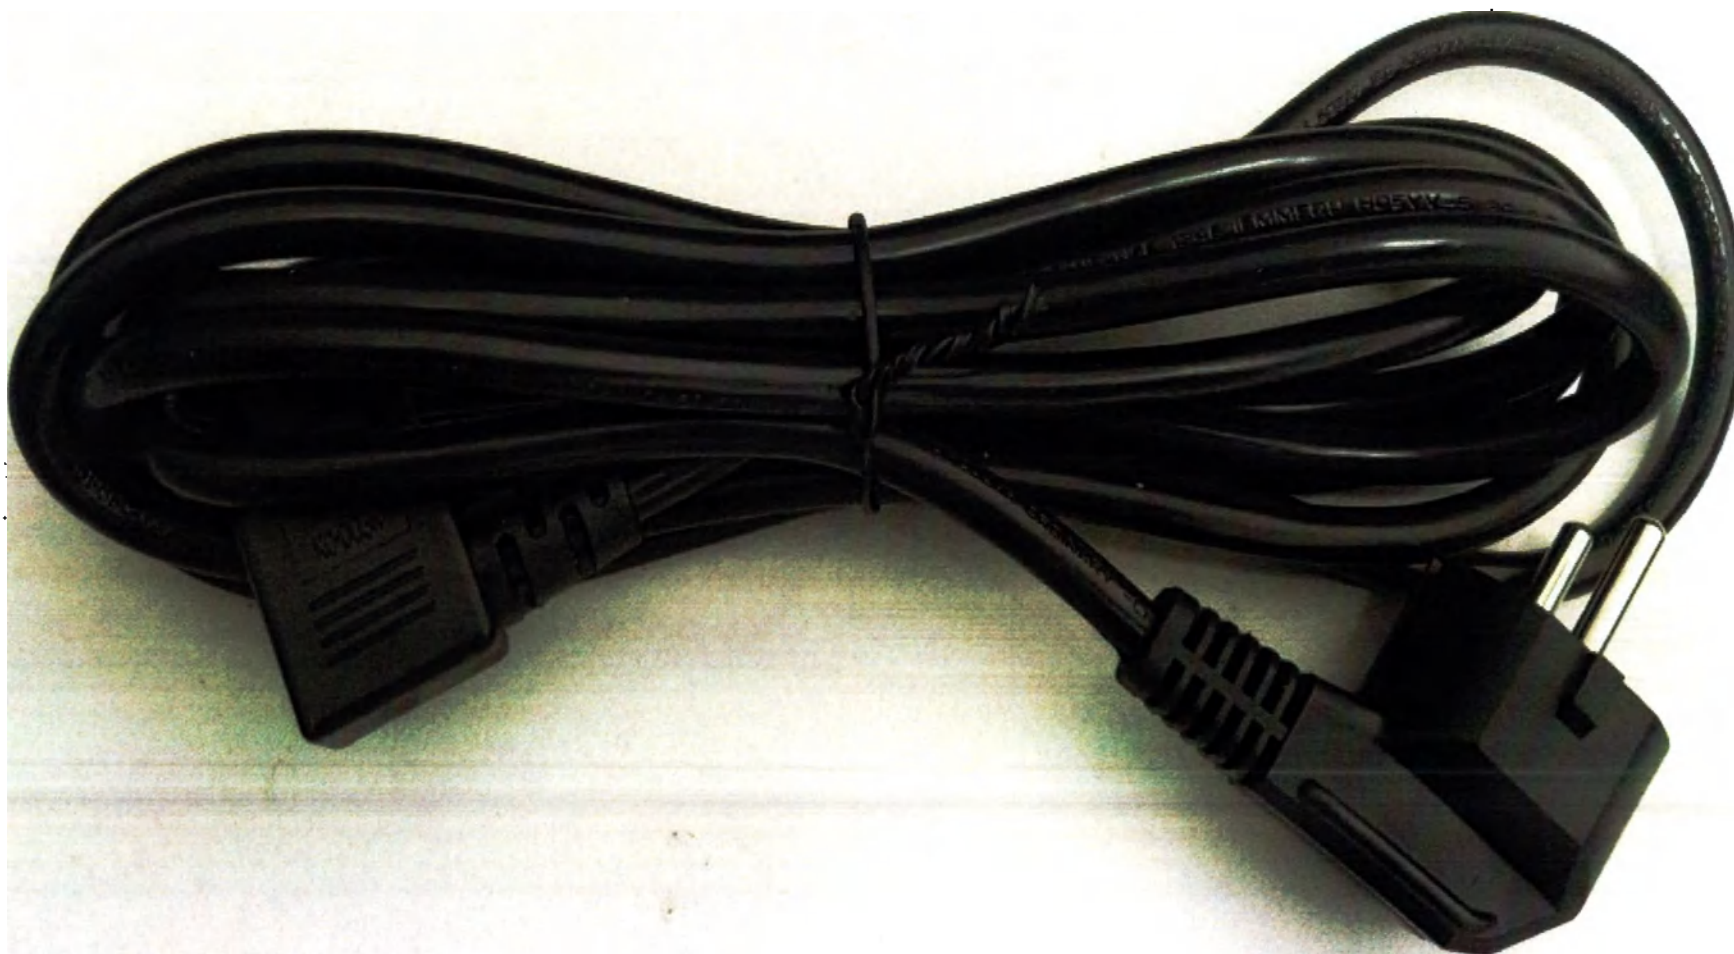


Рисунок 7. Кабель питания европейского стандарта для CX-6000/CX-6010

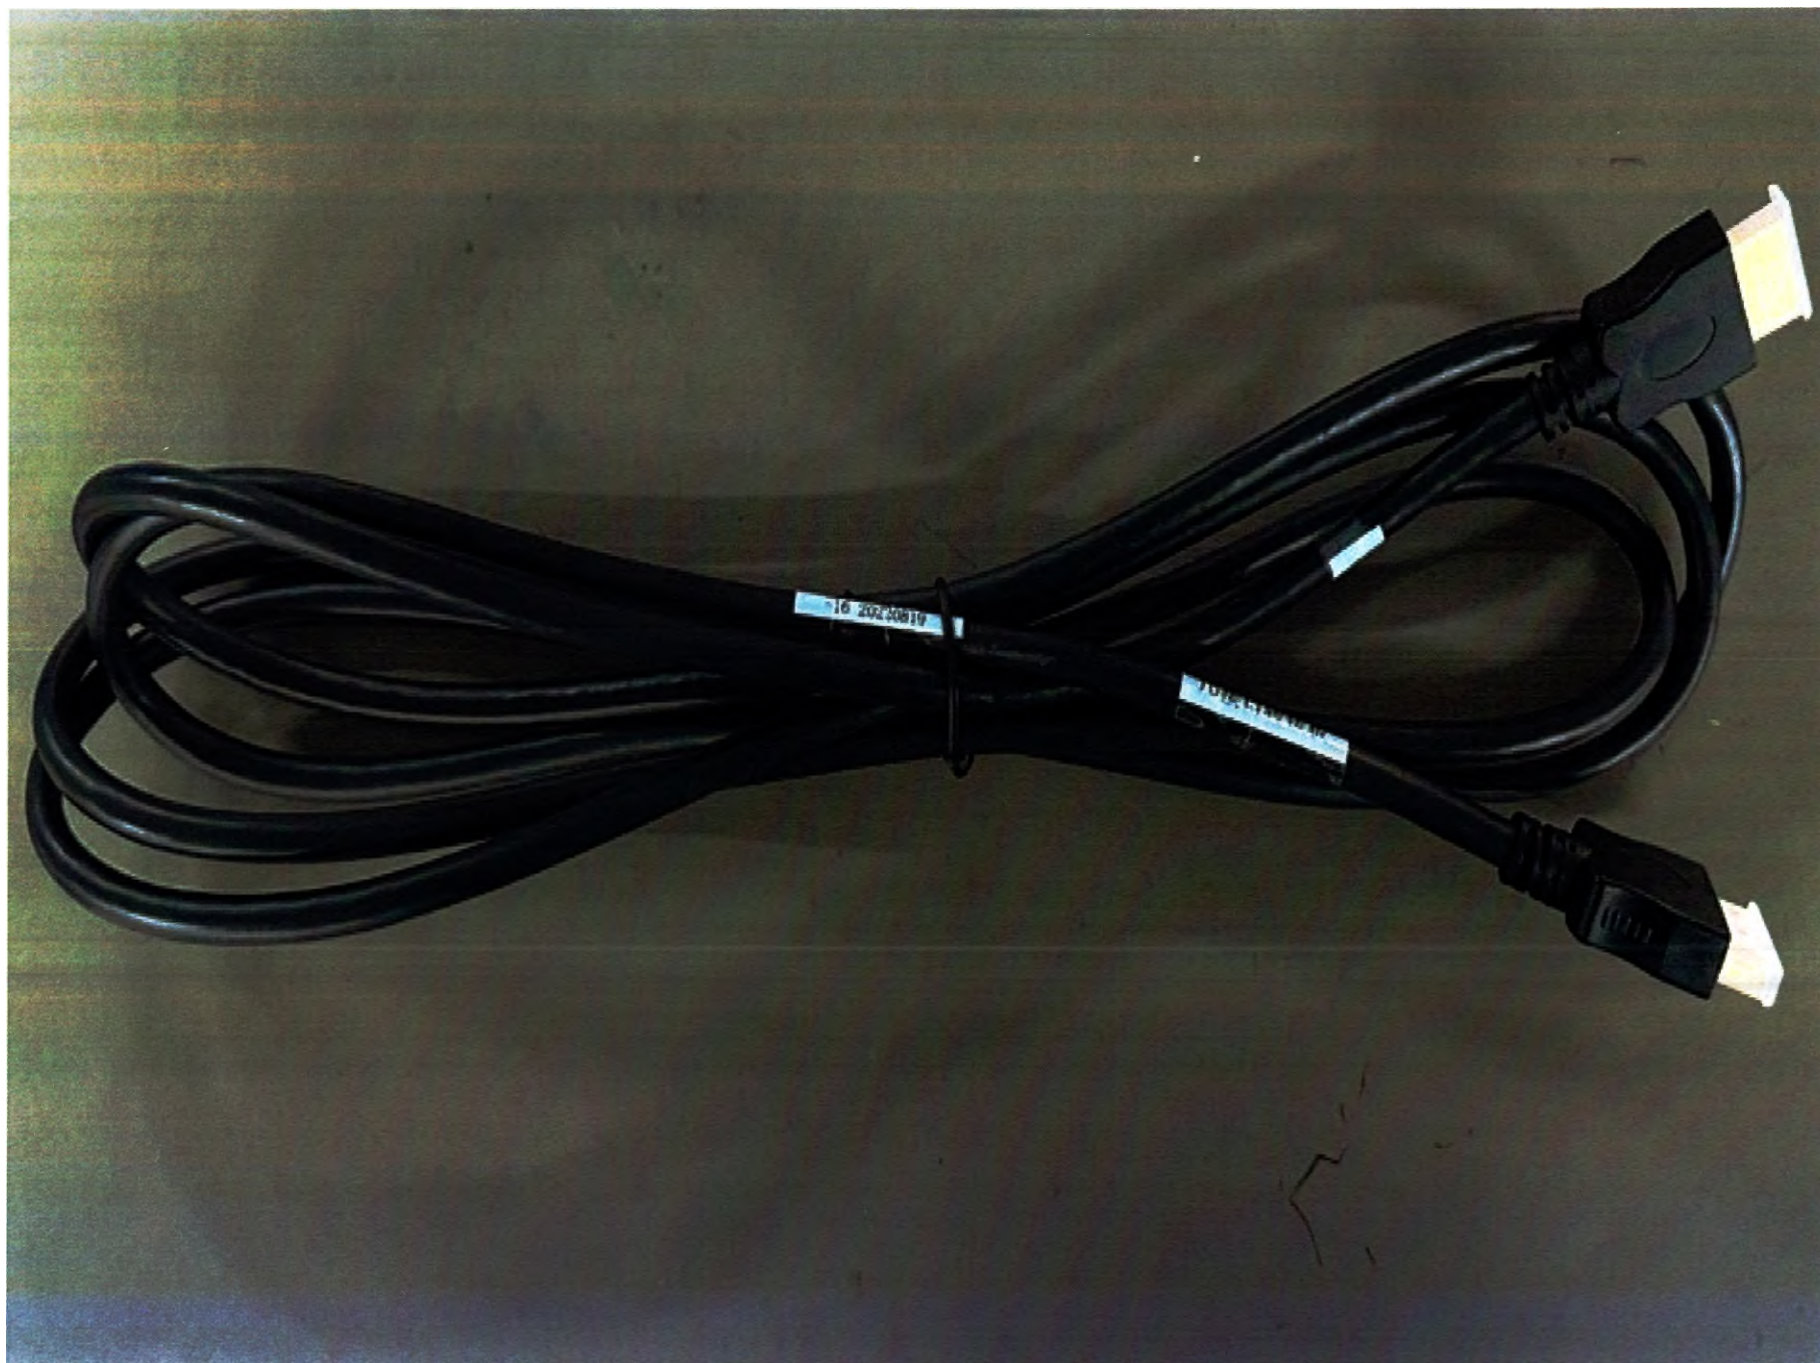


Рисунок 8. Кабель HDMI для подключения основного блока к ПК для CX-6000/CX-6010



Рисунок 9. Кабель USB для подключения основного блока к ПК для CX-6000/CX-6010 и CX-9010

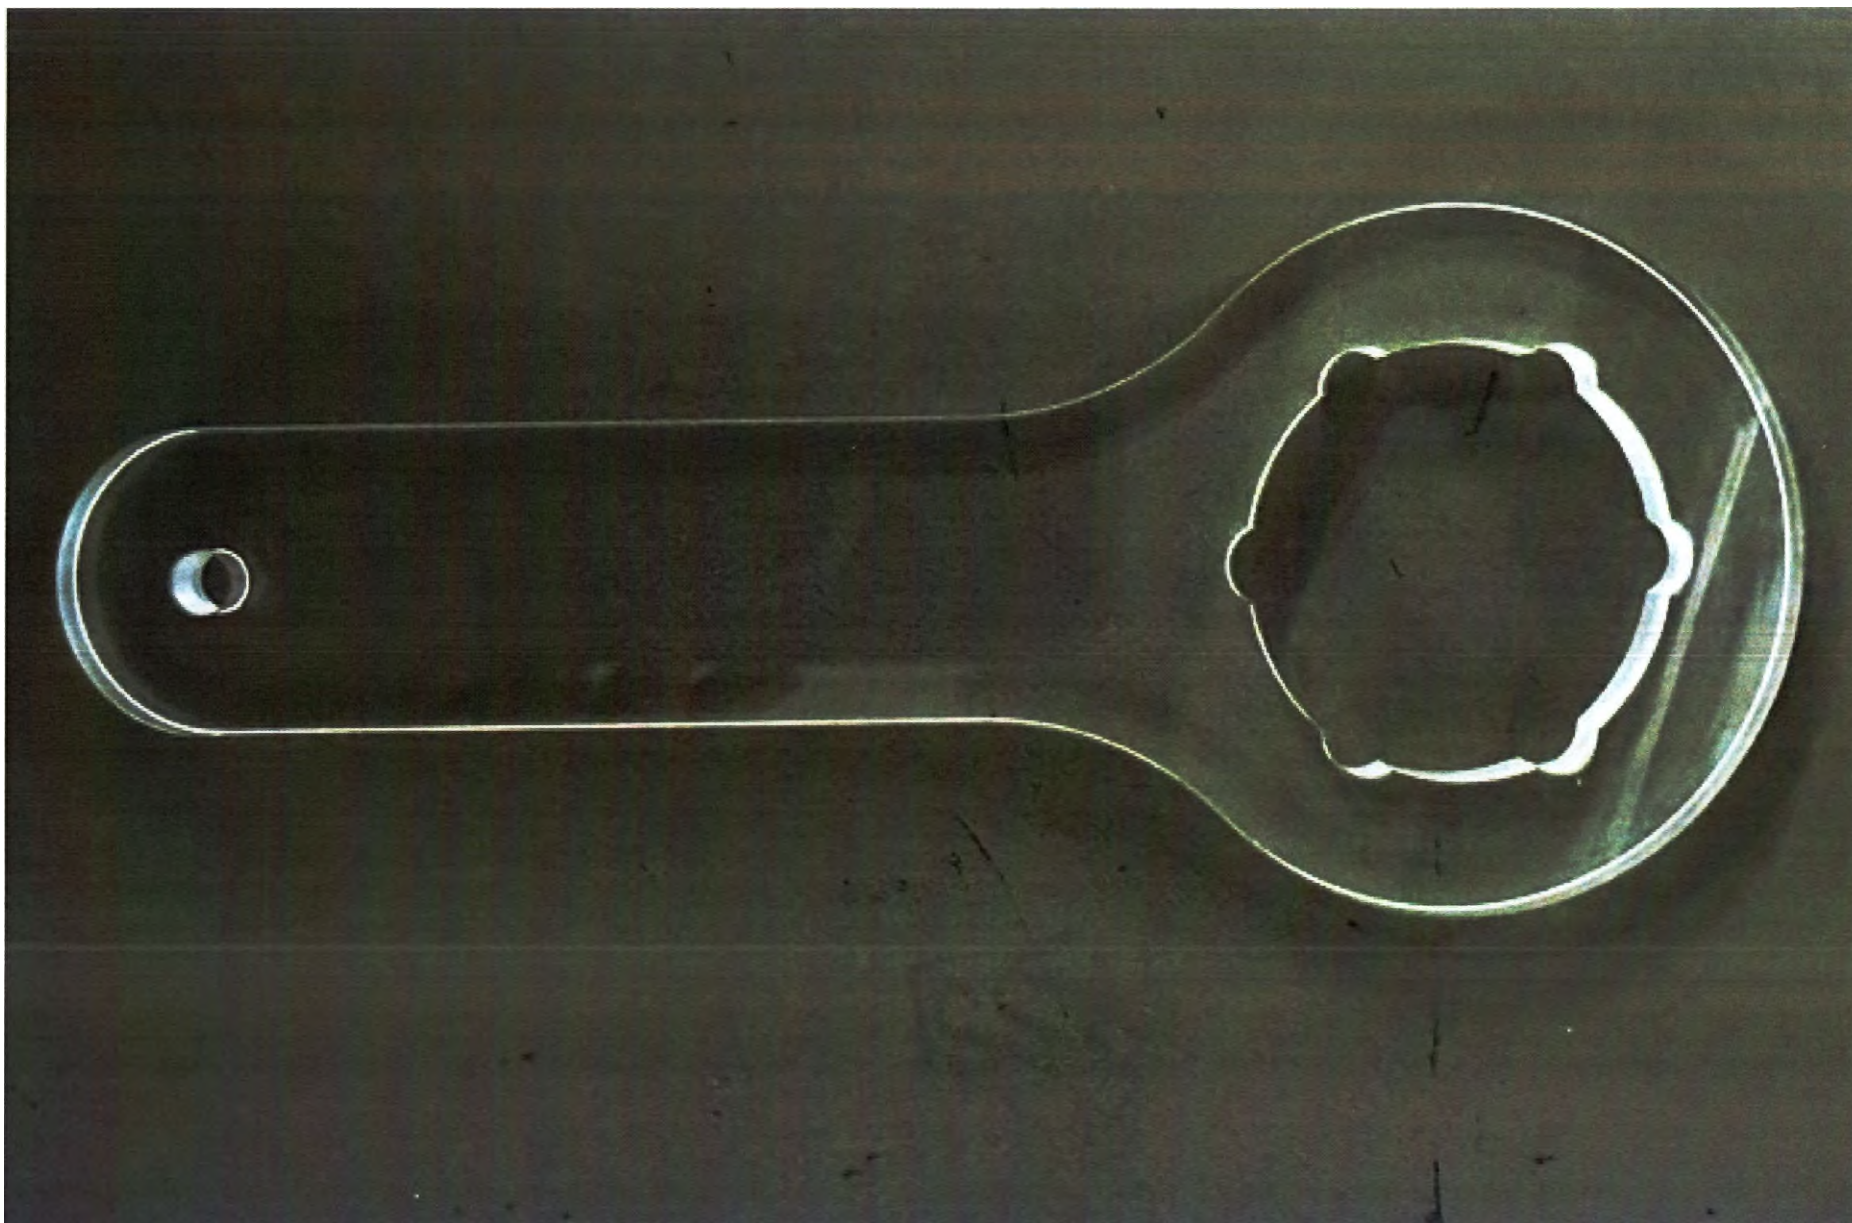


Рисунок 10. Устройство для открывания крышек канистр для СХ-6000/СХ-6010 и СХ-9000/СХ-9010



Рисунок 11. Адаптер металлический для микропробирок для СХ 6000/6010, СХ 9000/9010



Рисунок 12. Кюветы реакционные для анализаторов серии CX (рис.1).

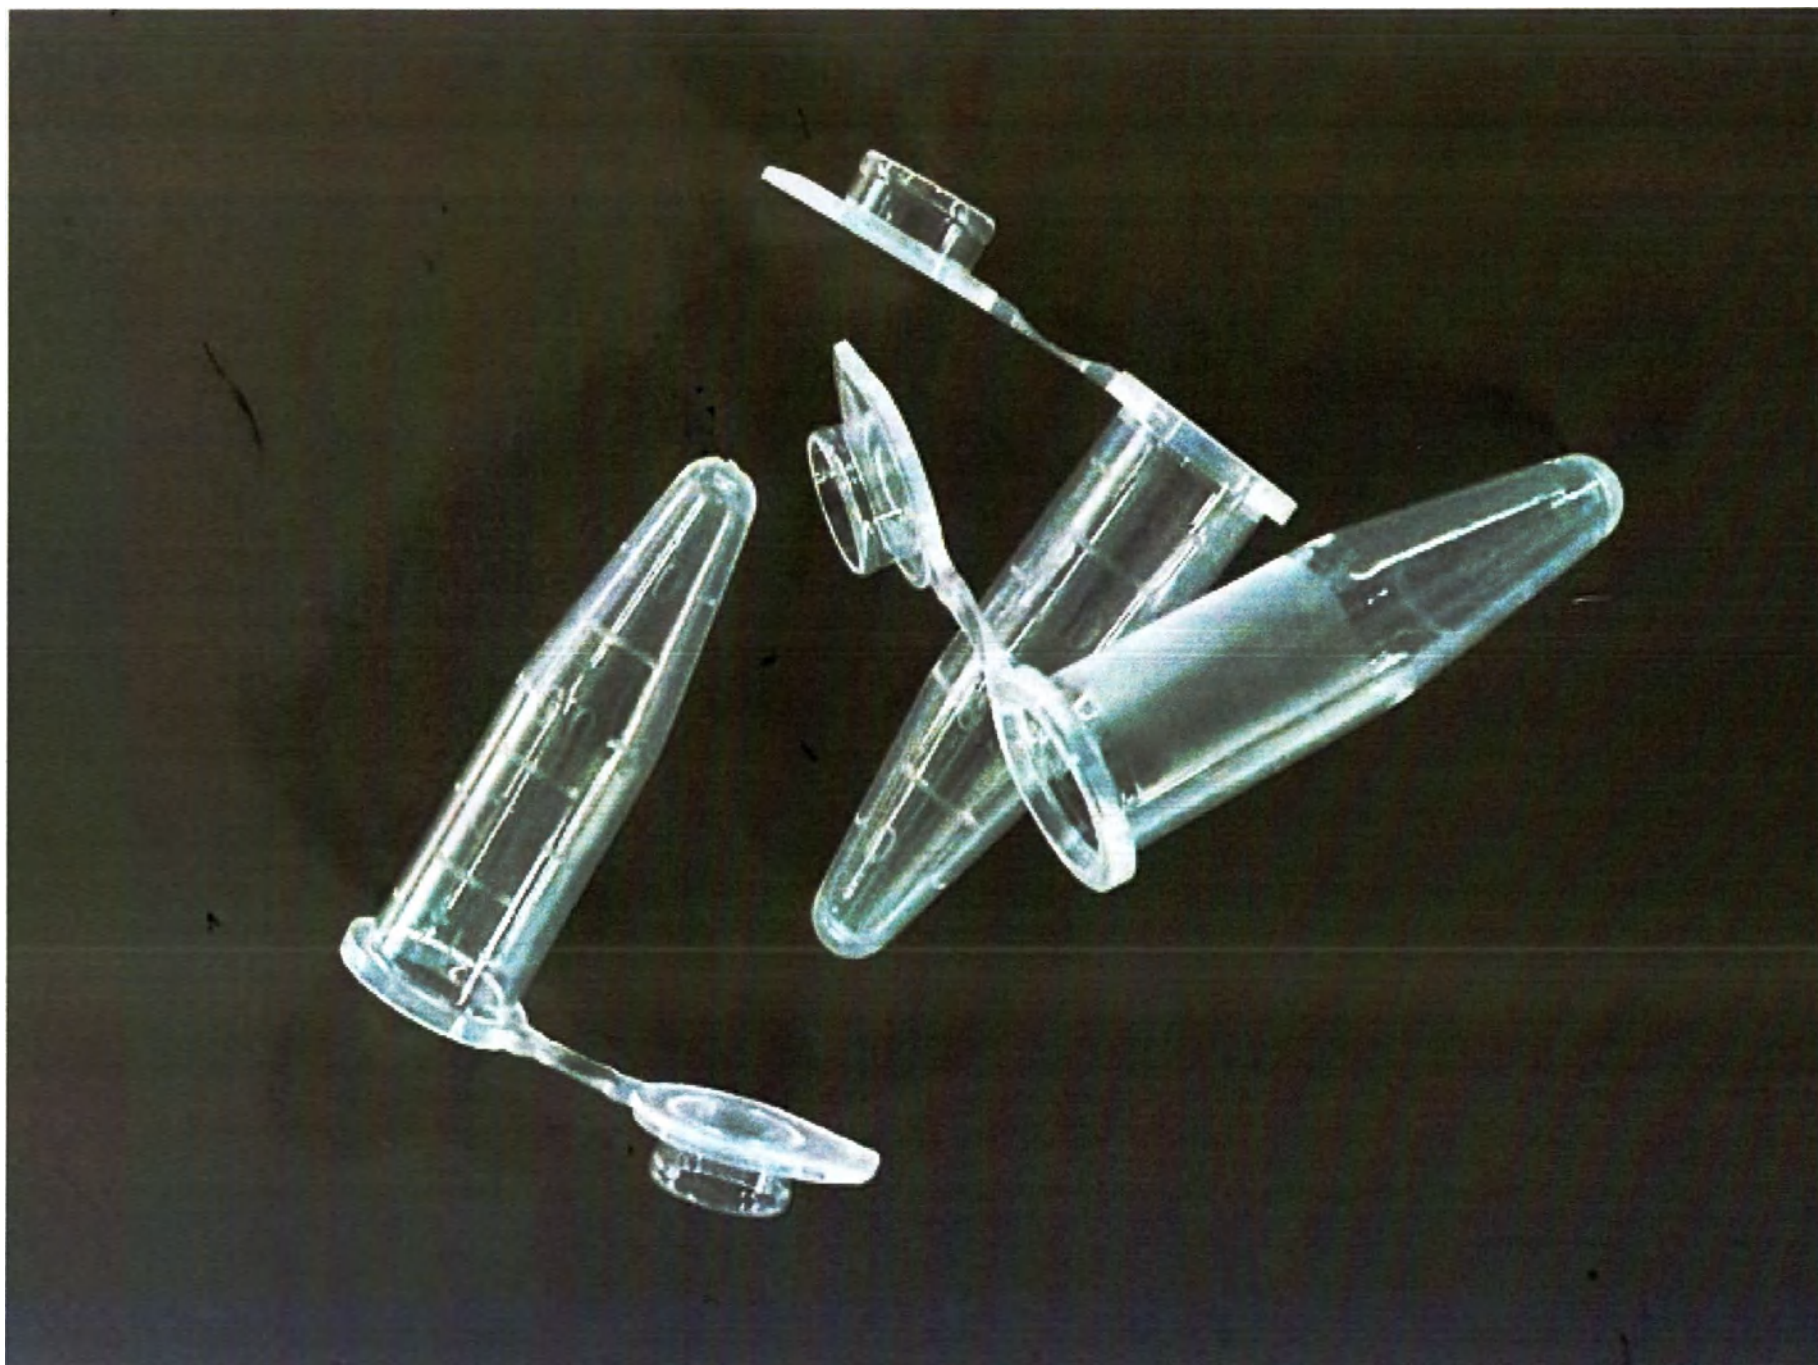


Рисунок 13. Микропробирка коническая с крышкой (1,5 мл) для СХ 6000/6010, СХ 9000/9010



Рисунок 14. Пакет для отходов для CX 6000/6010, CX 9000/9010

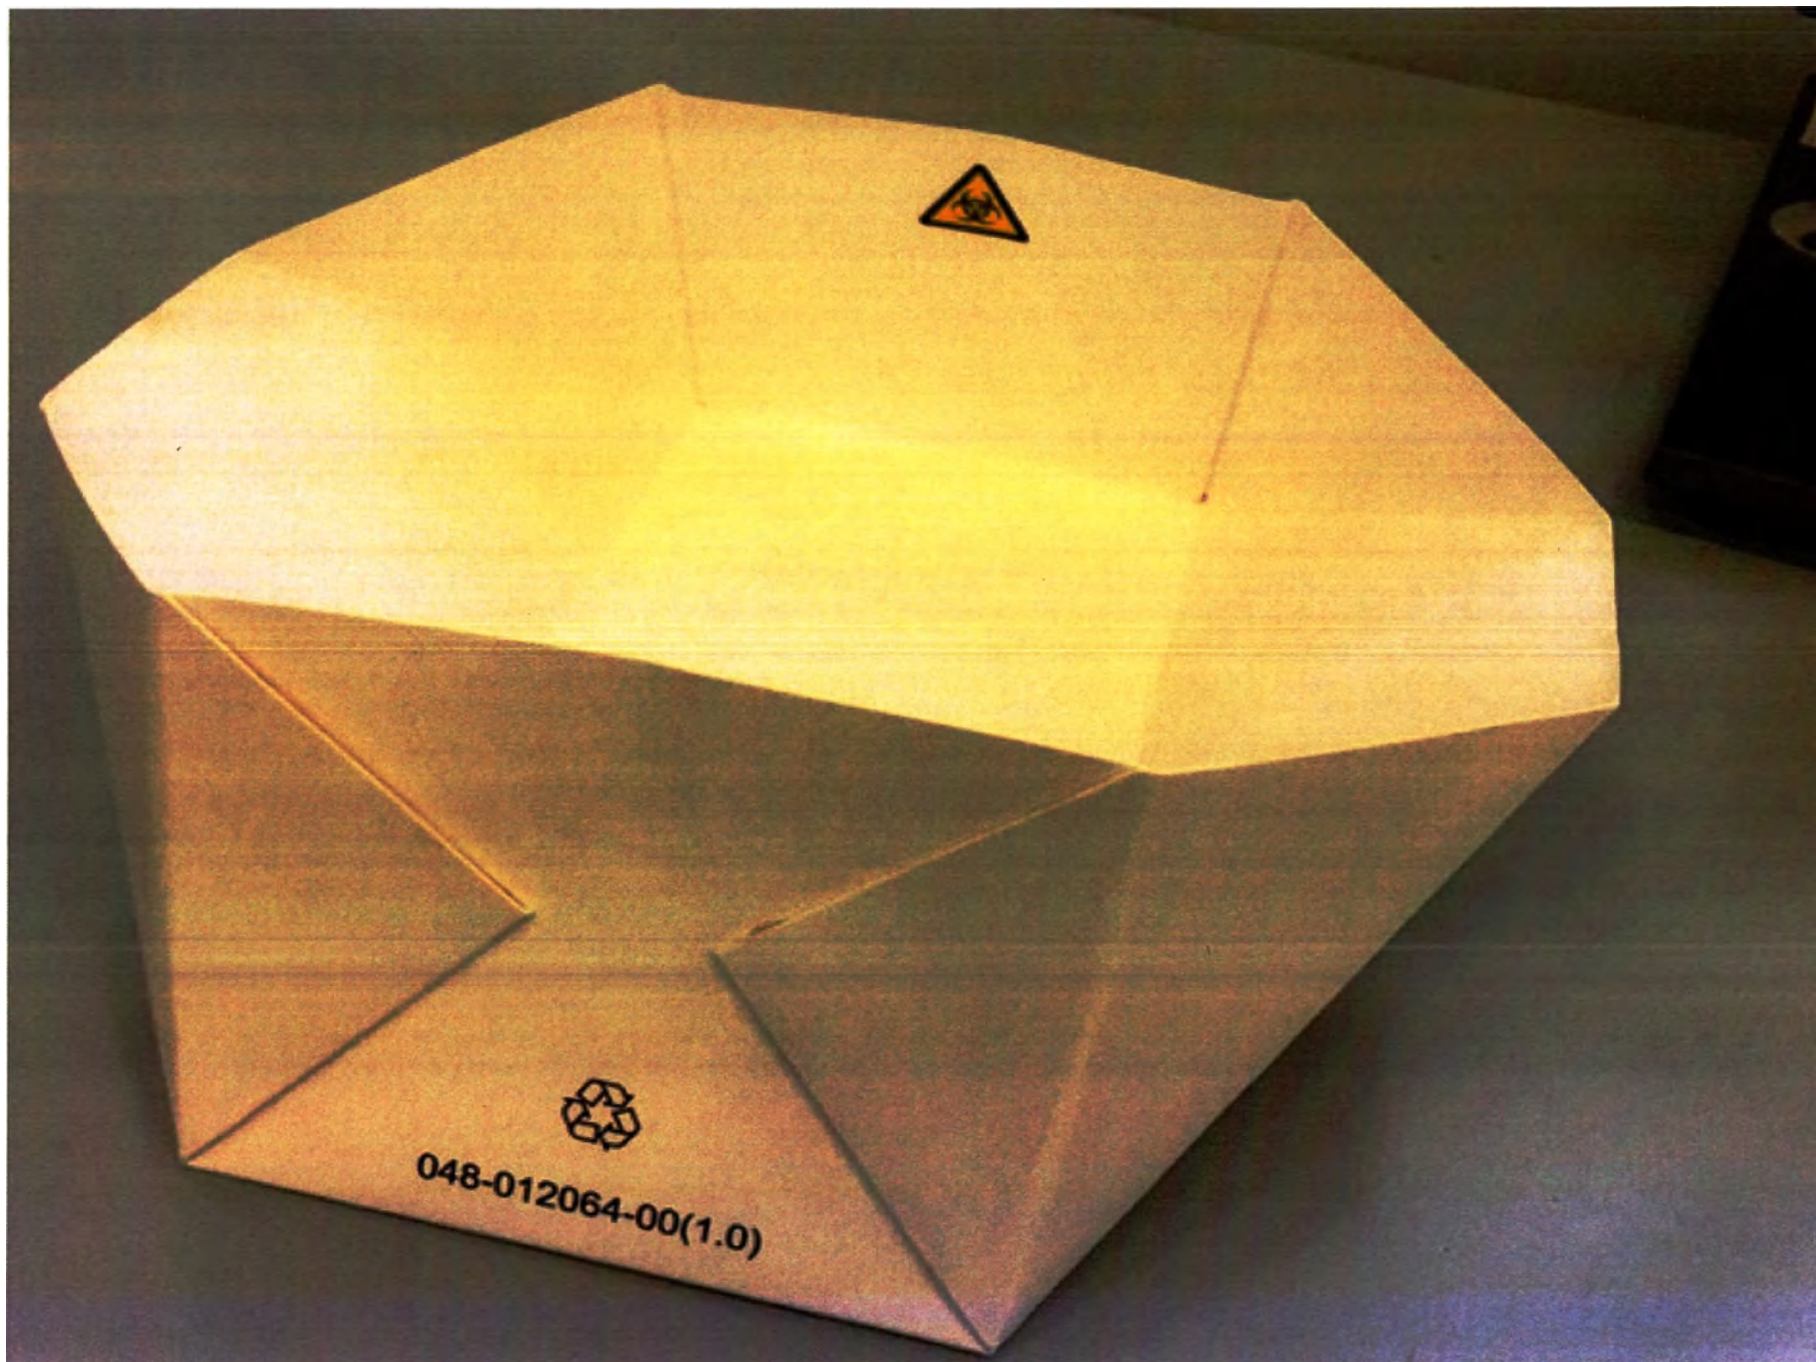


Рисунок 15. Контейнер для отходов для СХ 6010

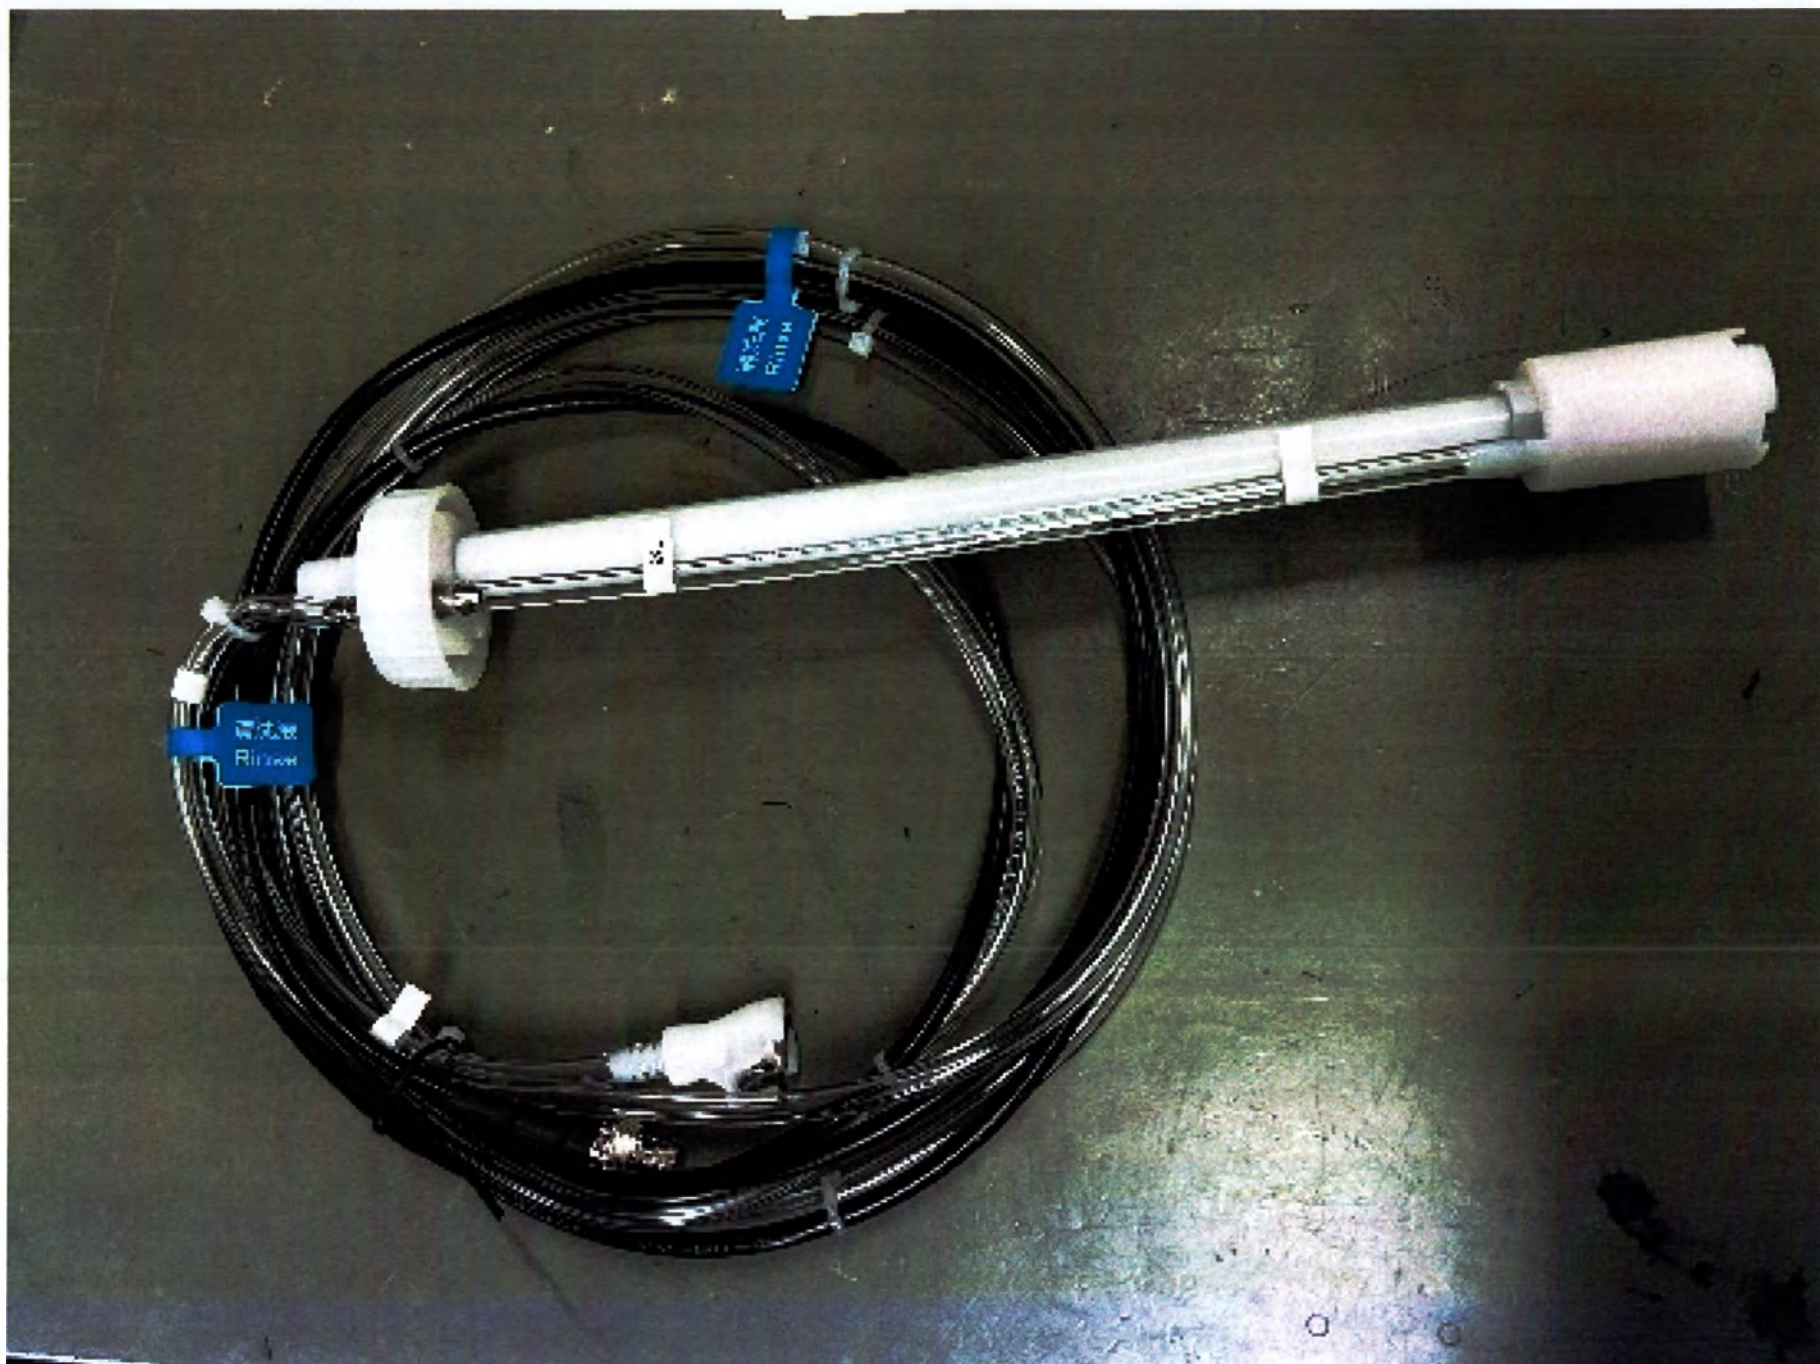


Рисунок 16. Узел крышки канистры с очищающим раствором для CX 6000/6010

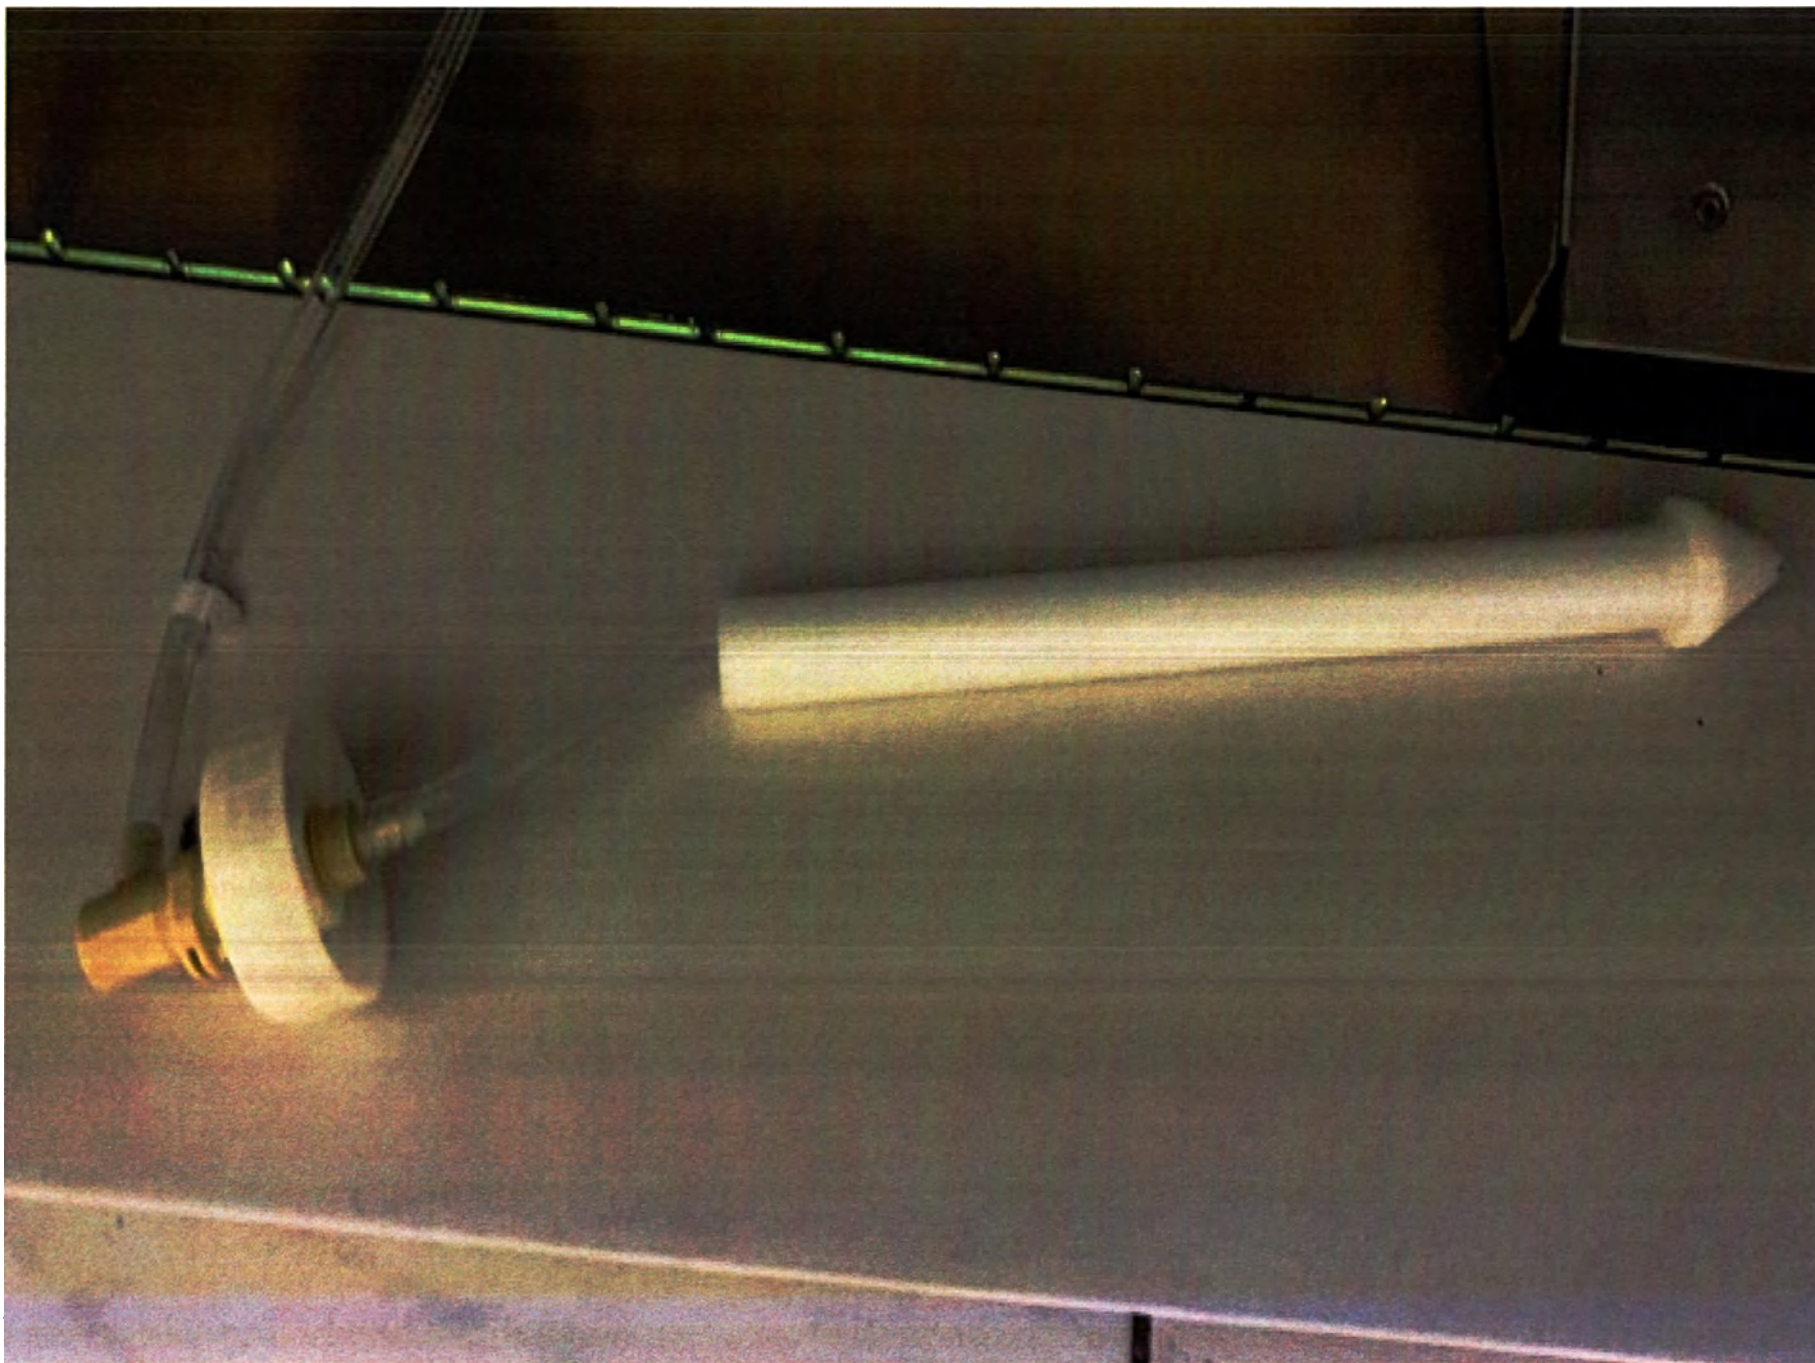


Рисунок 17. Узел крышки канистры с очищающим раствором для СХ 9000/9010

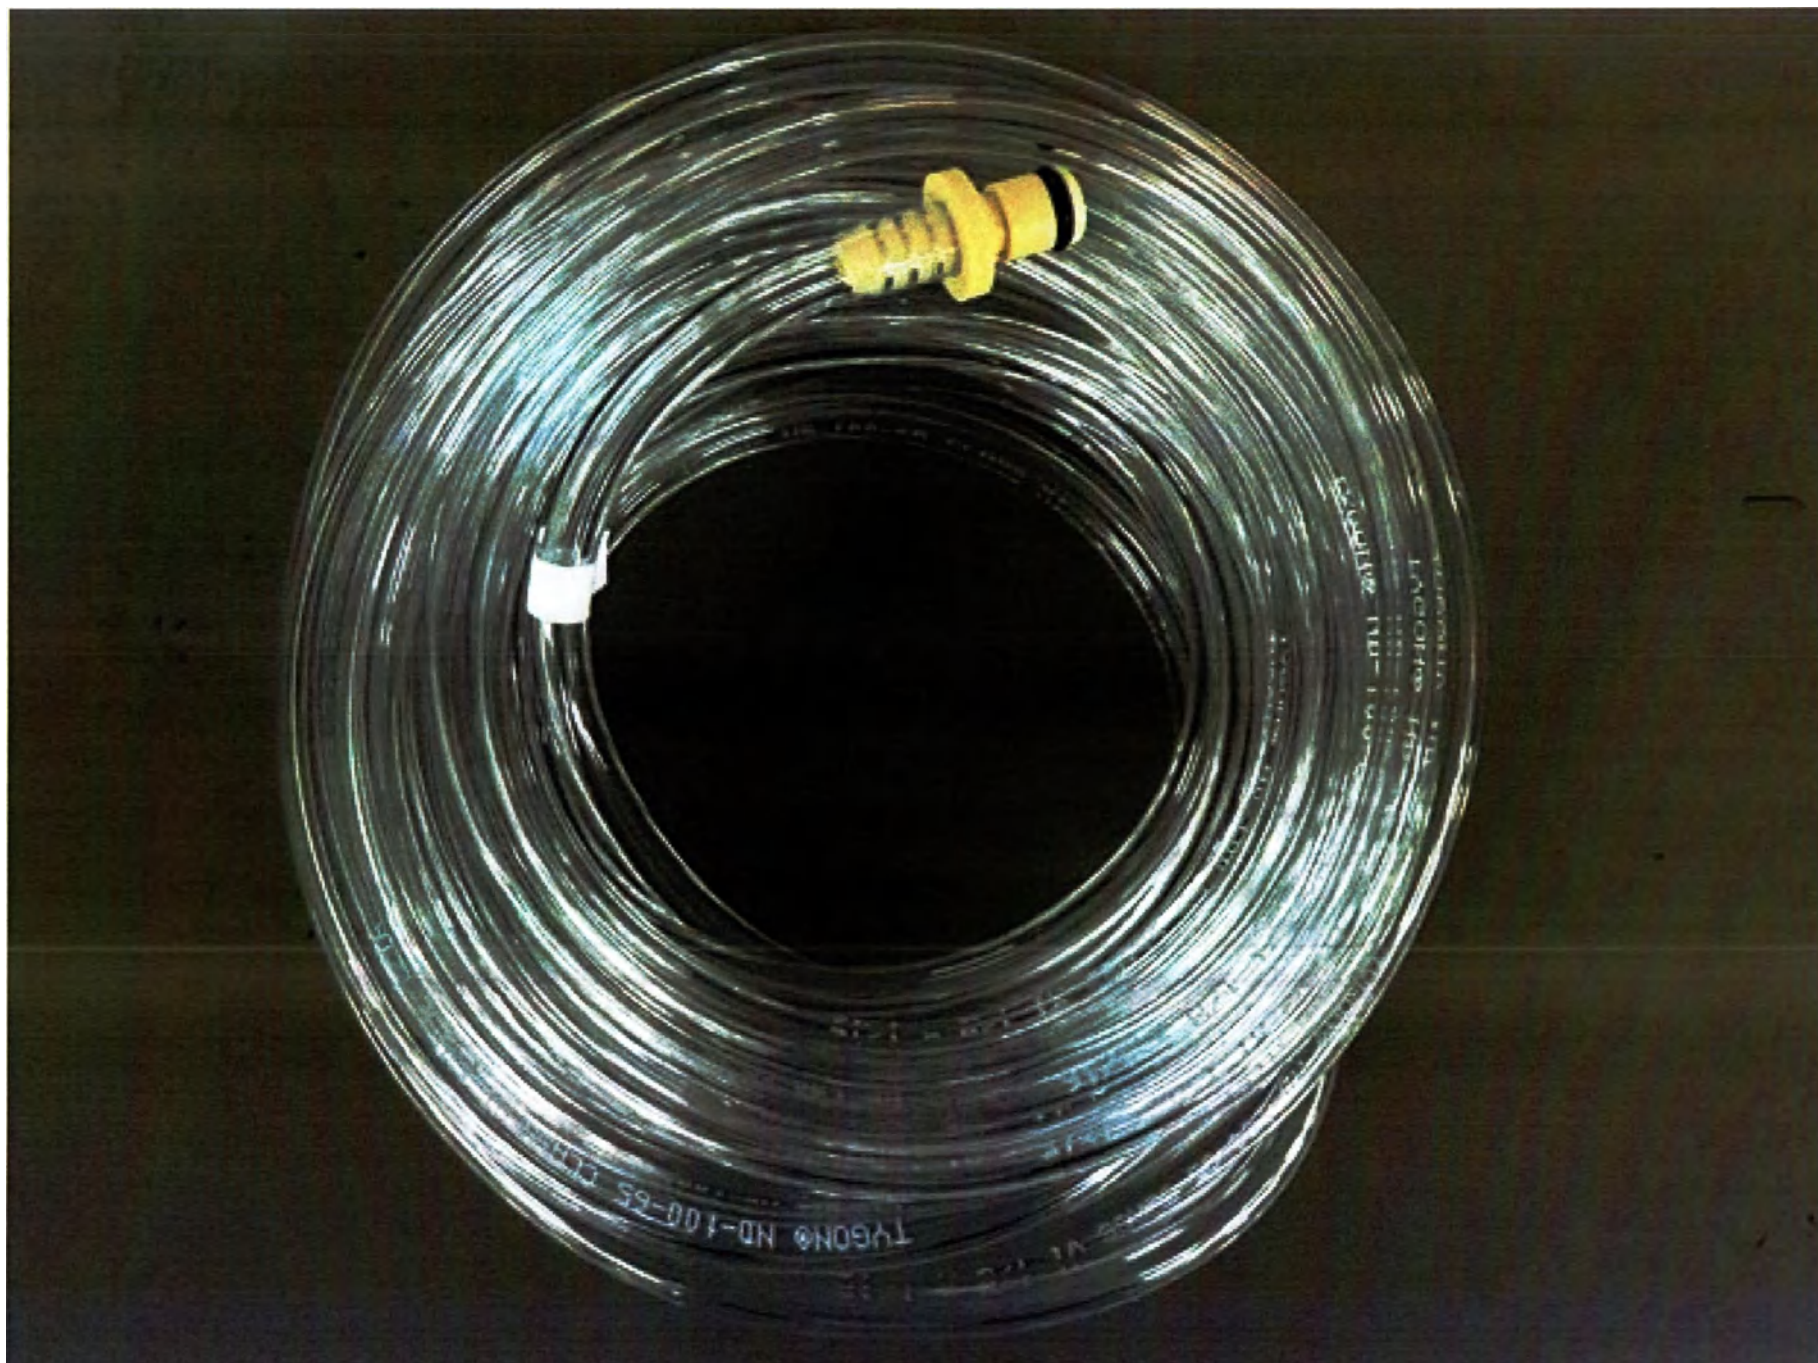


Рисунок 18. Трубка для сброса жидких отходов для СХ-6000/СХ-6010 и СХ-9000/СХ-9010

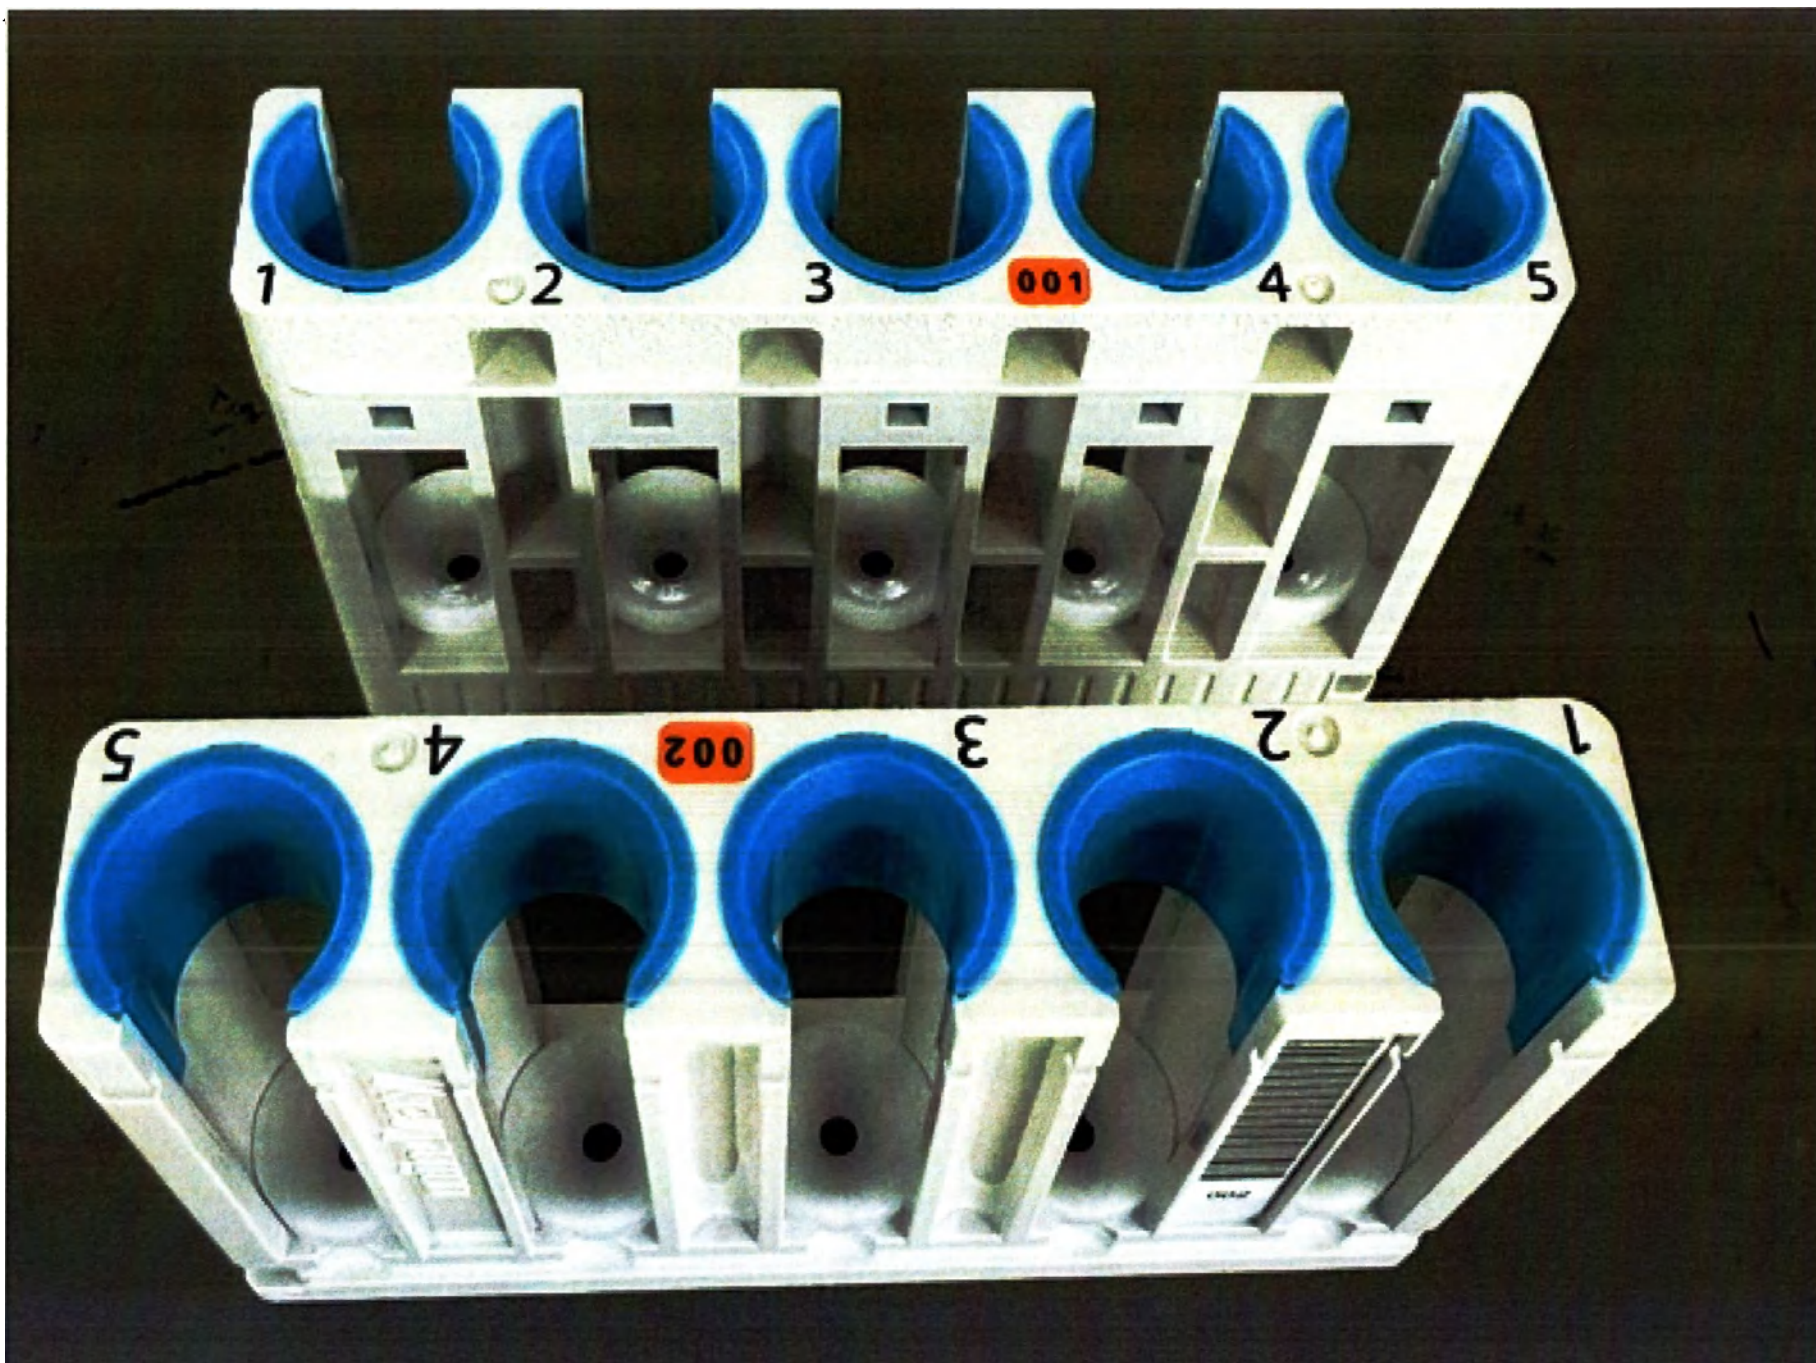


Рисунок 19. Штатив для стандартных пробирок для коагуляции для CX-6000/6010, CX-9000/9010

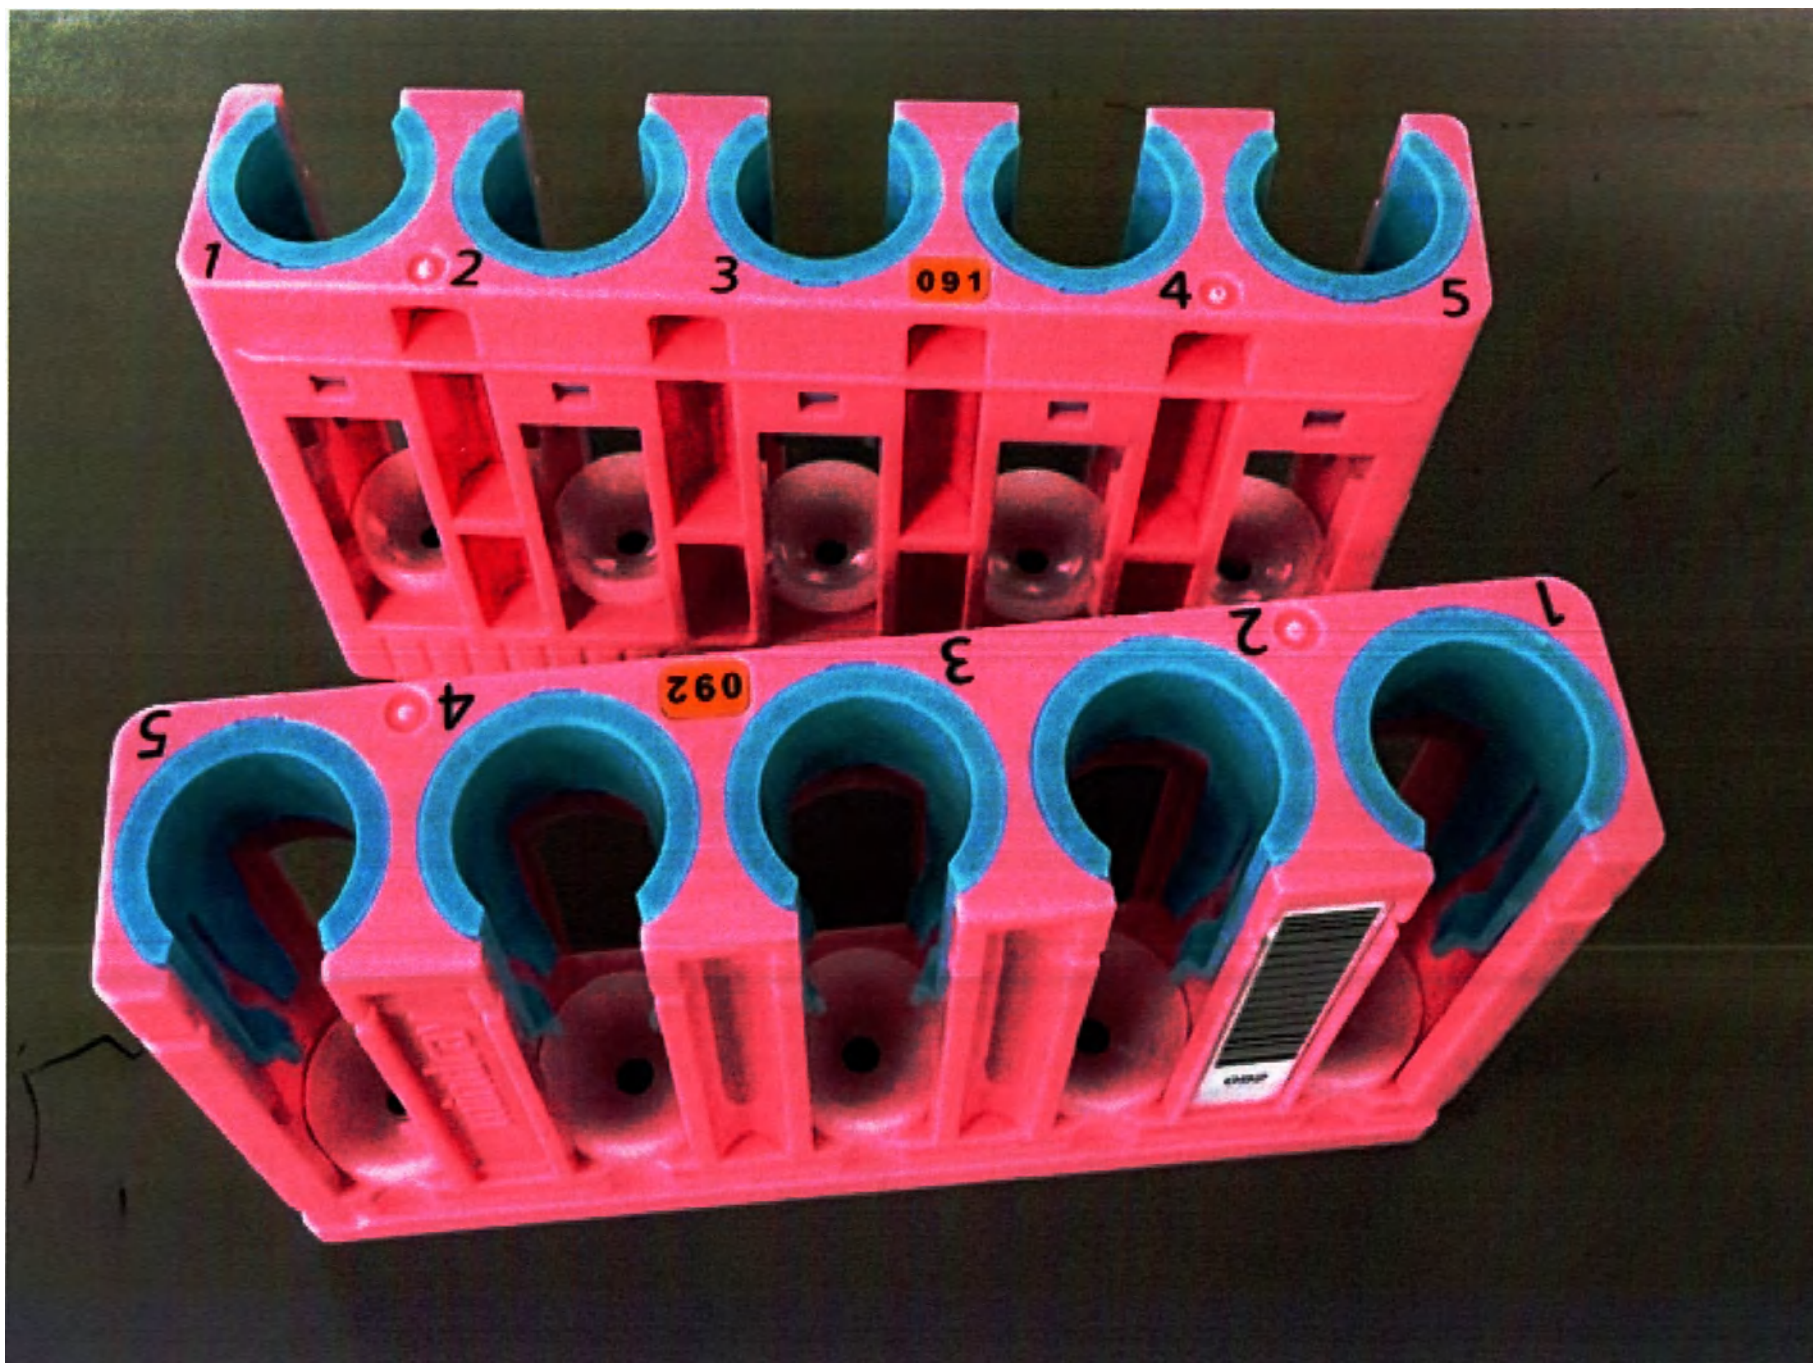


Рисунок 20. Штатив для микропробирок для коагуляции для СХ-6000/6010, СХ-9000/9010



Рисунок 21. Канистра для жидких отходов, 10 л, для CX-6000/CX-6010



Рисунок 22. Канистра для жидких отходов, 10 л, для СХ-9000/СХ-9010



Рисунок 23. Узел крышки канистры для жидких отходов для CX-6000/CX-6010

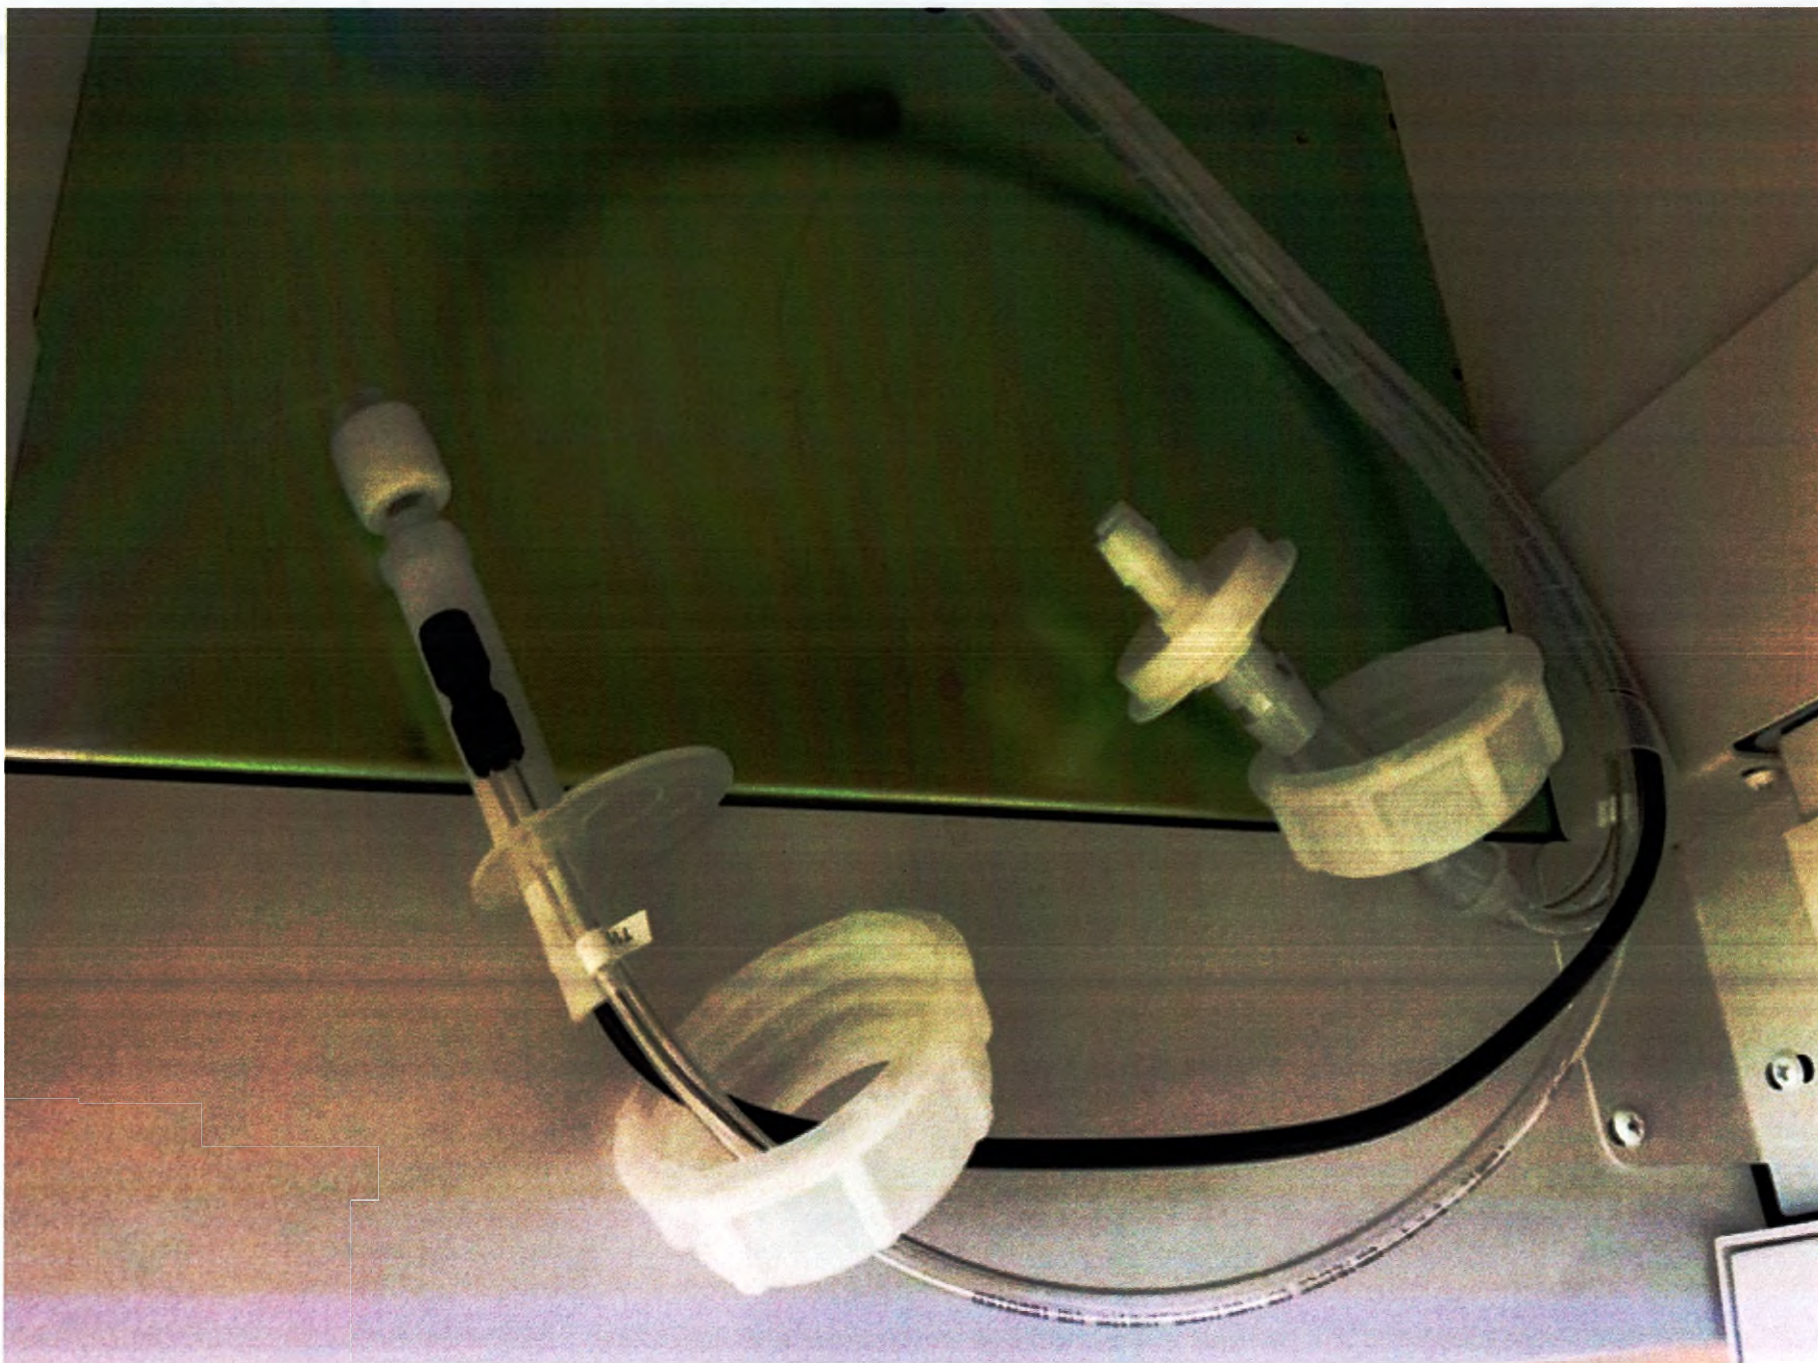


Рисунок 24. Узел крышки канистры для жидких отходов для CX-9000/CX-9010



Рисунок 25. Интернет-кабель для CX-6000/CX-6010



Рисунок 26. Держатель трубки разбавителя проб для CX-6000/CX-6010

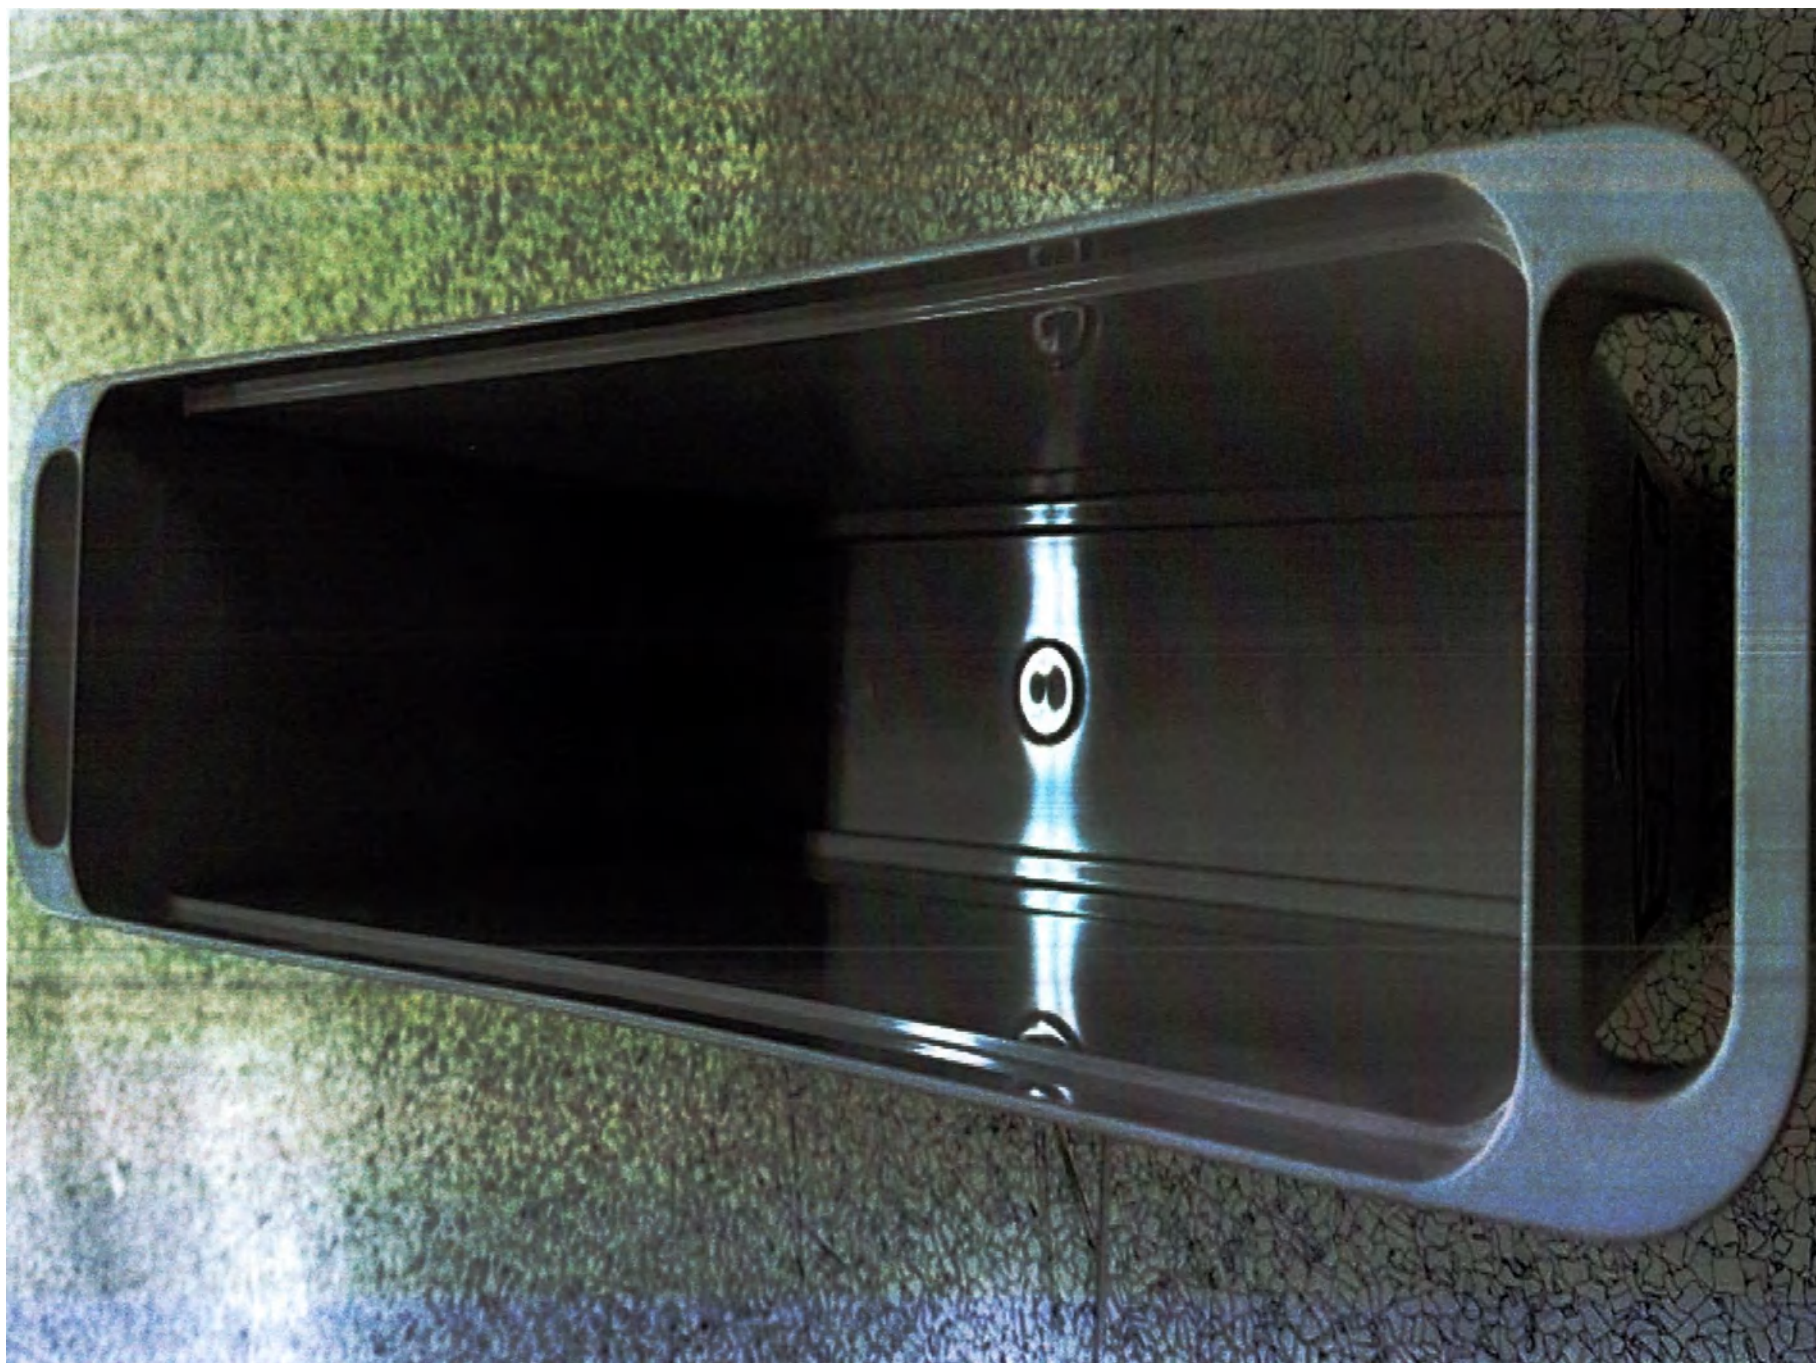


Рисунок 27. Контейнер для использованных кювет для СХ-6000 и СХ-9000/СХ-9010

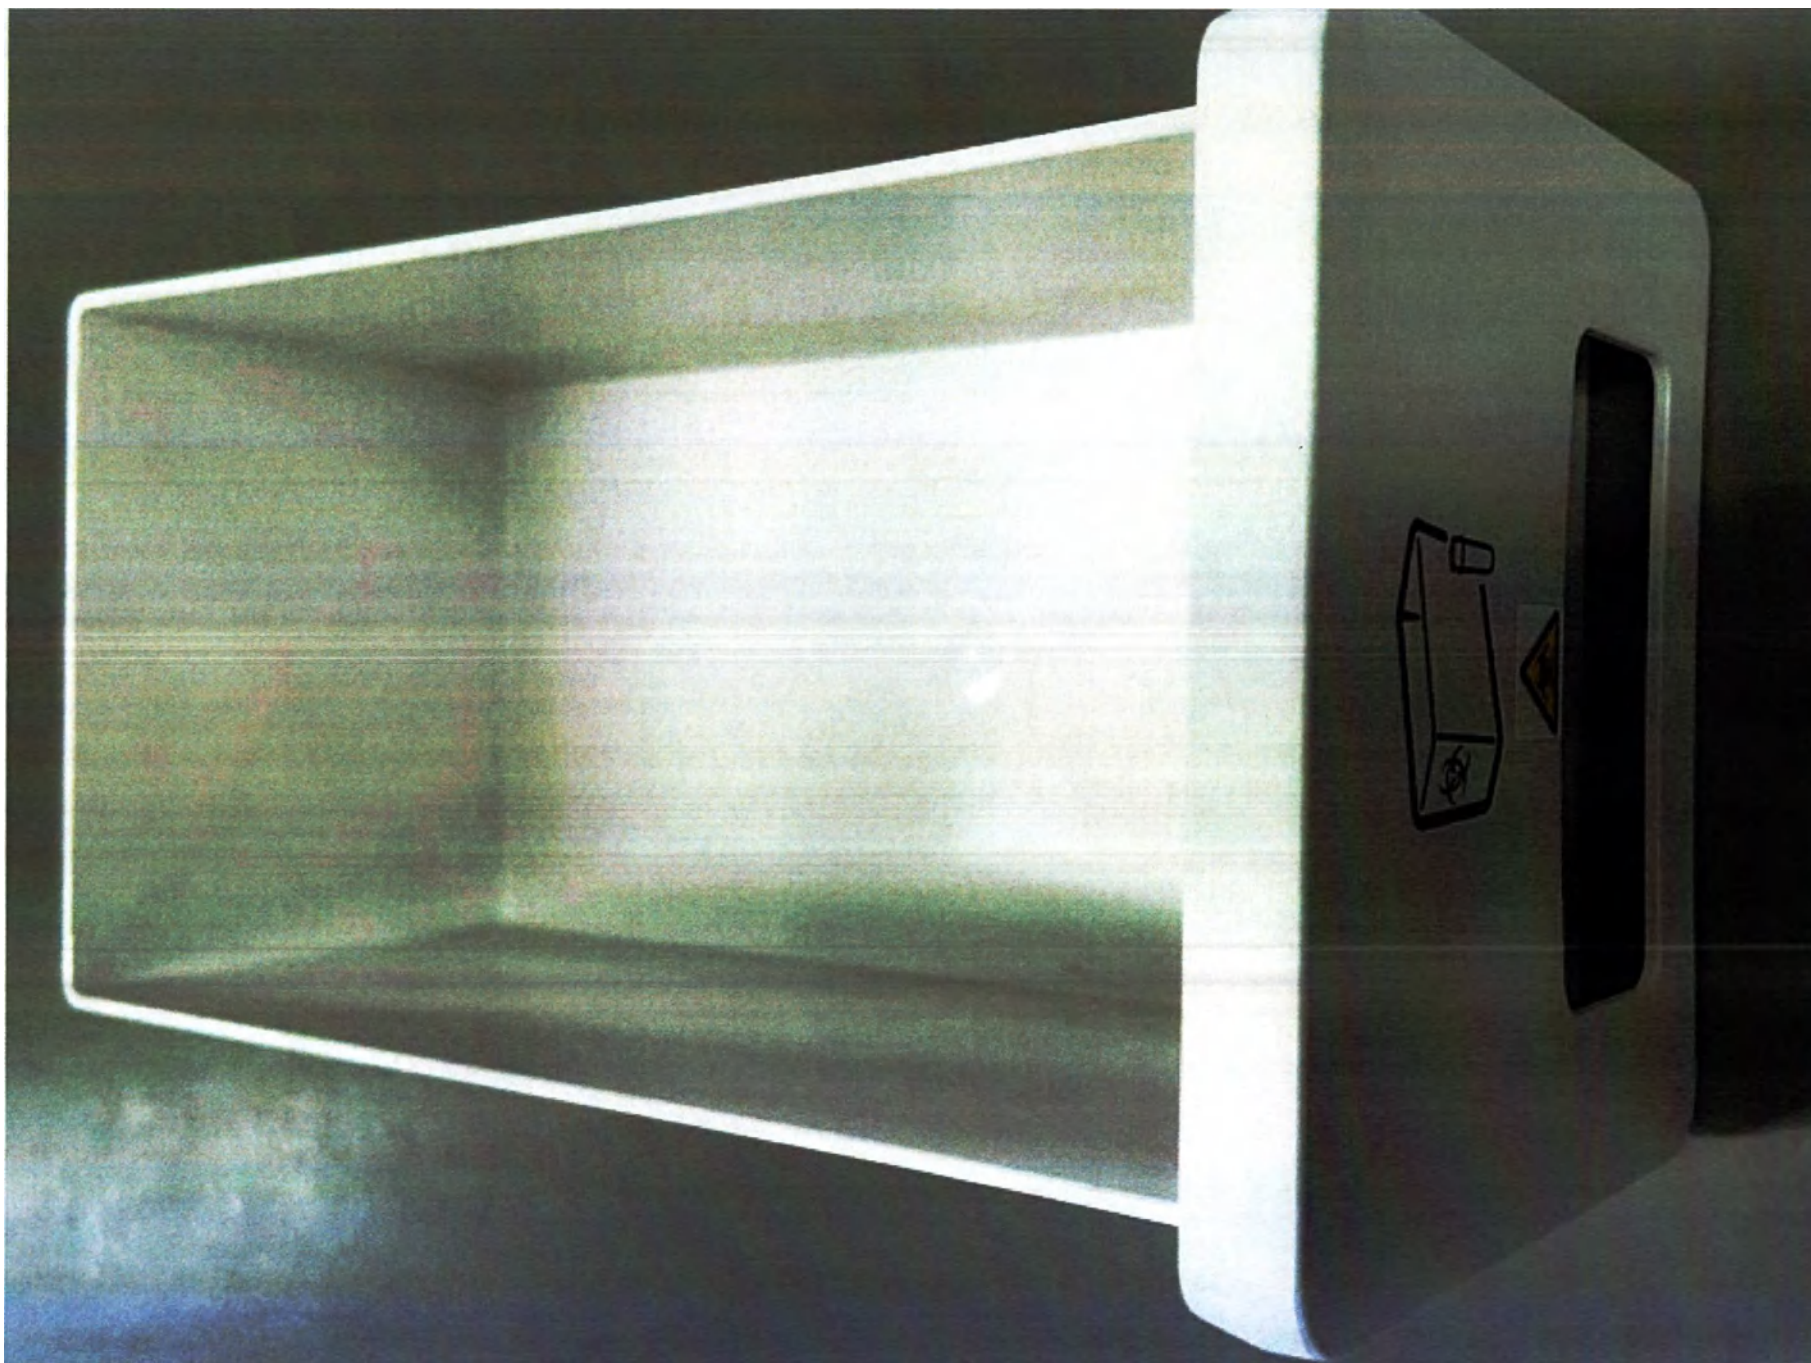


Рисунок 28. Контейнер для использованных кювет для СХ-6010

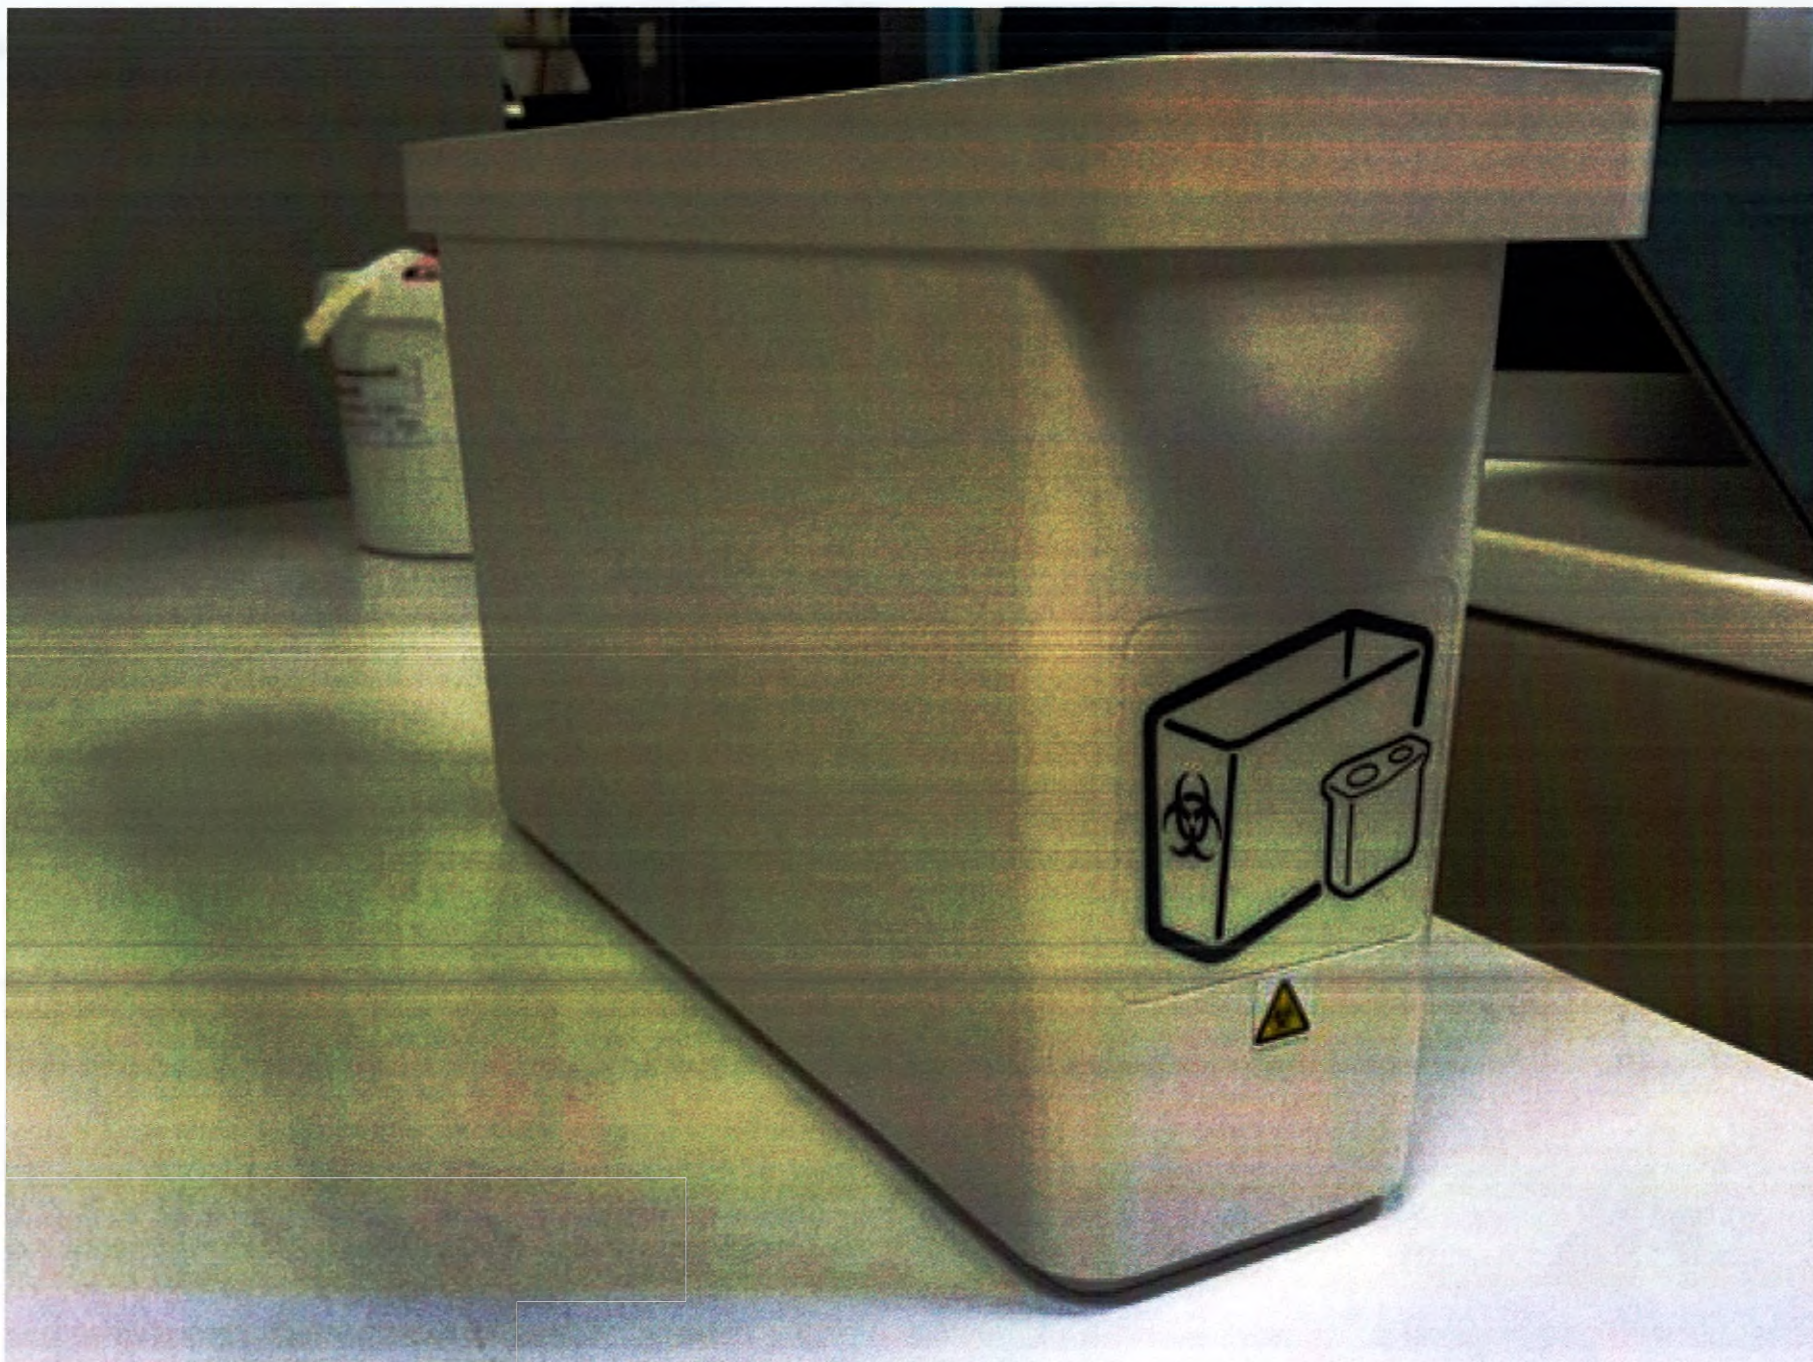


Рисунок 29. Контейнер для отходов для CX-6000 и CX-9000/CX-9010

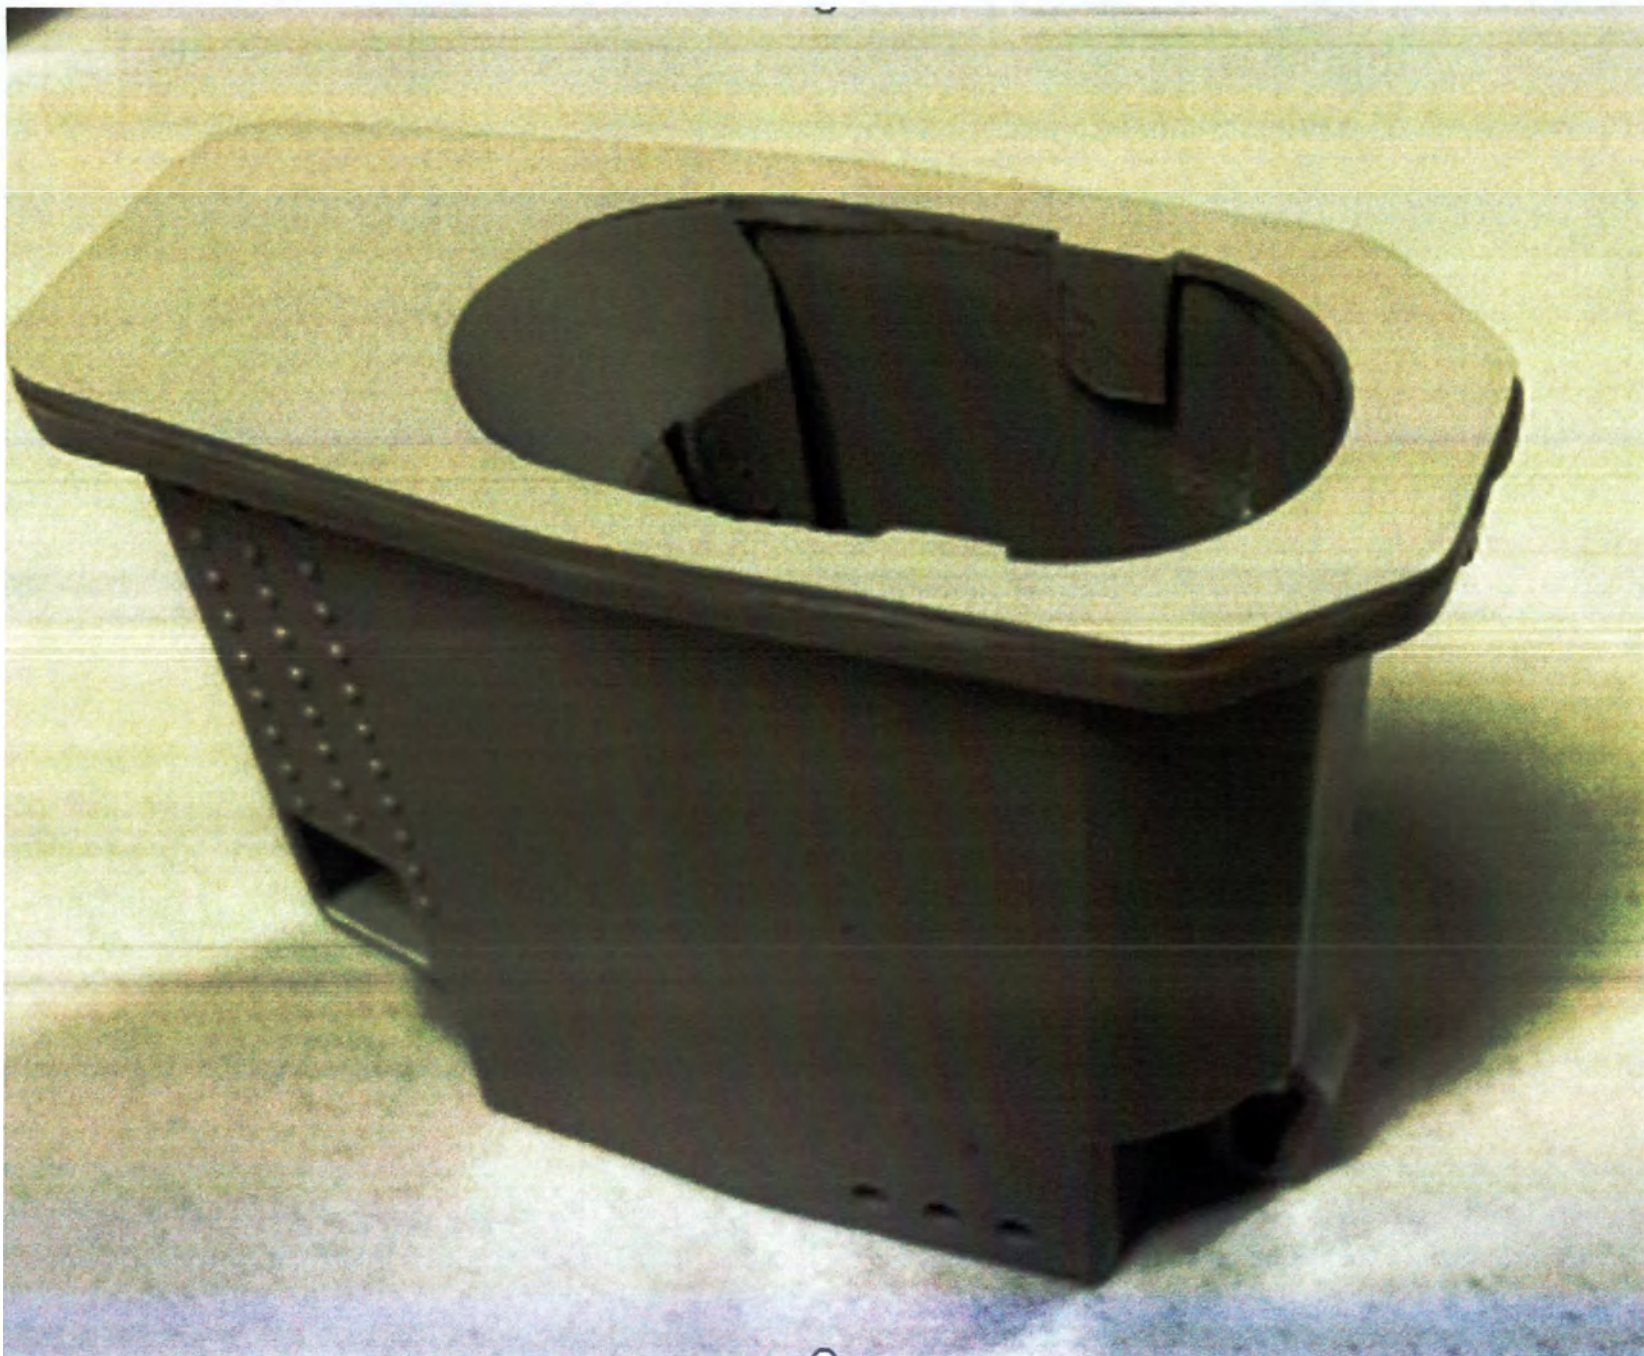


Рисунок 30. Адаптер для реагентов для CX-6000/6010, CX-9000/9010



Рисунок 31. Кассета для реагента для системной очистки анализатора для CX-6000/6010, CX-9000/9010

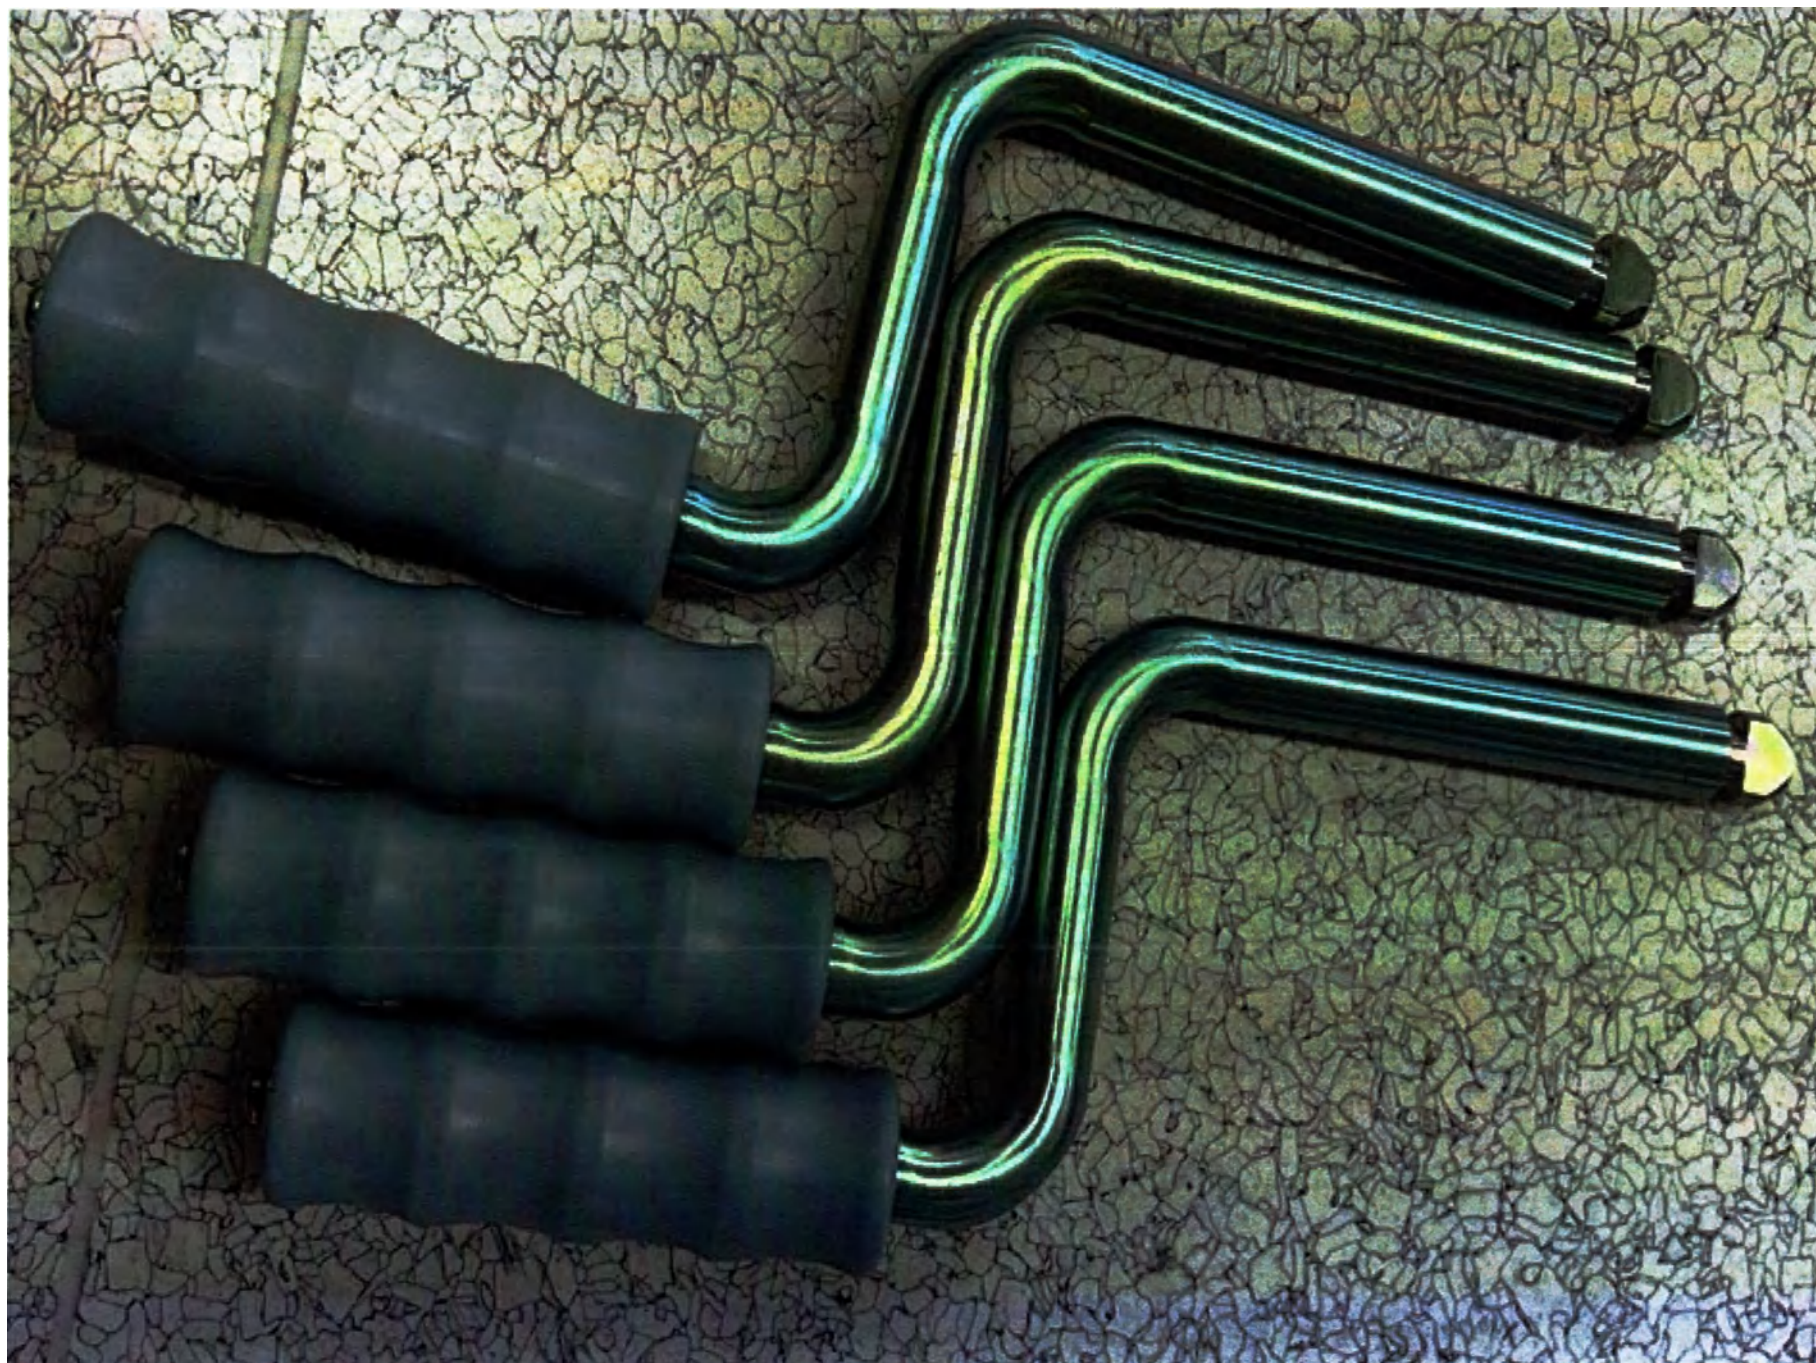


Рисунок 32. Ручка для транспортировки для СХ-6010

CX-9000/CX-9010

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗАТОР КООГУЛЯЦИИ**

Руководство оператора

Телефон технической поддержки пользователей
(звонок по России бесплатный)

8-800-333-5323

(Пн-Пт., 9:00-18:00)

E-mail: ruservice@mindray.com

mindray

Рисунок 33. Руководство оператора автоматического анализатора коагуляции CX-9000/CX-9010



Рисунок 34. Кабель питания европейского стандарта для CX-9010

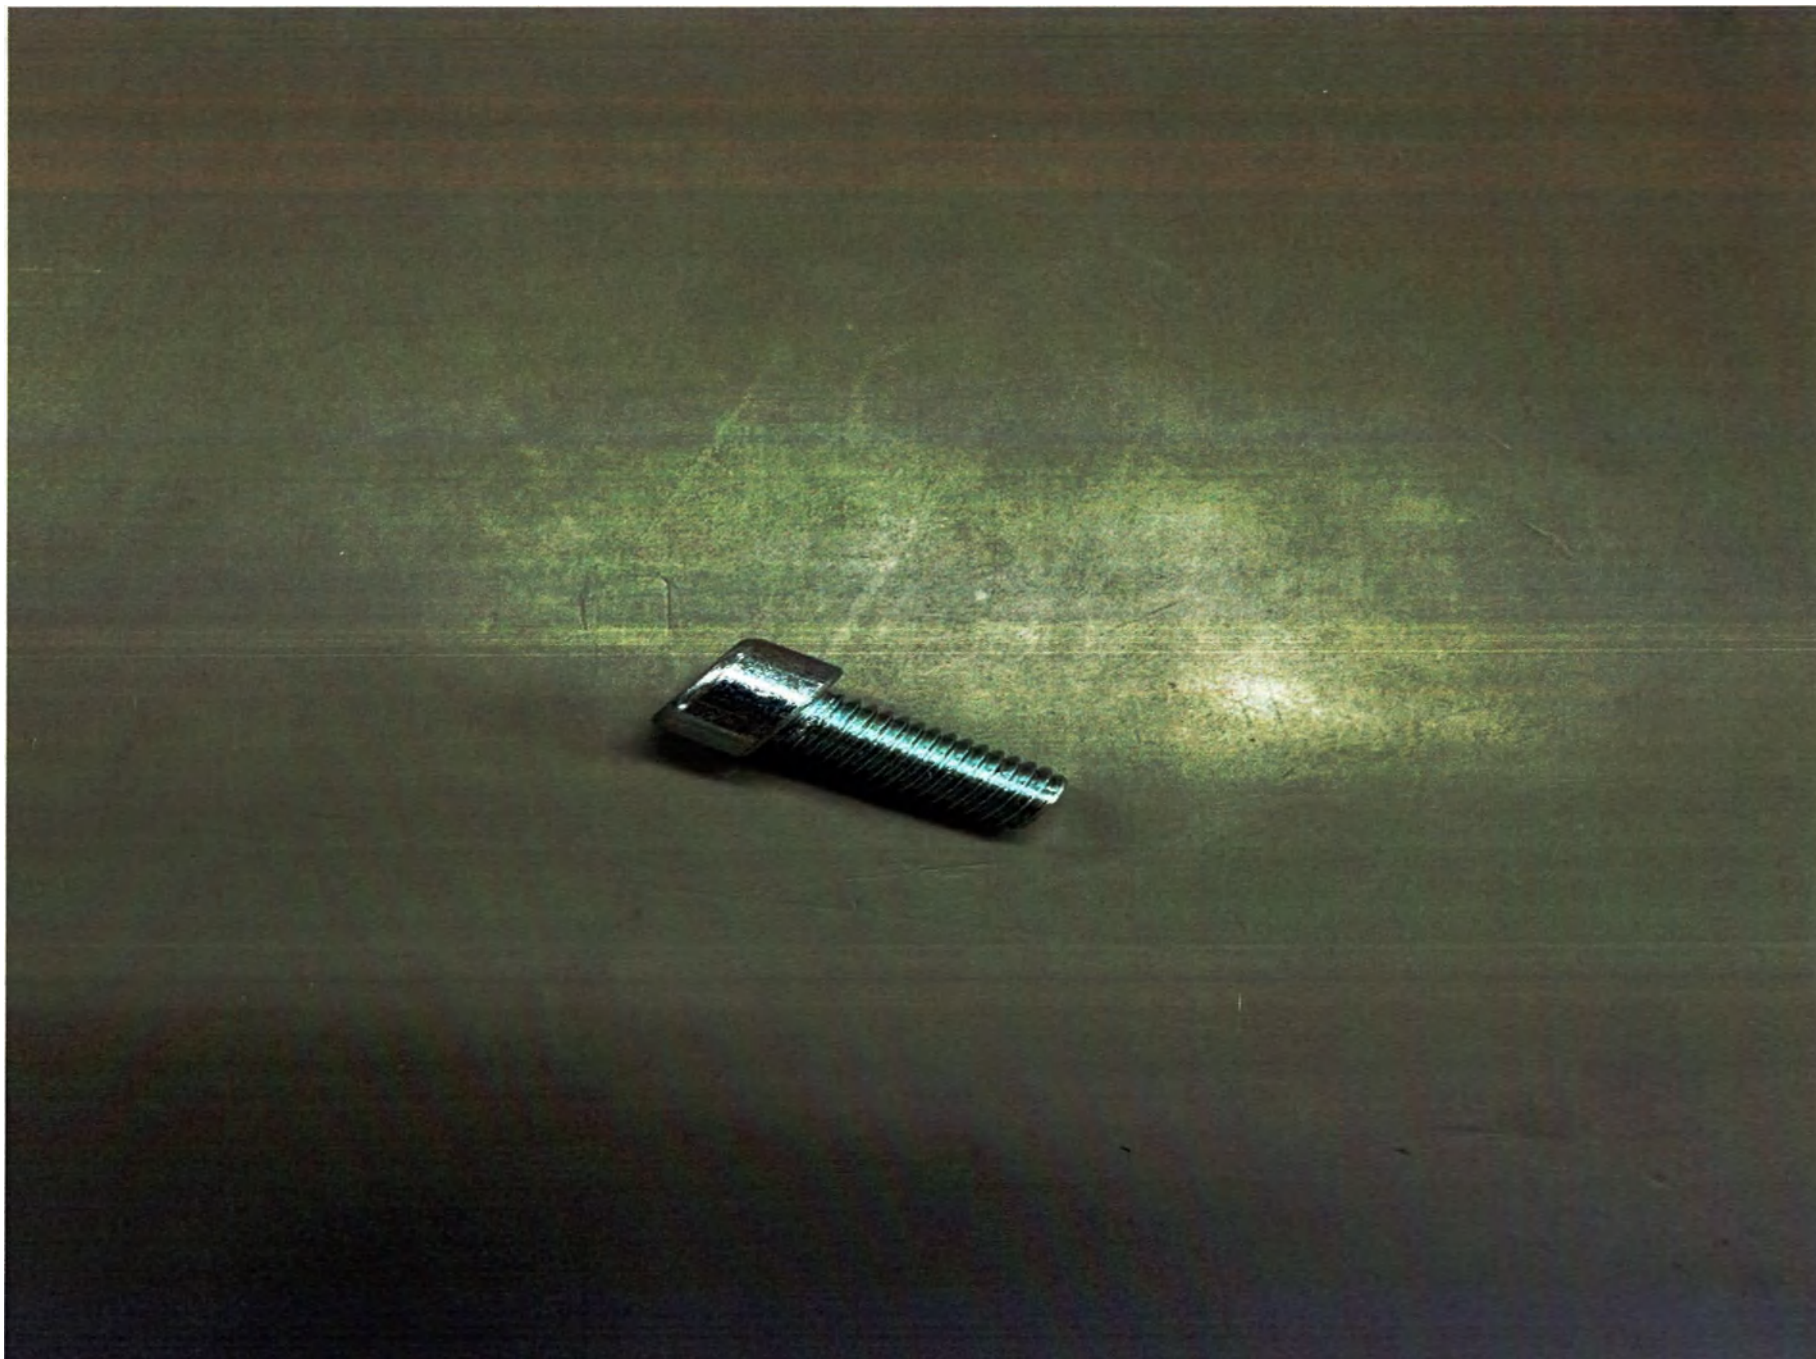


Рисунок 35. Винт с внутренним шестигранником М8Х20 для СХ-9010/9010

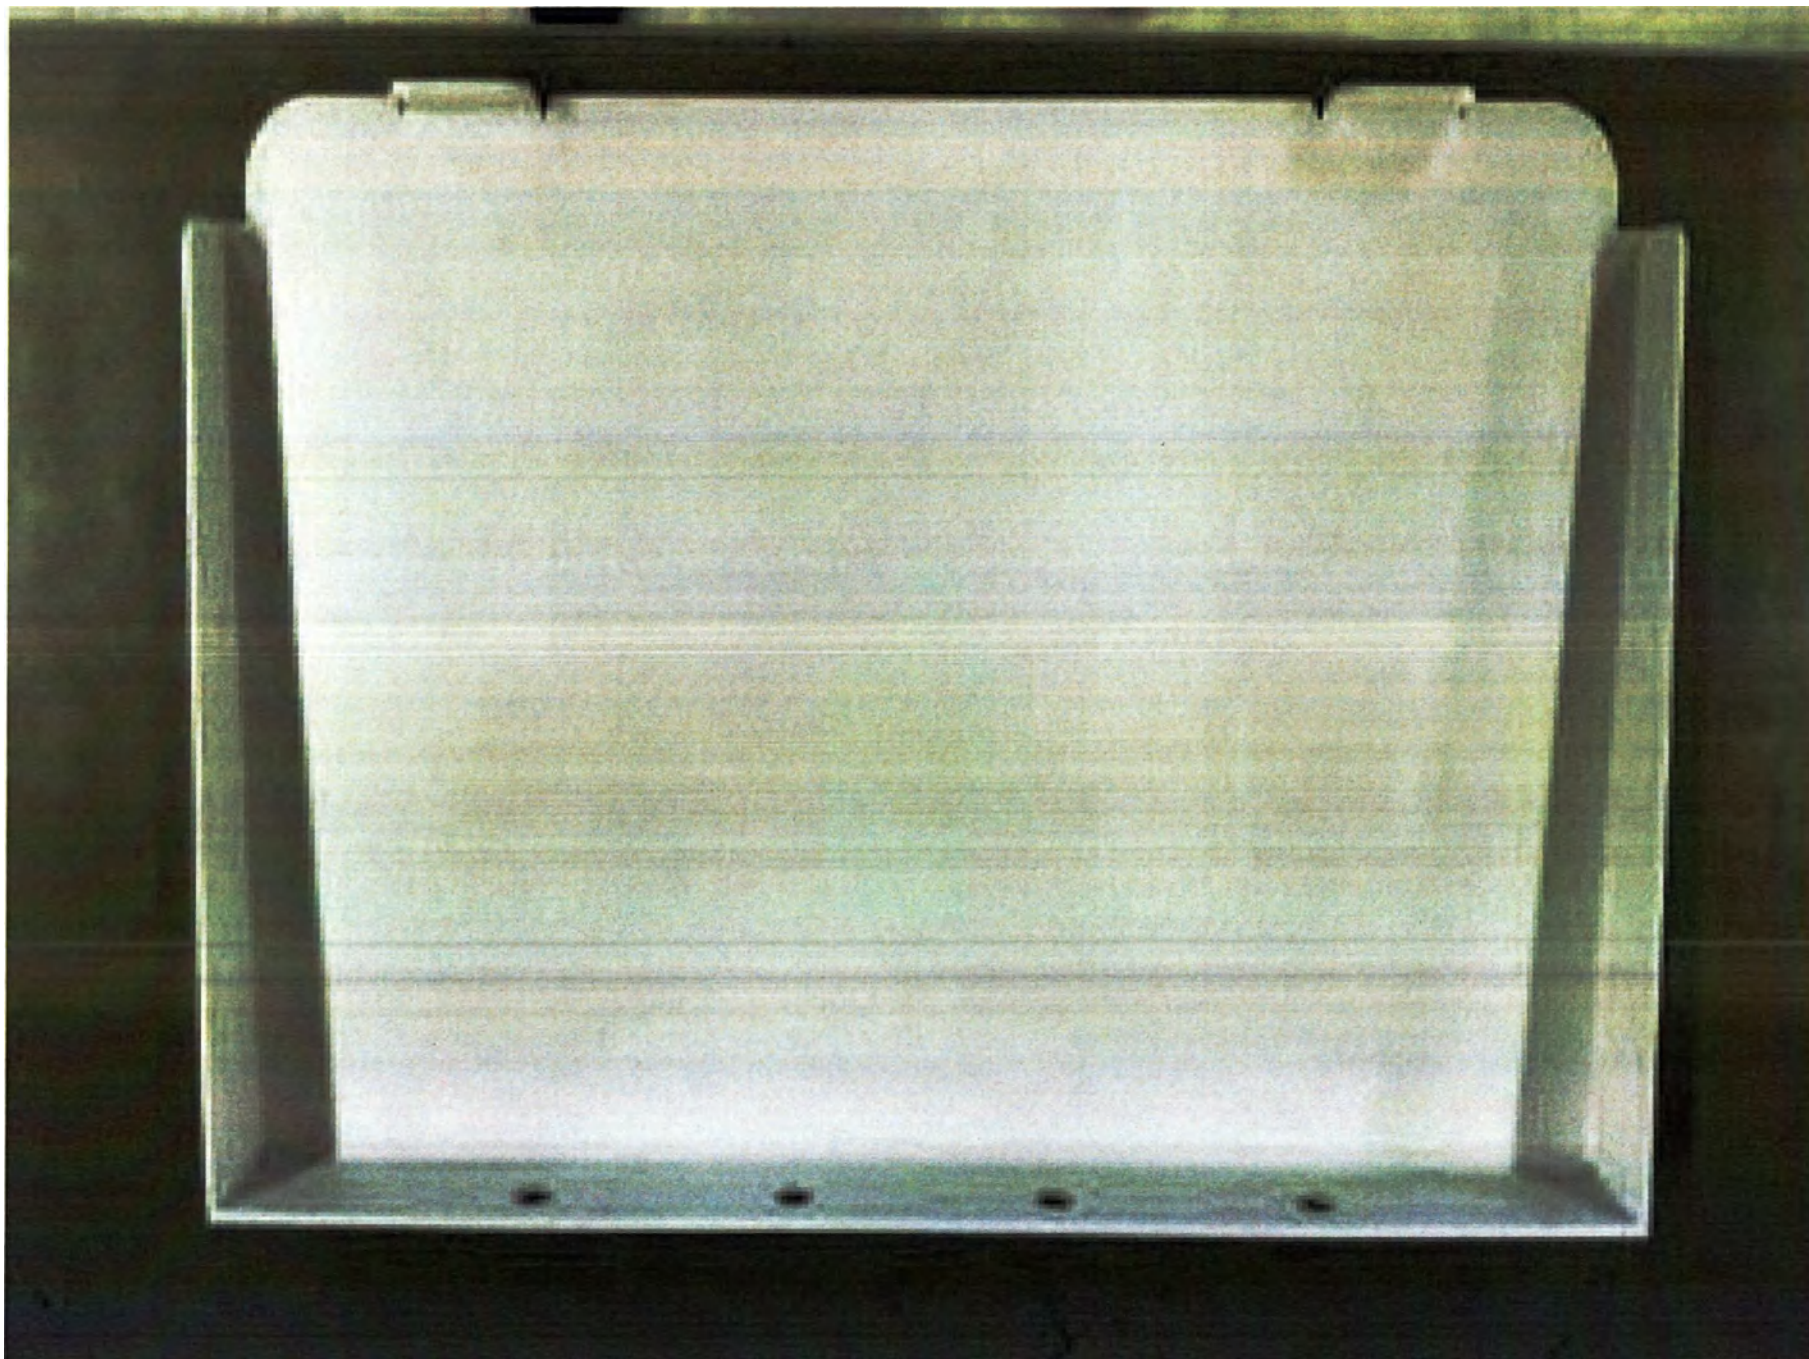


Рисунок 36. Лоток для хранения персонального компьютера для CX-9010

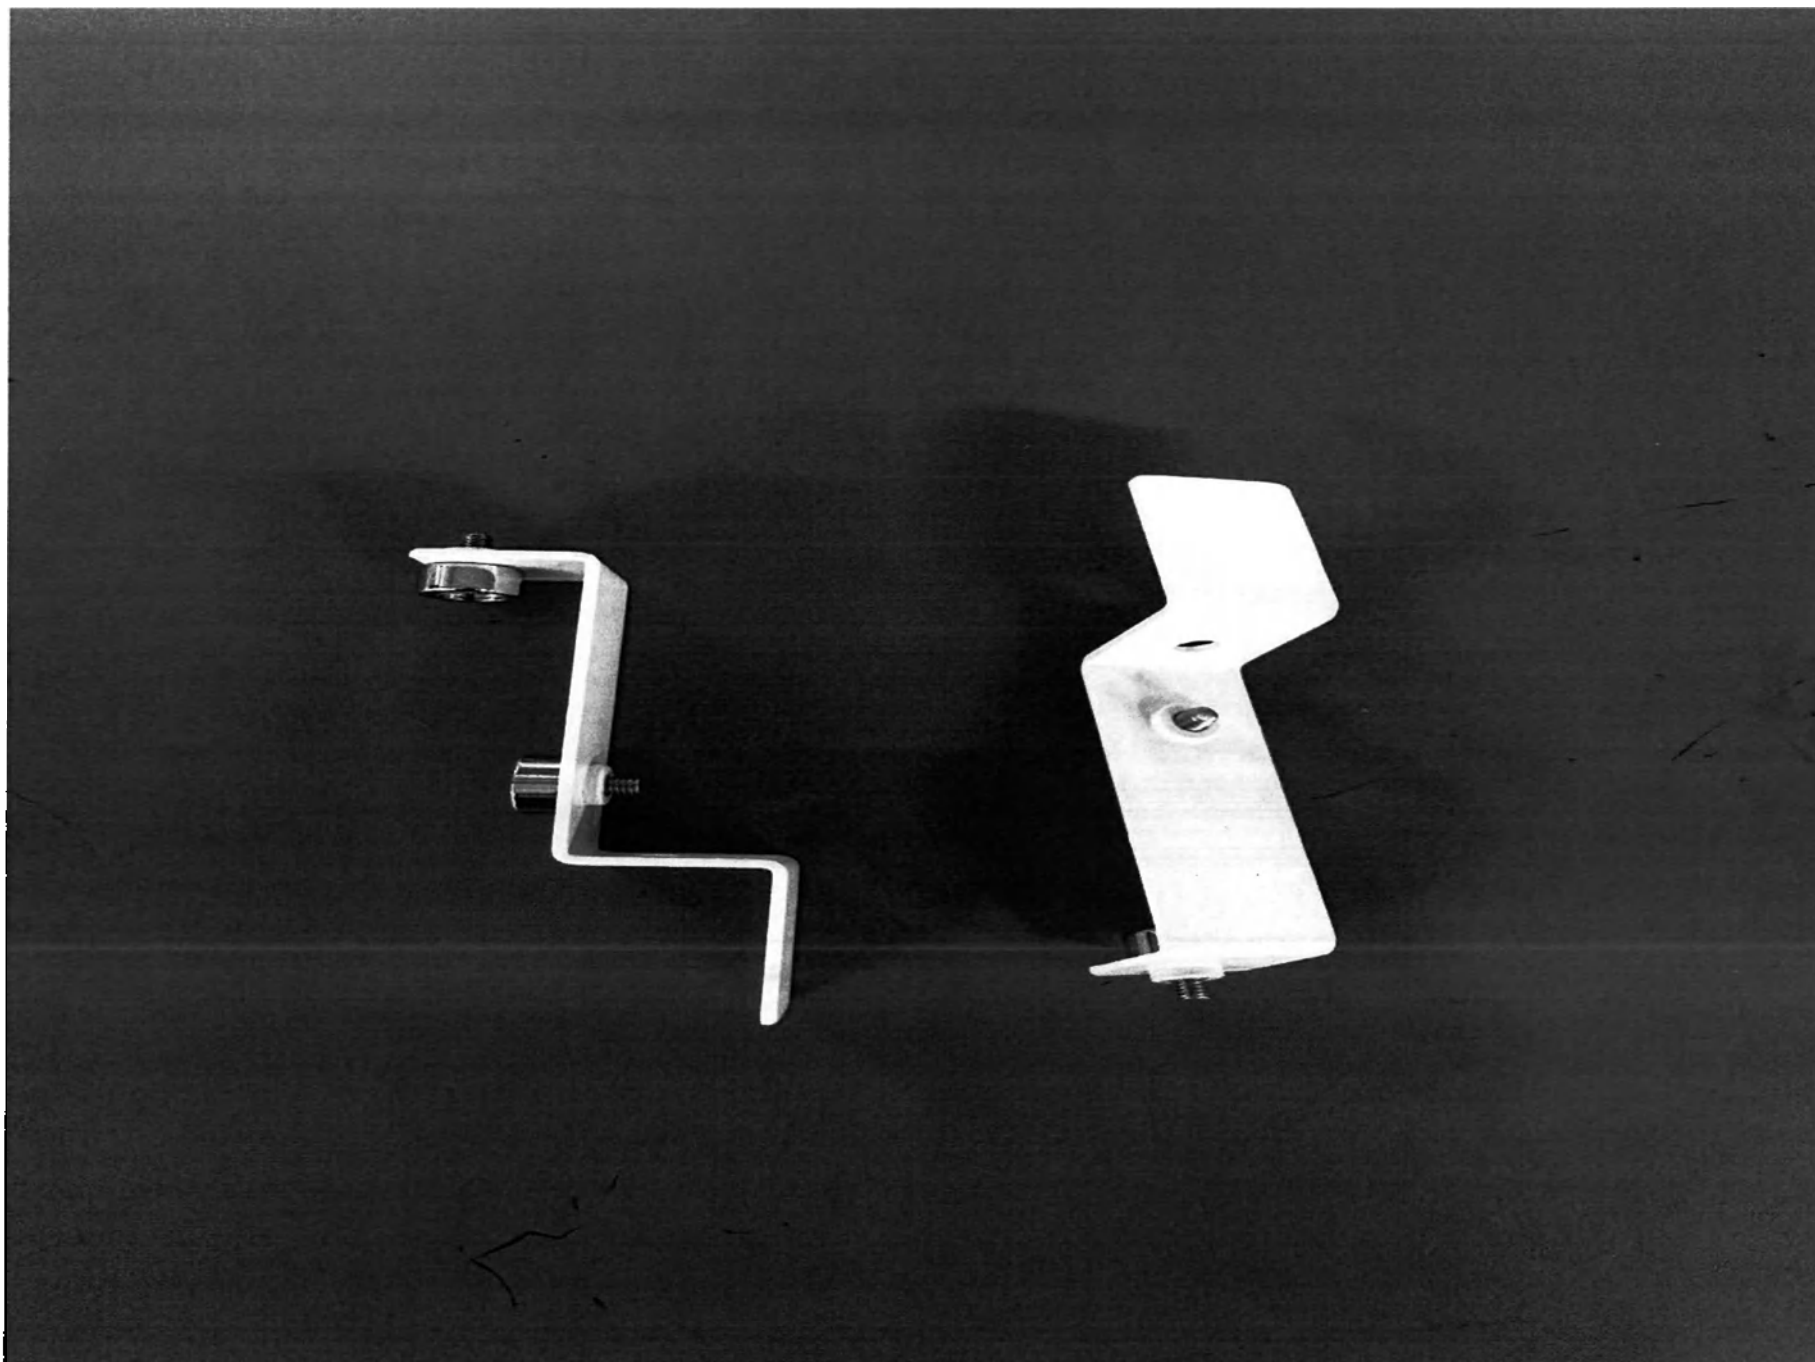


Рисунок 37. Держатель трубок для отходов для CX-9000

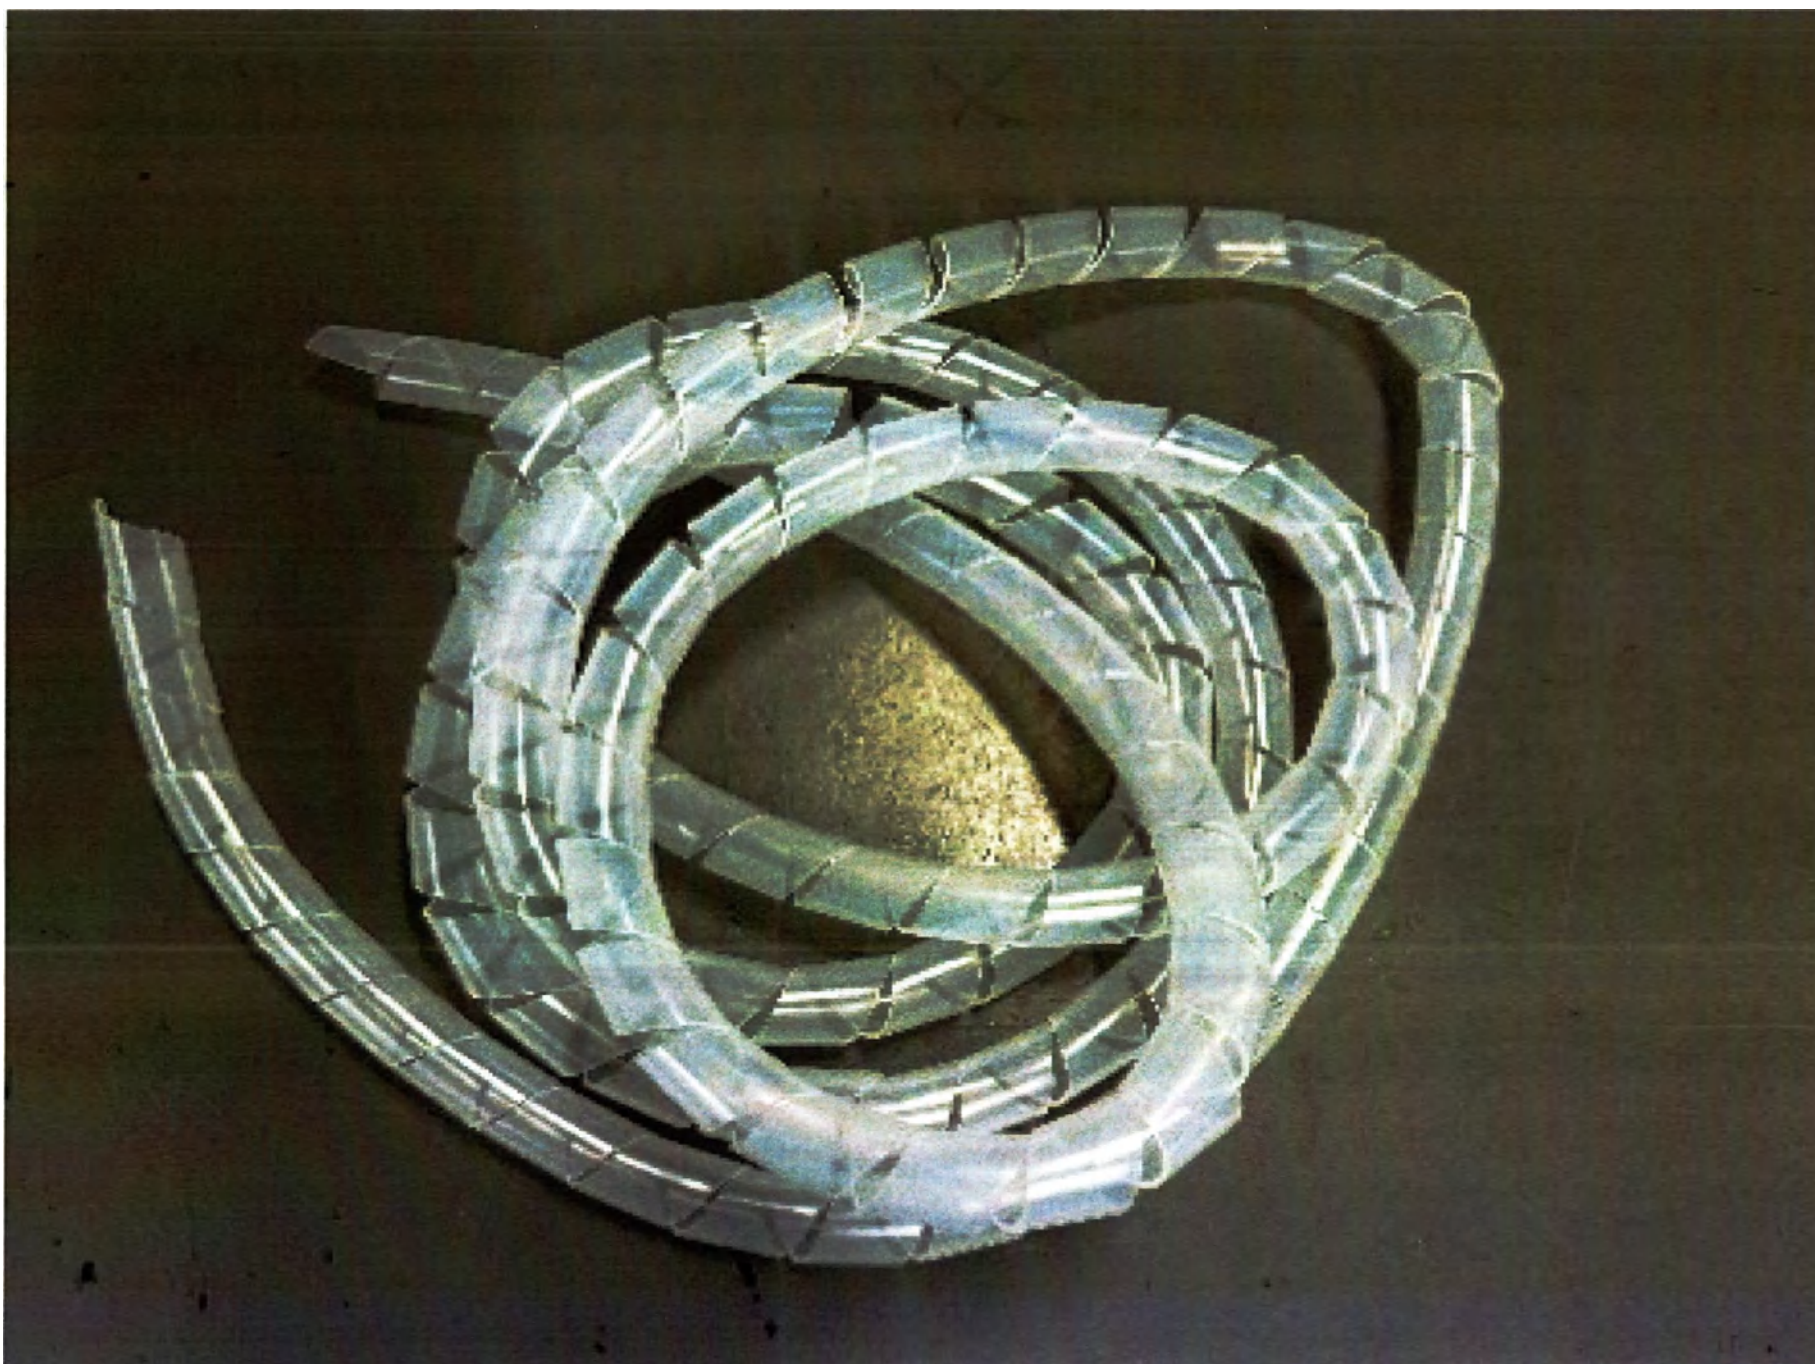


Рисунок 38. Жгут полиэтиленовый для проводов для СХ-9000/9010

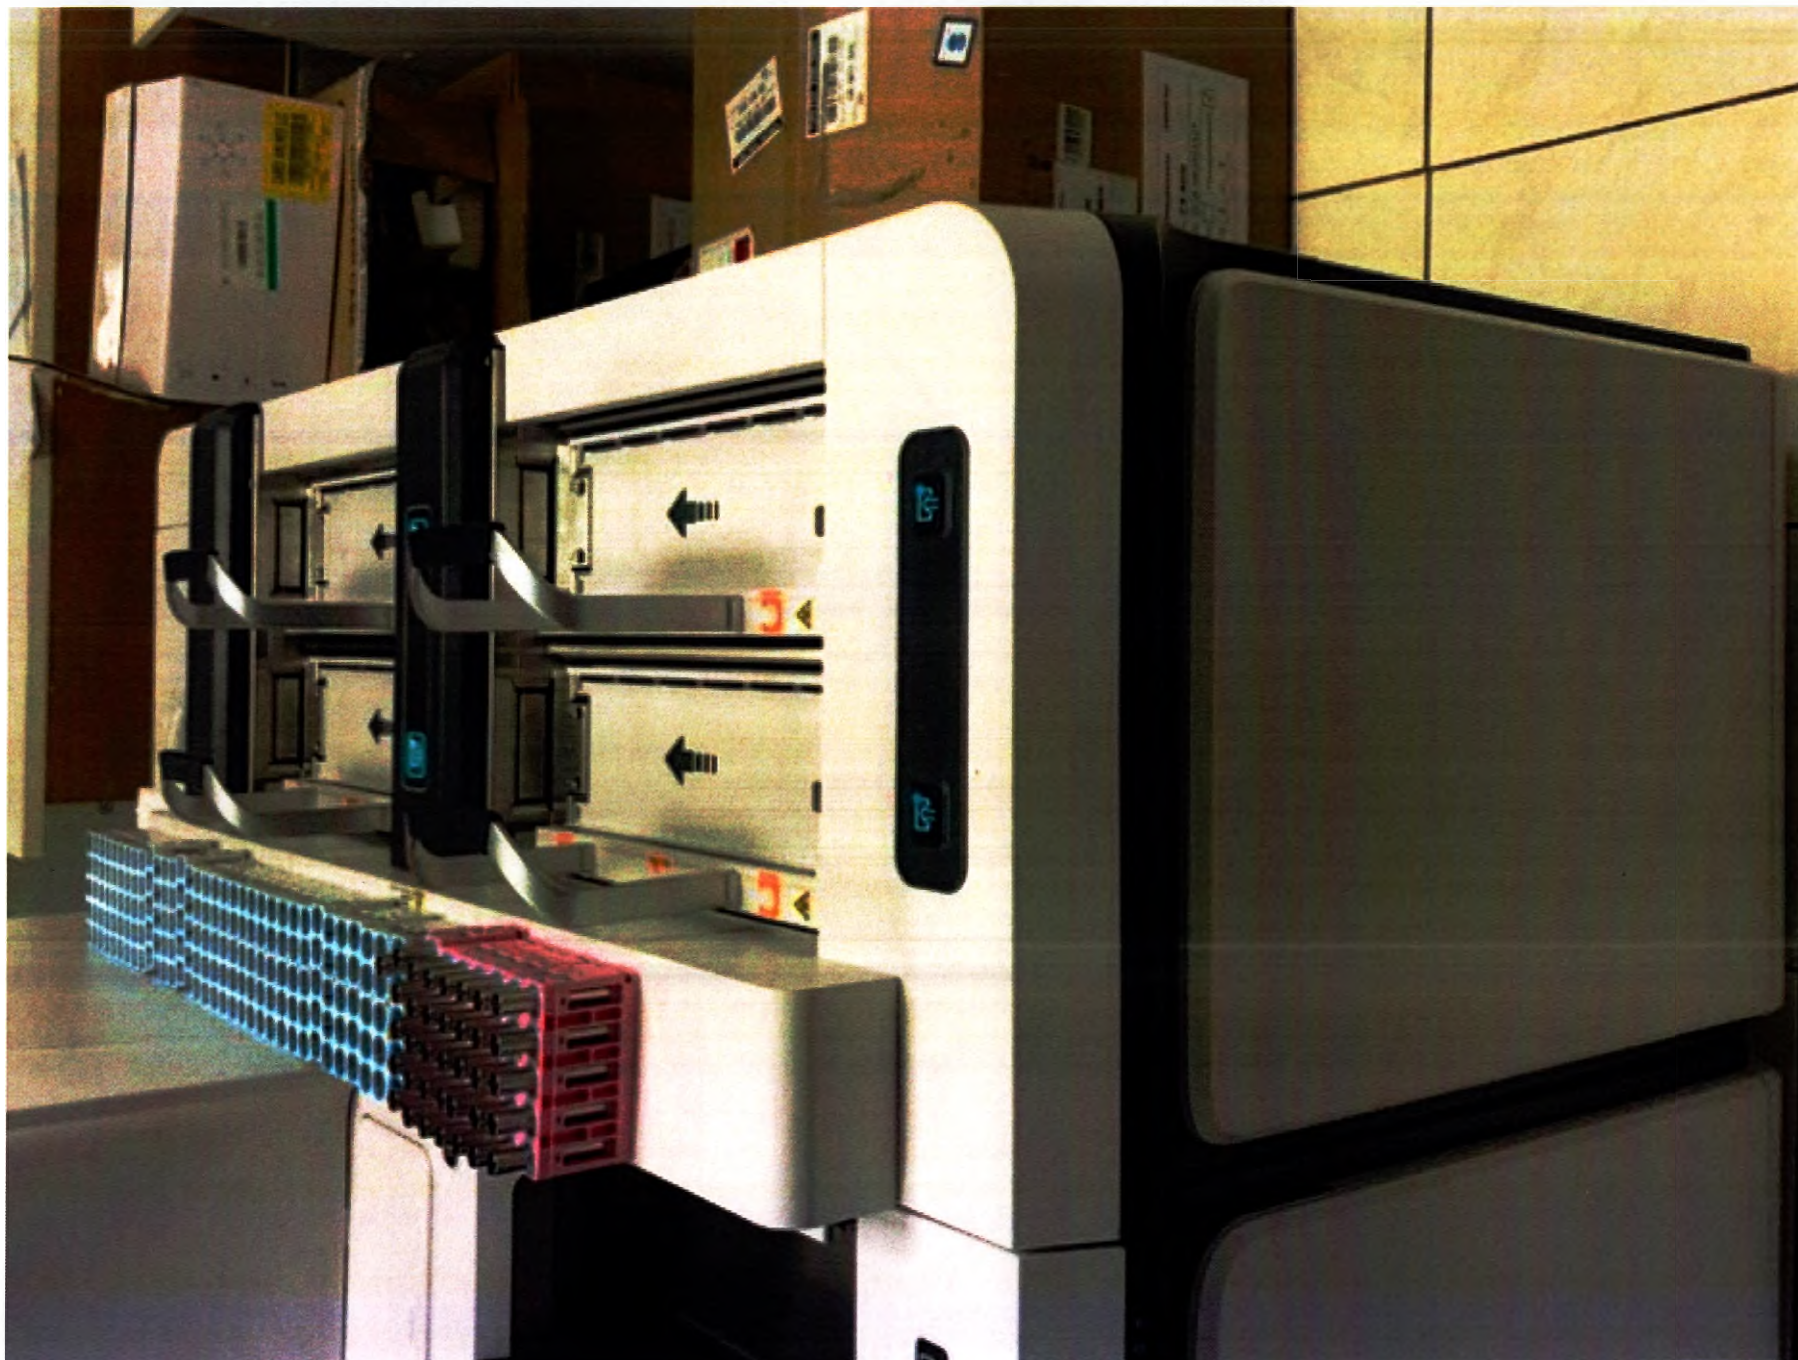


Рисунок 39. Модуль подачи проб (SDM) для CX-9000 (рис.1)

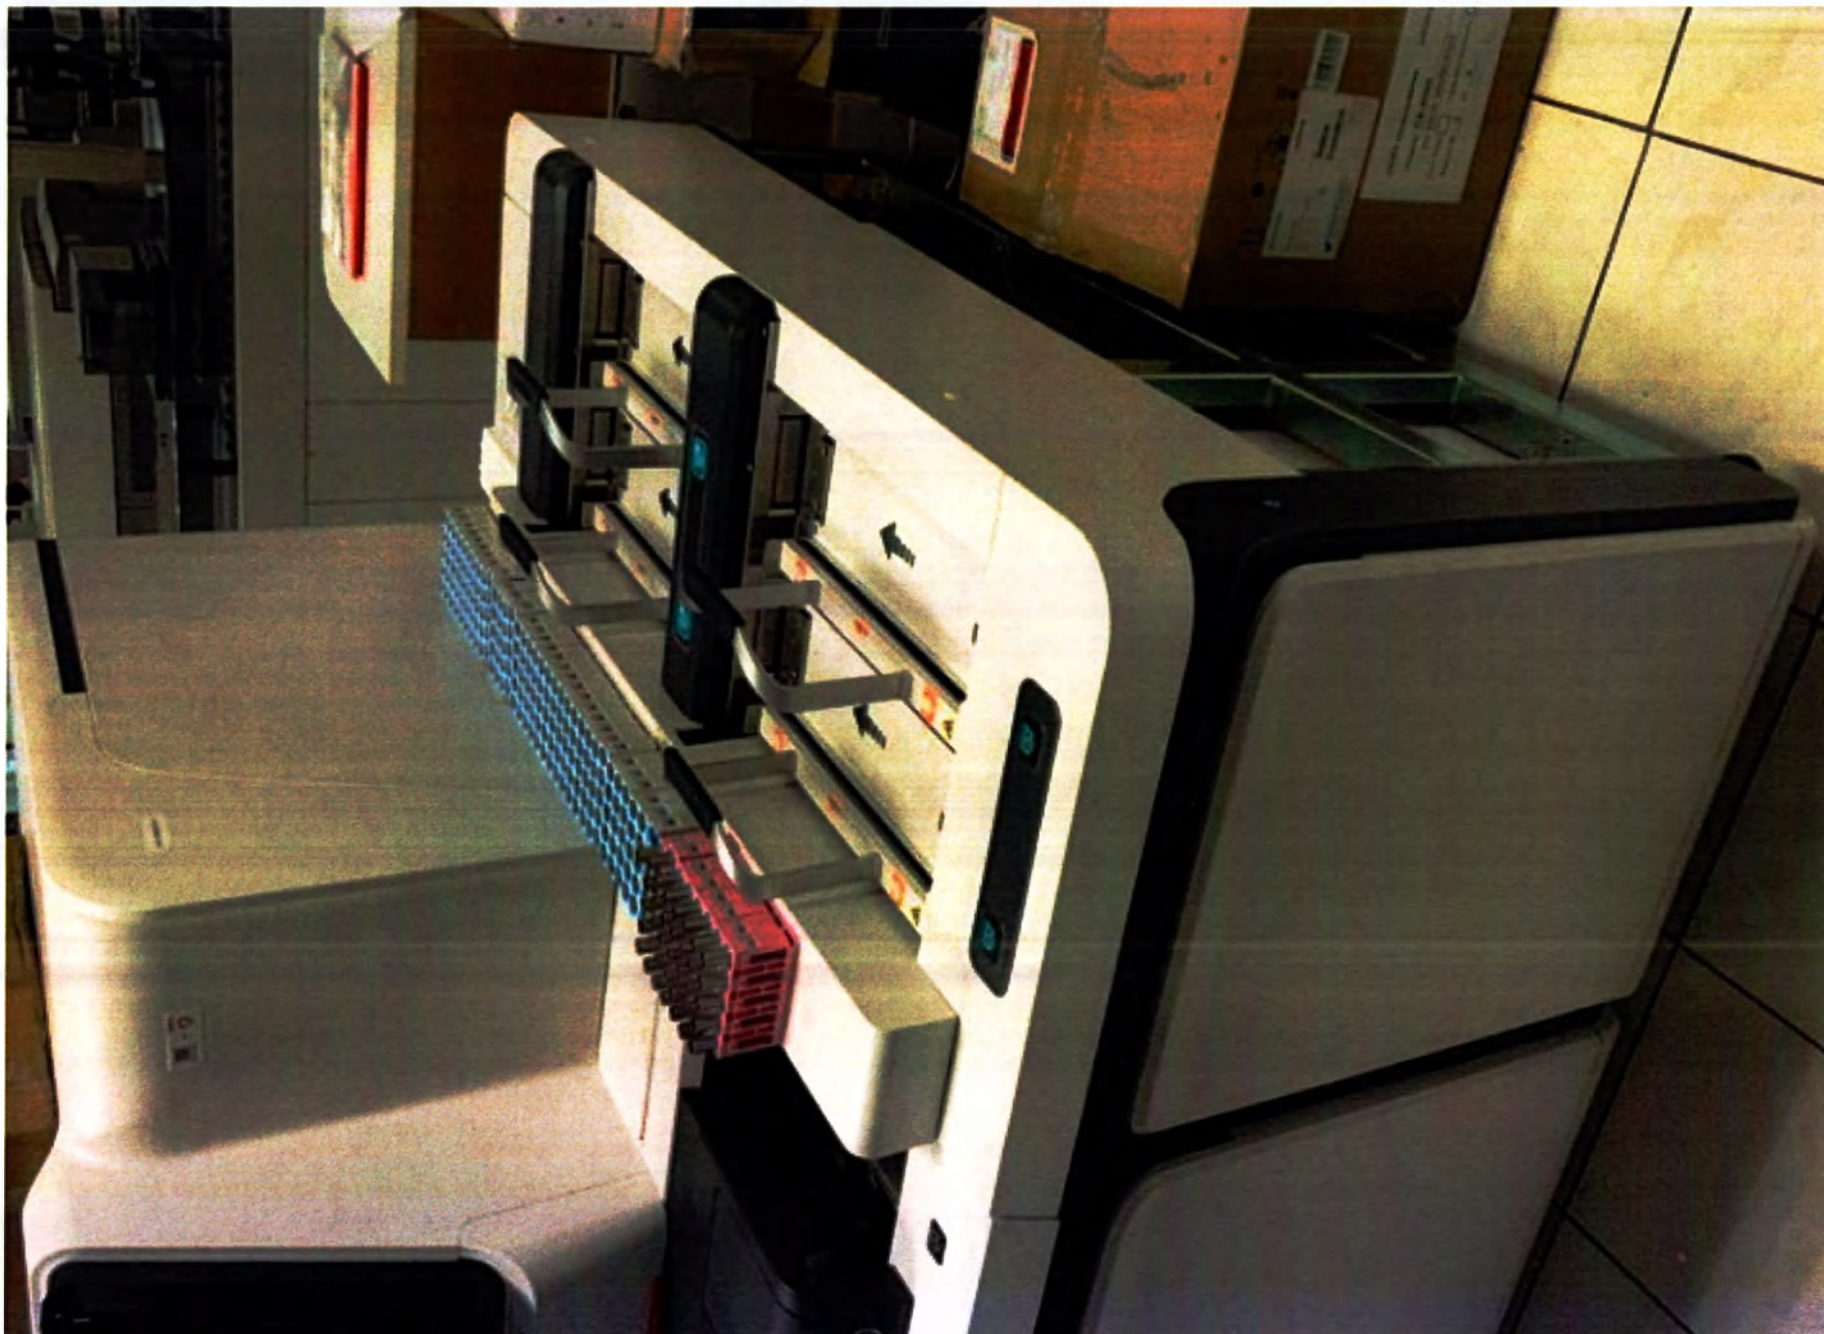


Рисунок 40. Модуль подачи проб (SDM) для CX-9000 (рис.2)

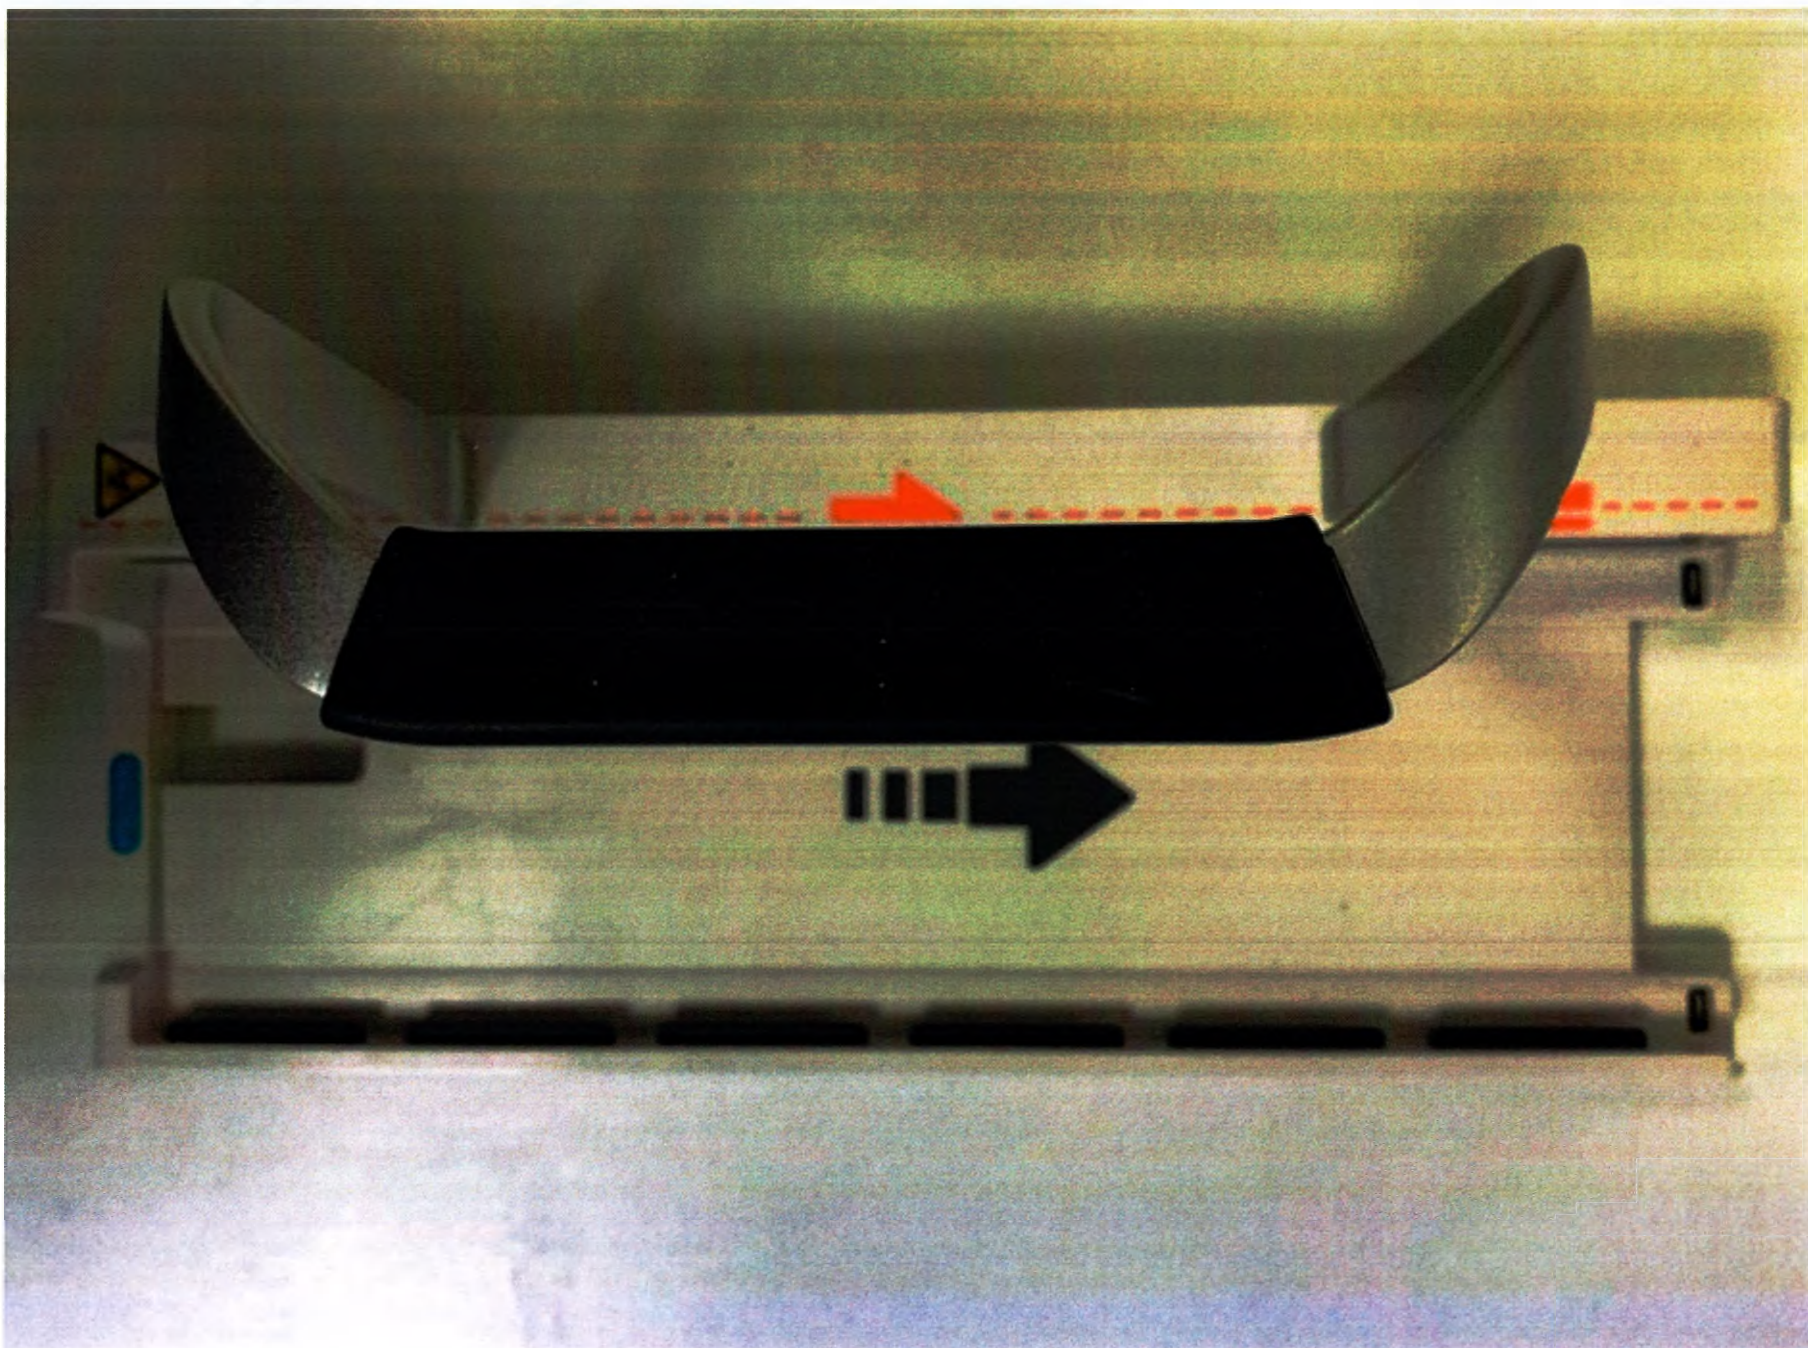


Рисунок 41. Держатель штативов с пробамми для SDM модуля для CX-9000

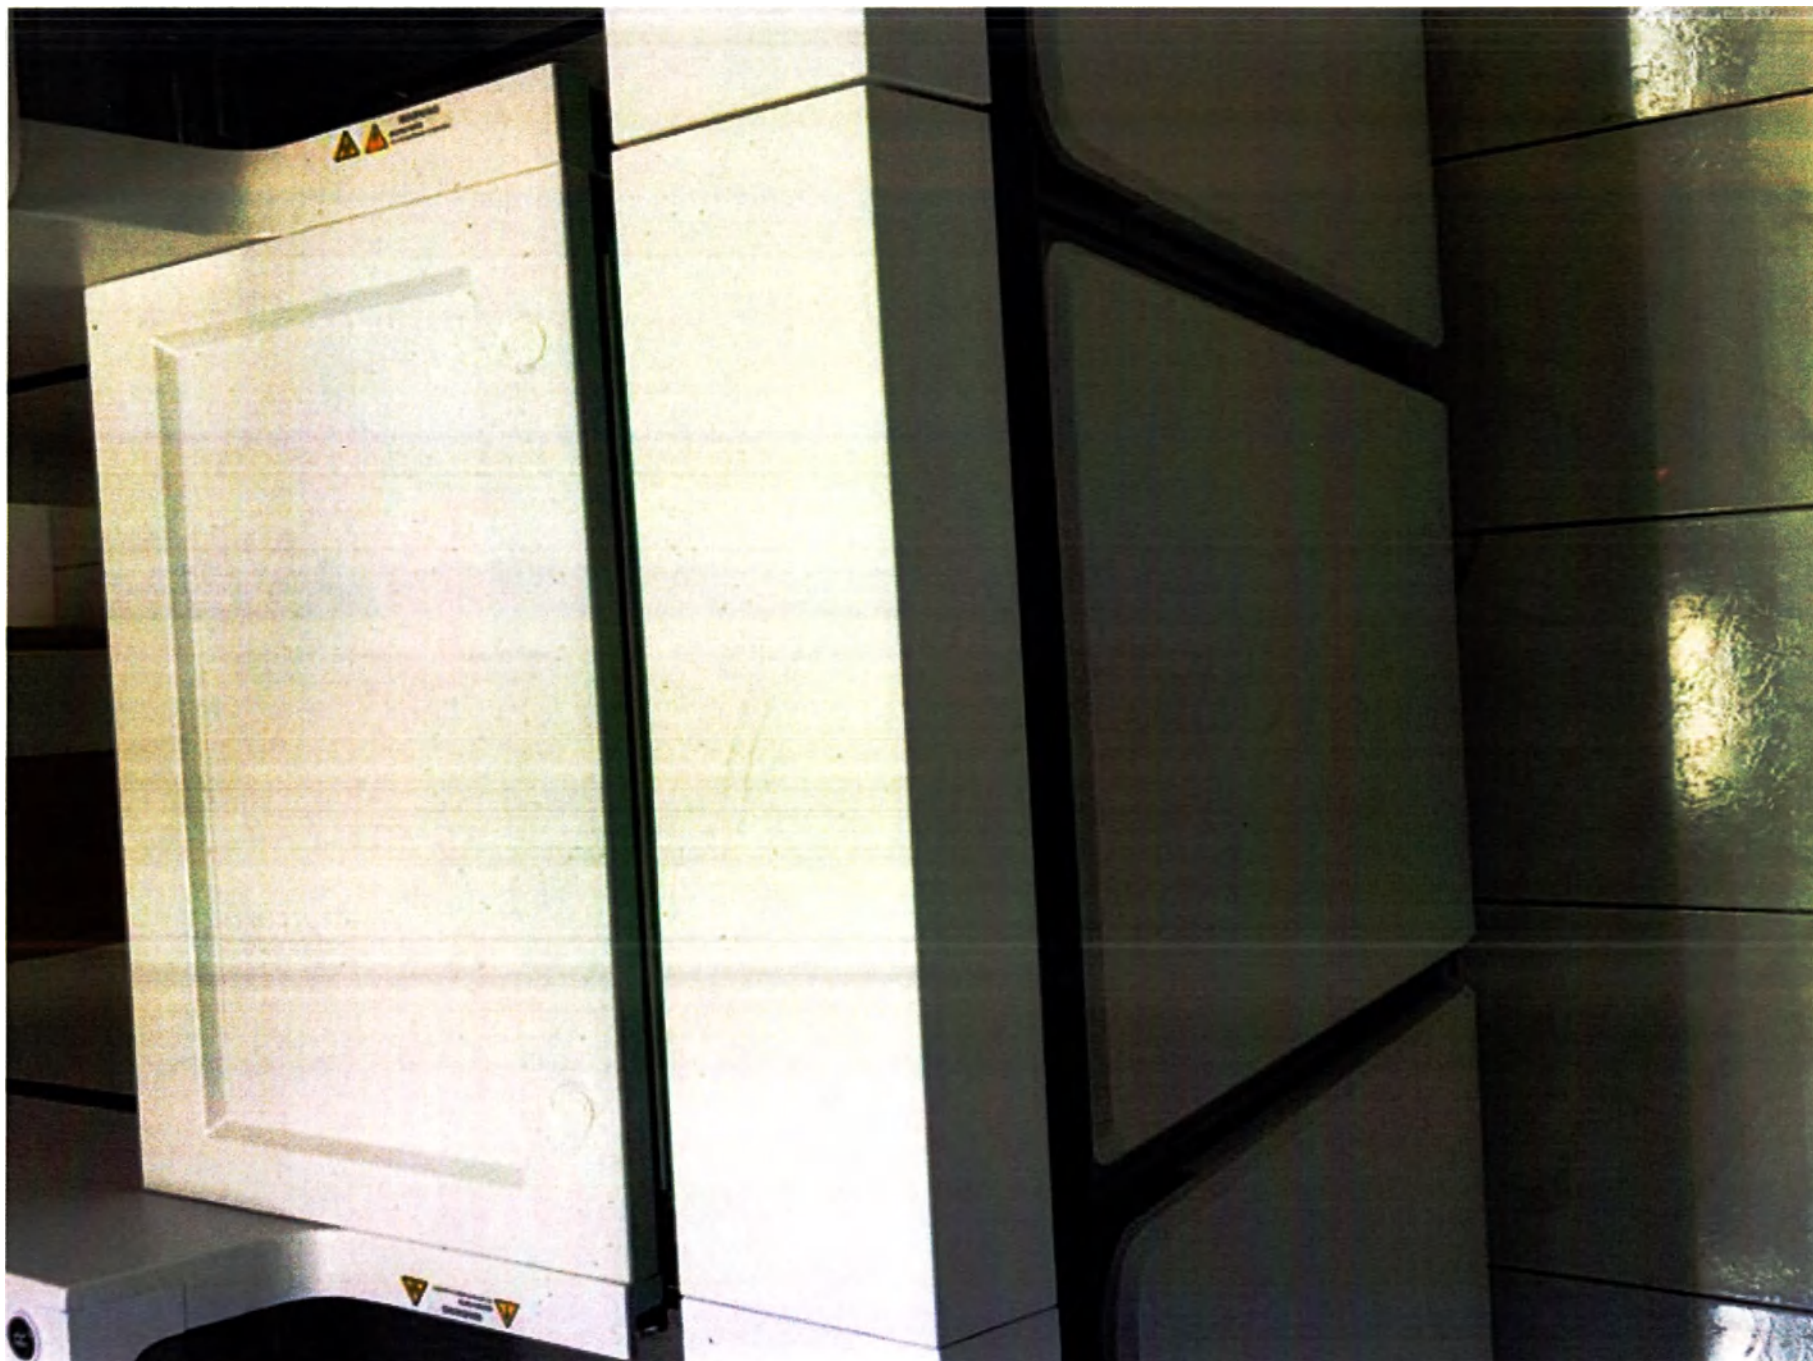


Рисунок 42. Соединительный модуль для CX-9000 (линия обработки проб М2/М3)



Рисунок 43. Кабель питания европейского стандарта SDM для CX-9000

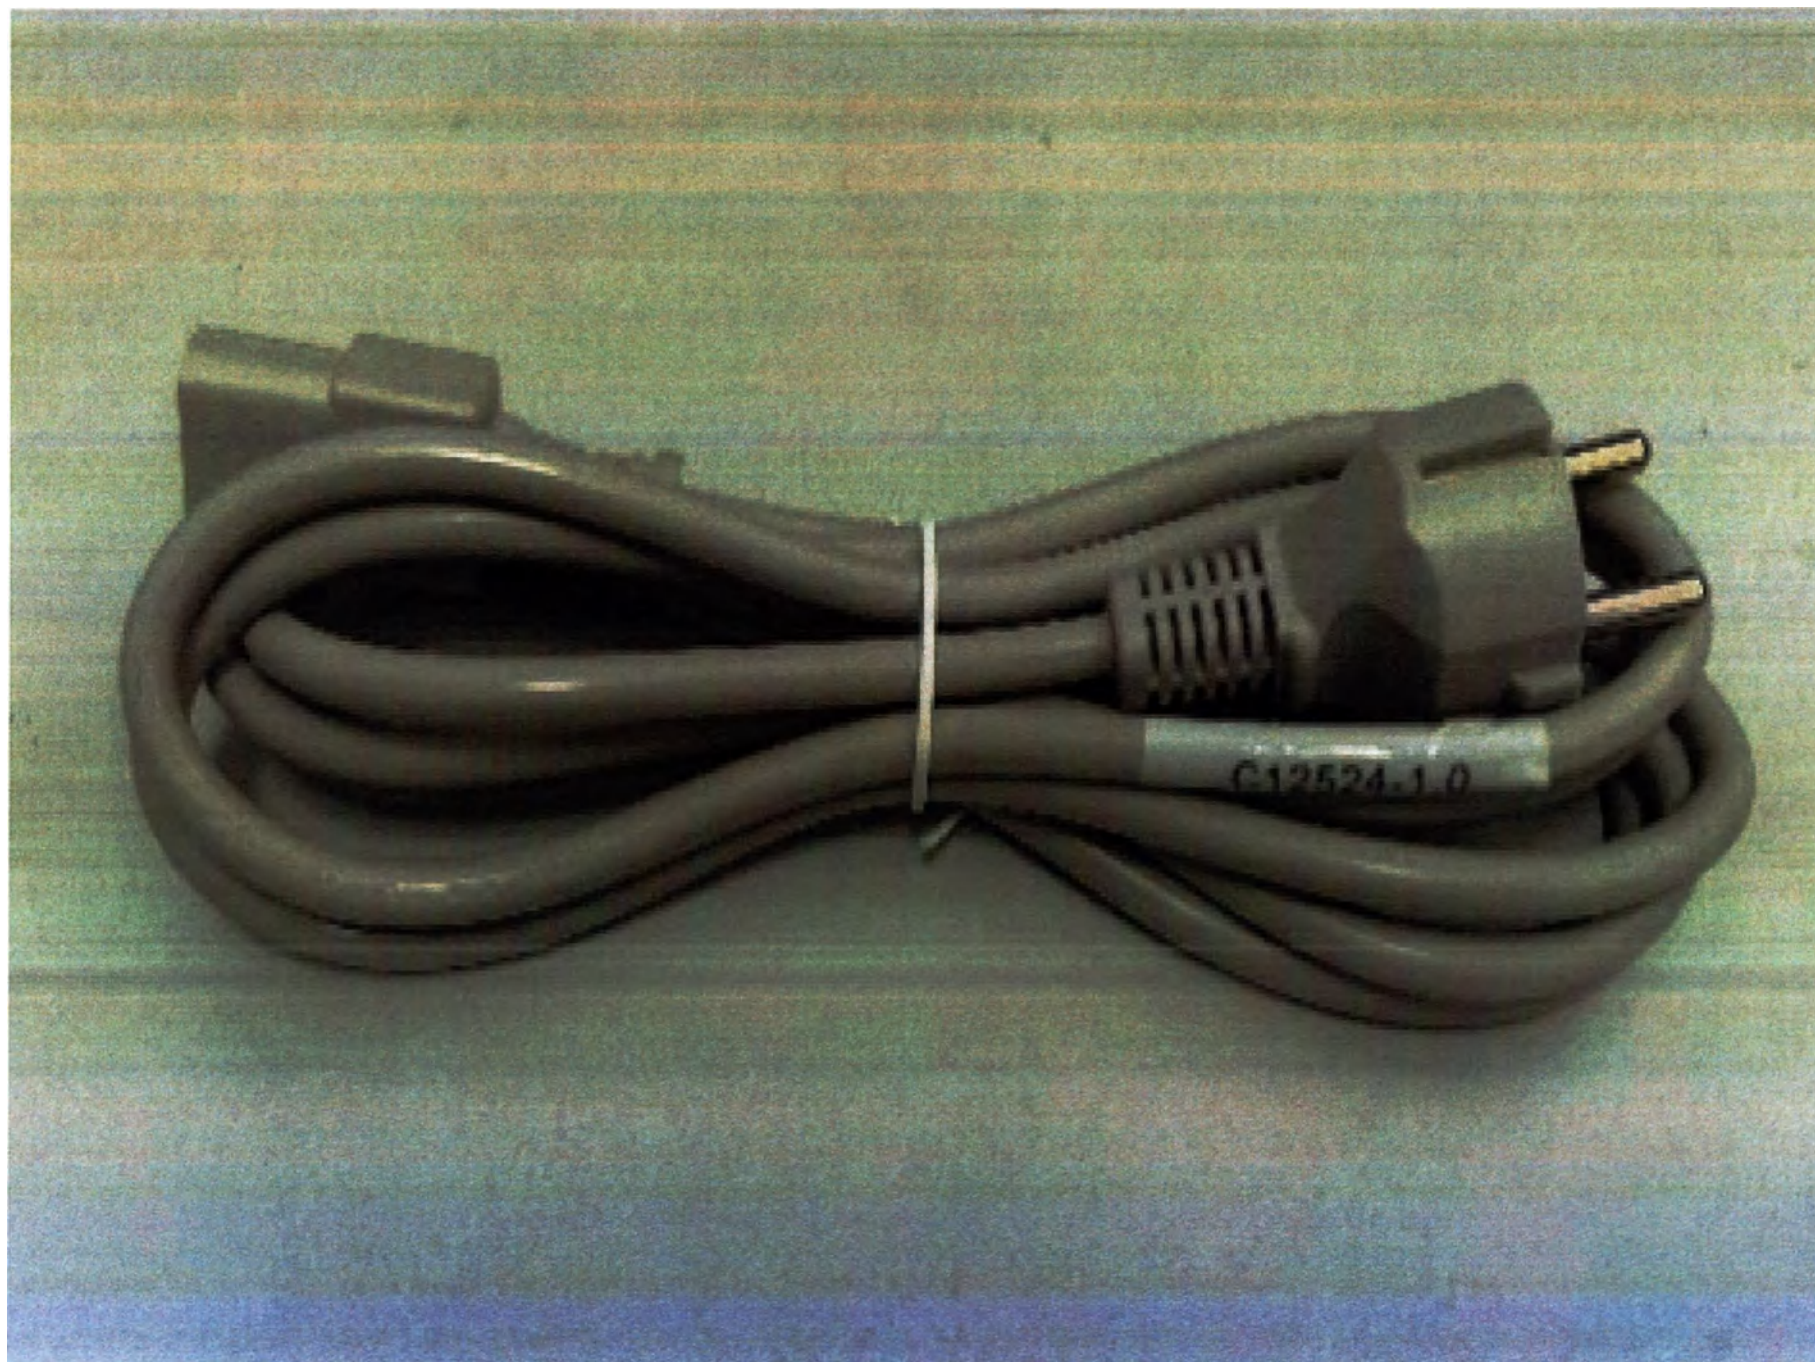


Рисунок 44. Кабель питания для СХ-9000



Рисунок 45. Крепежная пластина для направляющих для CX-9000



Рисунок 46. Кабель HDMI для подключения модуля SDM к интерфейсной плате ввода/вывода для CX-9000



Рисунок 47. Кабель USB для подключения модуля SDM к интерфейсной плате ввода/вывода для CX-9000



Рисунок 48. Кабель для соединения модуля SDM и основного блока для CX-9000



Рисунок 49. Стандартная пружинная шайба GB/T93 для CX-9000 (линия обработки проб M2/M3)



Рисунок 50. Шайба плоская D8 для CX-9000 (линия обработки проб M2/M3)



Рисунок 51. Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М8Х50 для СХ-9000 (линия обработки проб М2/М3)

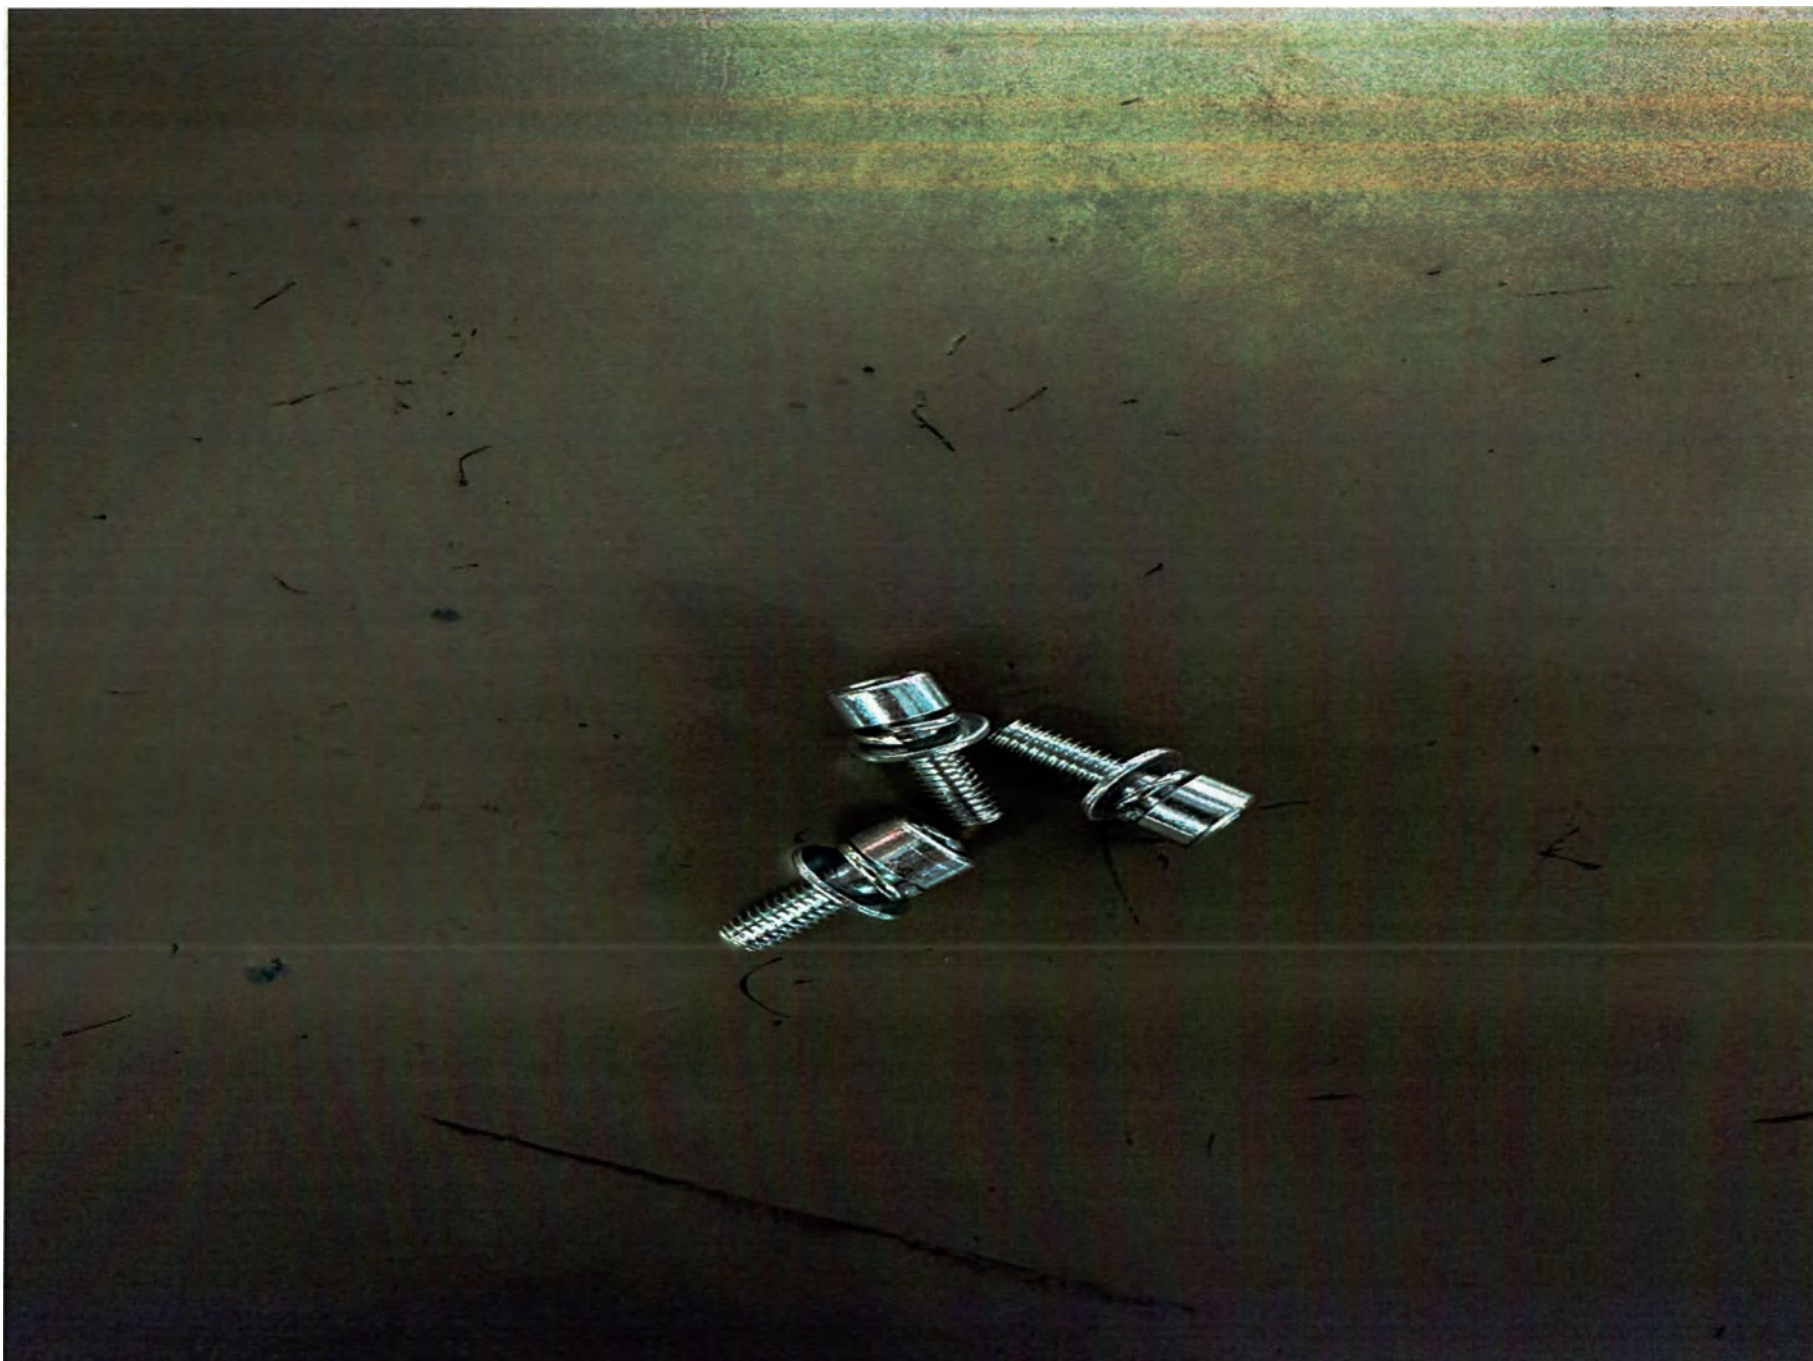


Рисунок 52. Комбинированный винт М4Х12 для СХ-9000 (линия обработки проб М2/М3)



Рисунок 53. Комбинированный винт М4Х16 для СХ-9000 (линия обработки проб М2/М3)

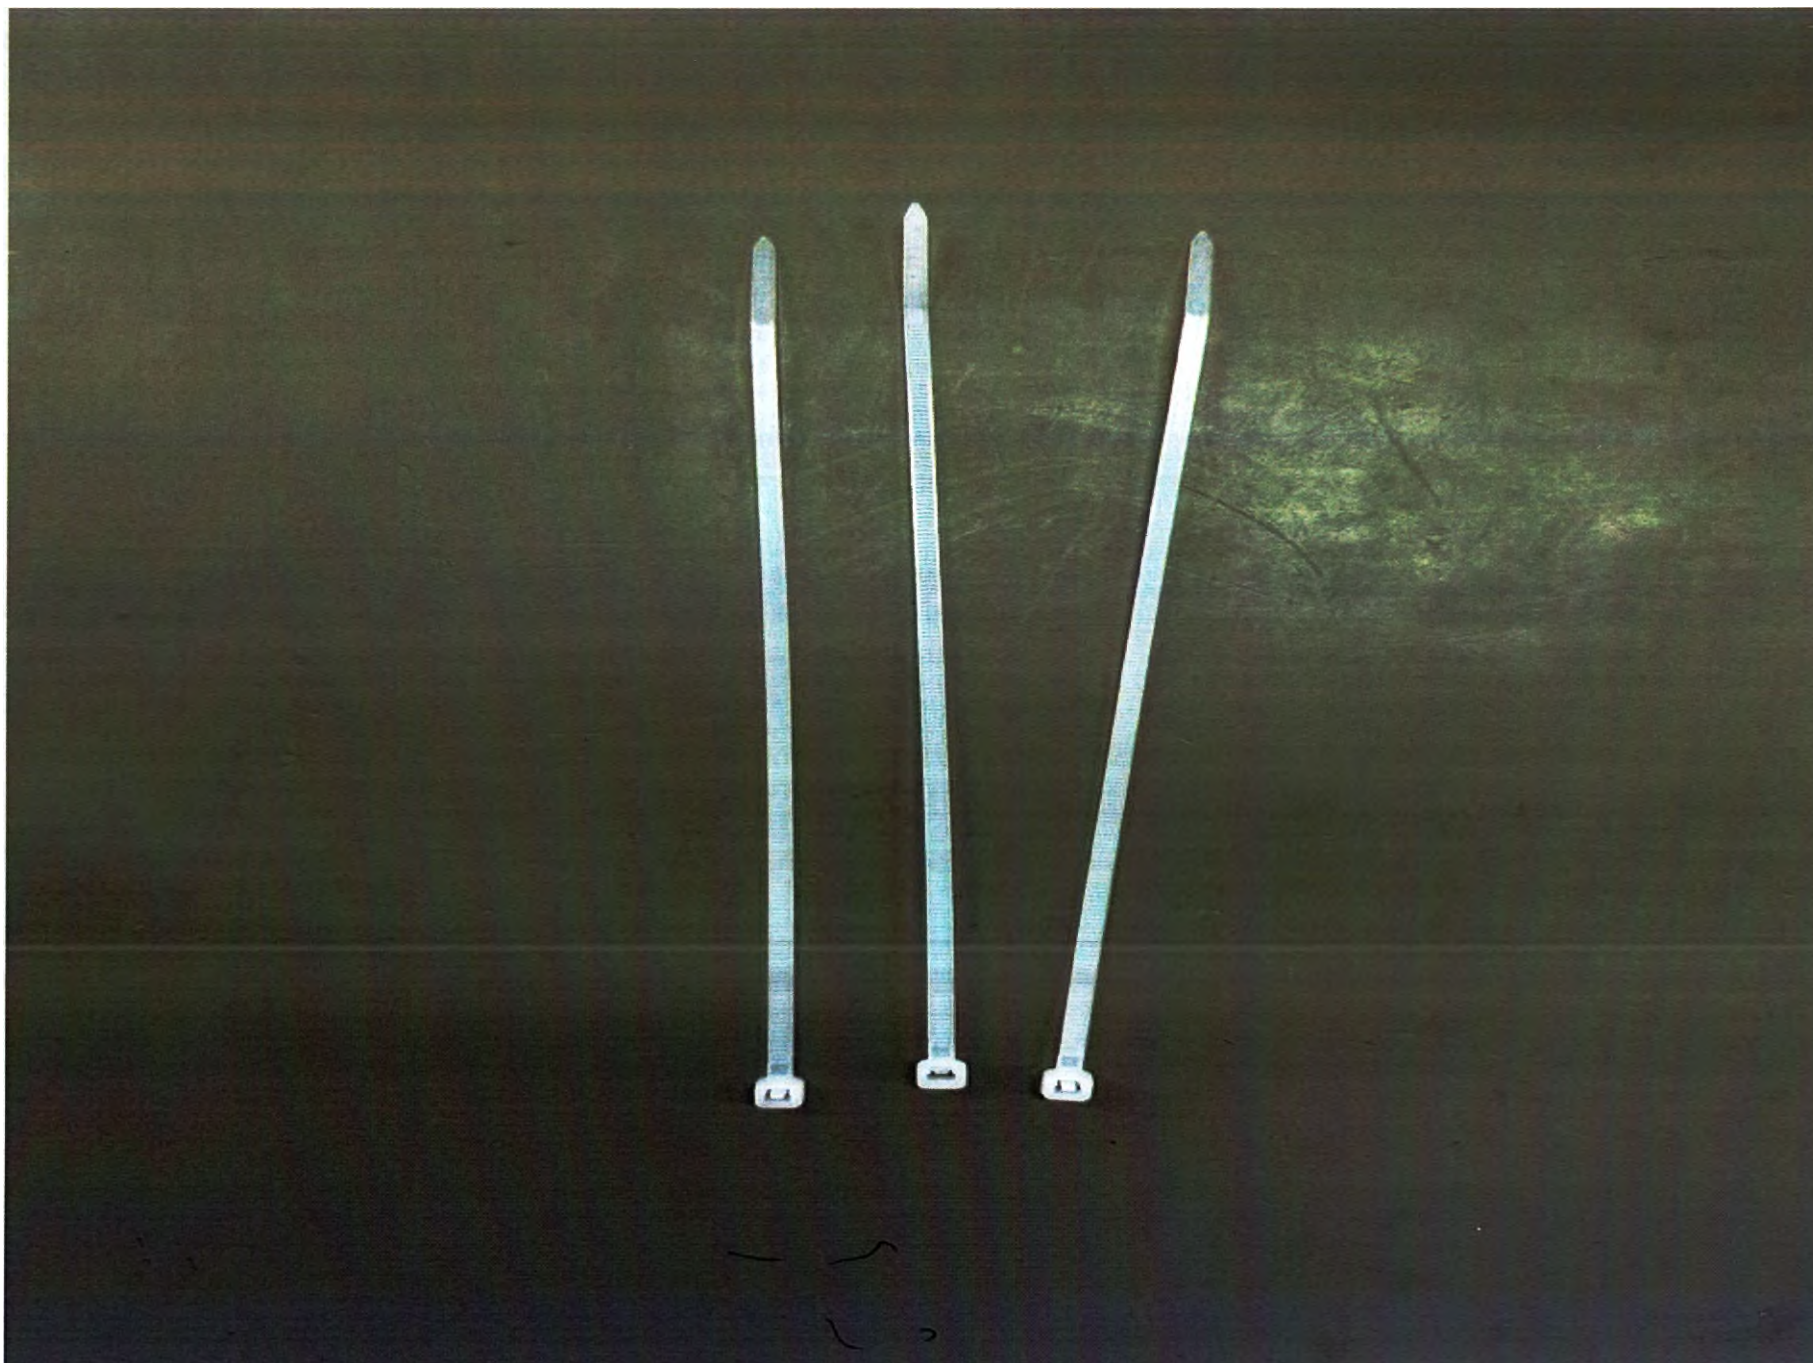


Рисунок 54. Нейлоновая кабельная стяжка для крепления кабелей для СХ-9000 (линия обработки проб М2/М3)

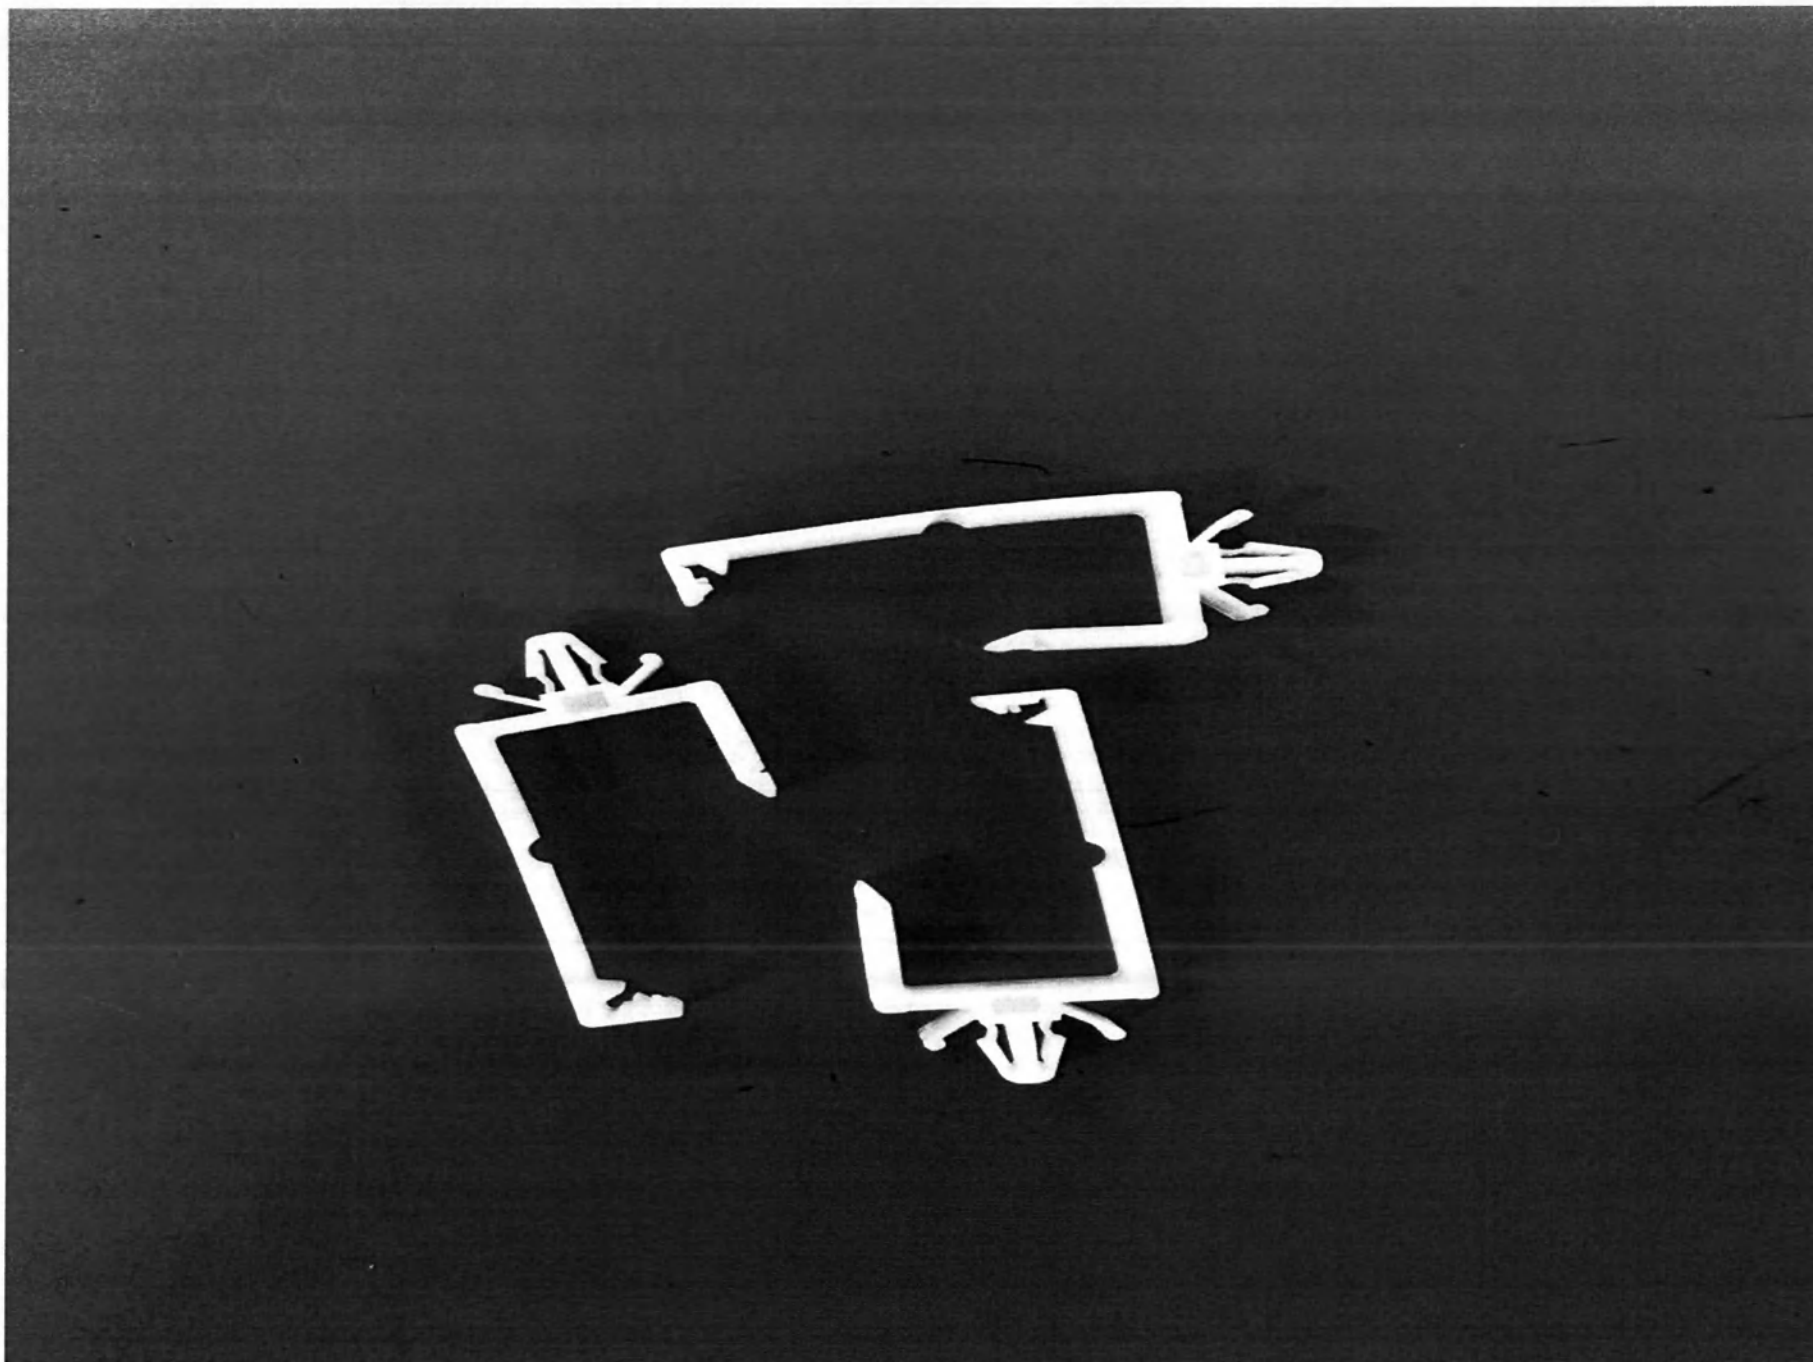


Рисунок 55. Зажим плоский для крепления кабелей для CX-9000 (линия обработки проб М2/М3)

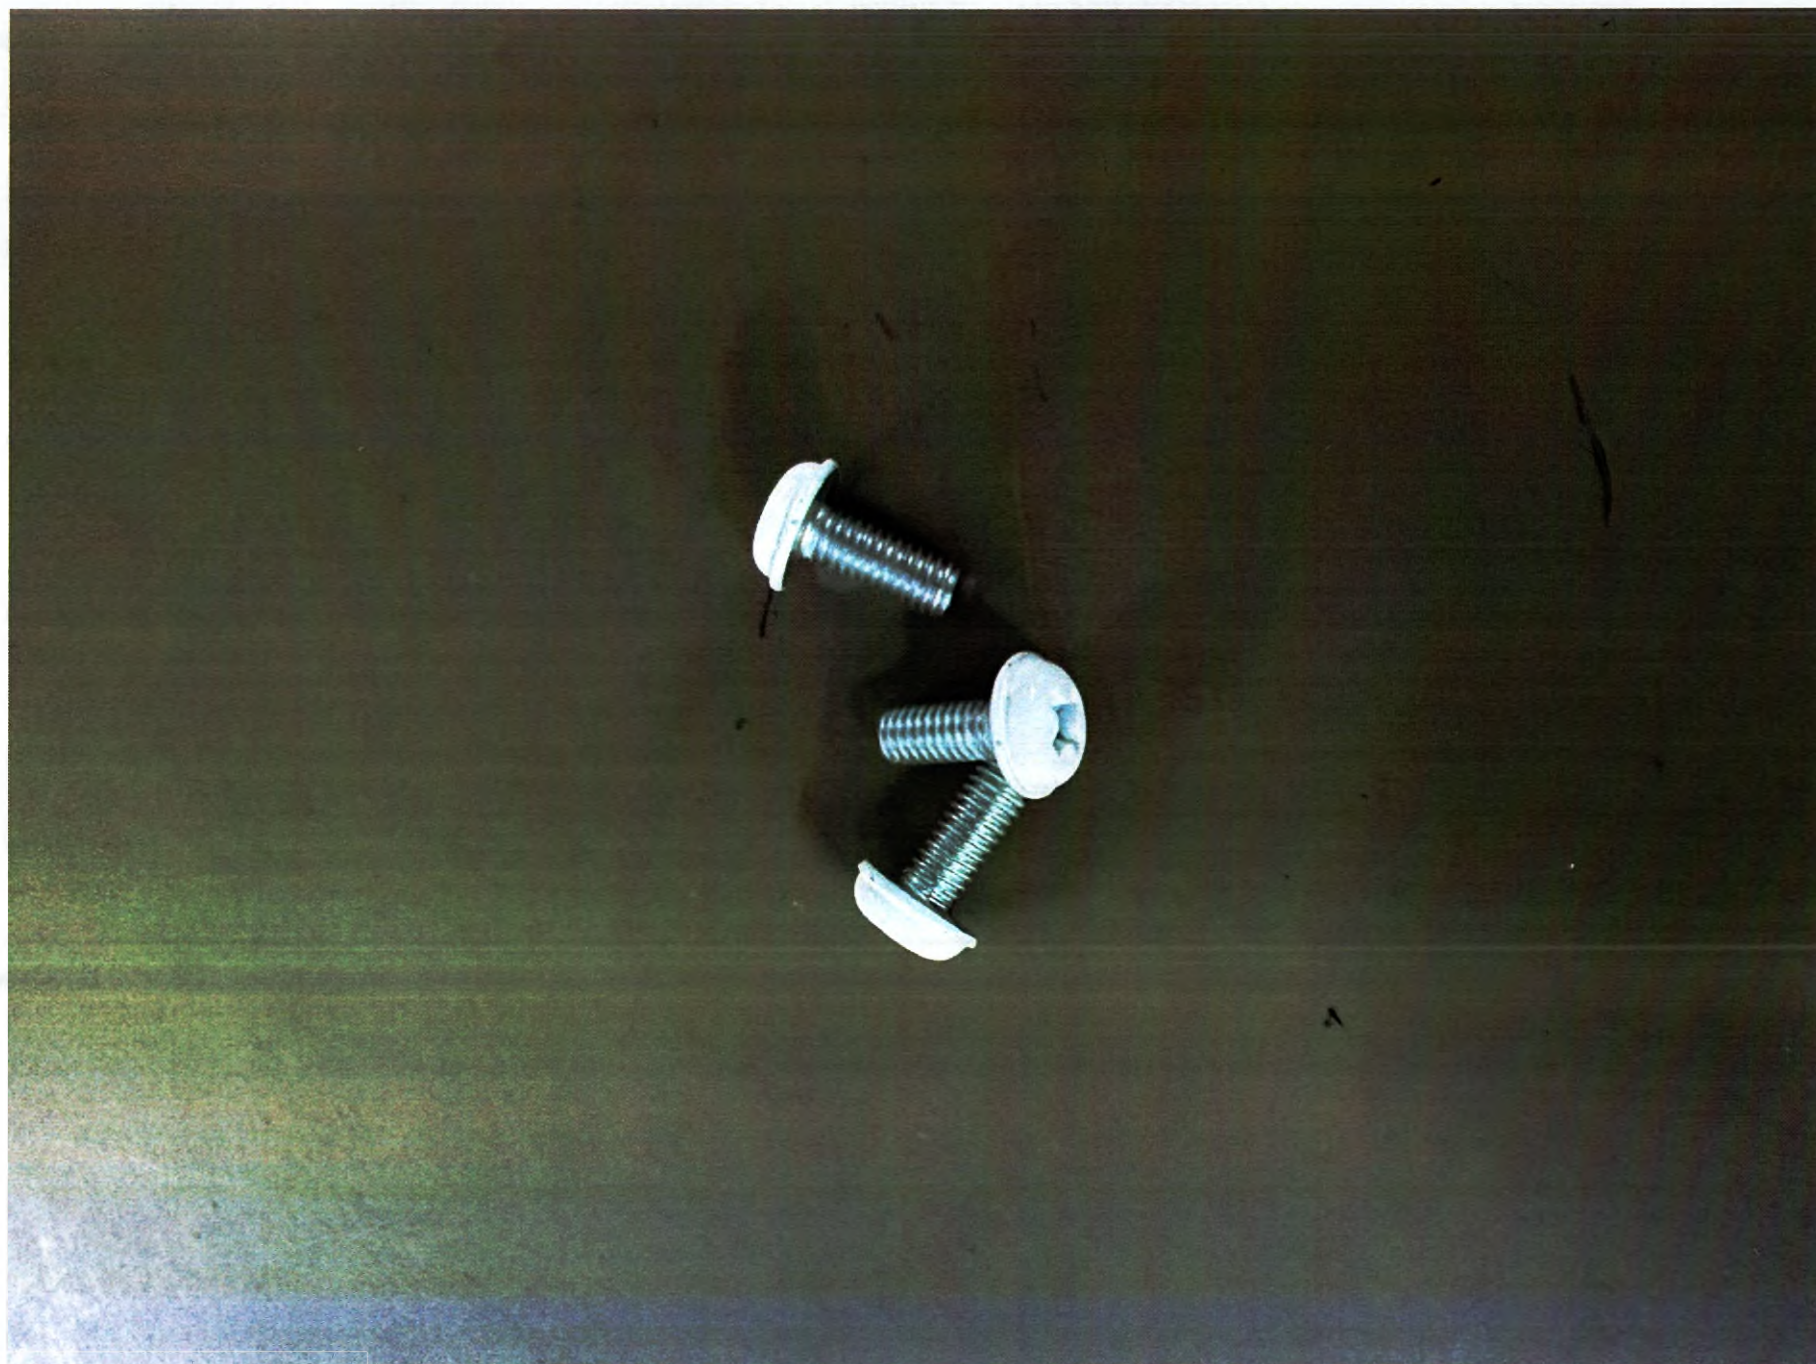


Рисунок 56. Винт М4Х10 (DS 193) для CX-9000 (линия обработки проб М2/М3)

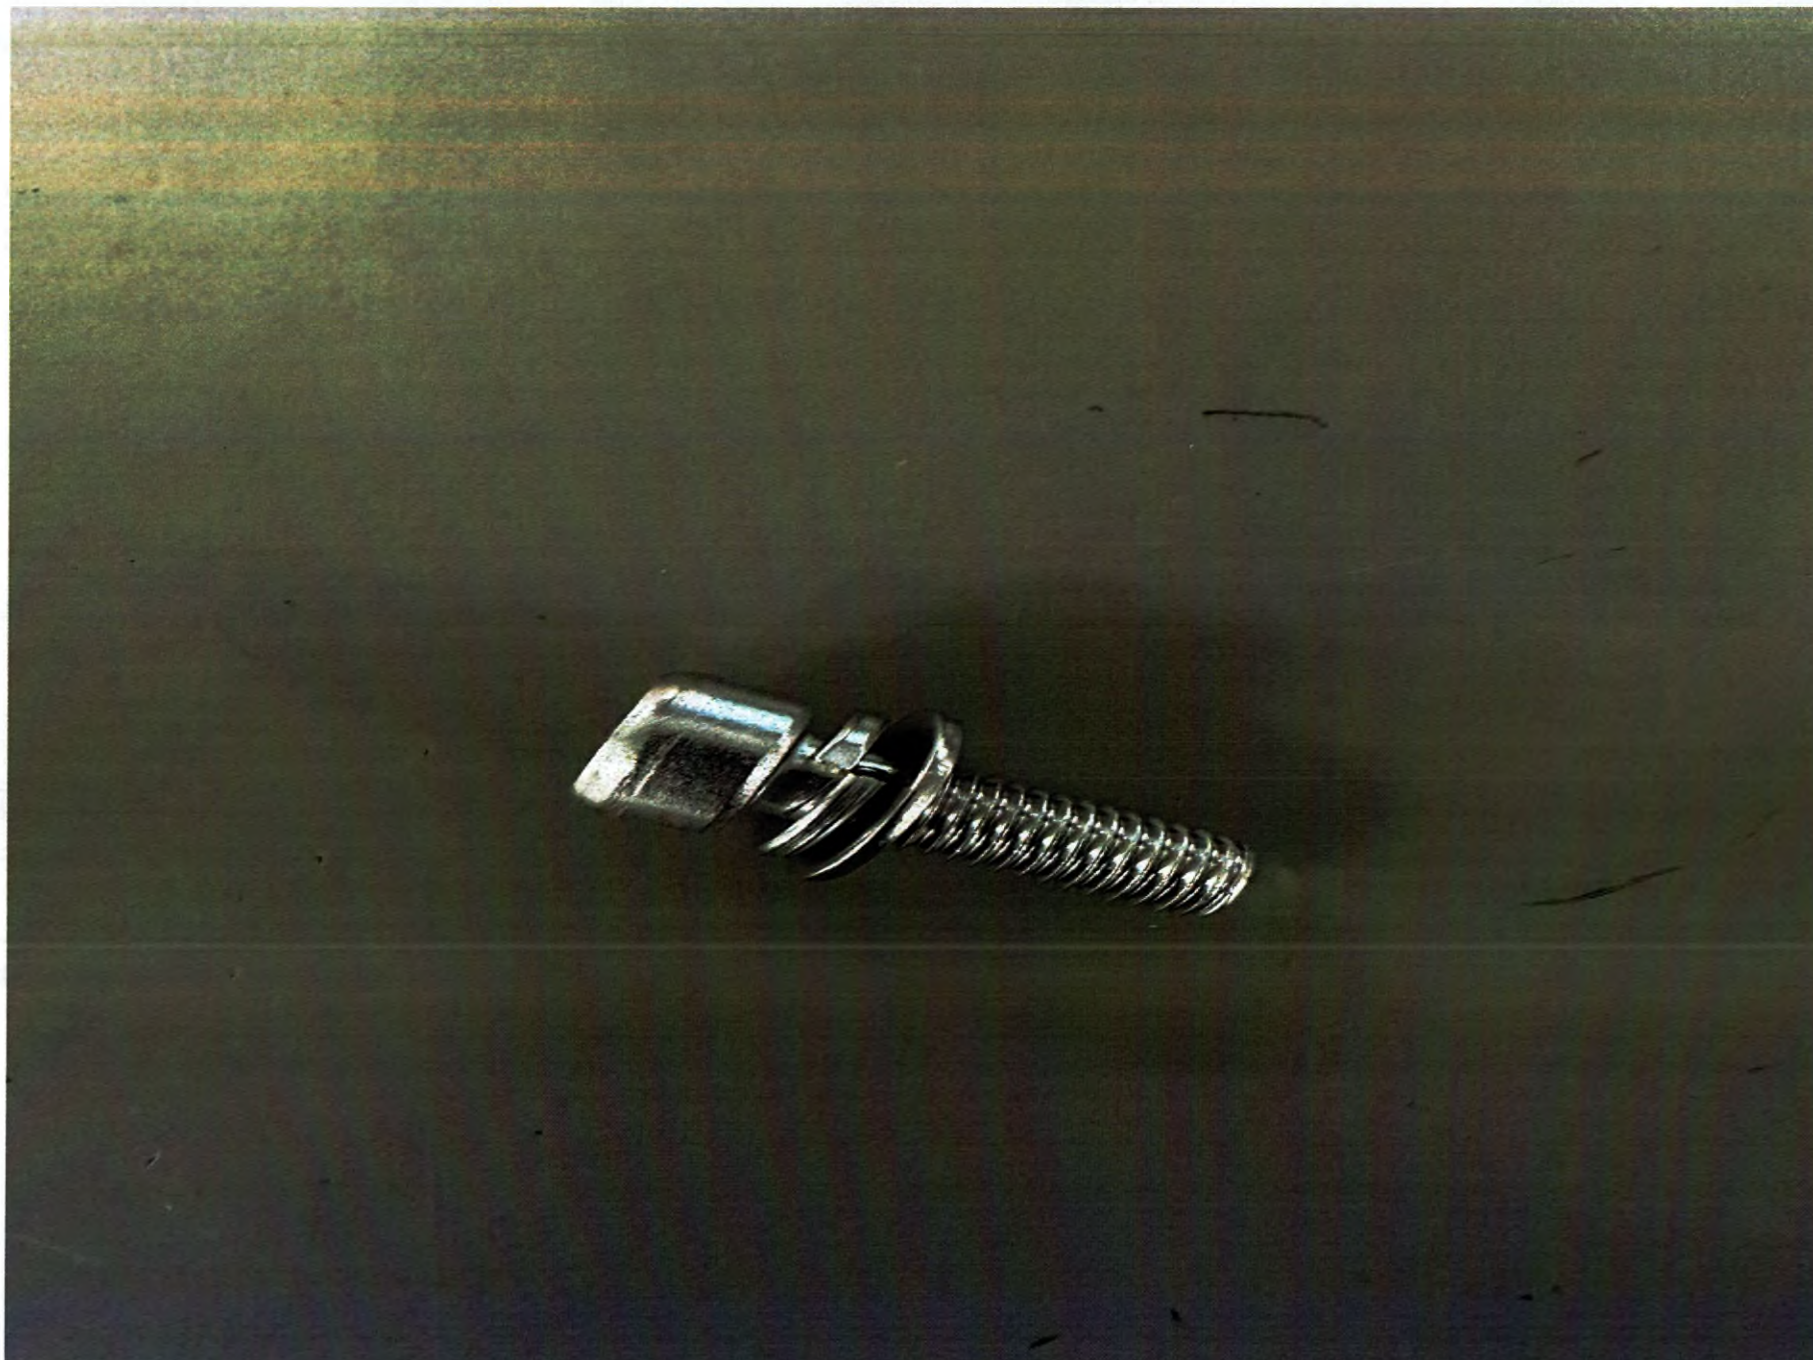


Рисунок 57. Комбинированный винт с внутренним шестигранником М8Х25 для СХ-9000 (линия обработки проб М2/М3)



Рисунок 58. Коробка заземляющего кабеля основного блока для СХ-9000 (линия обработки проб М2/М3)

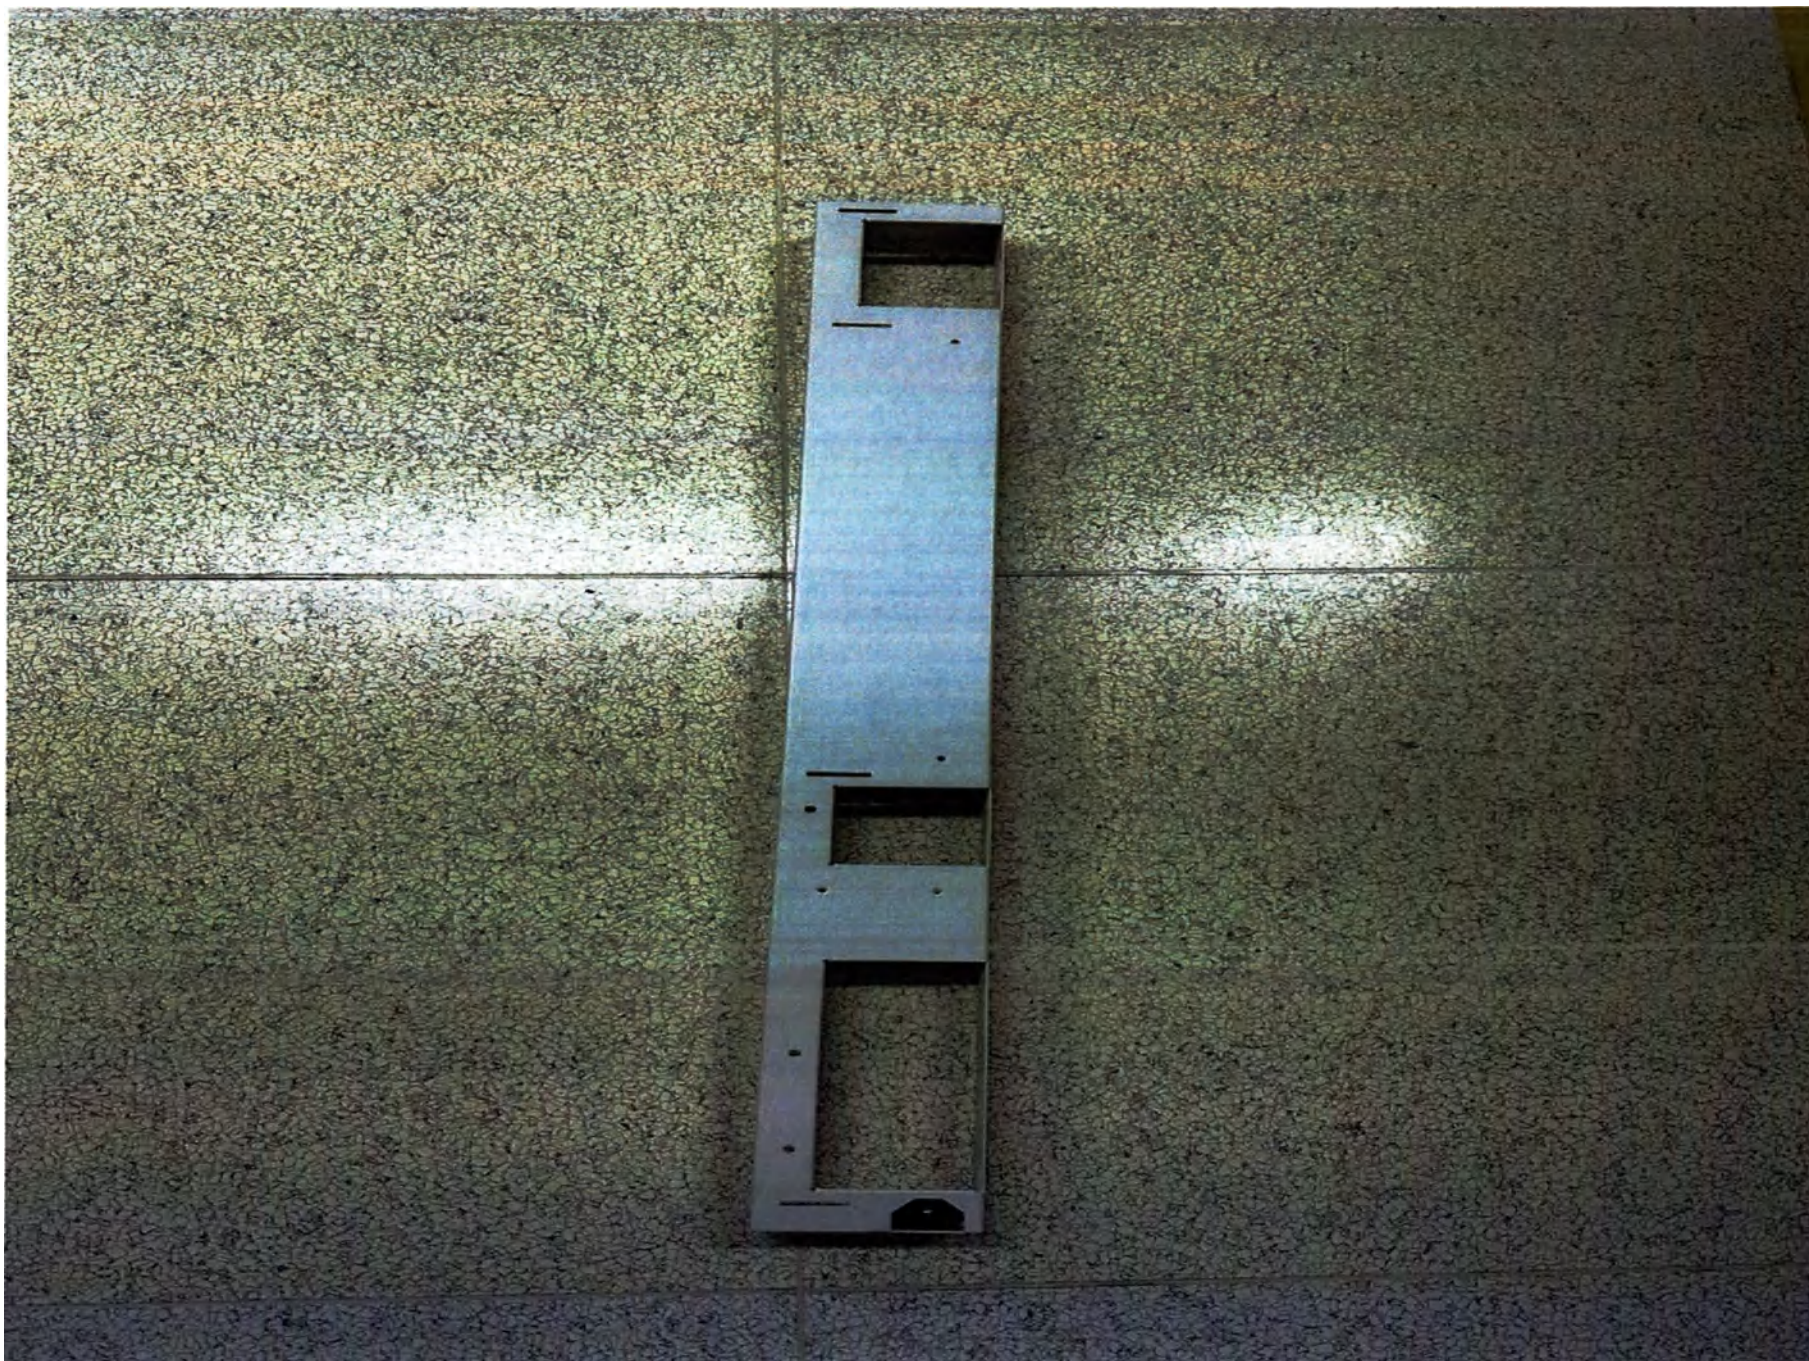


Рисунок 59. Коробка заземляющего кабеля модуля SDM для CX-9000 (линия обработки проб M2/M3)

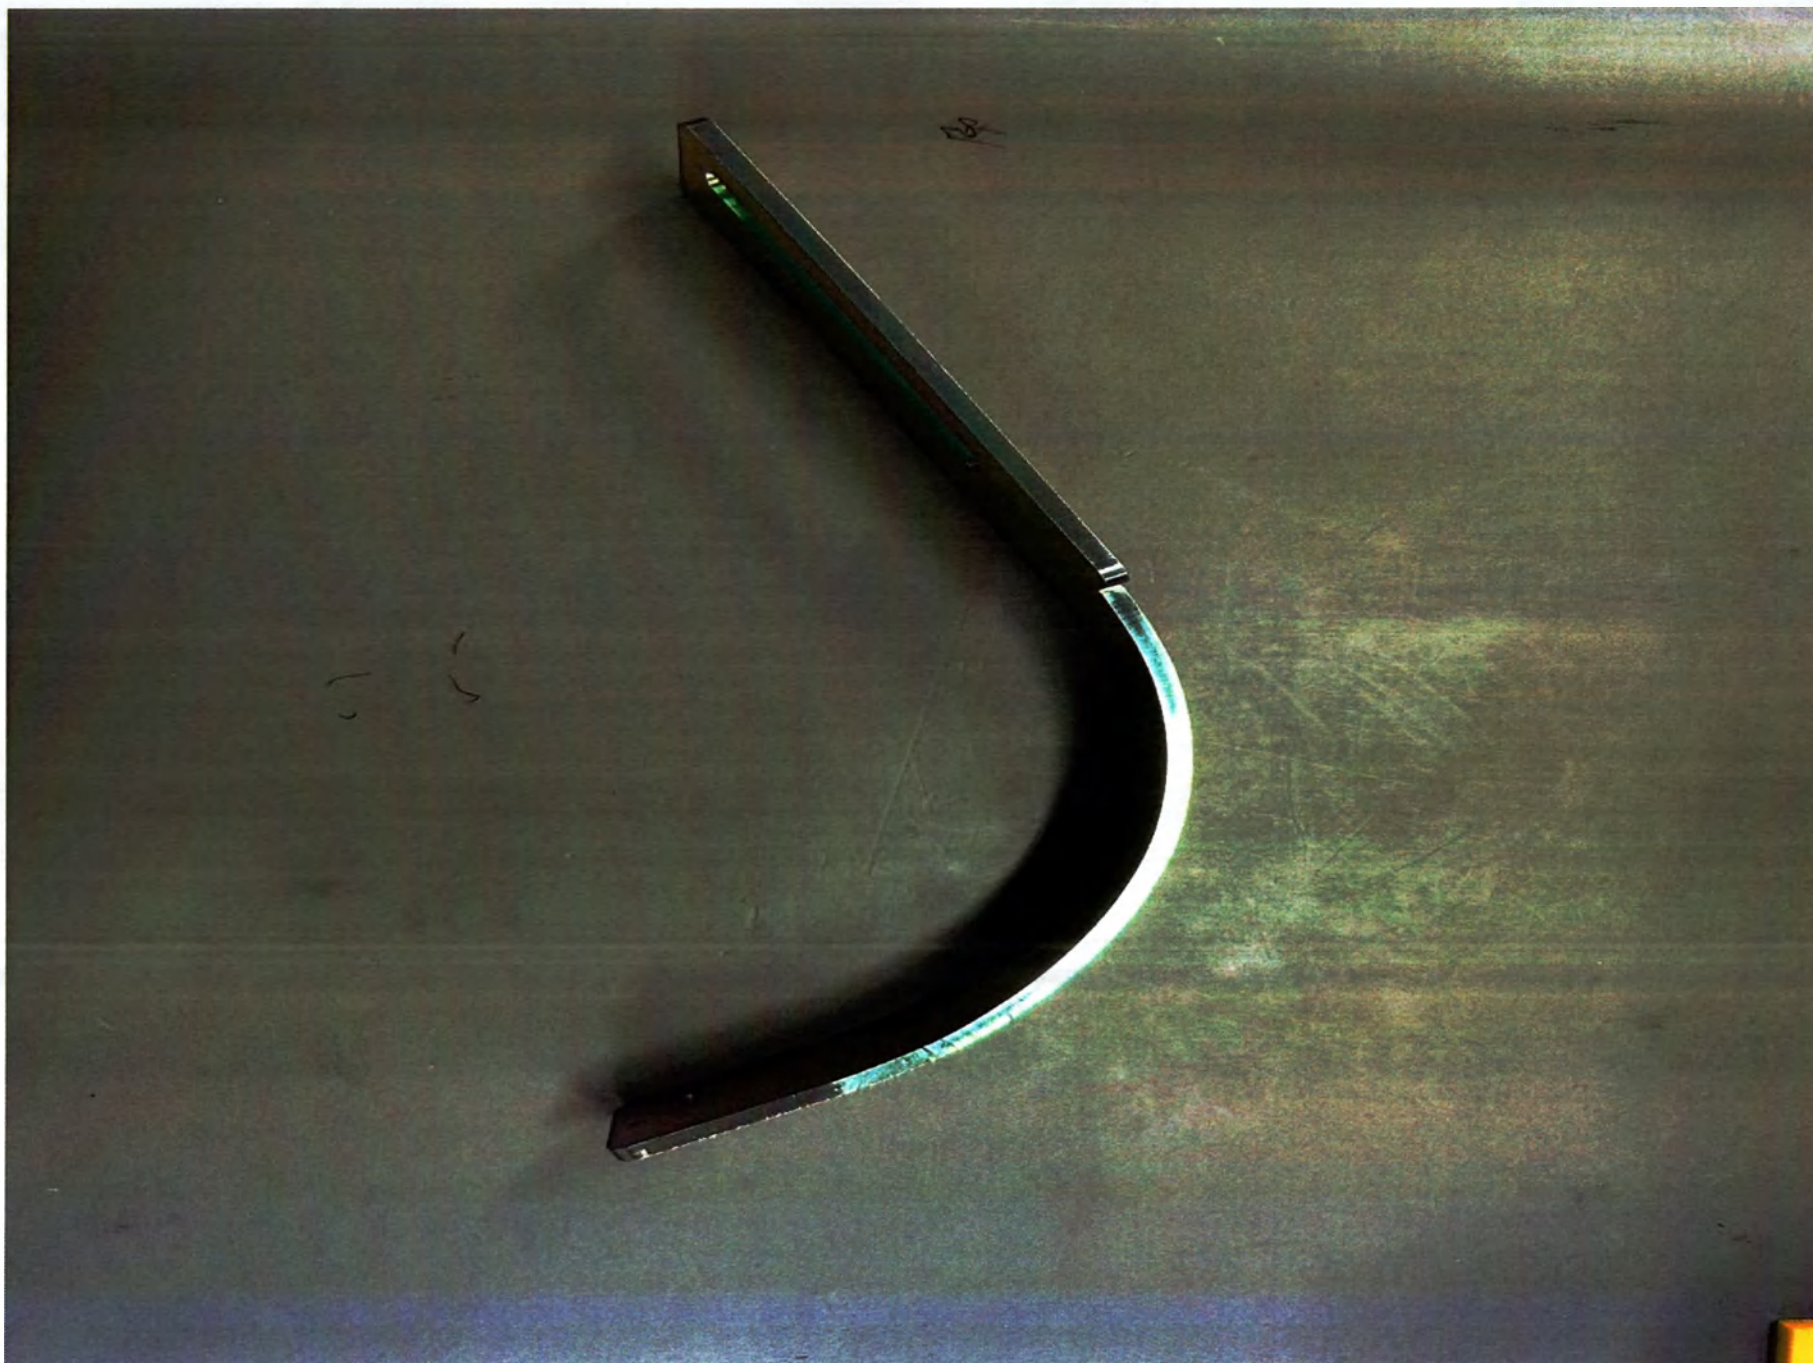


Рисунок 60. Кронштейн кабельной коробки для CX-9000 (линия обработки проб М2/М3)

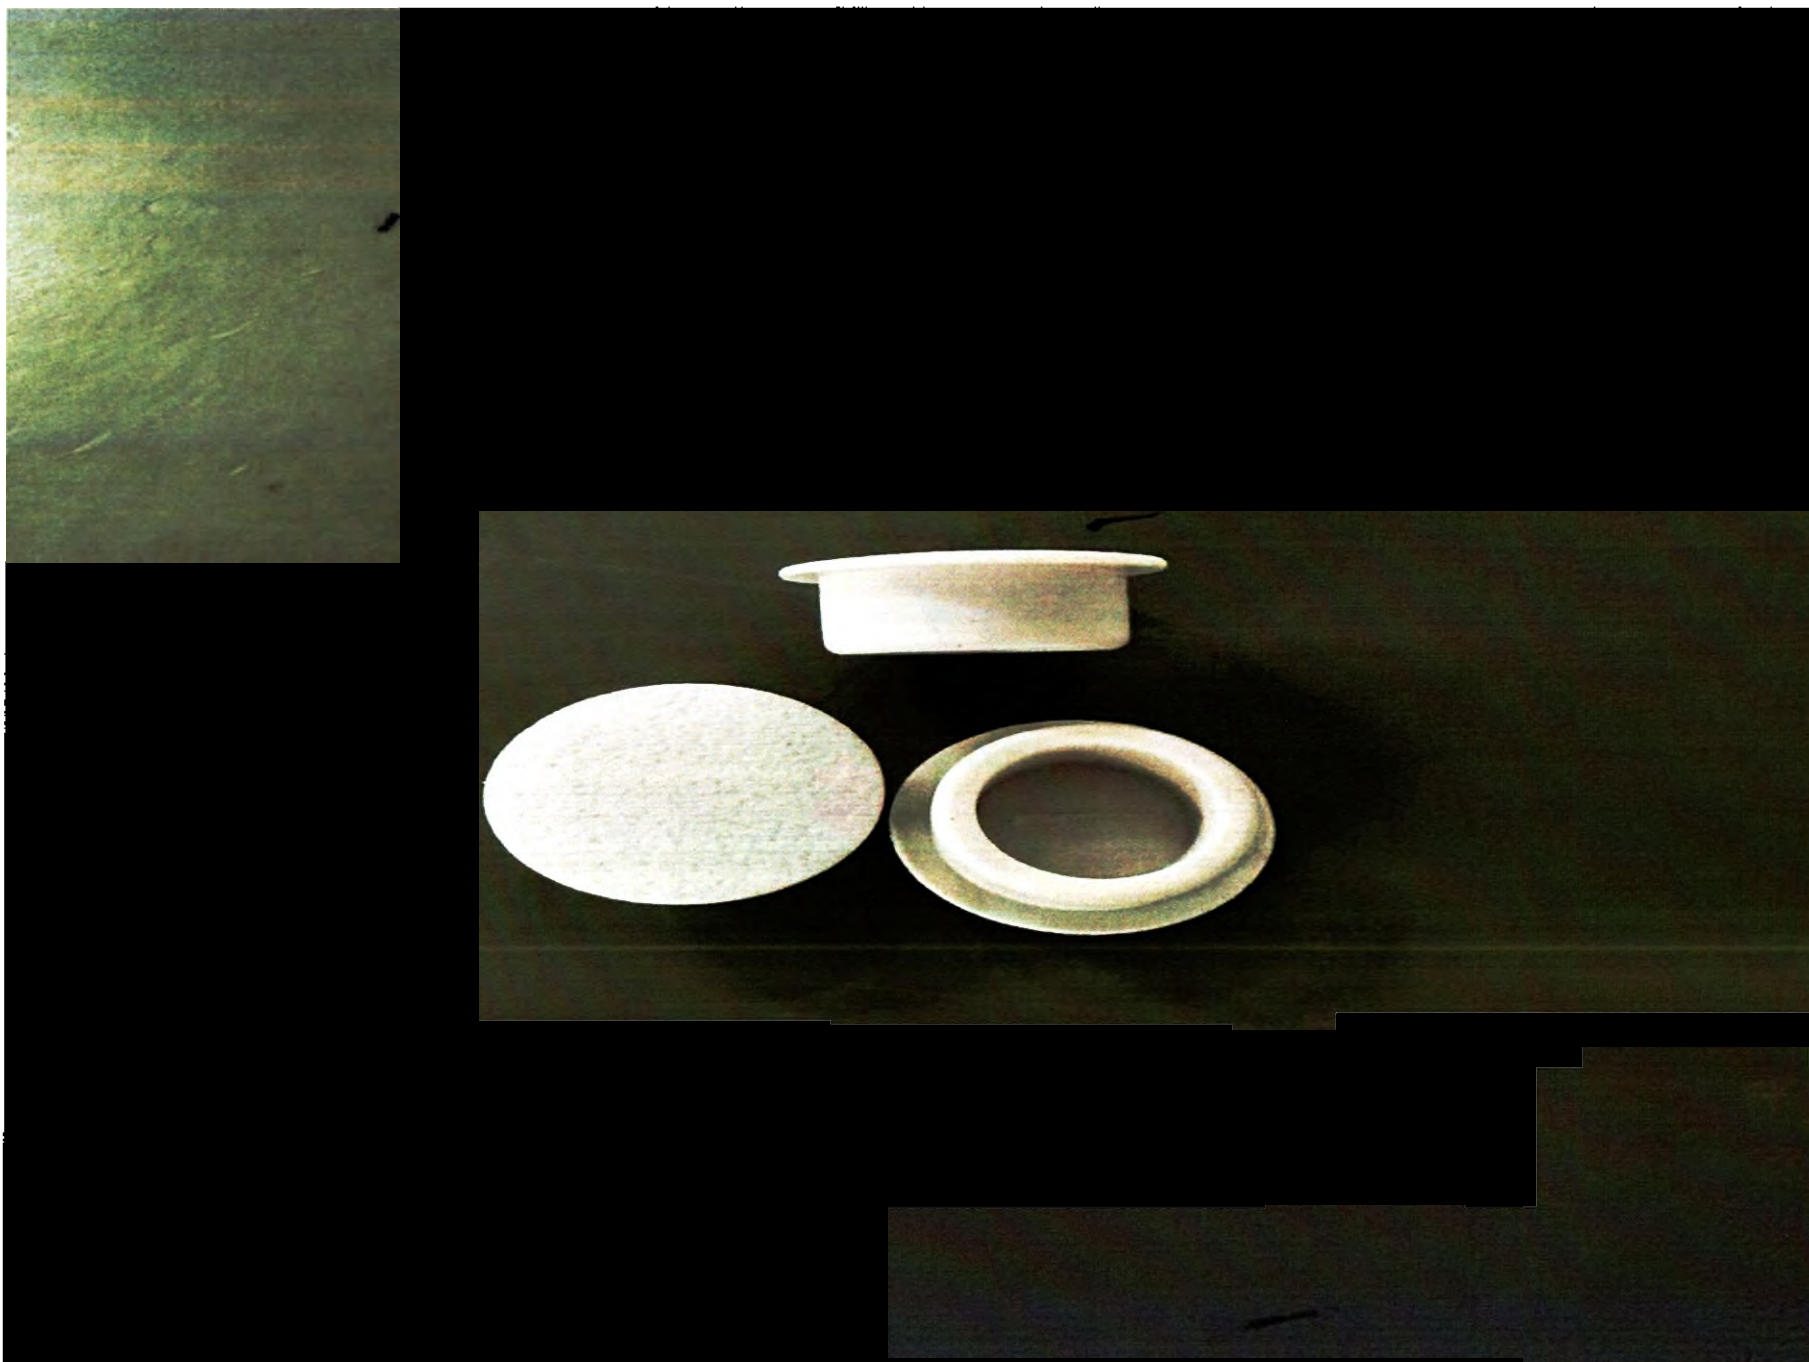


Рисунок 61. Защитная заглушка для CX-9000 (линия обработки проб M2/M3)

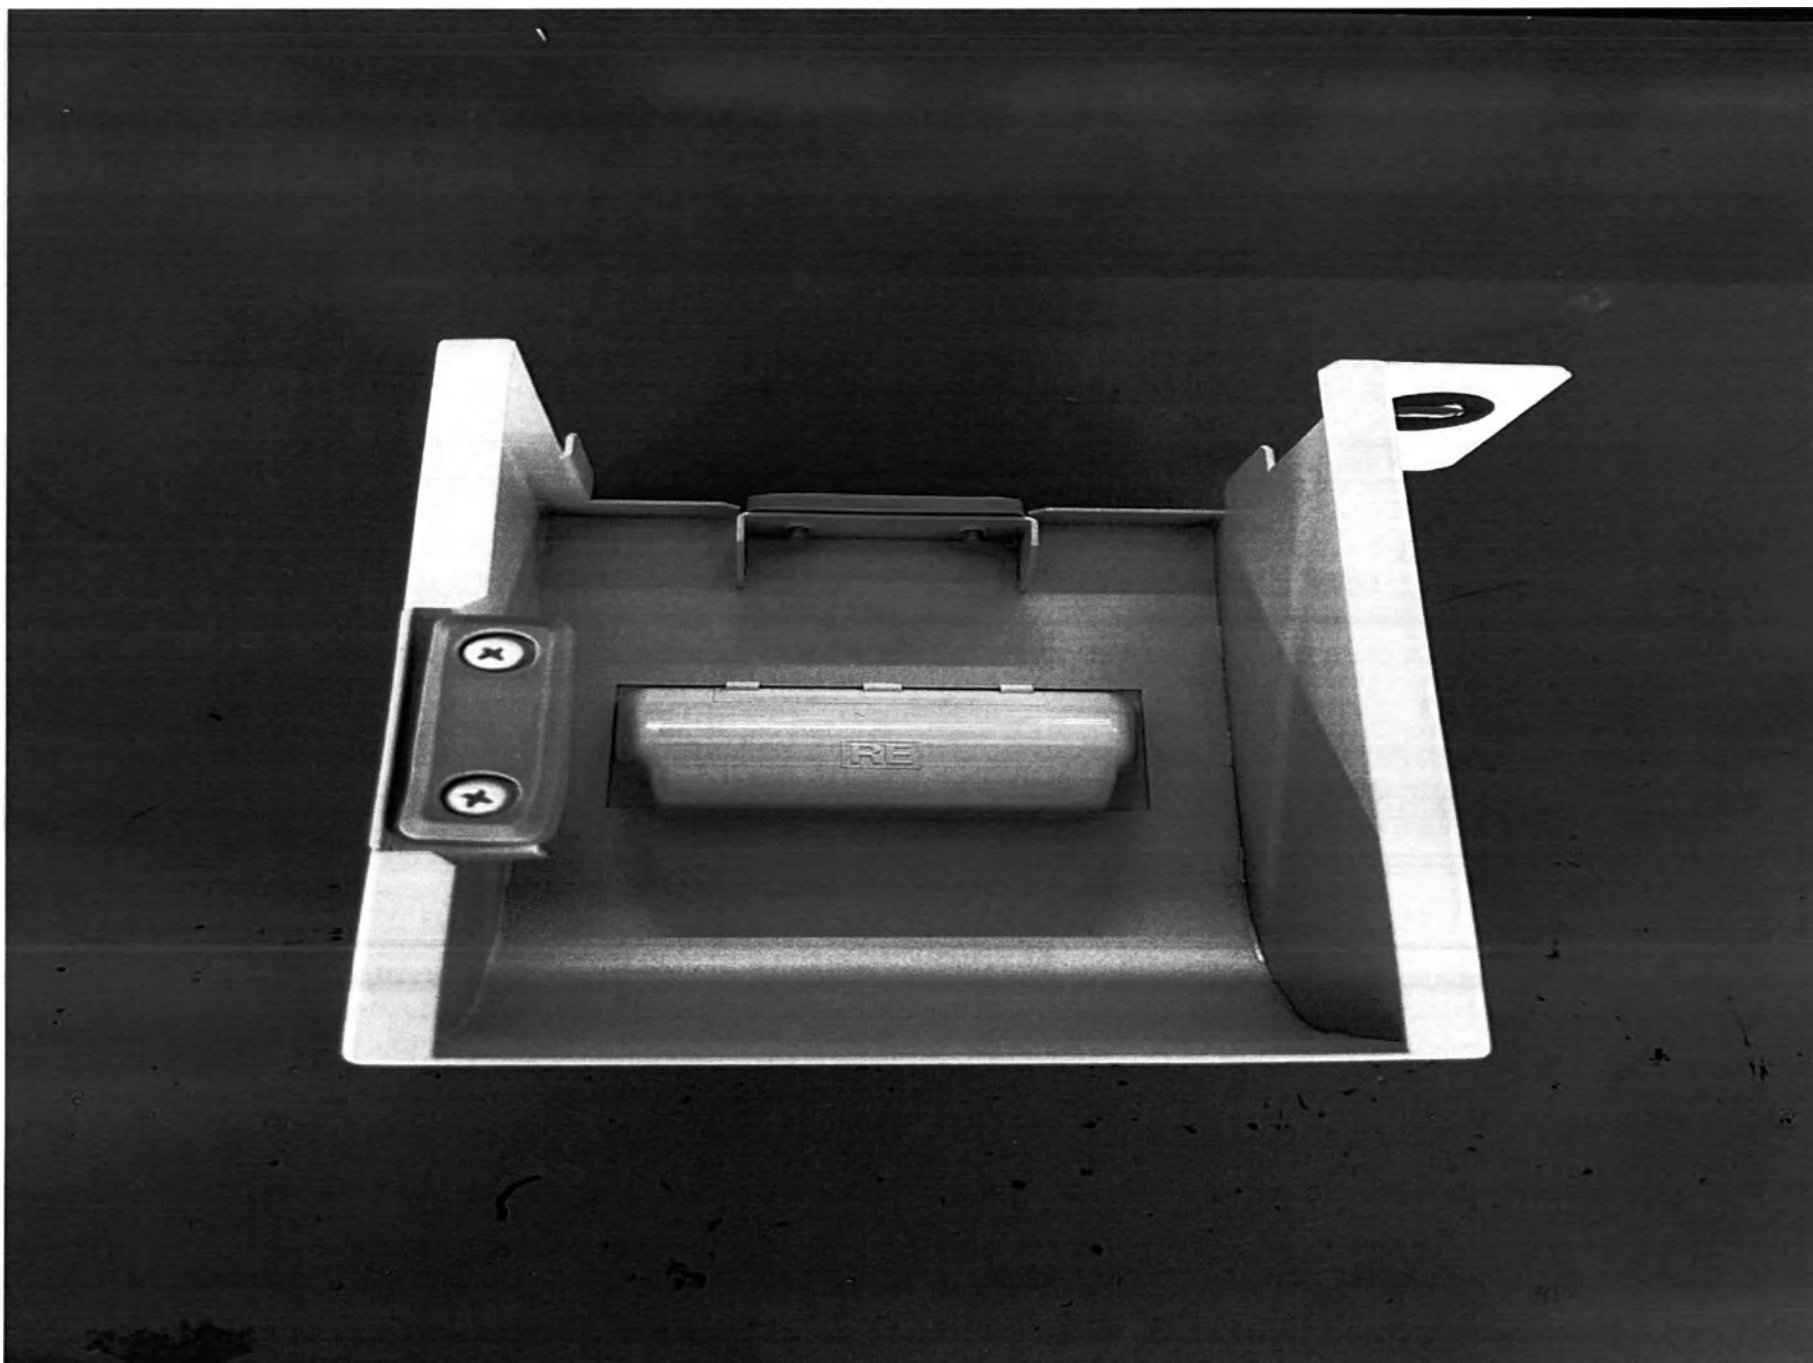


Рисунок 62. Кабельная коробка модуля SDM для CX-9000 (линия обработки проб M2/M3)

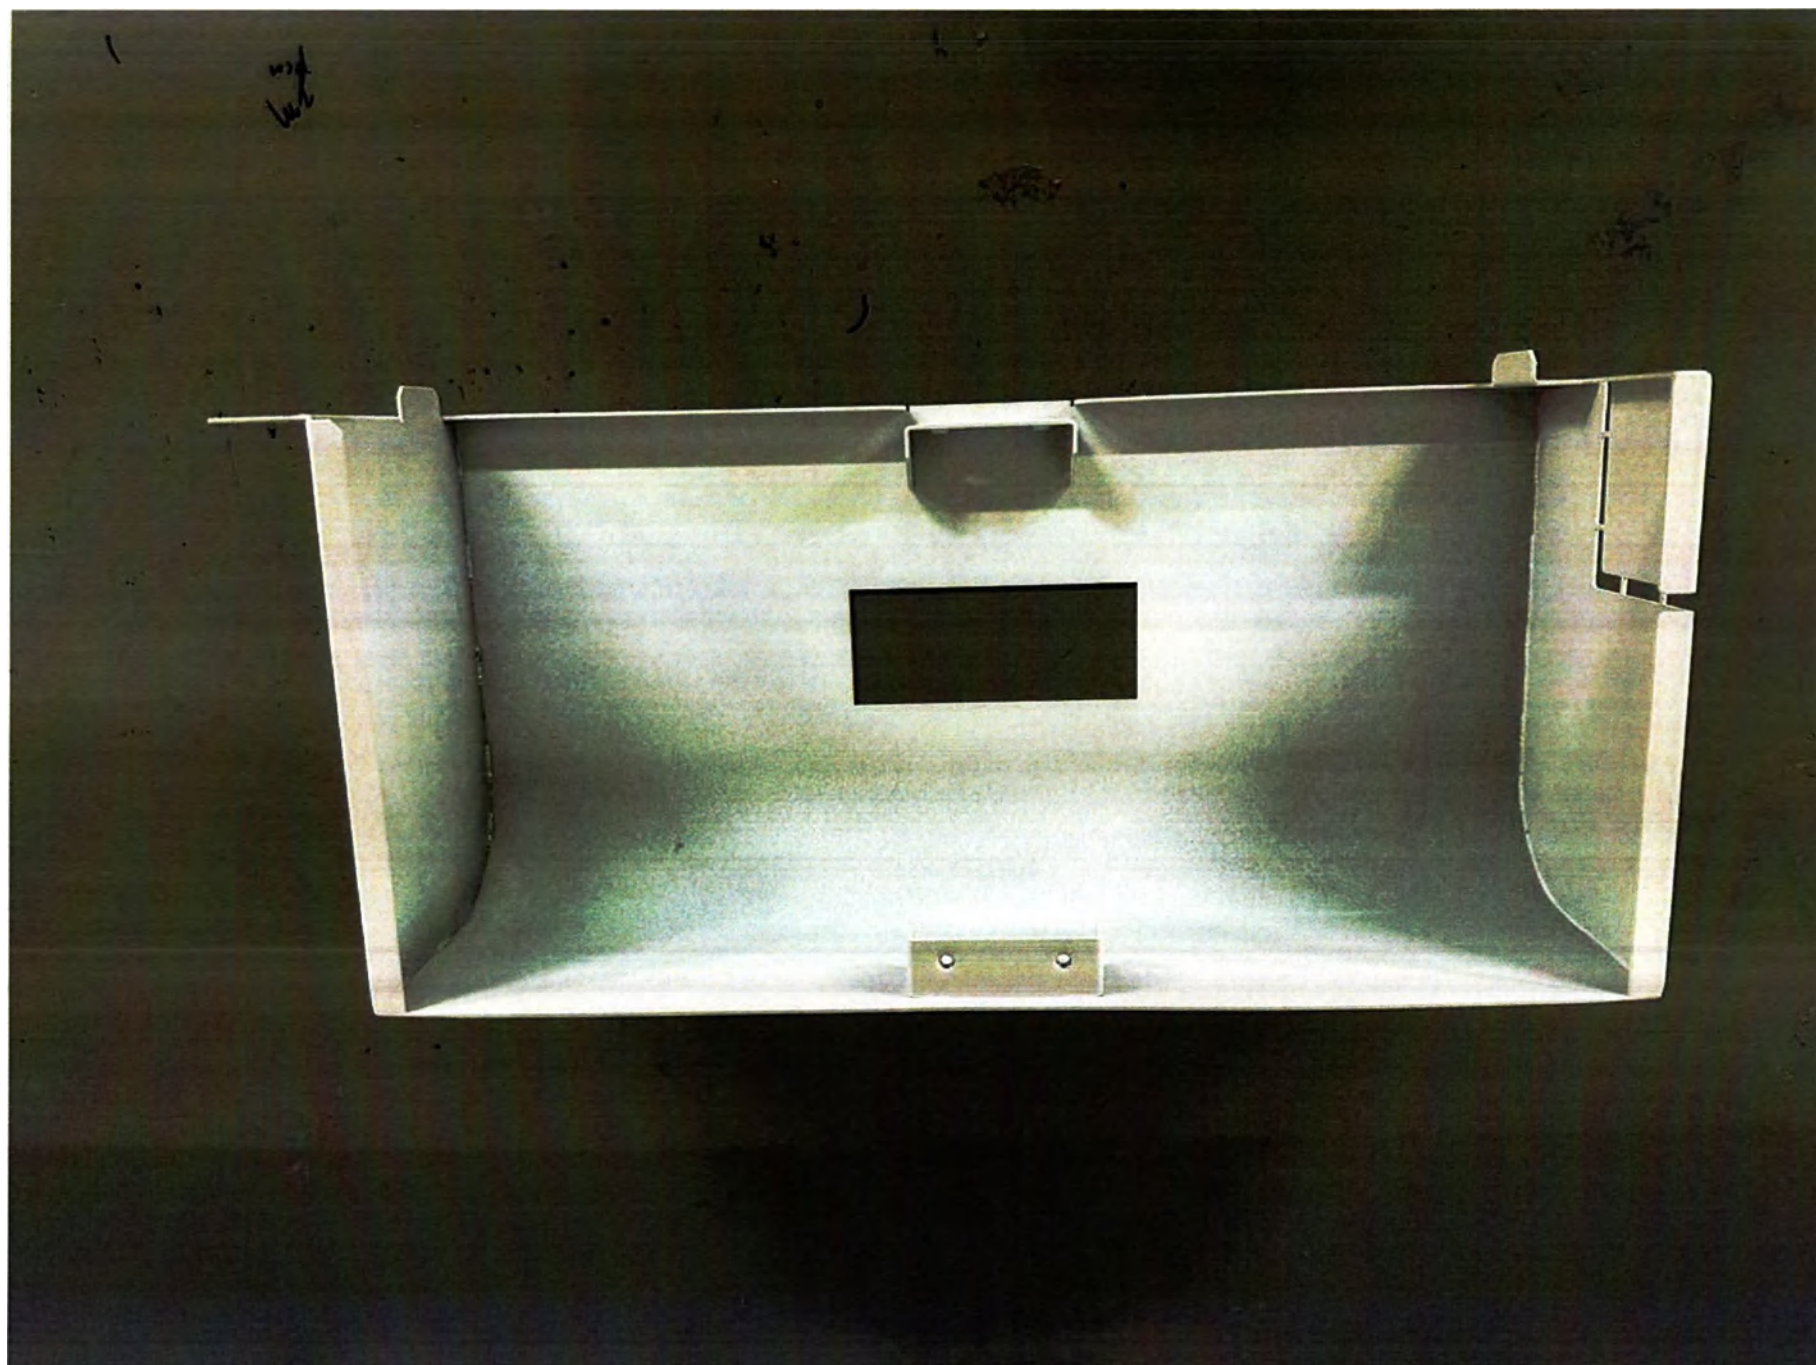


Рисунок 63. Кабельная коробка модуля основного блока для CX-9000 (линия обработки проб М2/М3)

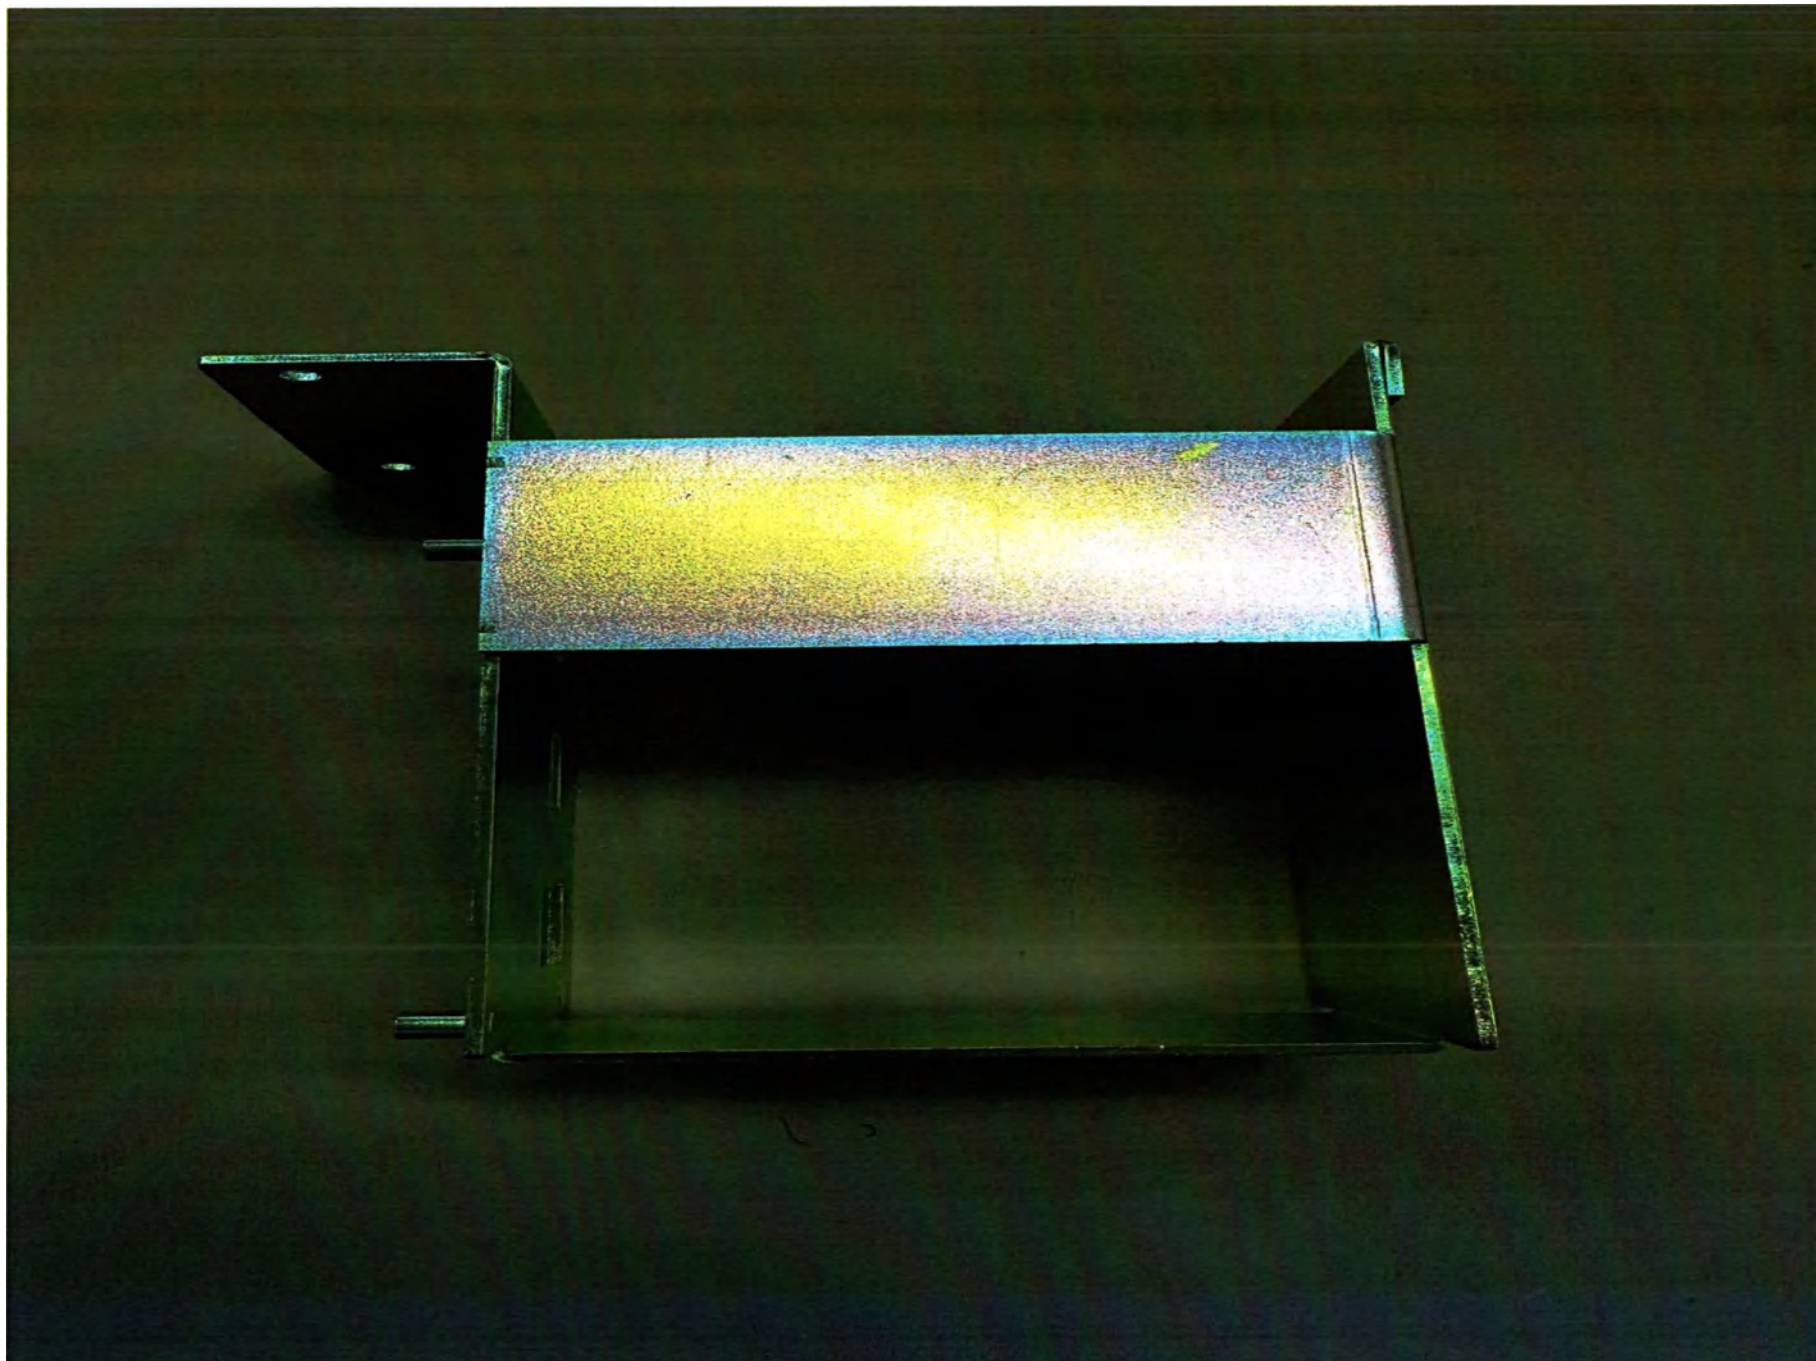


Рисунок 64. Кабельная коробка платы ввода/вывода в сборе для СХ-9000 (линия обработки проб М2/М3)

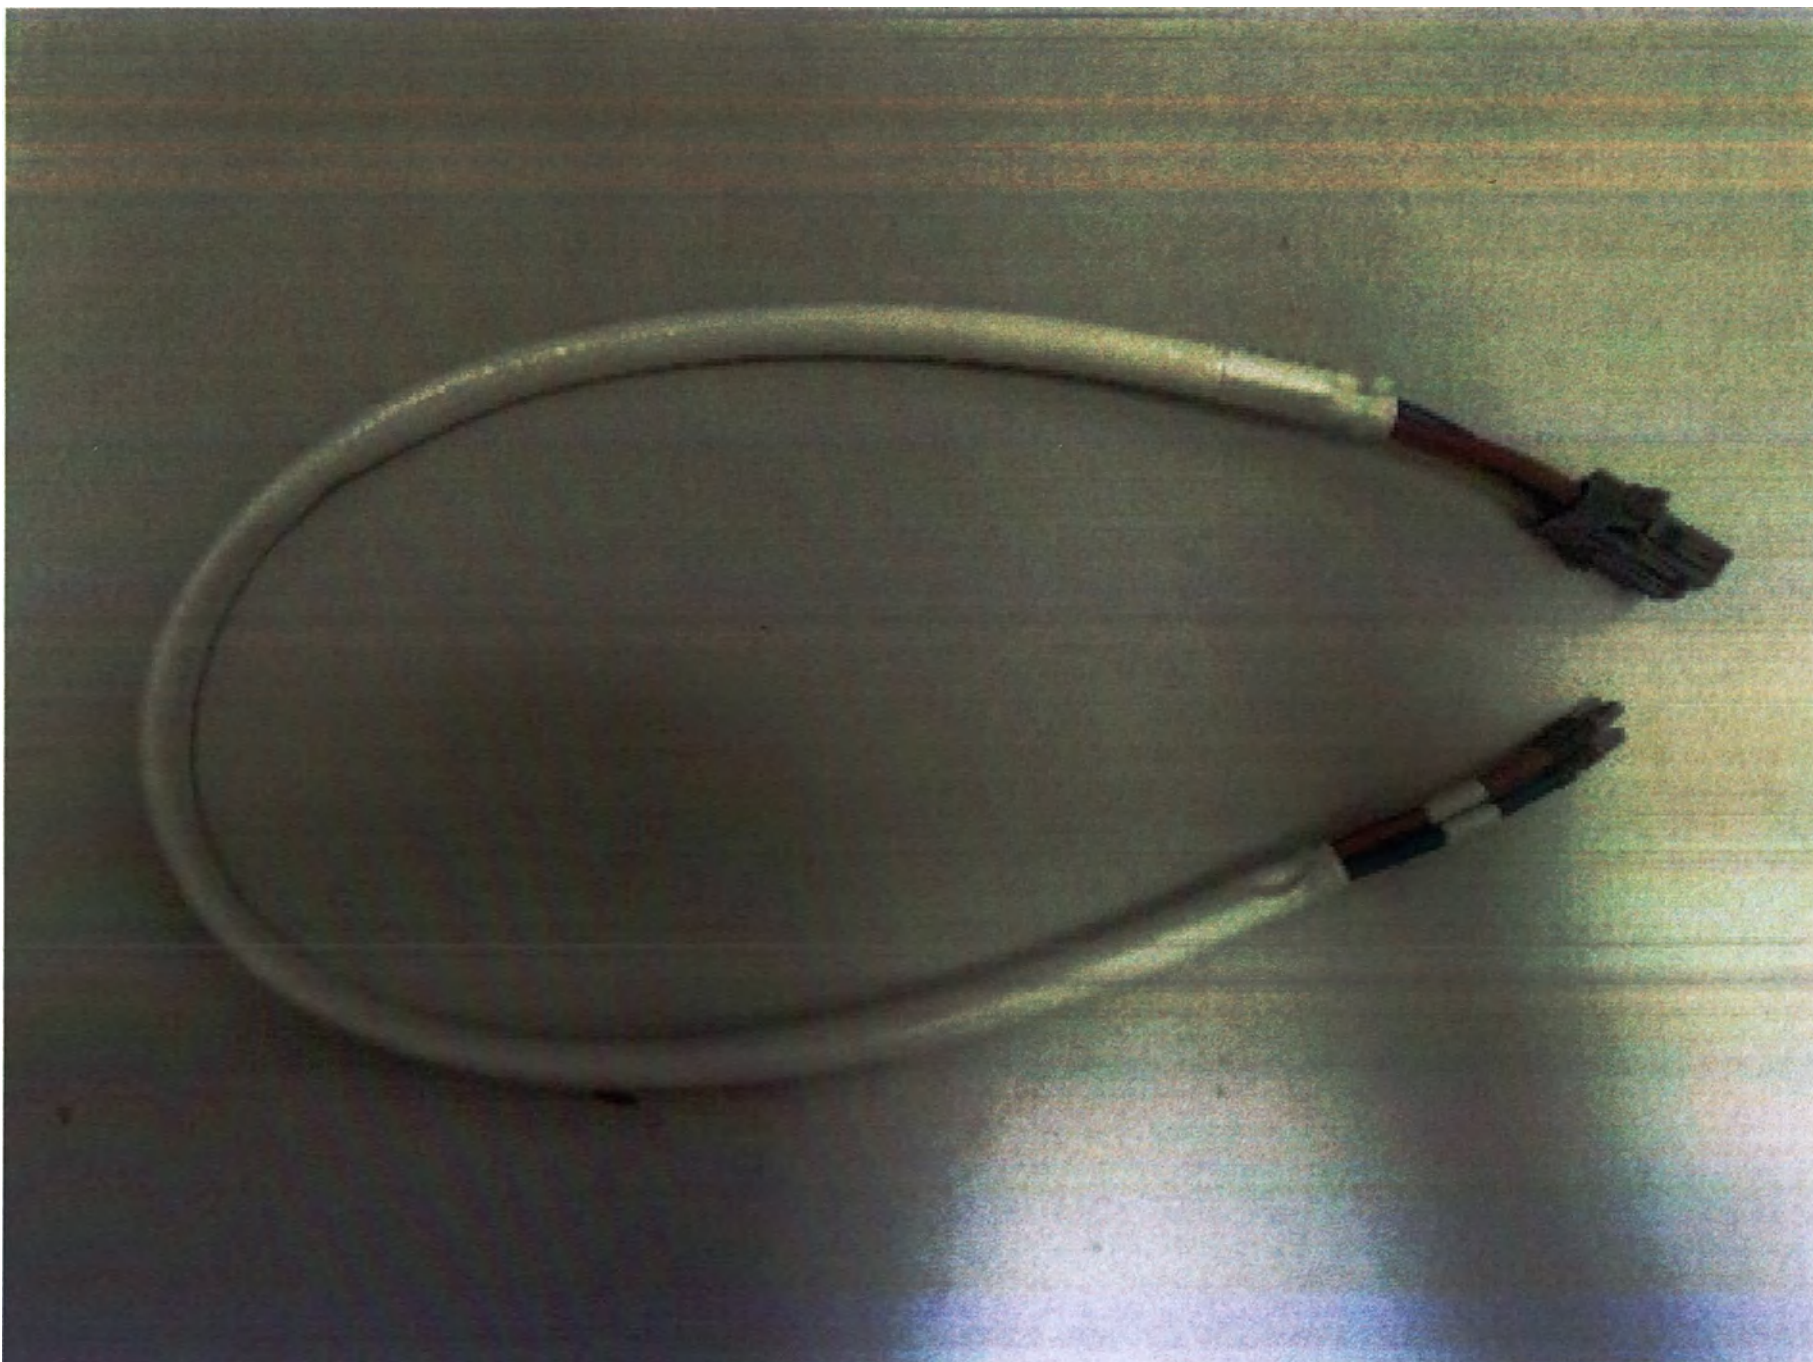


Рисунок 65. Коммутационный кабель для подключения анализаторов друг к другу для CX-9000 (линия обработки проб M2/M3)

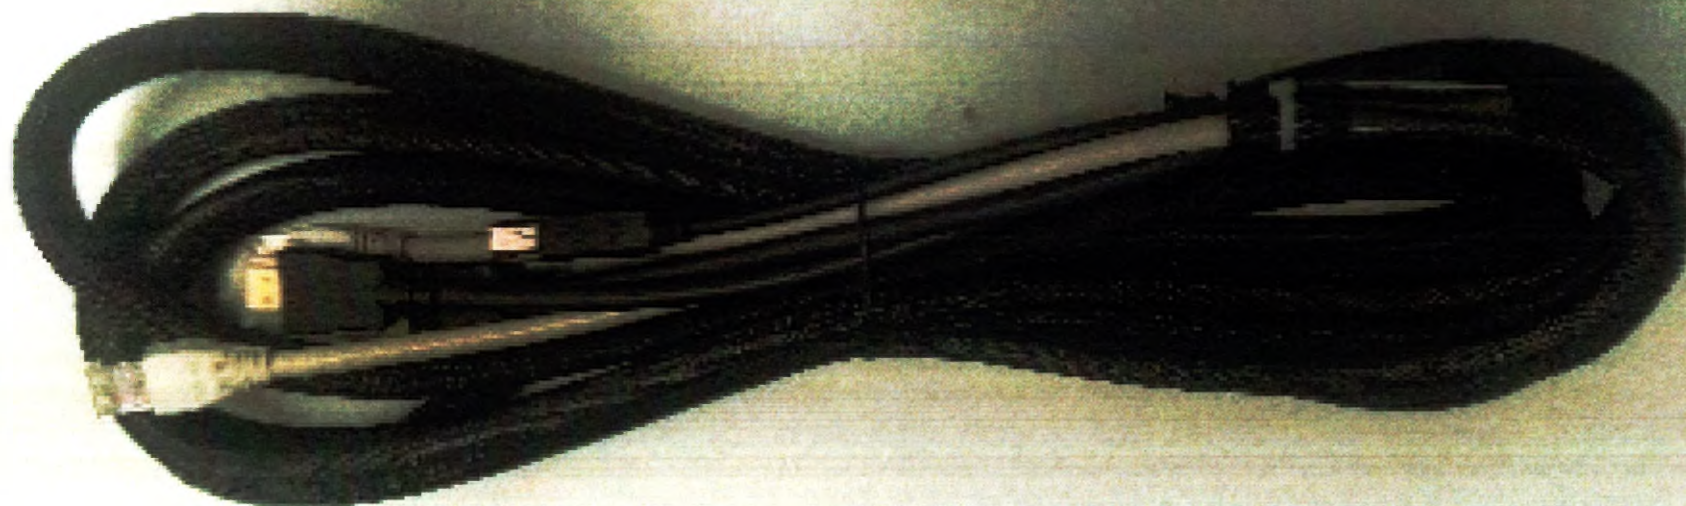


Рисунок 66. Коммутационный кабель задней рамы системы обработки образцов для CX-9000 (линия обработки проб M2/M3)

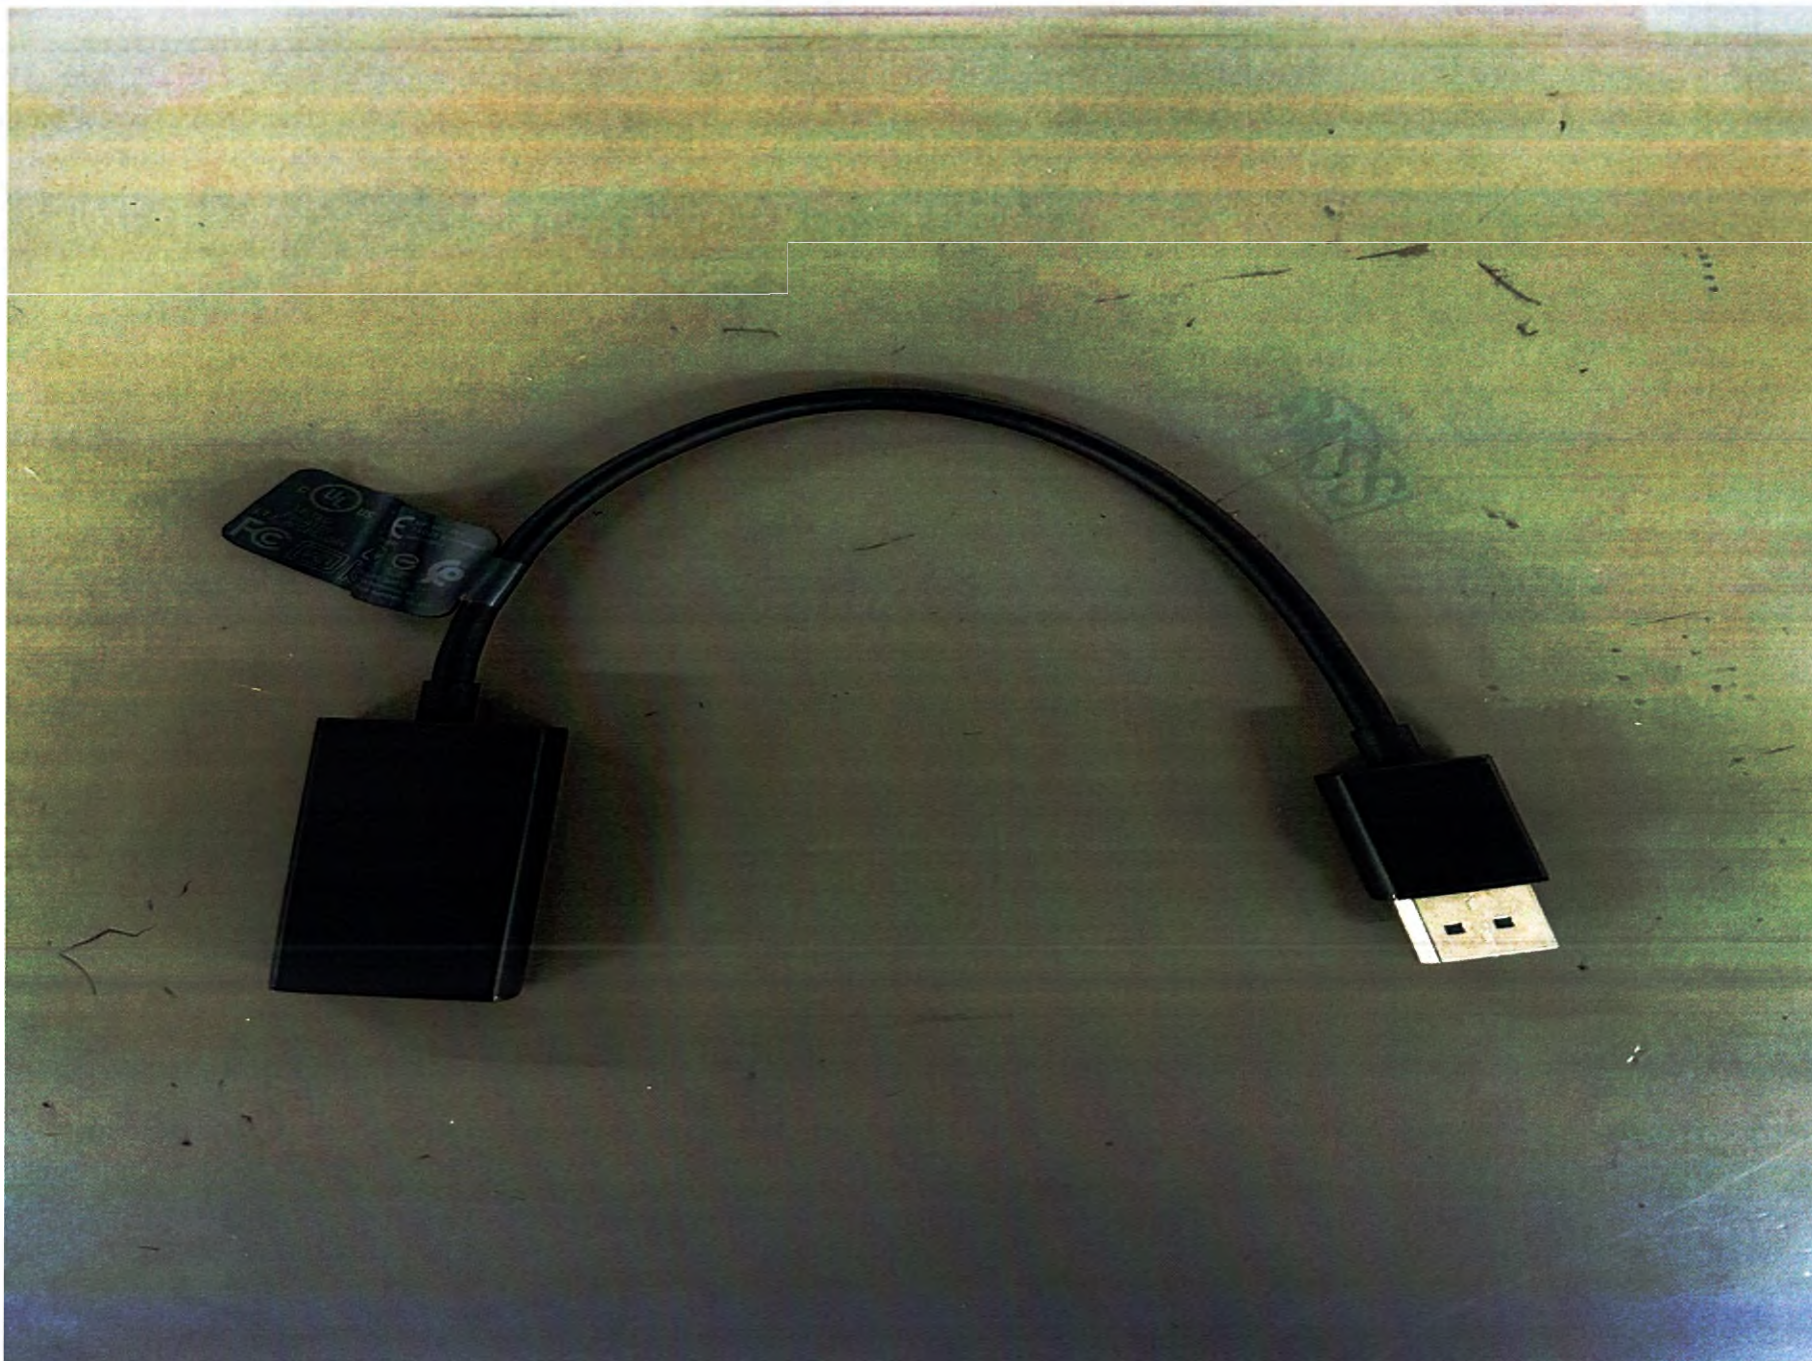


Рисунок 67. Коммутационный кабель с протокола DP на HDMI для CX-9000 (линия обработки проб М2/М3)



Рисунок 68. Силовой кабель квадратного сечения европейского стандарта для CX-9000 (линия обработки проб М2/М3)

产品名称: **全自动凝血分析仪**

mindray

型号、规格: CX-9010

SN



GC6-35000118



2023-05-06

电源: 220V ~ 50Hz 1200VA

使用期限: 7年

医疗器械注册证编号: 粤械注准20222220202

"其他内容详见说明书"

注册人/生产企业名称:

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

住所: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层

邮编: 518057

产地: 中国



047-036476-00(3.0)

UDI



(01)06903053019941

(11)230506

(21)GC6-35000118



IVD

Рисунок 69. Наклейка с маркировкой для CX-9000/CX-9010




100-240V~ 50/60Hz 10A

047-043061-00
(1.0/0.1)



220V~ 50Hz 1500VA



废液传感器

排气口

废液口

废液口

Рисунок 70. Наклейка с указанием типа питания для CX-9000/CX-9010

ПРОШЕТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ



ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СЫСоева Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ