

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 4

Согласовано

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ –
Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)

Организация

Россия, 115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 7, стр. 4

Адрес

Генеральный директор

Должность

Колас Мартин Пьер

Фамилия, Имя

05.04.2024

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature



Фотографические изображения

**Тубус гинекологический для создания эндоскопического доступа
в вариантах исполнения, с принадлежностями**

2024

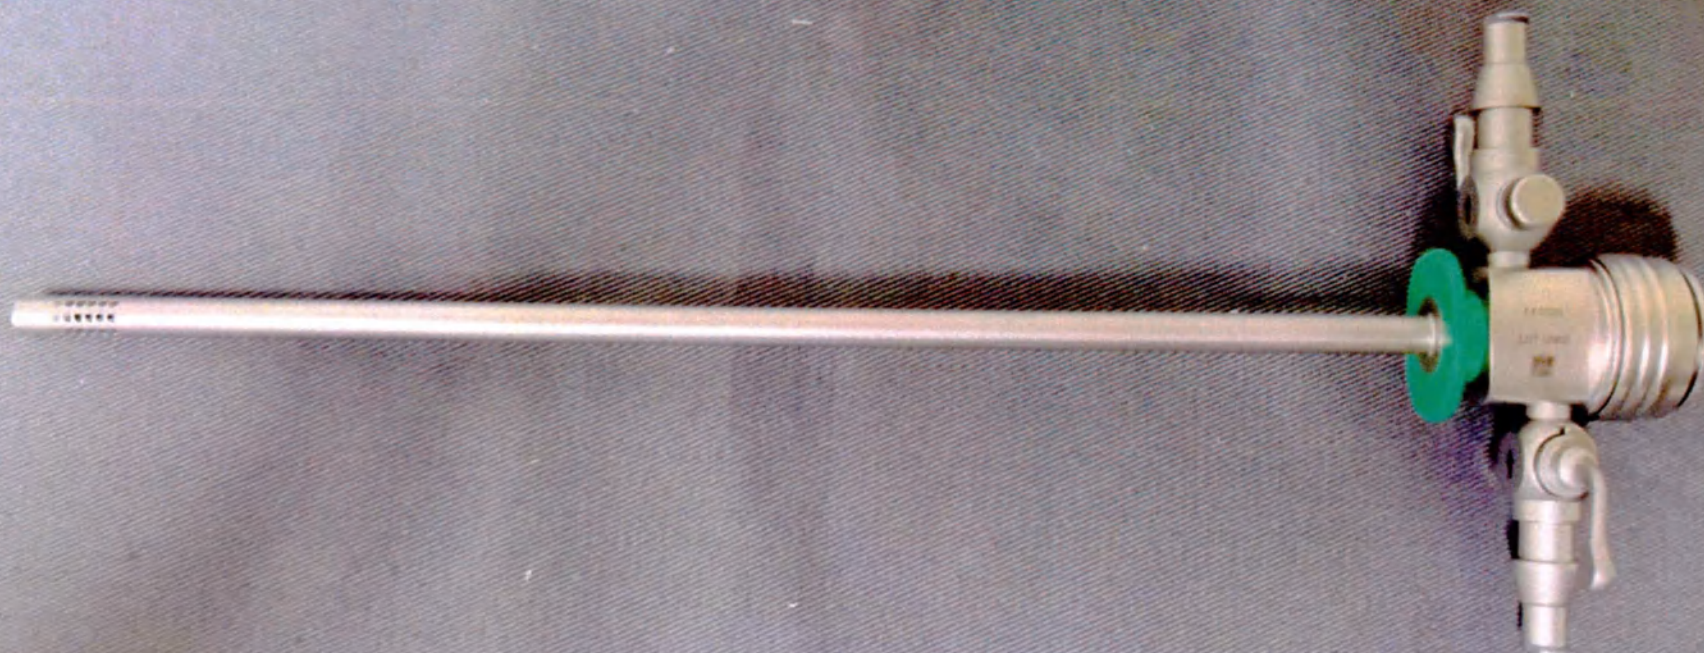


Рис. 1. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 15 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания. Имеет схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания, Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания

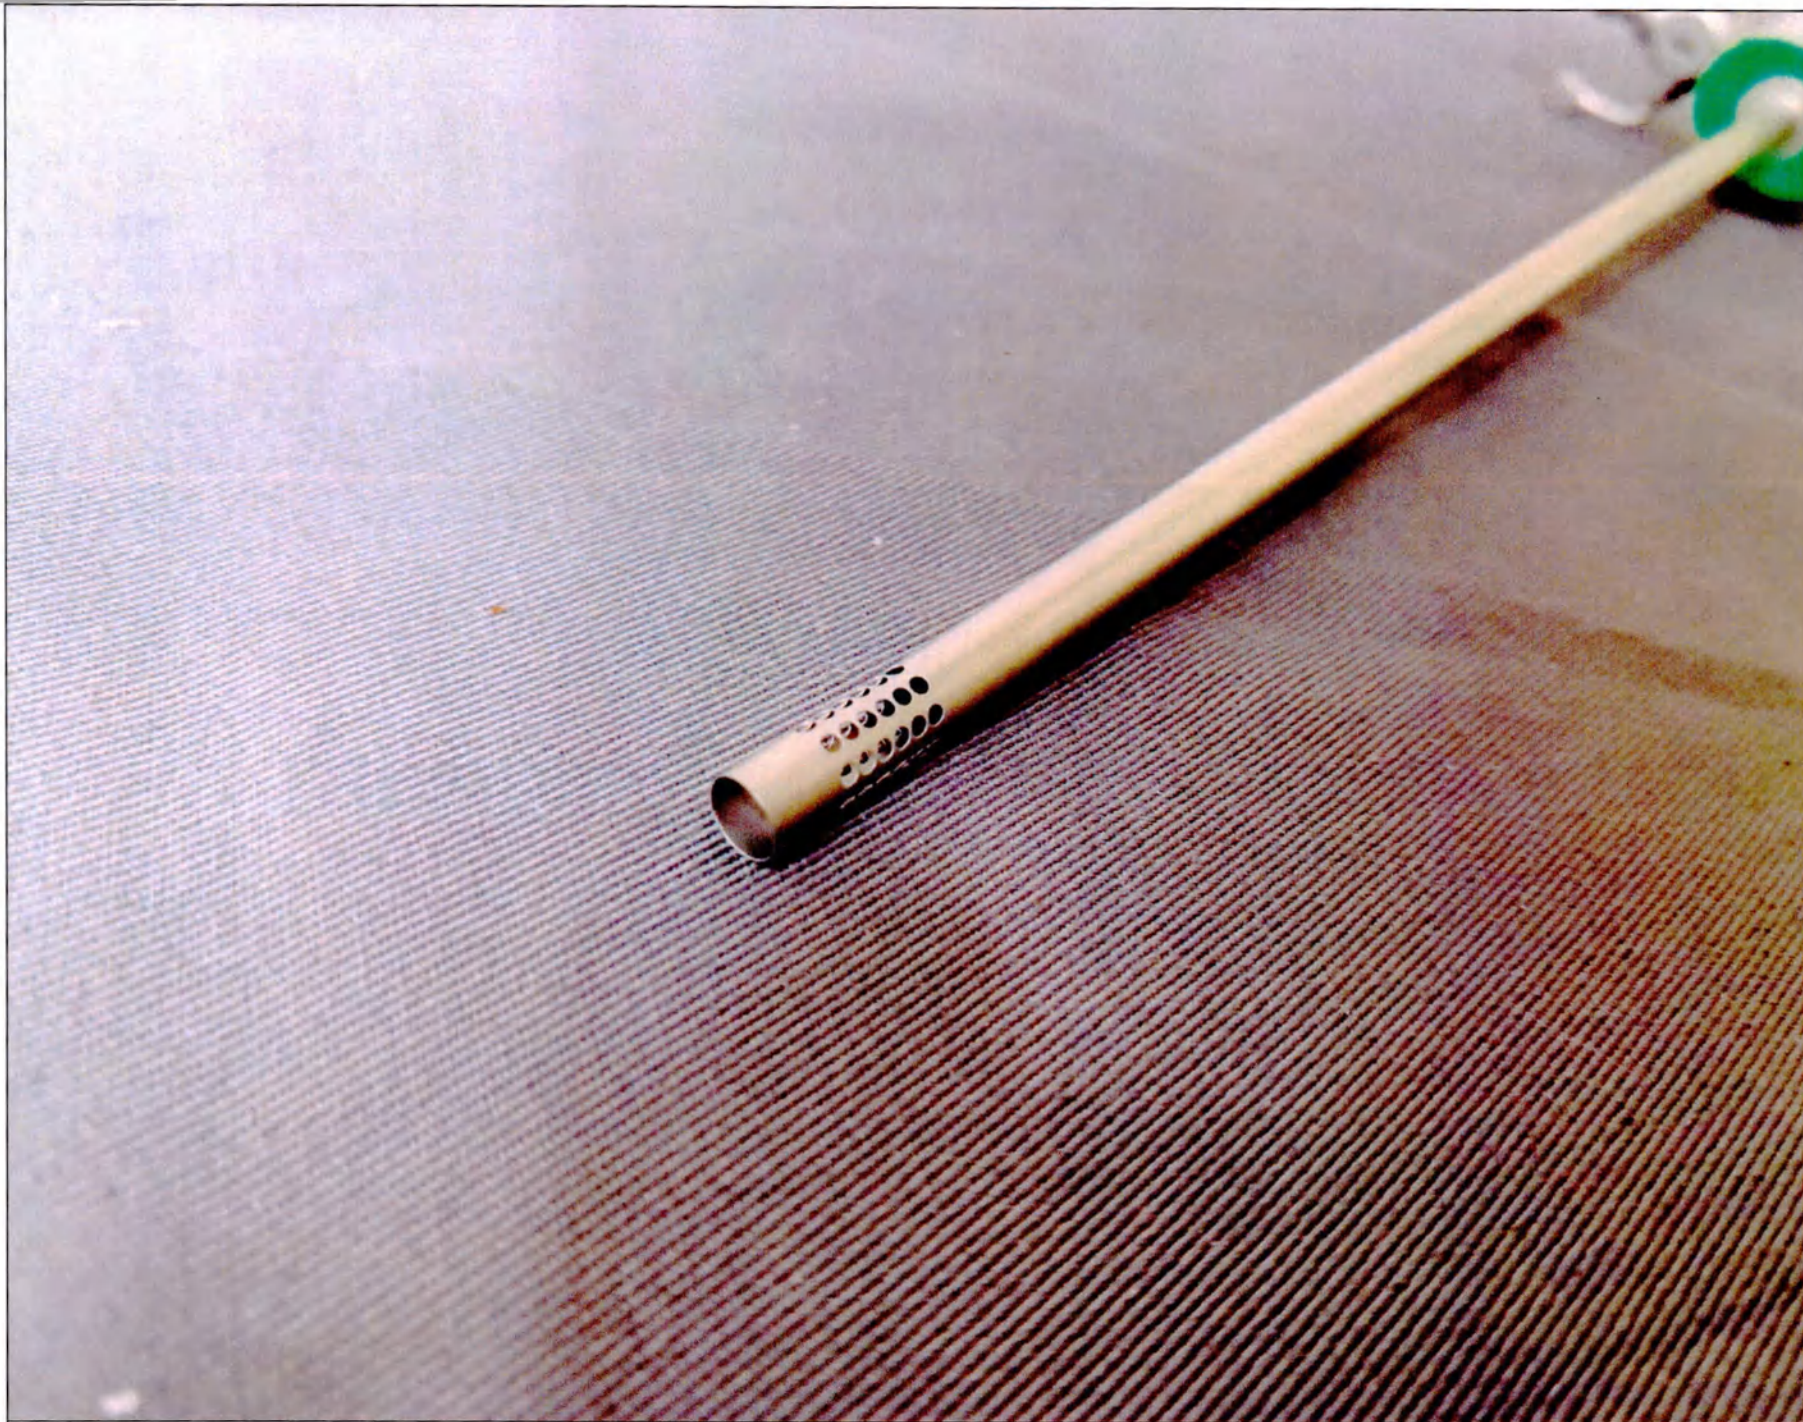


Рис. 2. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 15 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания. Имеет схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания, Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания



Рис. 3. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 15 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания. Имеет схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания, Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания

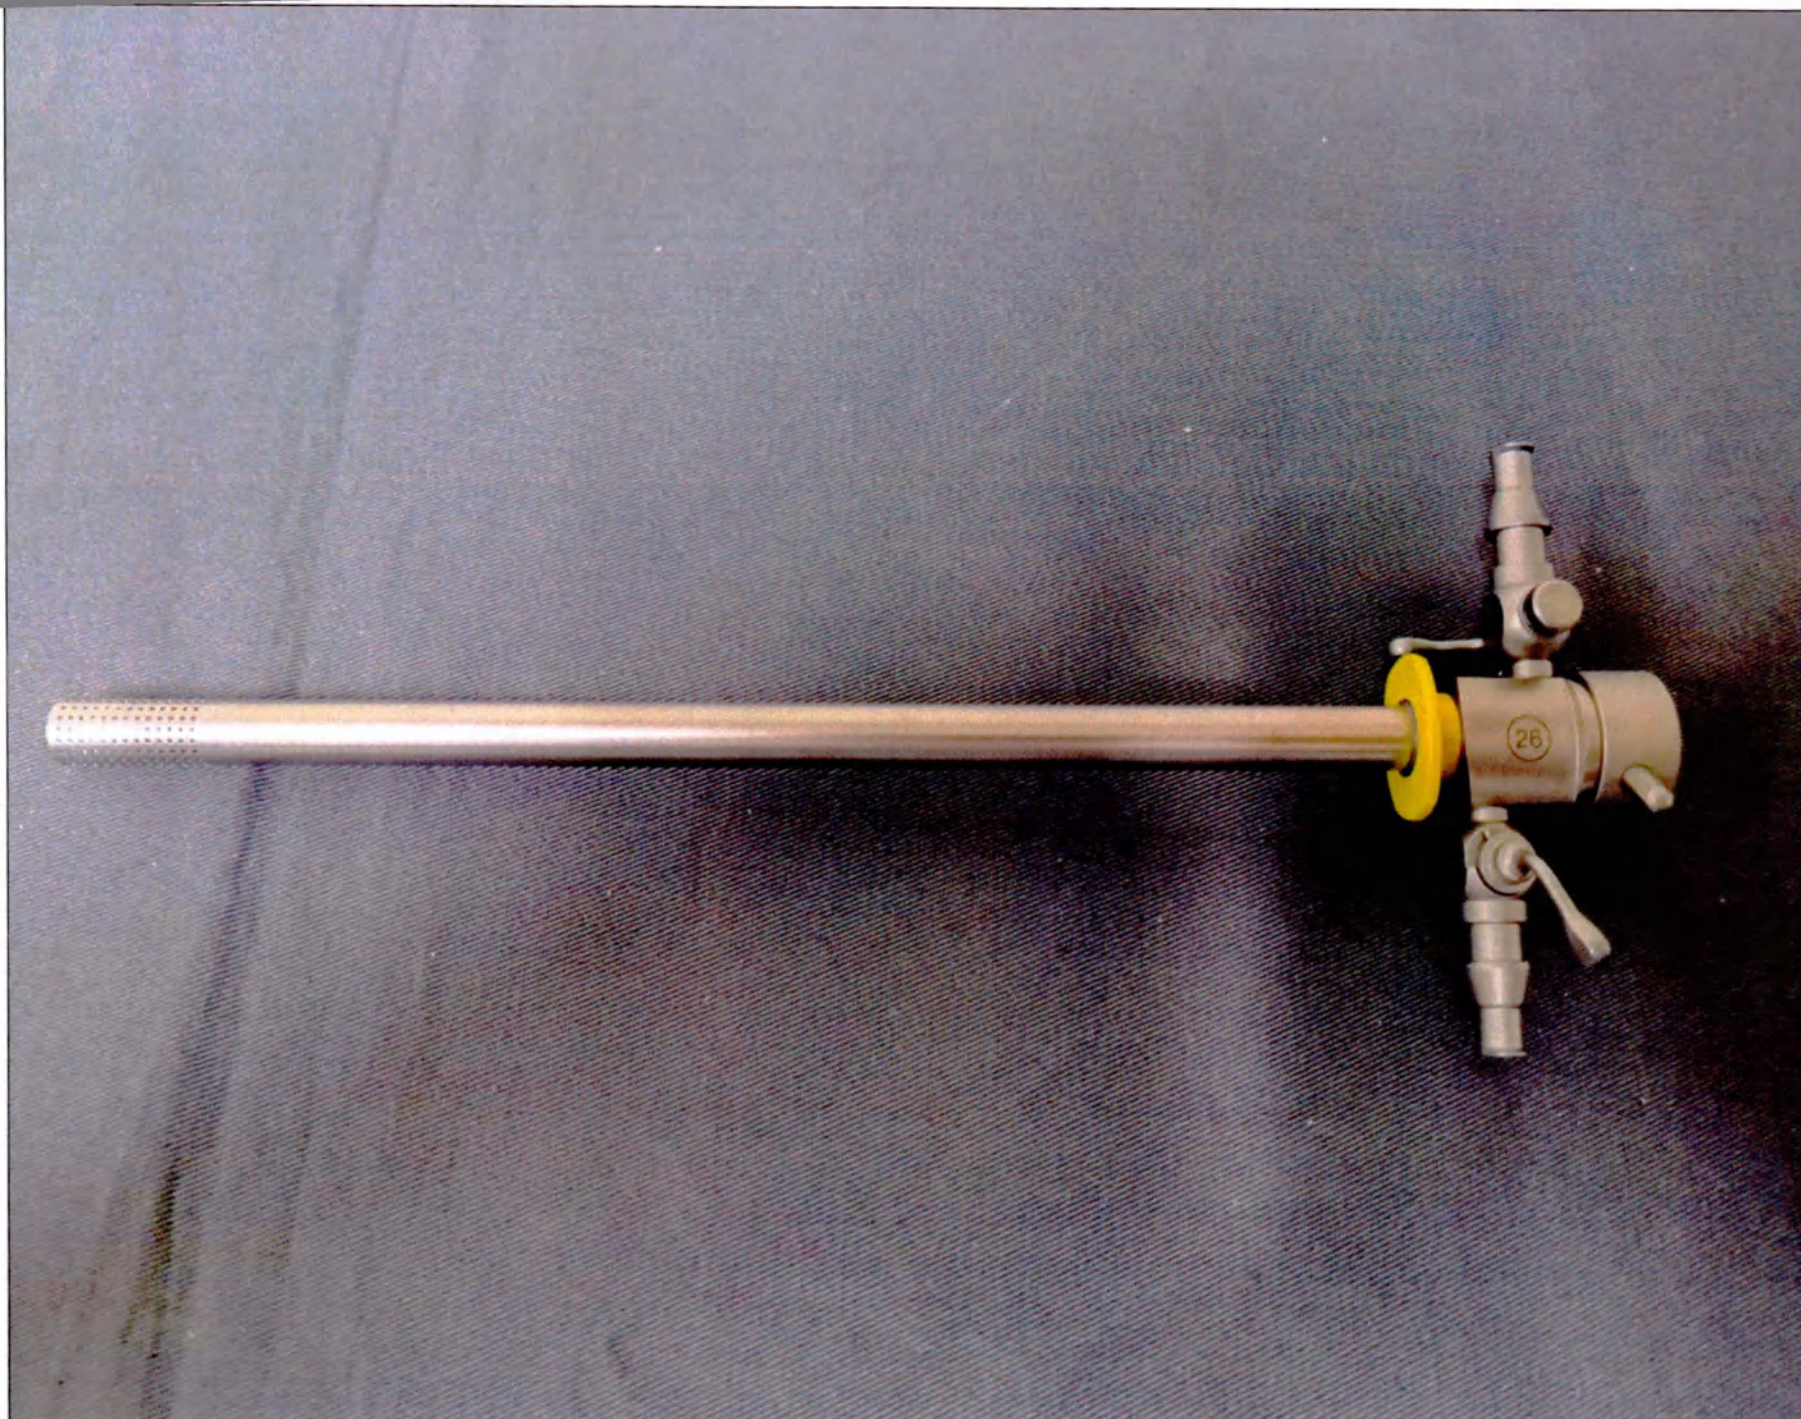


Рис. 4. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с двумя кранами

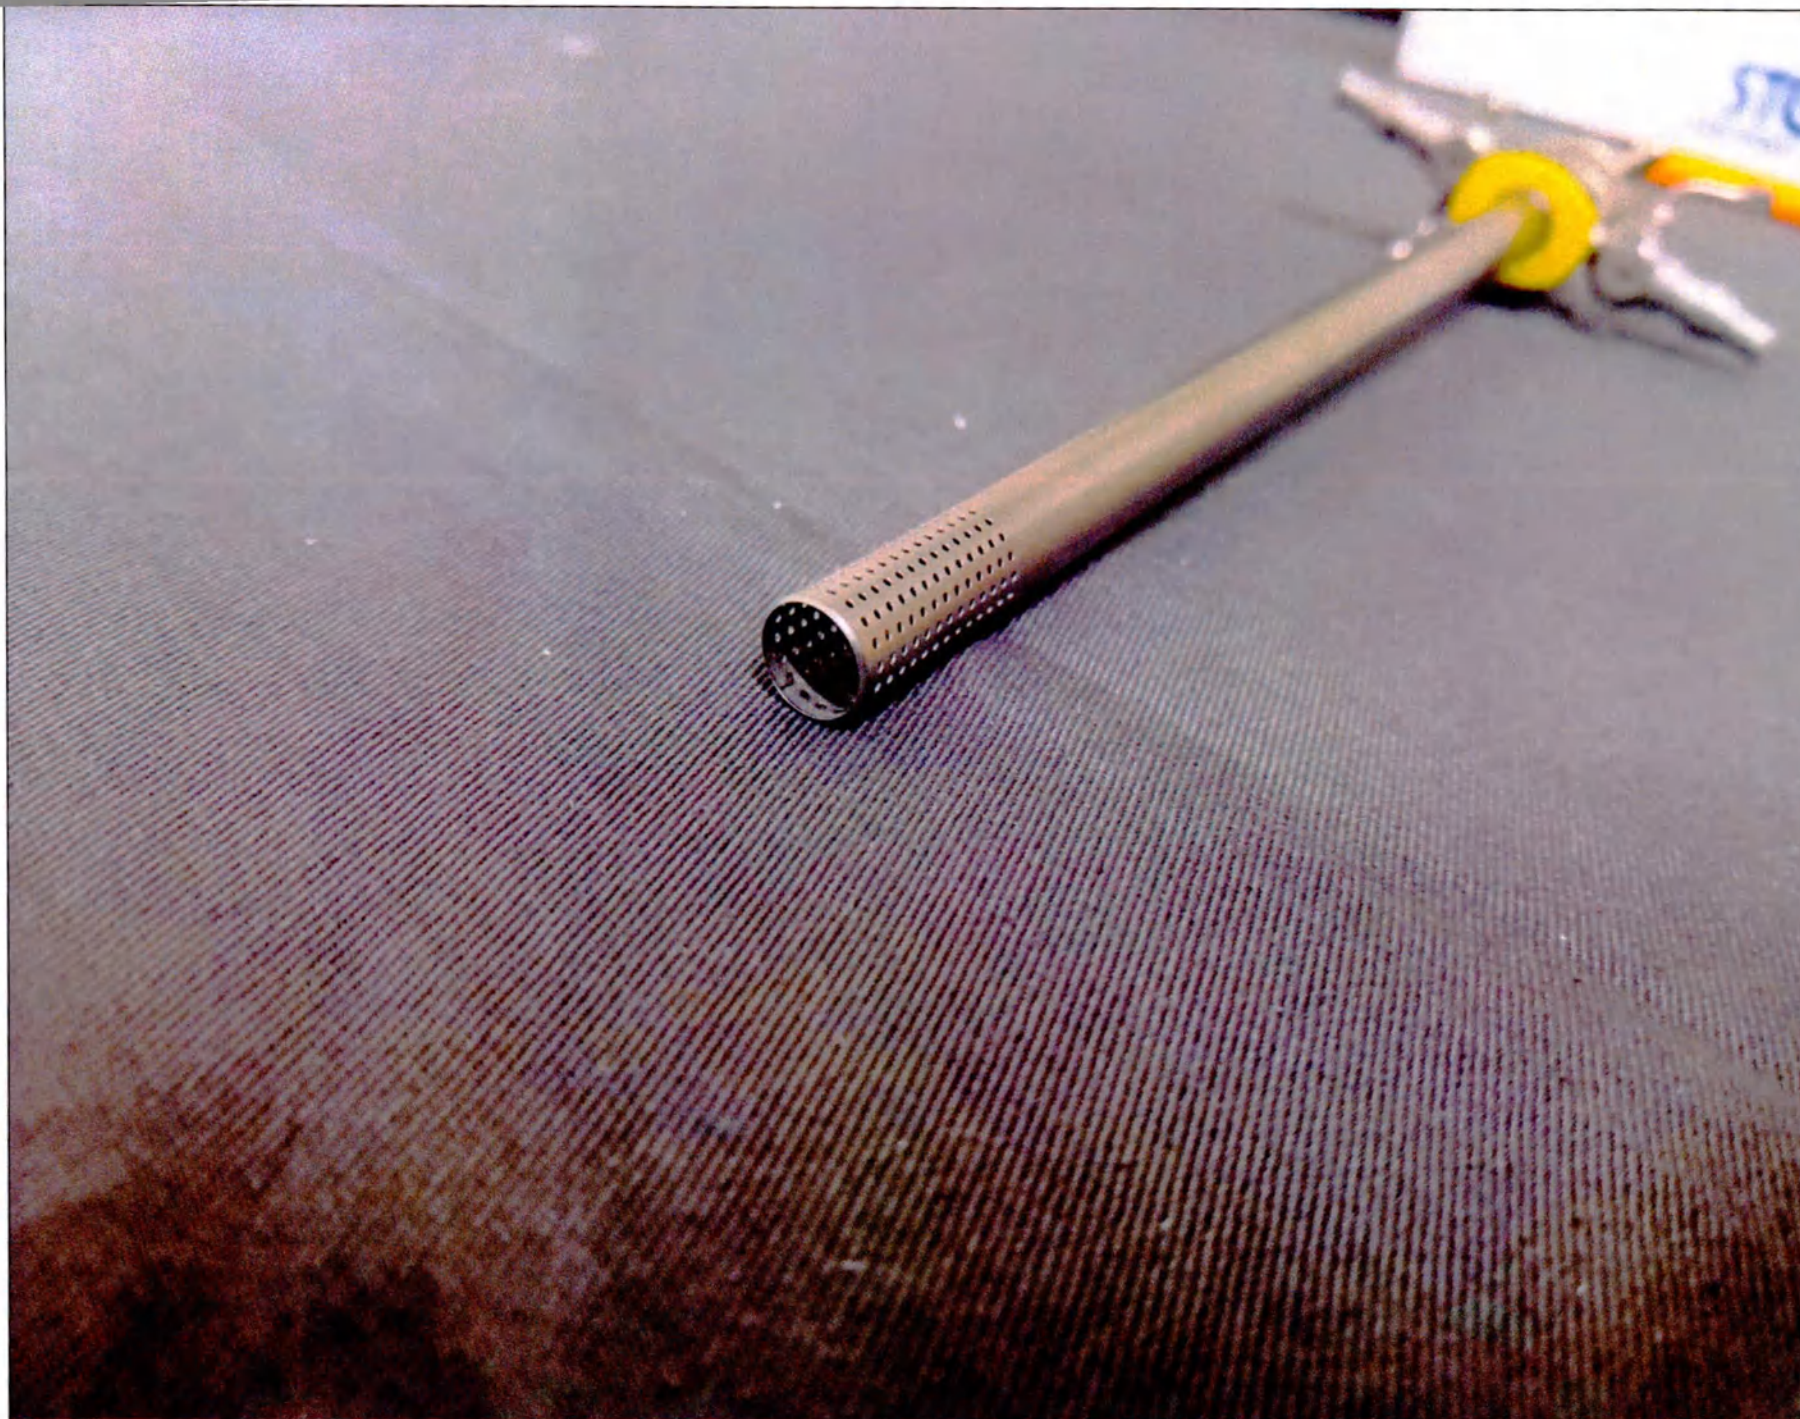


Рис. 5. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с двумя кранами

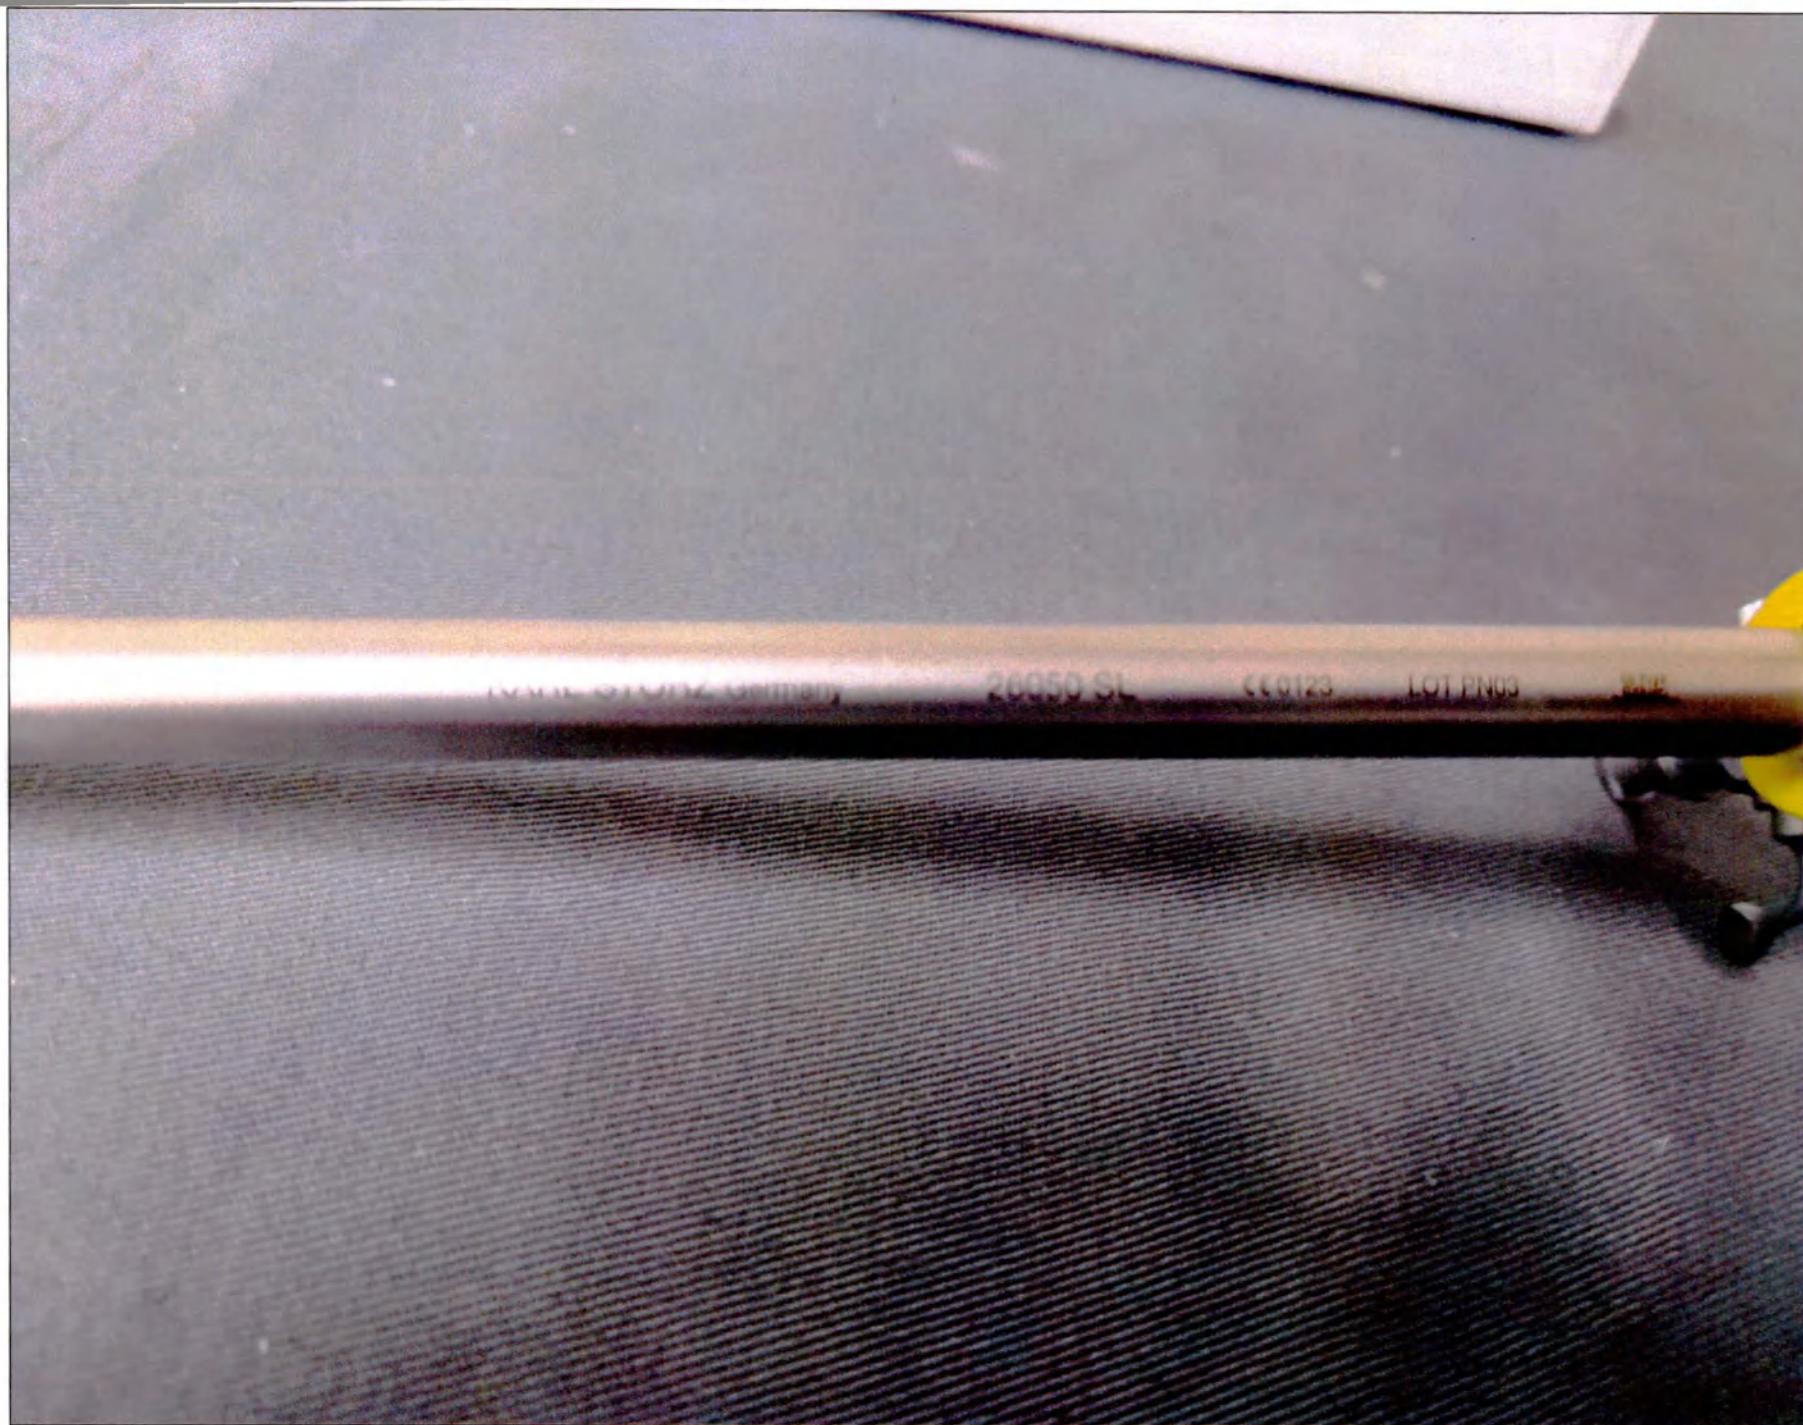


Рис. 6. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с двумя кранами

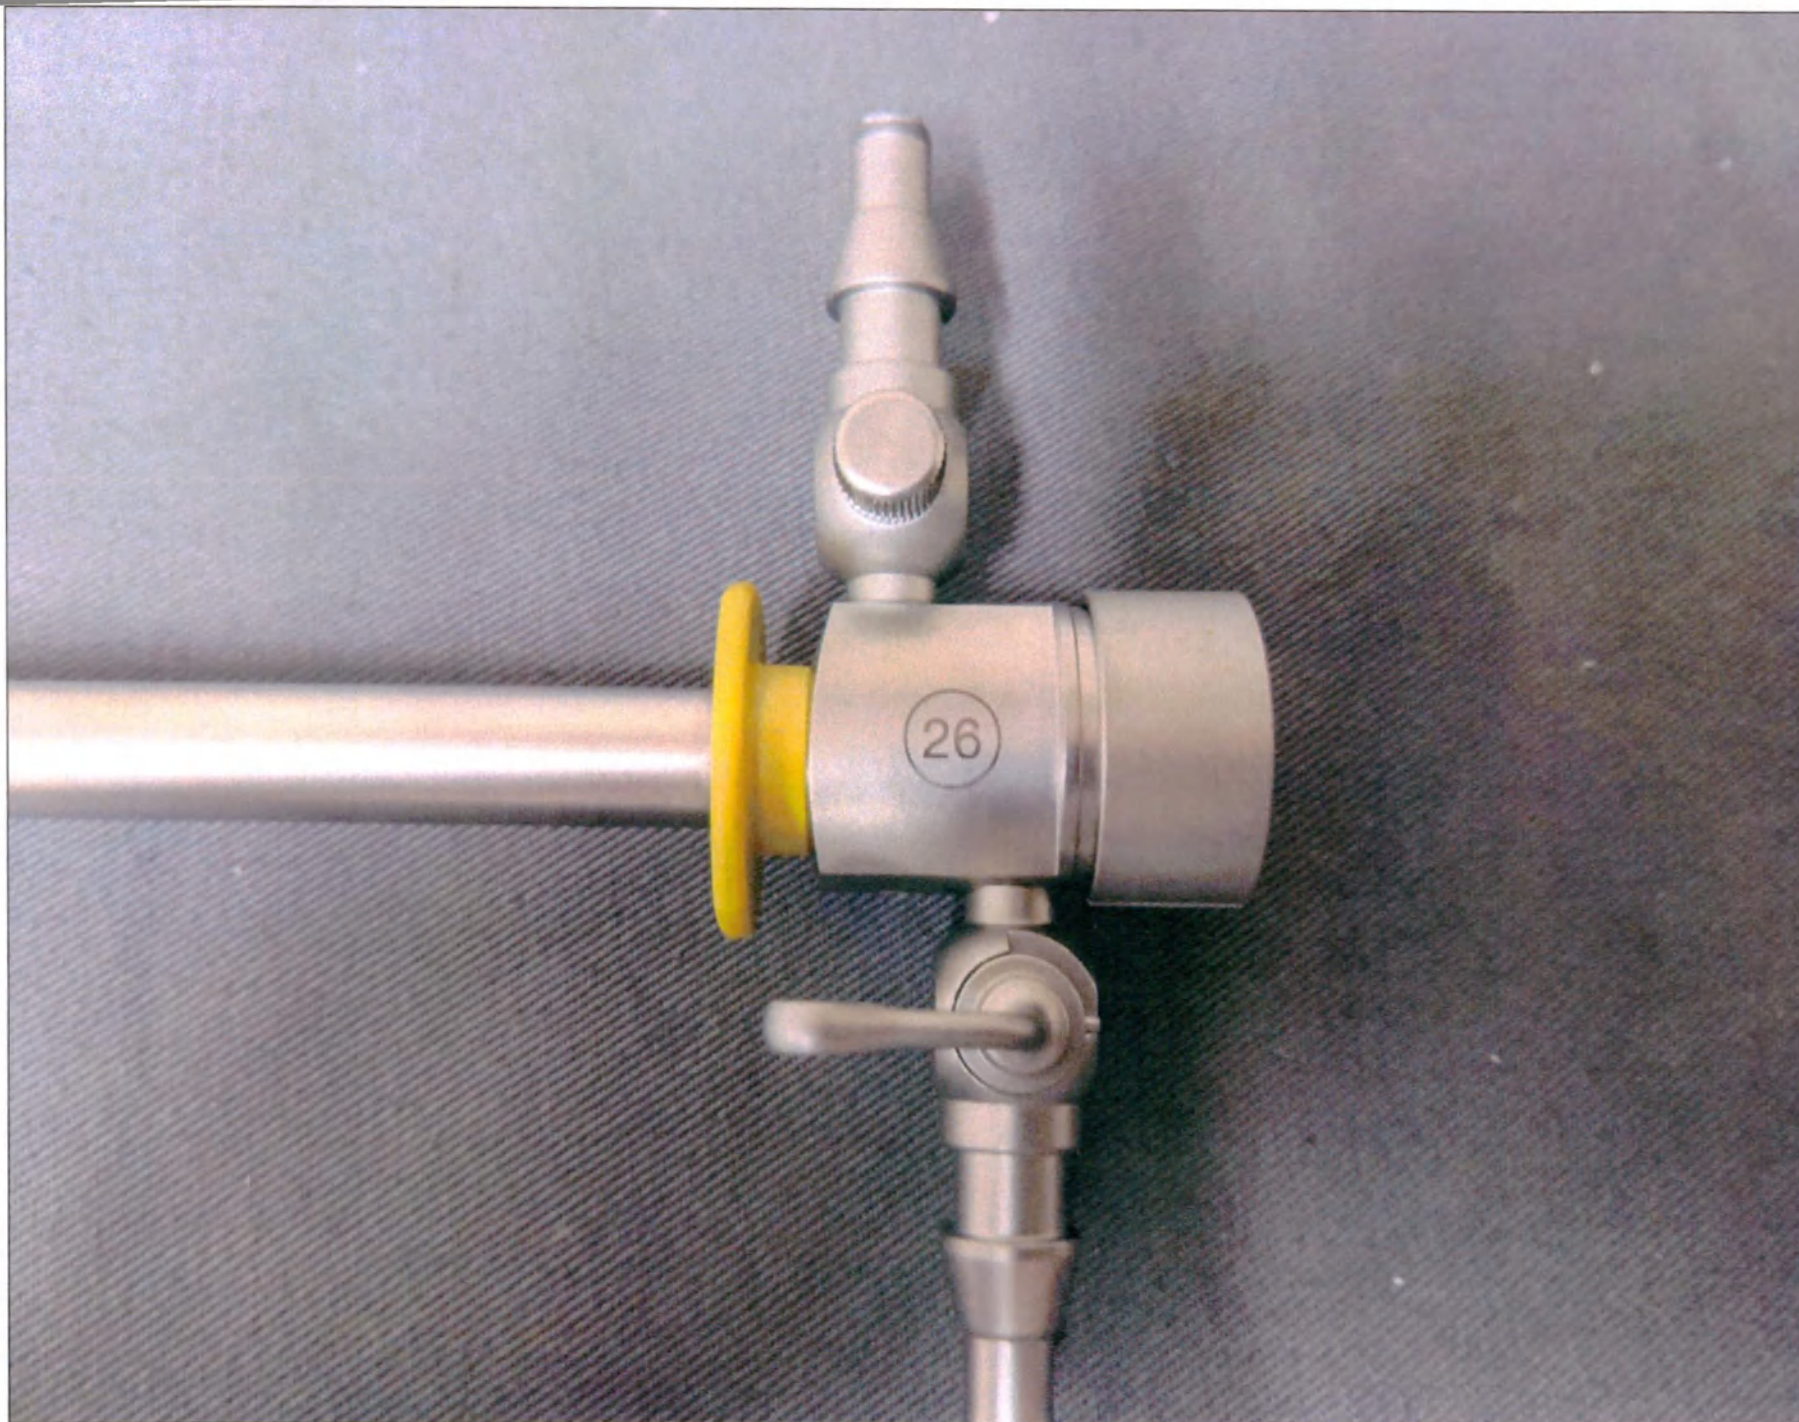


Рис. 7. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с двумя кранами. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с двумя кранами

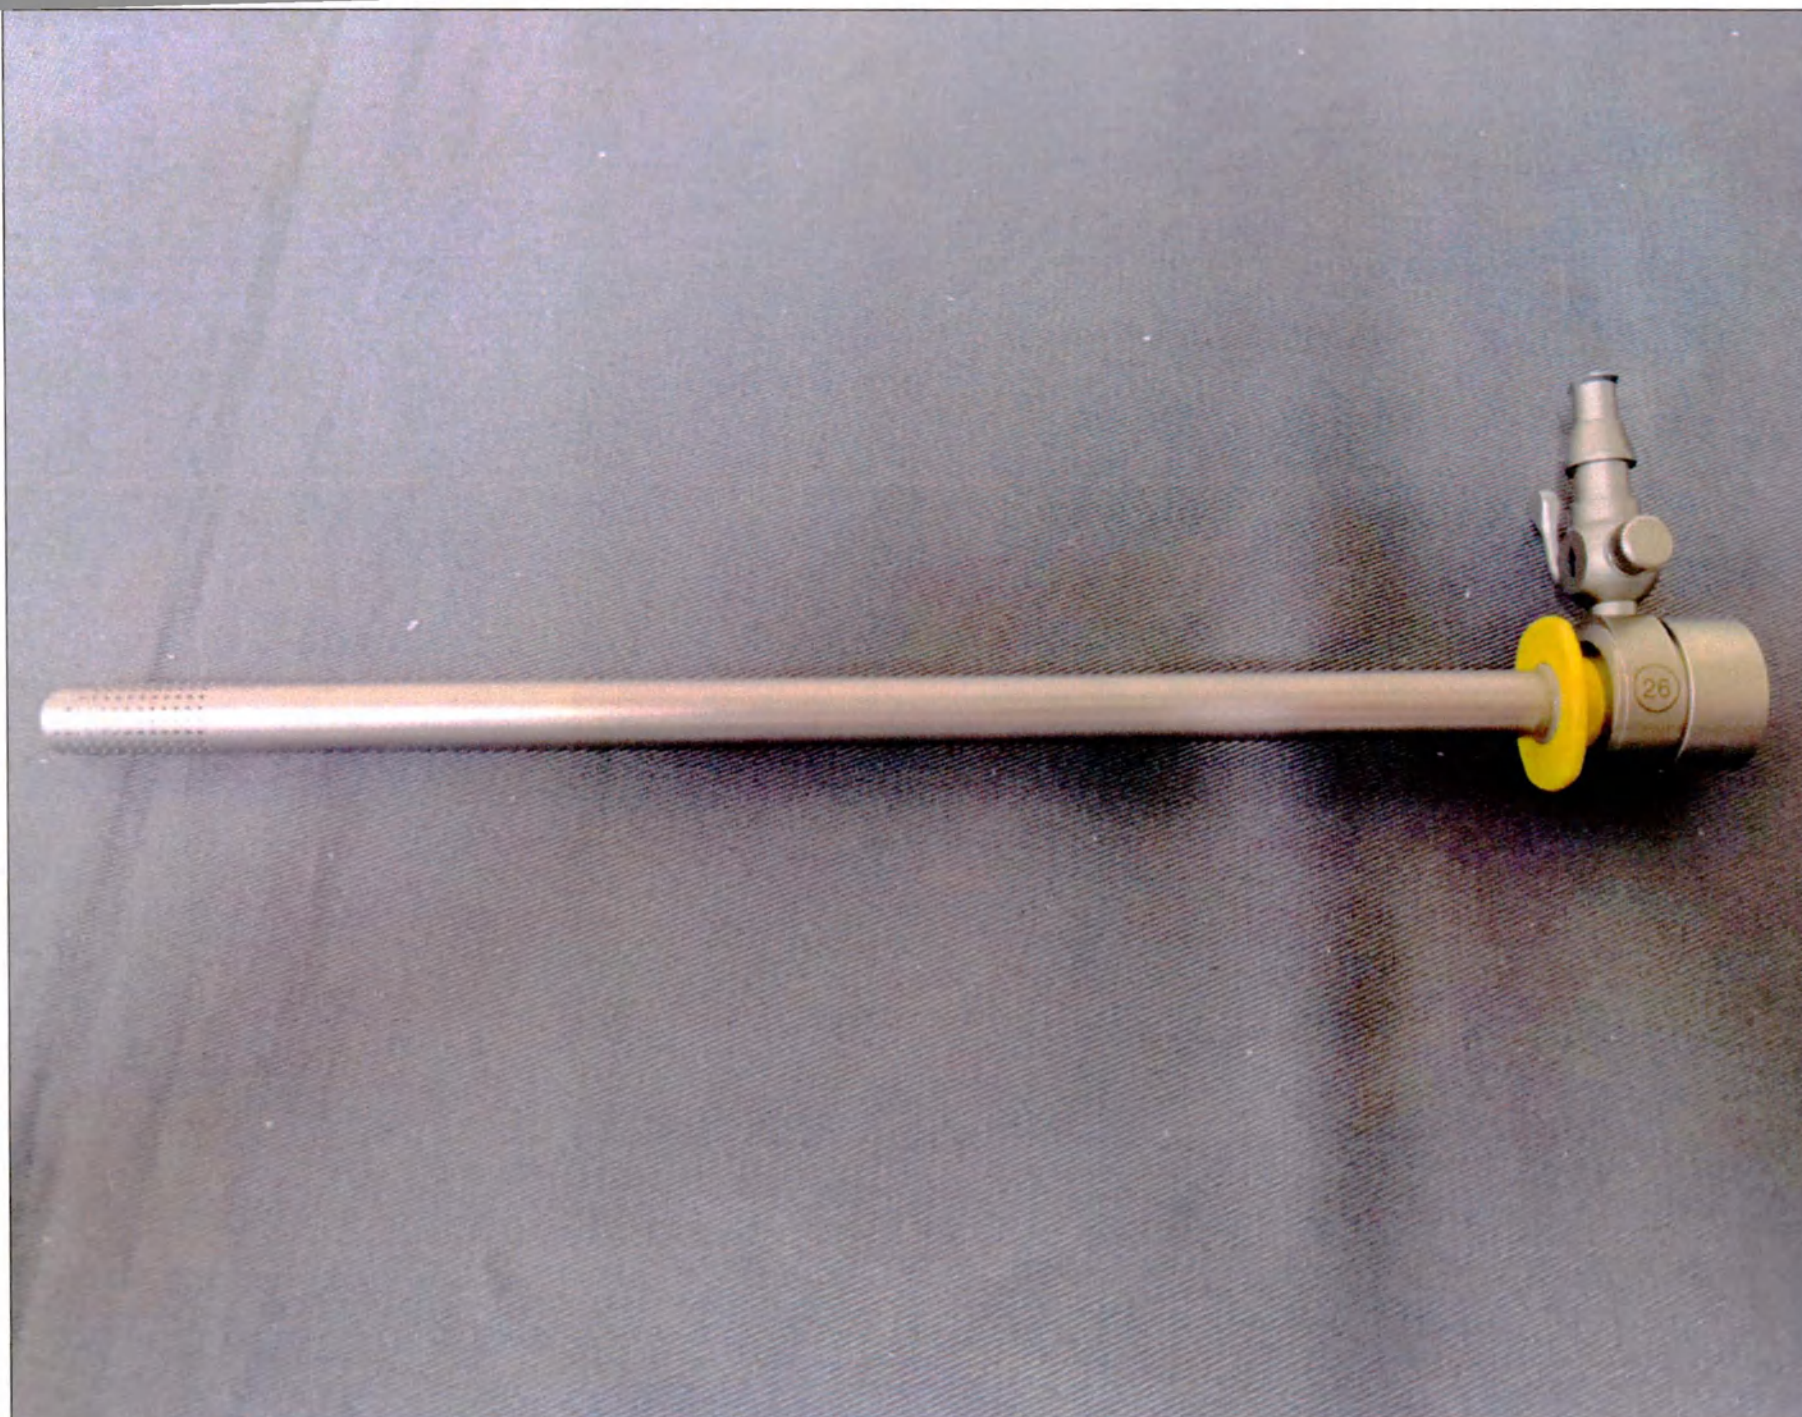


Рис. 8. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с одним краном, для использования с неповоротным внутренним тубусом. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с одним краном, для использования с неповоротным внутренним тубусом

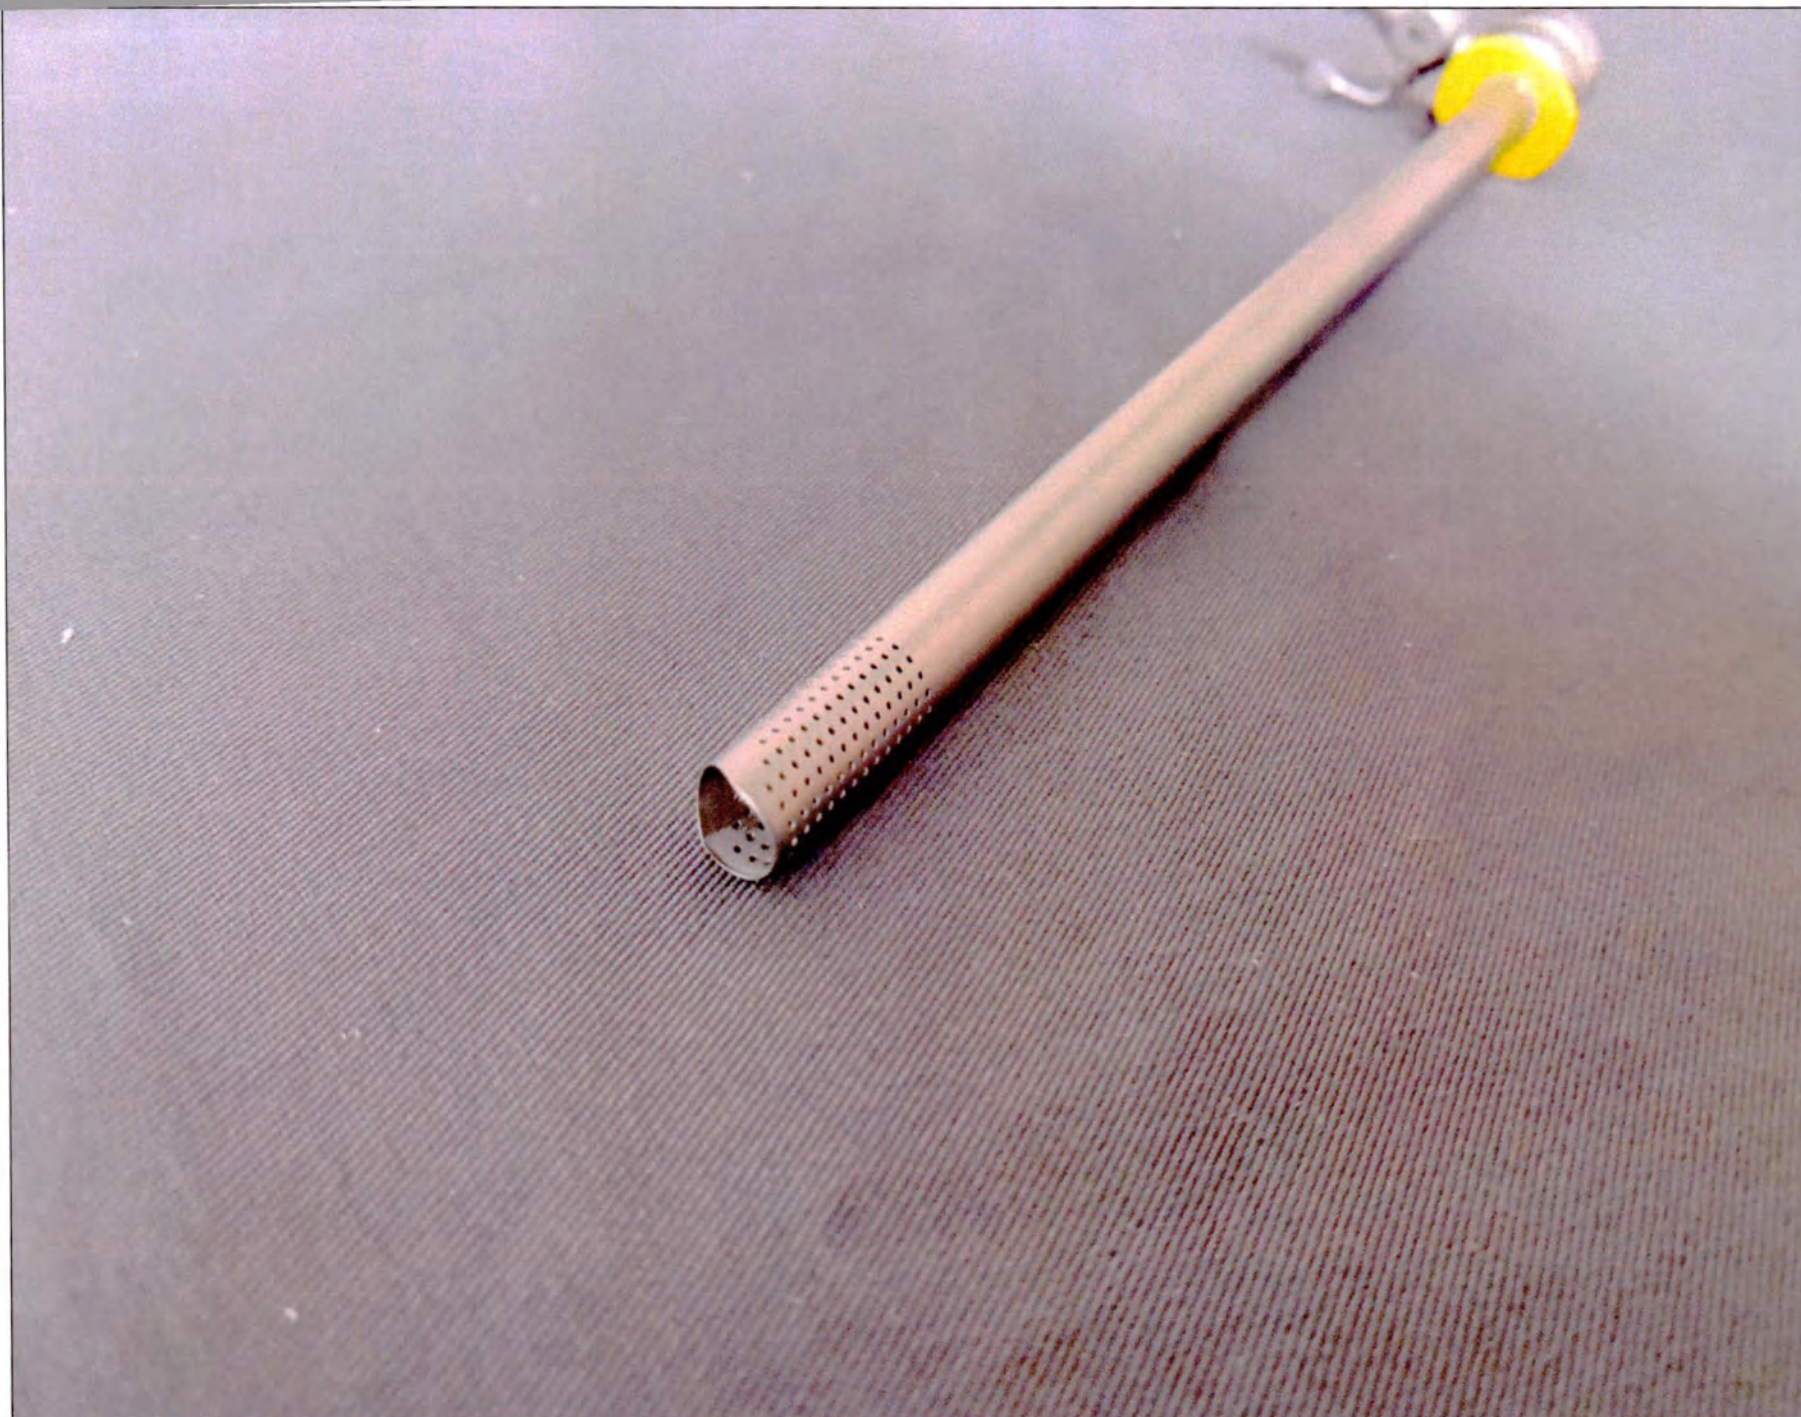


Рис. 9. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с одним краном, для использования с неповоротным внутренним тубусом. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с одним краном, для использования с неповоротным внутренним тубусом



Рис. 10. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с одним краном, для использования с неповоротным внутренним тубусом. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с одним краном, для использования с неповоротным внутренним тубусом

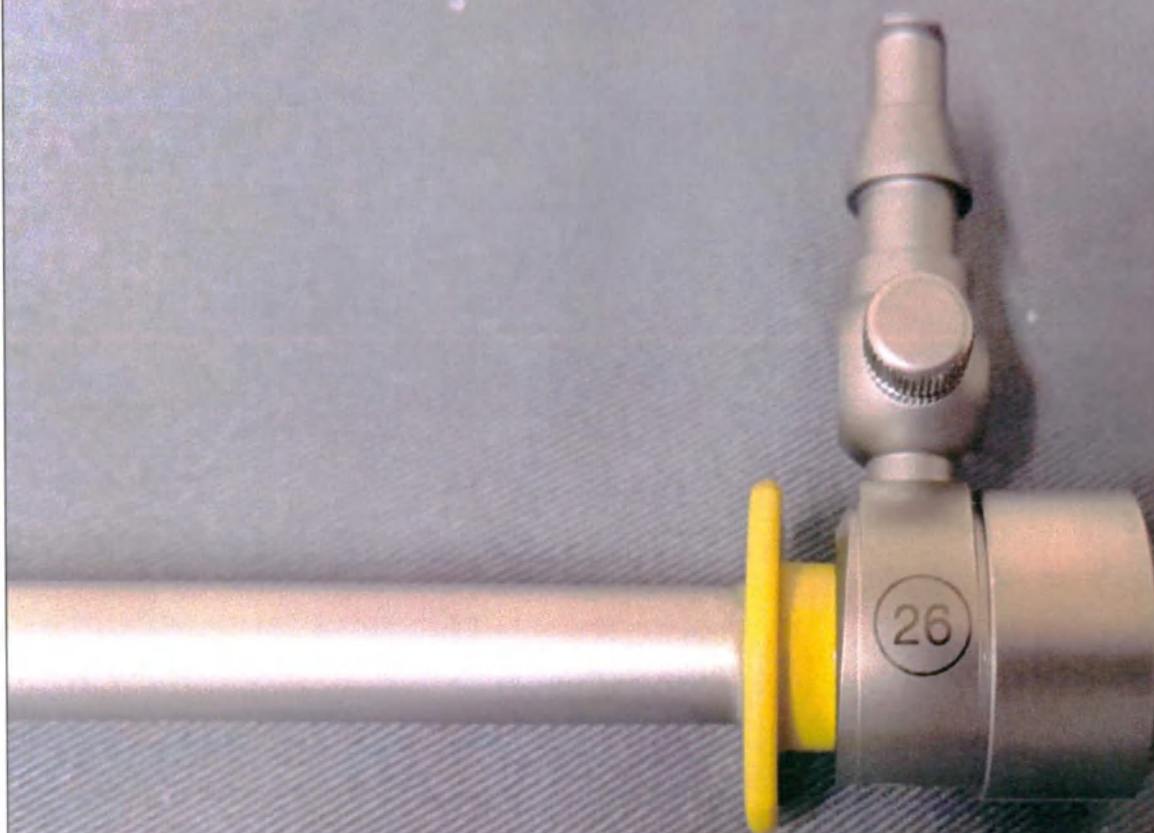


Рис. 11. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 26 Шр., с одним краном, для использования с неповоротным внутренним тубусом. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 22 Шр., с одним краном, для использования с неповоротным внутренним тубусом

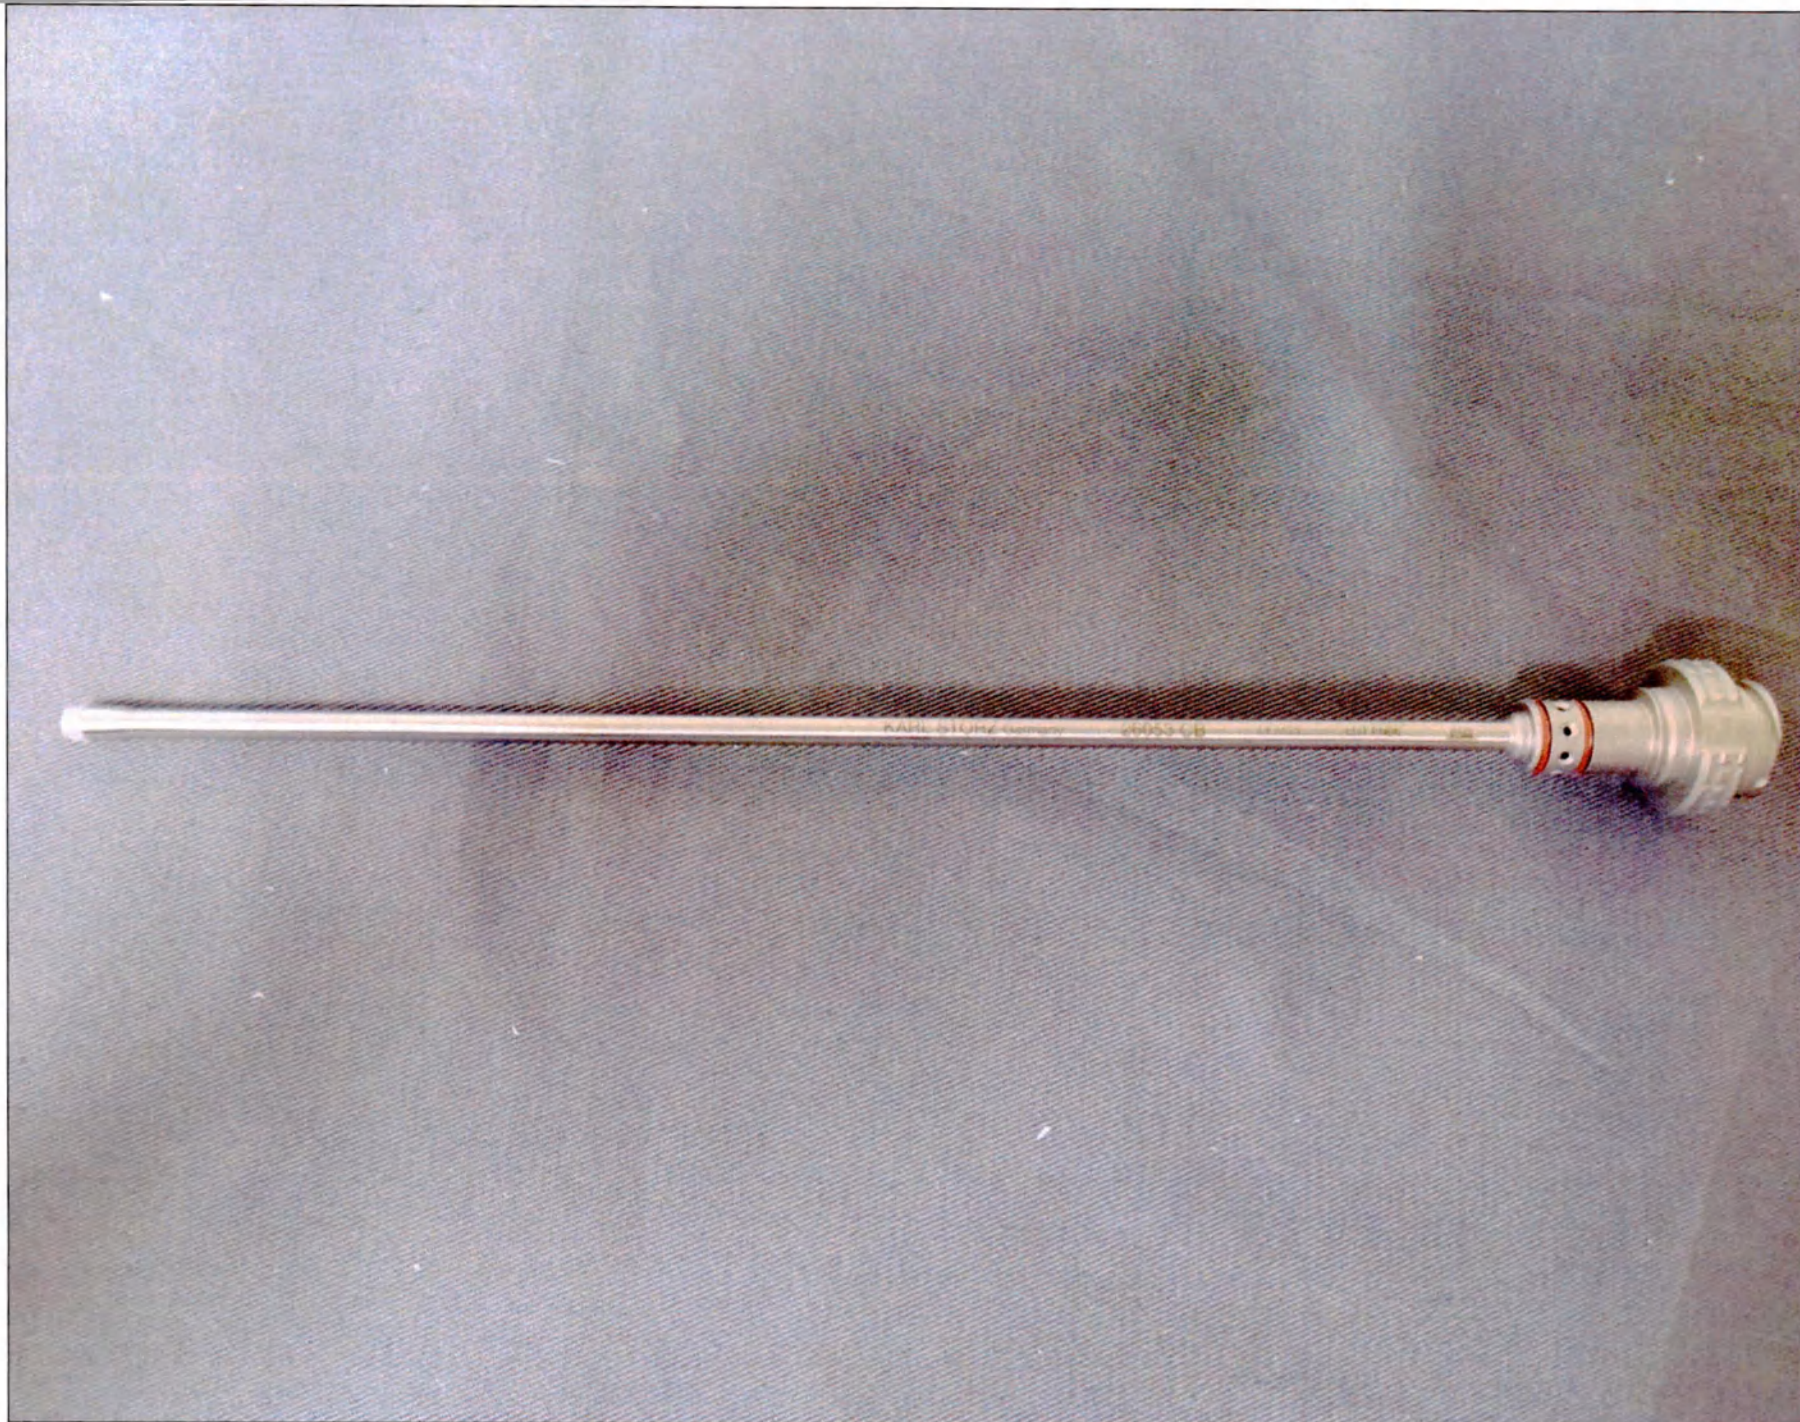


Рис. 12. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 15 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания. Имеют общий схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 22 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания, Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания

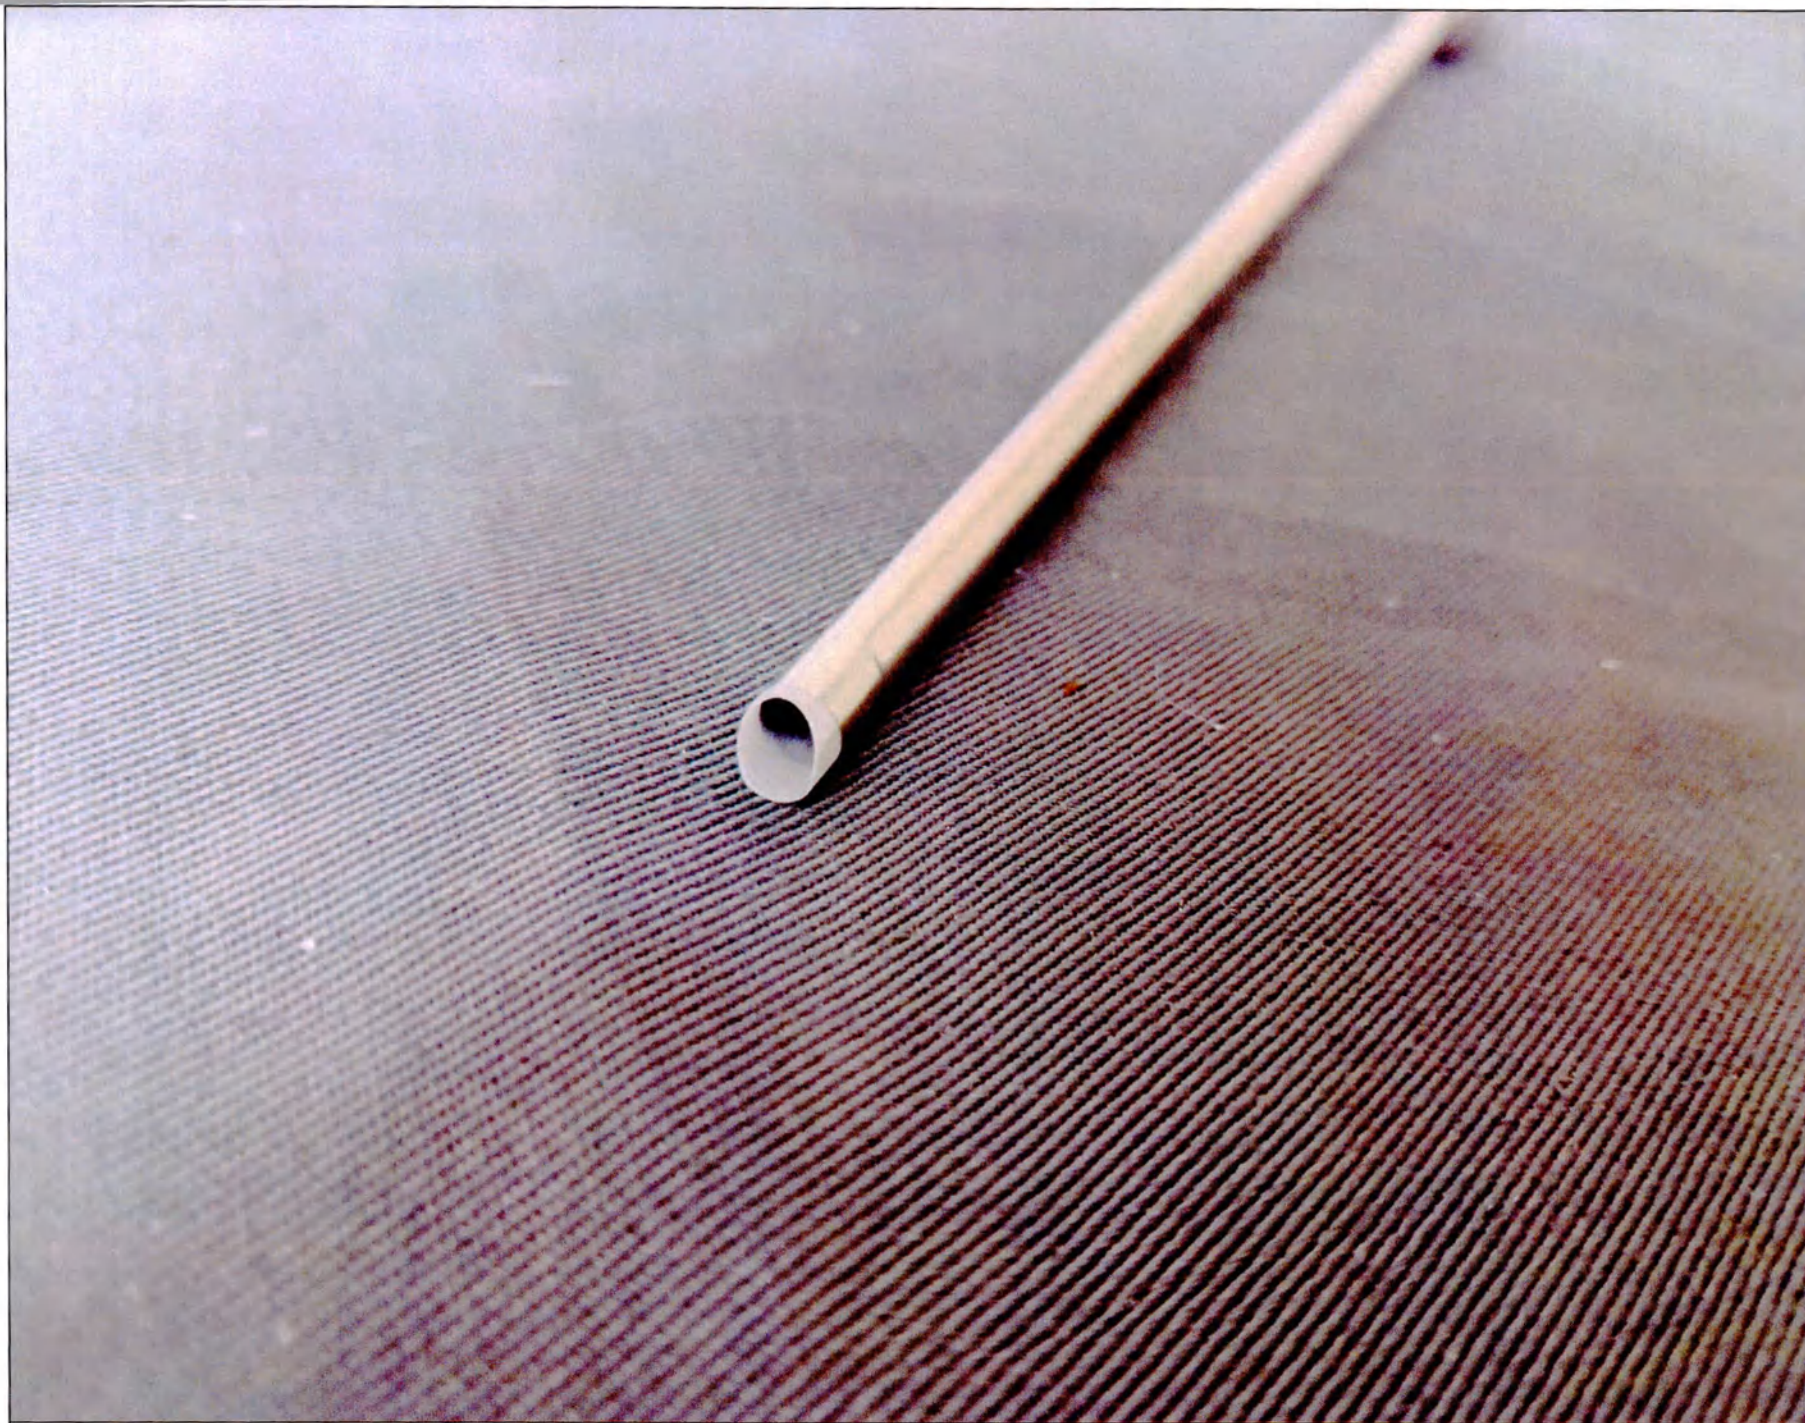


Рис. 13. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 15 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания. Имеют общий схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 22 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания, Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания

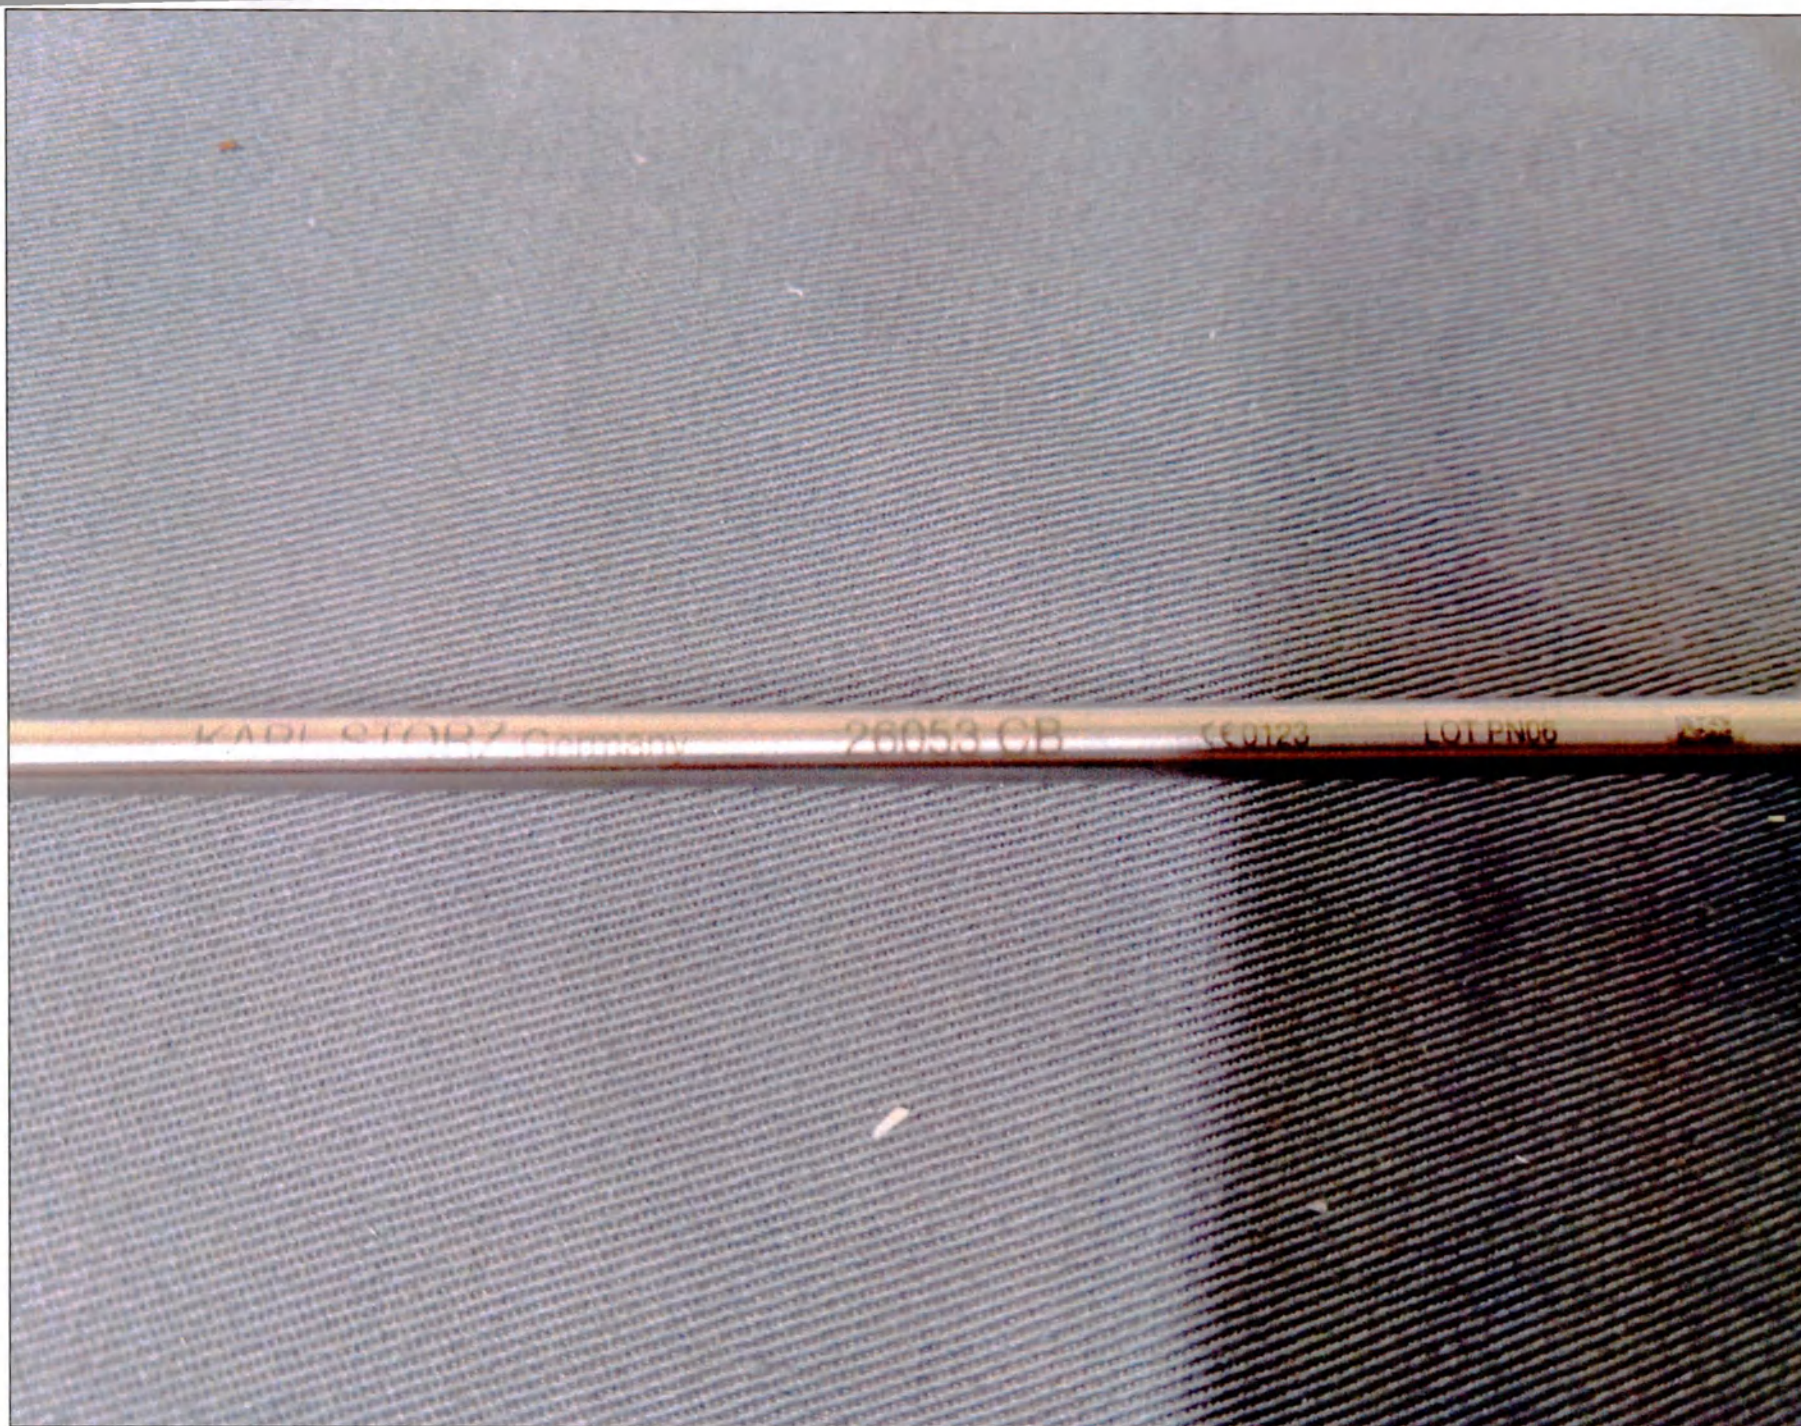


Рис. 14. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 15 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания. Имеют общий схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 22 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания, Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник, с замком быстрого смыкания/размыкания

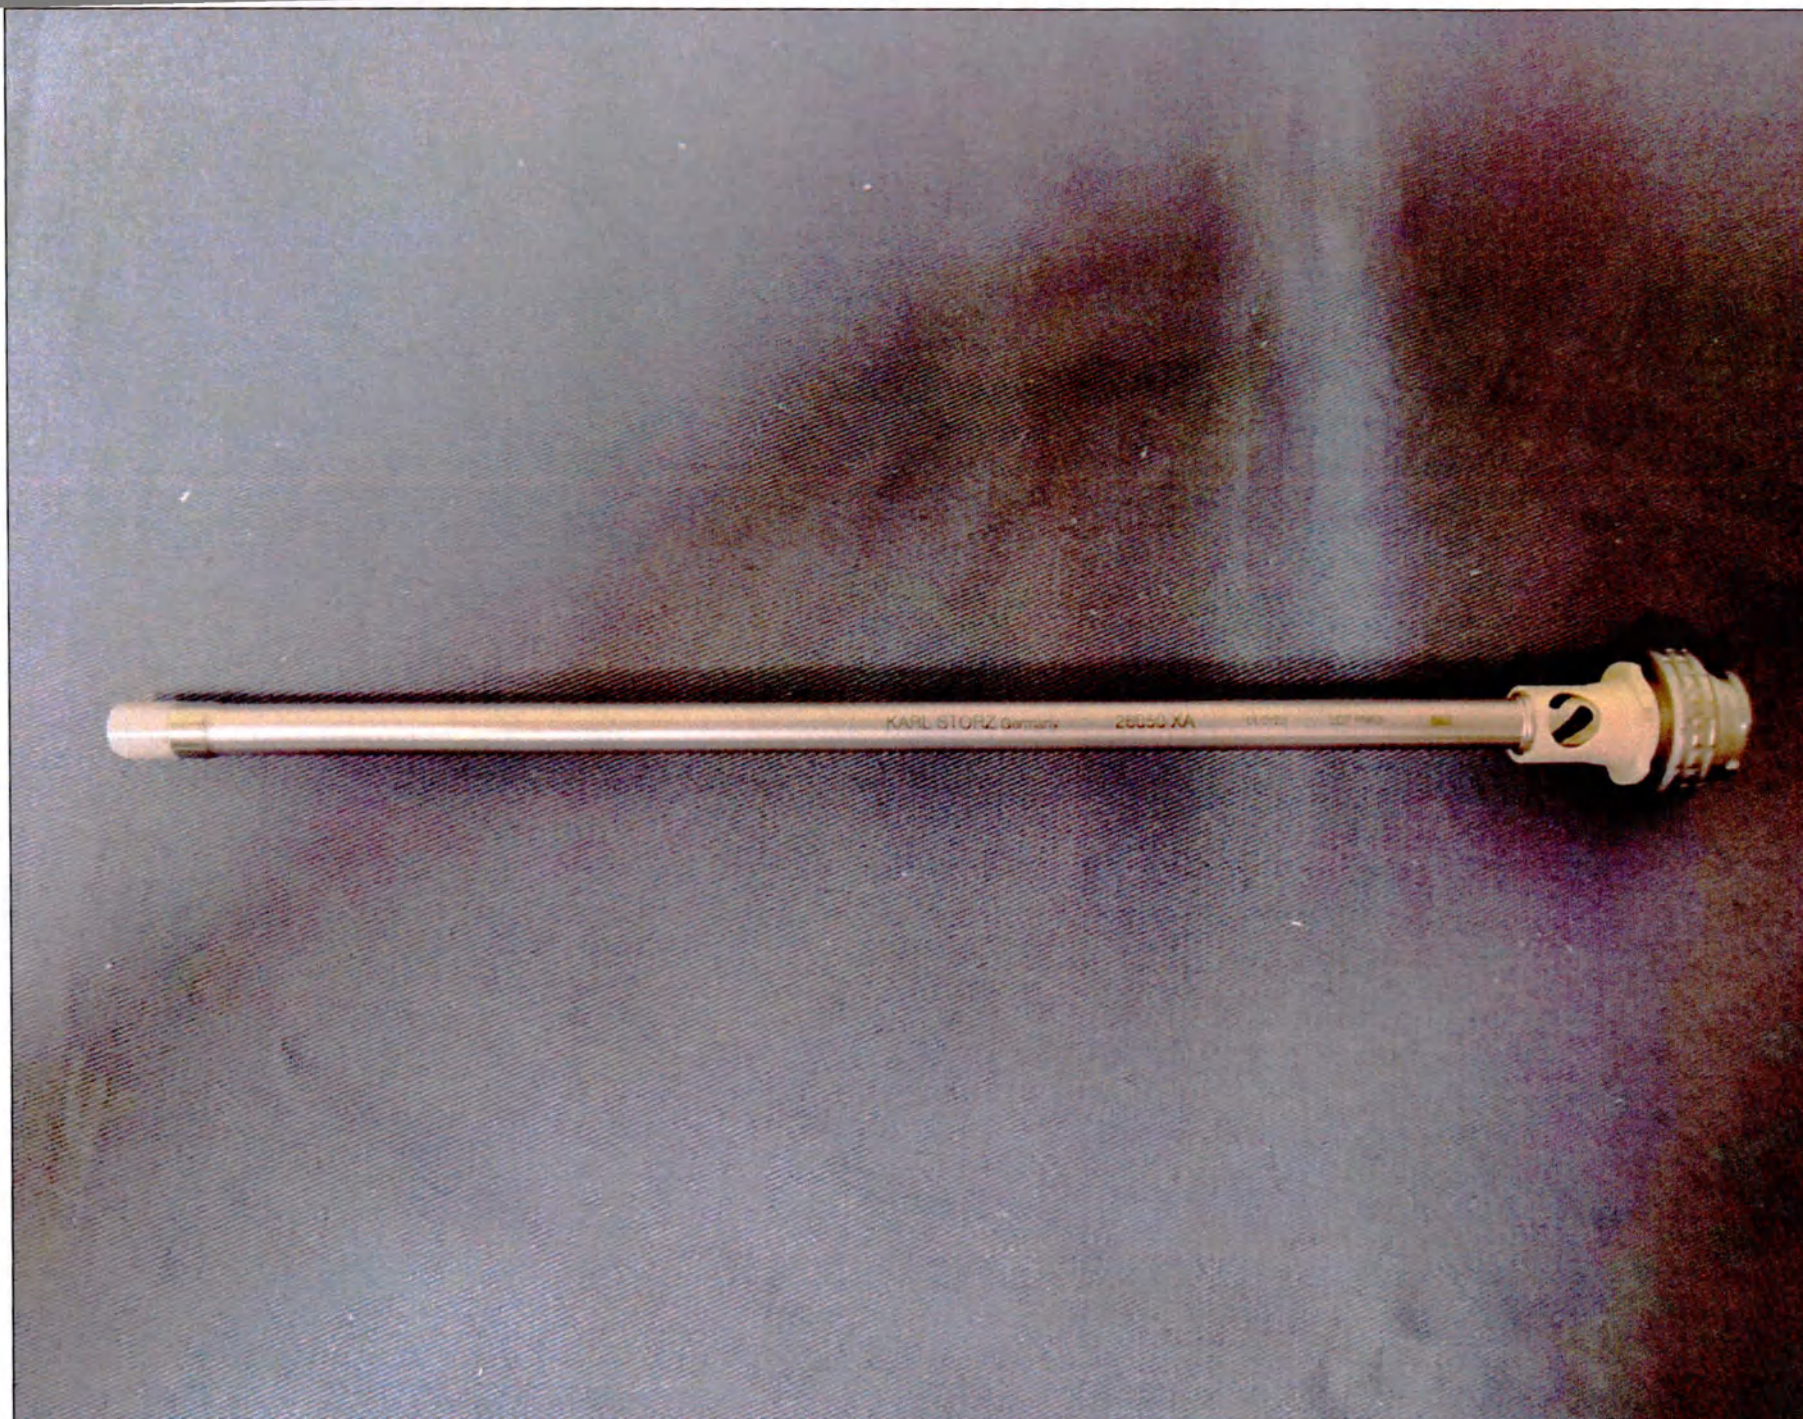


Рис. 15. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник. Имеет общий внешний вид, отличается размерным рядом: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 22 Шр., скошенный наконечник

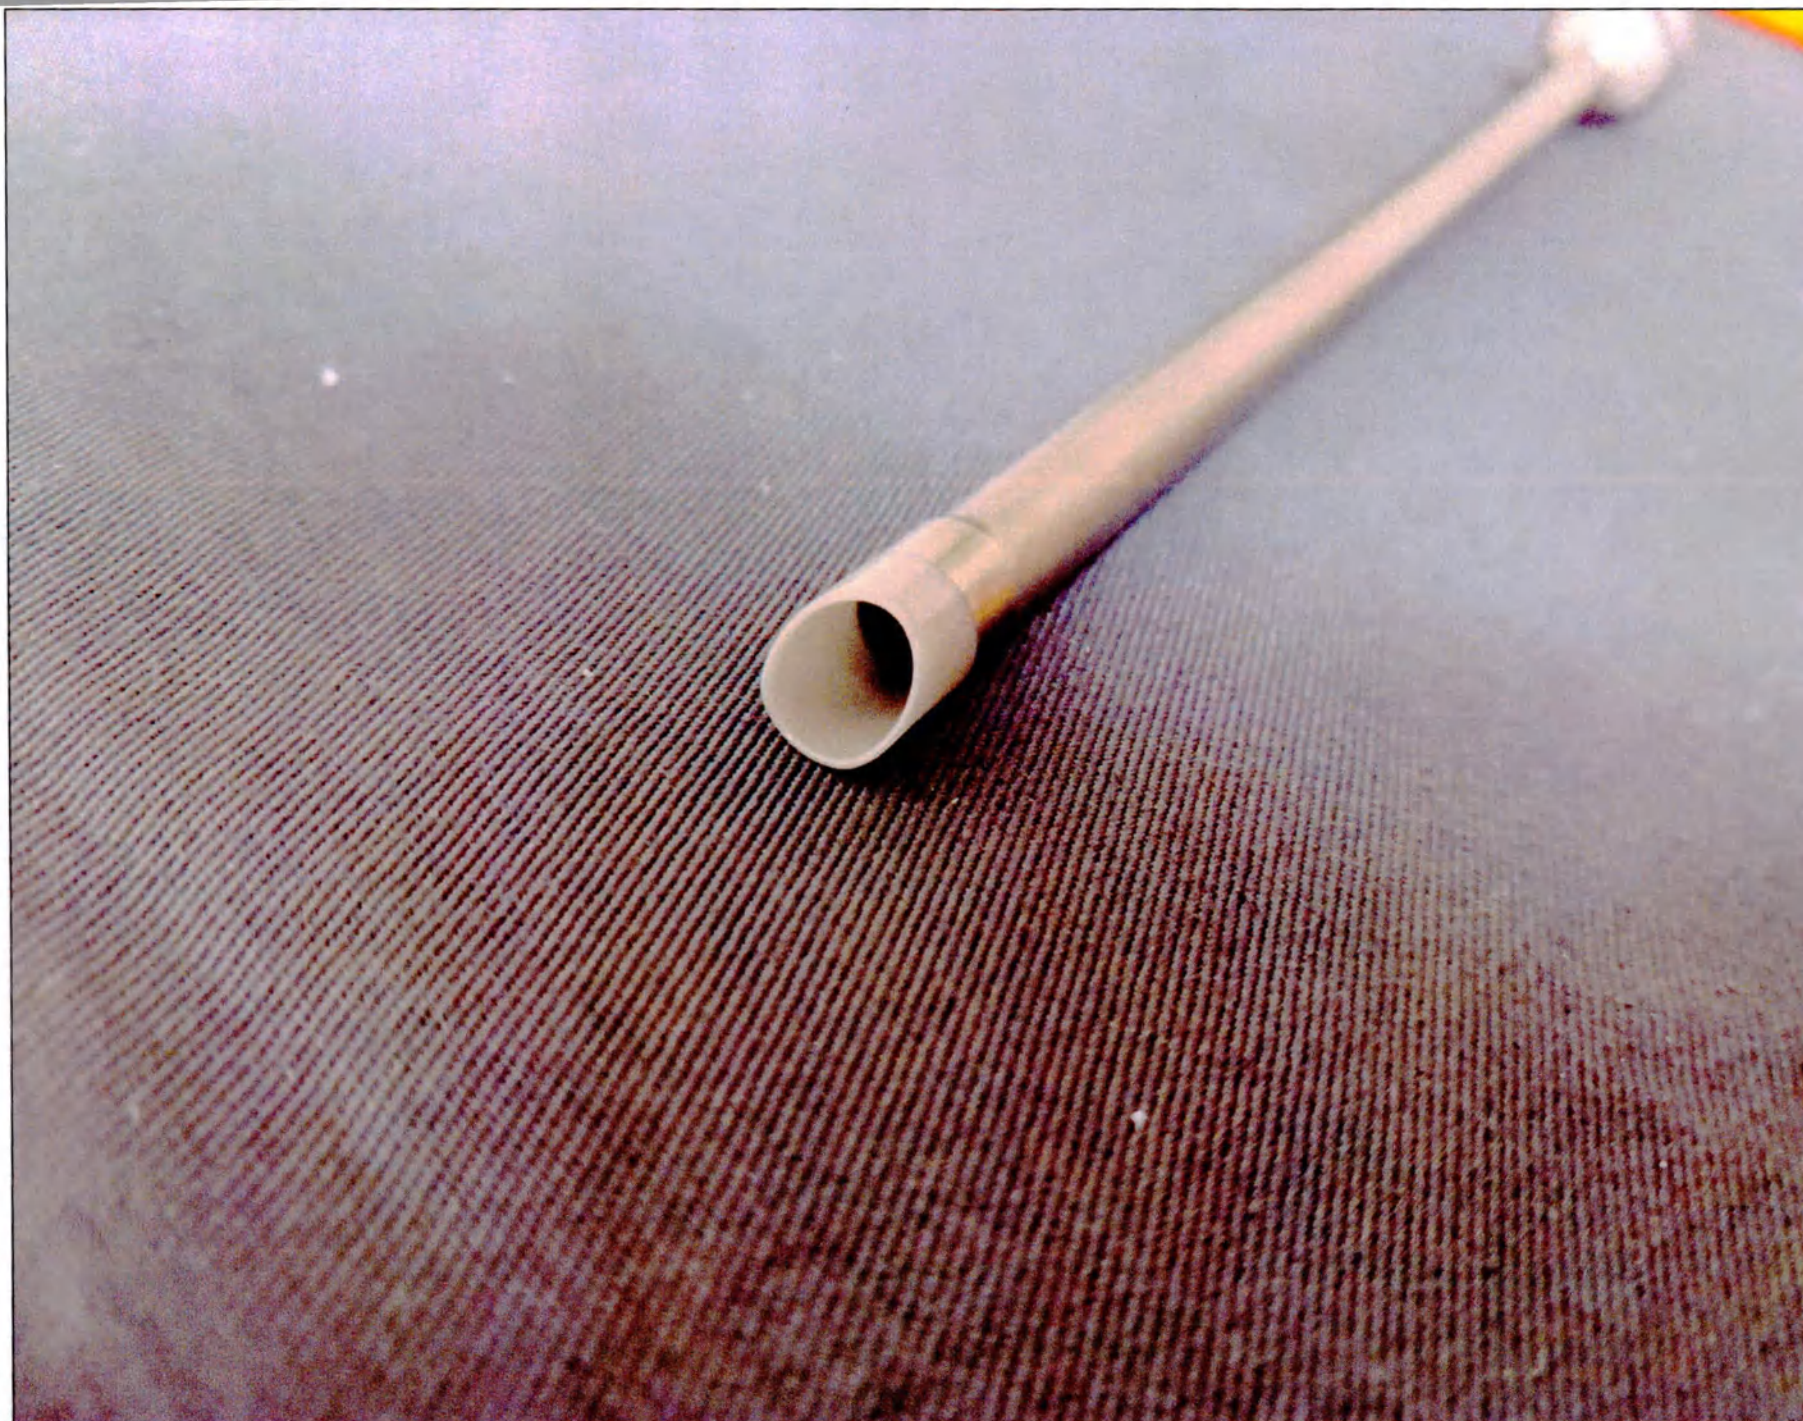


Рис. 16. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник. Имеет общий внешний вид, отличается размерным рядом: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 22 Шр., скошенный наконечник



Рис. 17. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник. Имеет общий внешний вид, отличается размерным рядом: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 22 Шр., скошенный наконечник



Рис. 18. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 26 Шр., скошенный наконечник. Имеет общий внешний вид, отличается размерным рядом: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, поворотный, 22 Шр., скошенный наконечник



Рис. 19. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 26 Шр., скошенный наконечник. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 22 Шр., скошенный наконечник

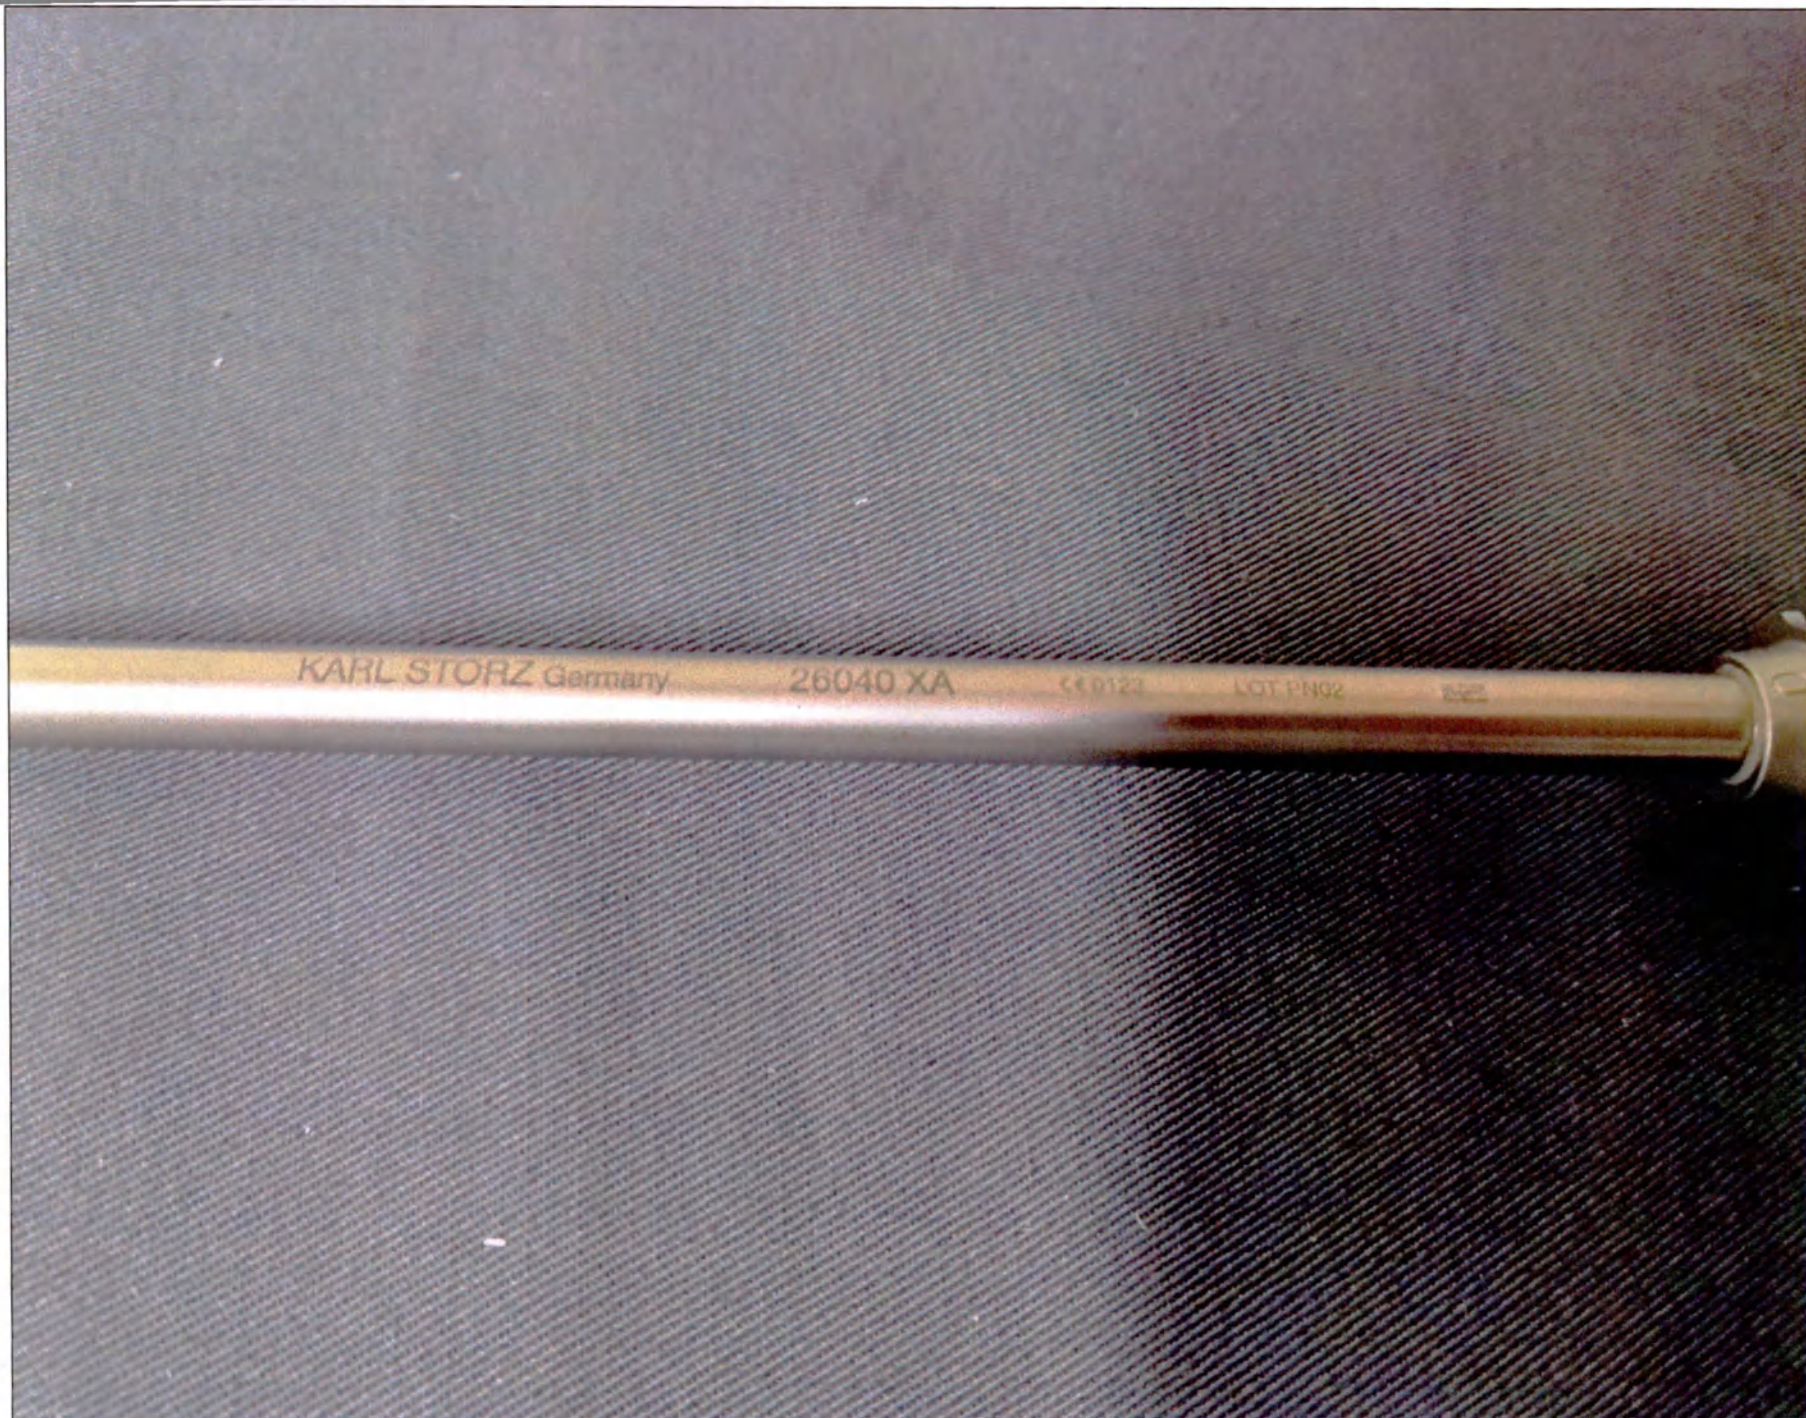


Рис. 20. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 26 Шр., скошенный наконечник. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 22 Шр., скошенный наконечник

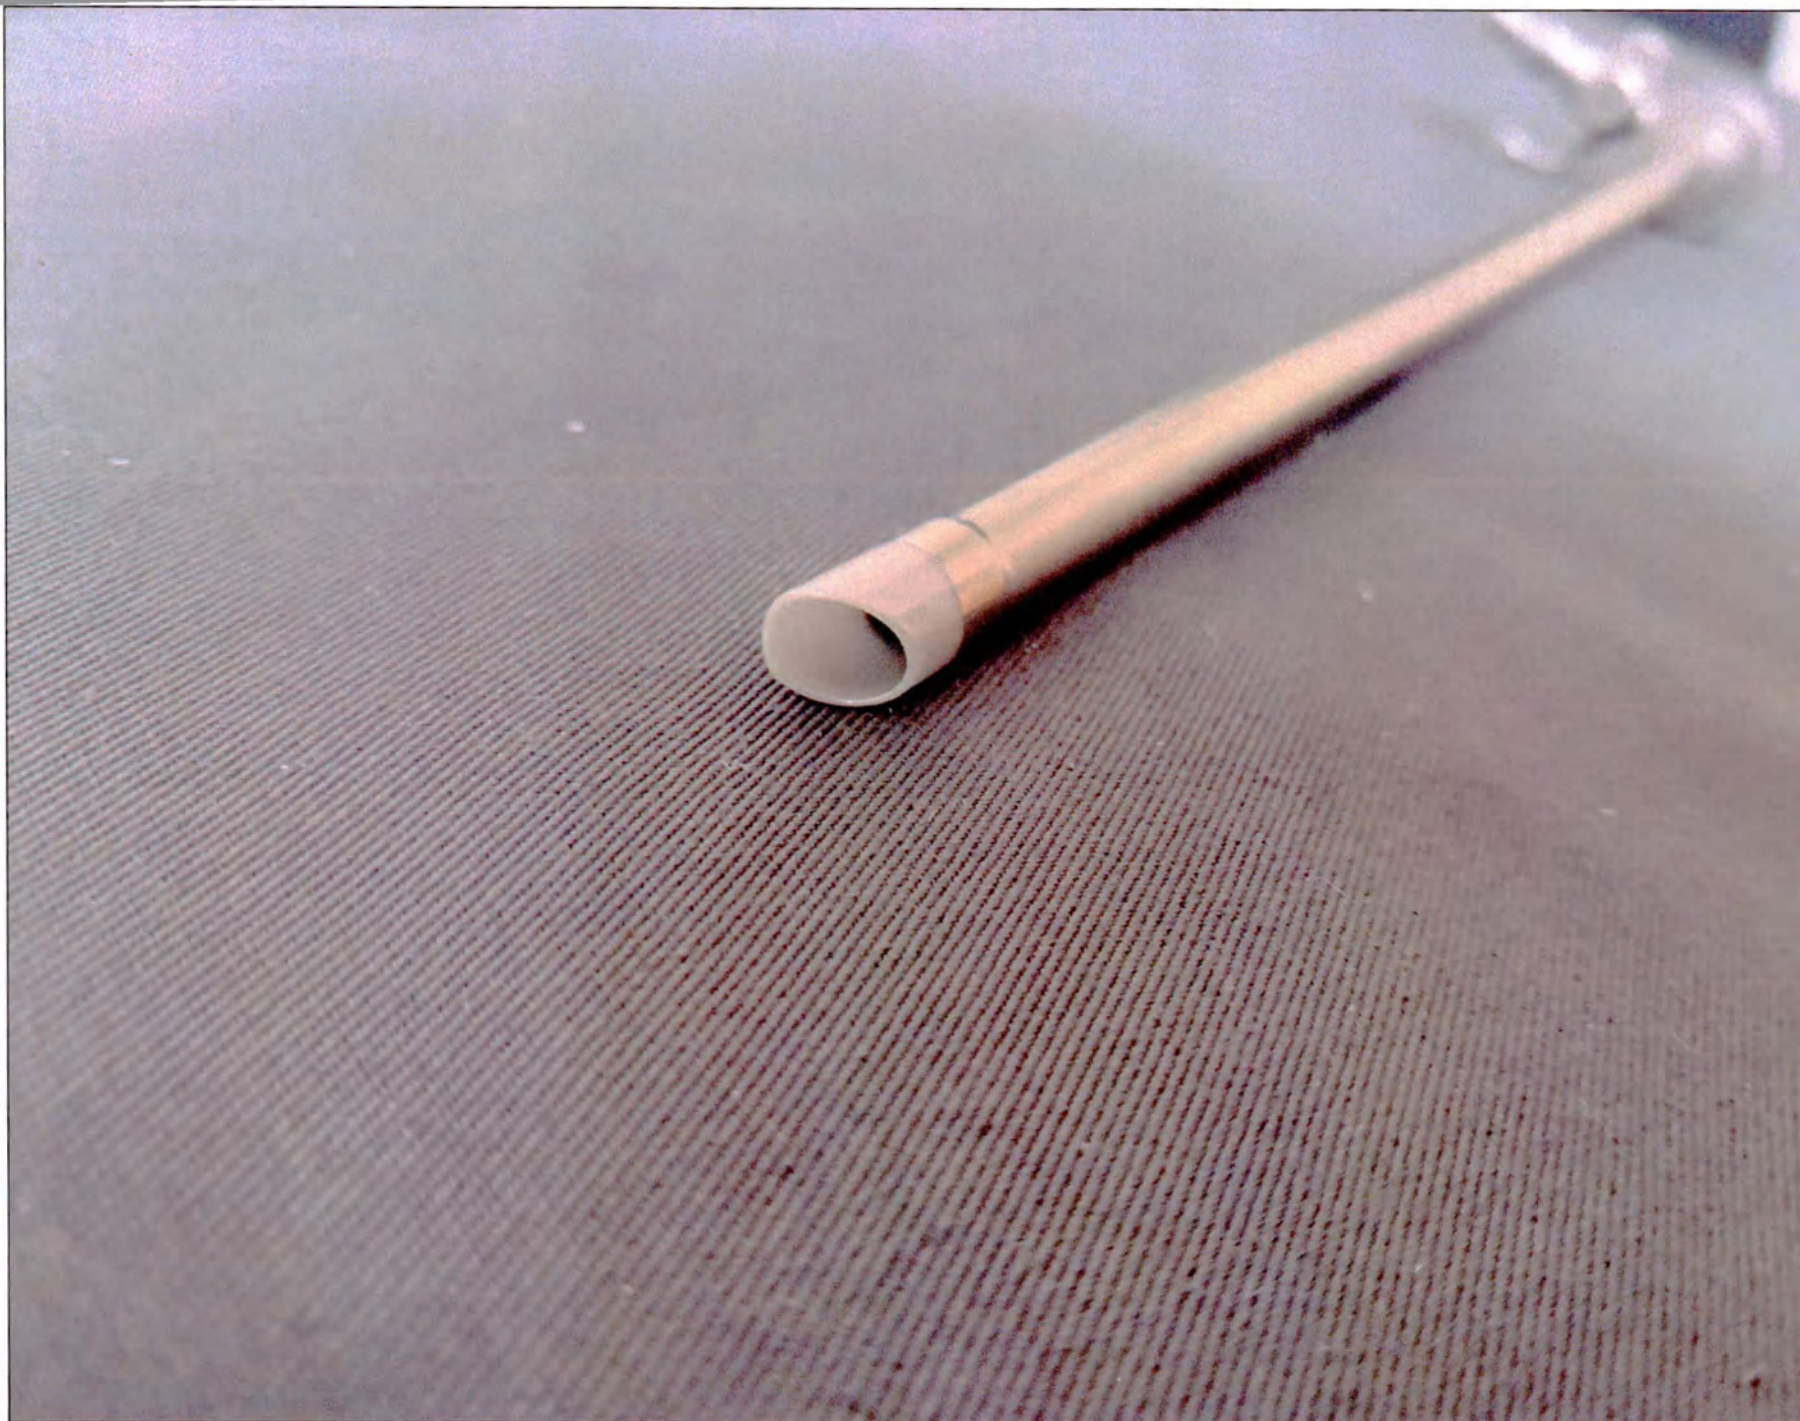


Рис. 21. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 26 Шр., скошенный наконечник. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 22 Шр., скошенный наконечник



Рис. 22. Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 26 Шр., скошенный наконечник. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внутренний, неповоротный, 22 Шр., скошенный наконечник

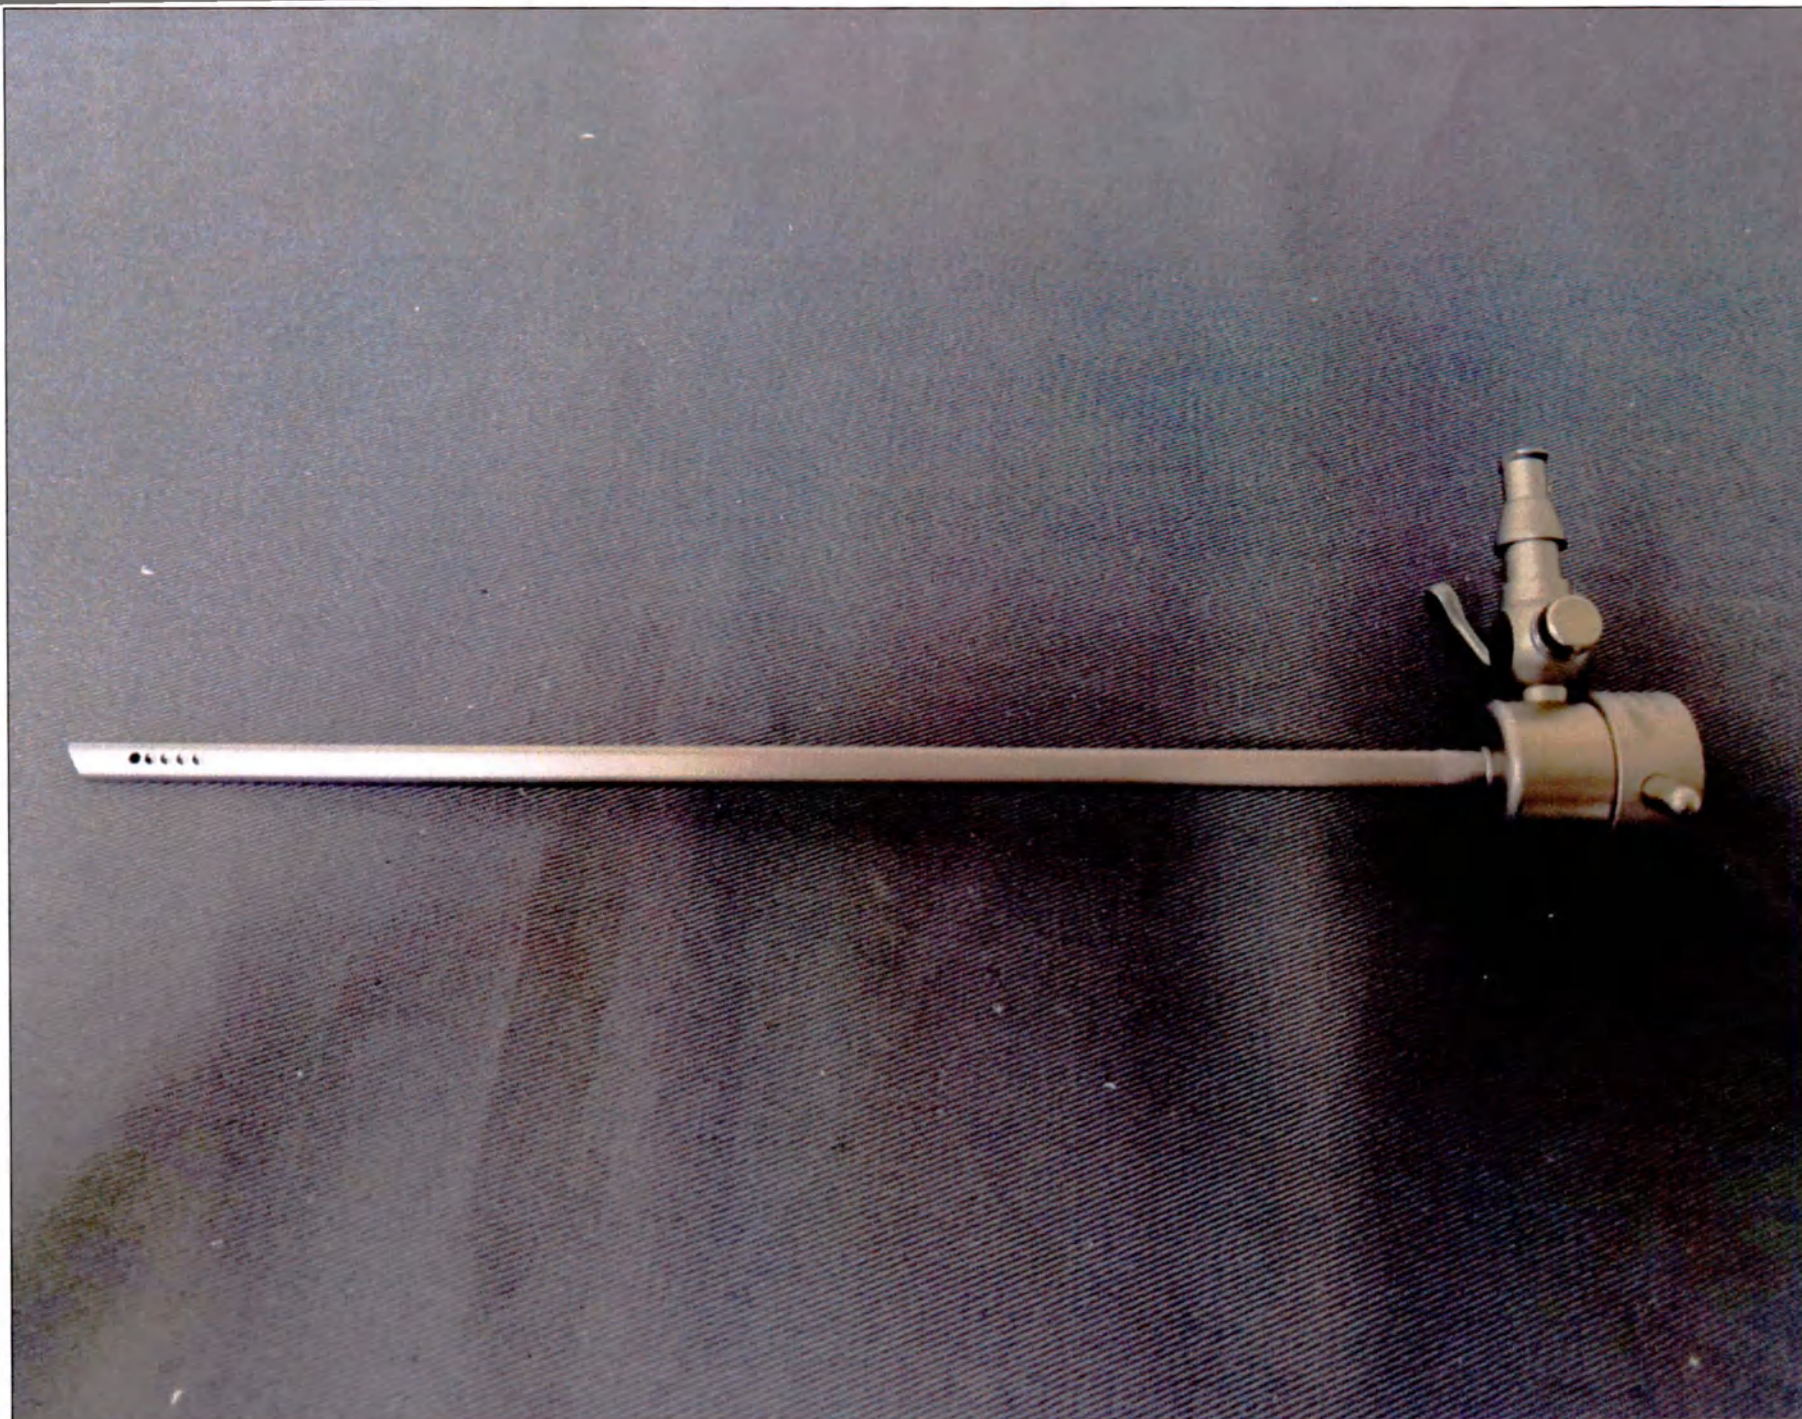


Рис. 23. Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСЧИ, внешний, размер 4,2 мм, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСЧИ, внешний, размер 5 мм, с одним краном, Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСЧИ, внешний, размер 5,5 мм, с одним краном, Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСЧИ, внешний, размер 6 мм, с одним краном

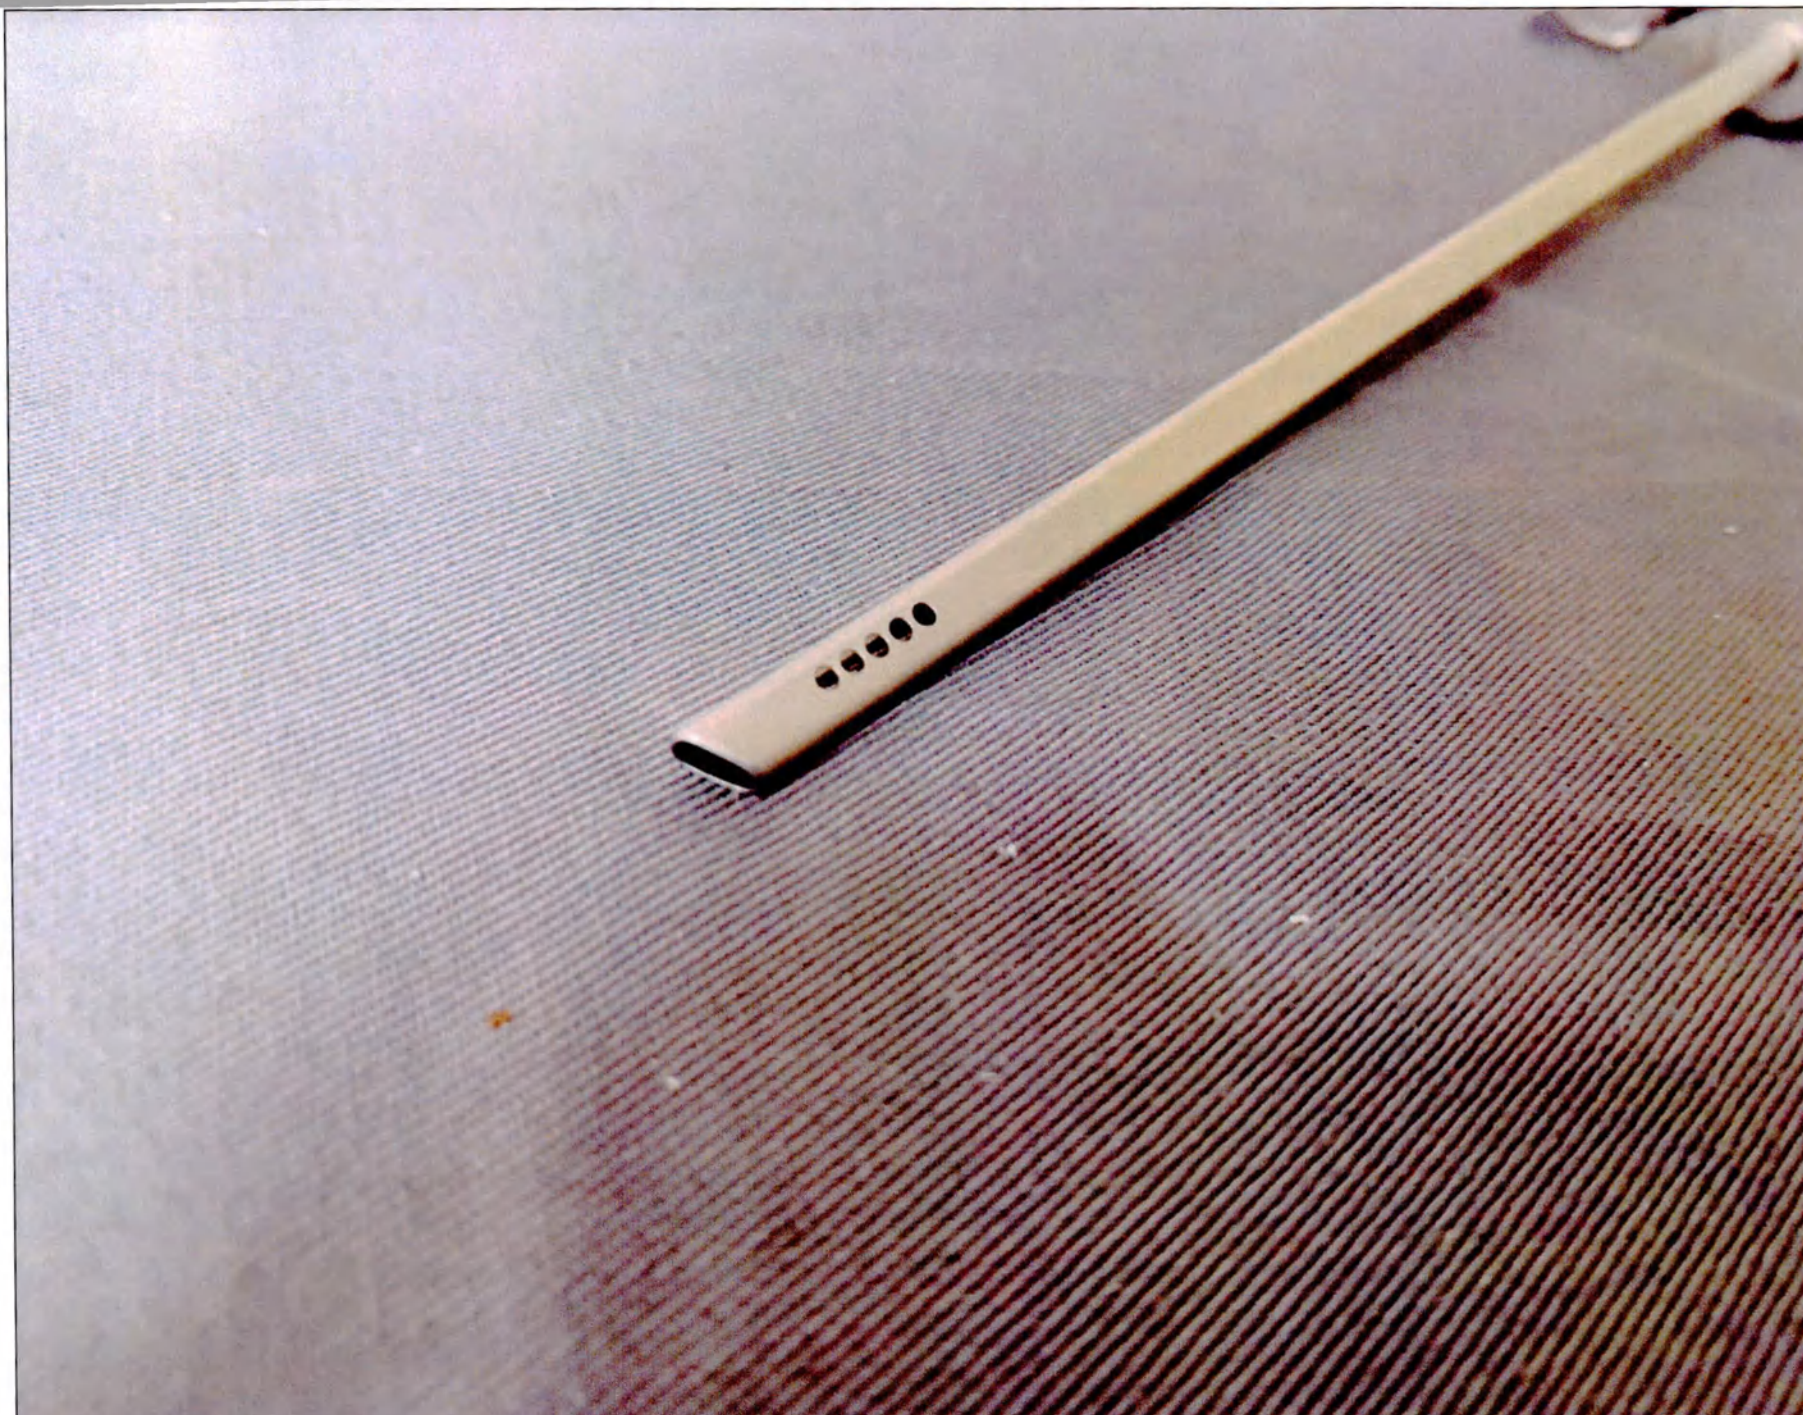


Рис. 24. Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСНИ, внешний, размер 4,2 мм, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСНИ, внешний, размер 5 мм, с одним краном, Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСНИ, внешний, размер 5,5 мм, с одним краном, Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСНИ, внешний, размер 6 мм, с одним краном

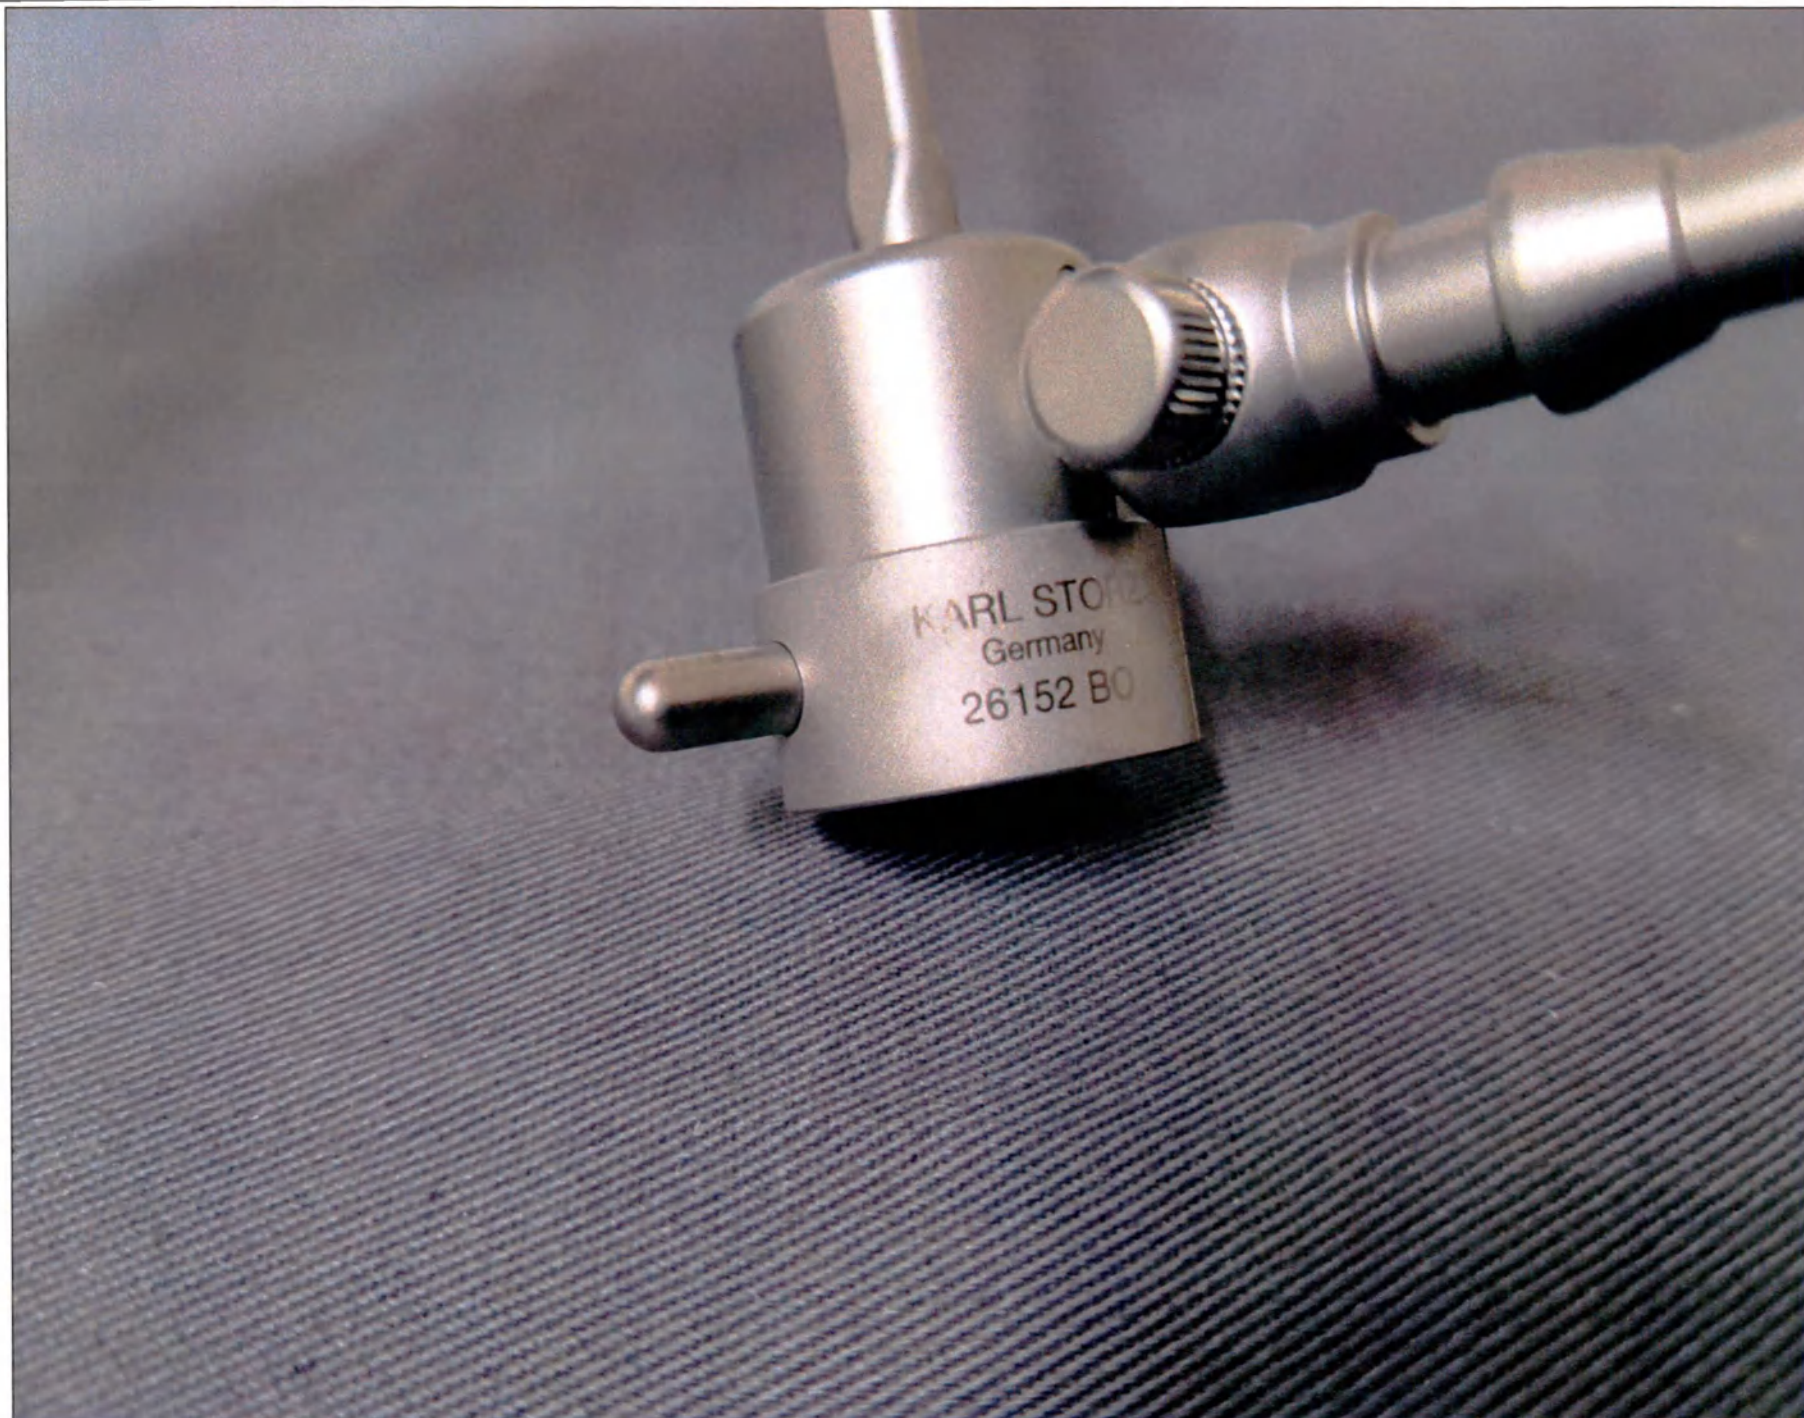


Рис. 25. Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСНИ, внешний, размер 4,2 мм, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСНИ, внешний, размер 5 мм, с одним краном, Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСНИ, внешний, размер 5,5 мм, с одним краном, Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСНИ, внешний, размер 6 мм, с одним краном

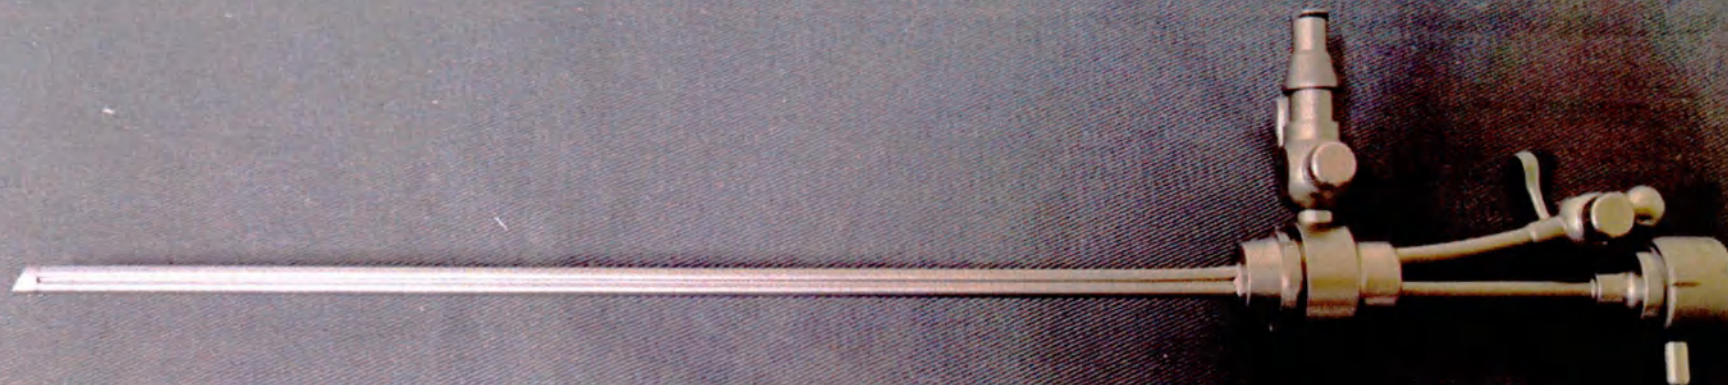


Рис. 26. Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОССНІ, внутренний, размер 3,6 мм, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОССНІ, внутренний, размер 4,3 мм, с одним краном, Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОССНІ, внутренний, размер 4,9 мм, с одним краном, Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОССНІ, внутренний, размер 5,4 мм, с одним краном

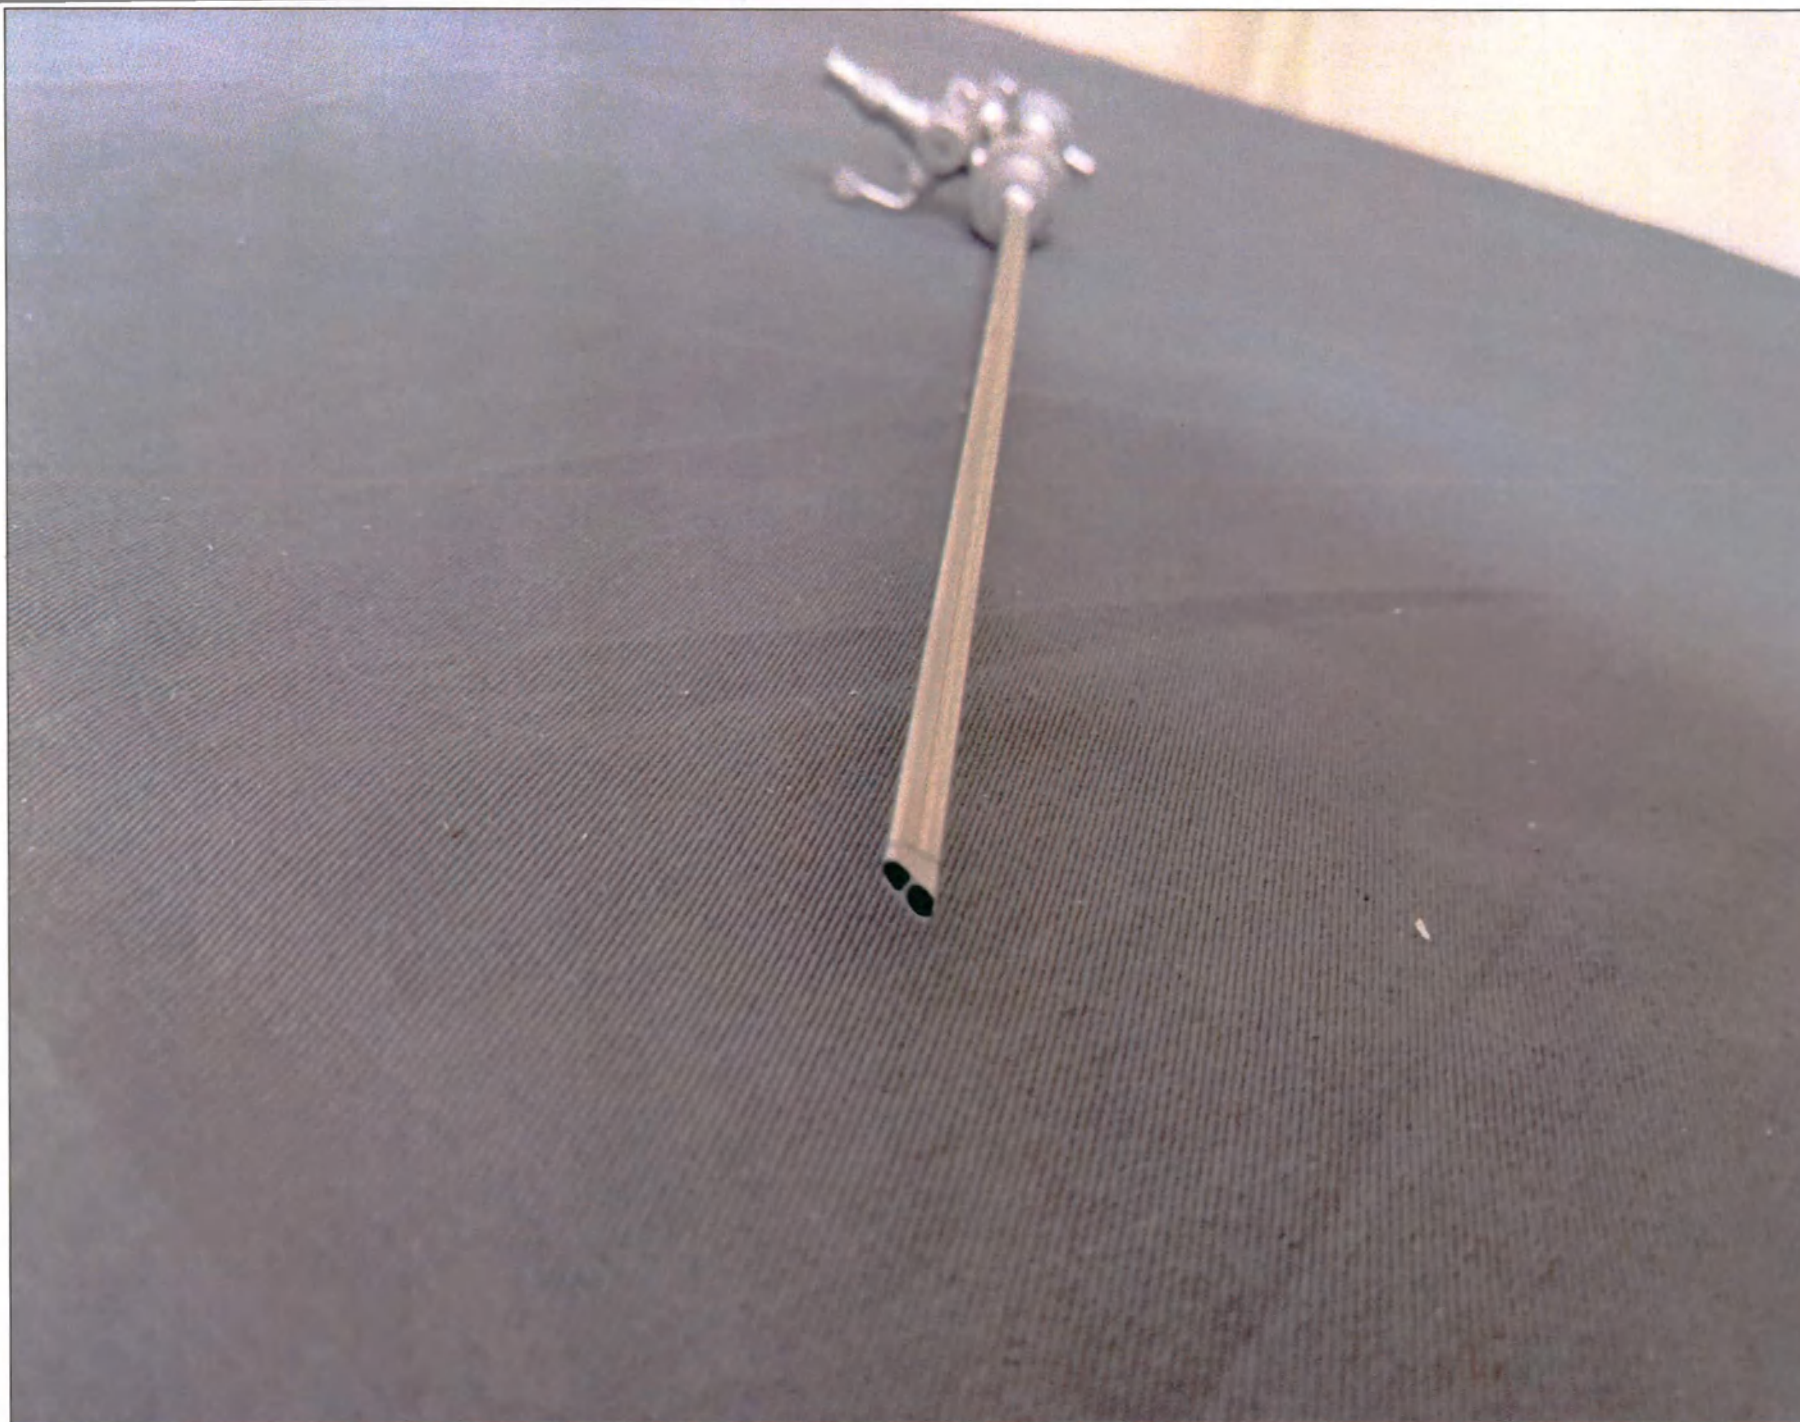


Рис. 27. Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОССНІ, внутренний, размер 3,6 мм, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОССНІ, внутренний, размер 4,3 мм, с одним краном, Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОССНІ, внутренний, размер 4,9 мм, с одним краном, Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОССНІ, внутренний, размер 5,4 мм, с одним краном

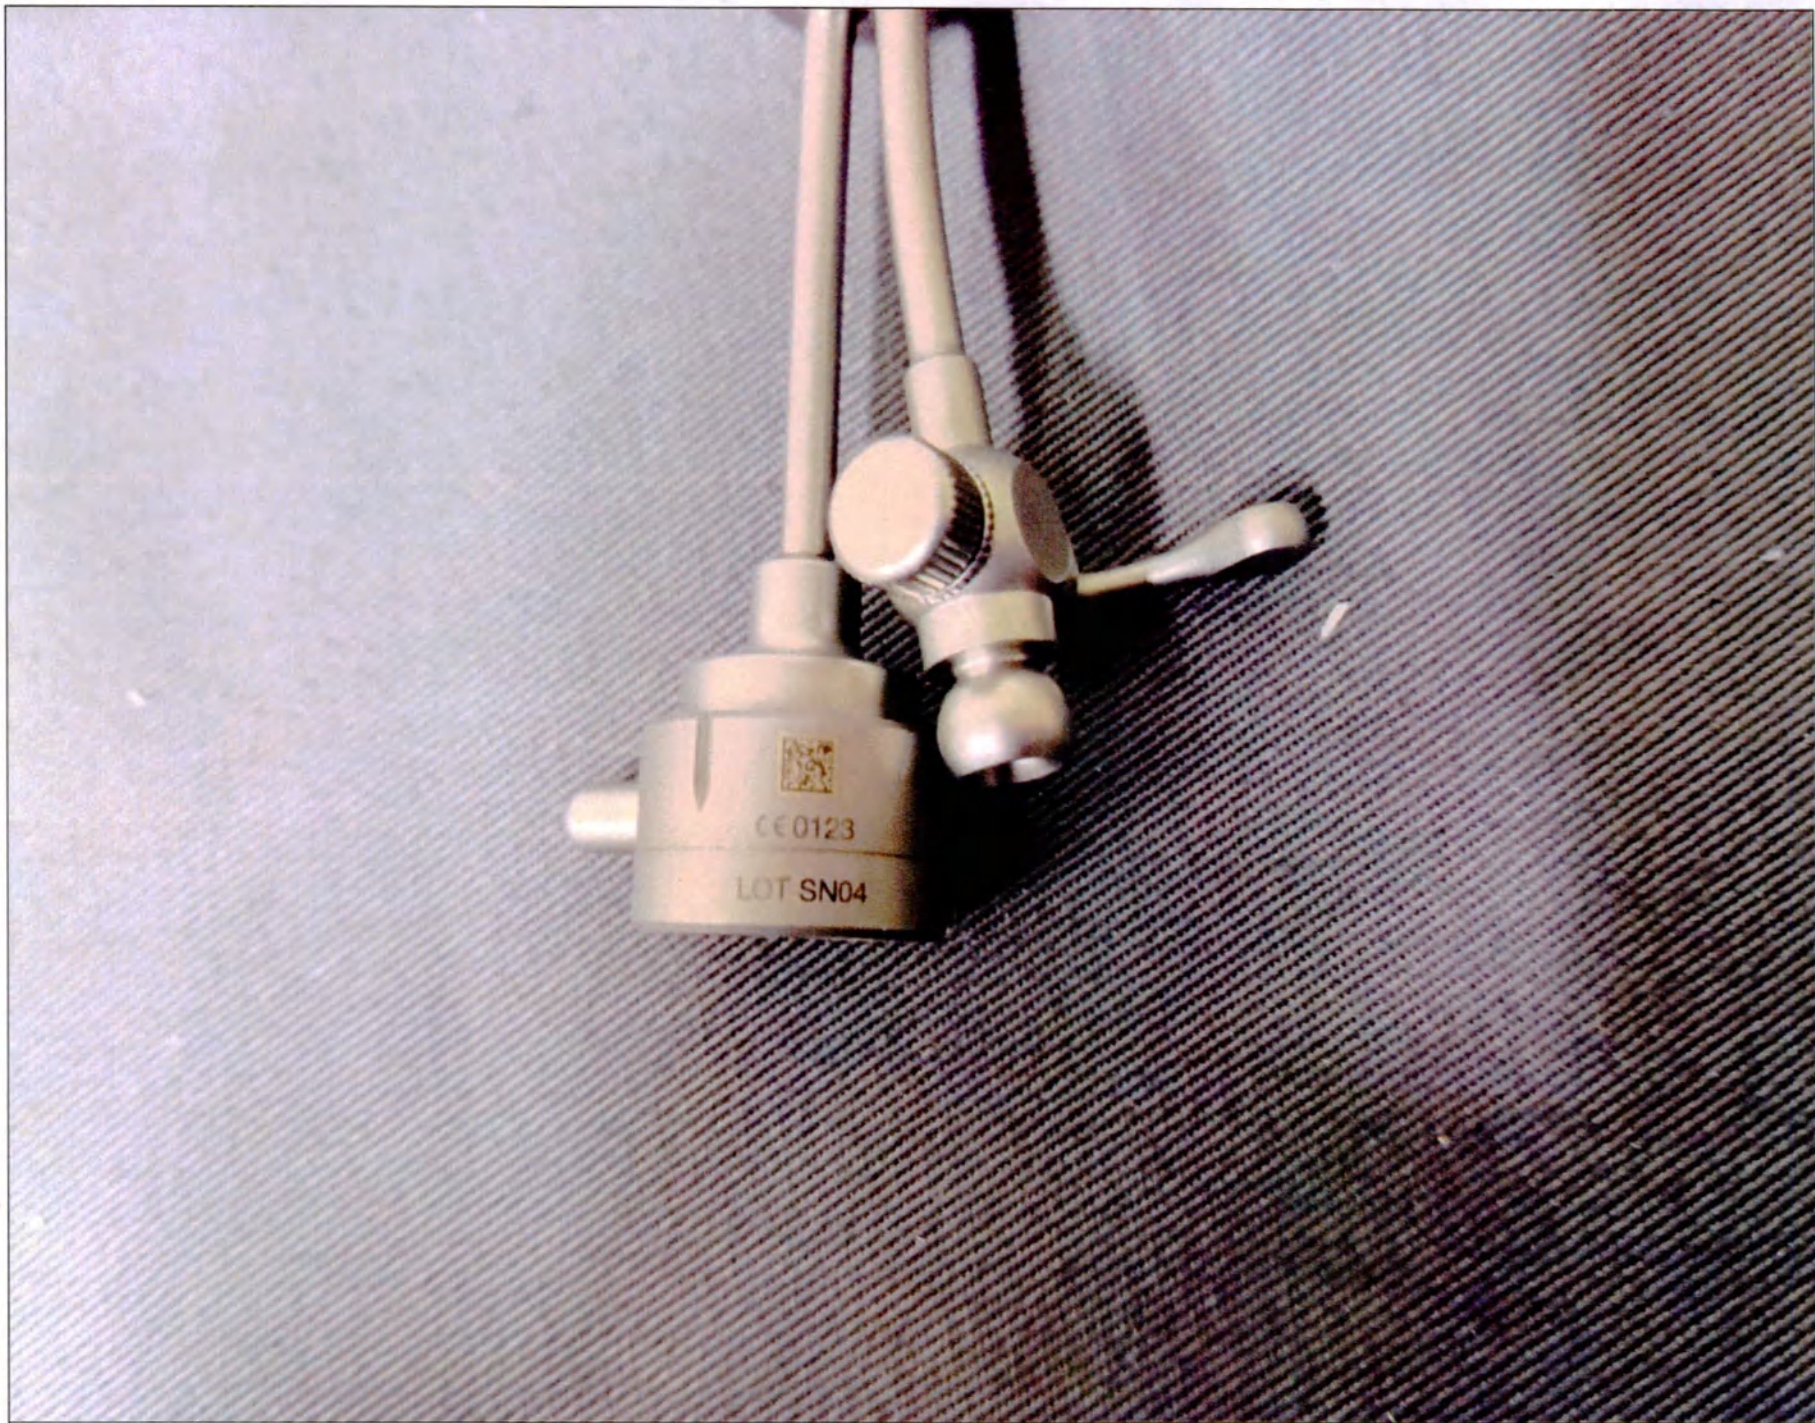


Рис. 28. Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСЧИ, внутренний, размер 3,6 мм, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСЧИ, внутренний, размер 4,3 мм, с одним краном, Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСЧИ, внутренний, размер 4,9 мм, с одним краном, Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСЧИ, внутренний, размер 5,4 мм, с одним краном



Рис. 29. Колпачок уплотнительный, диаметр 0,8 мм. Идентичен Колпачку уплотнительному, диаметр 0,8 мм в составах типоразмеров Тубус операционного гистероскопа, по ВЕТТОСНИ, внутренний

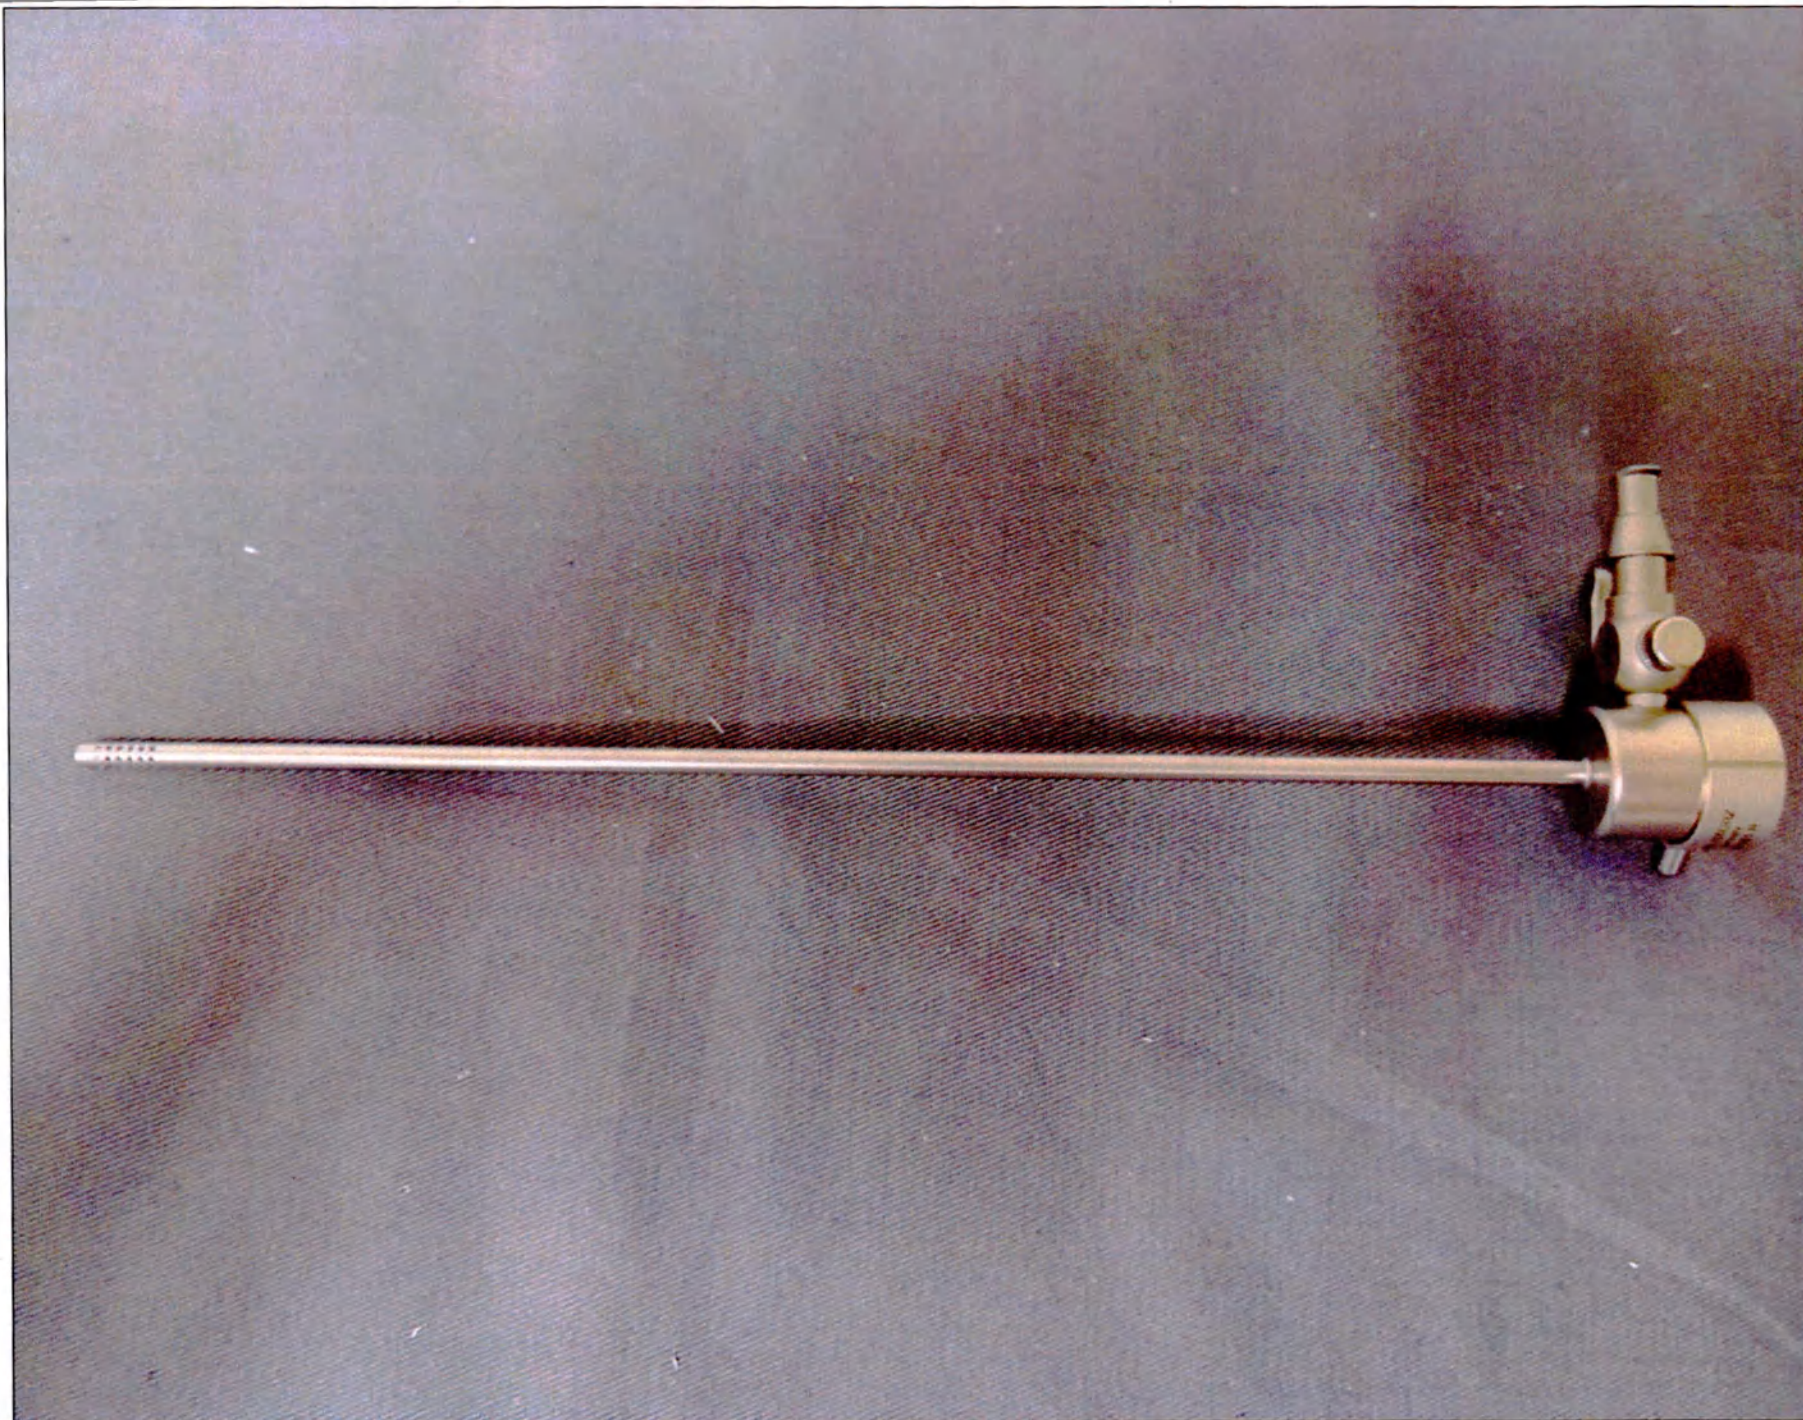


Рис. 30. Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внешний, диаметр 3,6 мм, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внешний, диаметр 4,5 мм, с одним краном, Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внешний, диаметр 6,2 мм, с одним краном

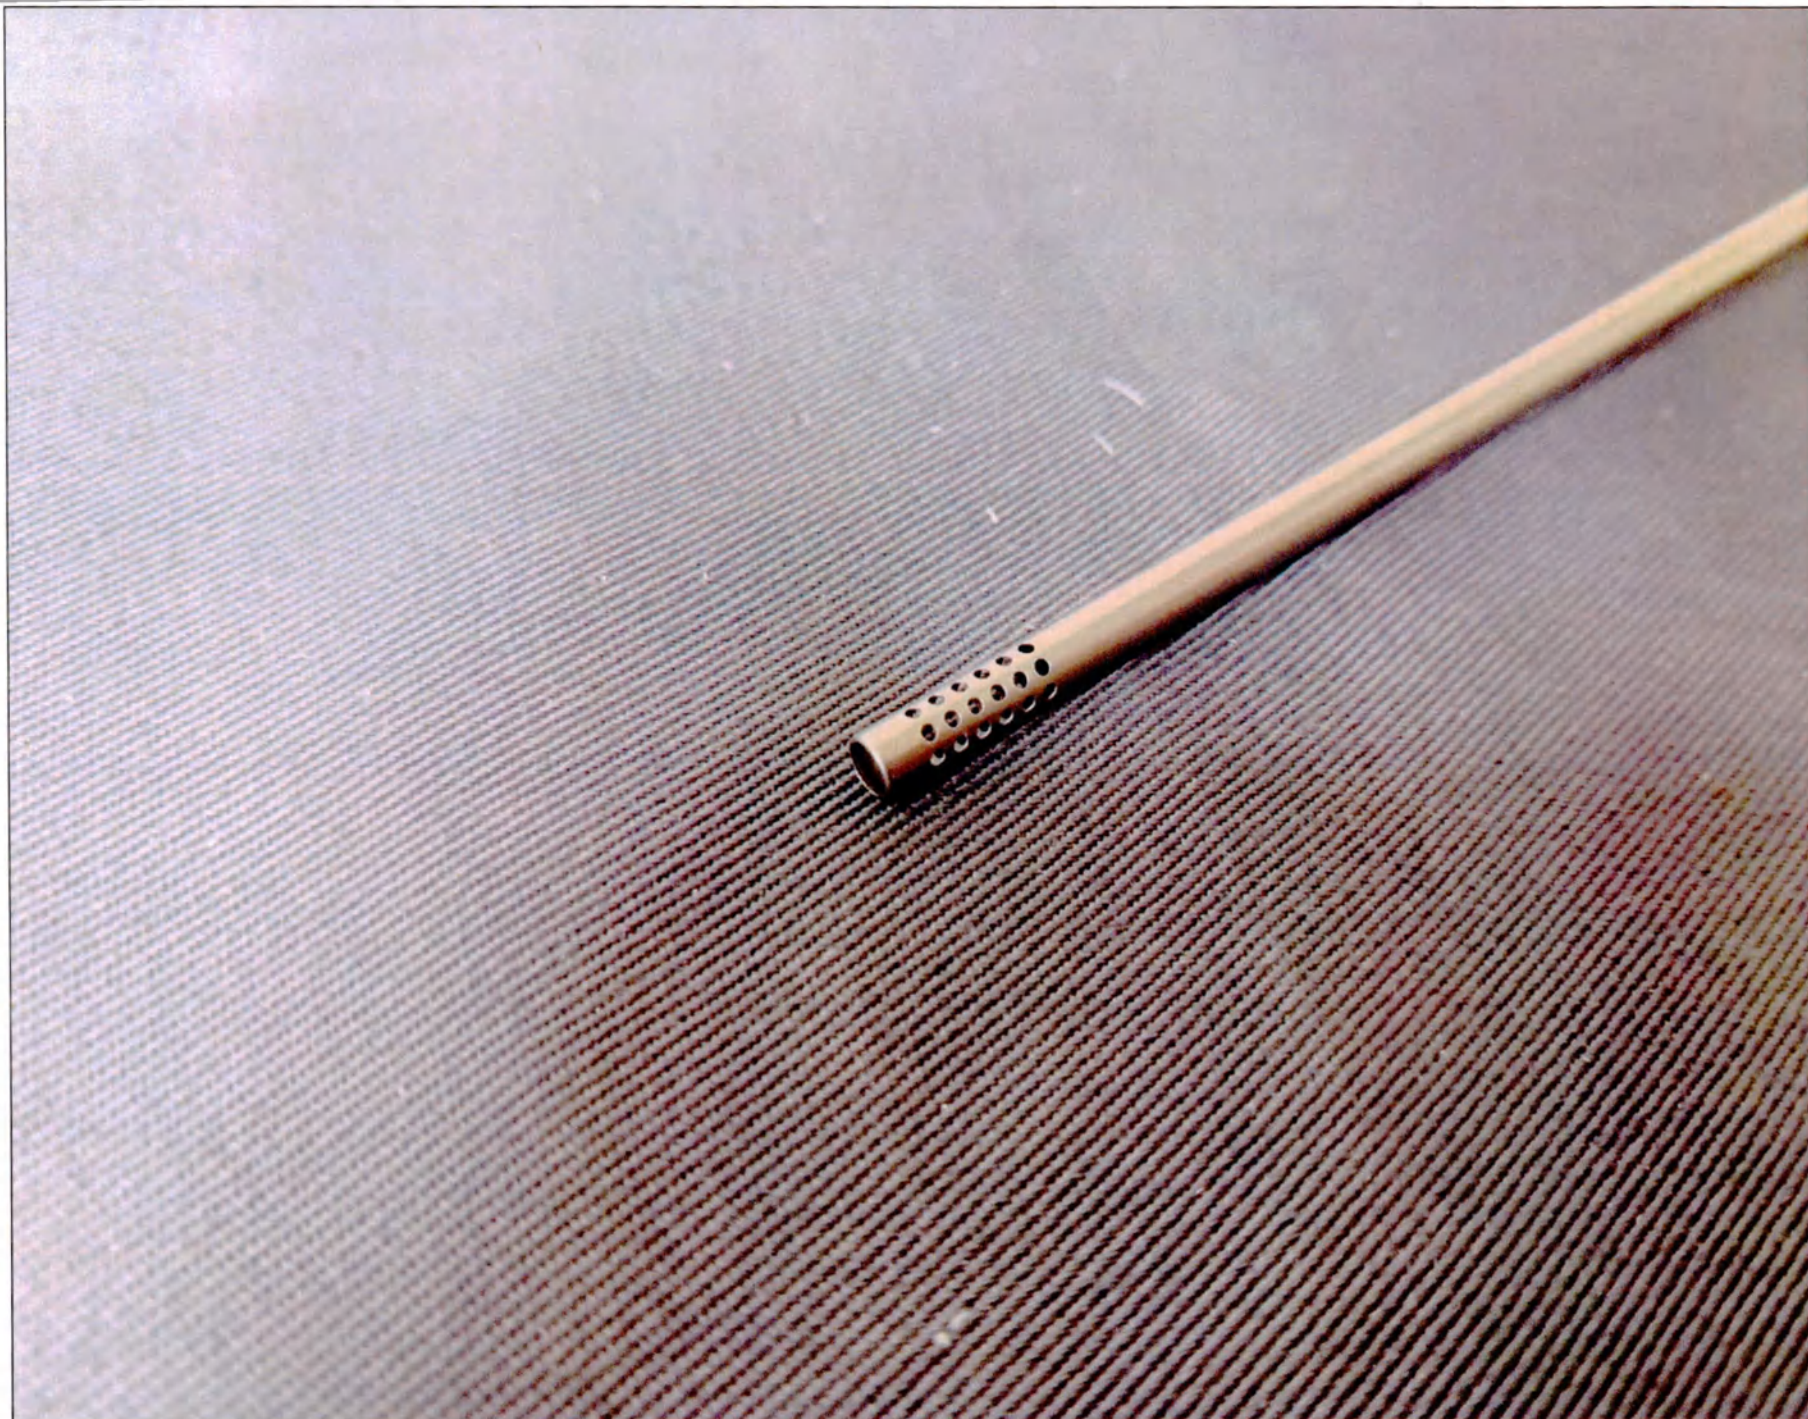


Рис. 31. Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внешний, диаметр 3,6 мм, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внешний, диаметр 4,5 мм, с одним краном, Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внешний, диаметр 6,2 мм, с одним краном

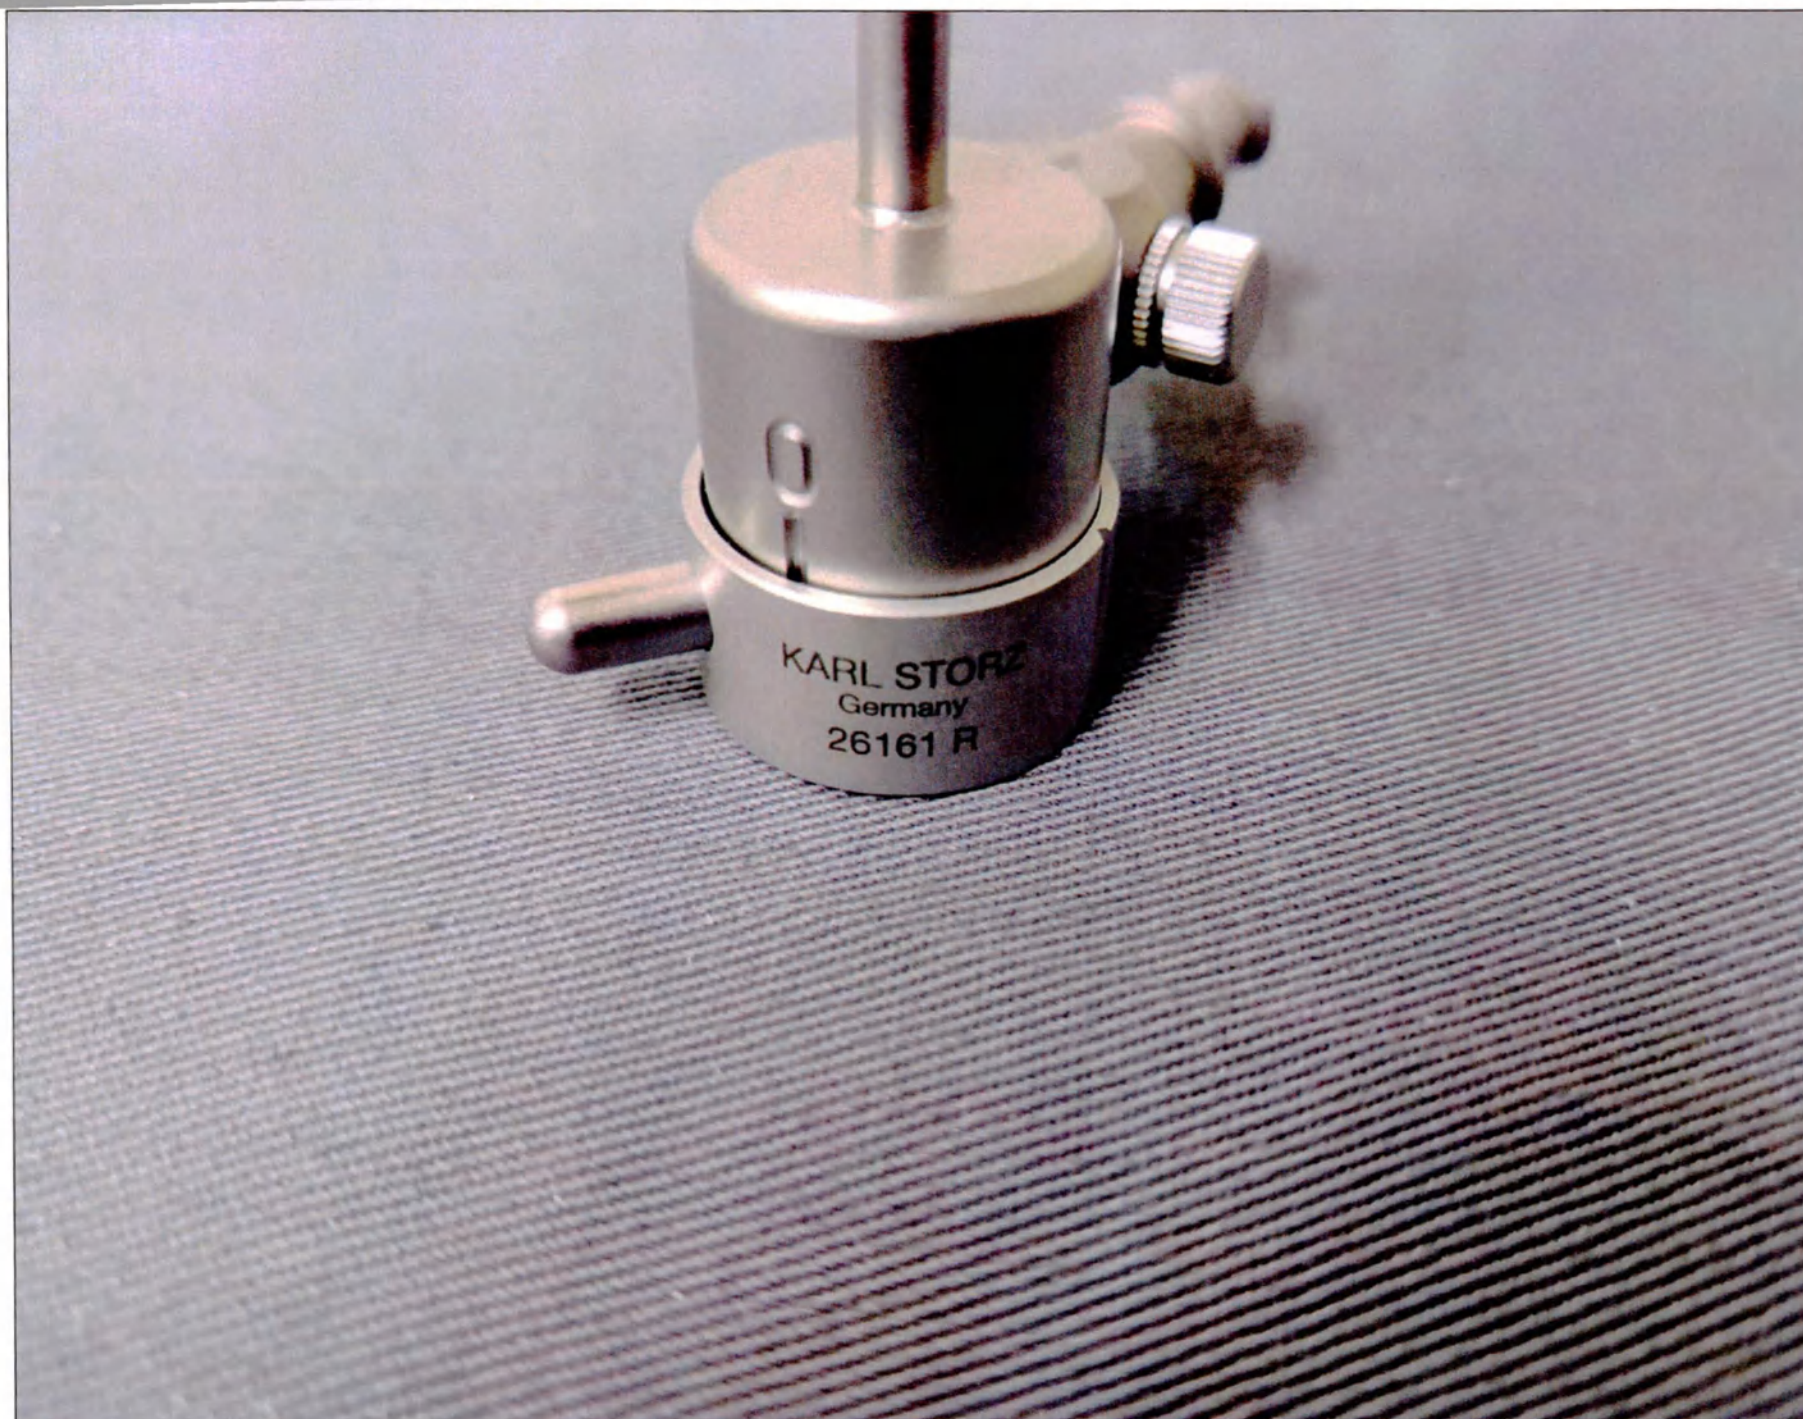


Рис. 32. Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внешний, диаметр 3,6 мм, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внешний, диаметр 4,5 мм, с одним краном, Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внешний, диаметр 6,2 мм, с одним краном

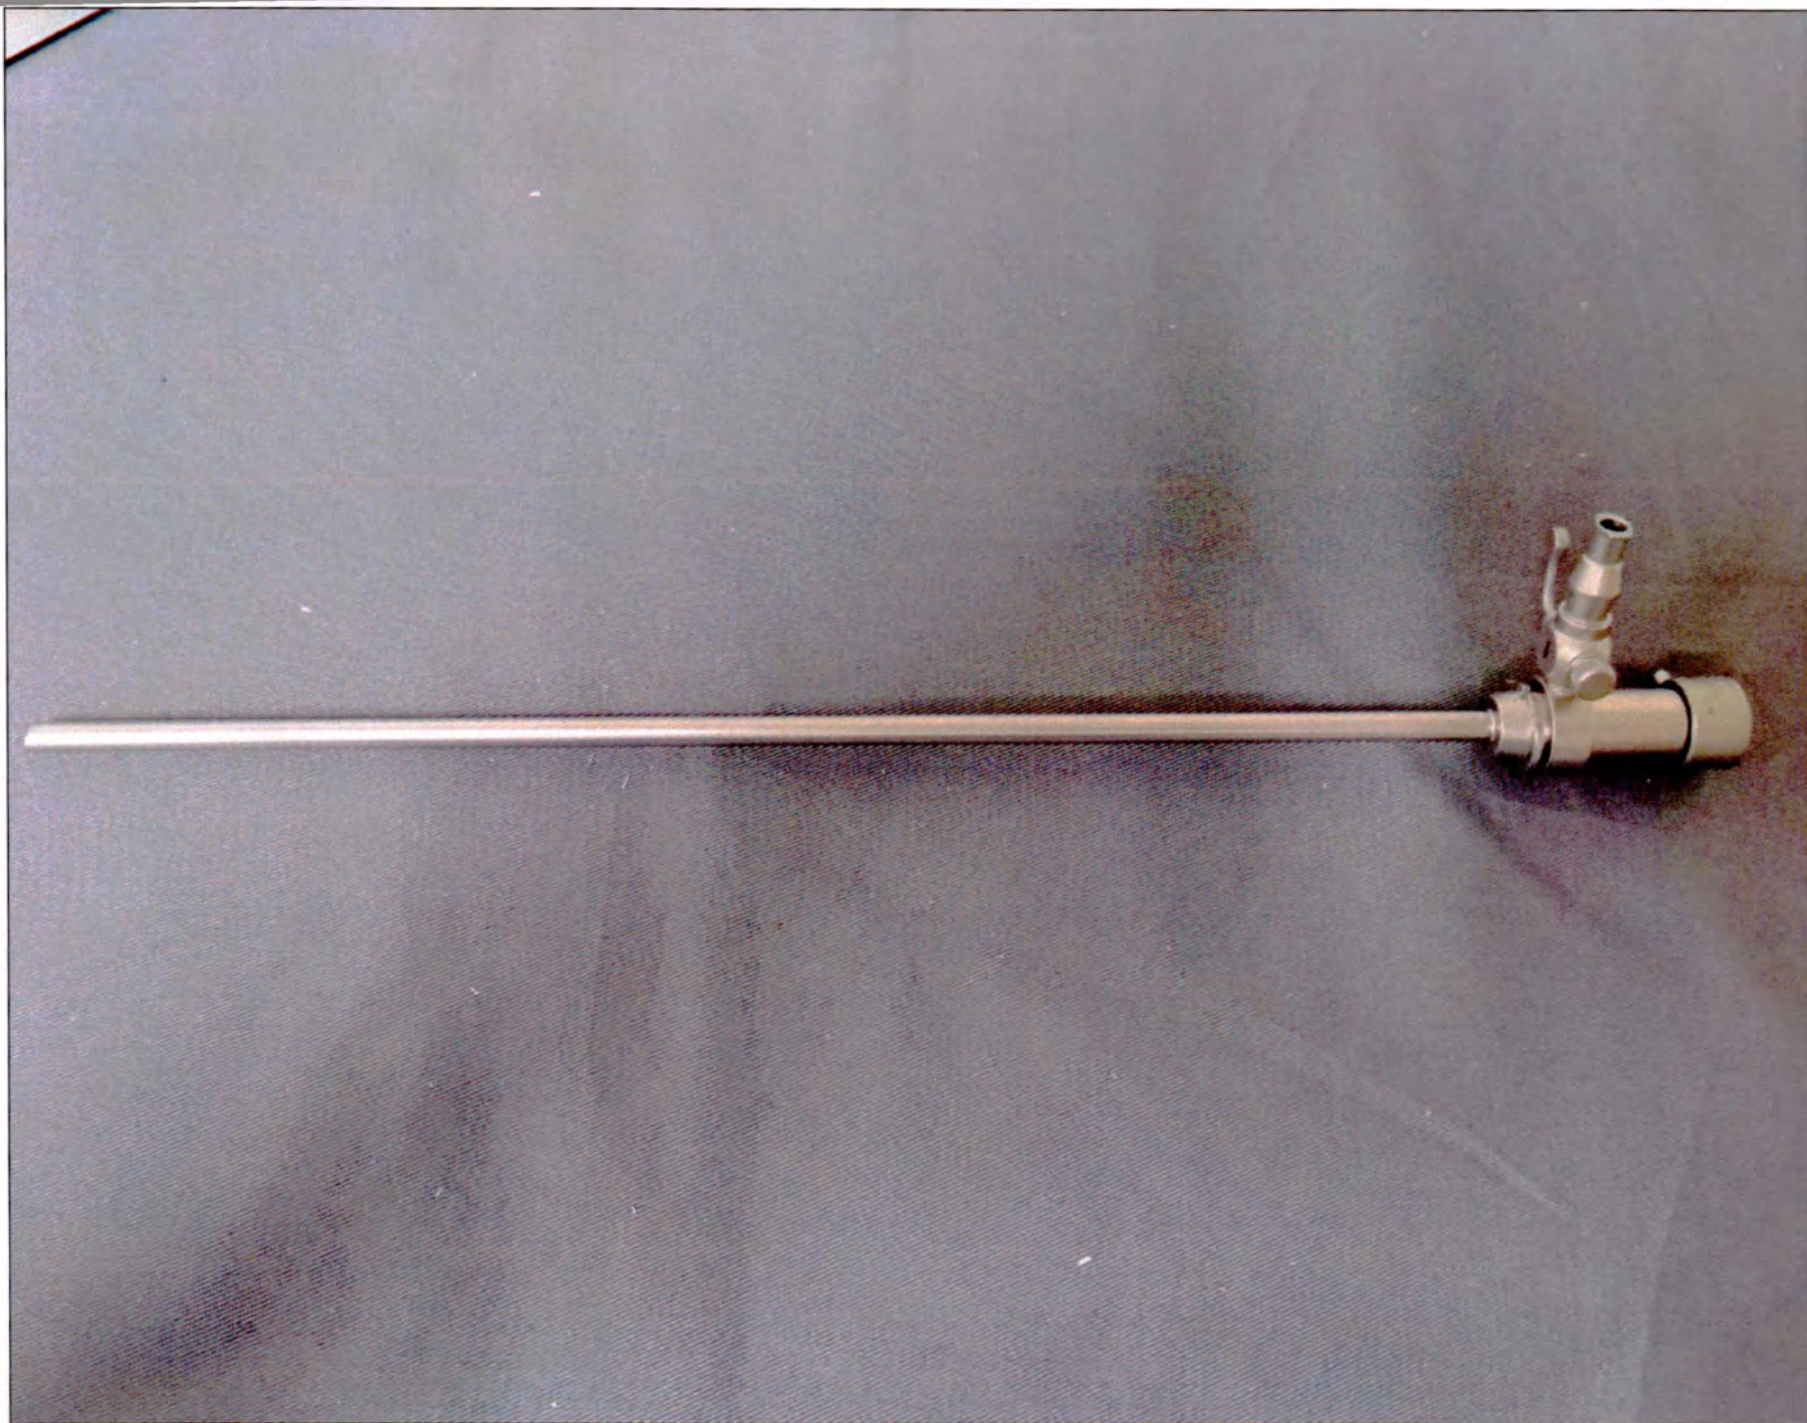


Рис. 33. Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внутренний, диаметр 5,2 мм, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внутренний, диаметр 2,8 мм, с одним краном, Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внутренний, диаметр 3,8 мм, с одним краном

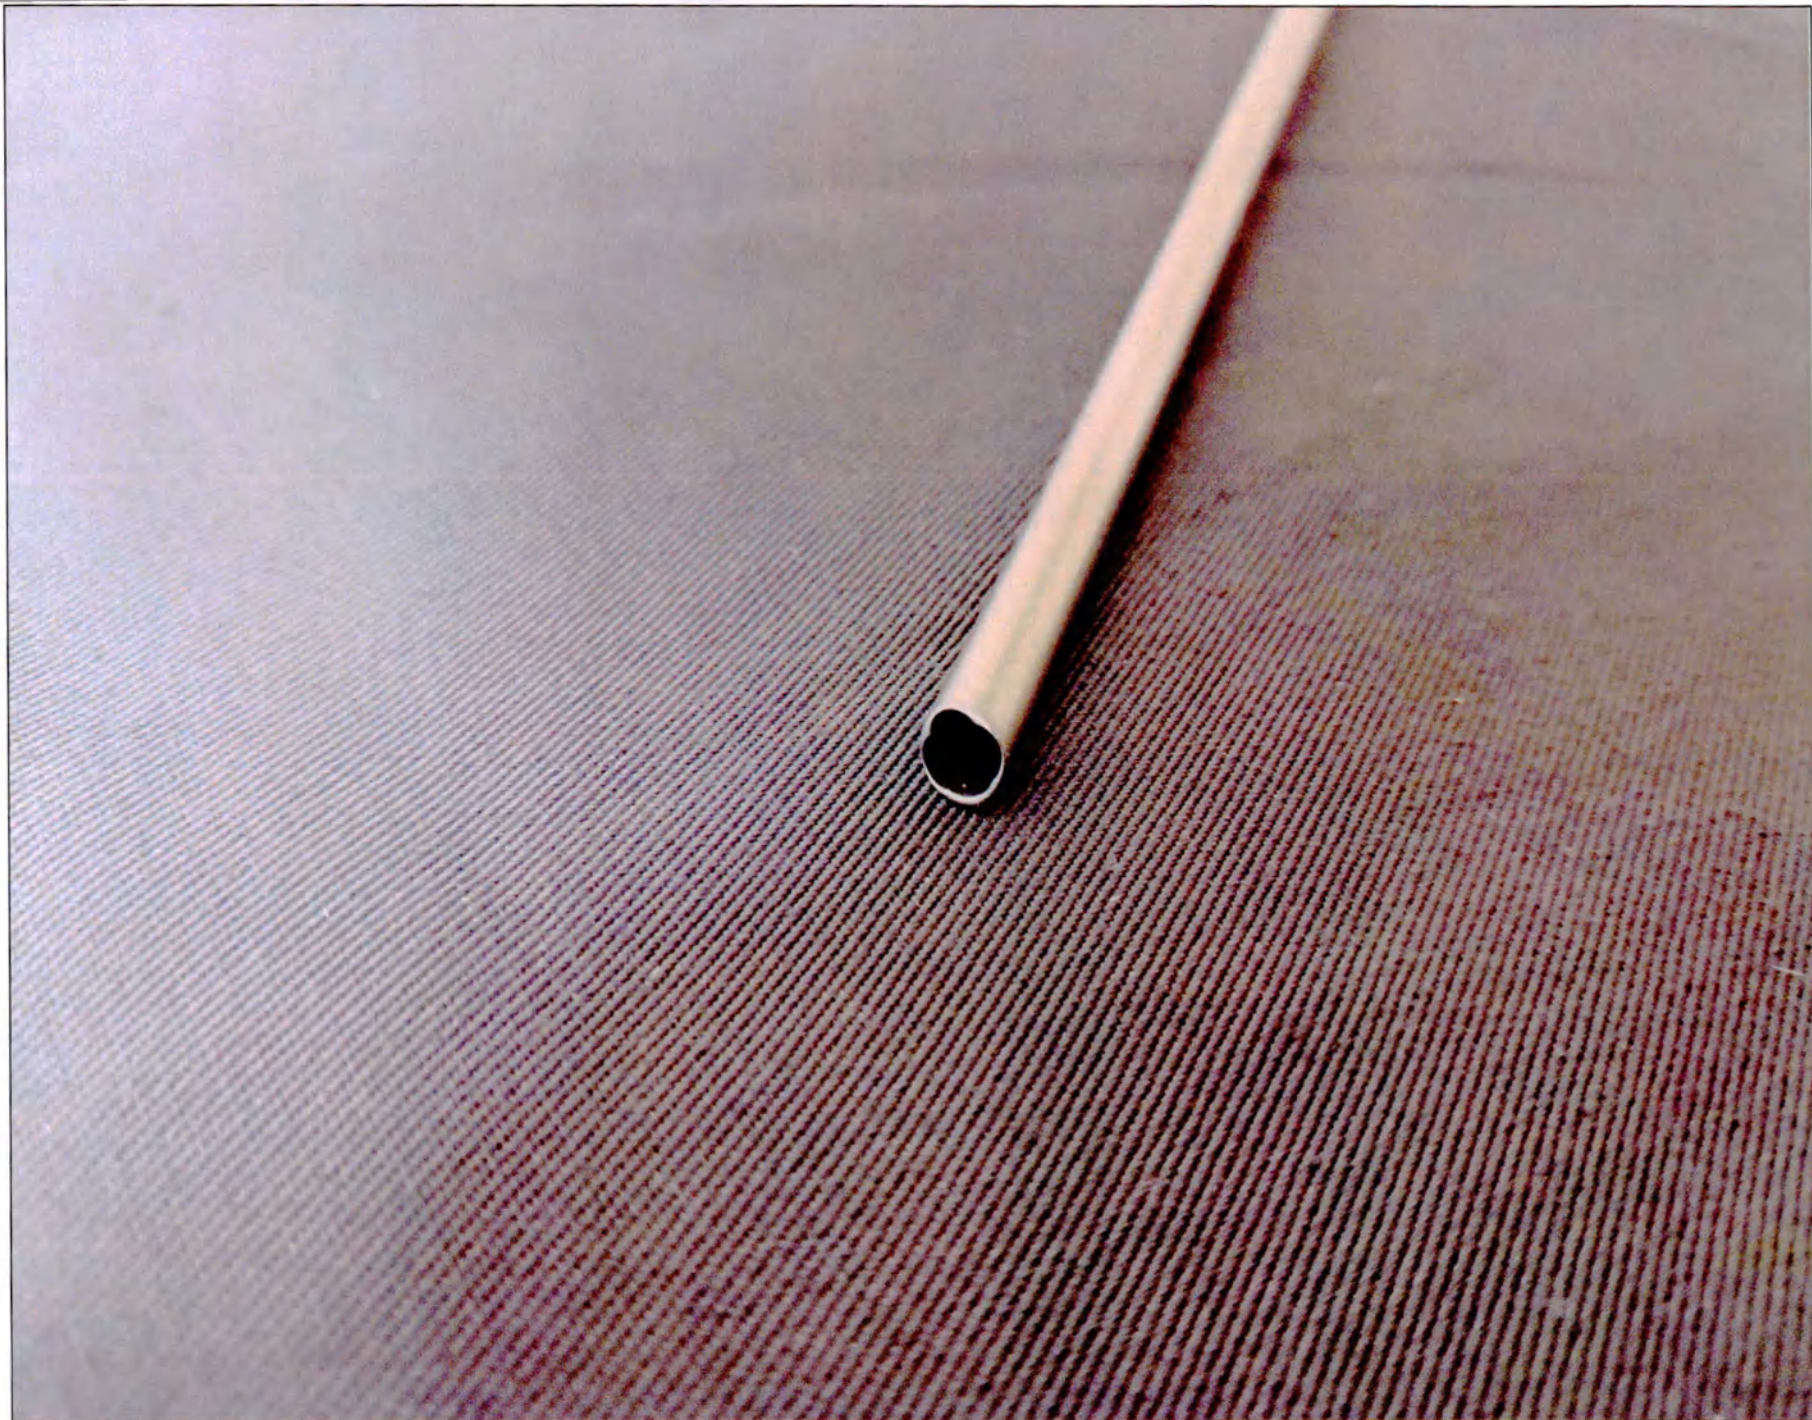


Рис. 34. Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внутренний, диаметр 5,2 мм, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внутренний, диаметр 2,8 мм, с одним краном, Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внутренний, диаметр 3,8 мм, с одним краном



Рис. 35. Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внутренний, диаметр 5,2 мм, с одним краном. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внутренний, диаметр 2,8 мм, с одним краном, Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, внутренний, диаметр 3,8 мм, с одним краном

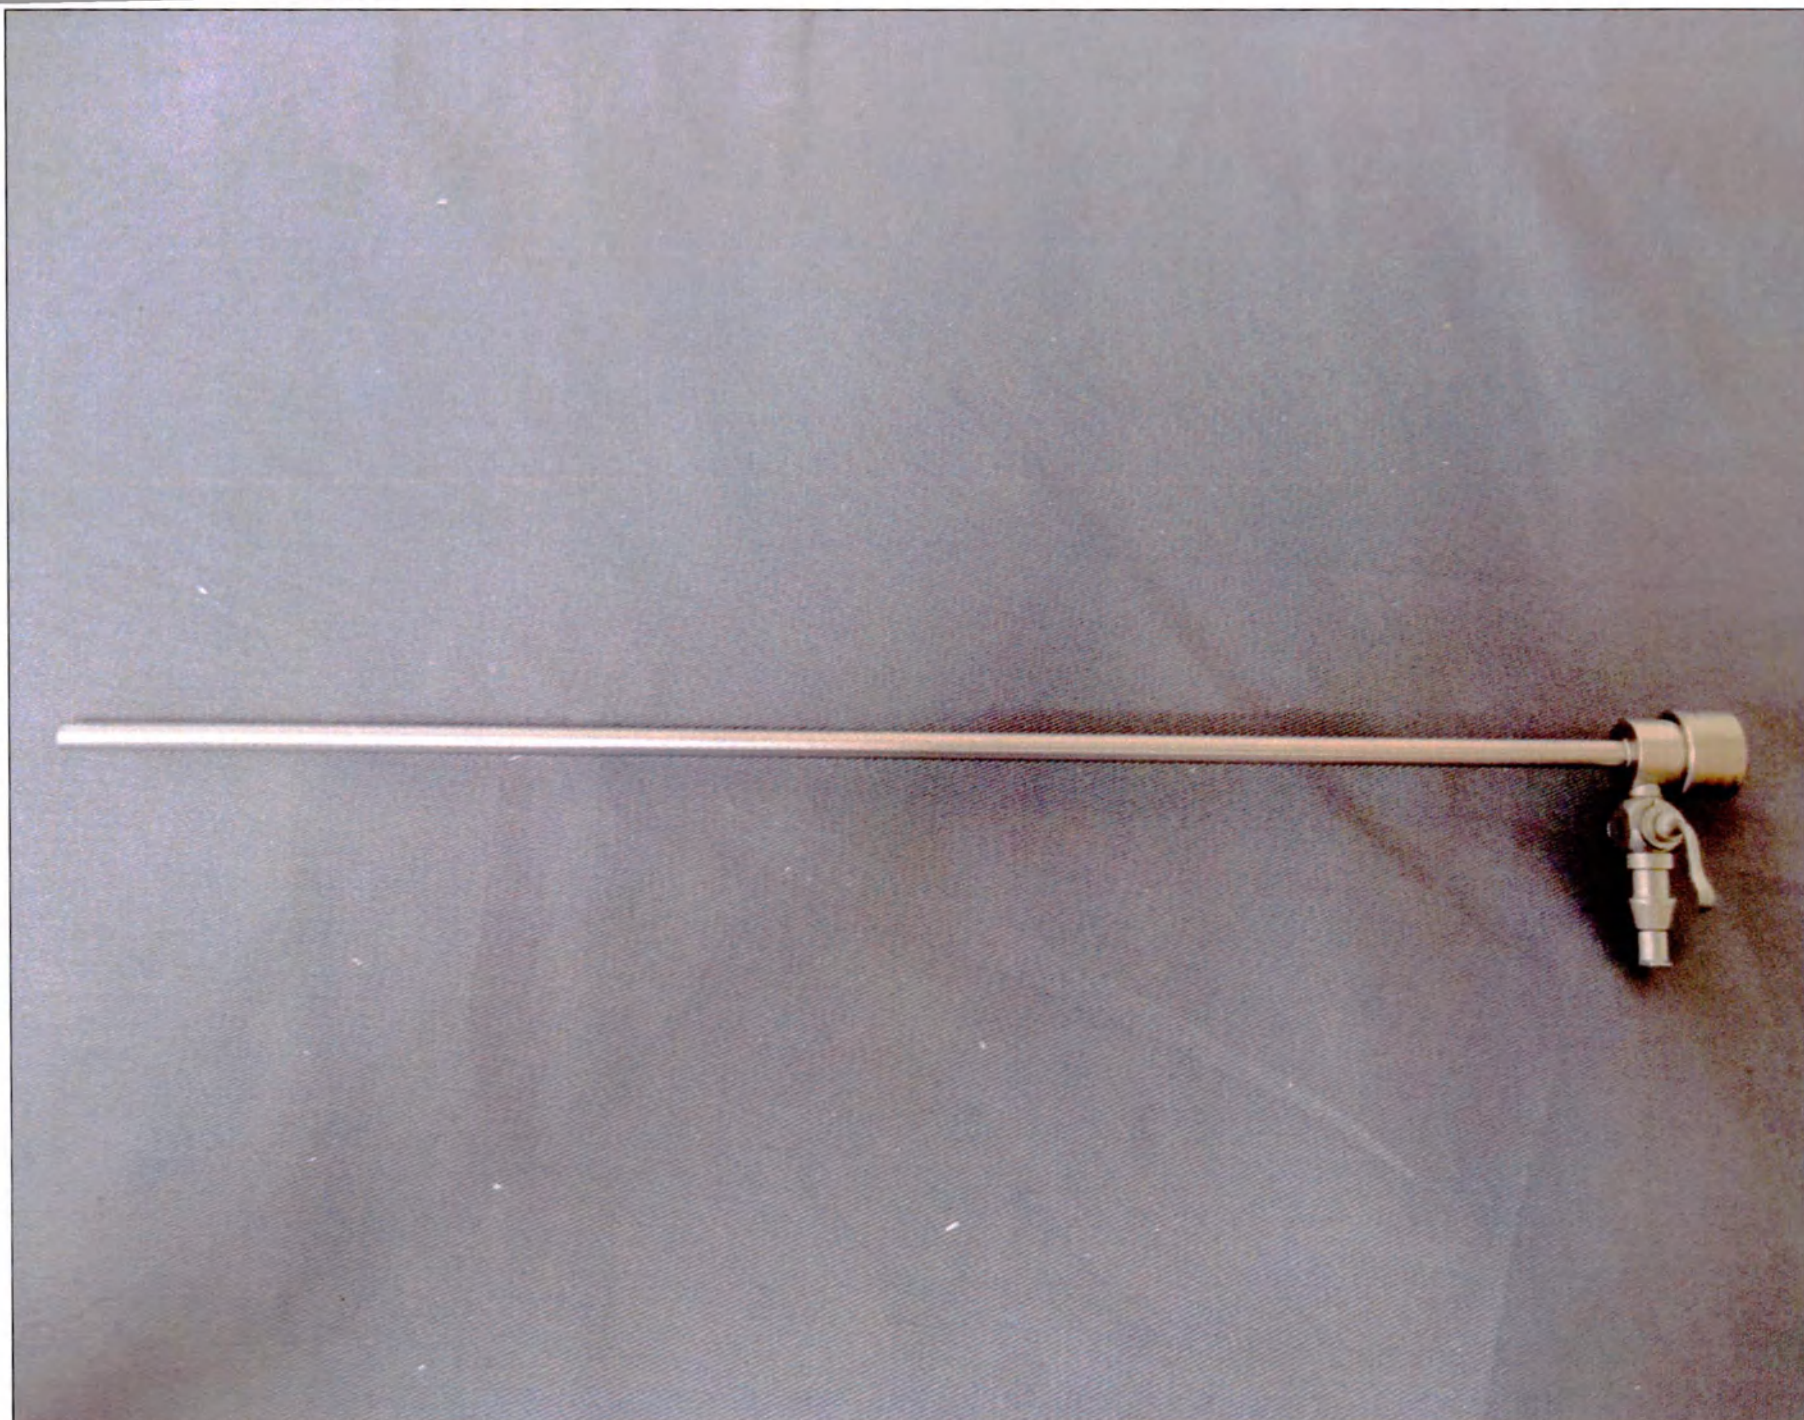


Рис. 36. Тубус диагностического гистероскопа, диаметр 5,1 мм, с одним краном. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Тубус диагностического гистероскопа, диаметр 4,1 мм, с одним краном

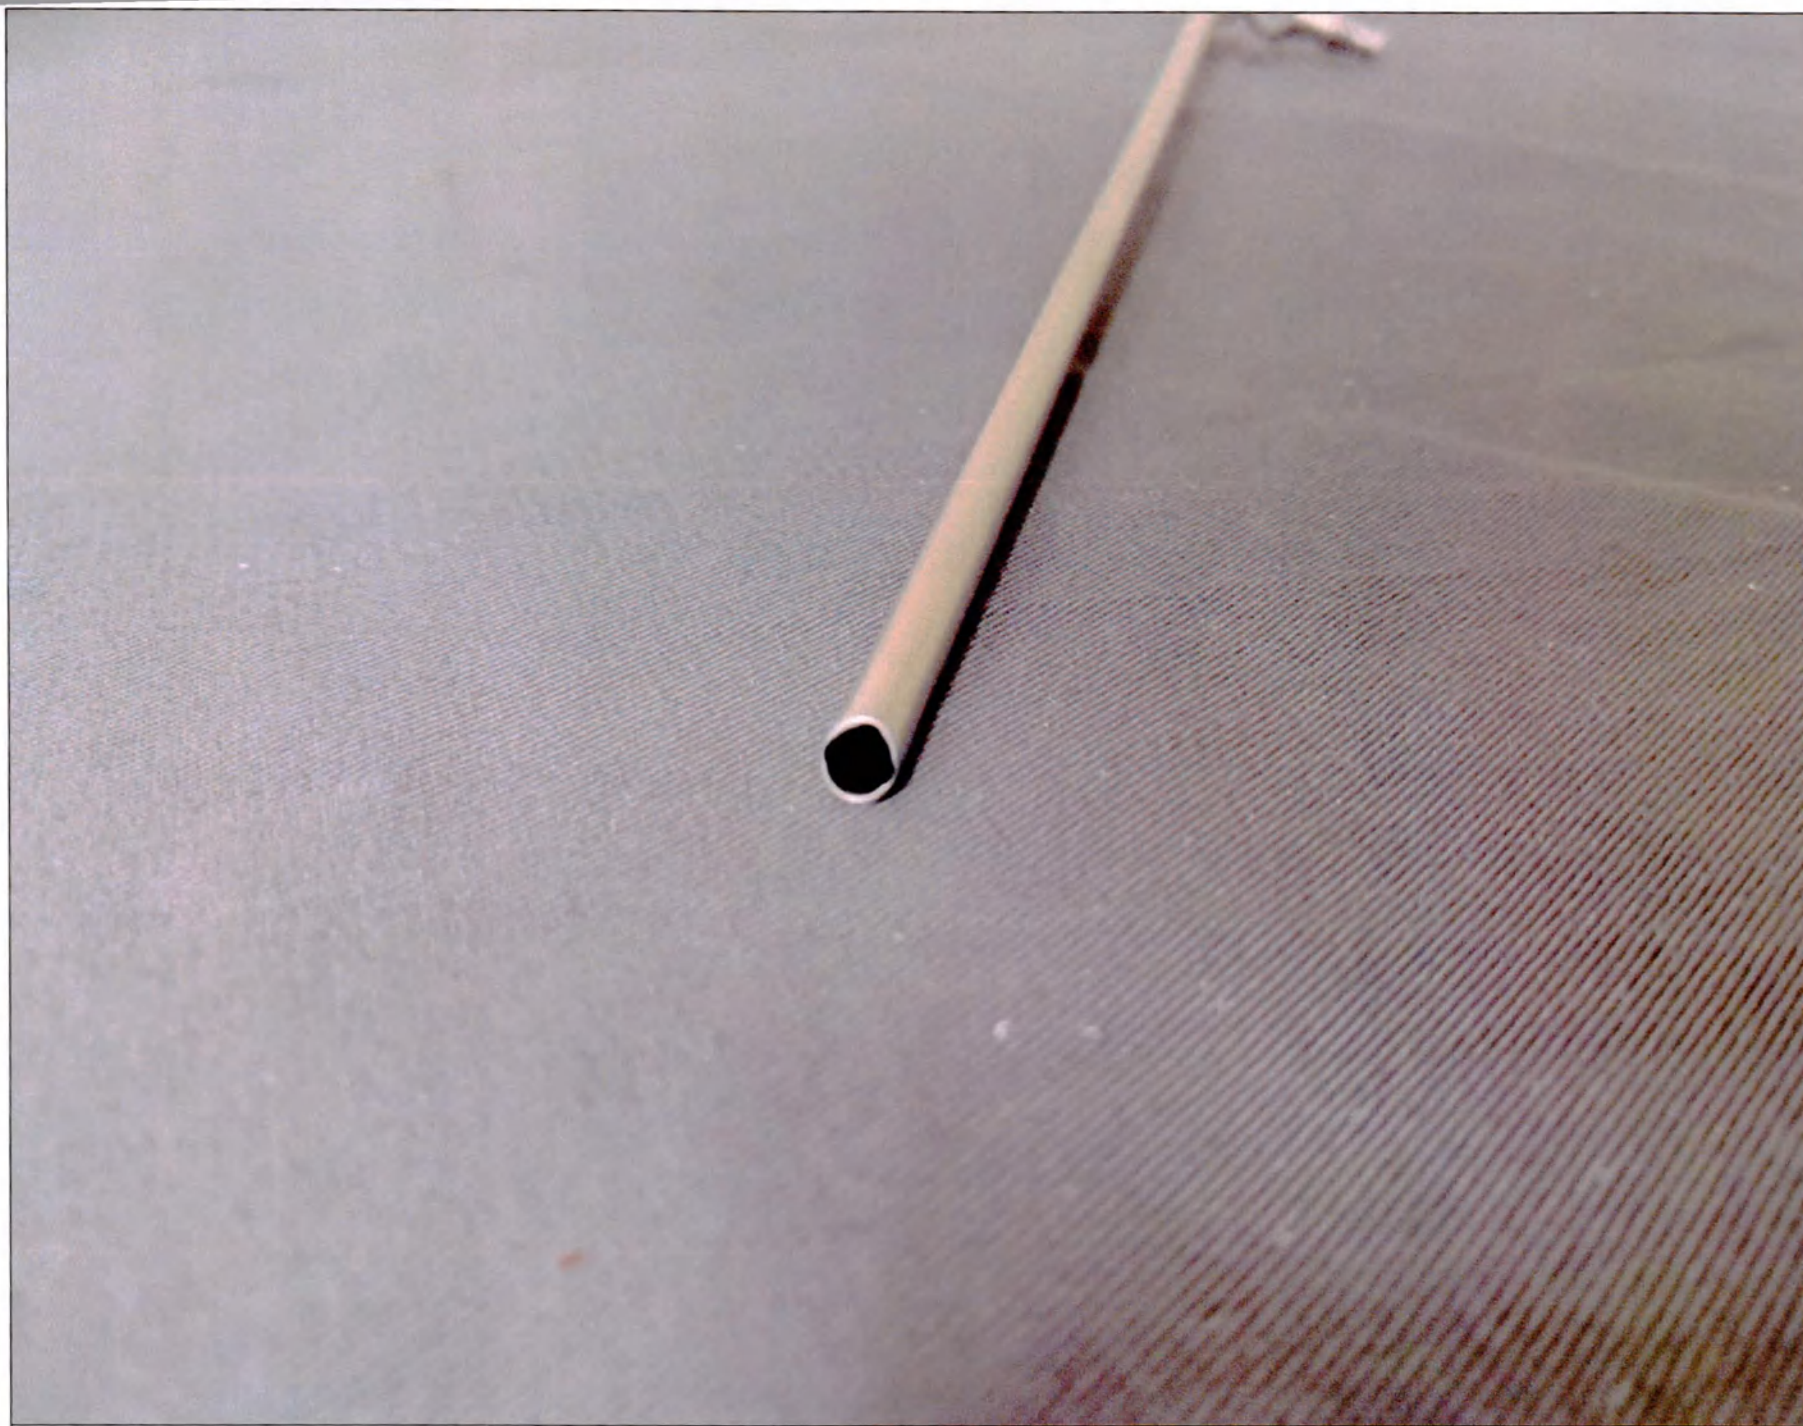


Рис. 37. Тубус диагностического гистероскопа, диаметр 5,1 мм, с одним краном. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Тубус диагностического гистероскопа, диаметр 4,1 мм, с одним краном

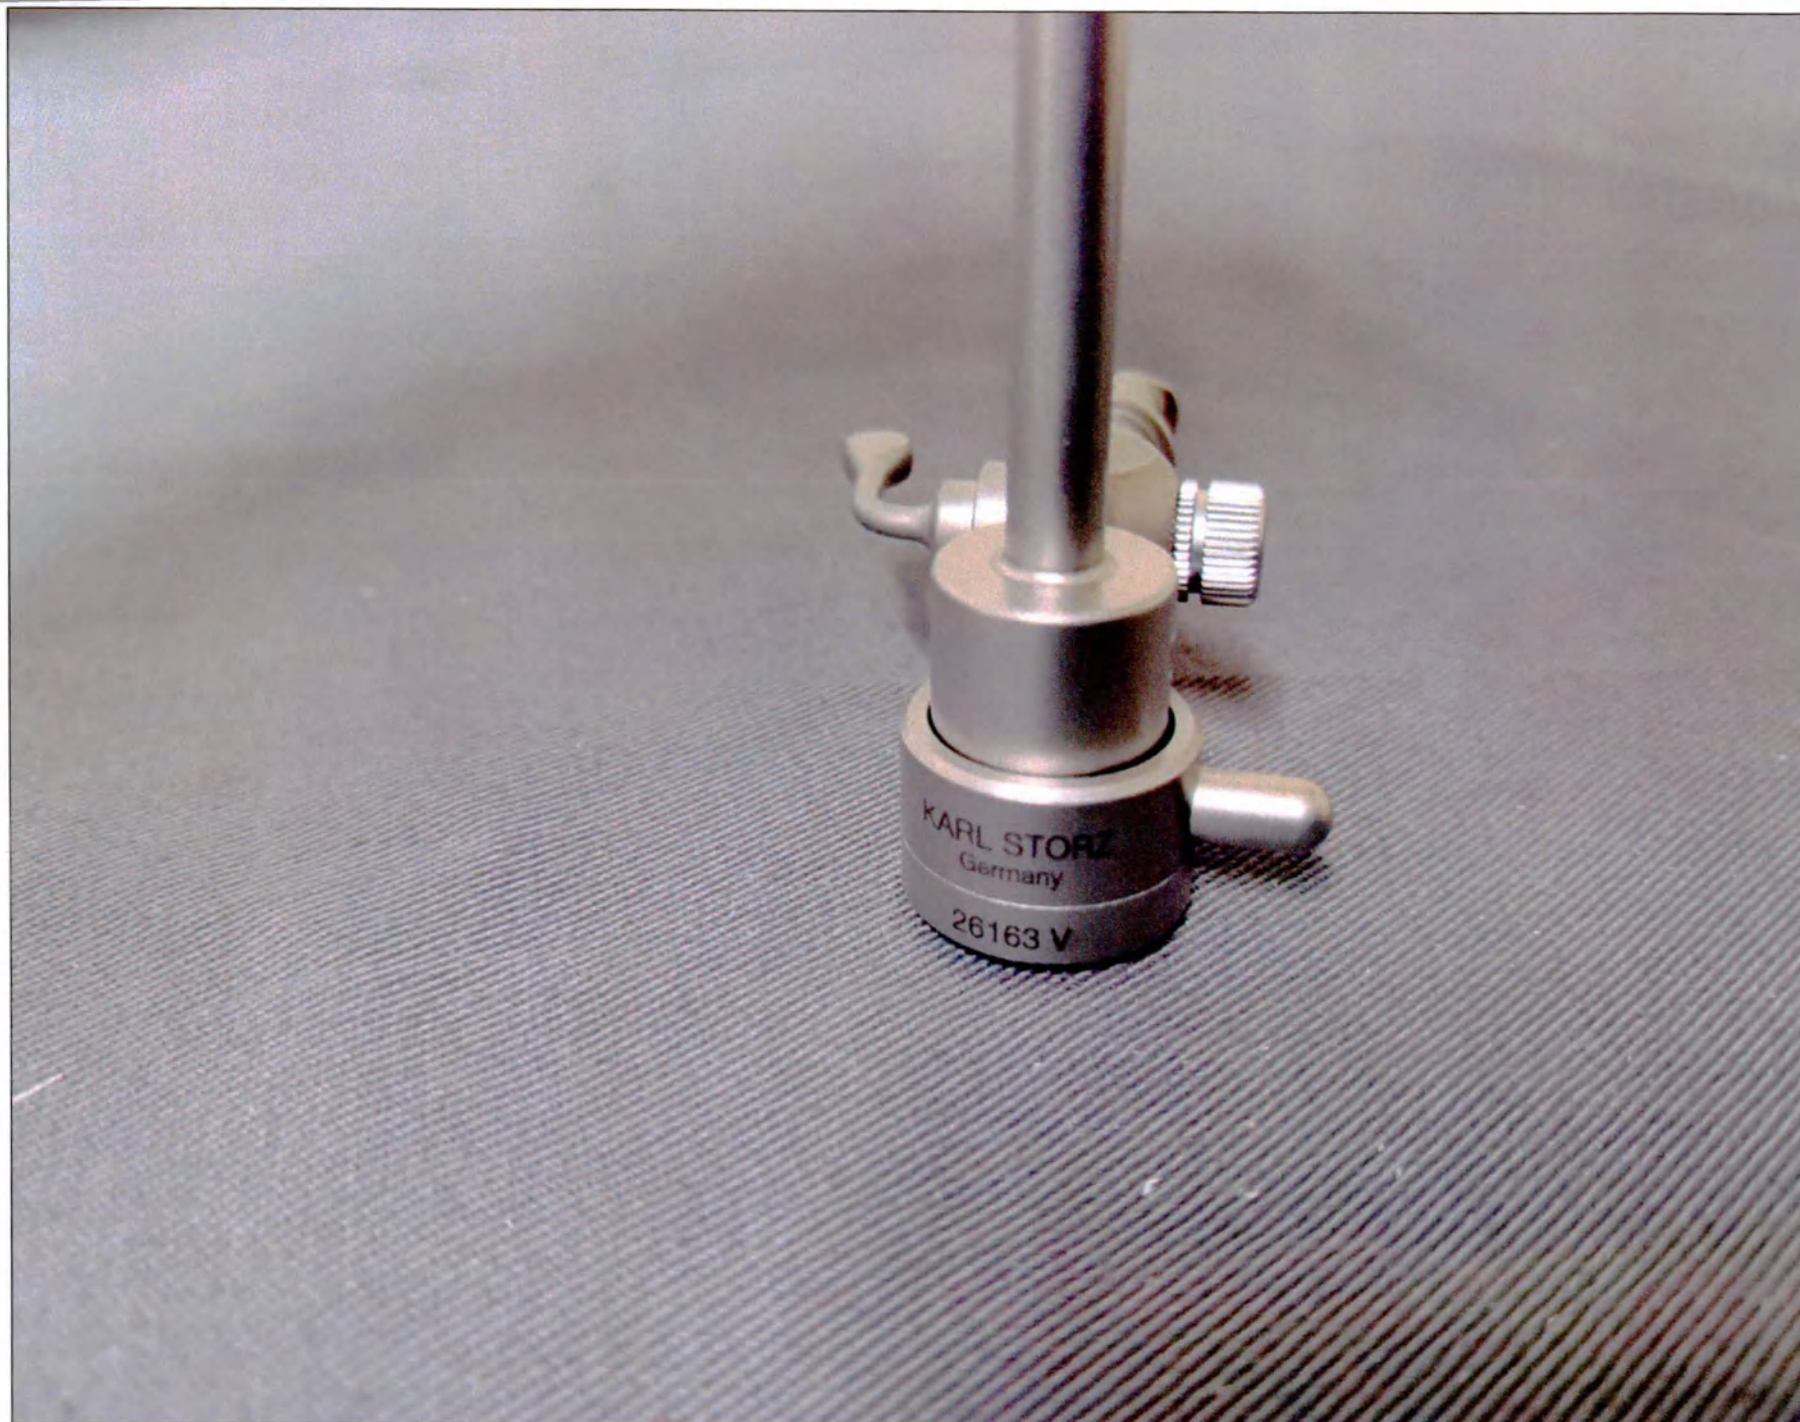


Рис. 38. Тубус диагностического гистероскопа, диаметр 5,1 мм, с одним краном. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом: Тубус диагностического гистероскопа, диаметр 4,1 мм, с одним краном

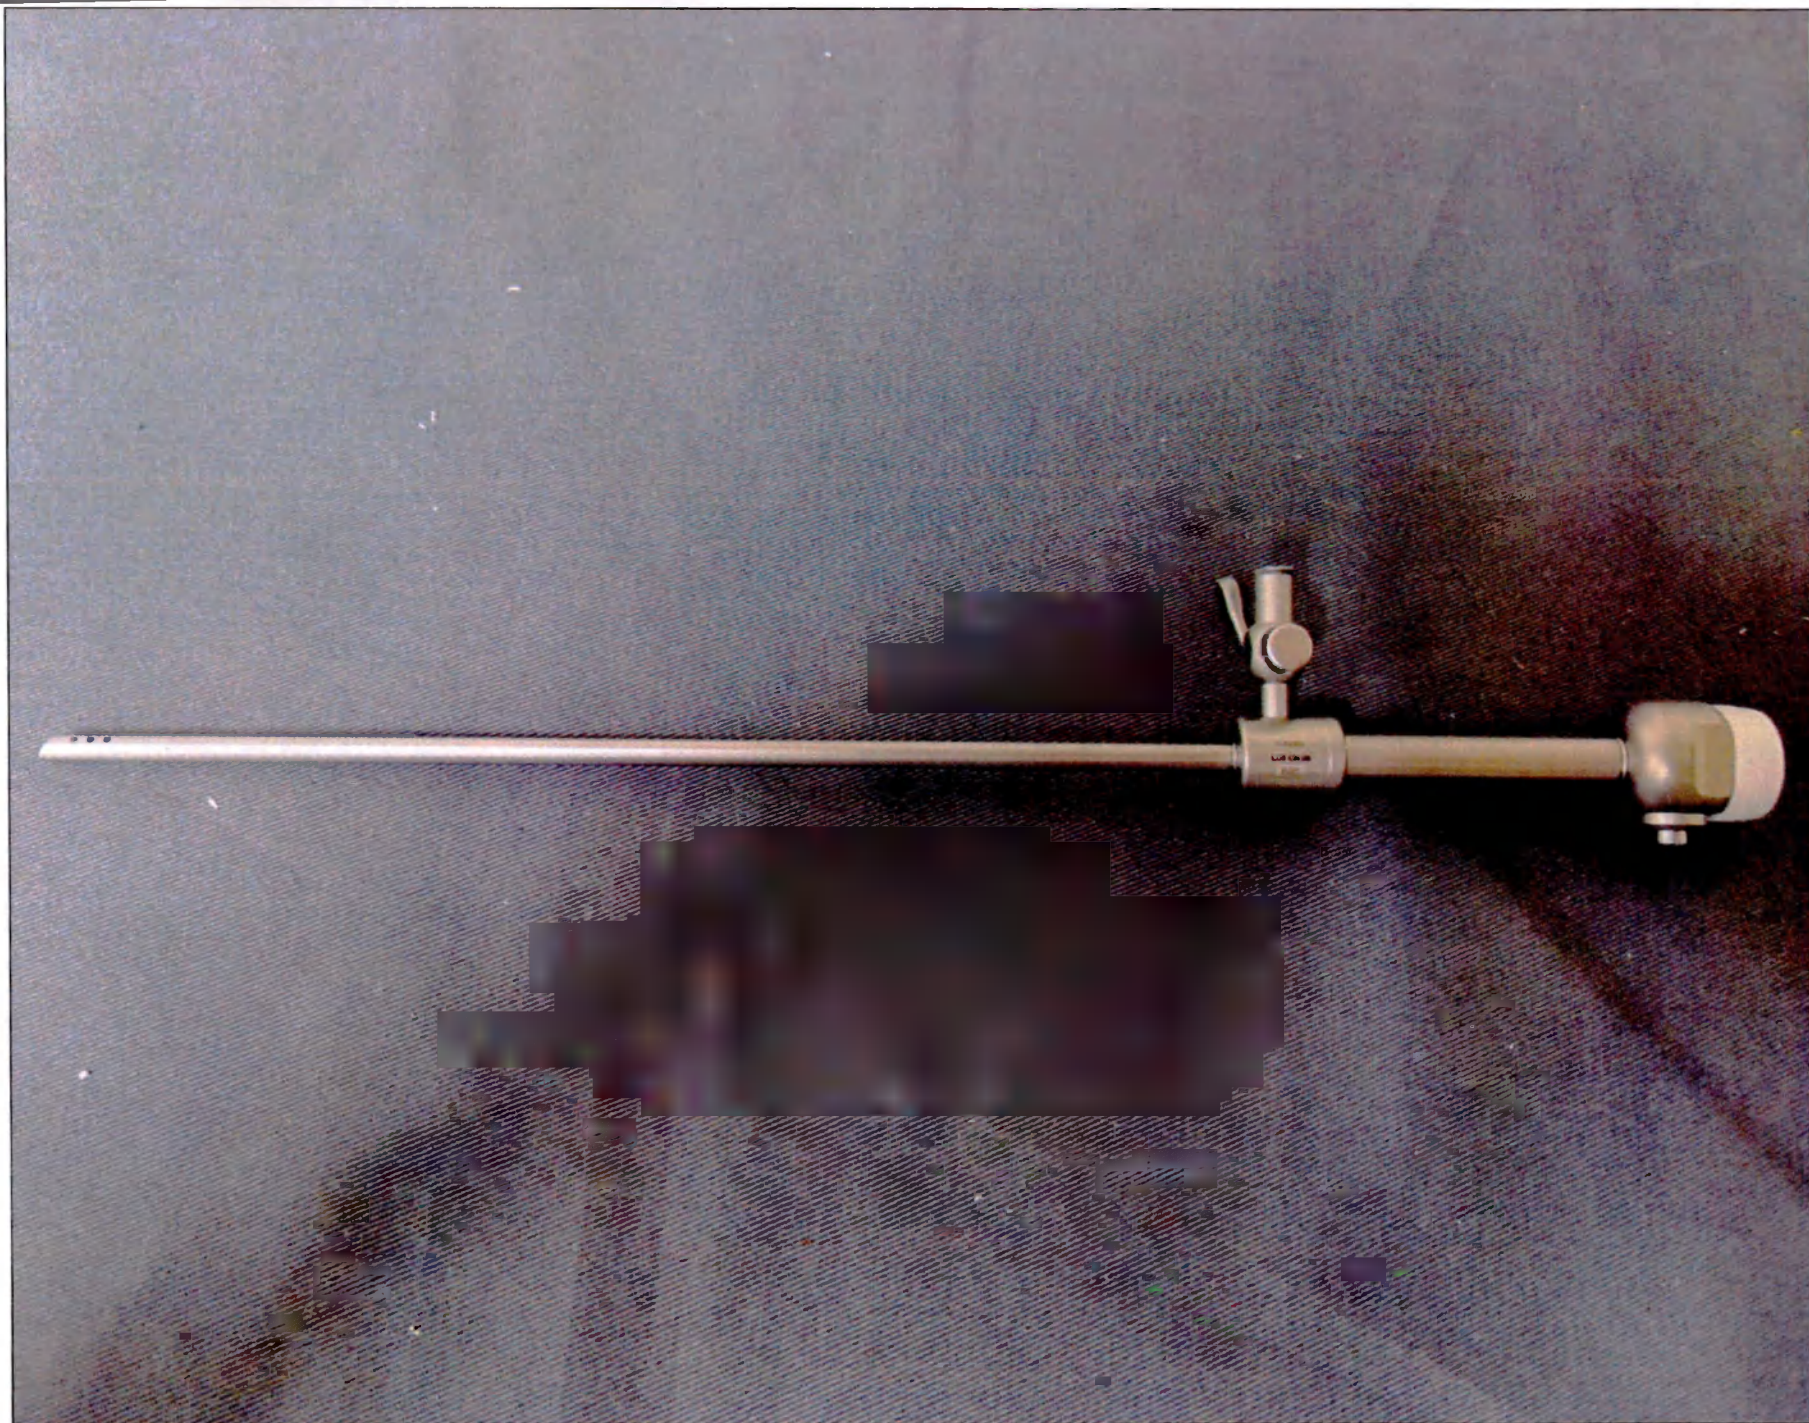


Рис. 39. Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, размер 3,7 мм, длина 18 см.

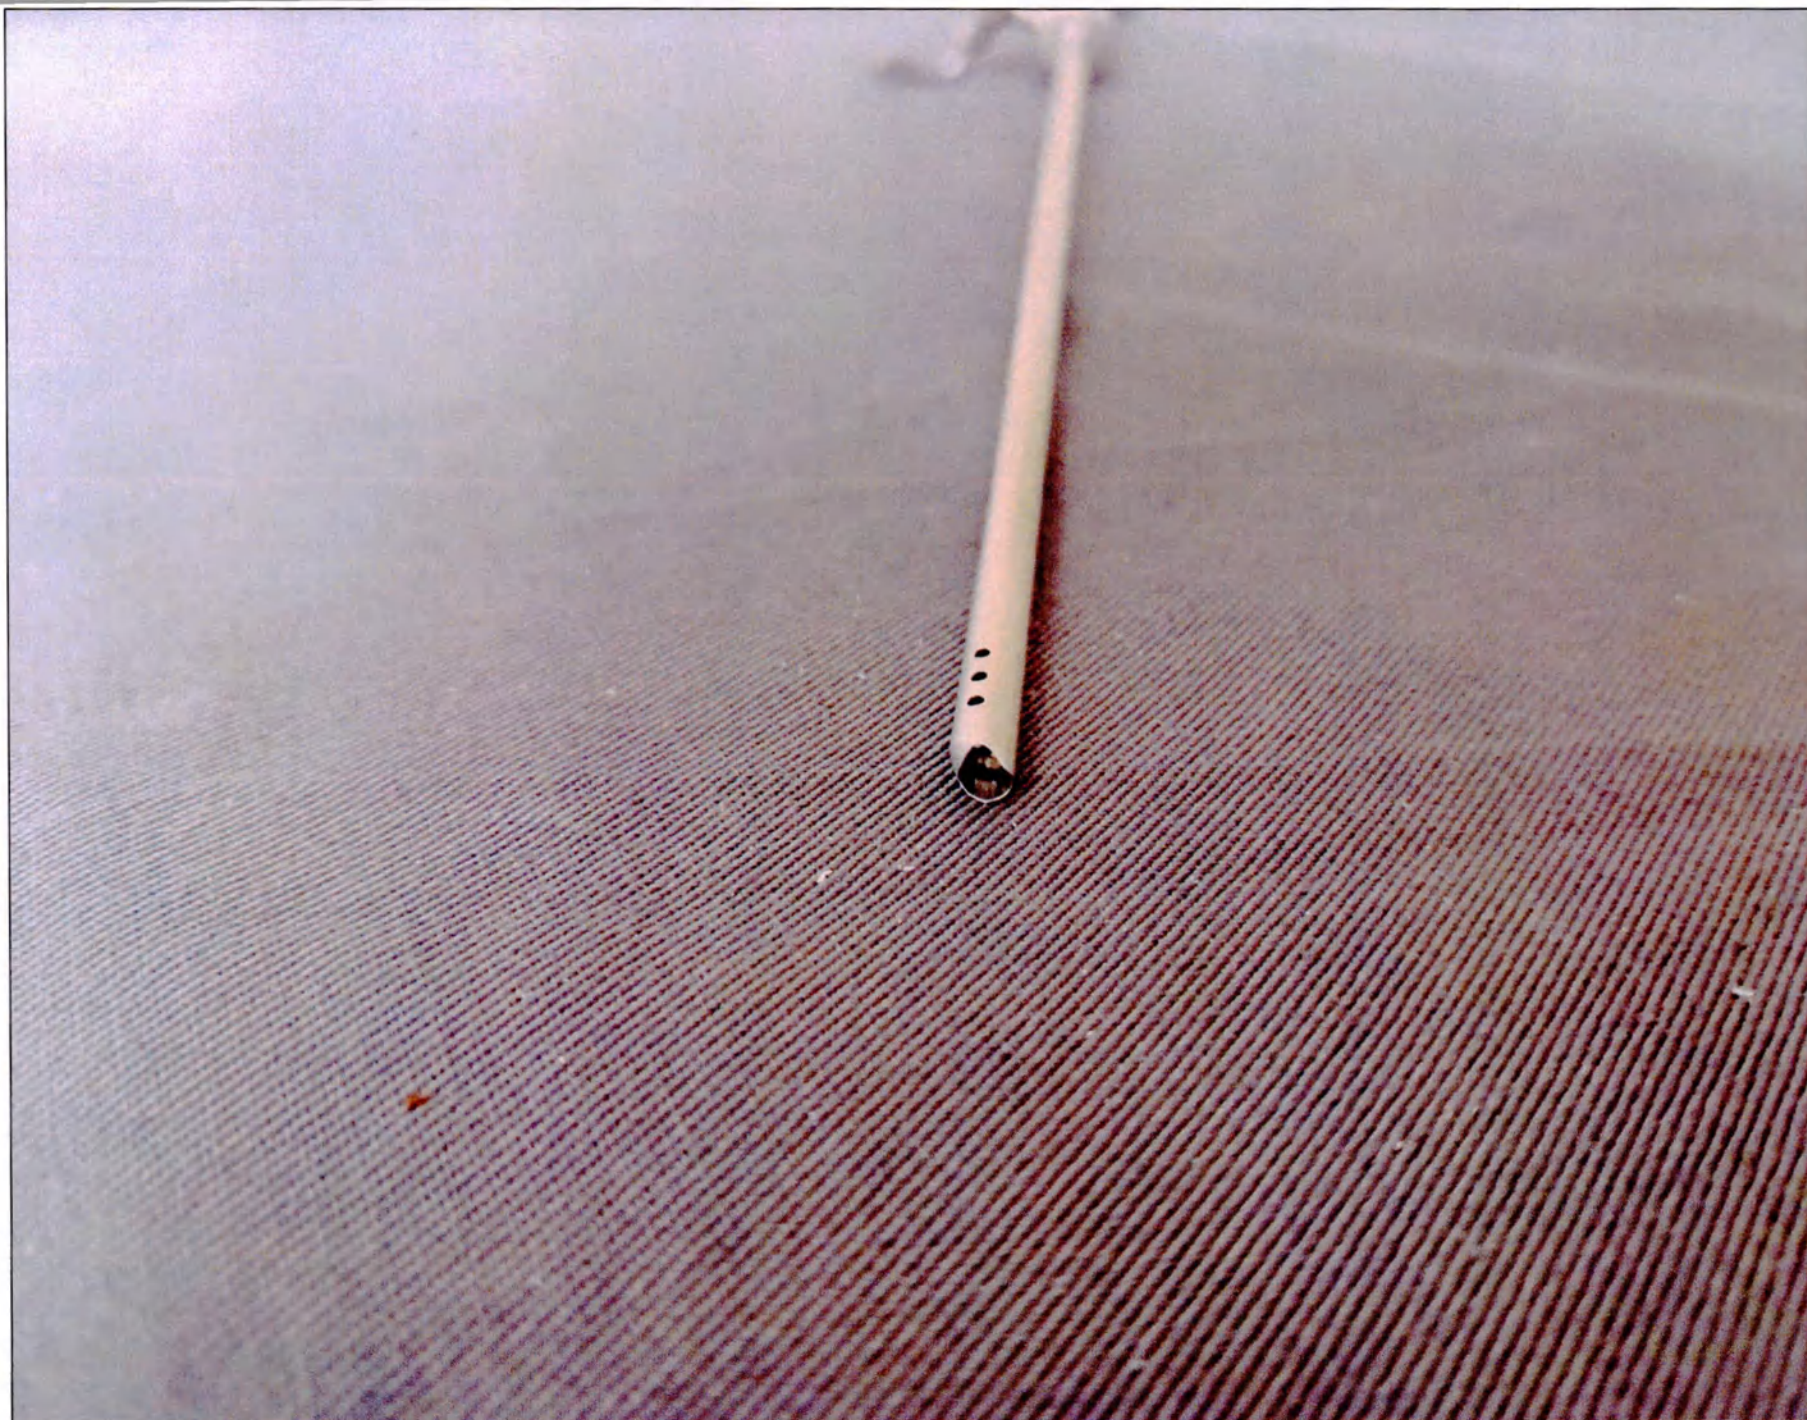


Рис. 40. Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, размер 3,7 мм, длина 18 см.

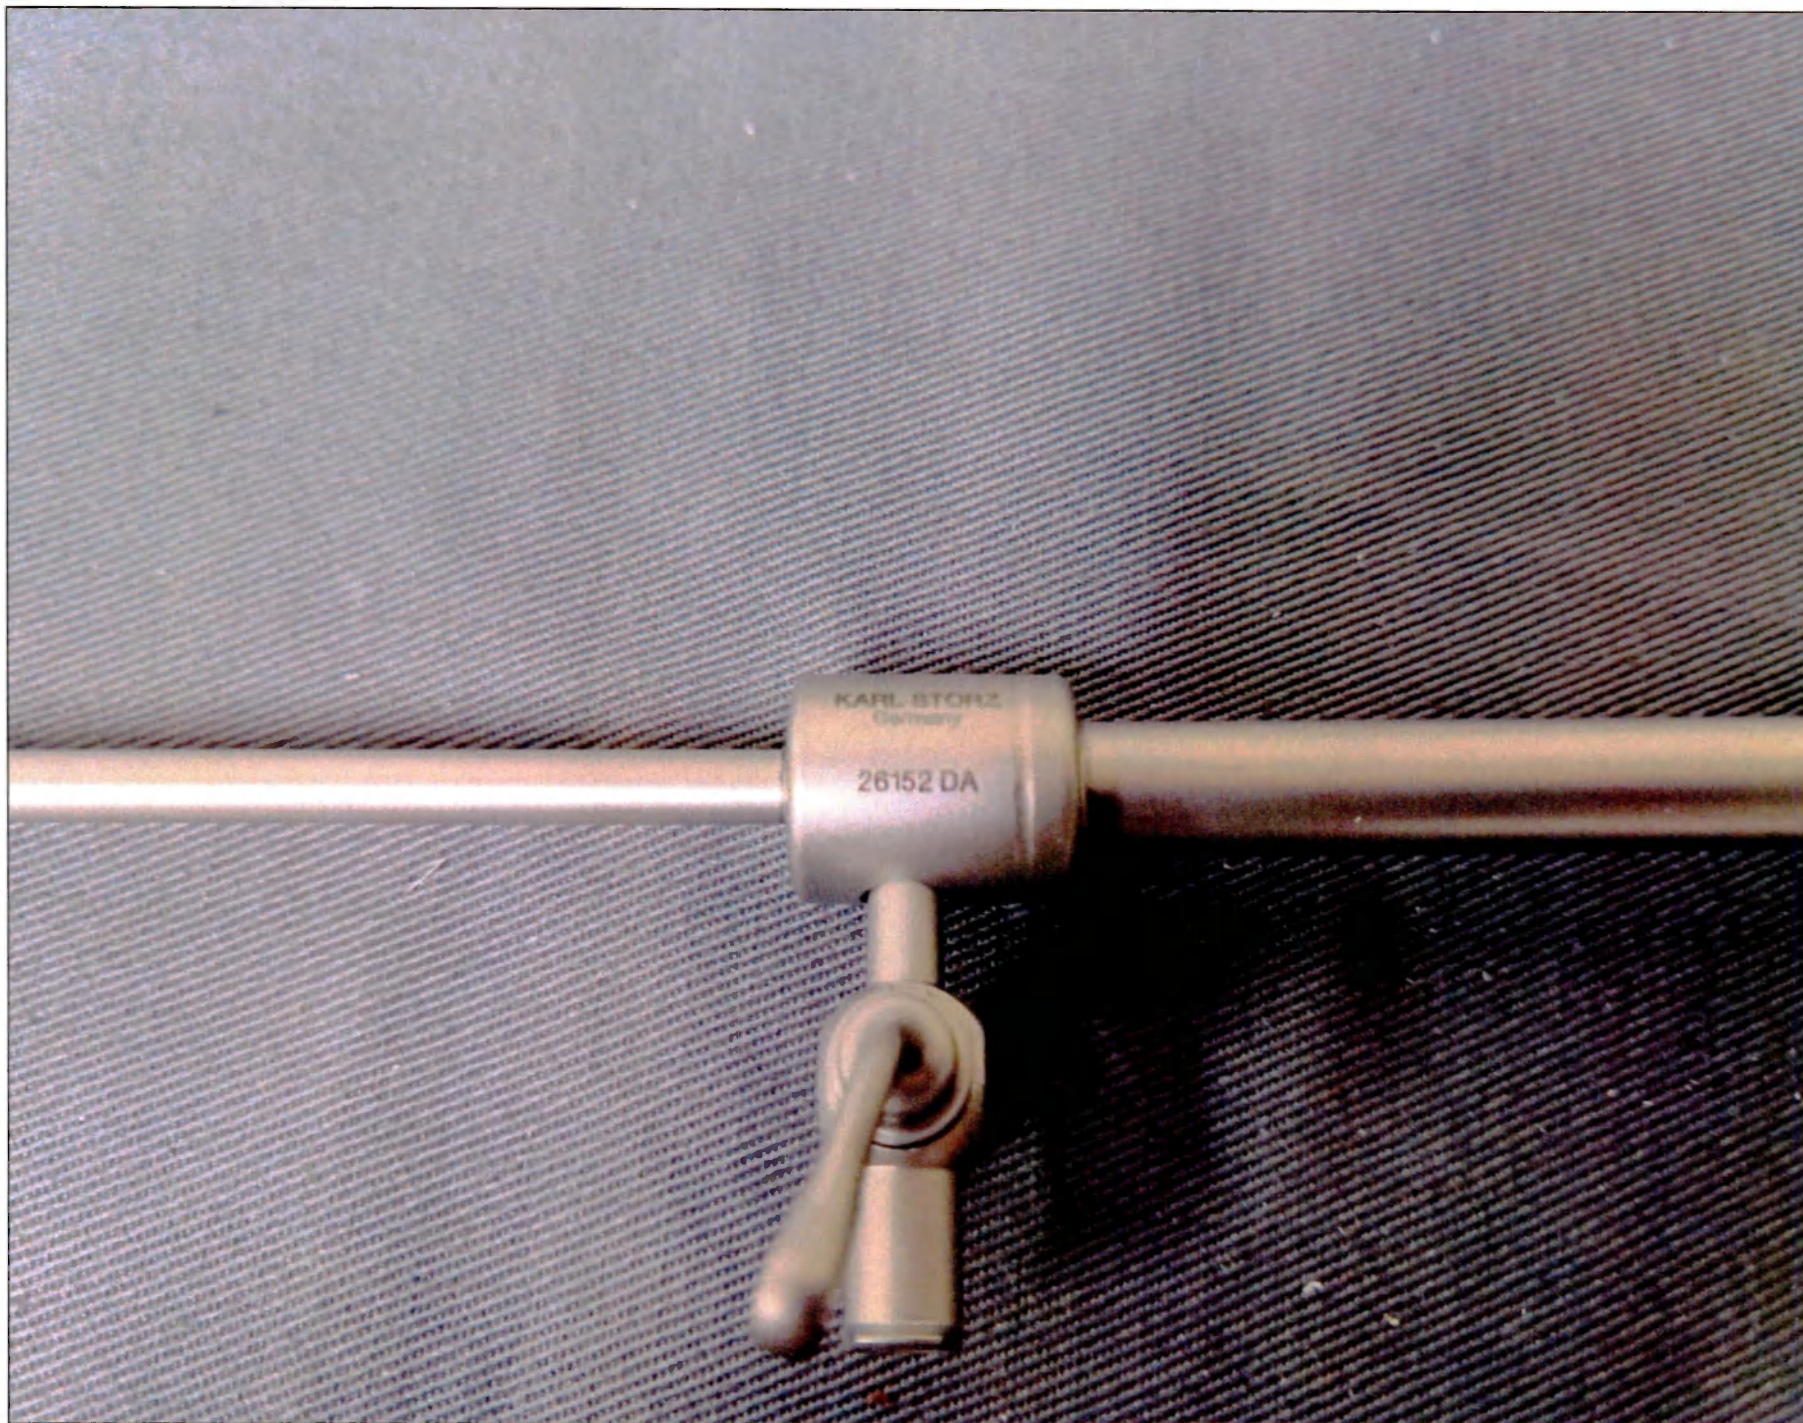


Рис. 41. Тубус диагностического гистероскопа, для постоянного промывания, размер 3,7 мм, длина 18 см.



Рис. 42. Тубус операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 6,2 мм, длина 16 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 5,8 мм, длина 16 см

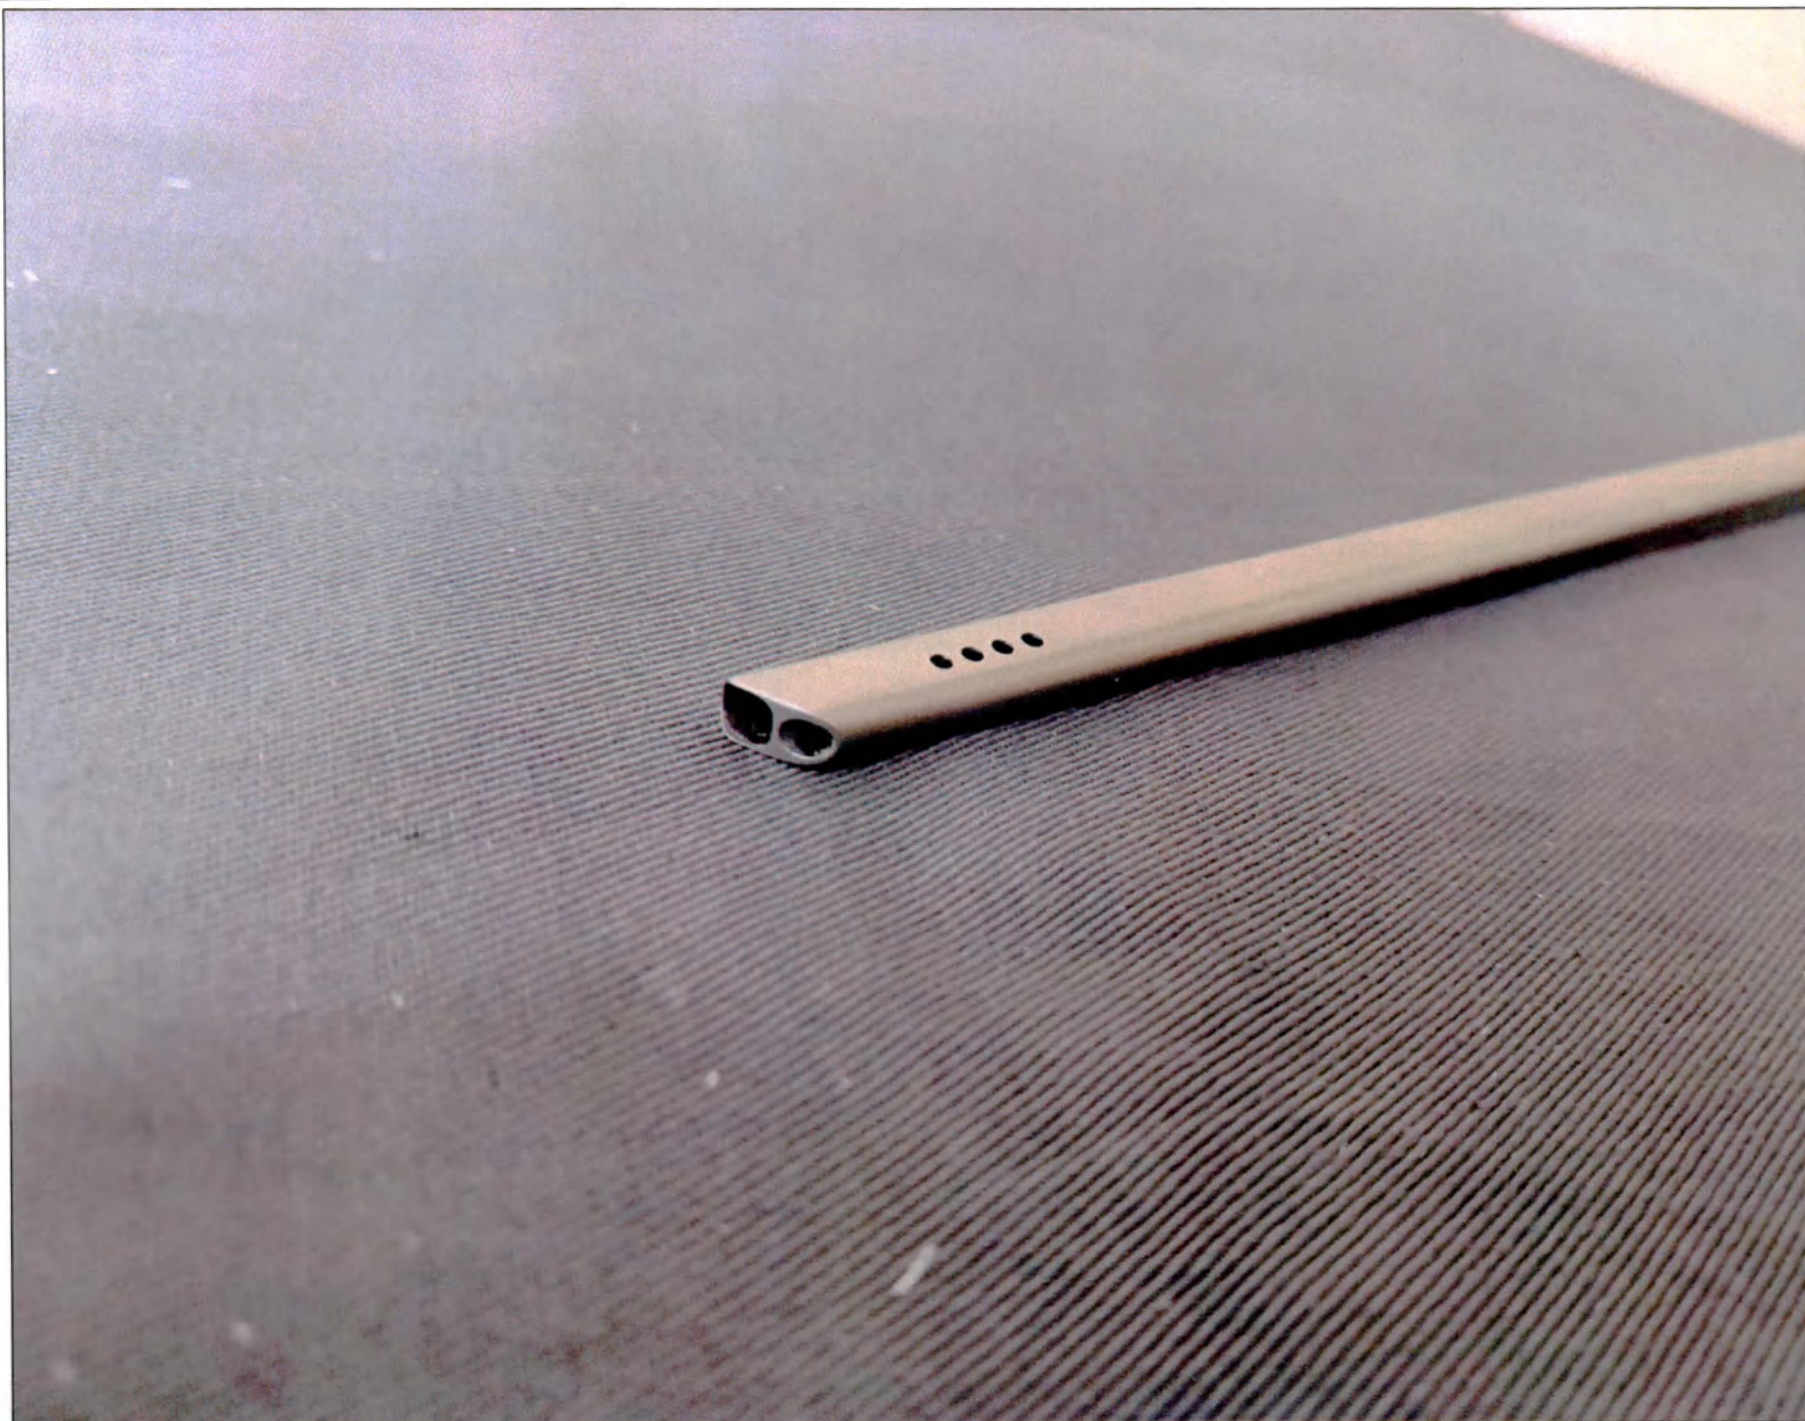


Рис. 43. Тубус операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 6,2 мм, длина 16 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 5,8 мм, длина 16 см

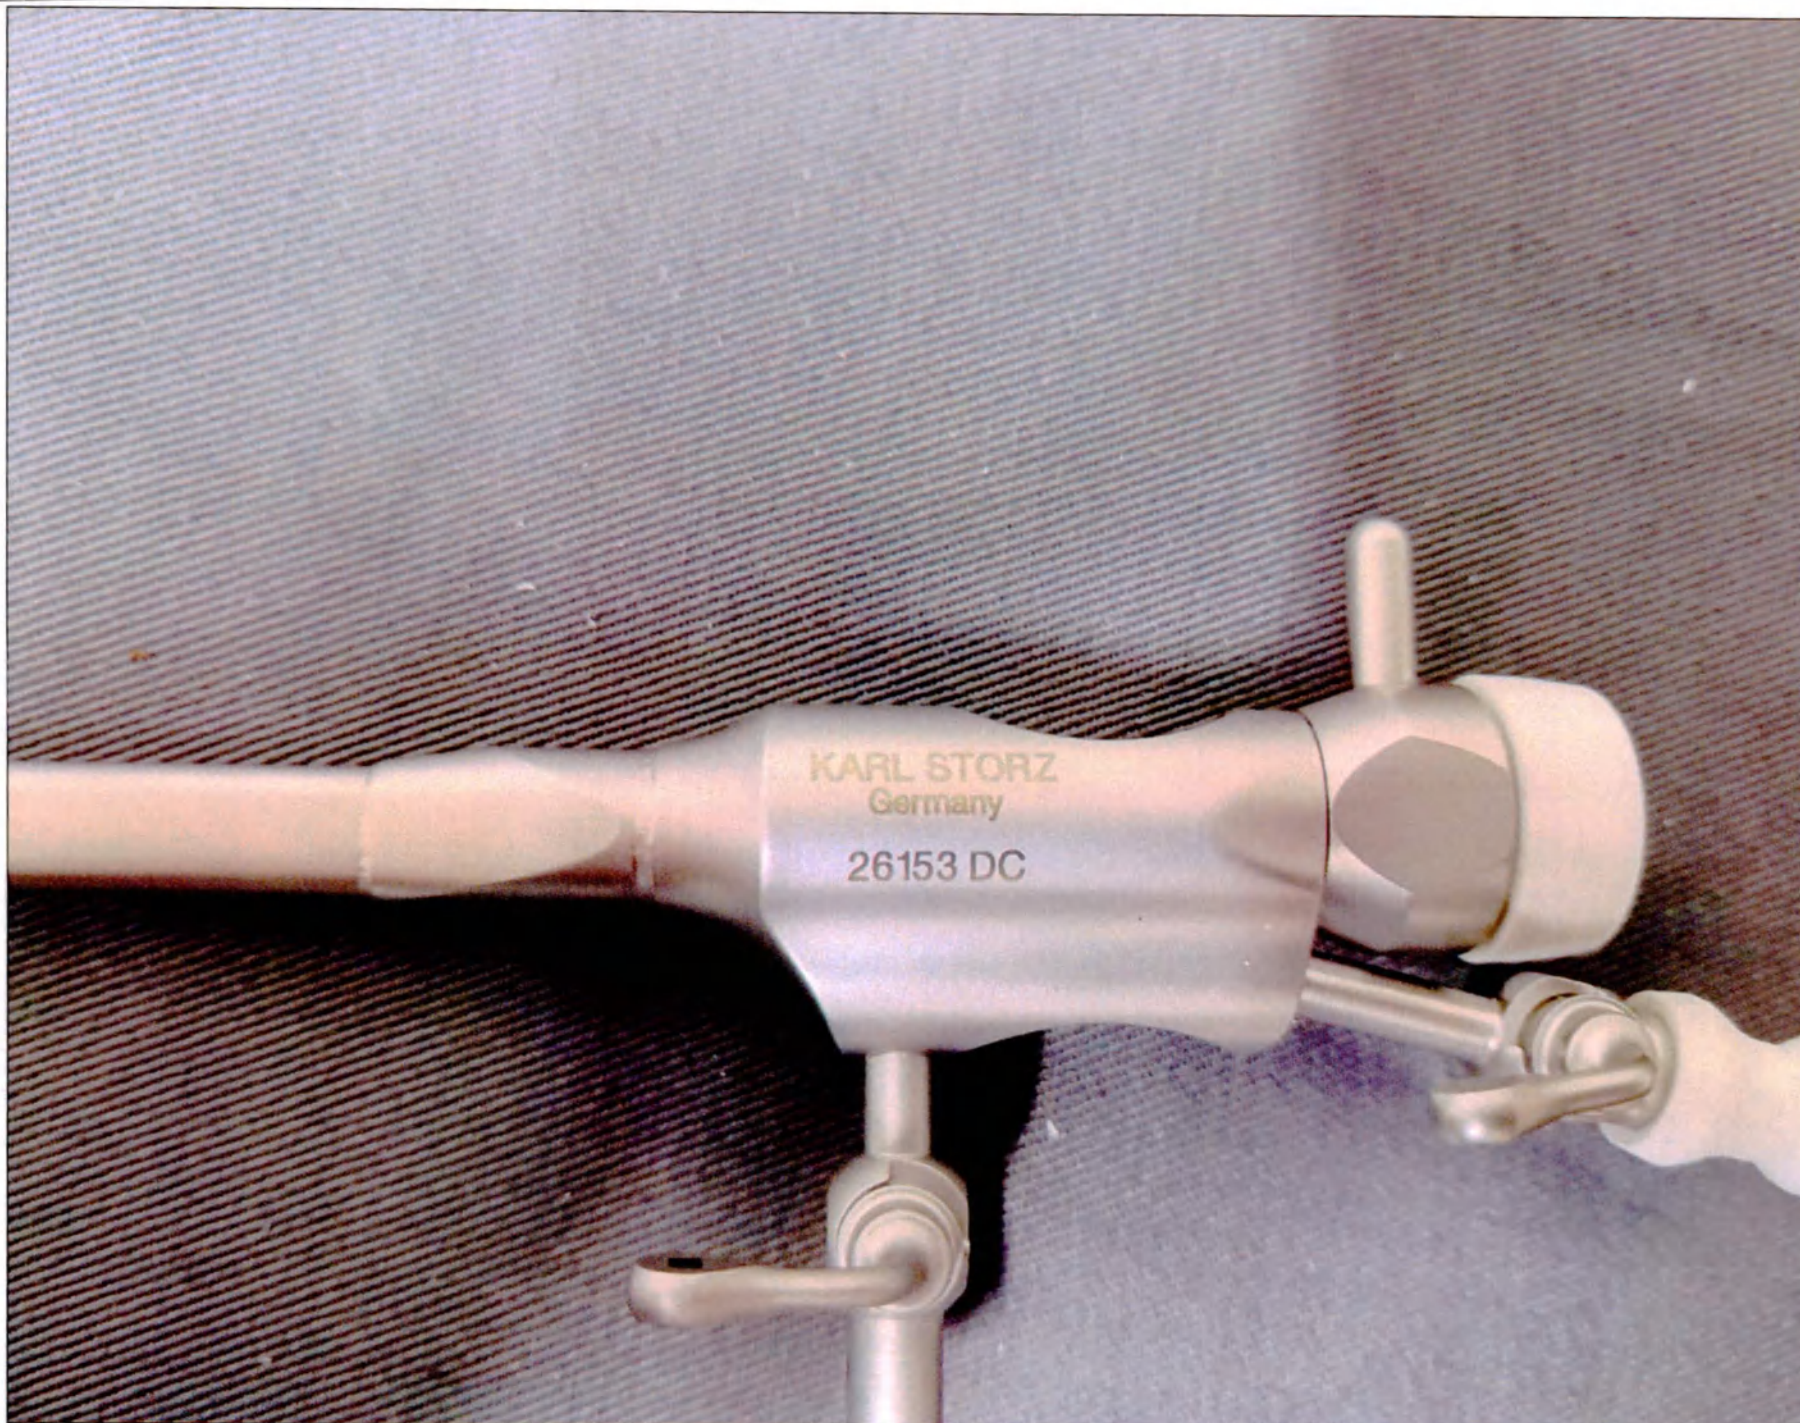


Рис. 44. Тубус операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 6,2 мм, длина 16 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом: Тубус операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 5,8 мм, длина 16 см



Рис. 45. Тубус операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 4,4 мм, длина 16 см

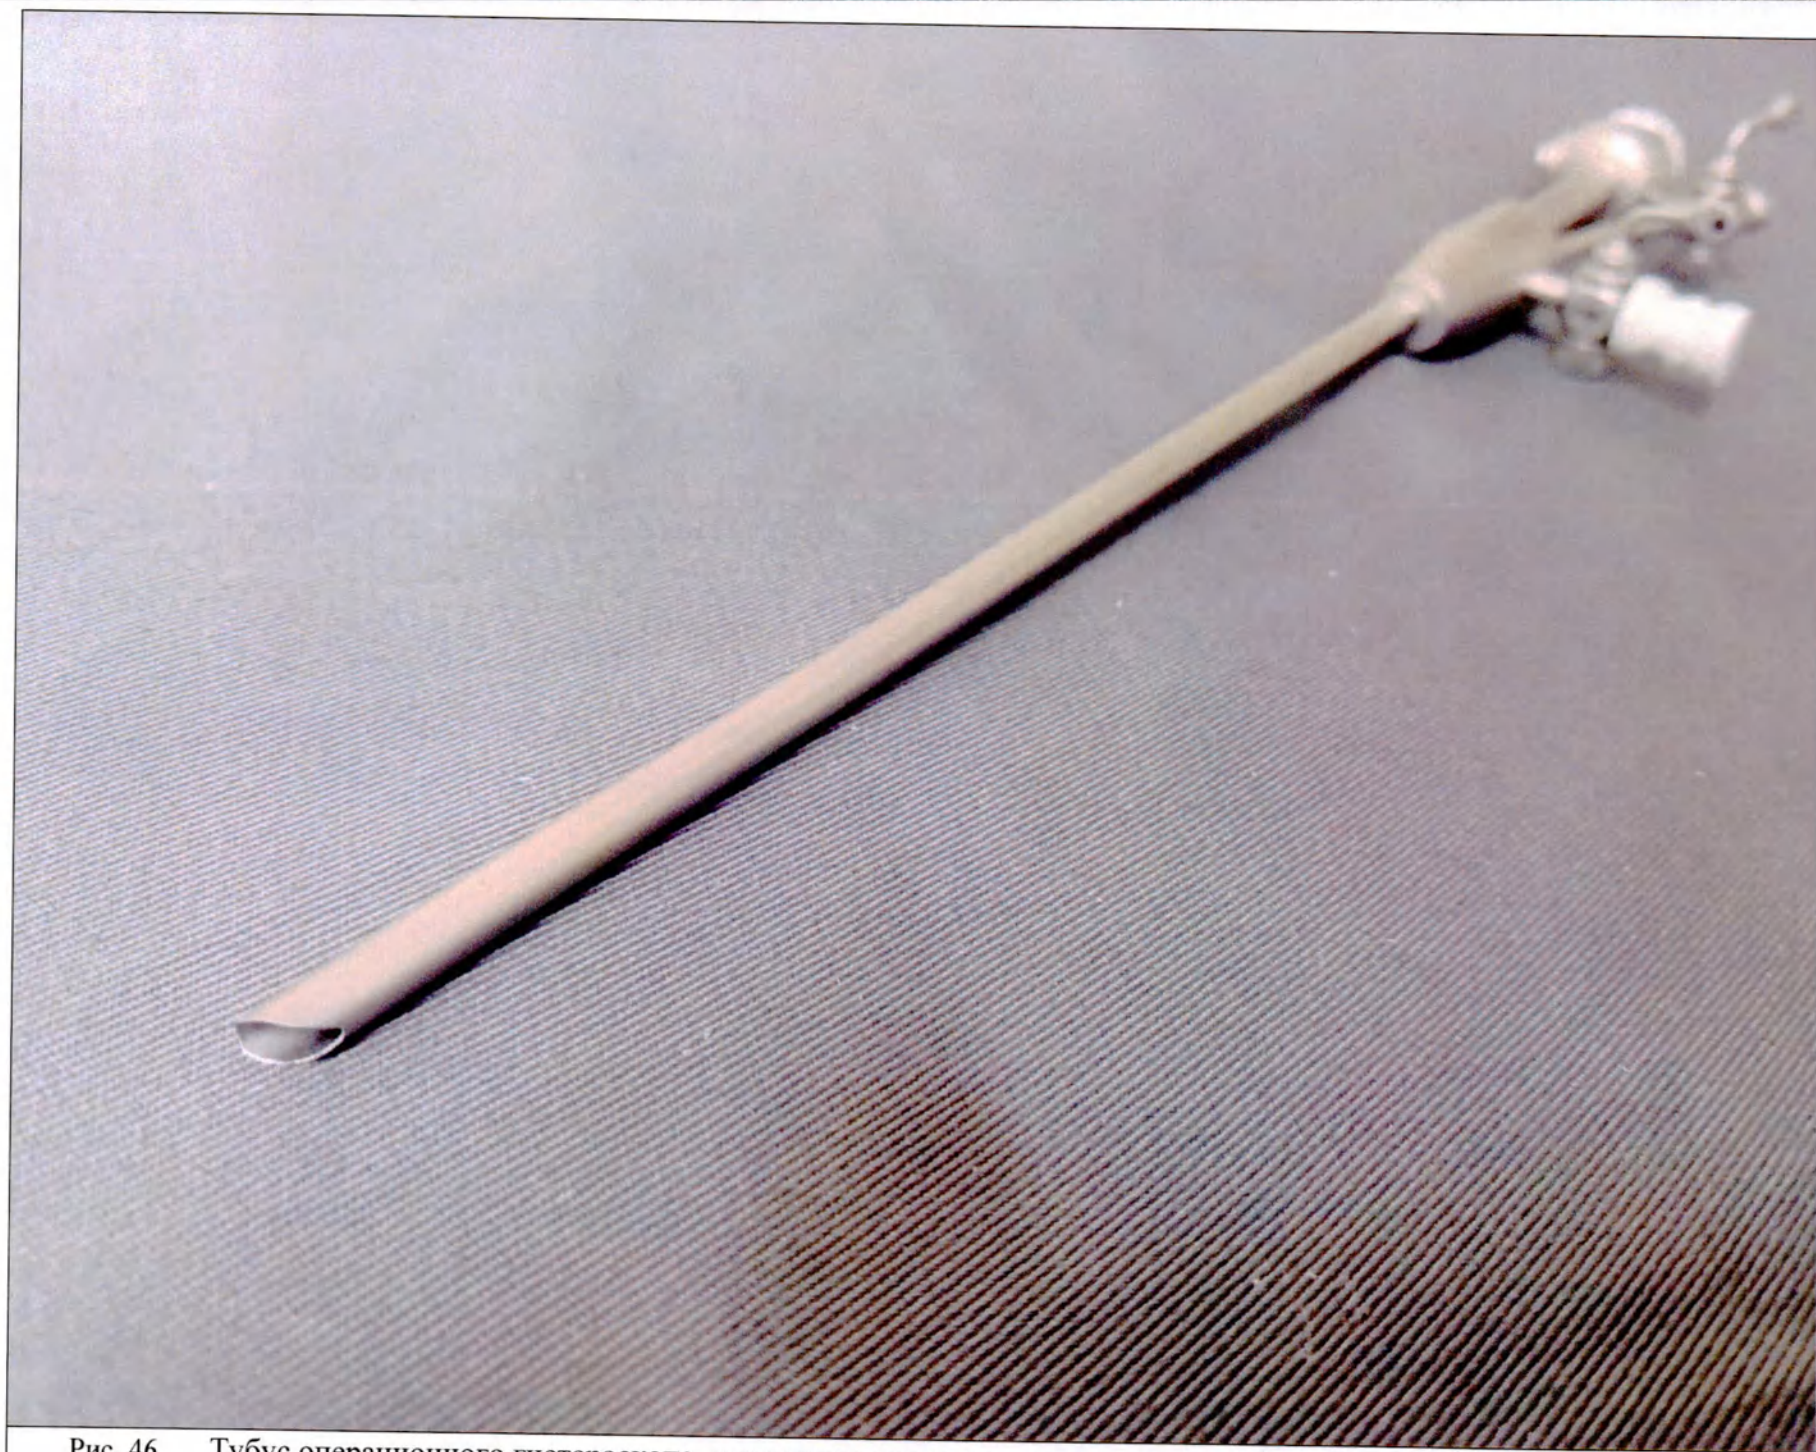


Рис. 46. Тубус операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 4,4 мм, длина 16 см

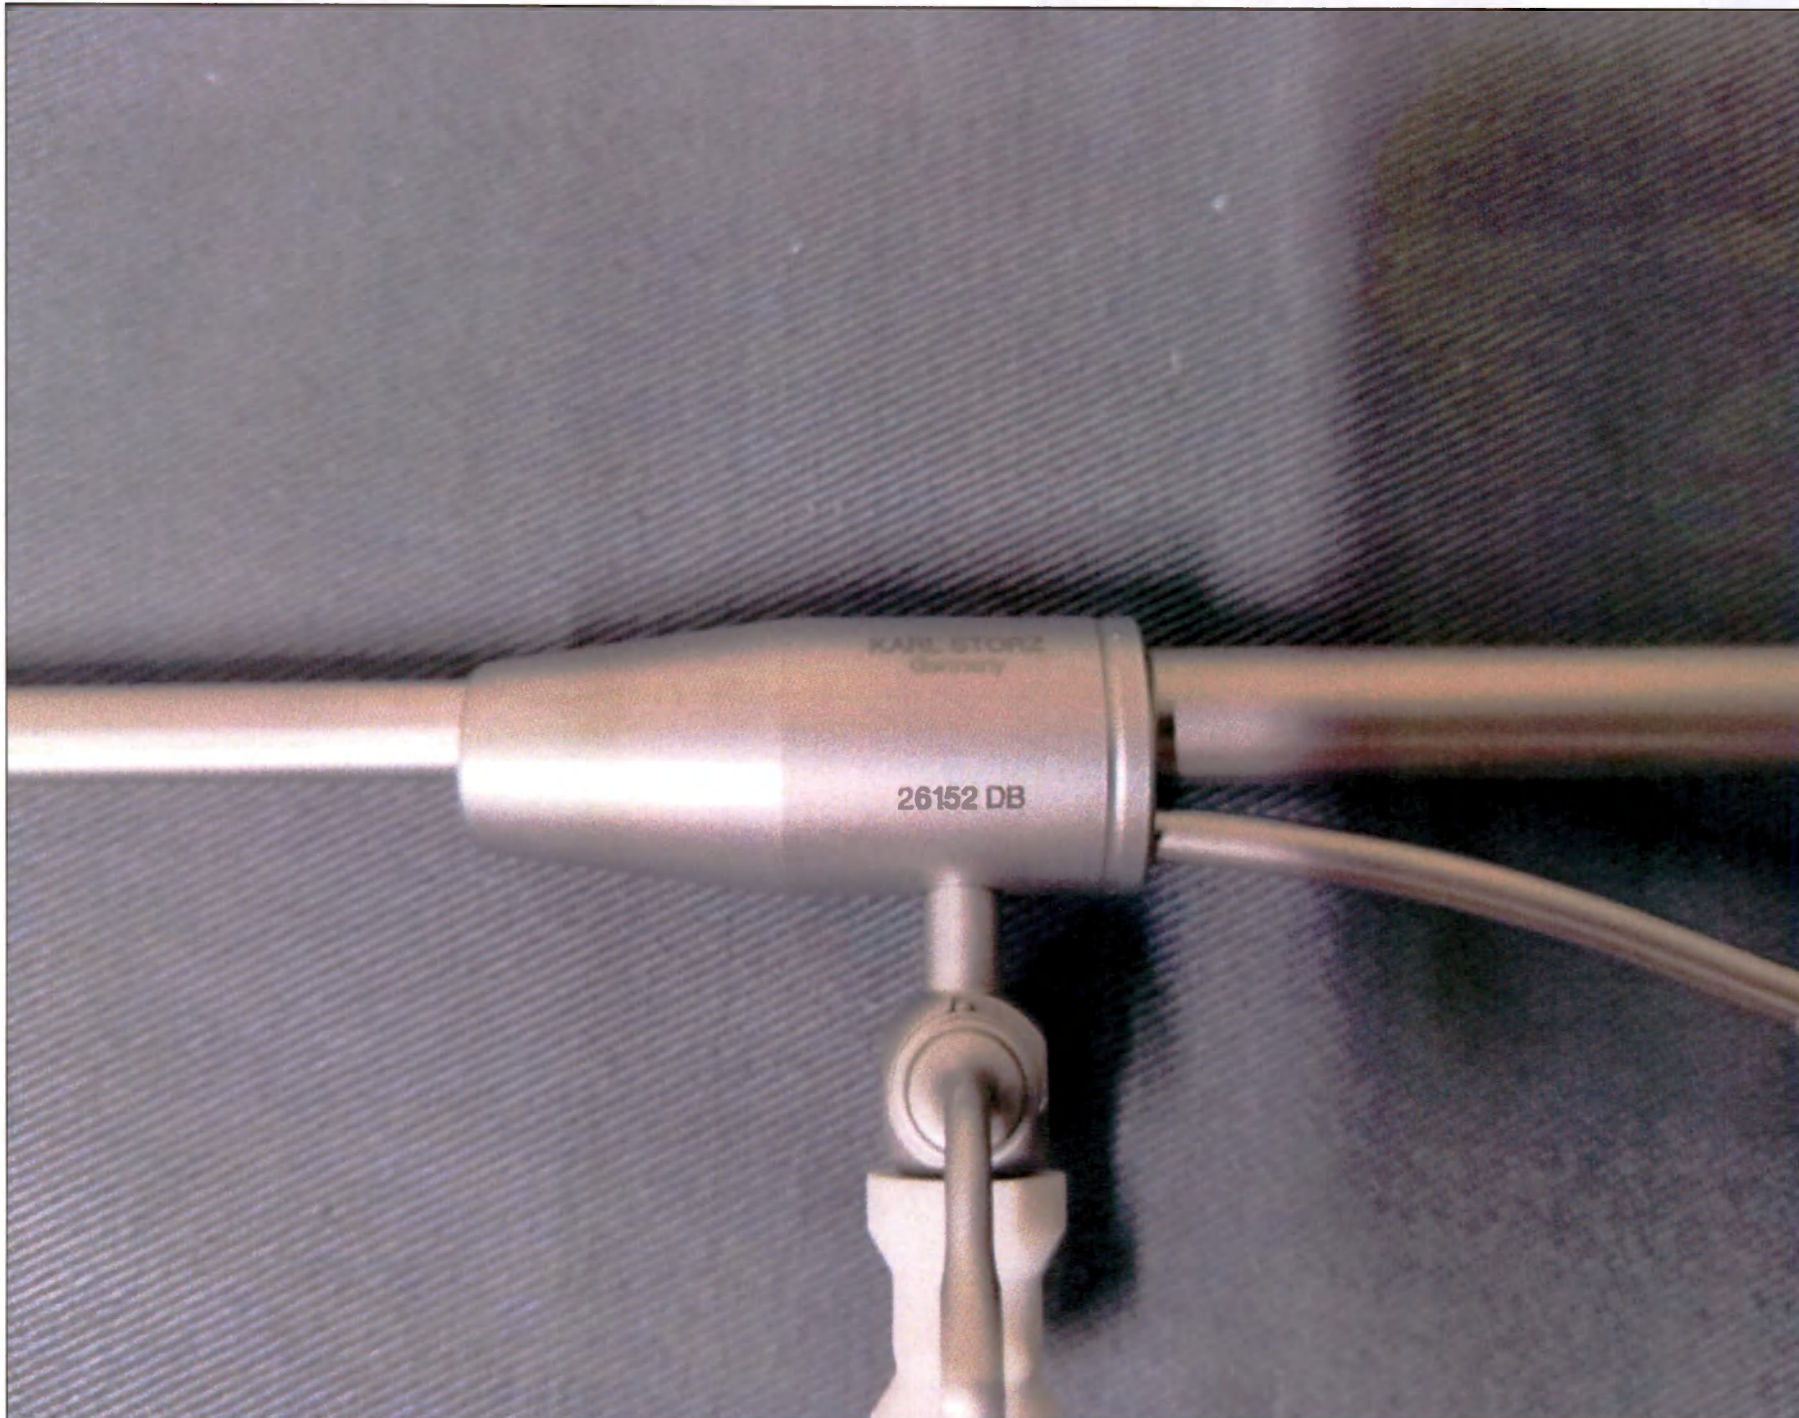


Рис. 47. Тубус операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 4,4 мм, длина 16 см

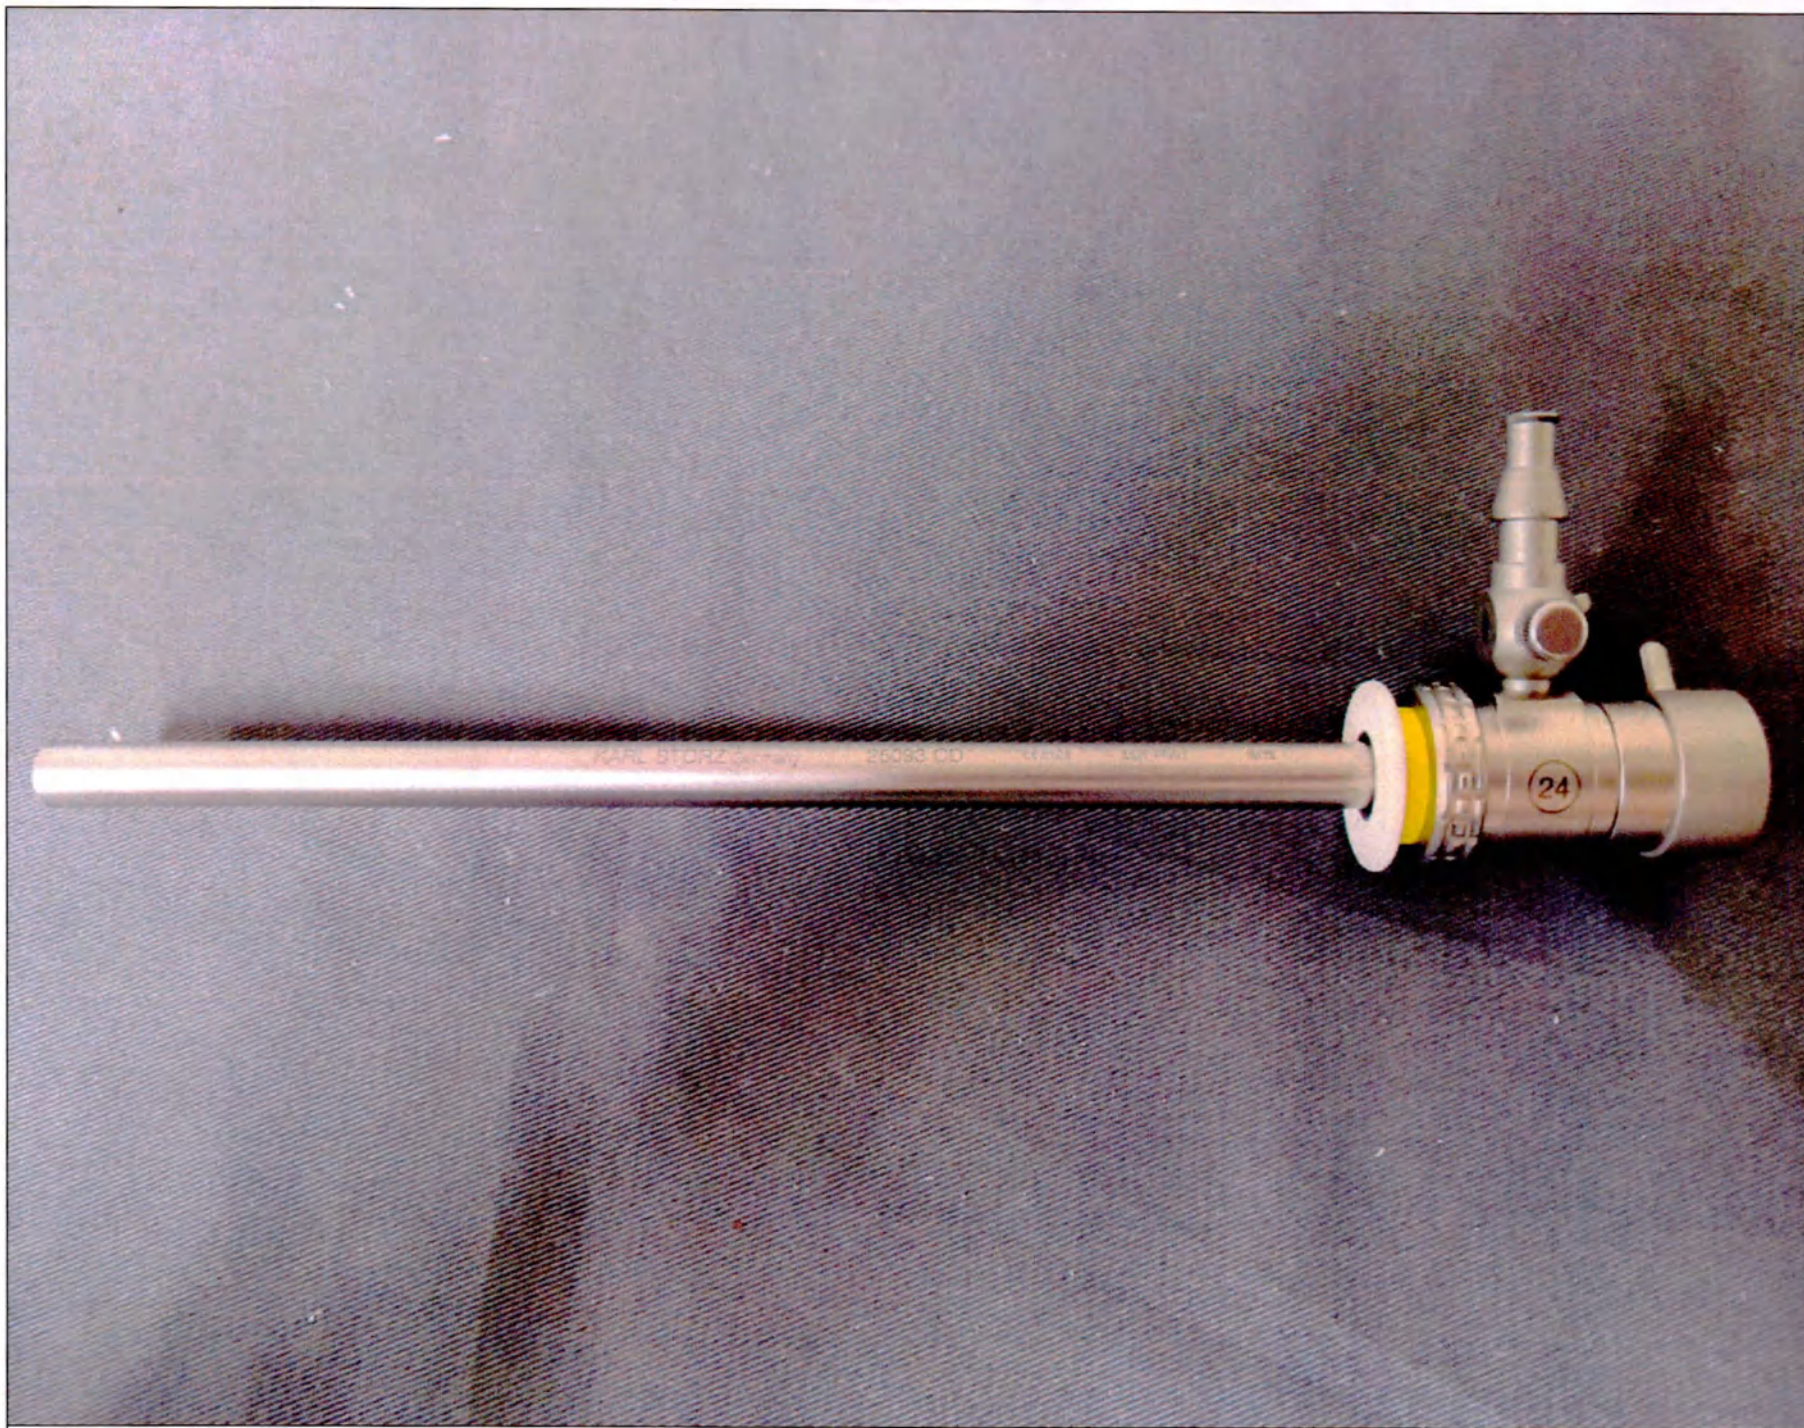


Рис. 48. Тубус операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 24 Шр., поворотный

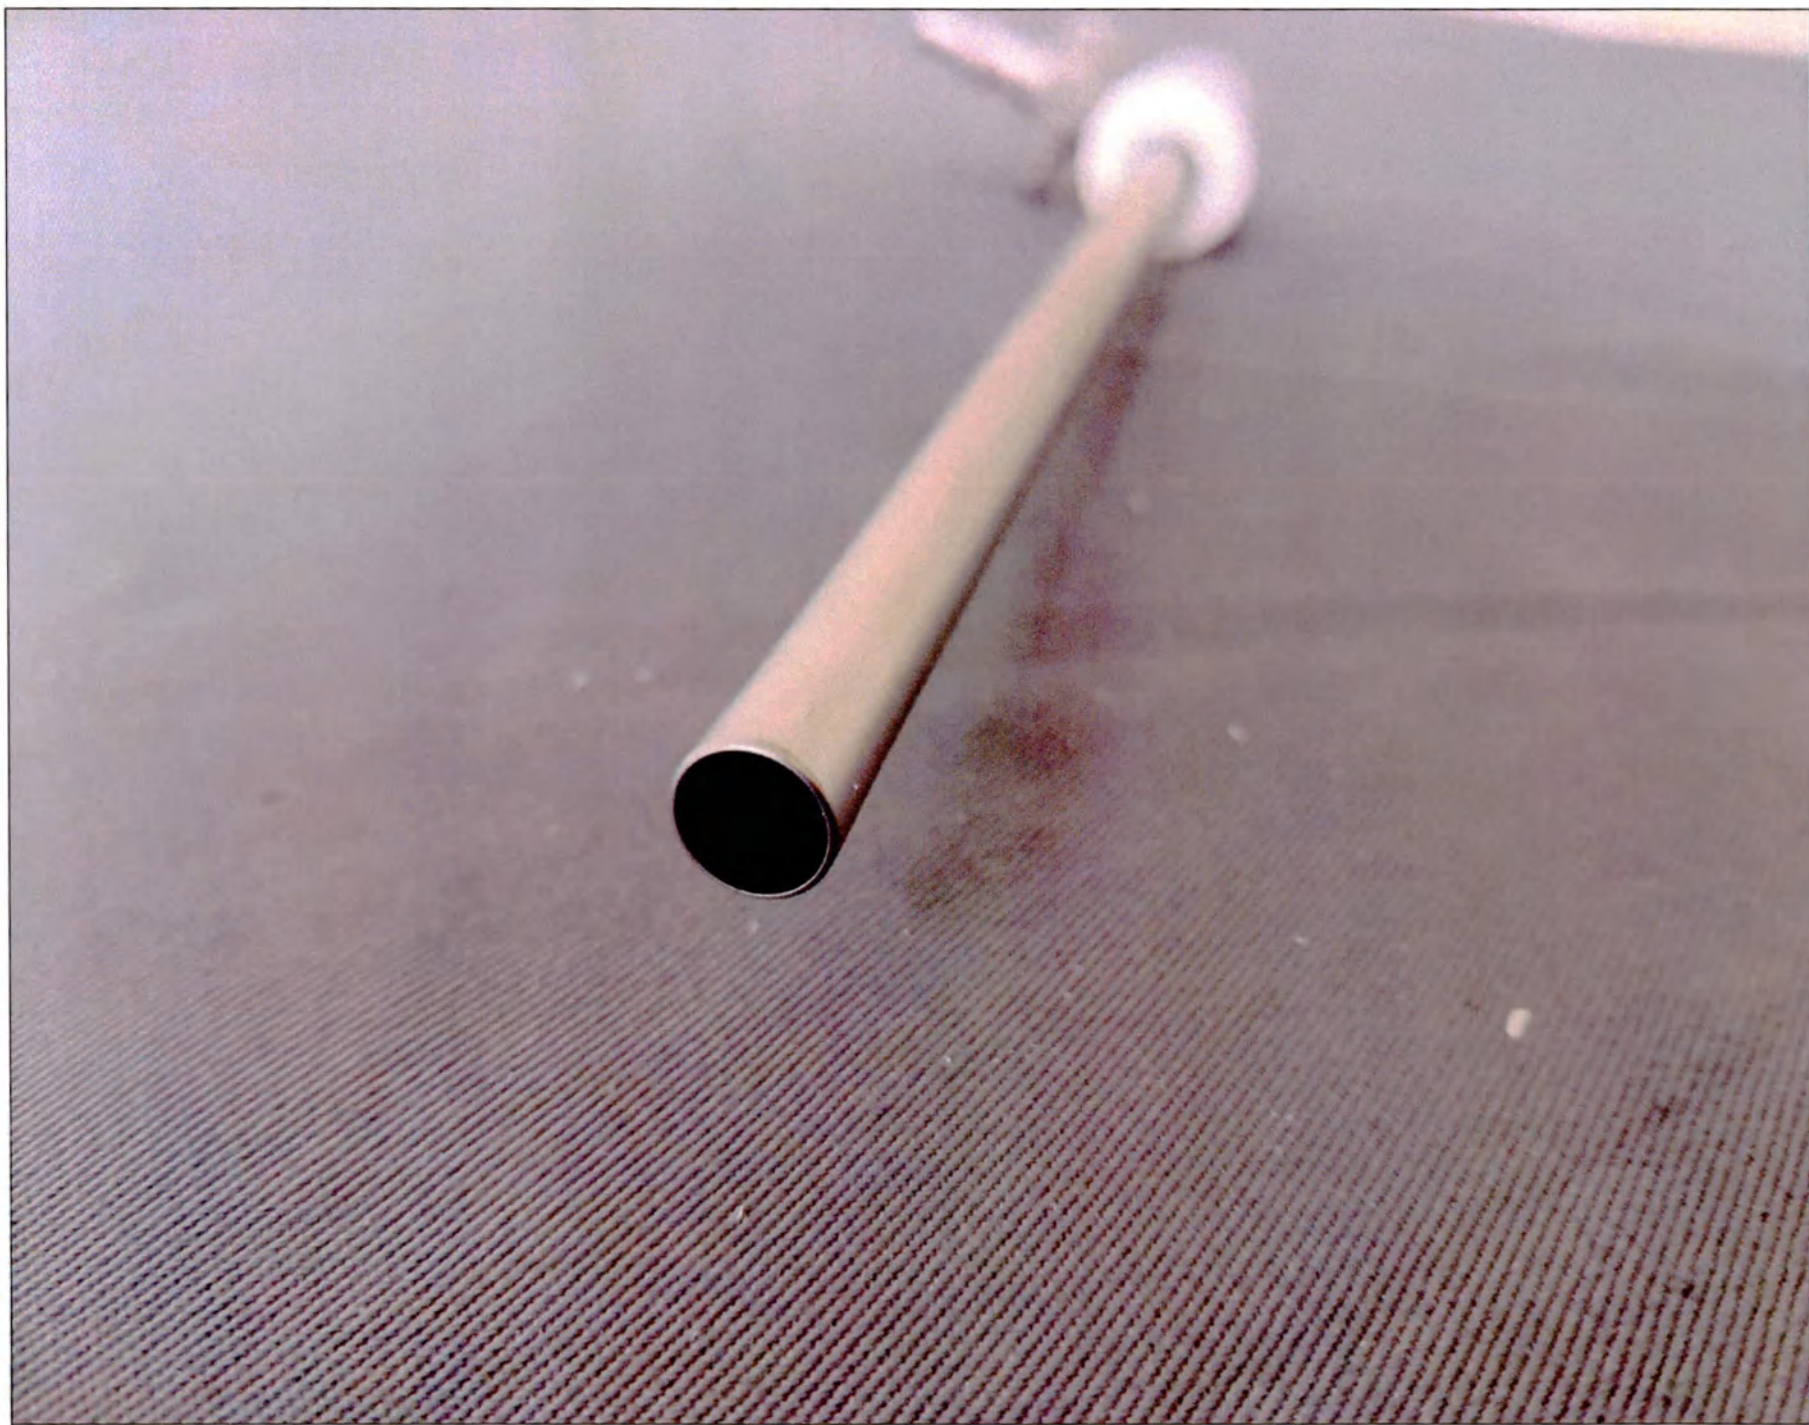


Рис. 49. Тубус операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 24 Шр., поворотный

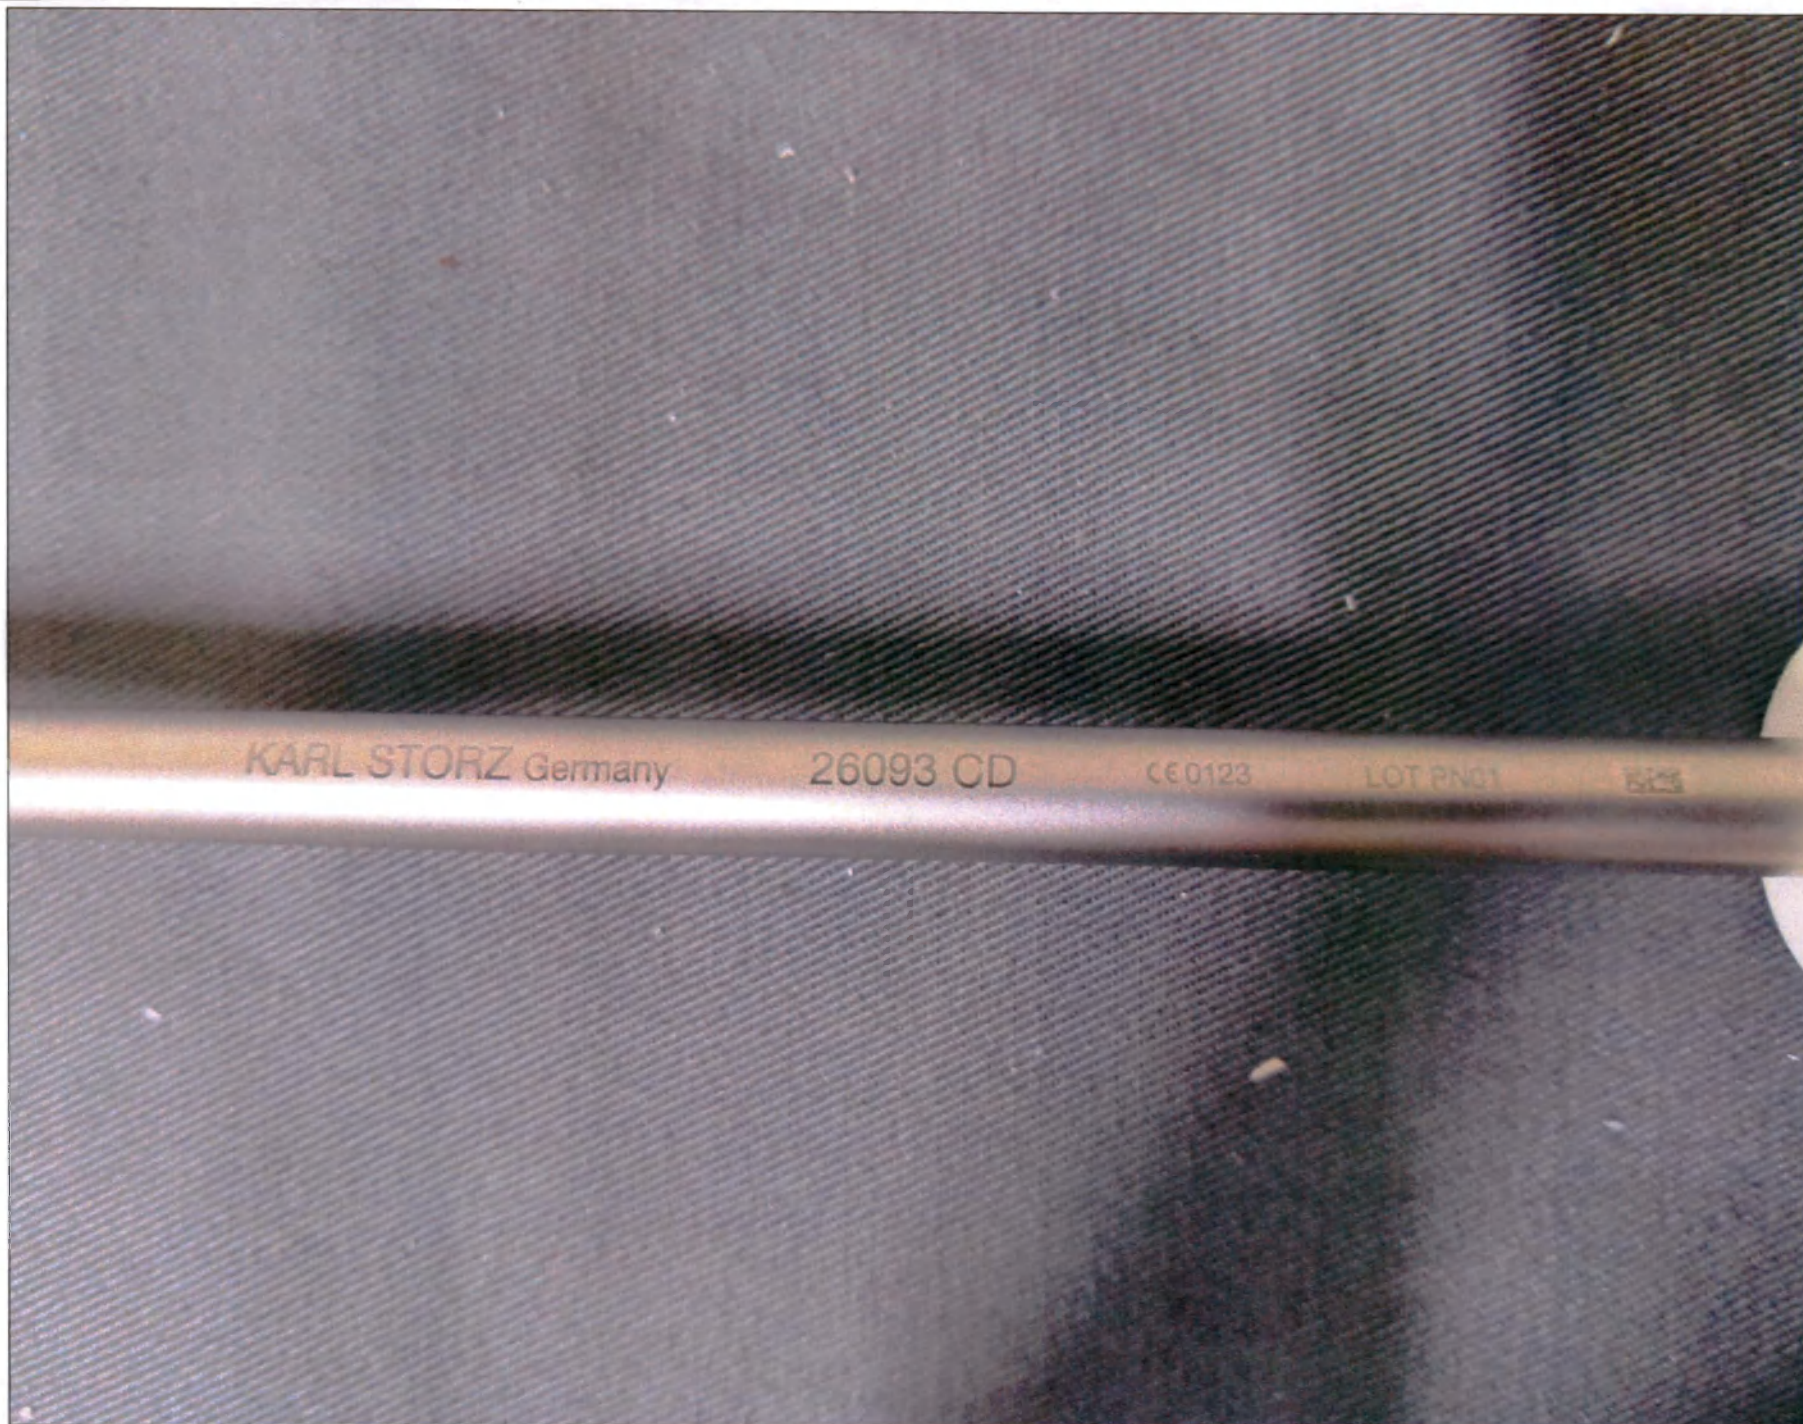


Рис. 50. Тубус операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 24 Шр., поворотный

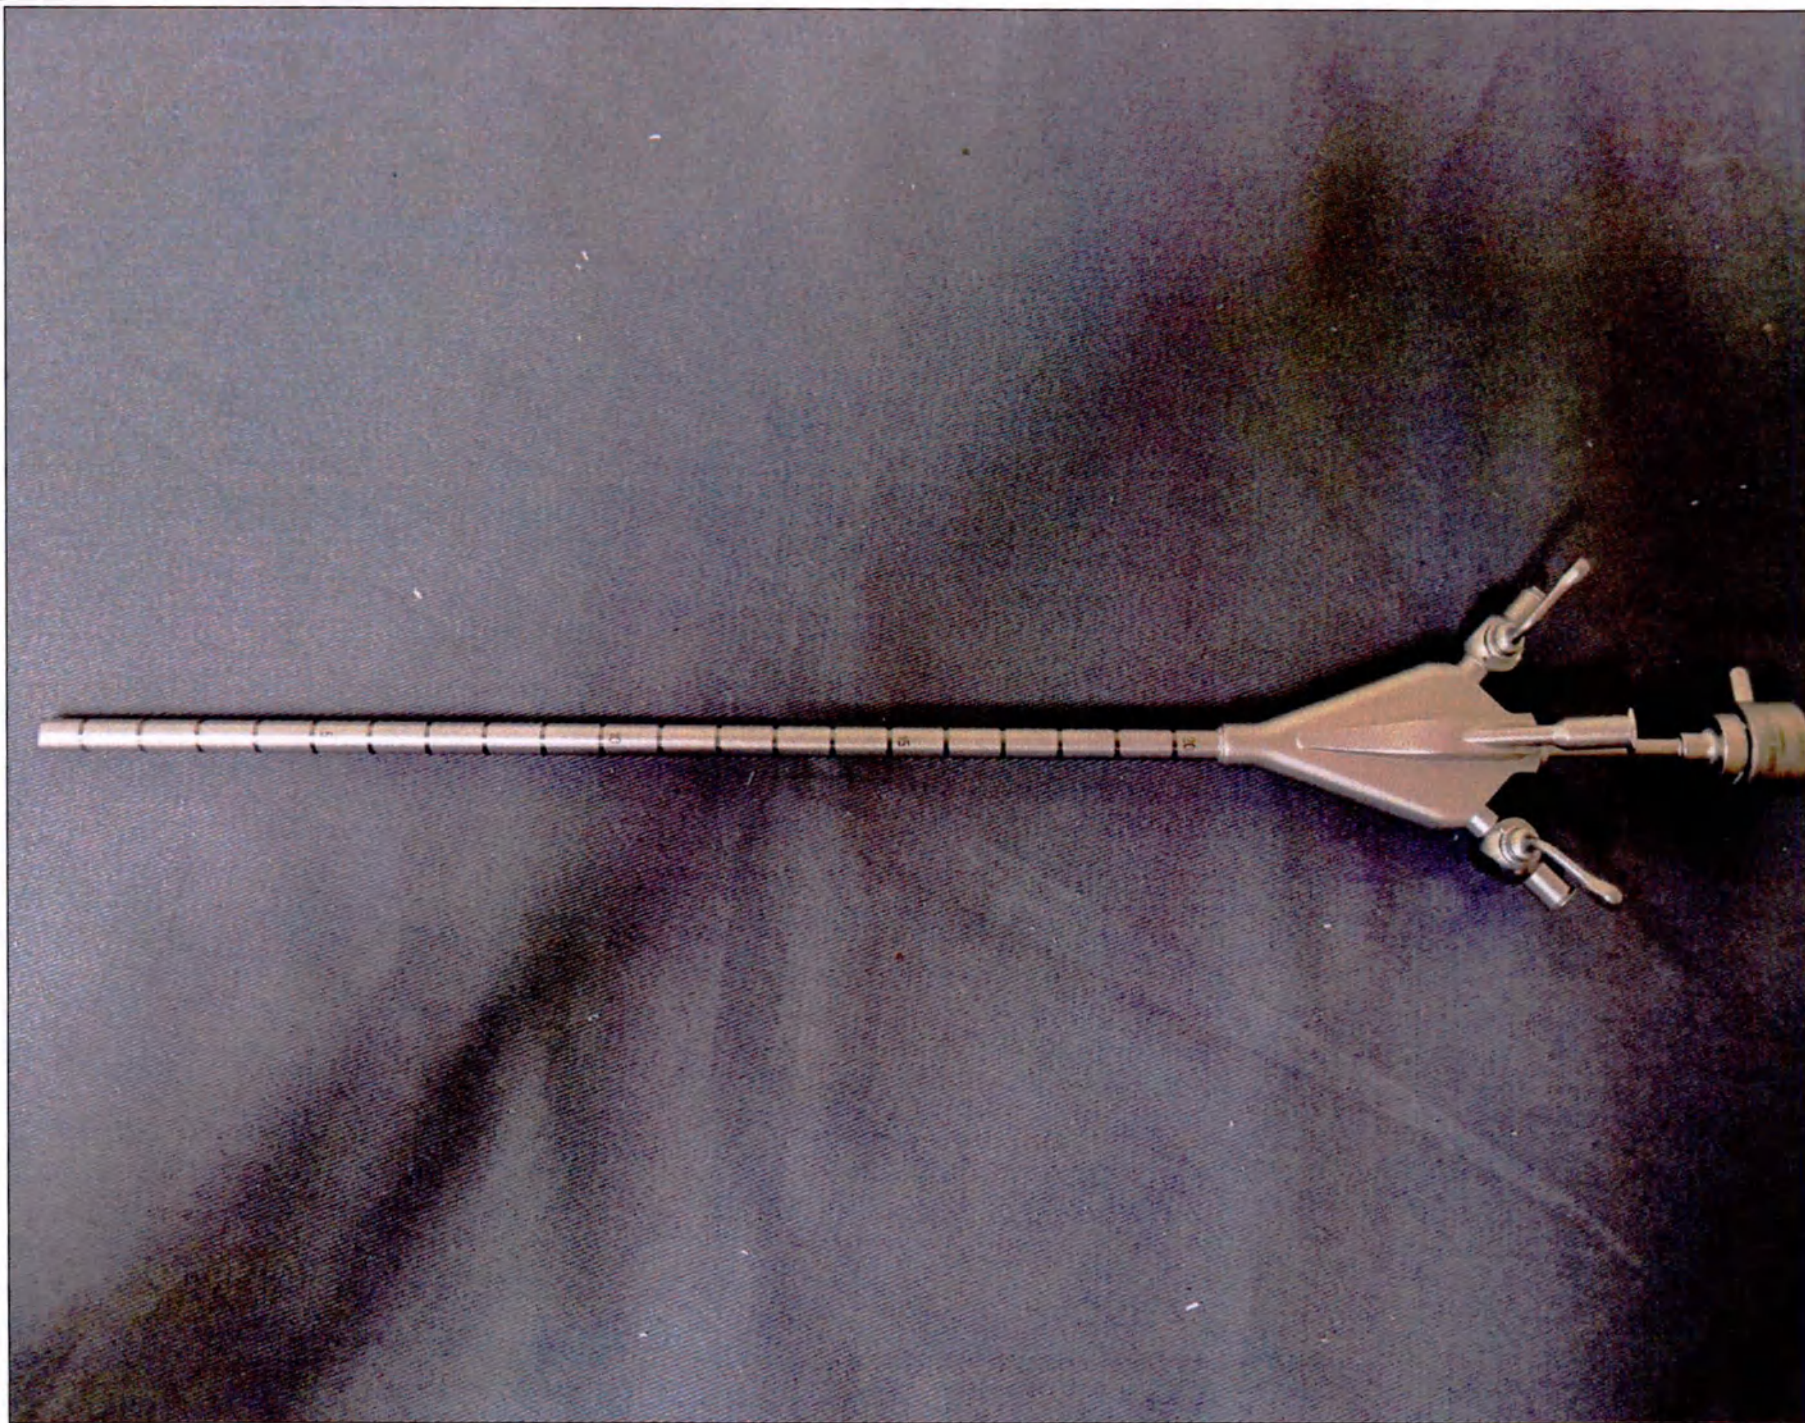


Рис. 51. Тубус операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 5 мм.

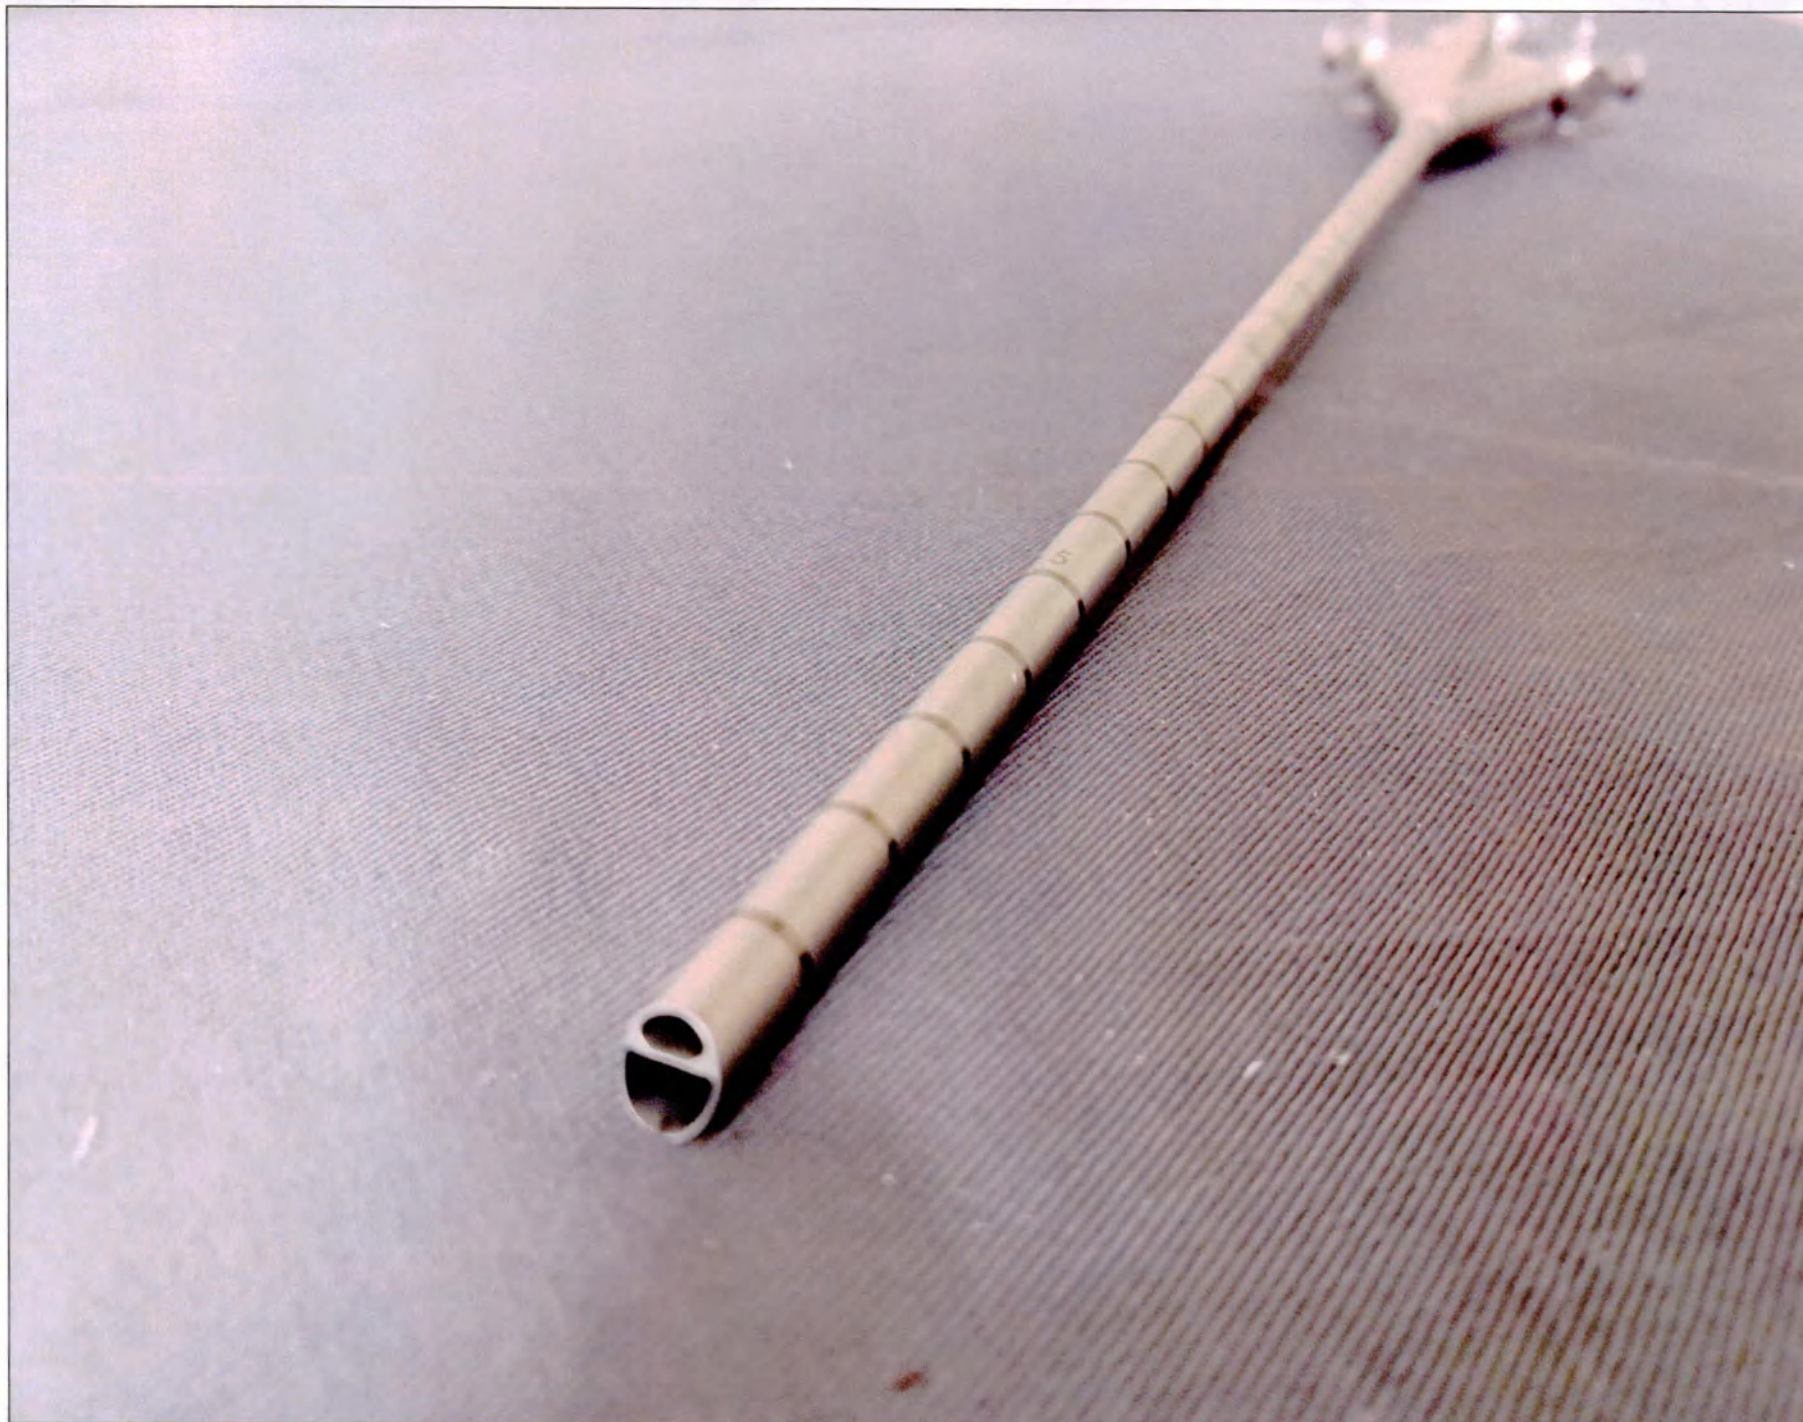


Рис. 52. Тубус операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 5 мм.

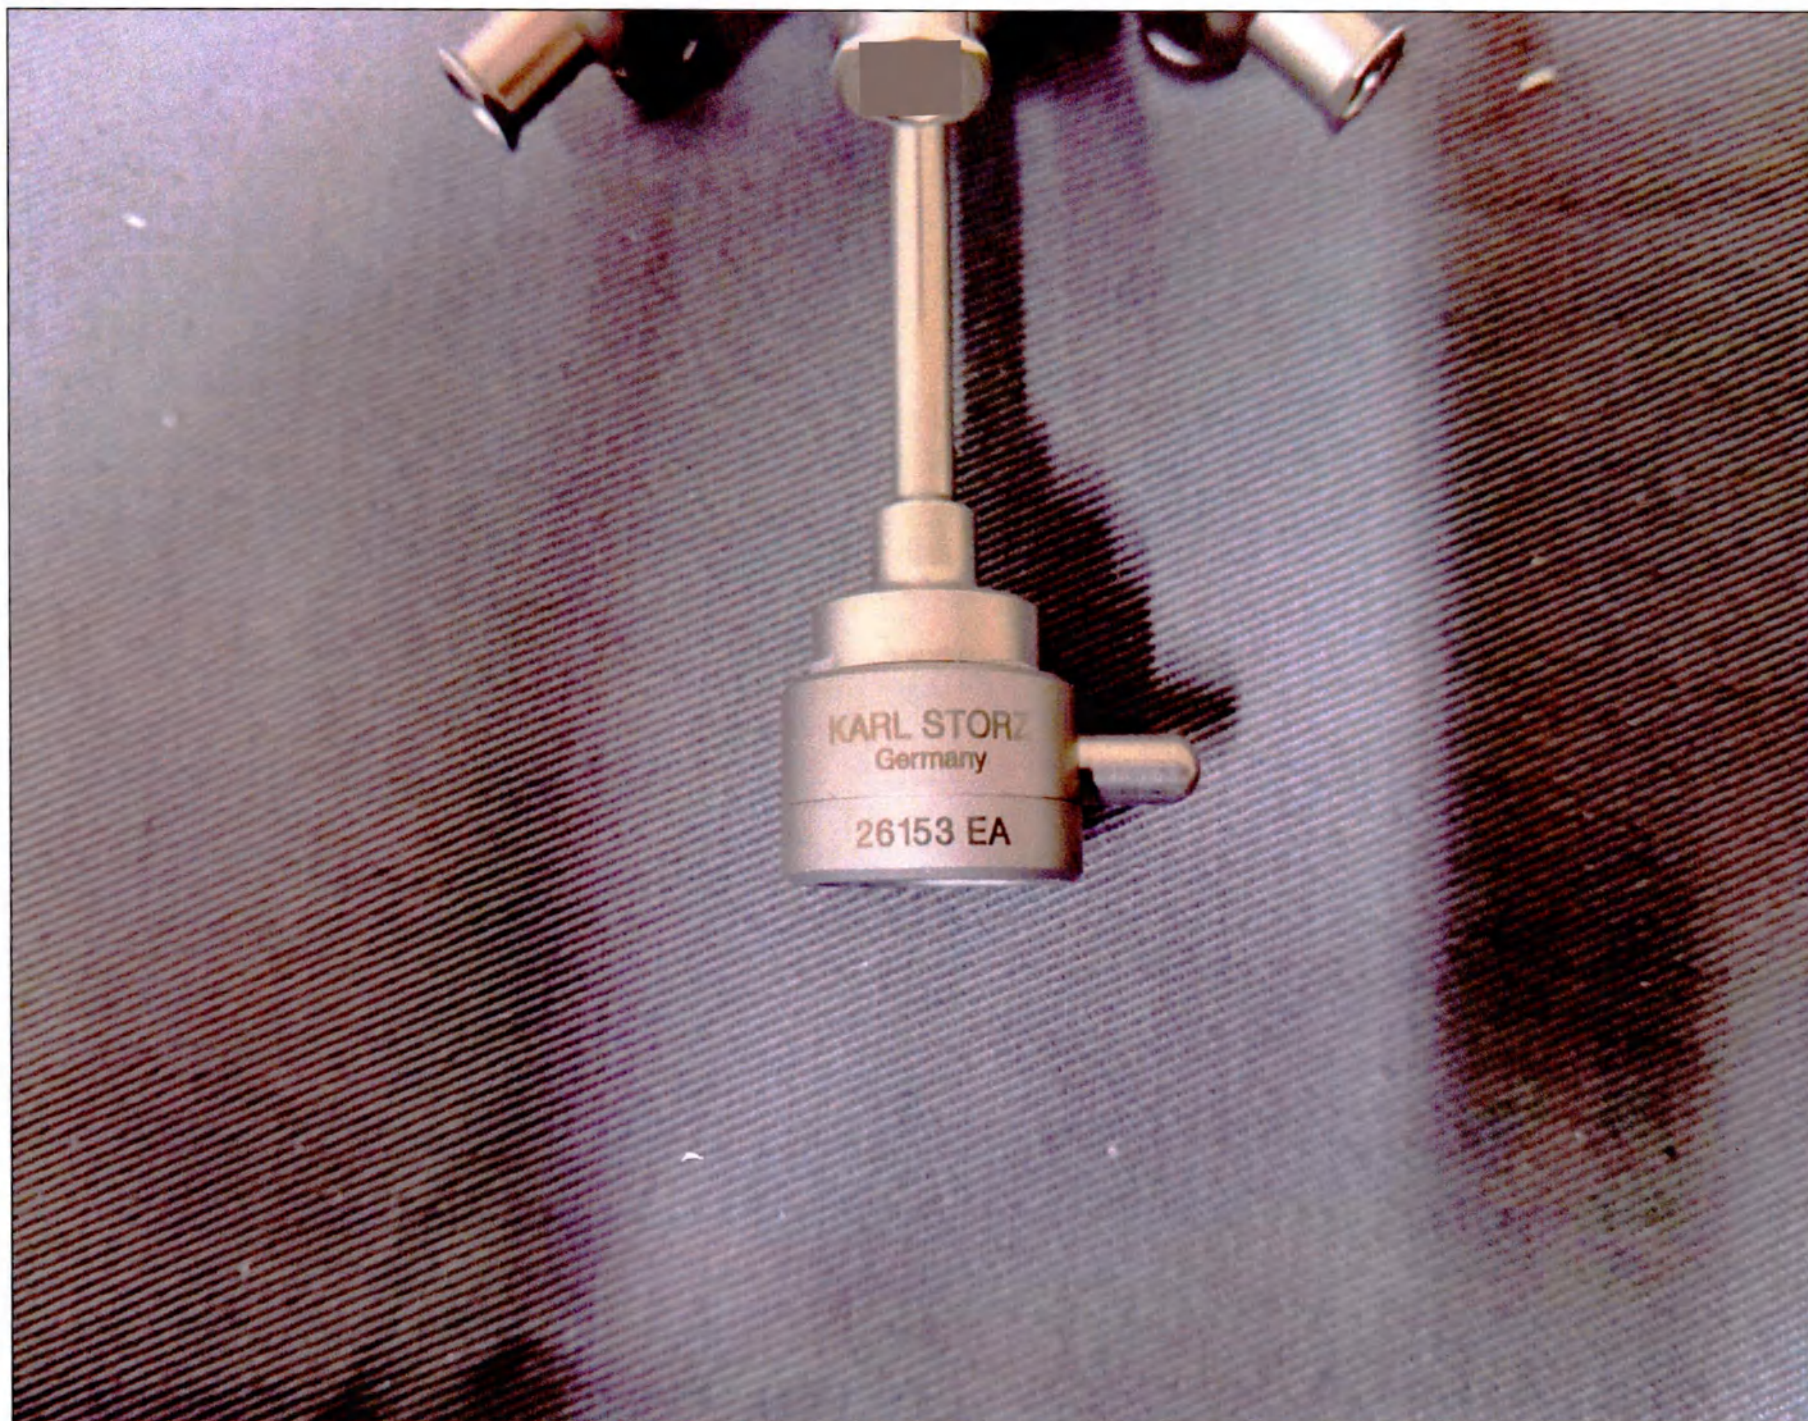


Рис. 53. Тубус операционного гистероскопа, для постоянного промывания, размер 5 мм.

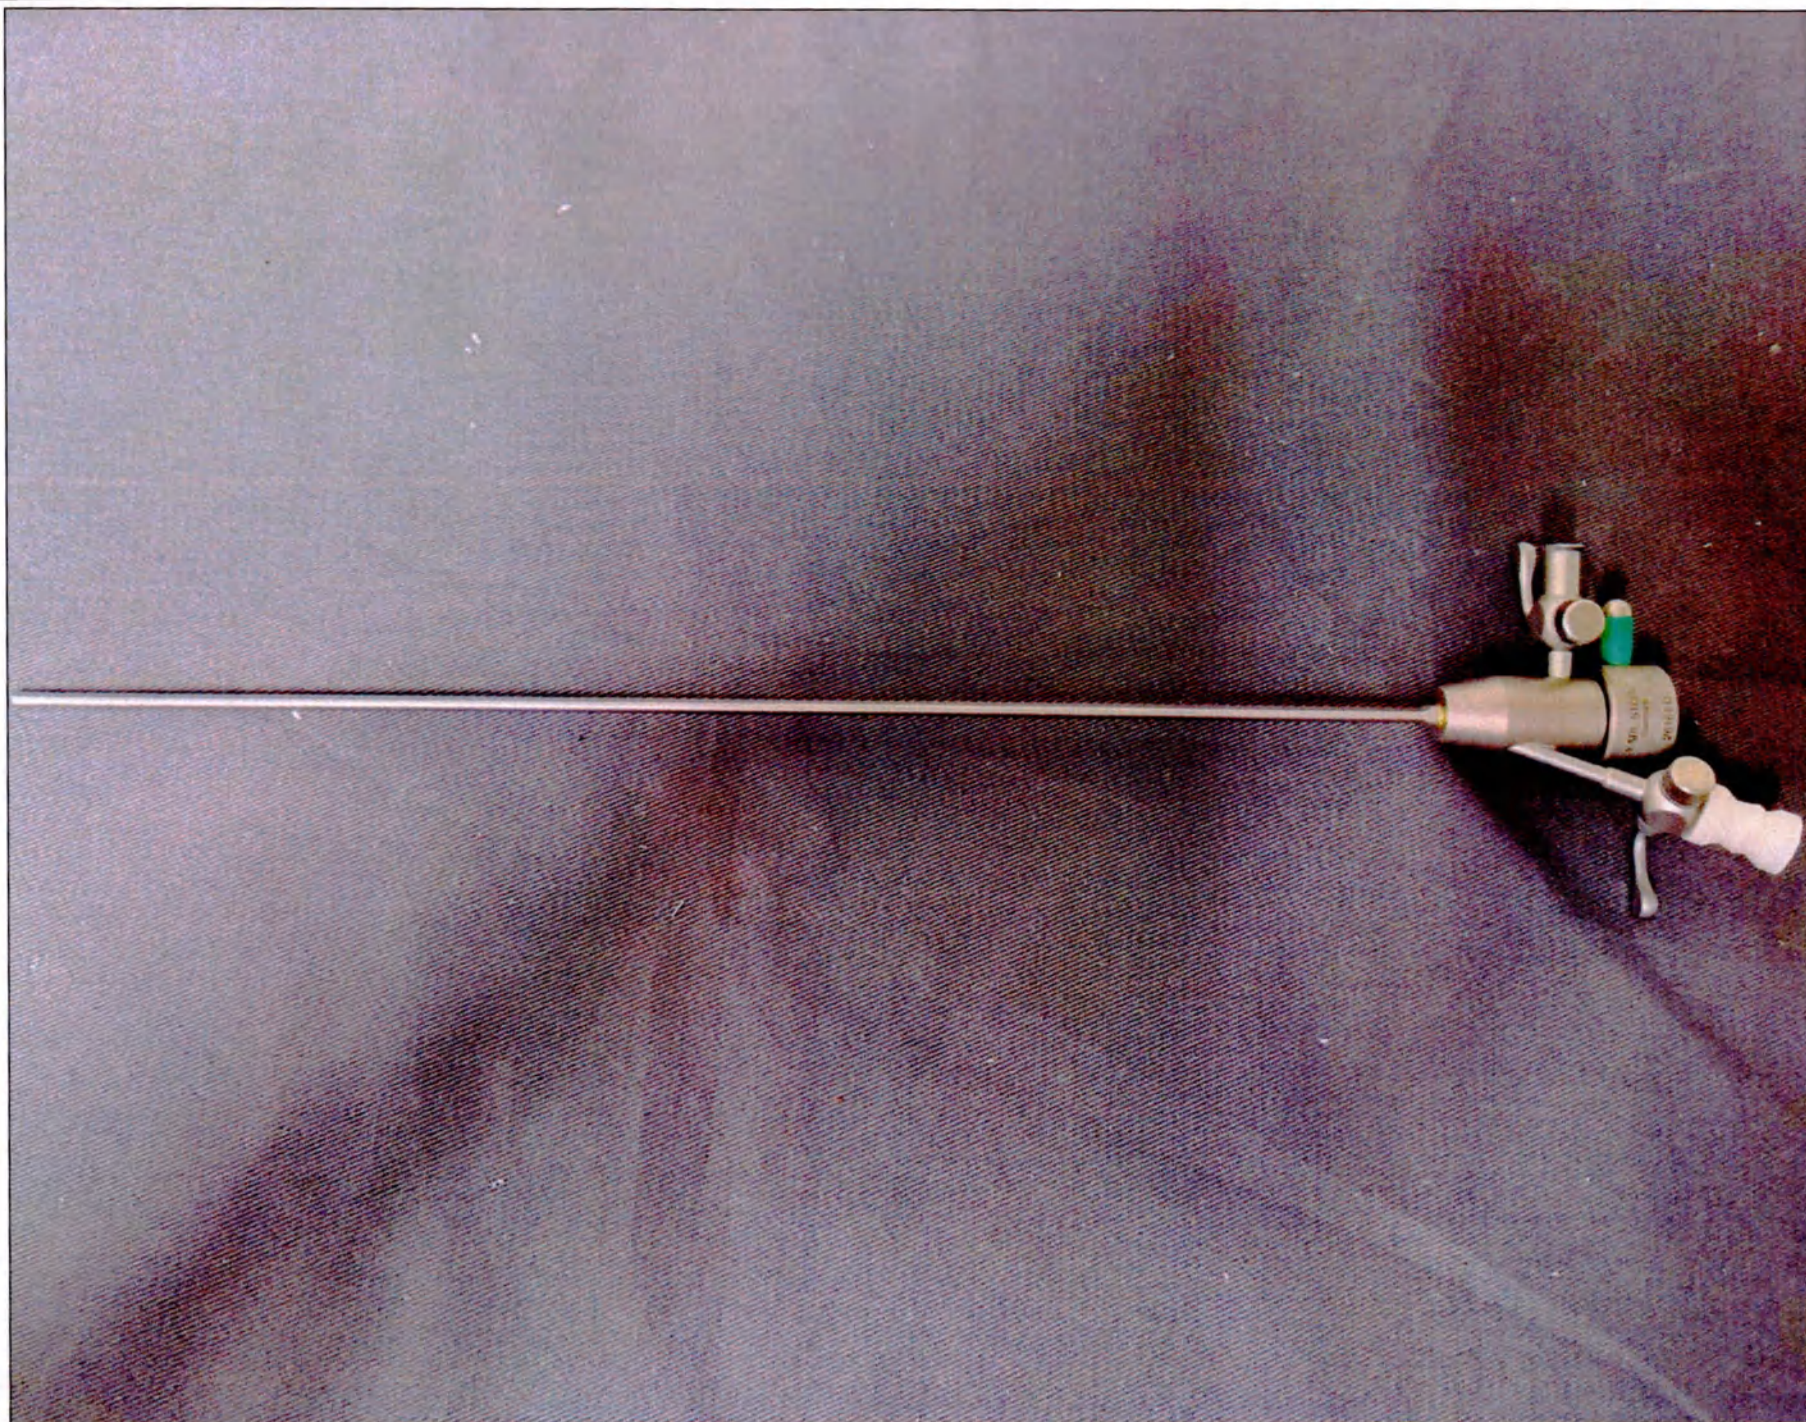


Рис. 54. Тубус операционного фетоскопа, размер 9 Шр. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус операционного фетоскопа, размер 11,5 Шр.

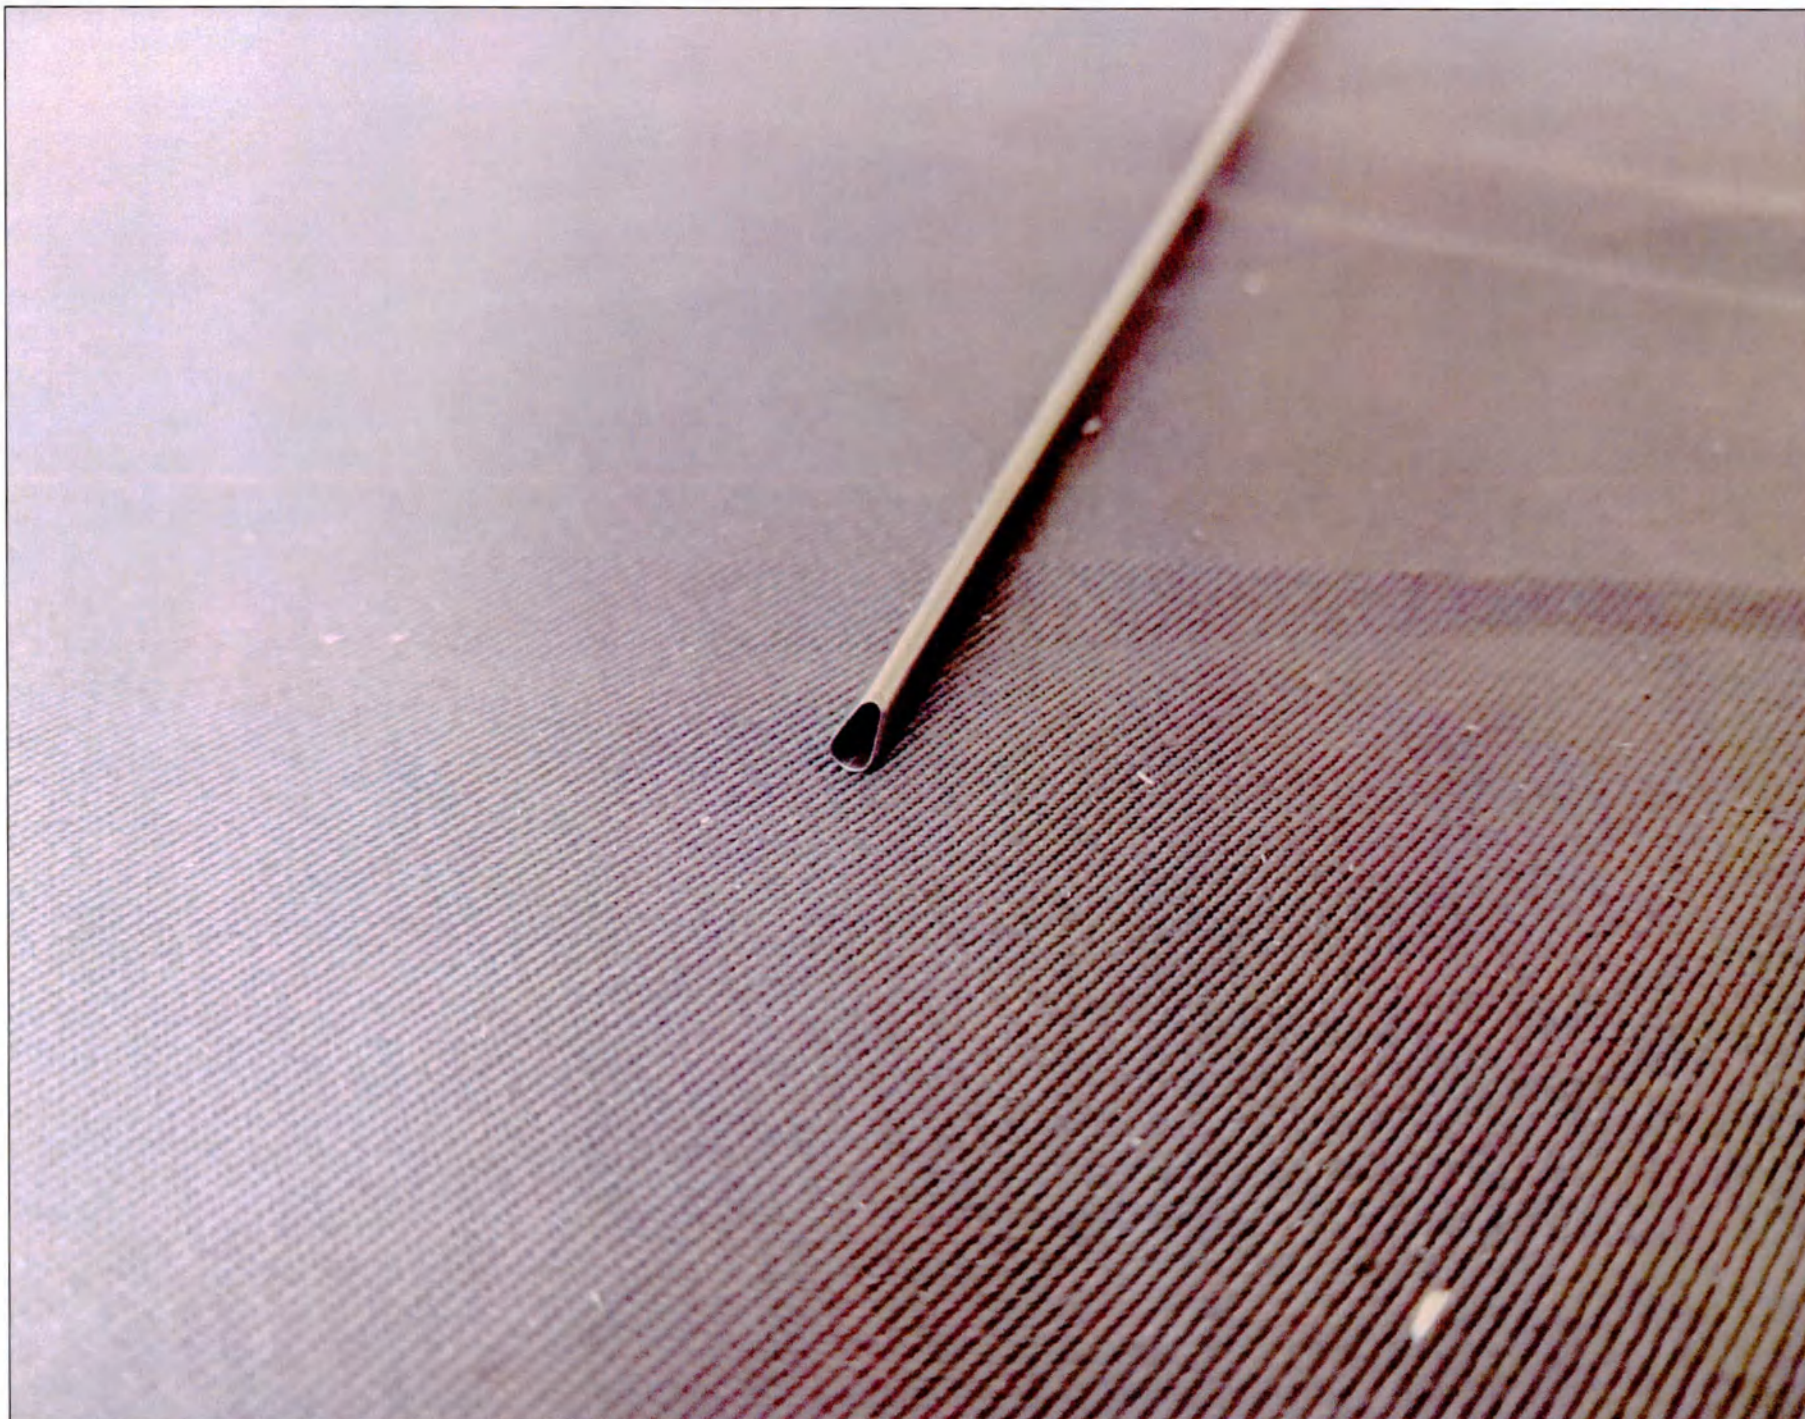


Рис. 55. Тубус операционного фетоскопа, размер 9 Шр. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус операционного фетоскопа, размер 11,5 Шр.



Рис. 56. Тубус операционного фетоскопа, размер 9 Шр. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Тубус операционного фетоскопа, размер 11,5 Шр.

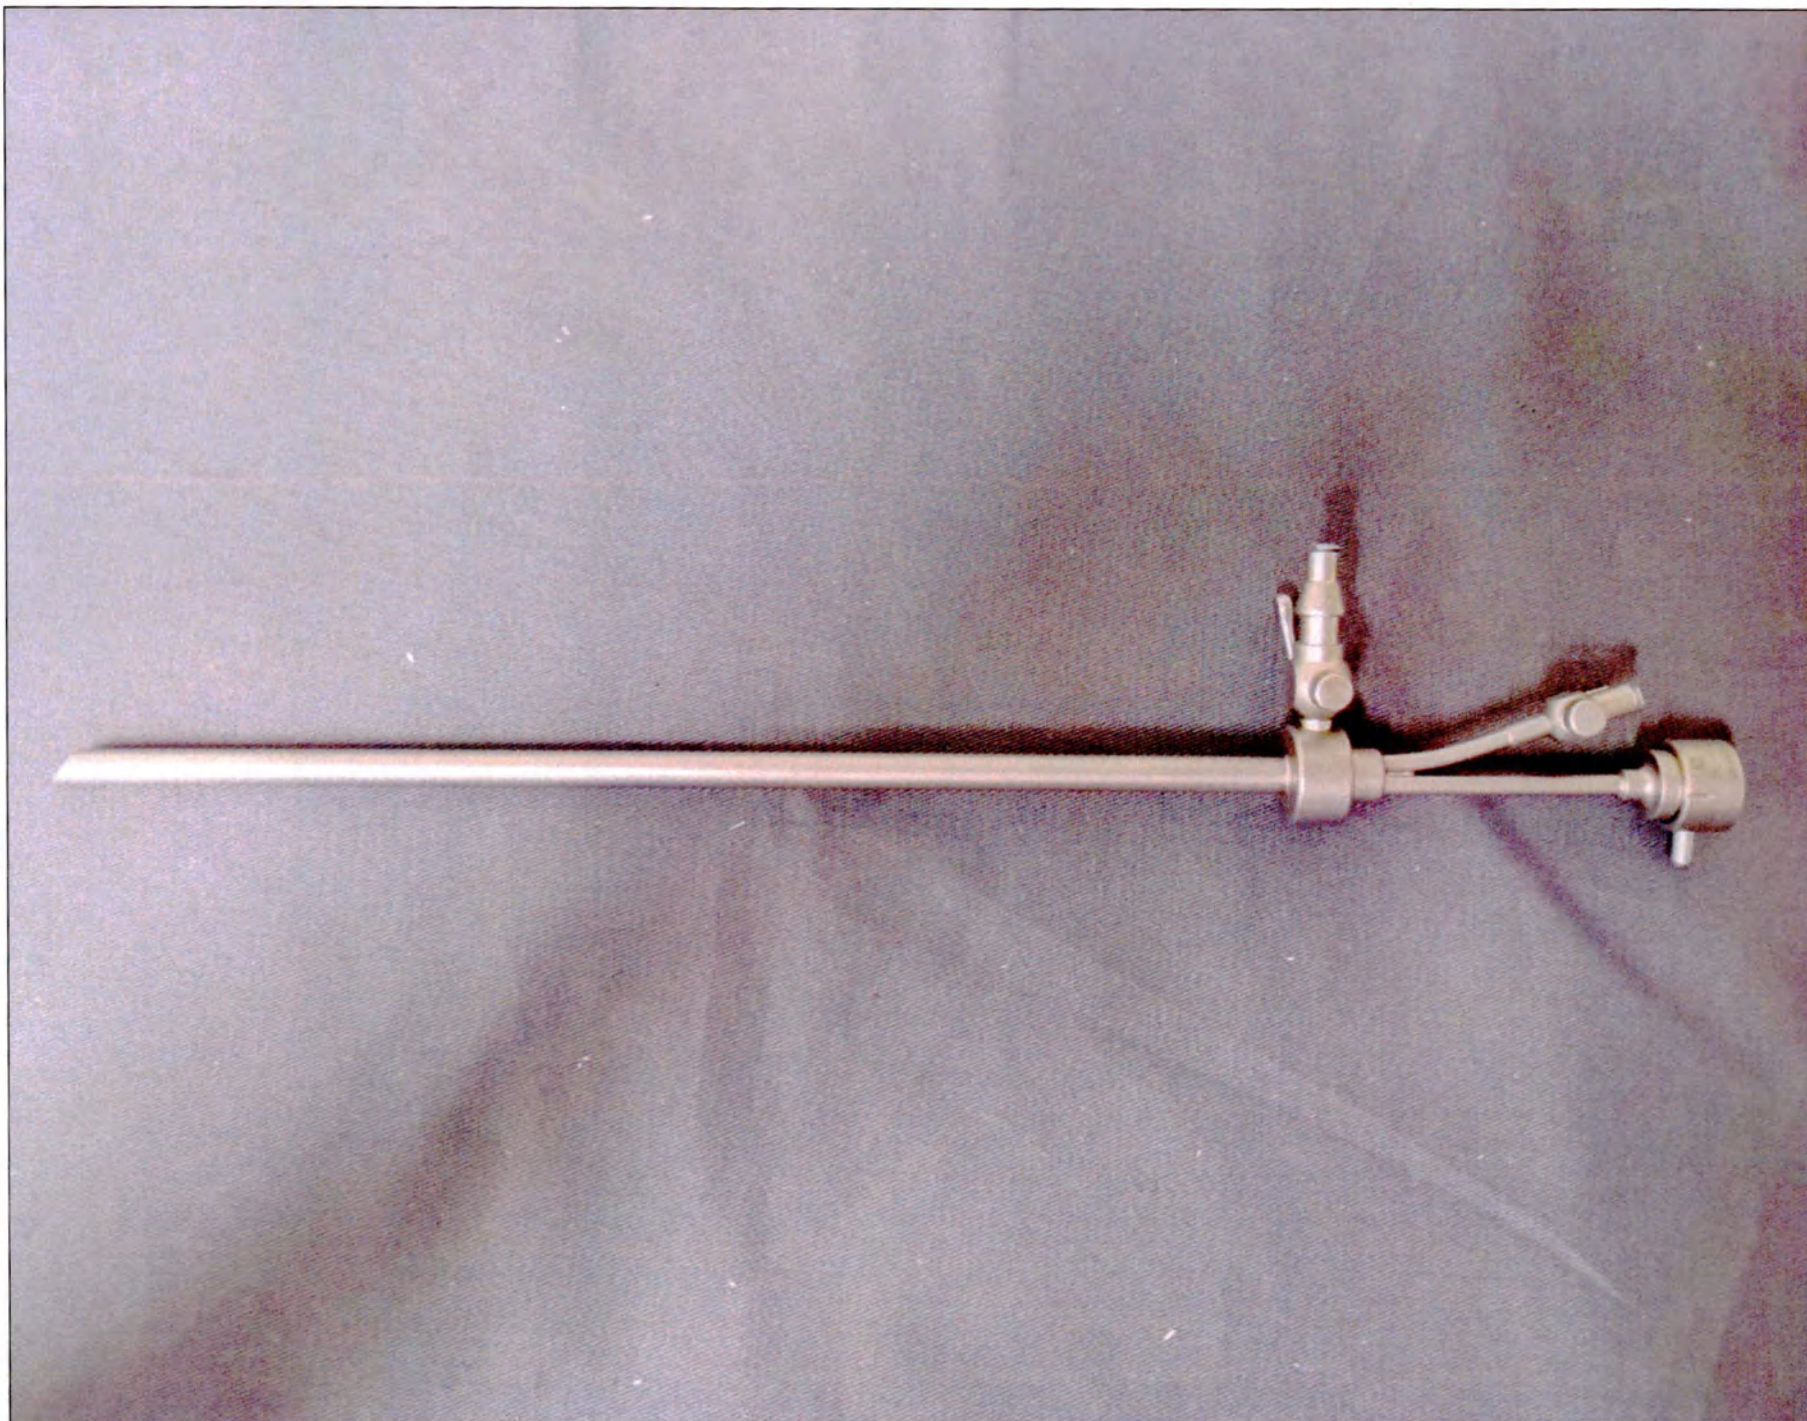


Рис. 57. Тубус операционный для трансвагинальной эндоскопии, диаметр 6,6 мм, длина 29 см, с одним краном

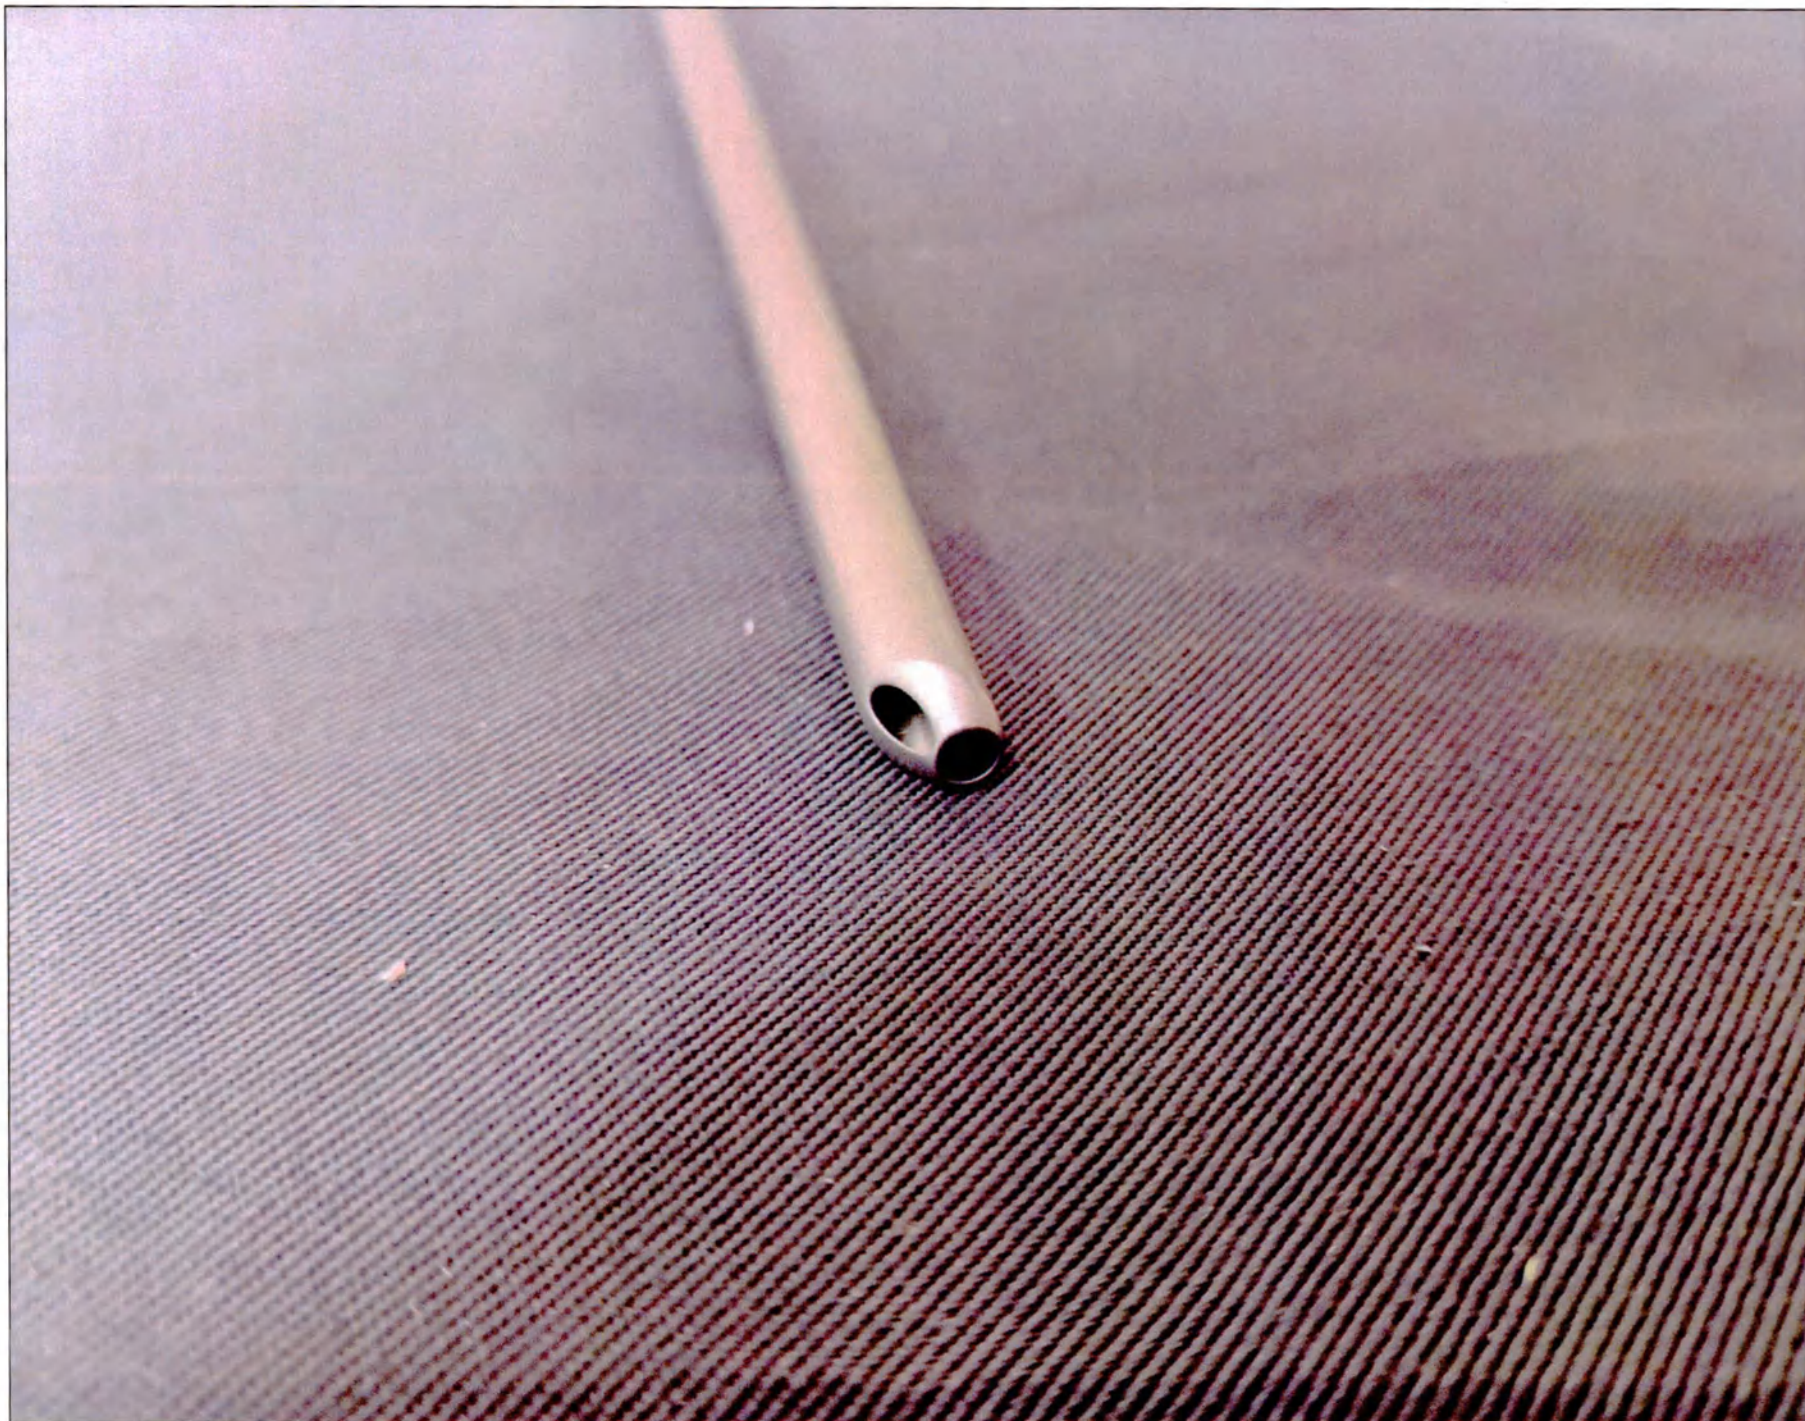


Рис. 58. Тубус операционный для трансвагинальной эндоскопии, диаметр 6,6 мм, длина 29 см, с одним краном



Рис. 59. Тубус операционный для трансвагинальной эндоскопии, диаметр 6,6 мм, длина 29 см, с одним краном



Рис. 60. Тубус диагностический для трансвагинальной эндоскопии, диаметр 3,7 мм, длина 29 см, с одним краном

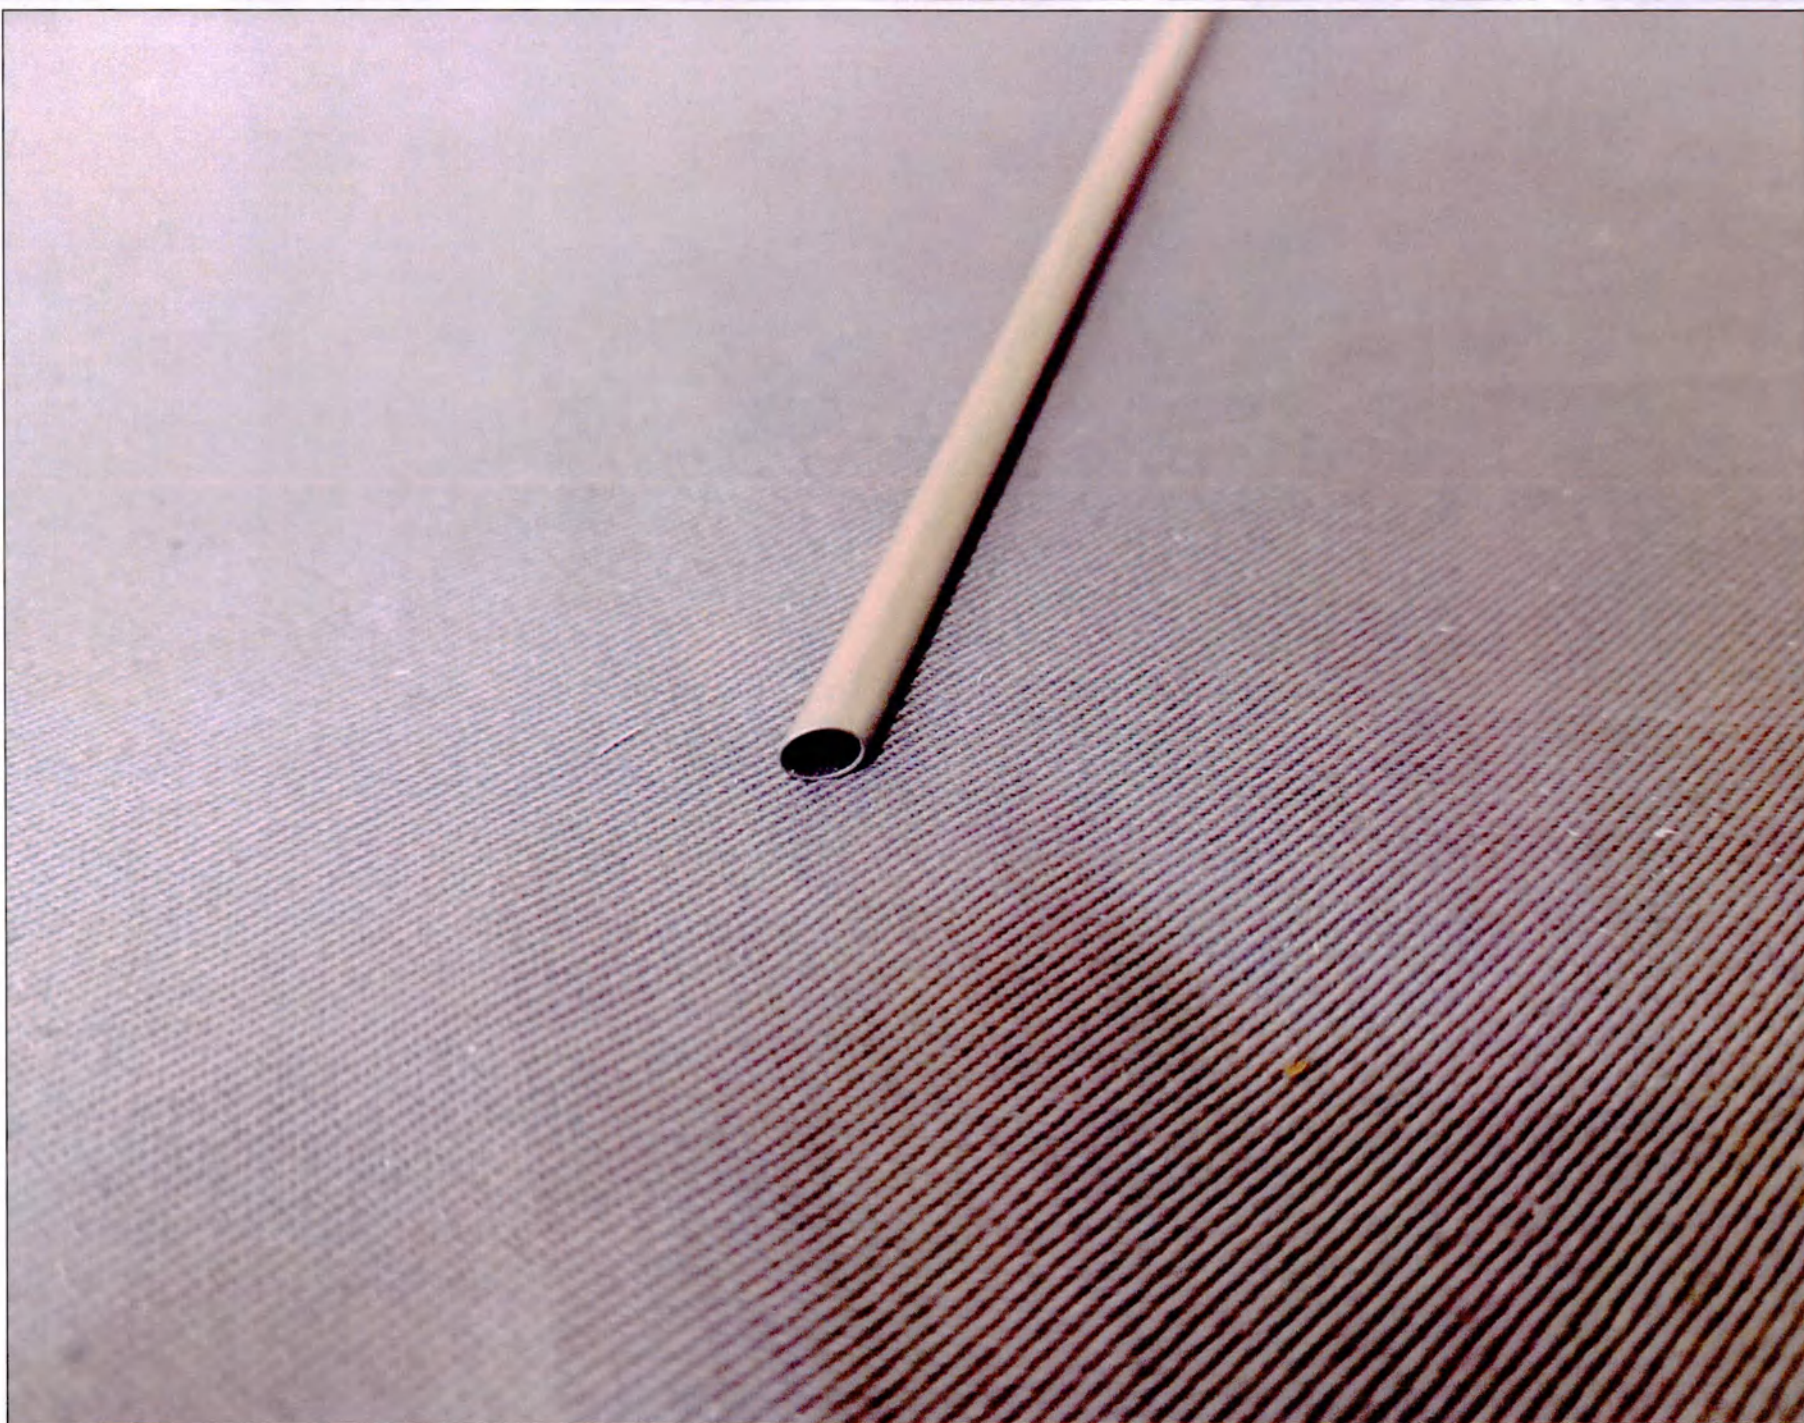


Рис. 61. Тубус диагностический для трансвагинальной эндоскопии, диаметр 3,7 мм, длина 29 см, с одним краном

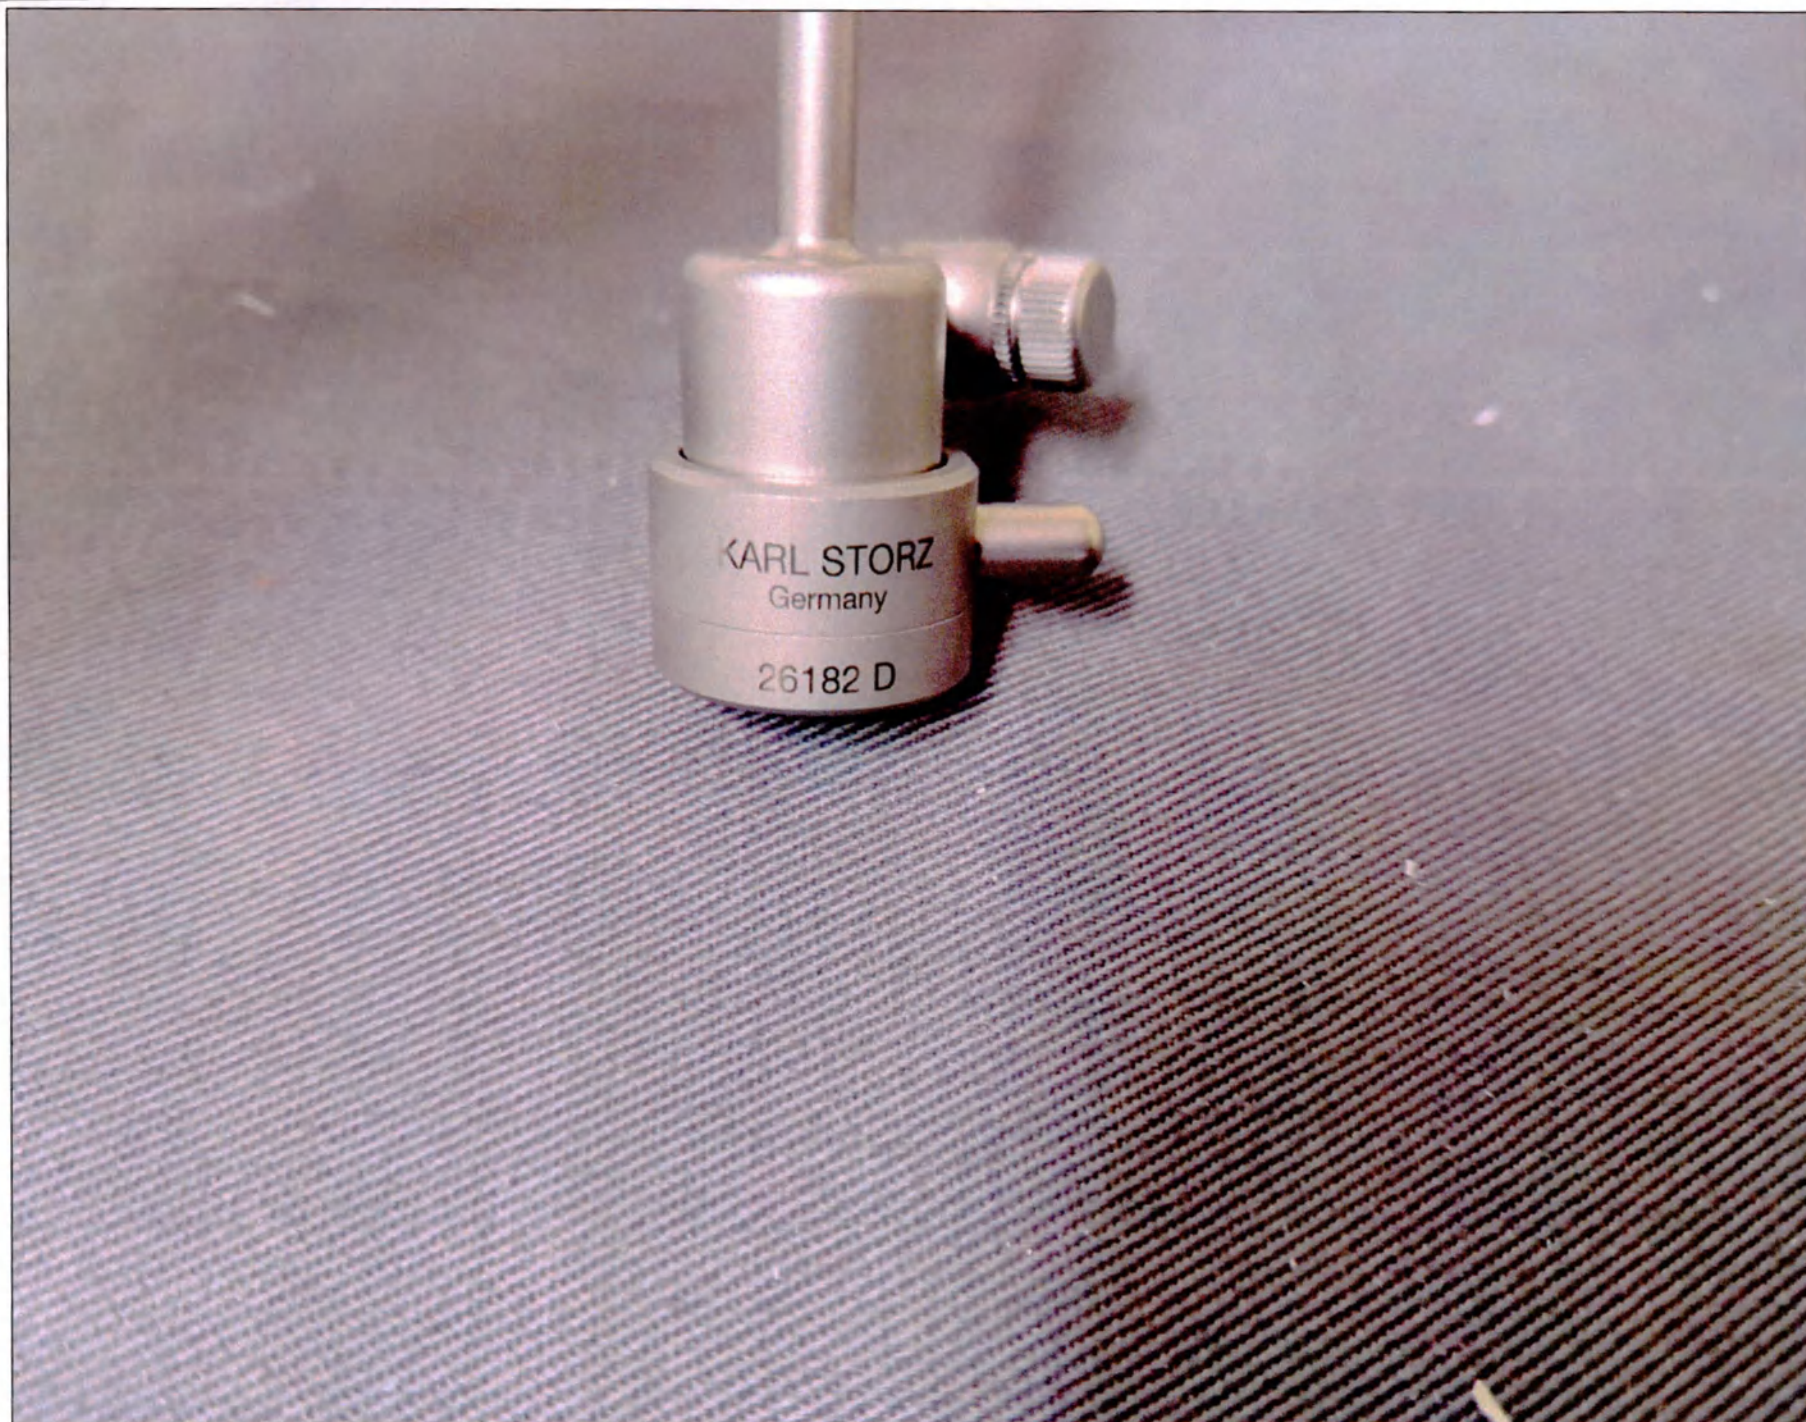


Рис. 62. Тубус диагностический для трансвагинальной эндоскопии, диаметр 3,7 мм, длина 29 см, с одним краном

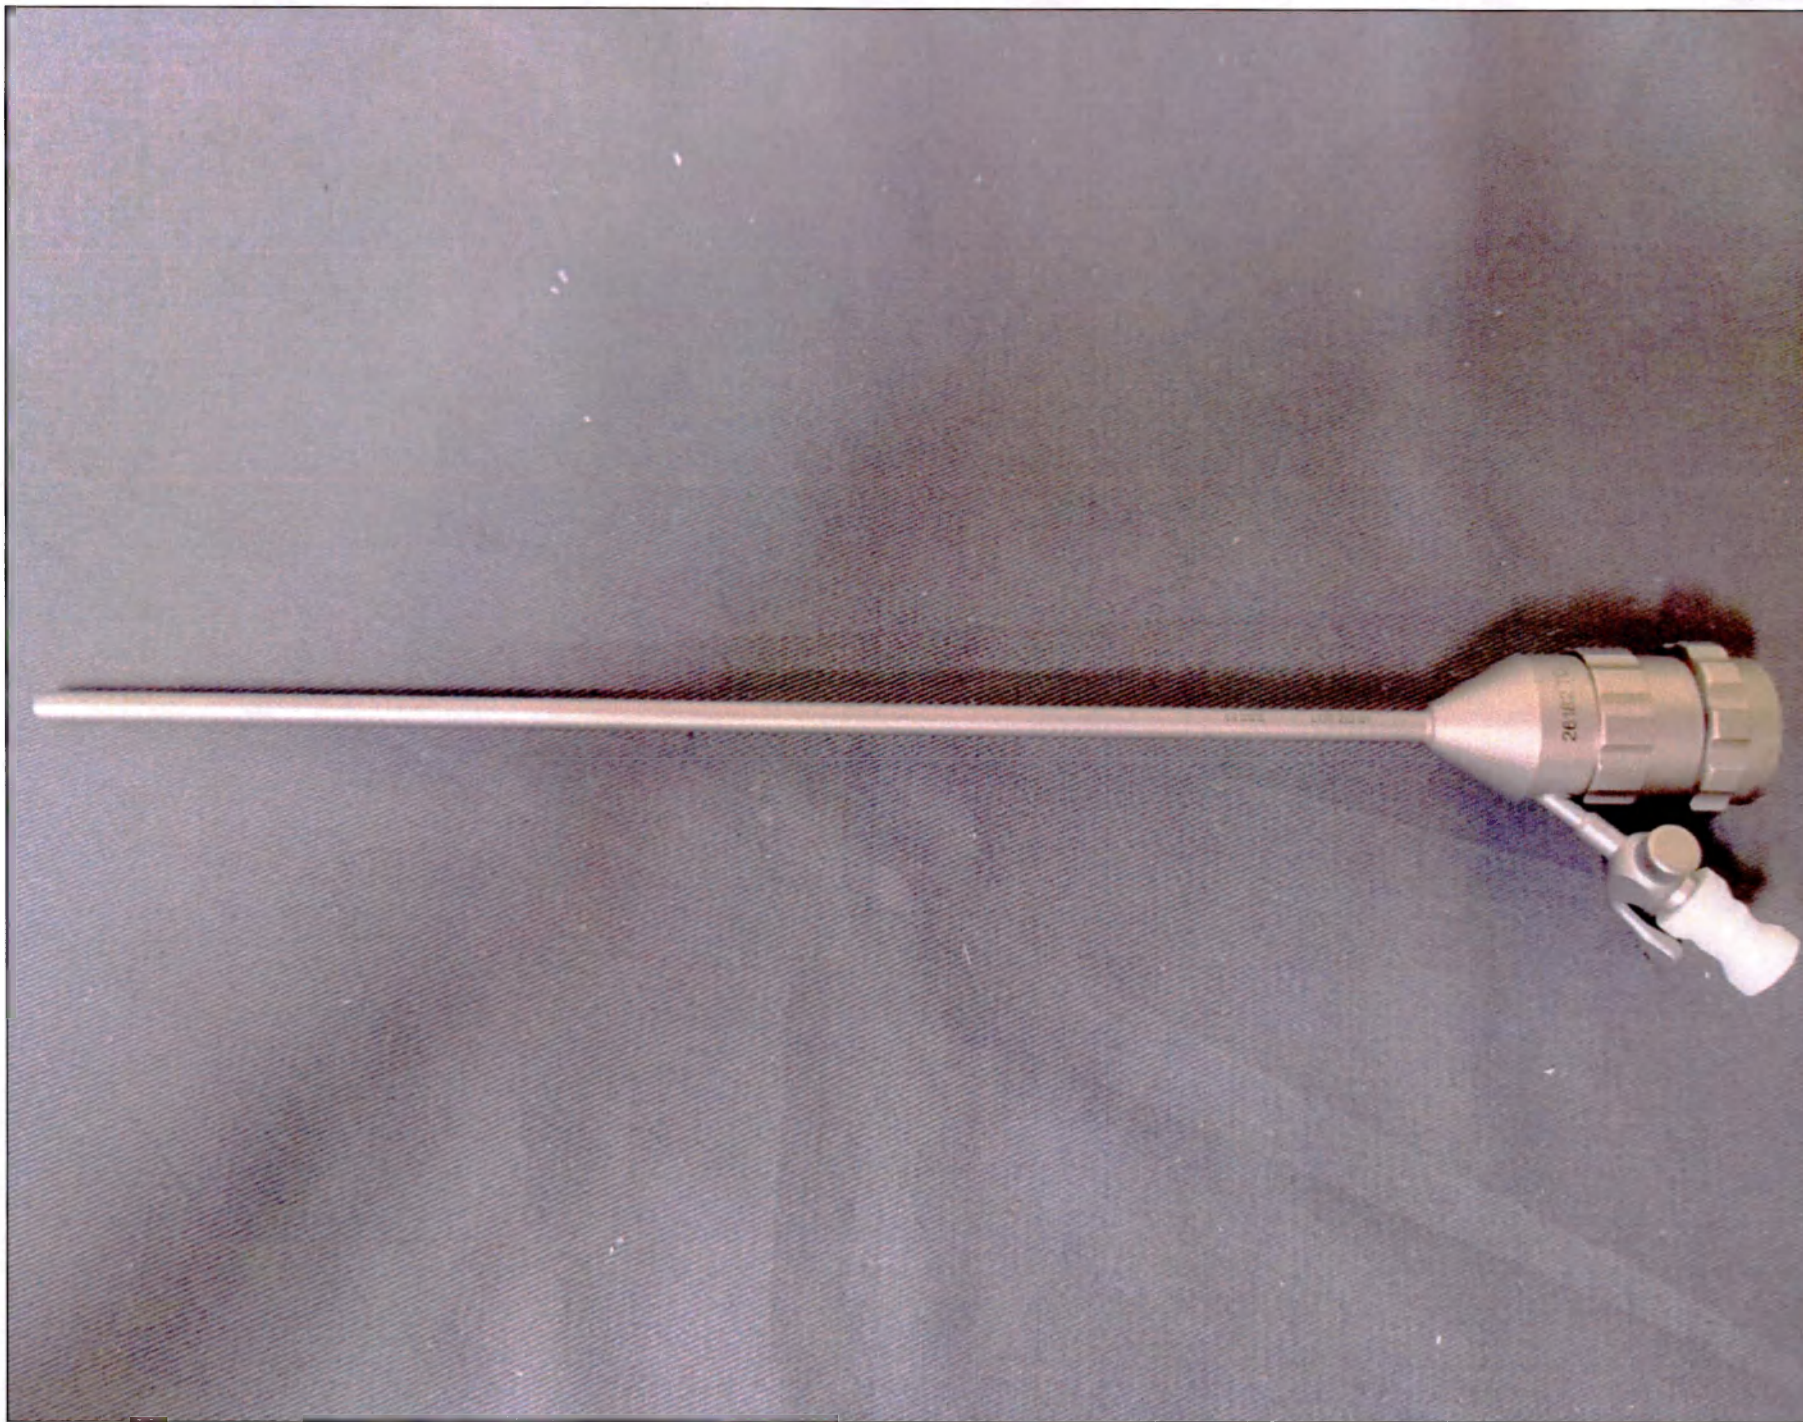


Рис. 63. Тубус для трансвагинальной эндоскопии, диаметр 4,4 мм, длина 20 см.

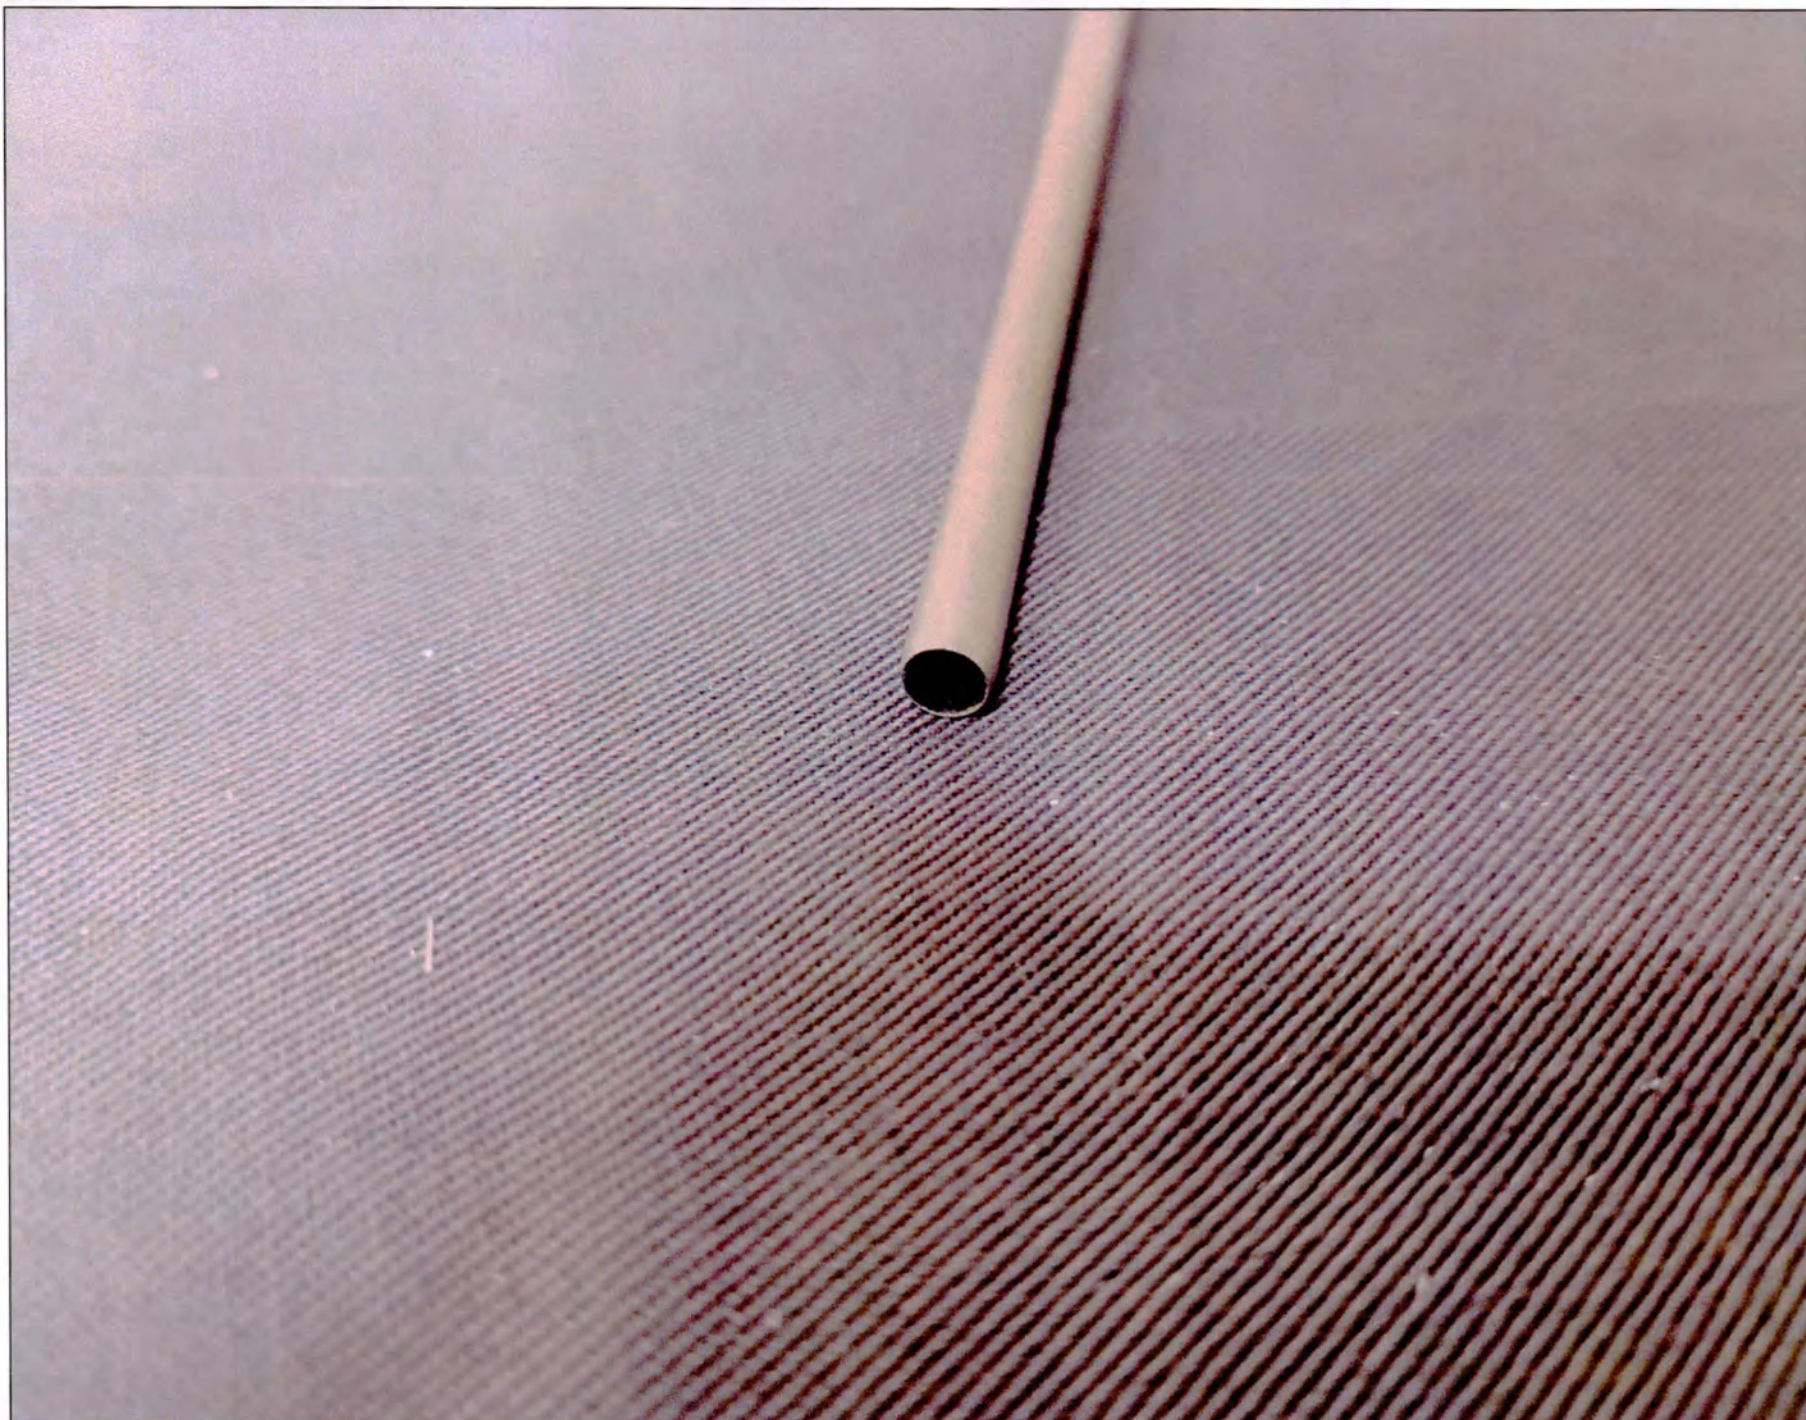


Рис. 64. Тубус для трансвагинальной эндоскопии, диаметр 4,4 мм, длина 20 см.



Рис. 65. Тубус для трансвагинальной эндоскопии, диаметр 4,4 мм, длина 20 см.



Рис. 66. Тубус для трансвагинальной эндоскопии, диаметр 4,4 мм, длина 20 см.

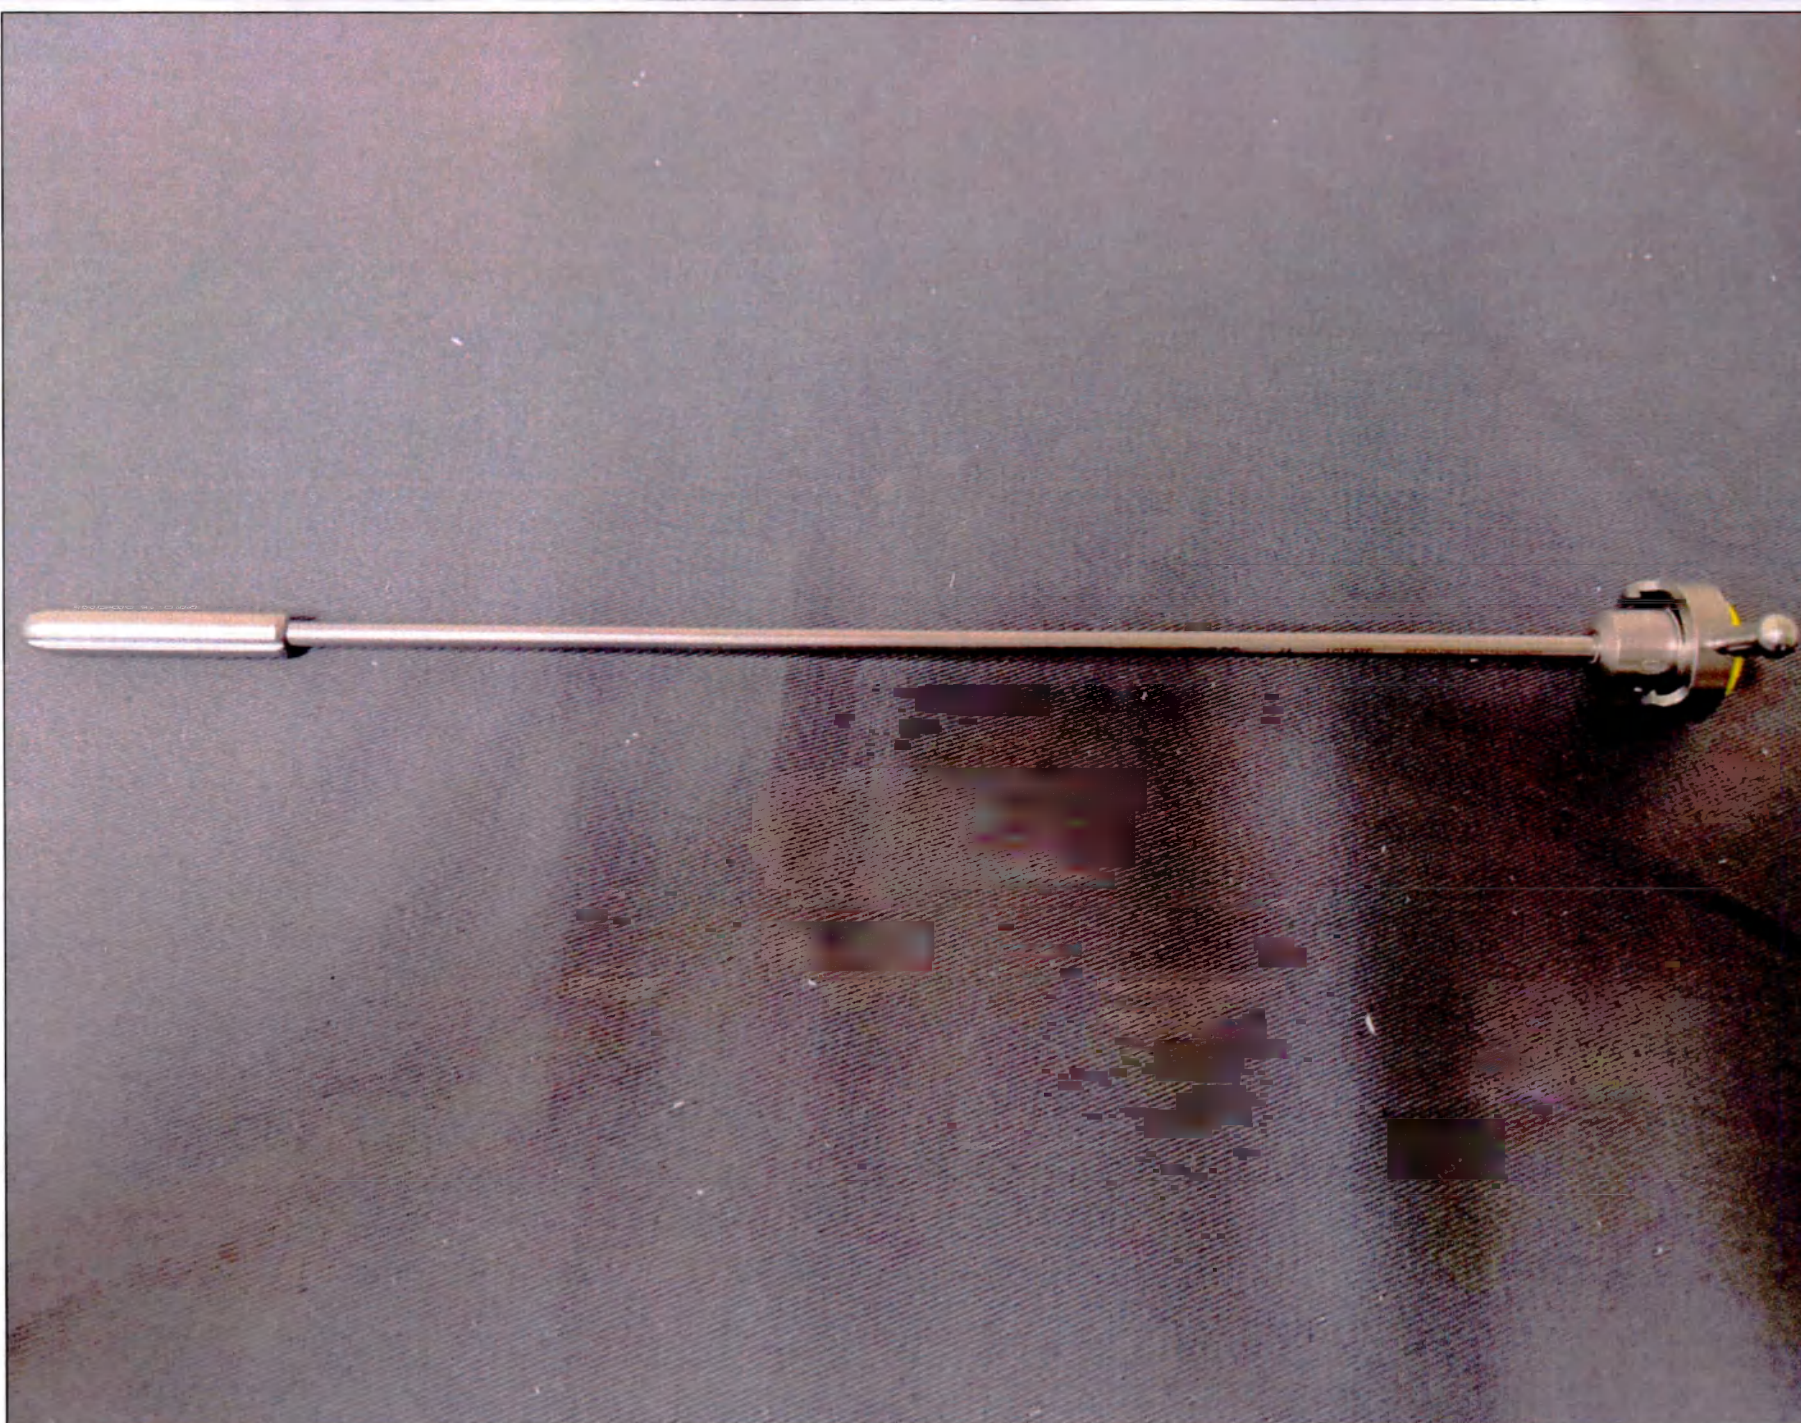


Рис. 67. Обтуратор стандартный, диаметр 7 мм, длина 25 см. Имеют схожий внешний вид, отличаются размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор стандартный, диаметр 4 мм, длина 25 см, Обтуратор стандартный, диаметр 6 мм, длина 25 мм

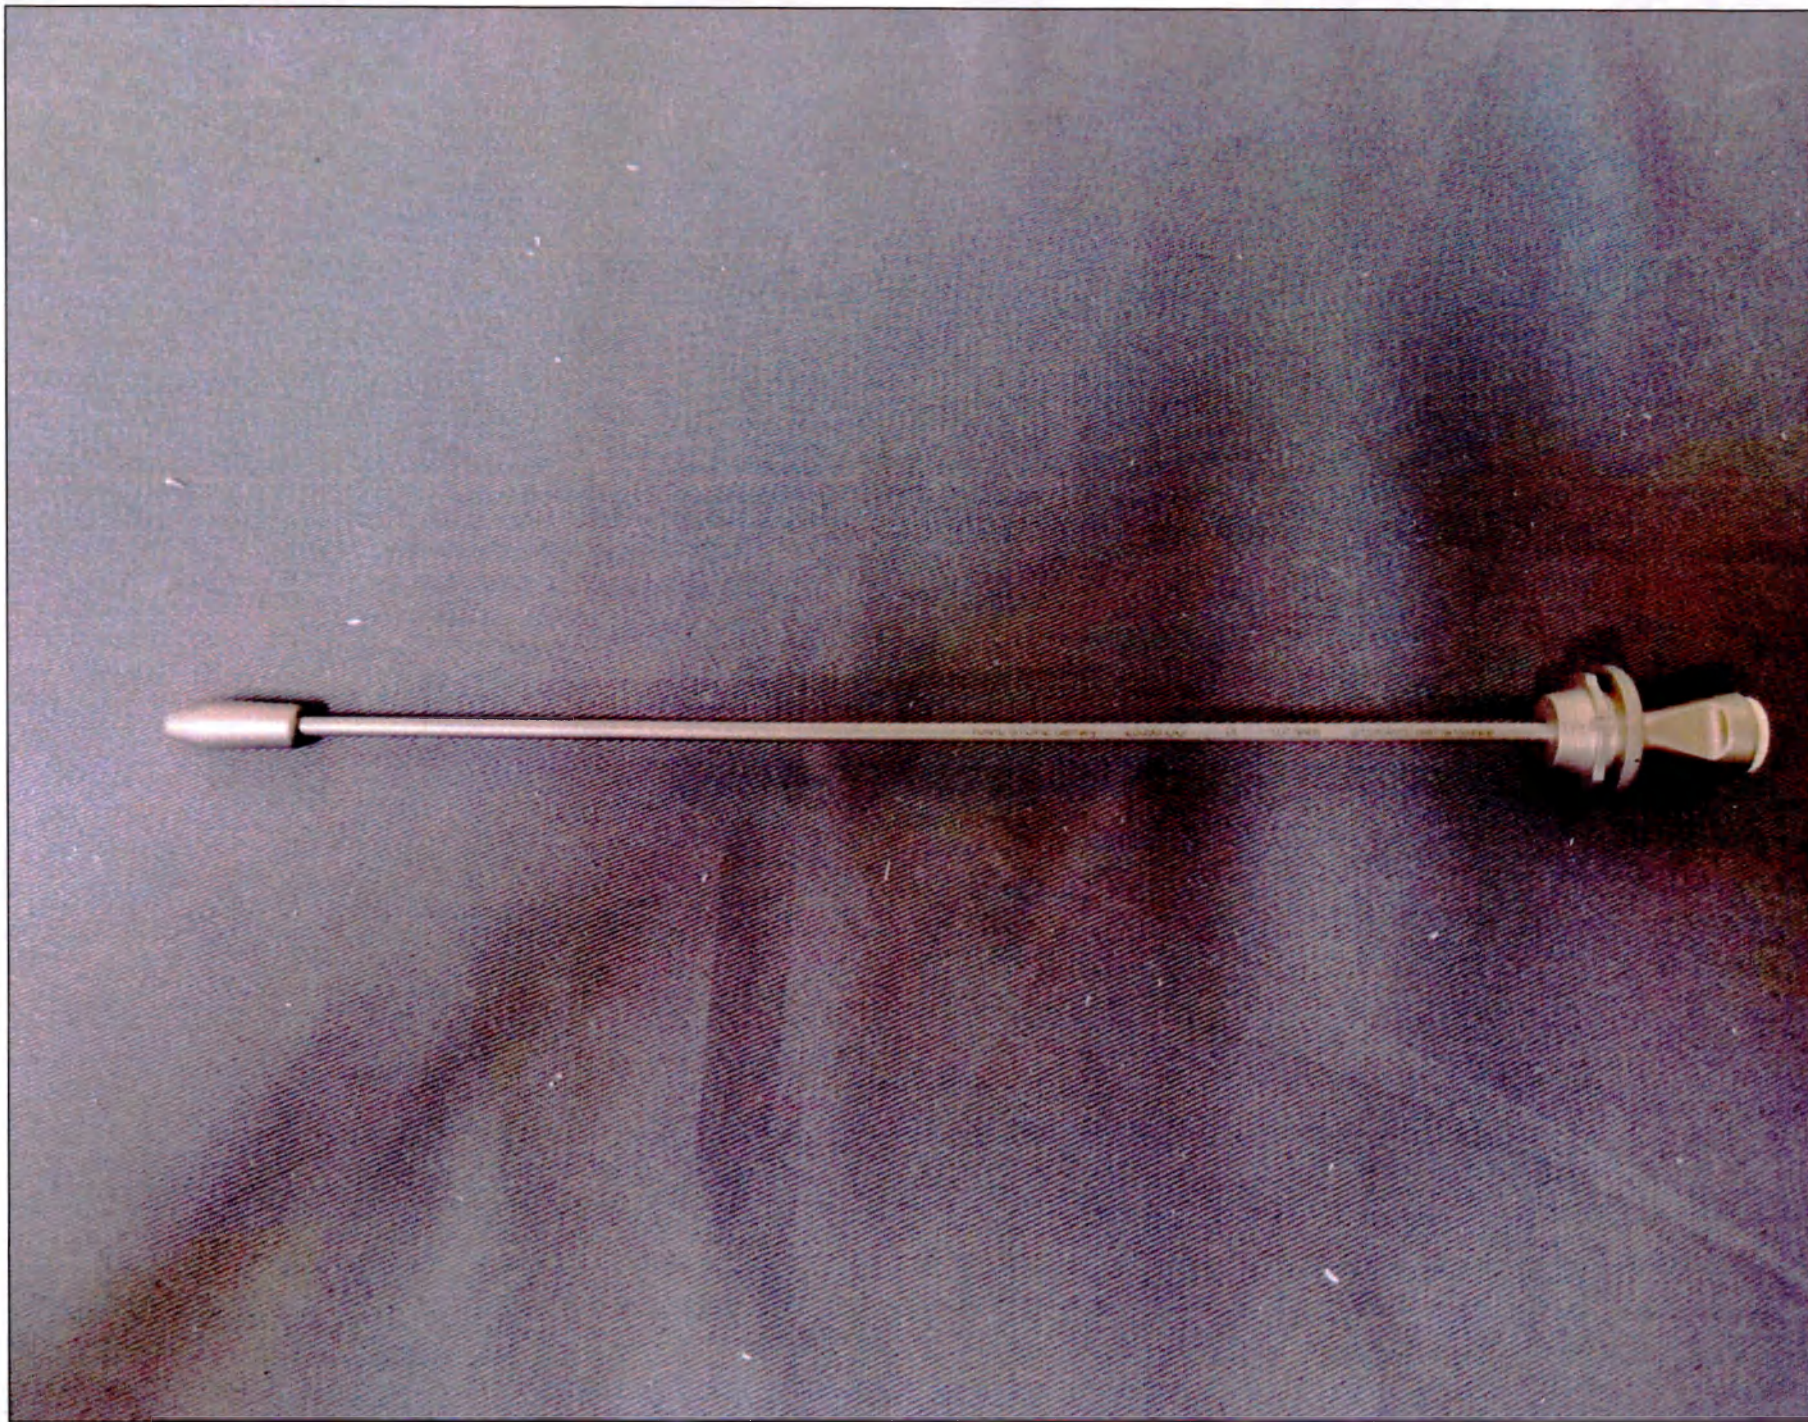


Рис. 69. Обтуратор полый, диаметр 7 мм, длина 24 см

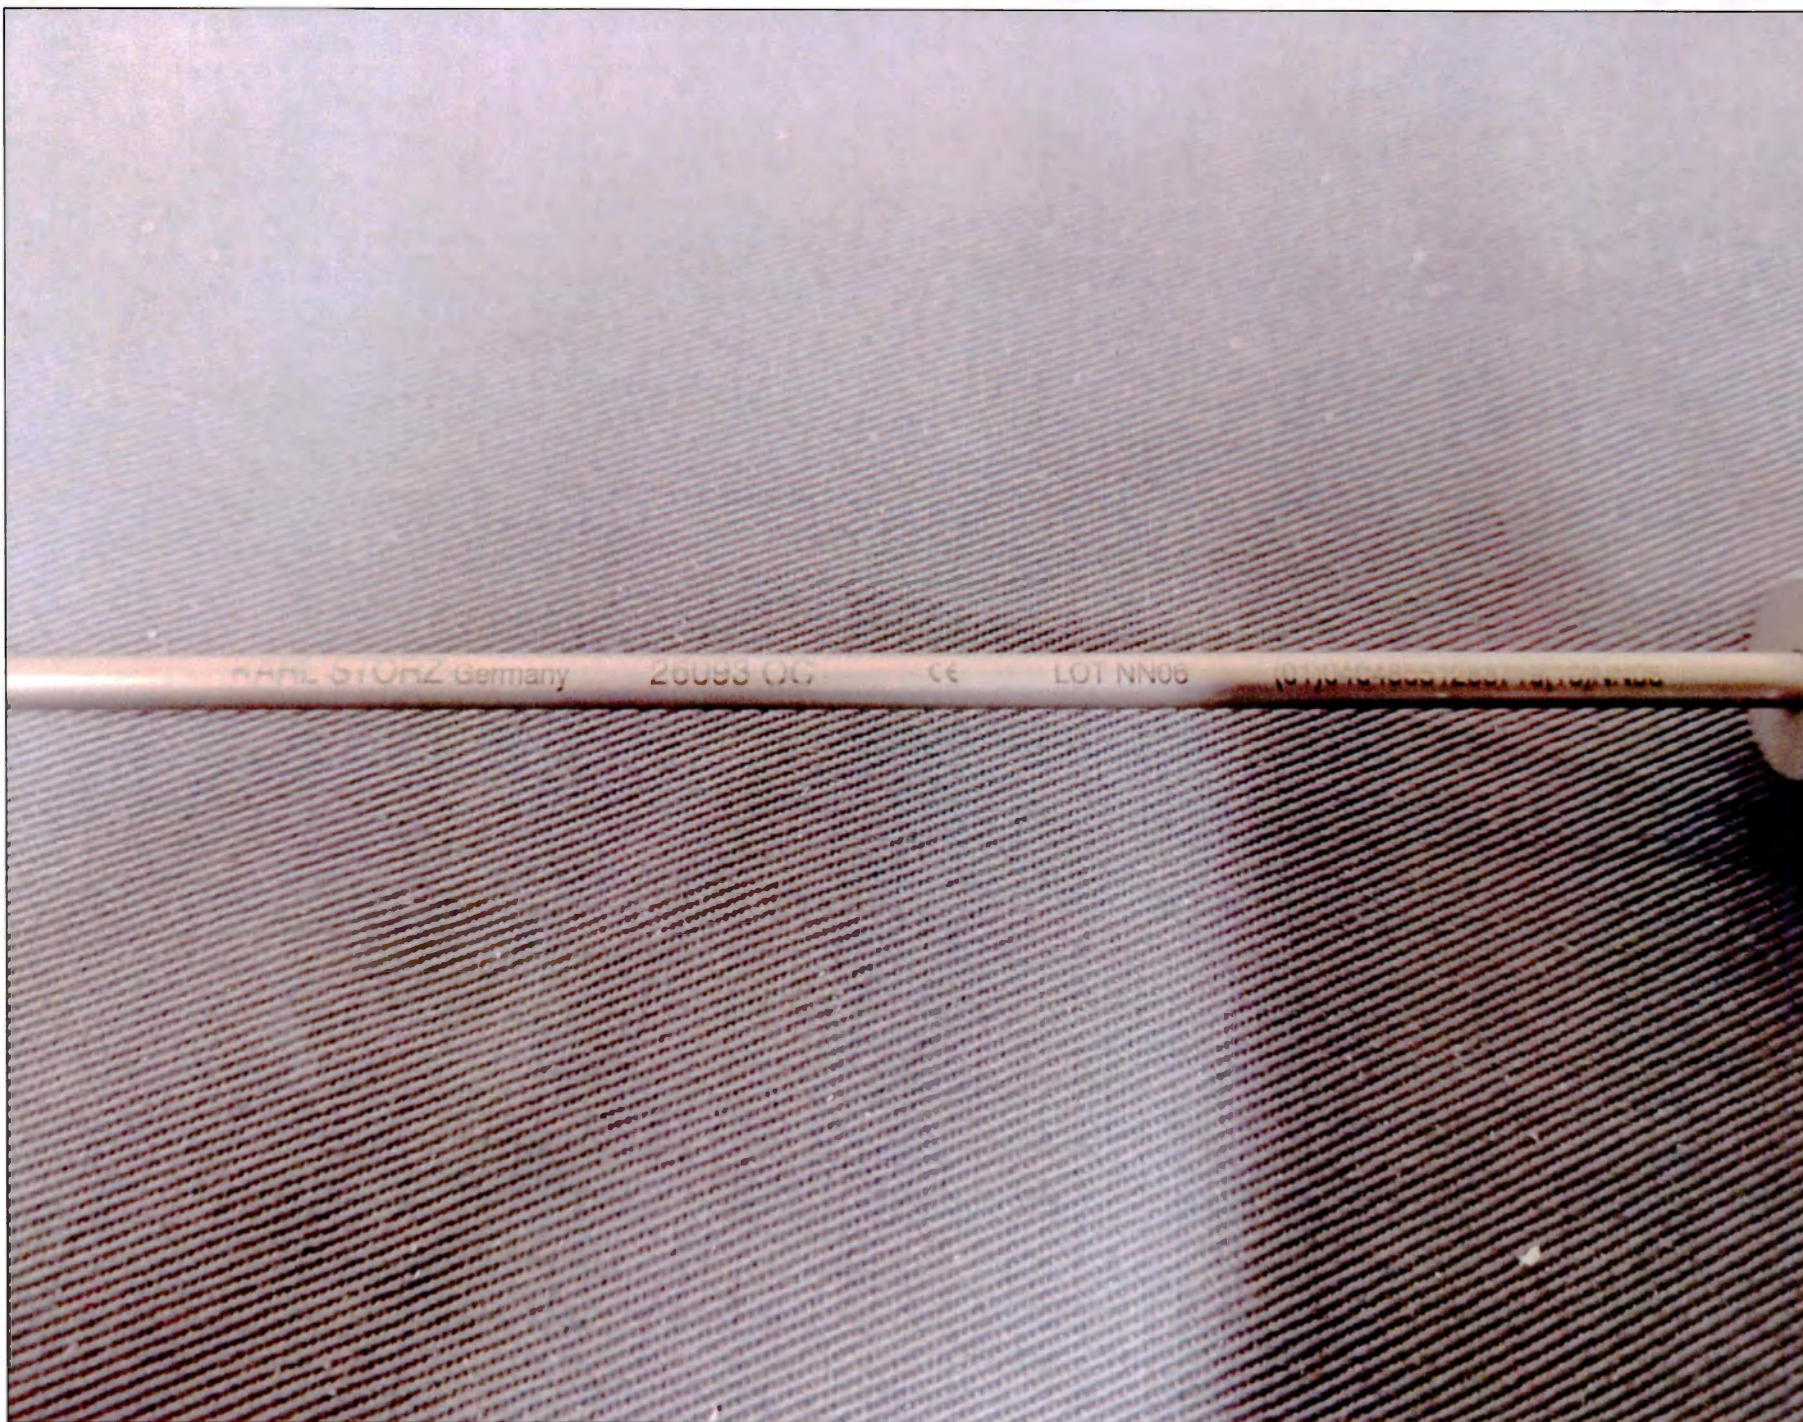


Рис. 70. Обтуратор полый, диаметр 7 мм, длина 24 см

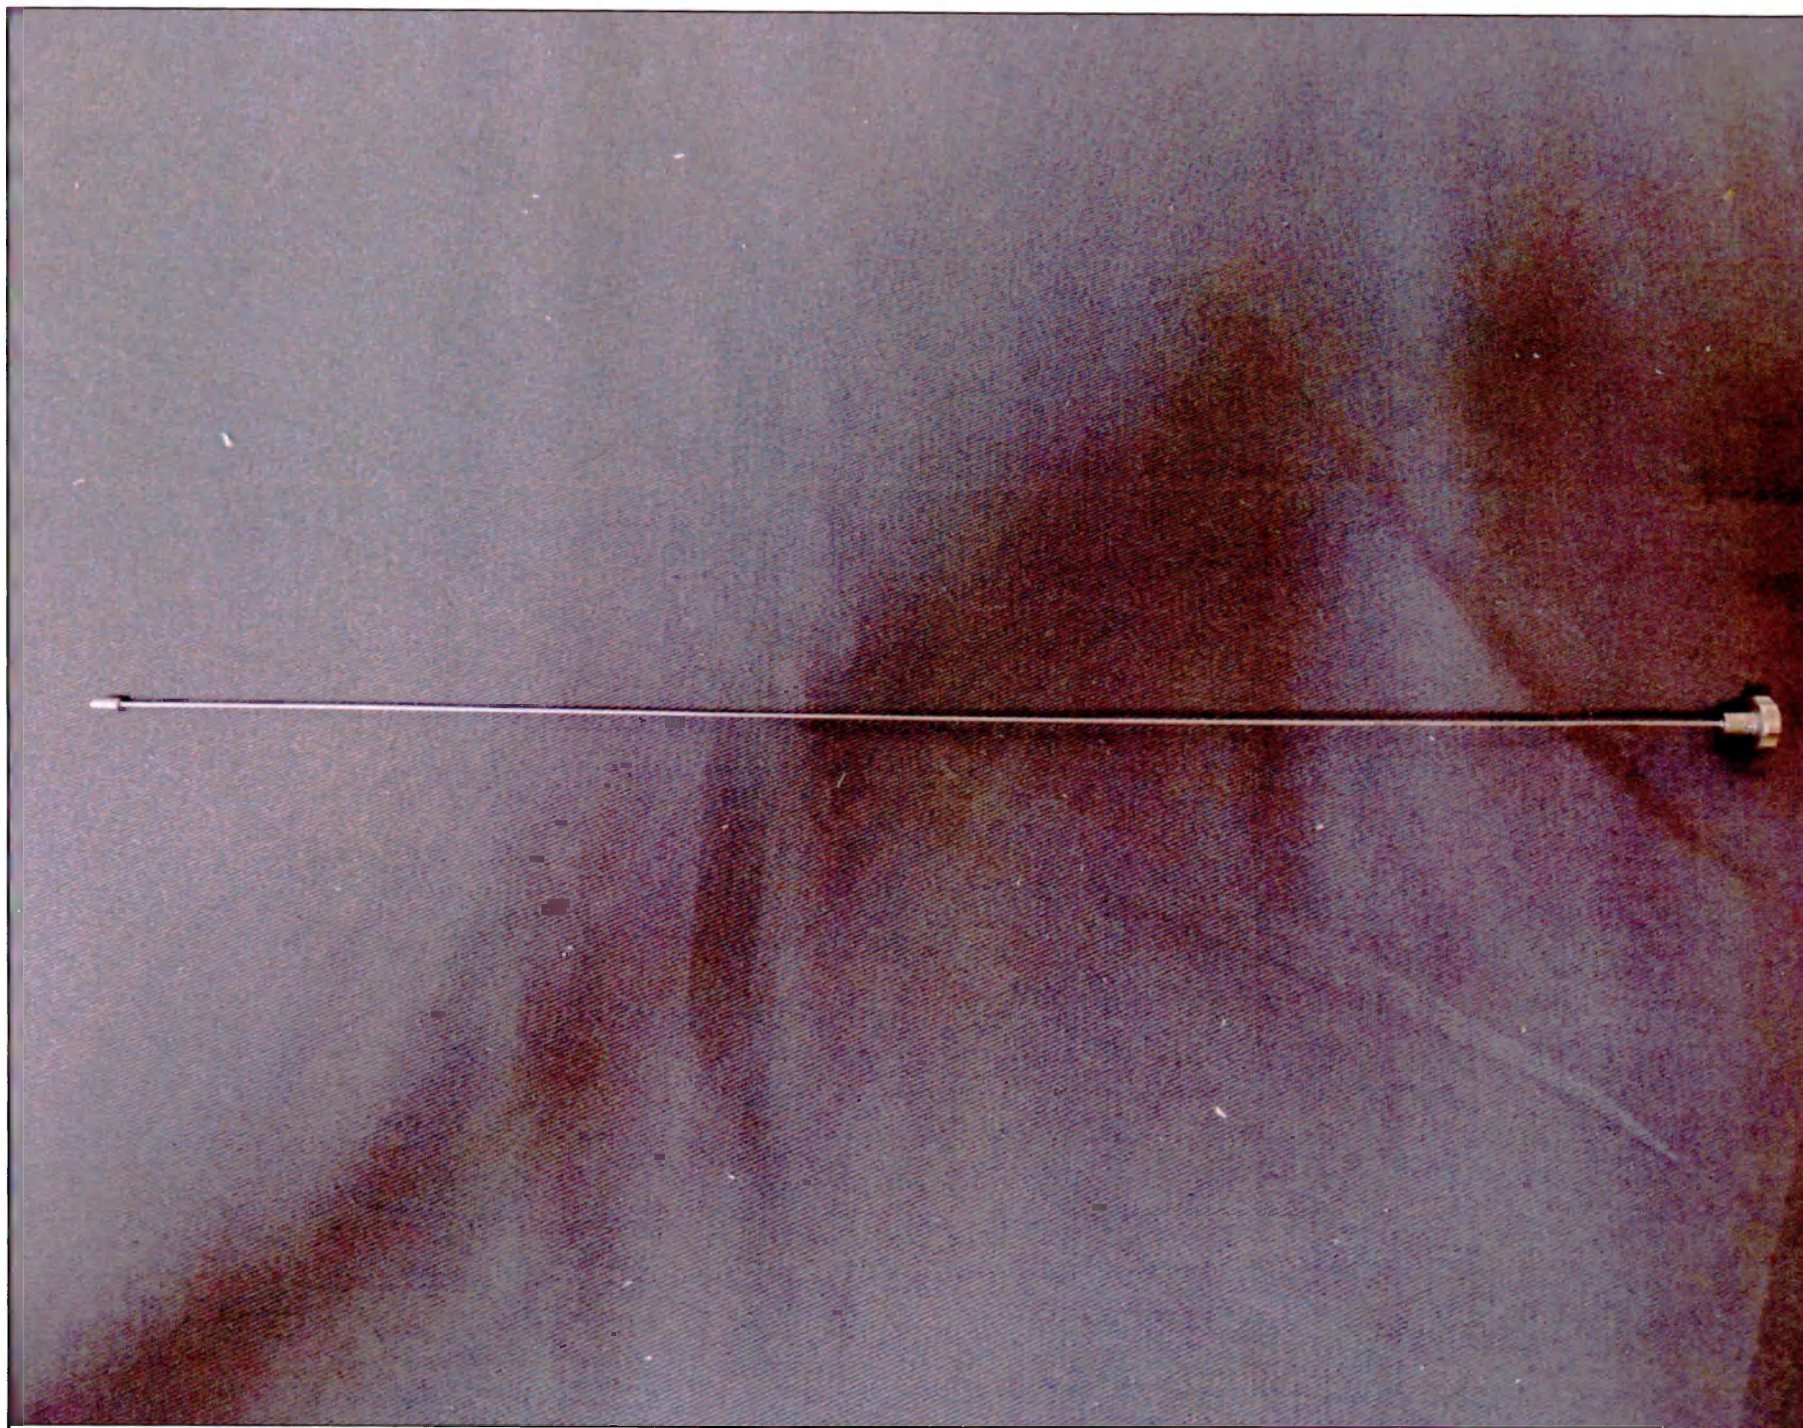


Рис. 71. Обтуратор, диаметр 2 мм, длина 29 см.

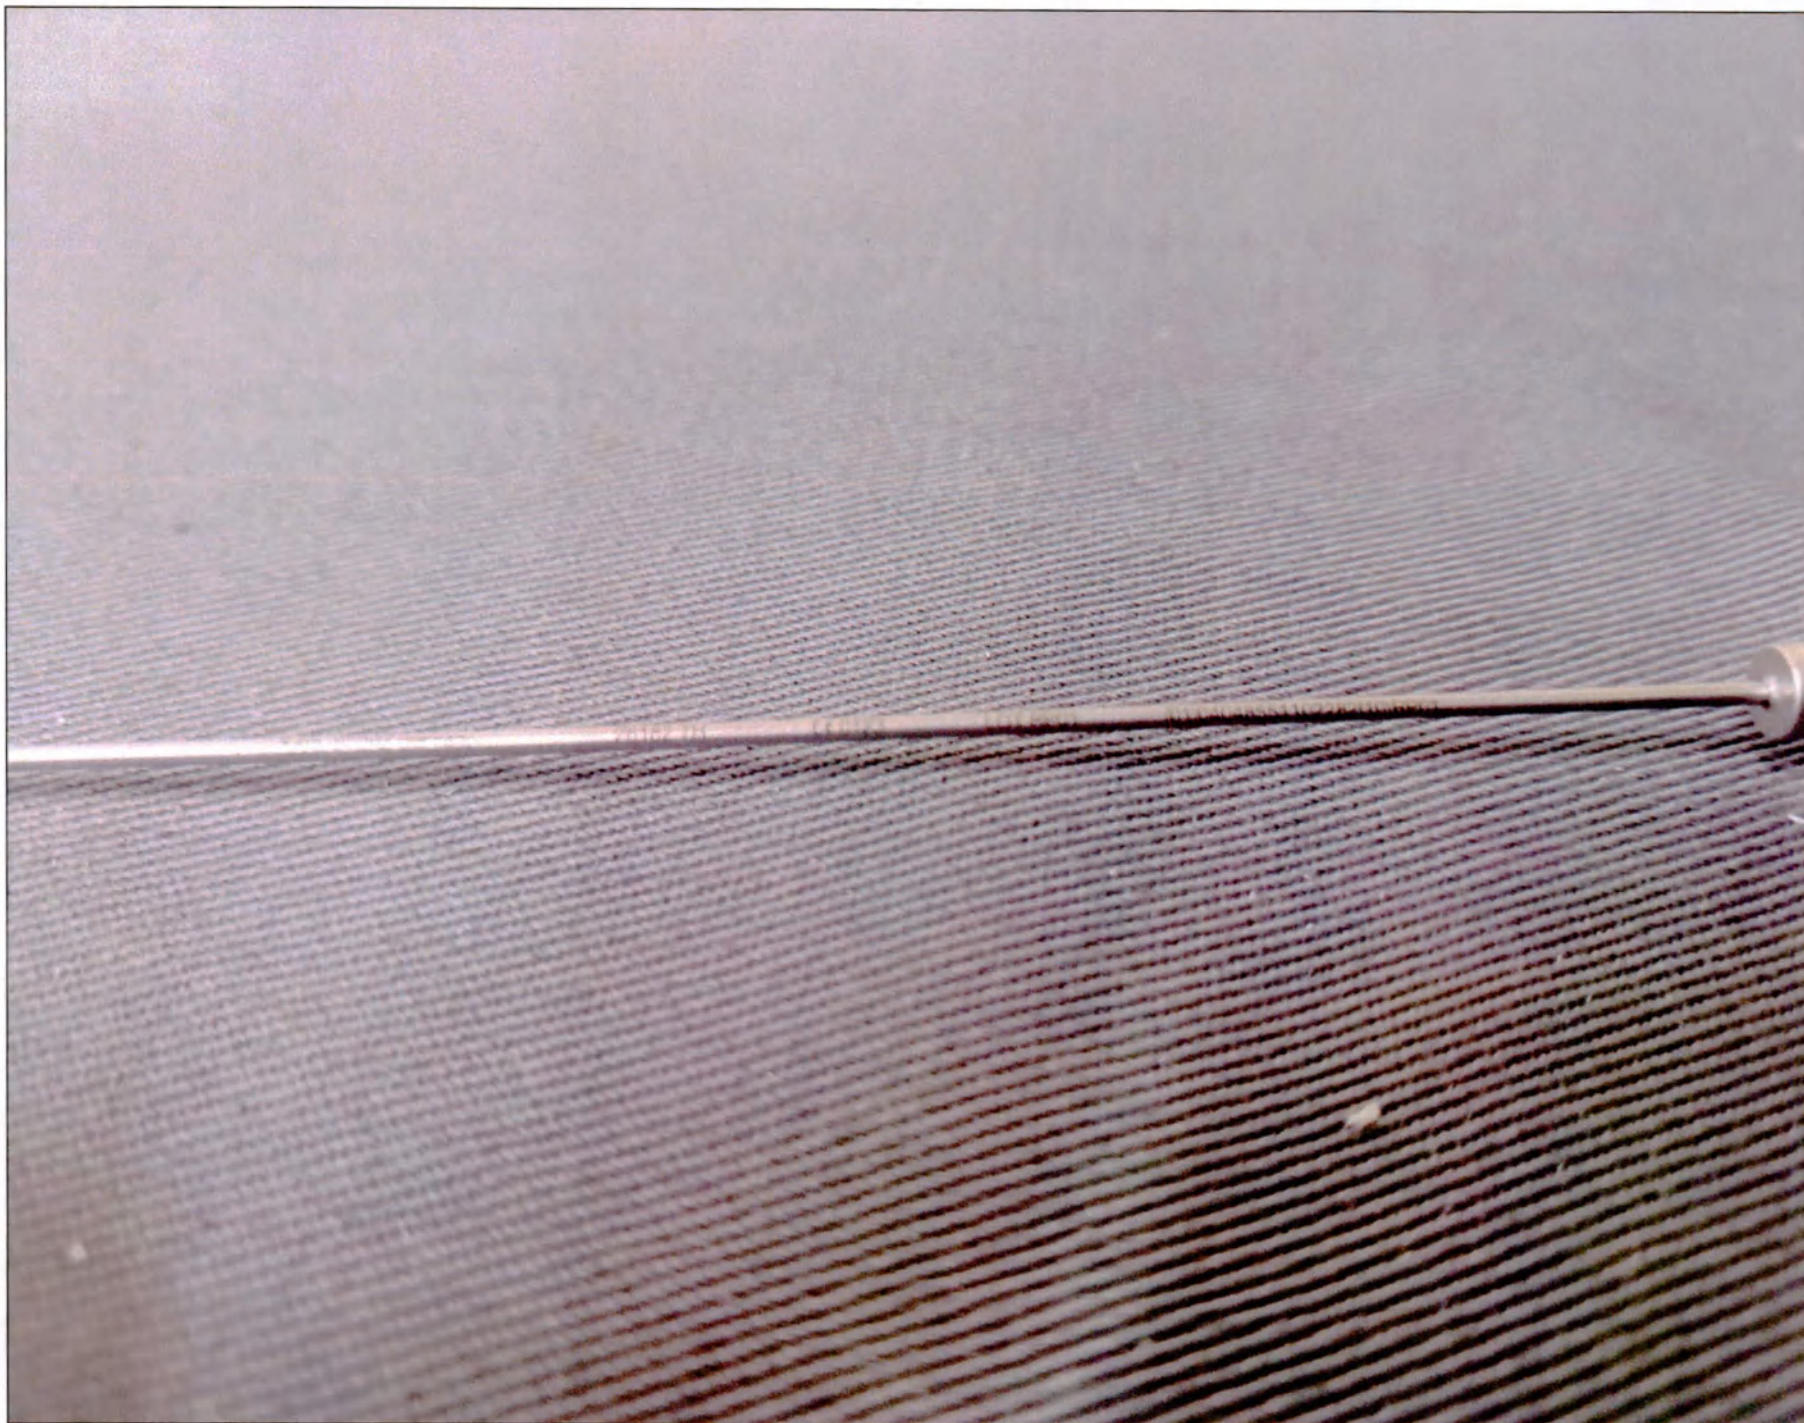


Рис. 72. Обтуратор, диаметр 2 мм, длина 29 см.

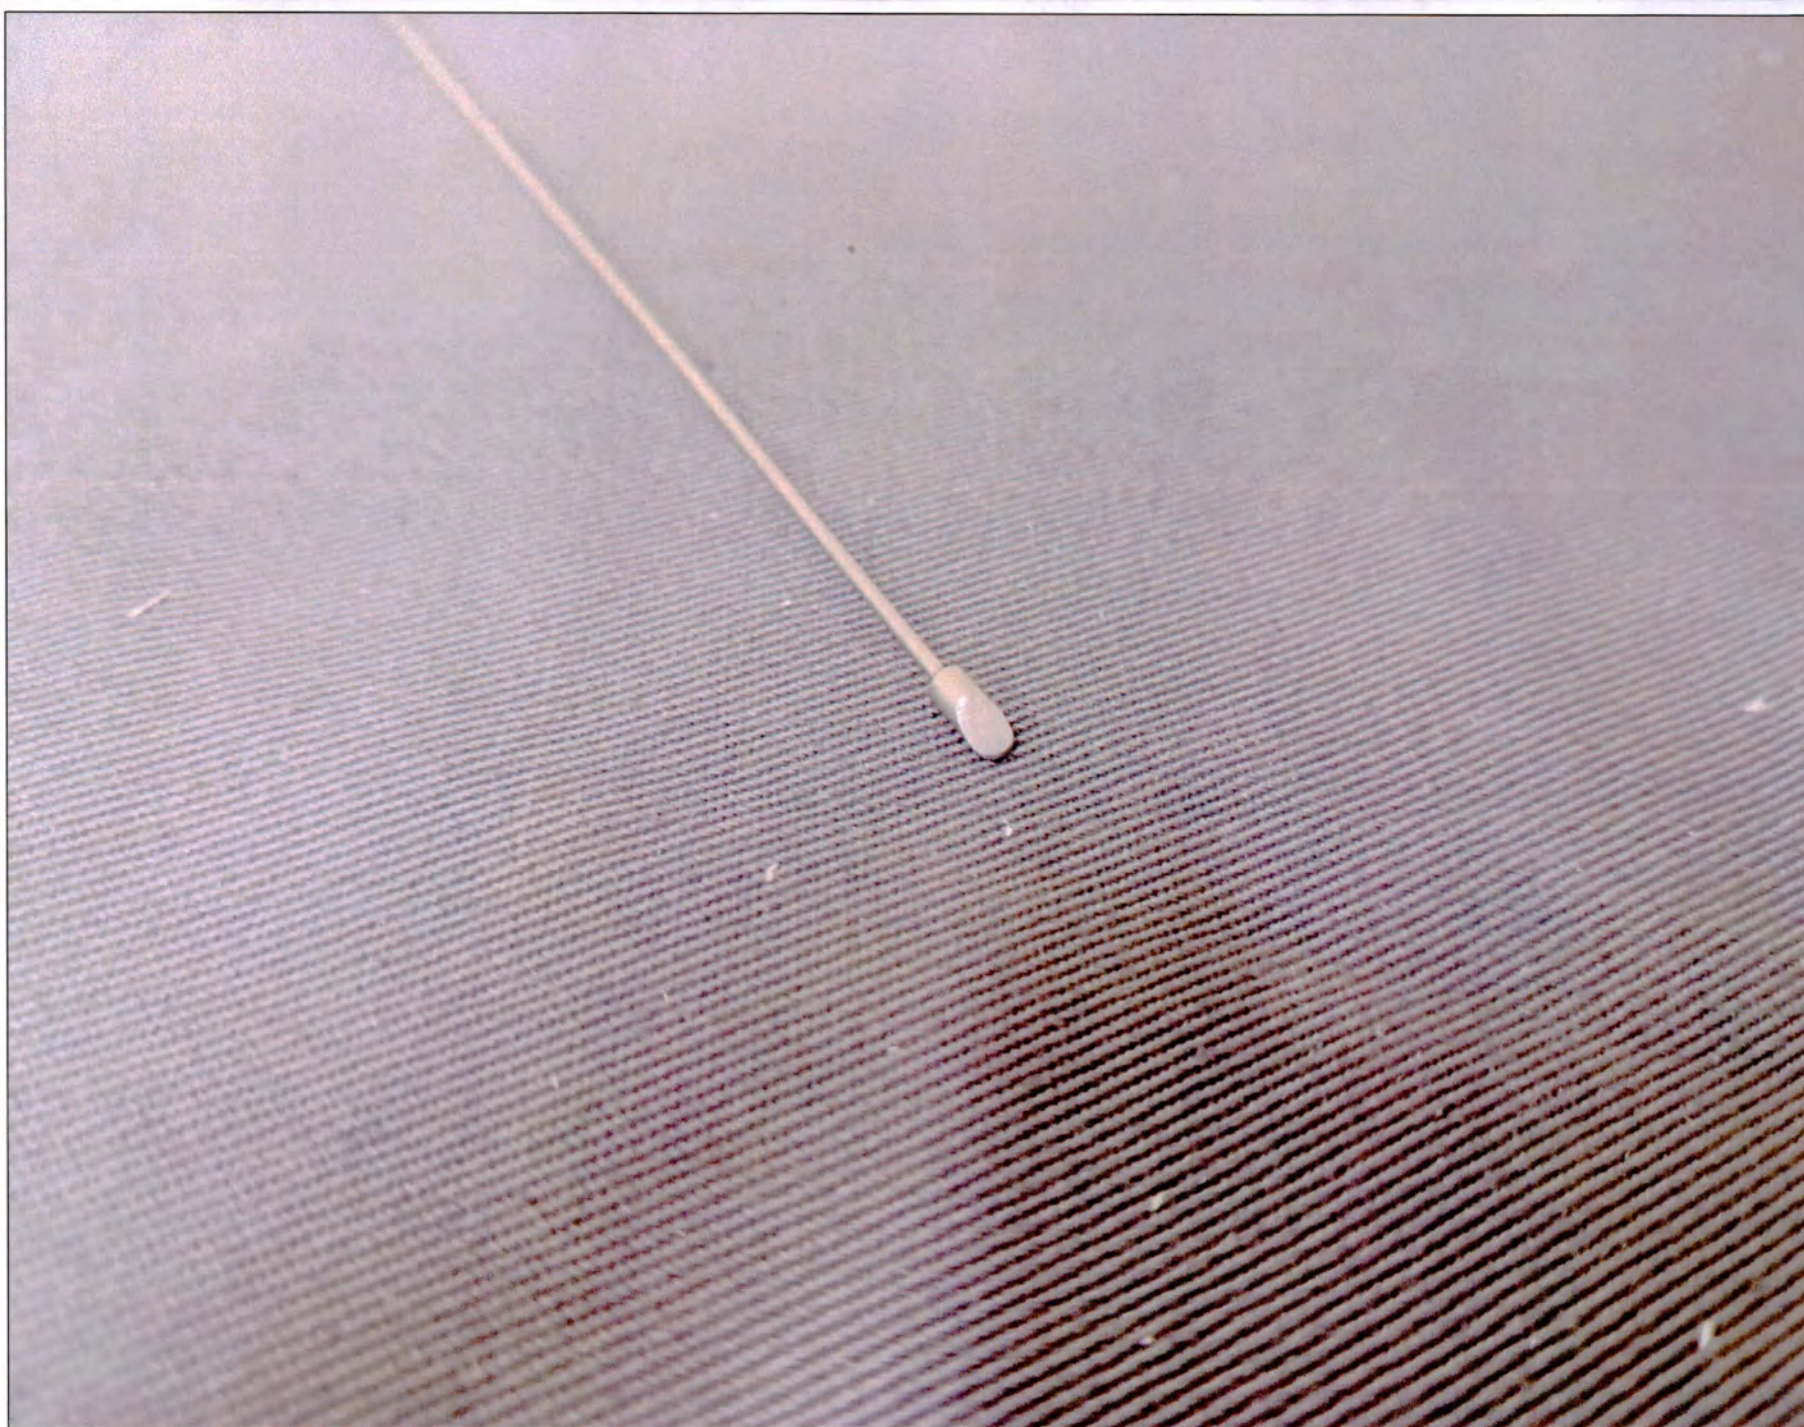


Рис. 73. Обтуратор, диаметр 2 мм, длина 29 см.

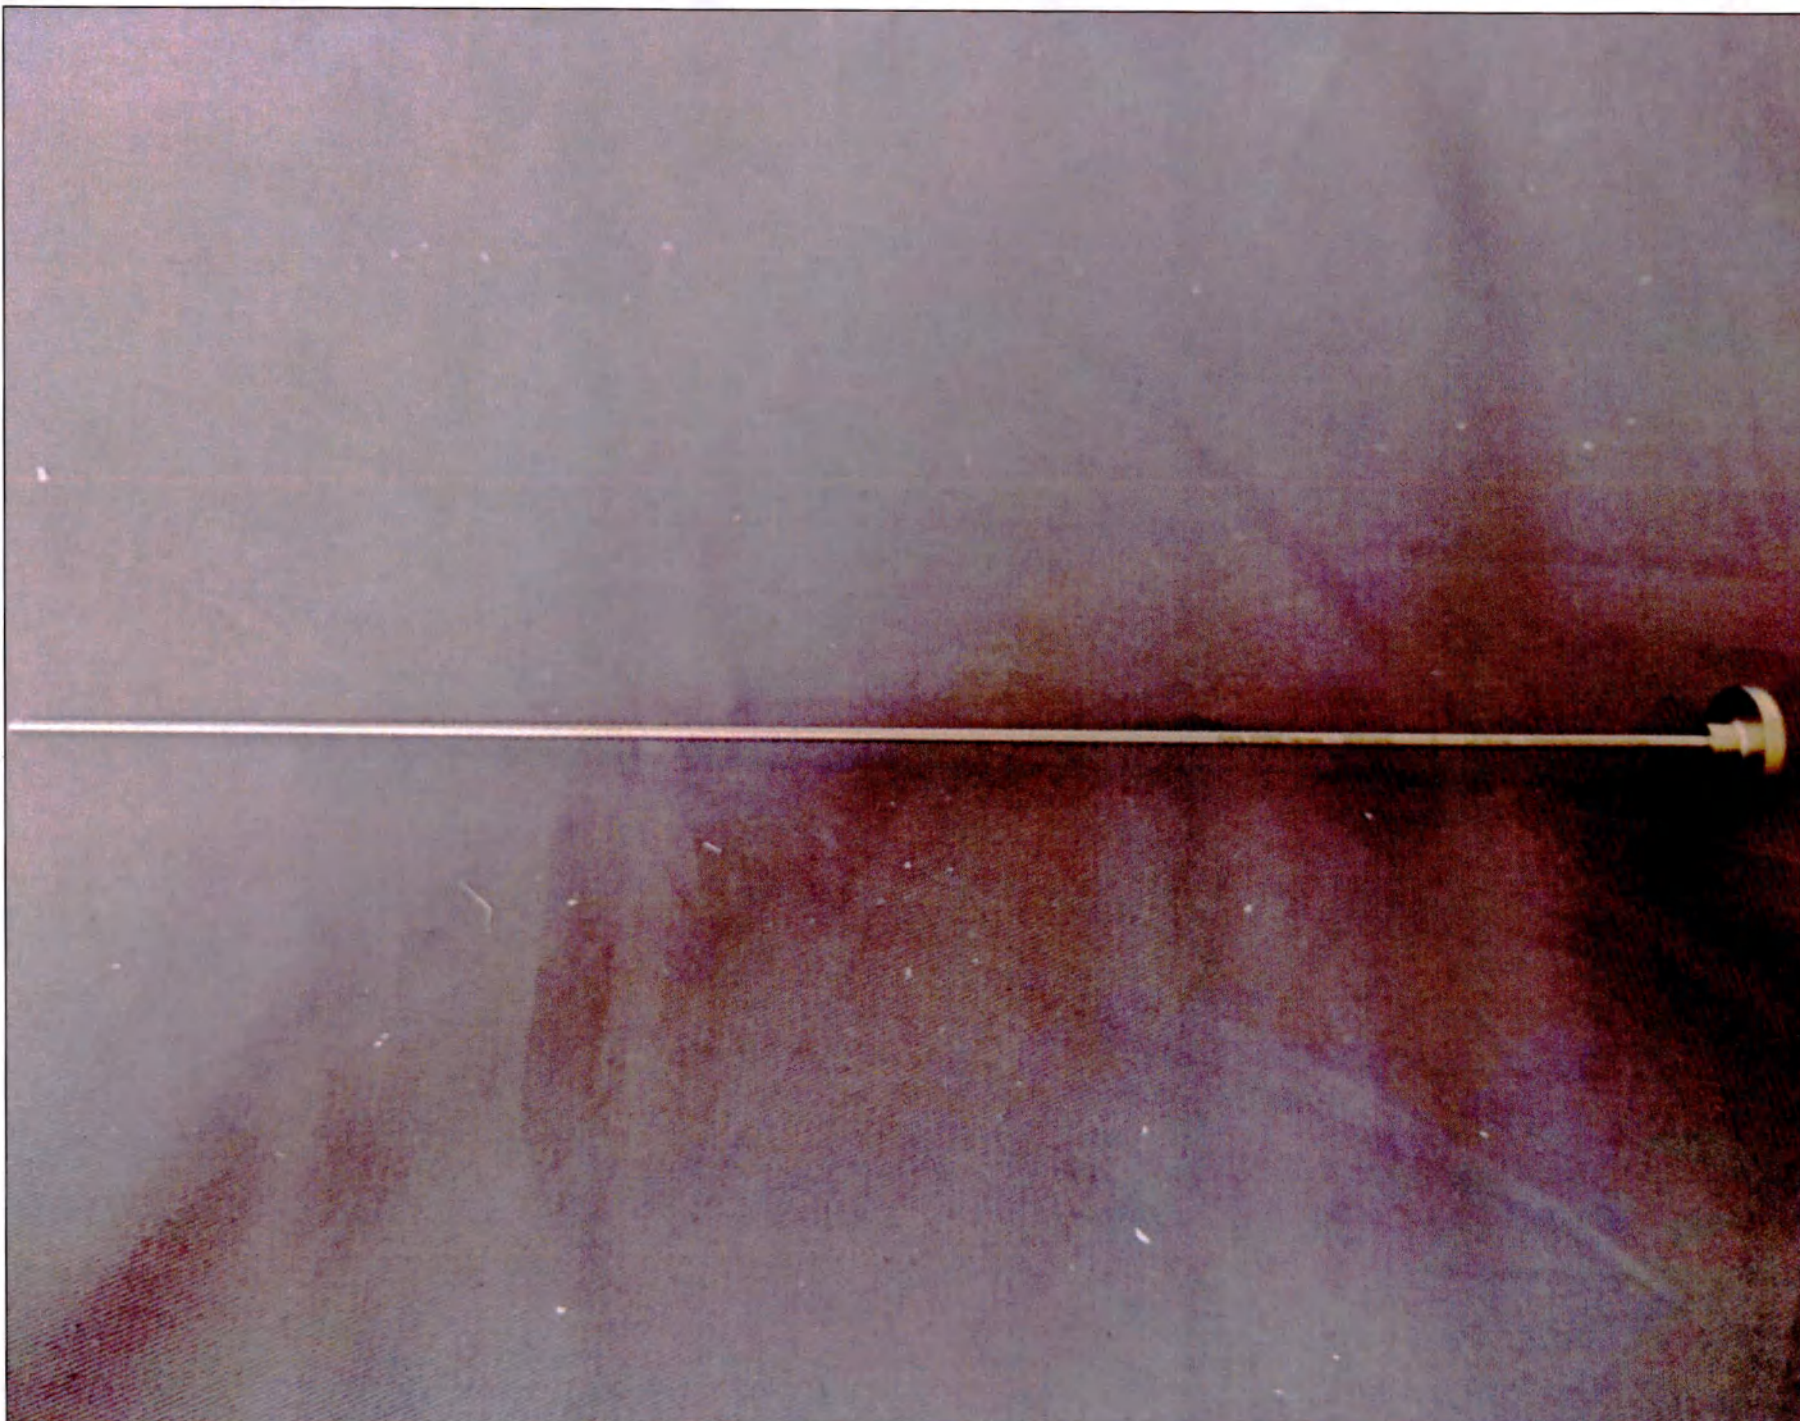


Рис. 74. Обтуратор, диаметр 2 мм, длина 28 см, также имеется в составе изделия Вставка рабочая фетоскопа с направляющим рычагом

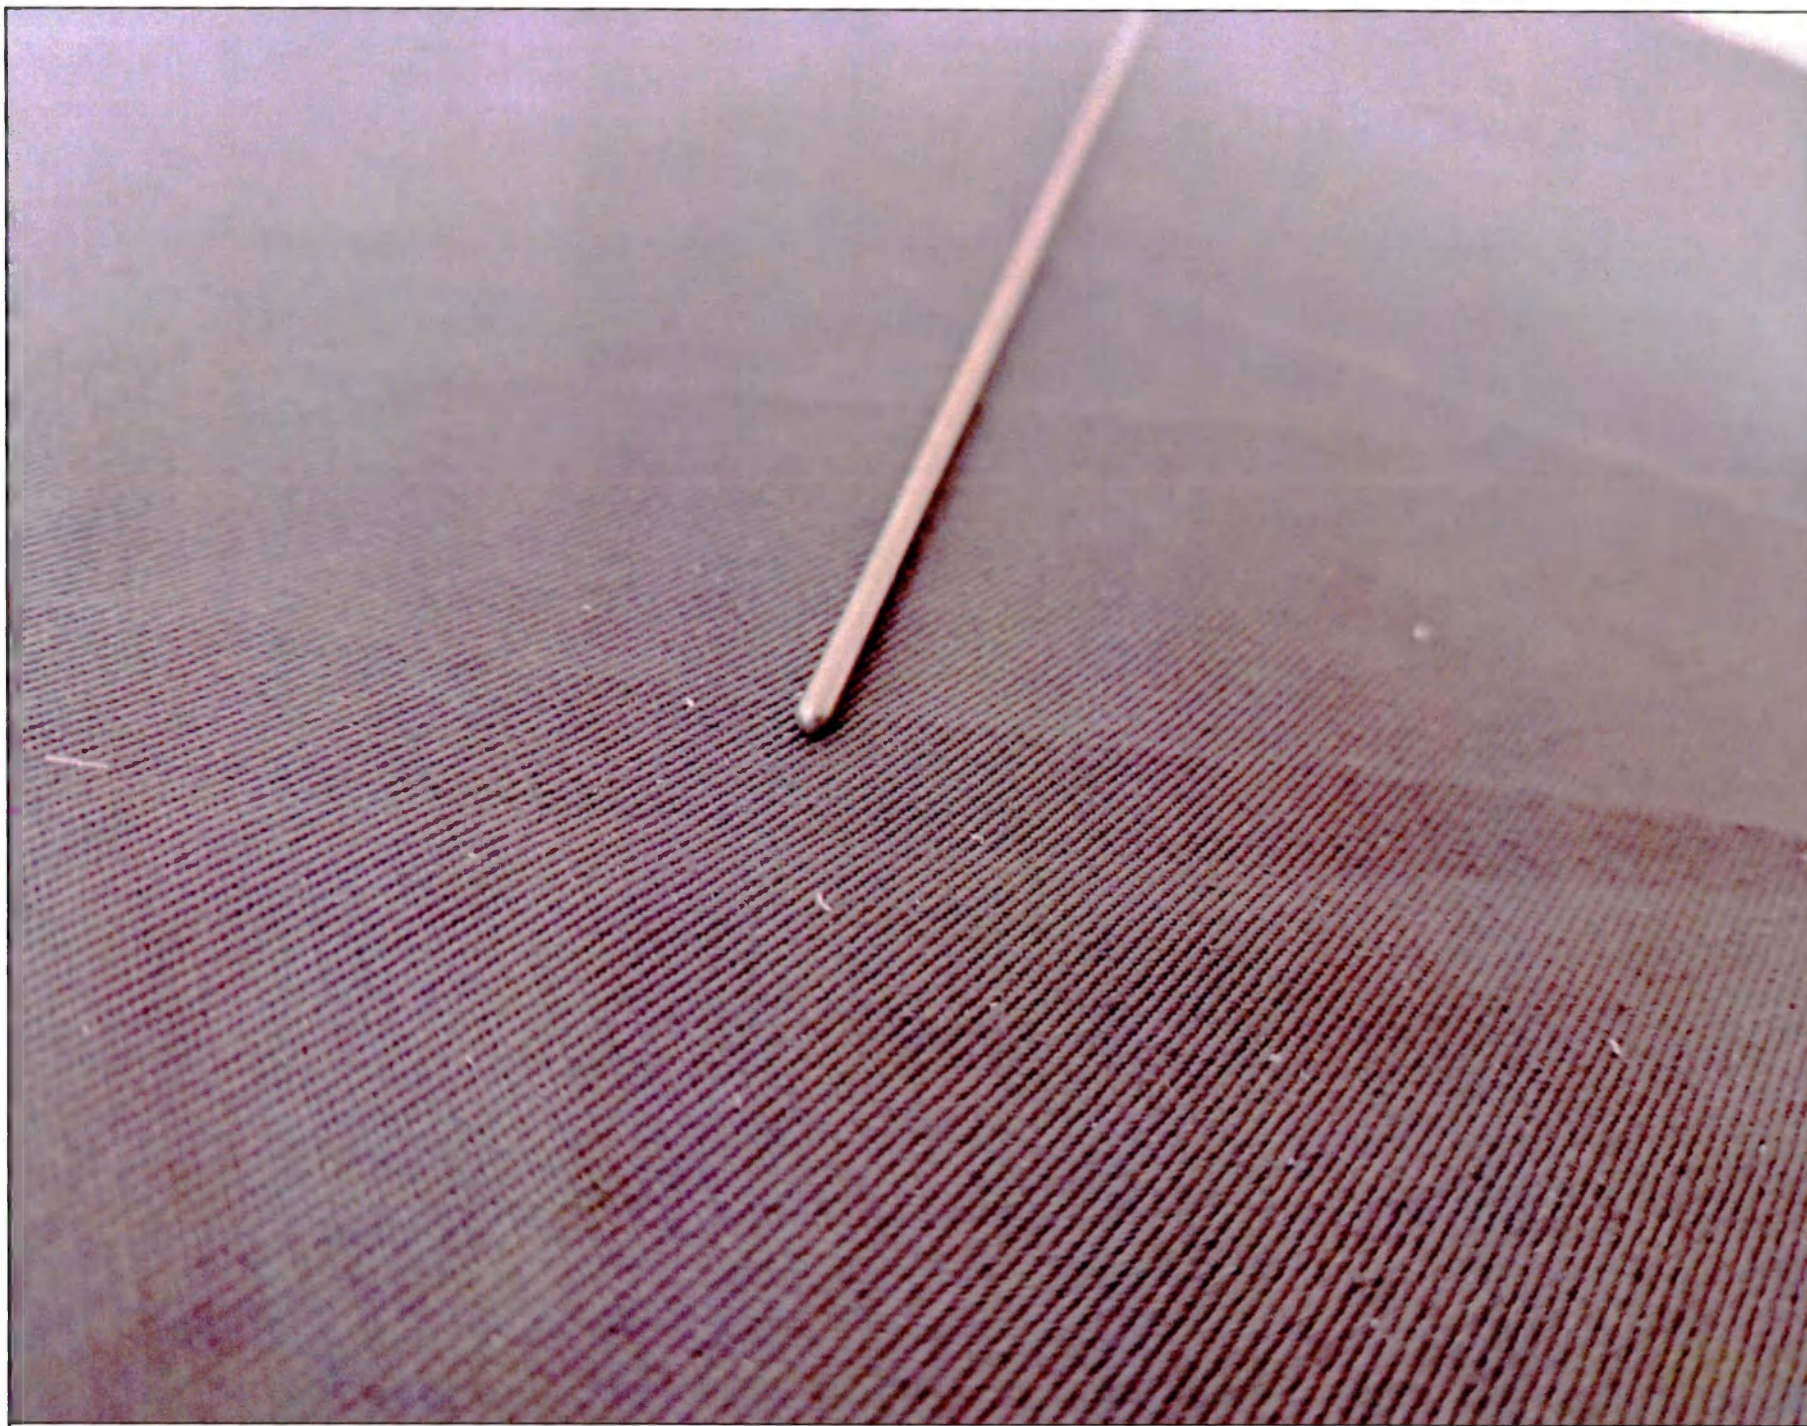


Рис. 75. Обтуратор, диаметр 2 мм, длина 28 см.

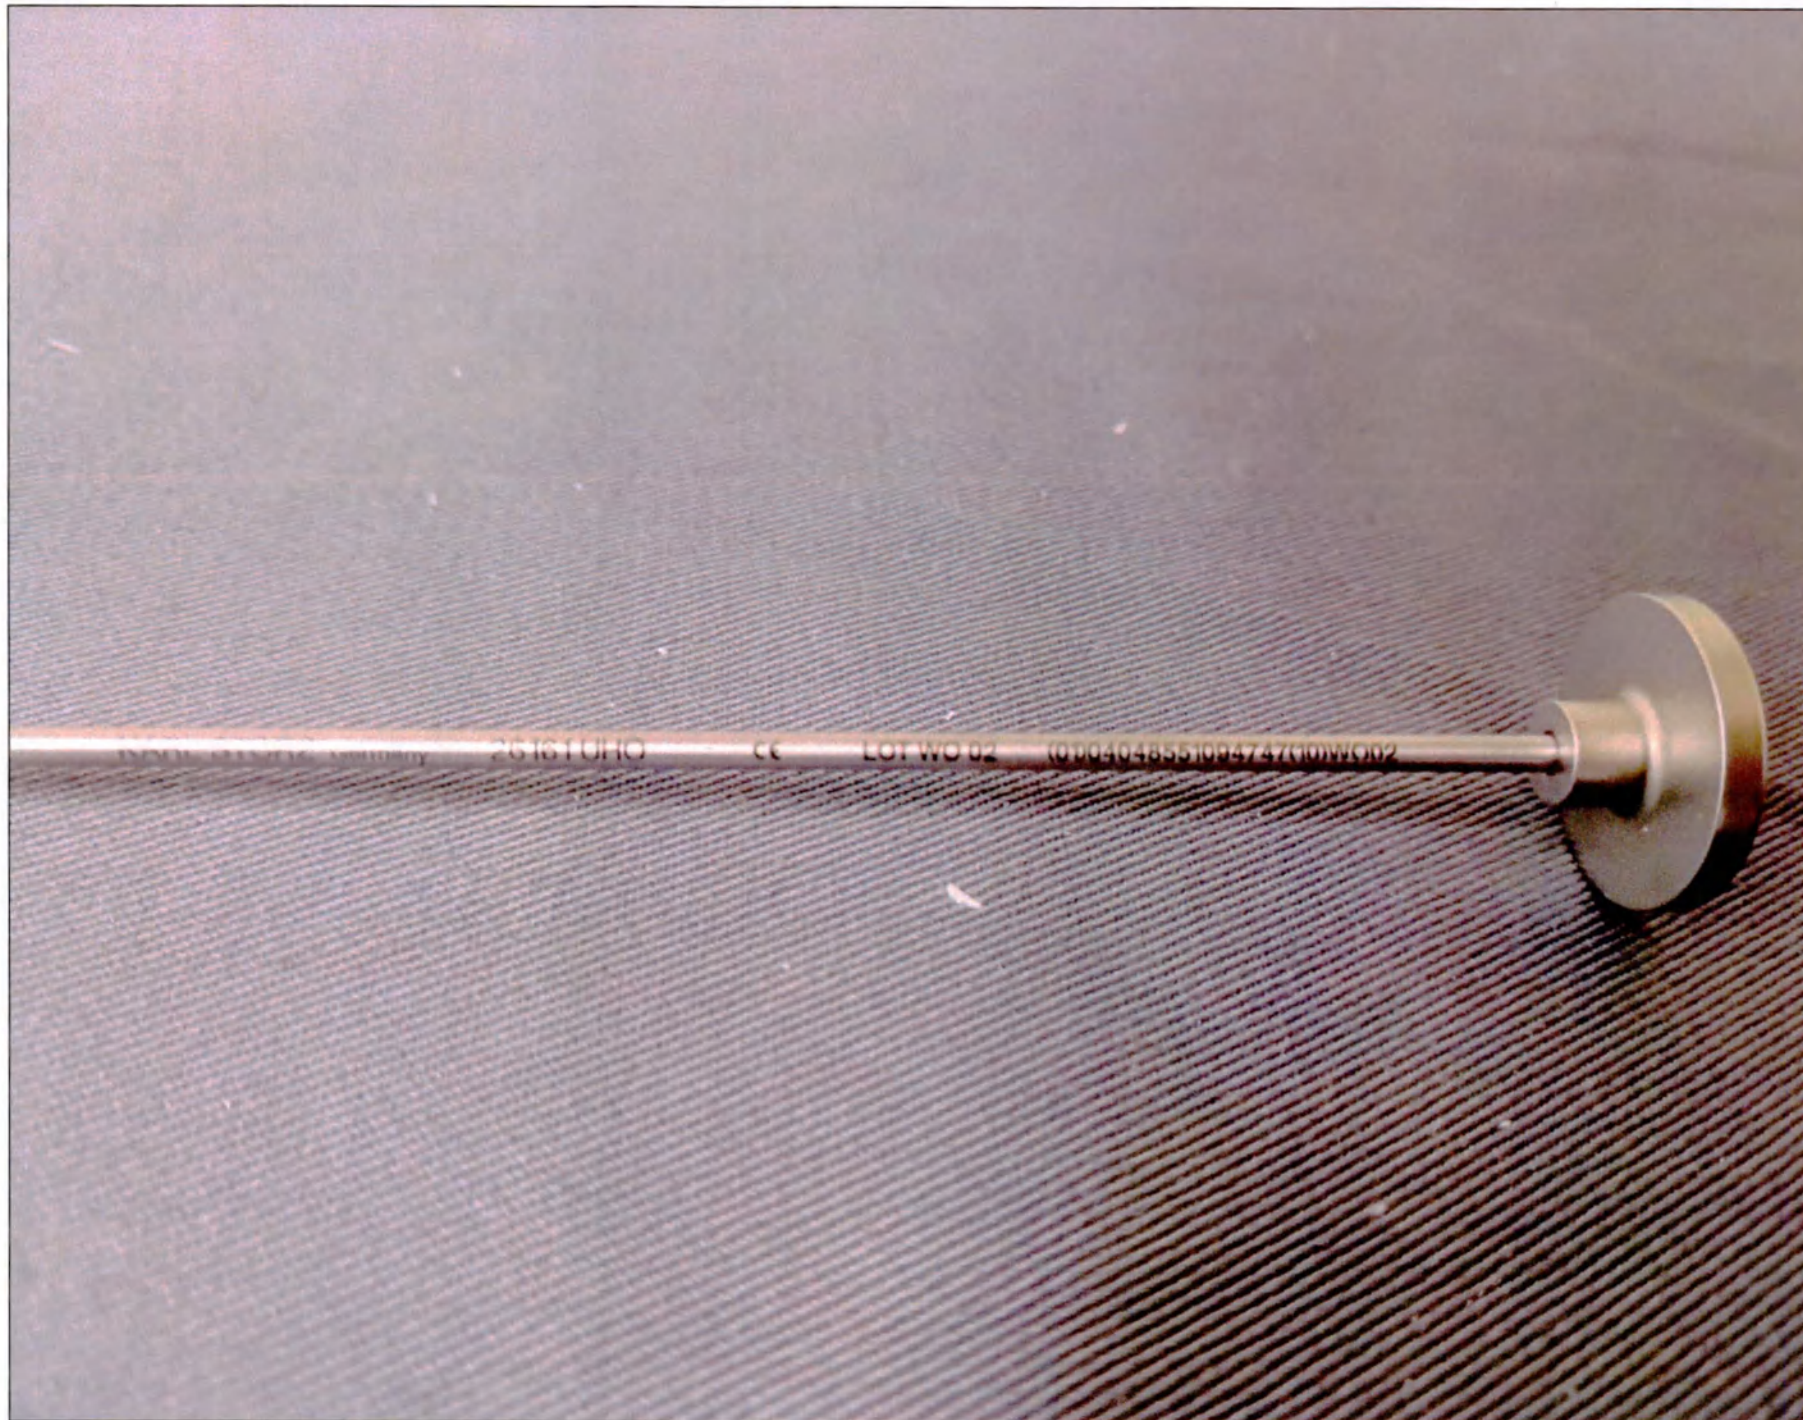


Рис. 76. Обтуратор, диаметр 2 мм, длина 28 см.

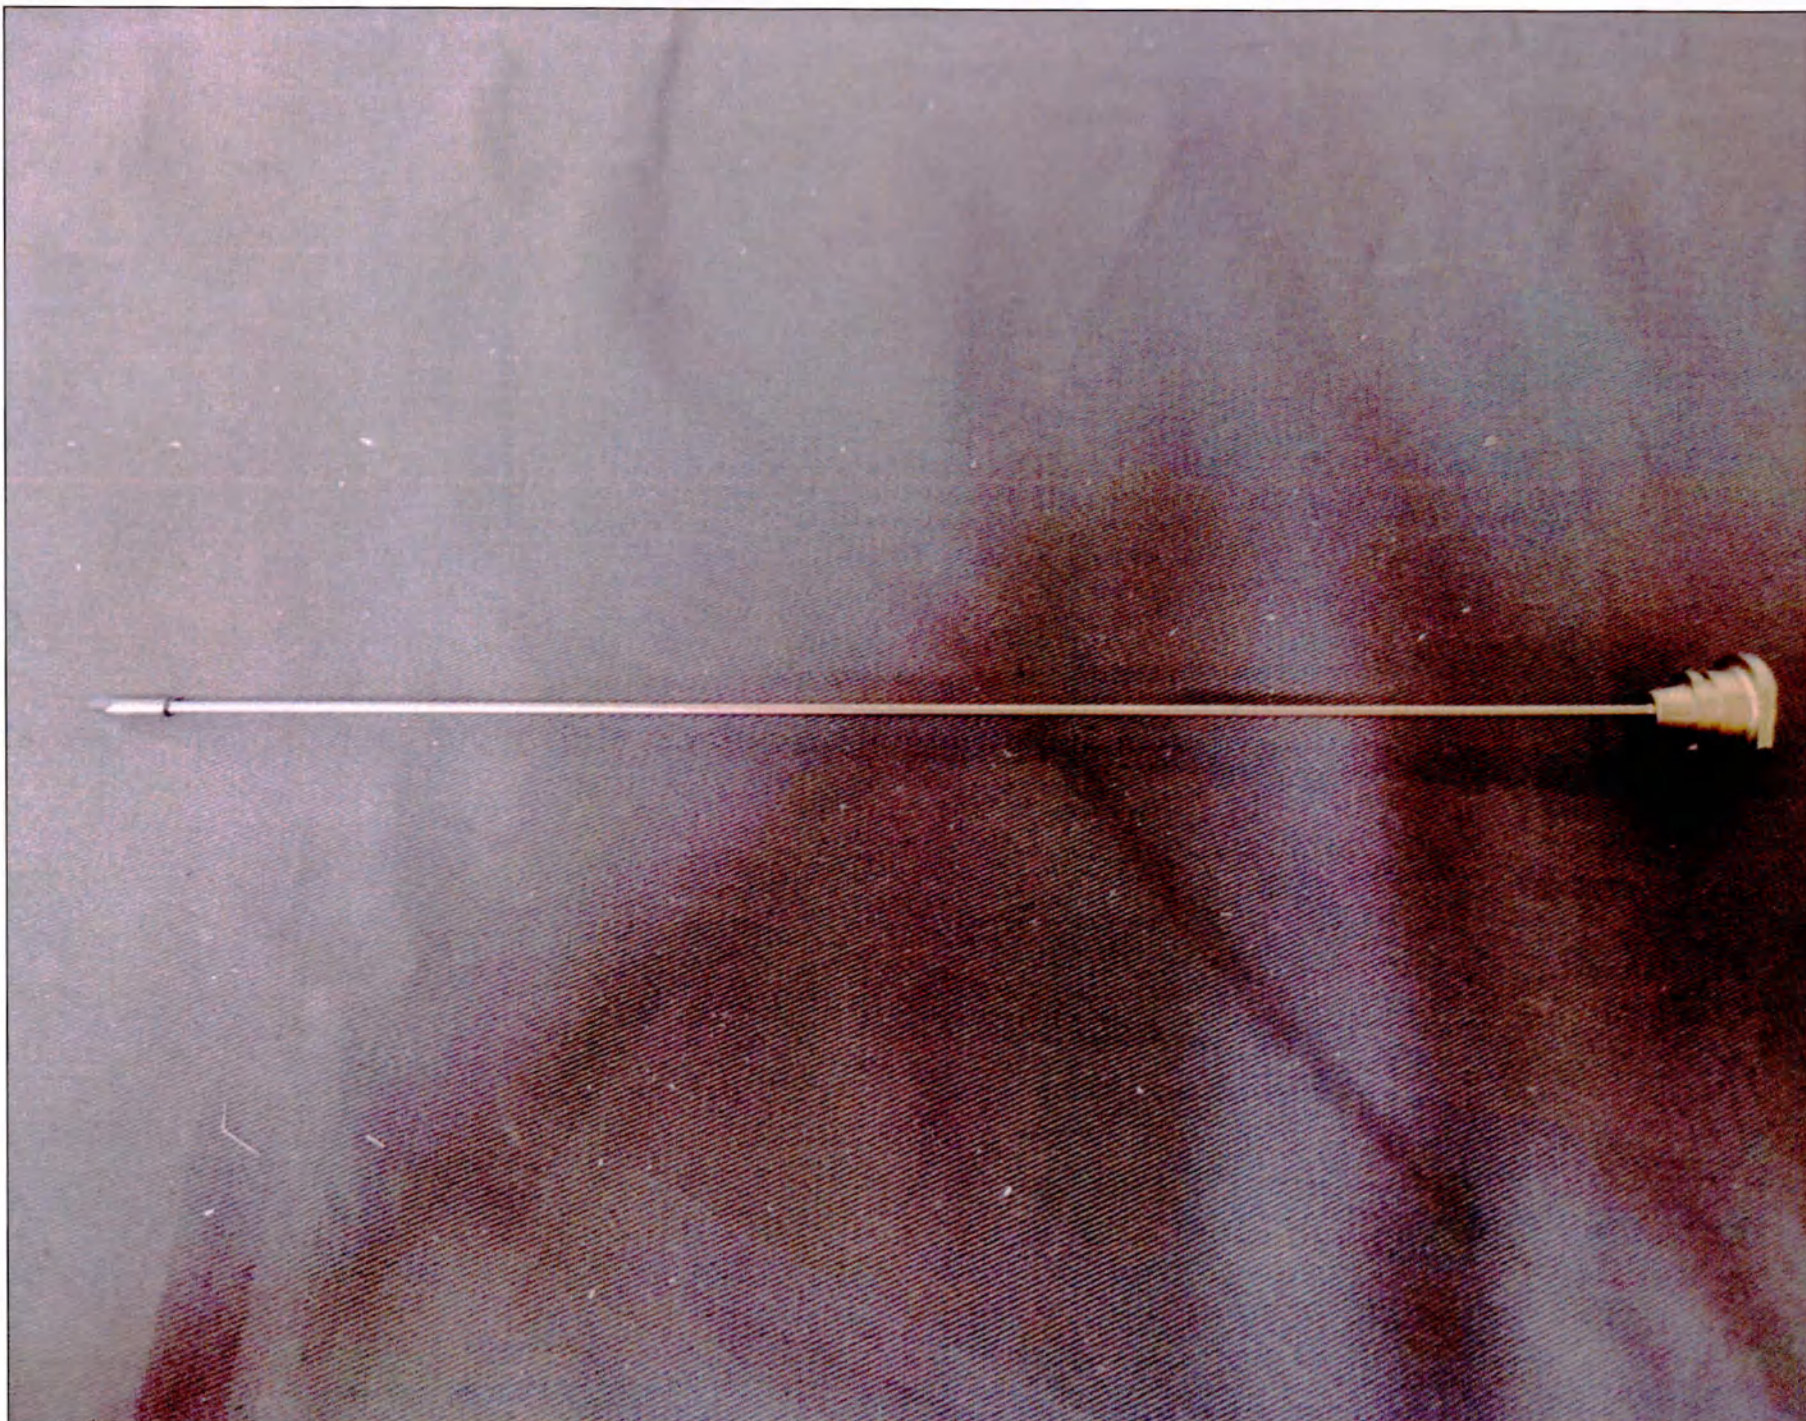


Рис. 77. Обтуратор пирамидальный, размер 11,5 Шр. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор пирамидальный, размер 9 Шр.

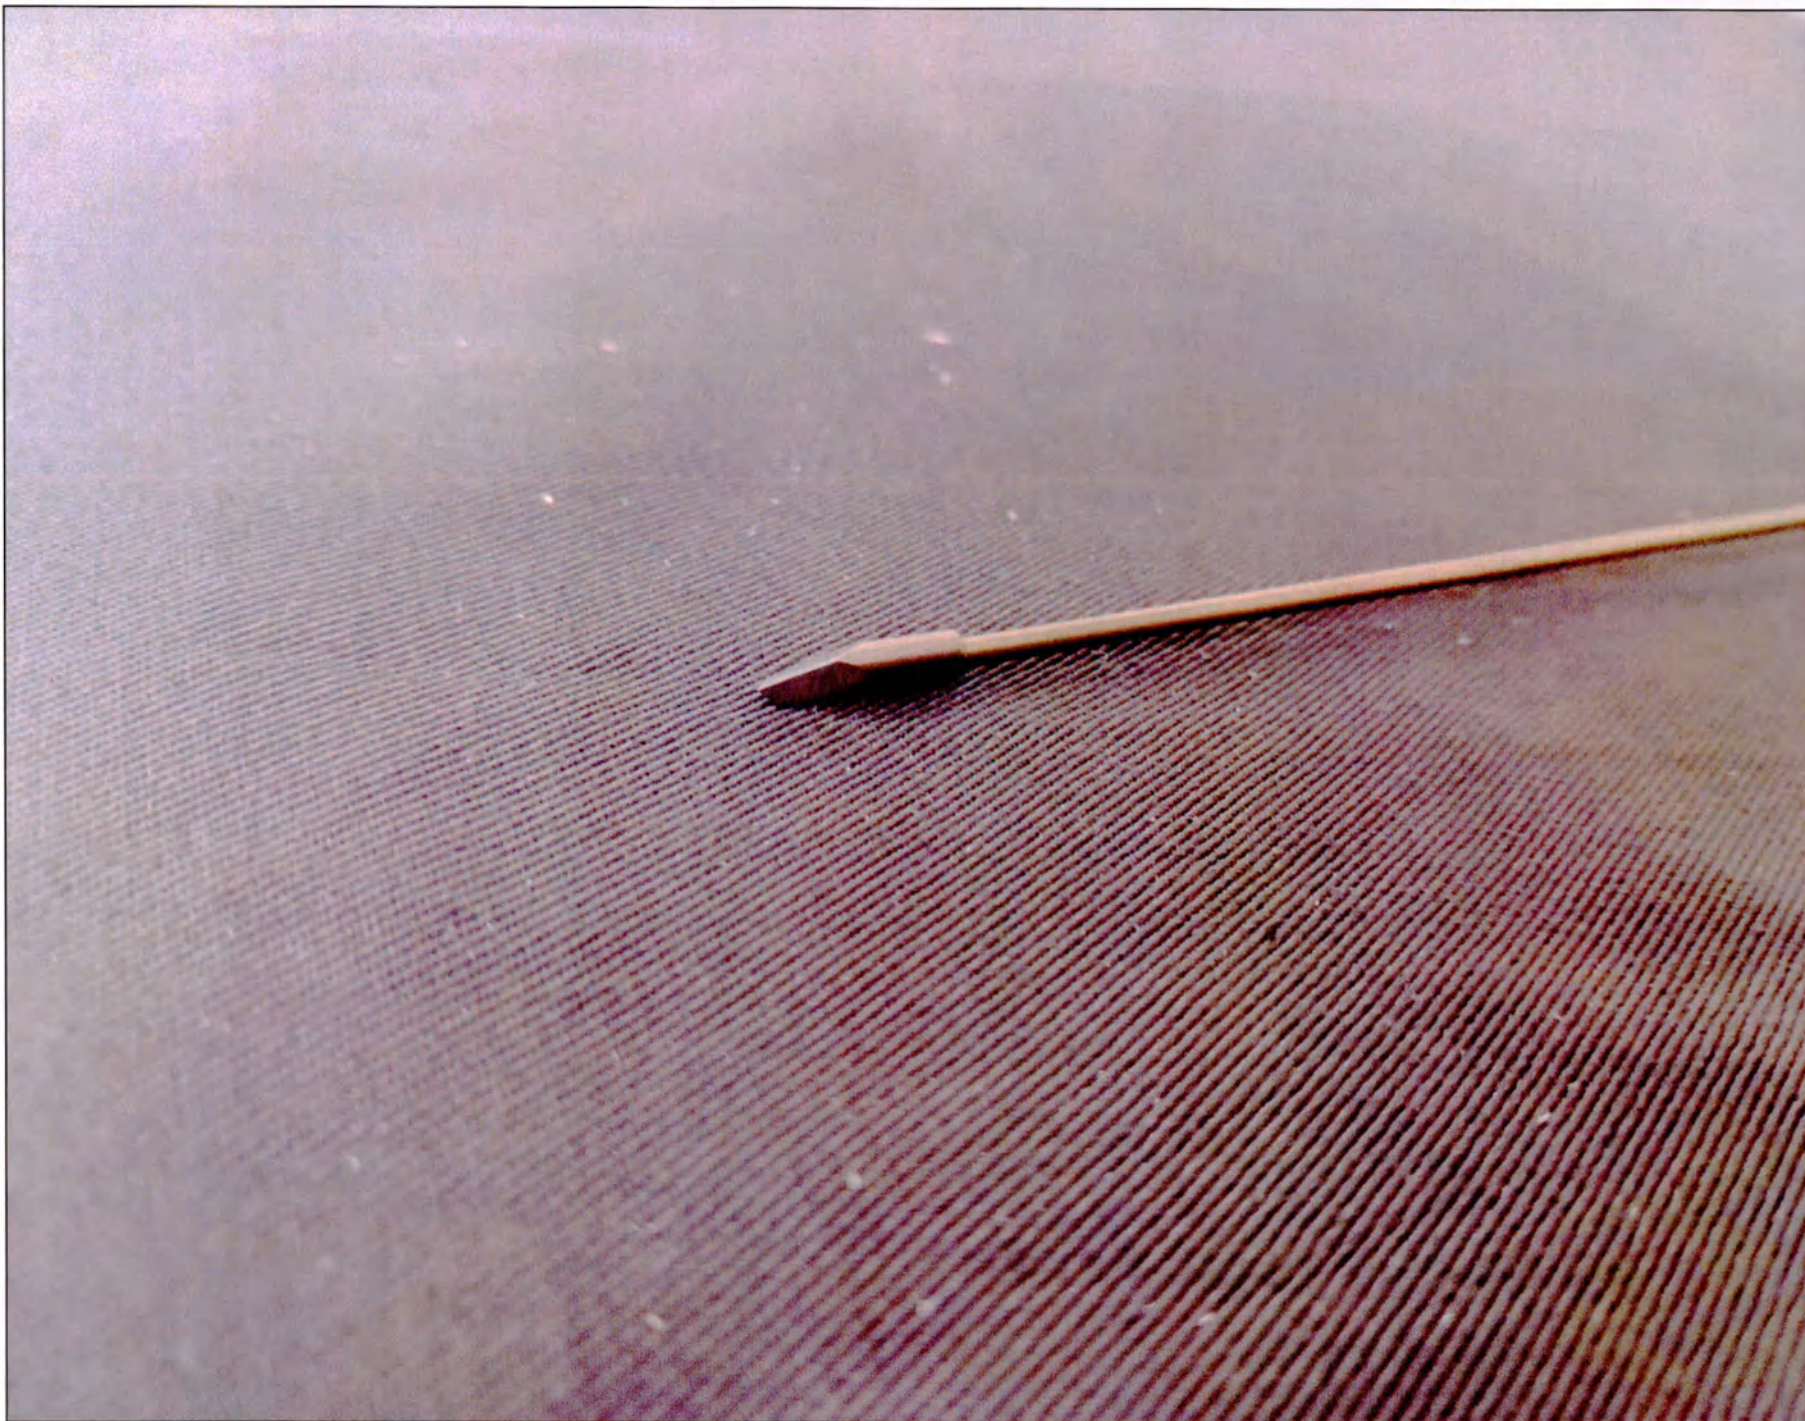


Рис. 78. Обтуратор пирамидальный, размер 11,5 Шр. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор пирамидальный, размер 9 Шр.

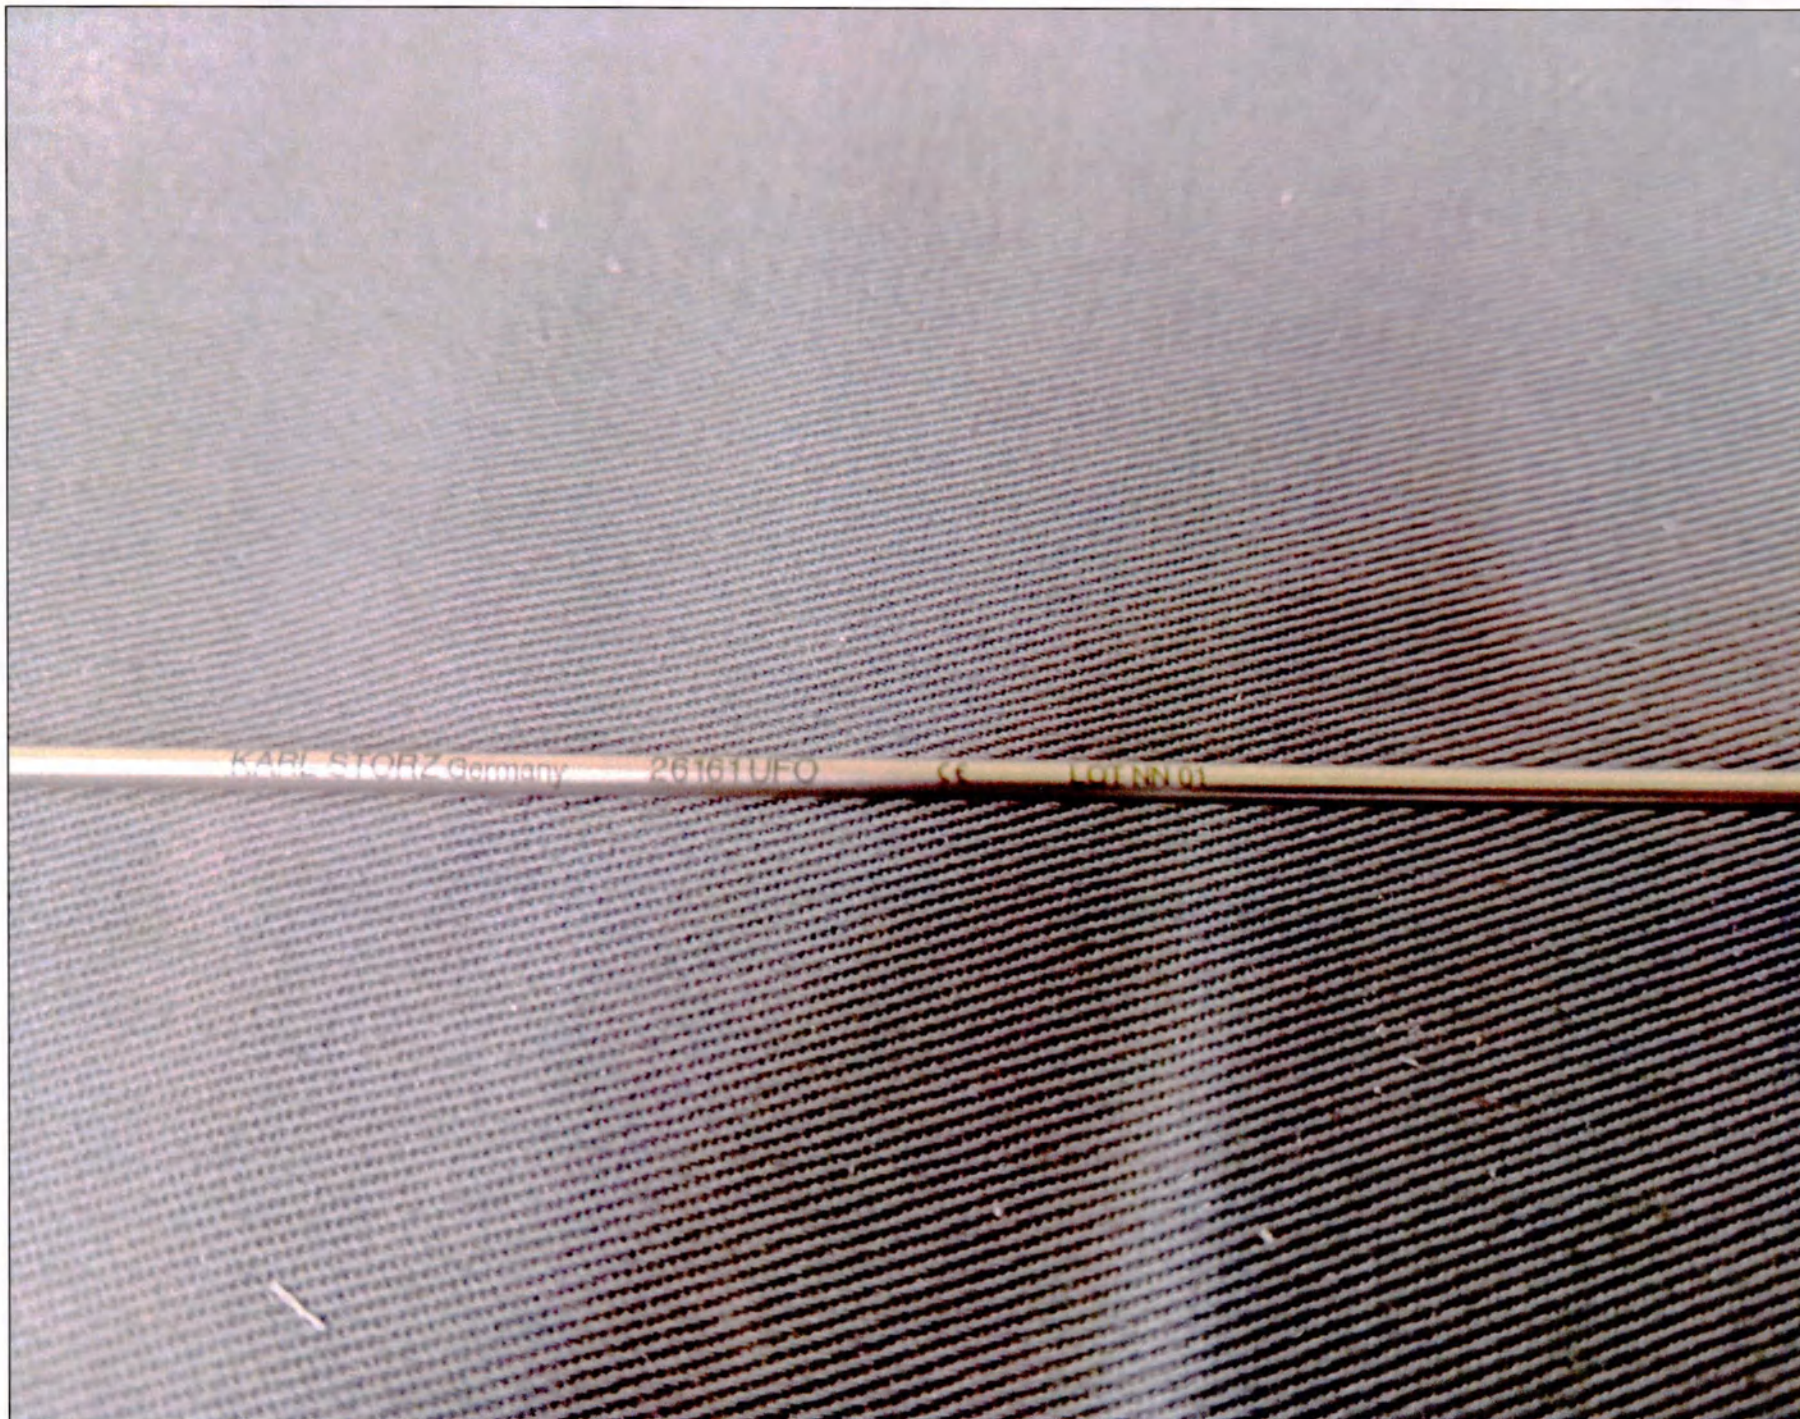


Рис. 79. Обтуратор пирамидальный, размер 11,5 Шр. Имеет схожий внешний вид, отличается размерным рядом и цветовой маркировкой: Обтуратор пирамидальный, размер 9 Шр.

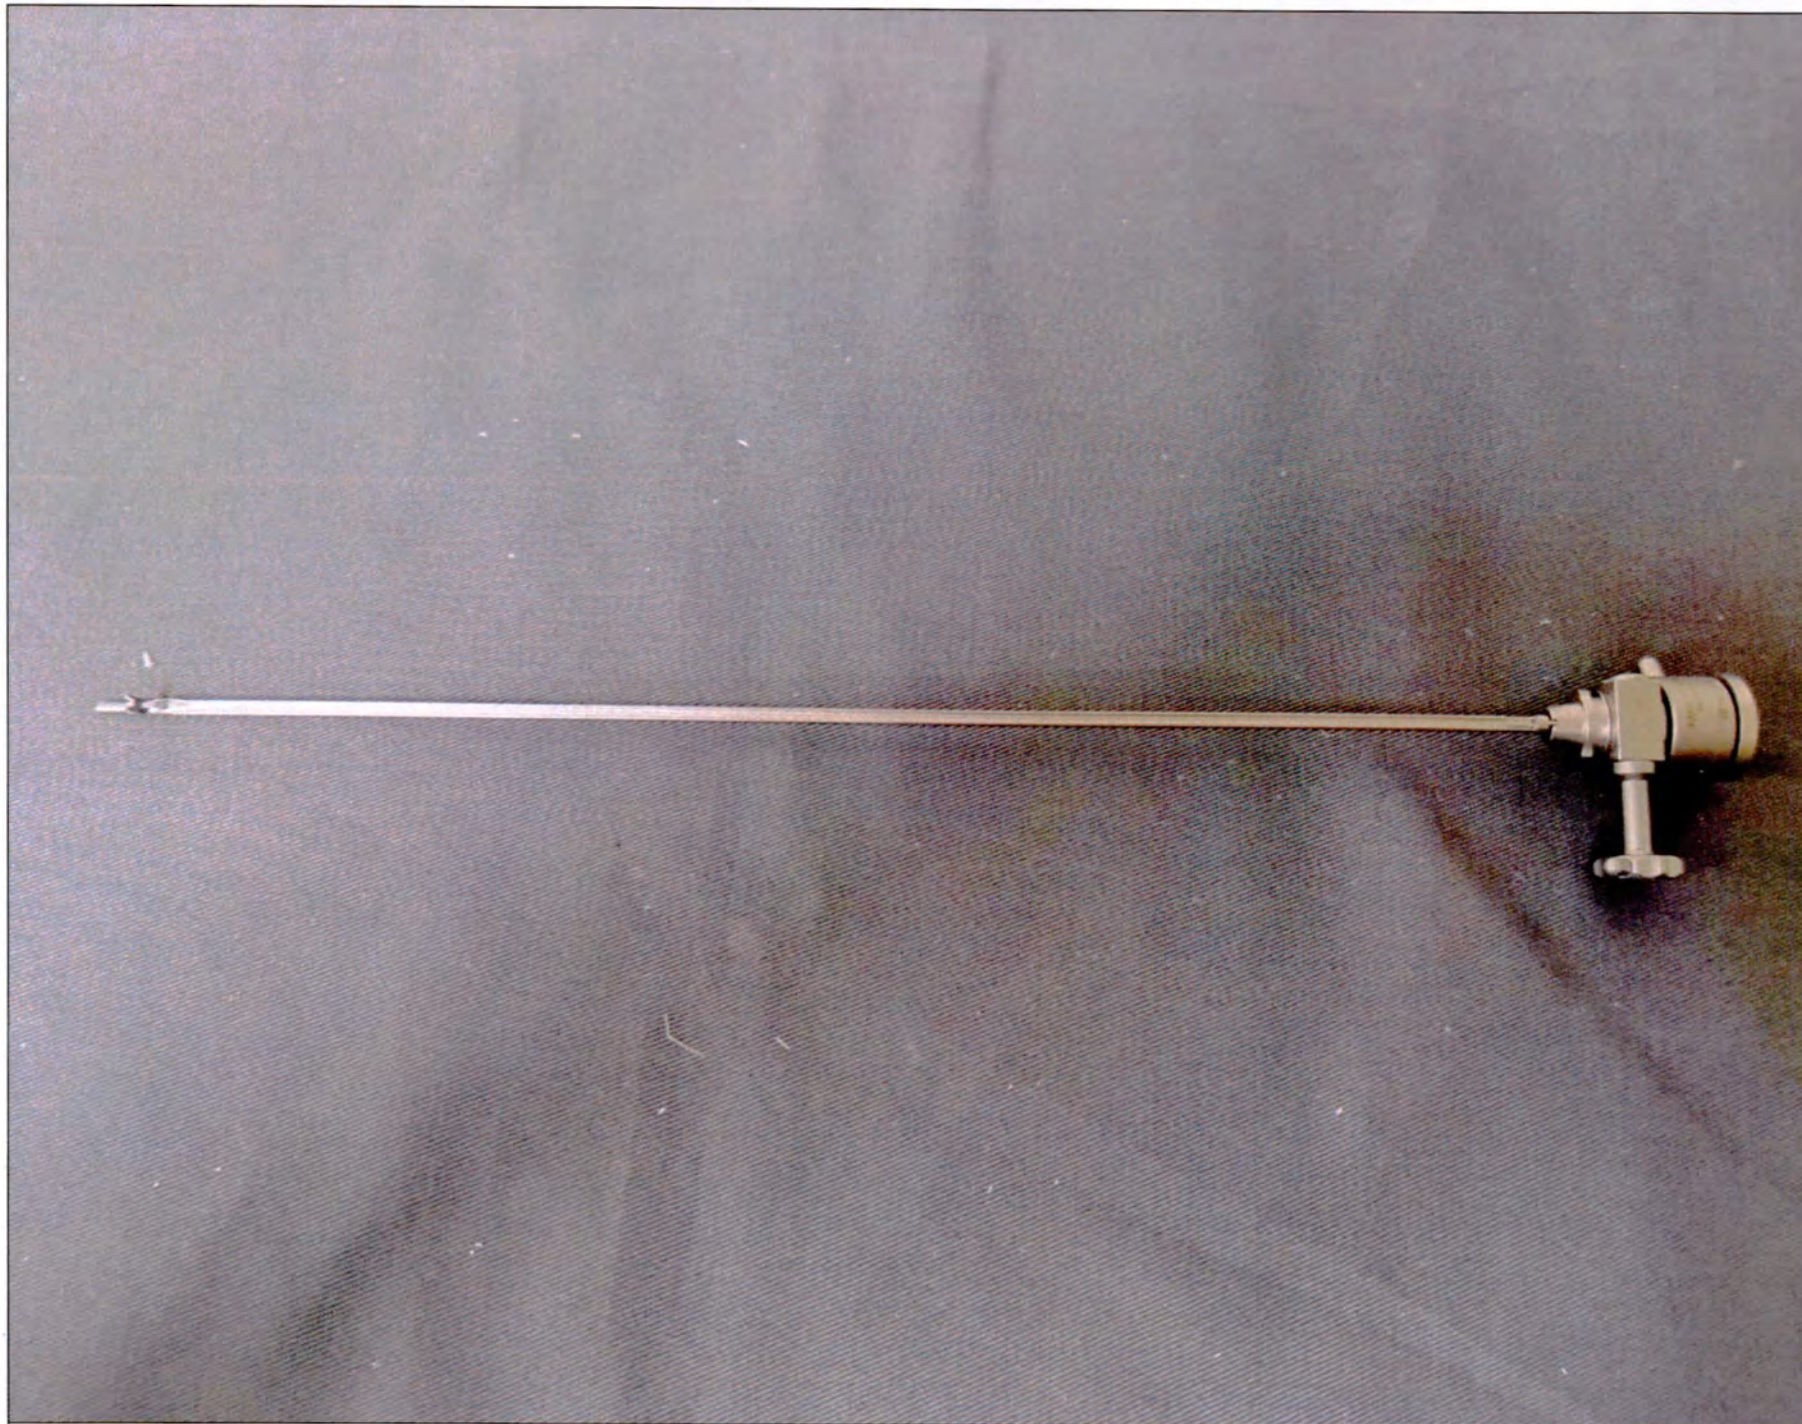


Рис. 80. Вставка рабочая фетоскопа с направляющим рычагом

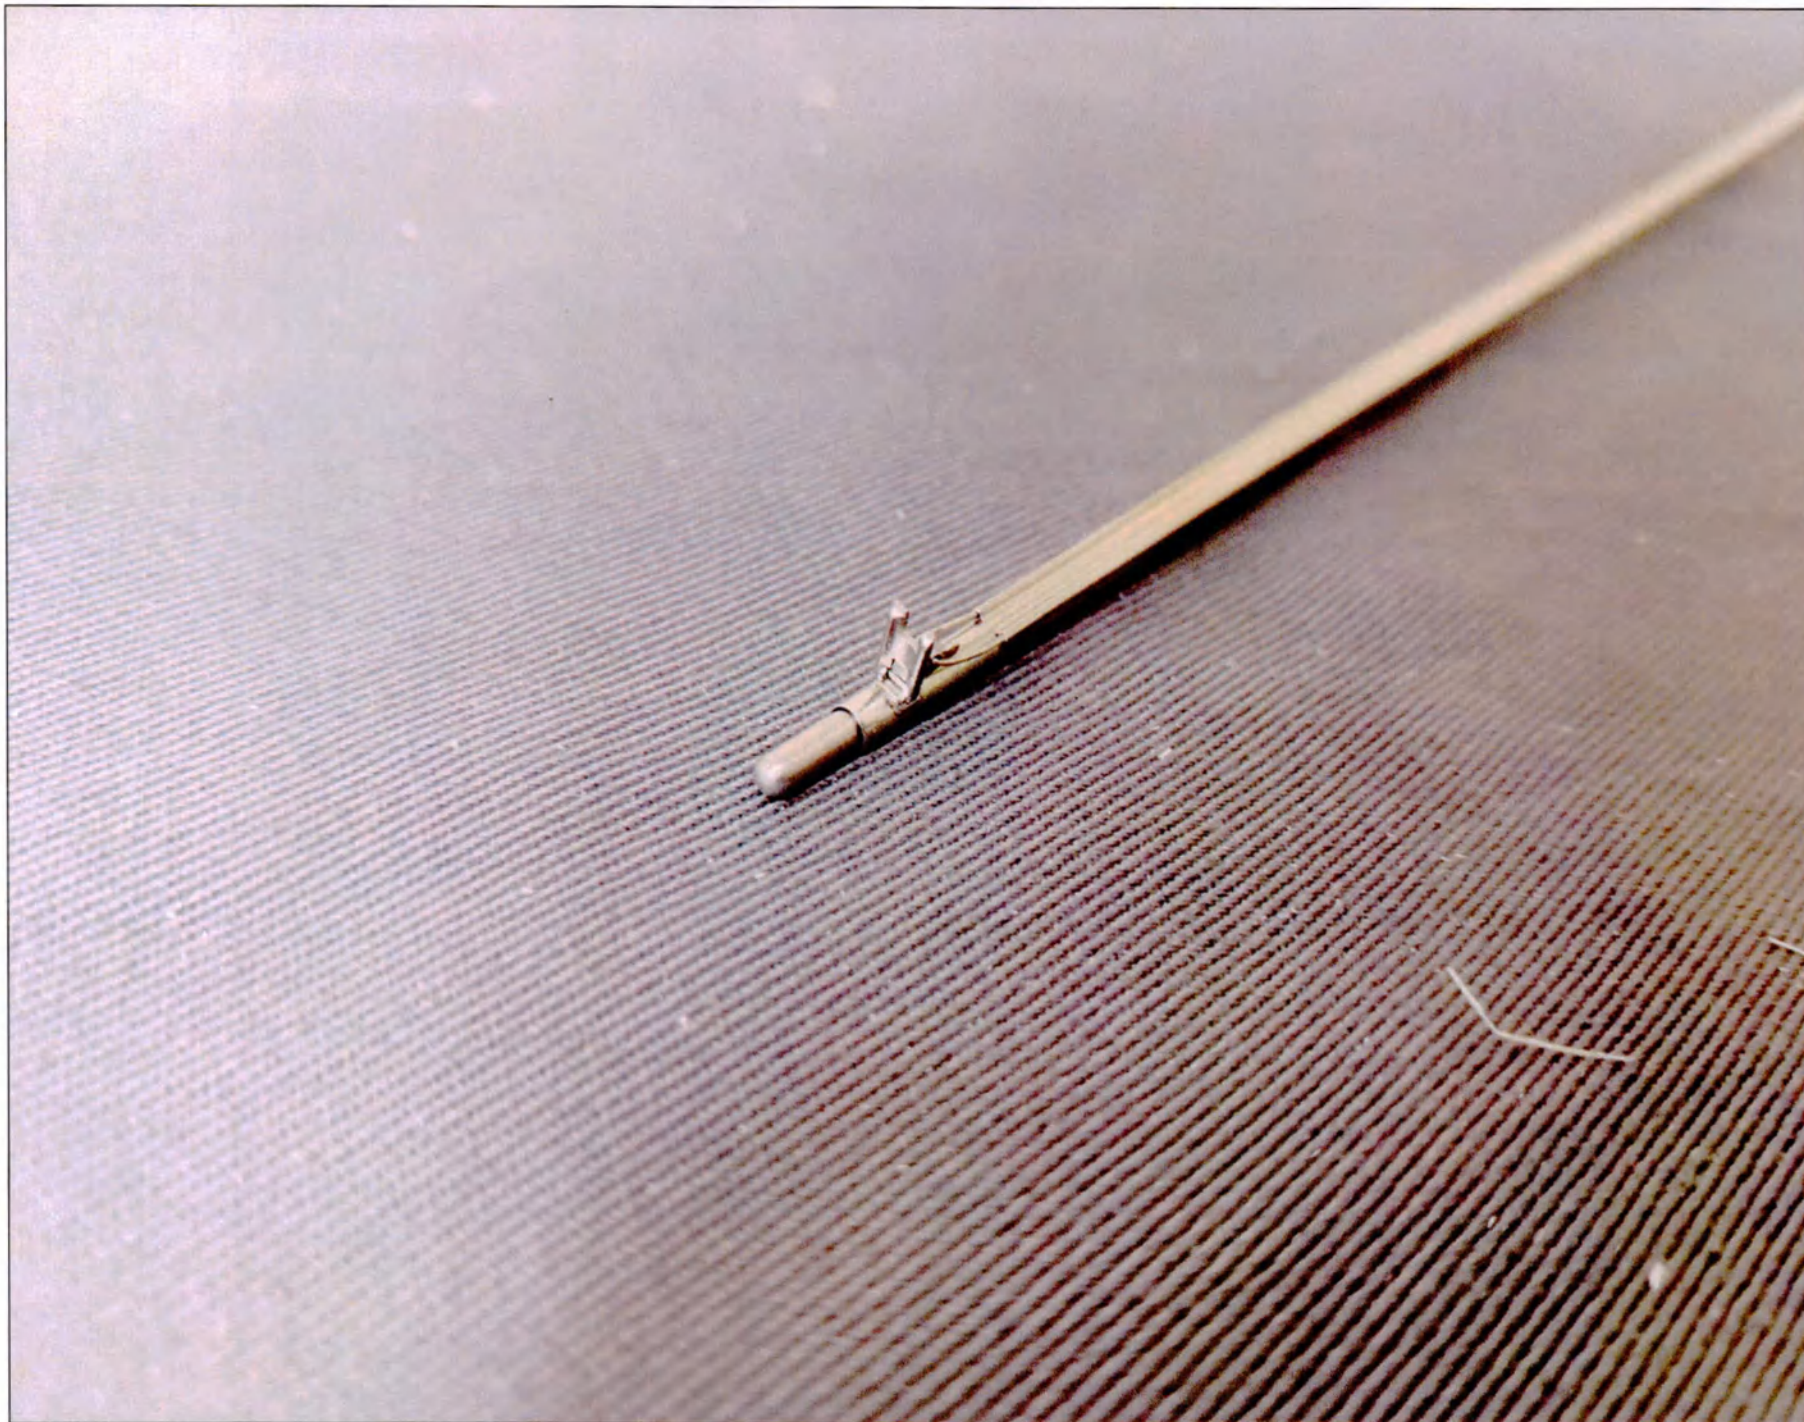


Рис. 81. Вставка рабочая фетоскопа с направляющим рычагом



Рис. 82. Вставка рабочая фетоскопа с направляющим рычагом

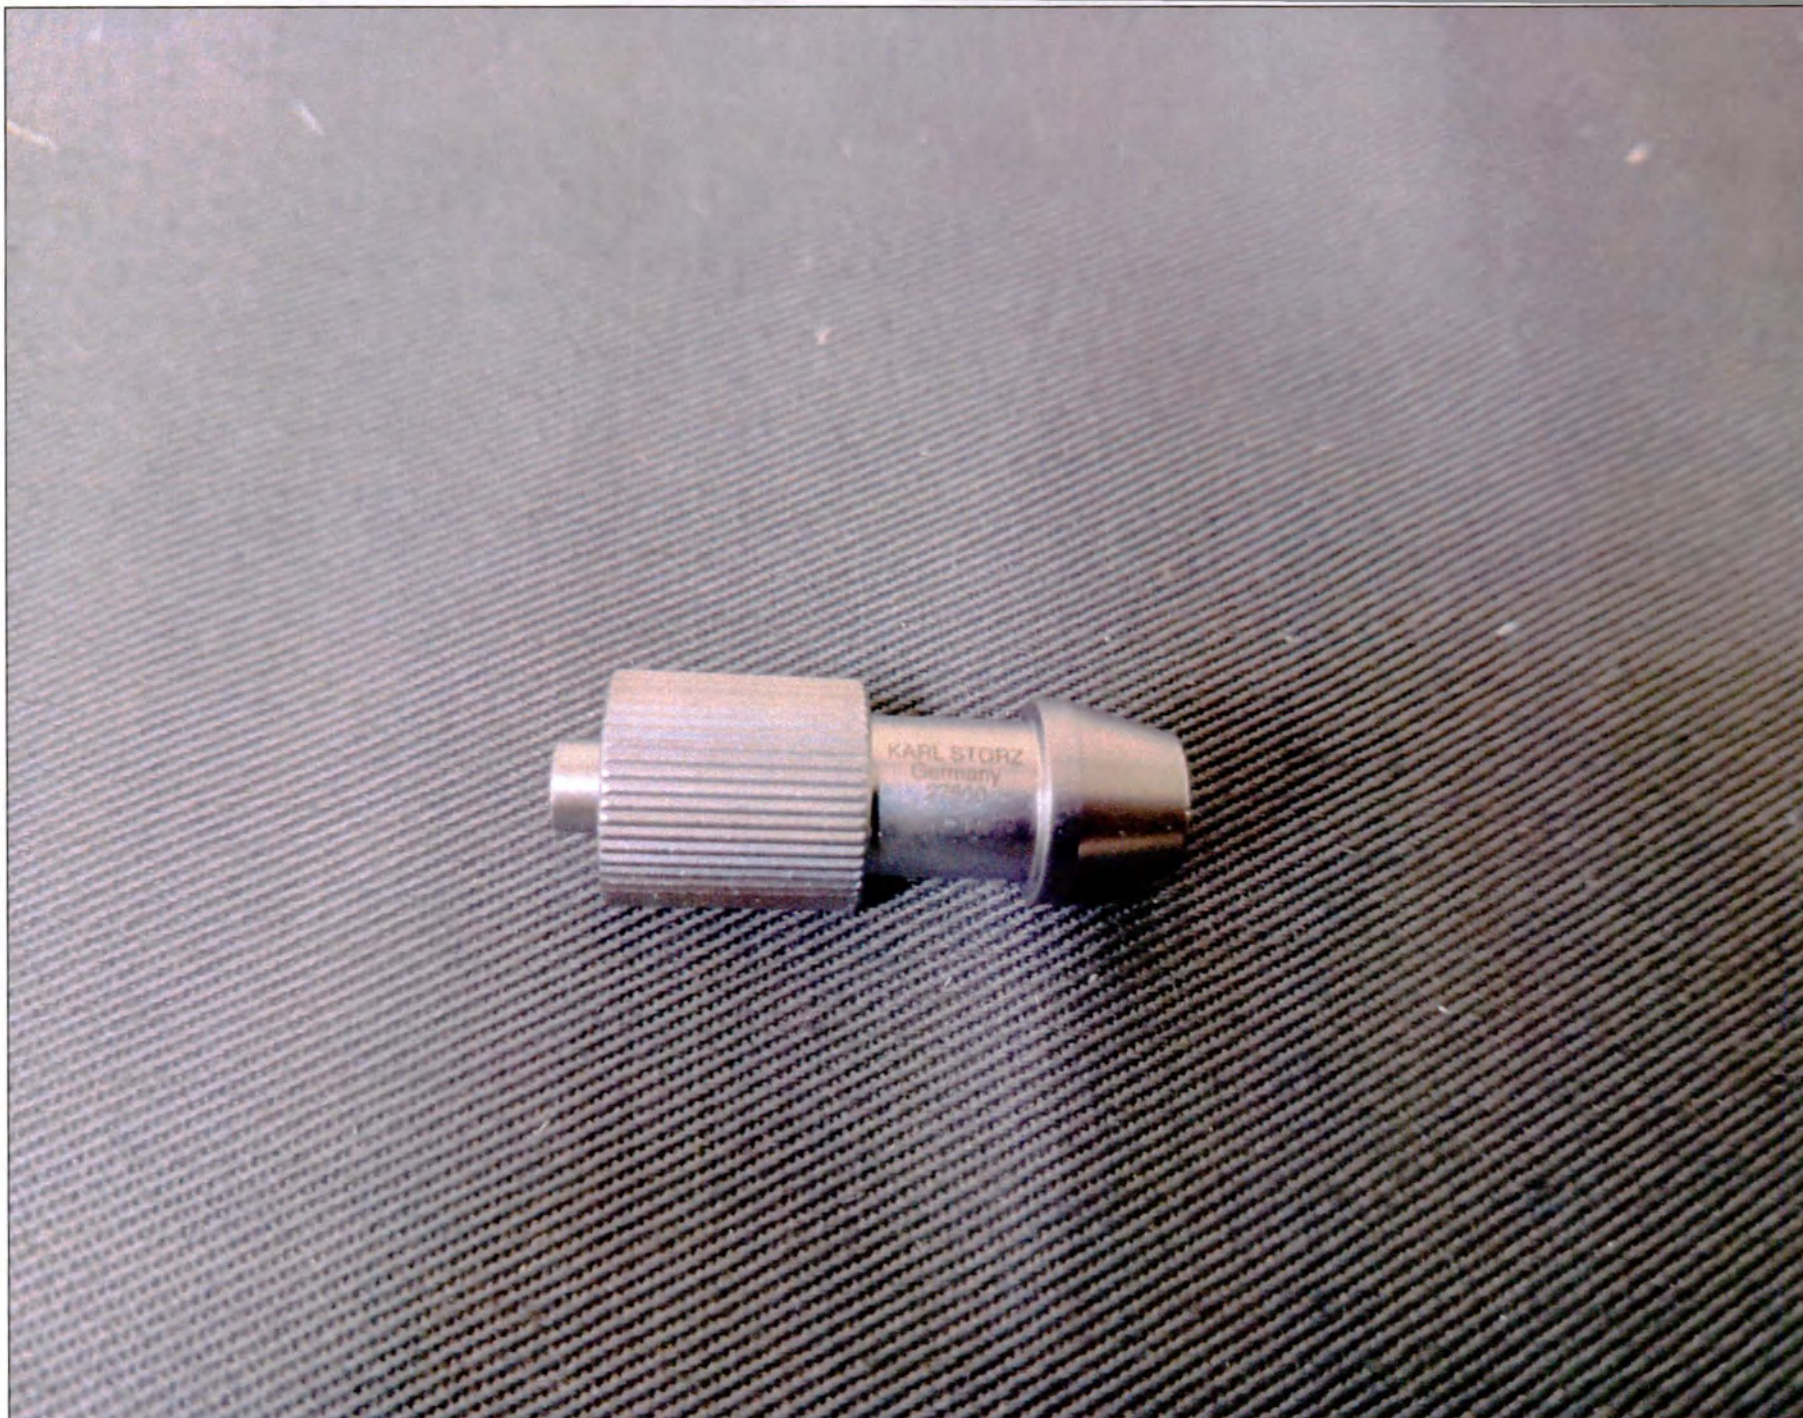


Рис. 83. Переходник для силиконовых трубок с соединением Luer

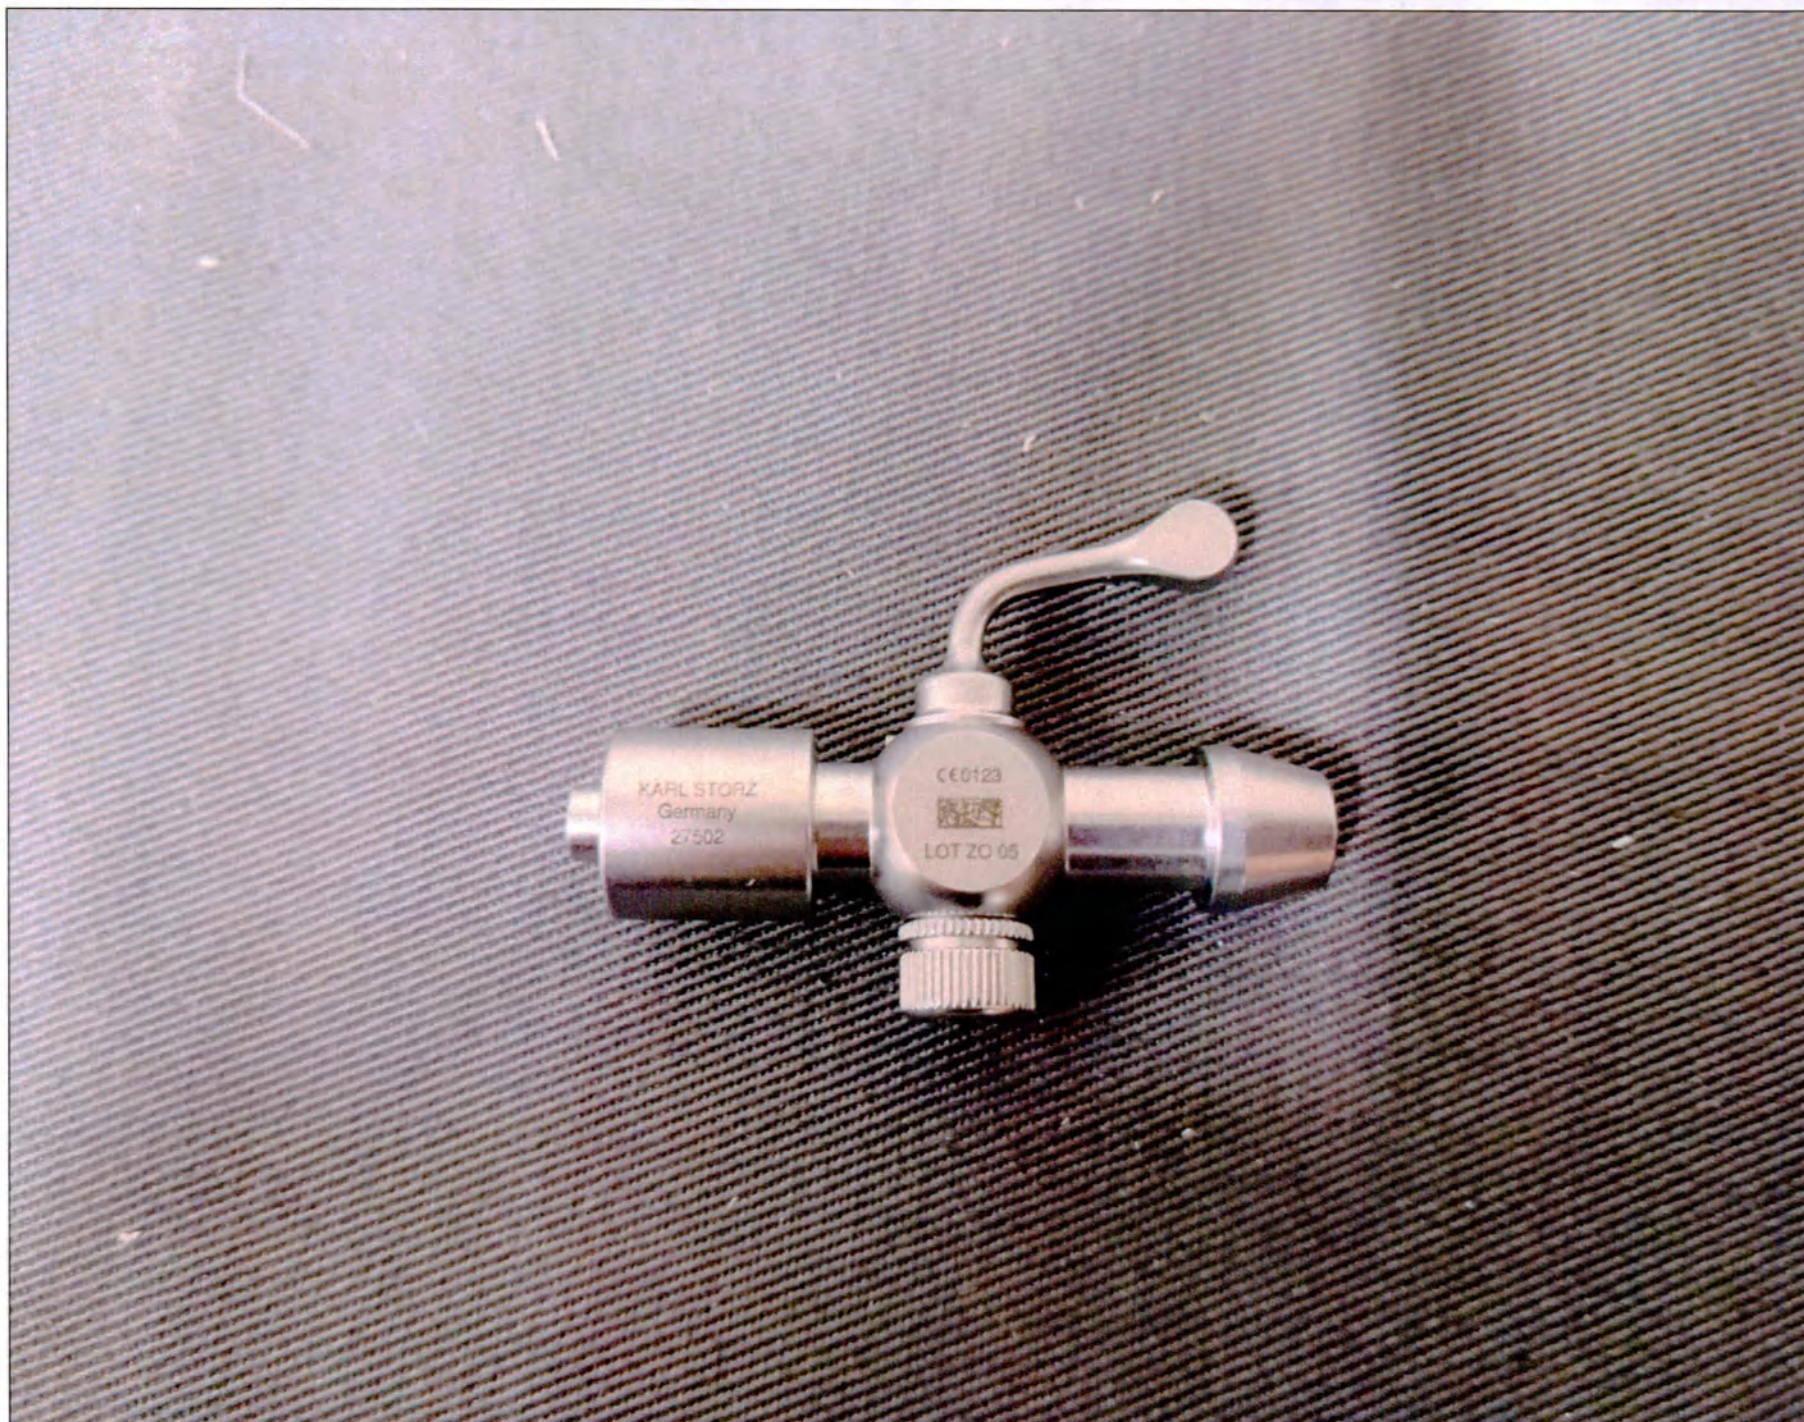


Рис. 84. Переходник для силиконовых трубок с соединением Luer с запорным краном

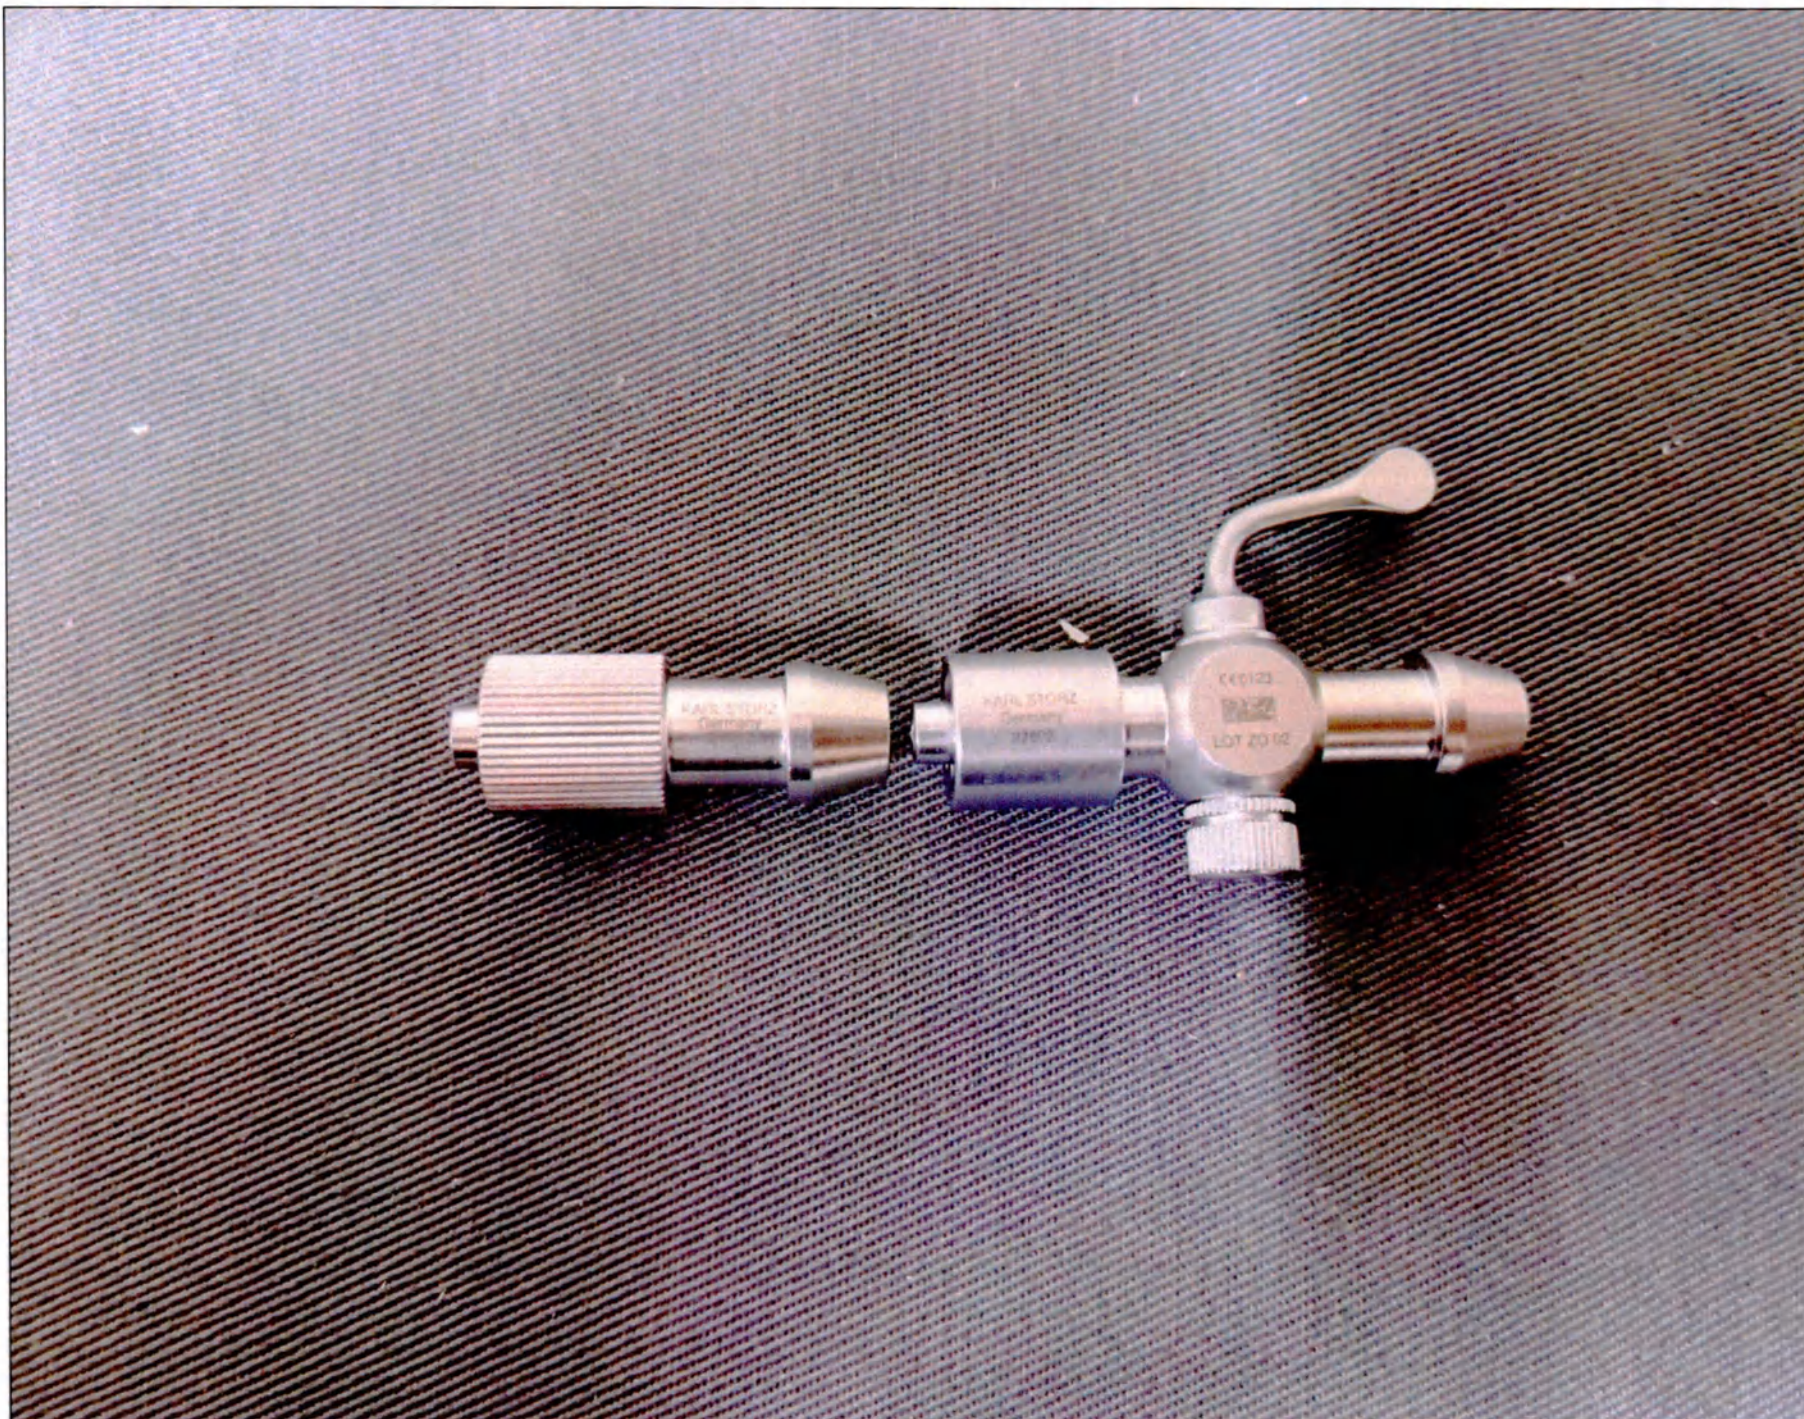


Рис. 85. Набор переходников для силиконовых трубок с соединением Luer, в составе: переходник для силиконовых трубок с соединением Luer – 1 шт., переходник для силиконовых трубок с соединением Luer с запорным краном

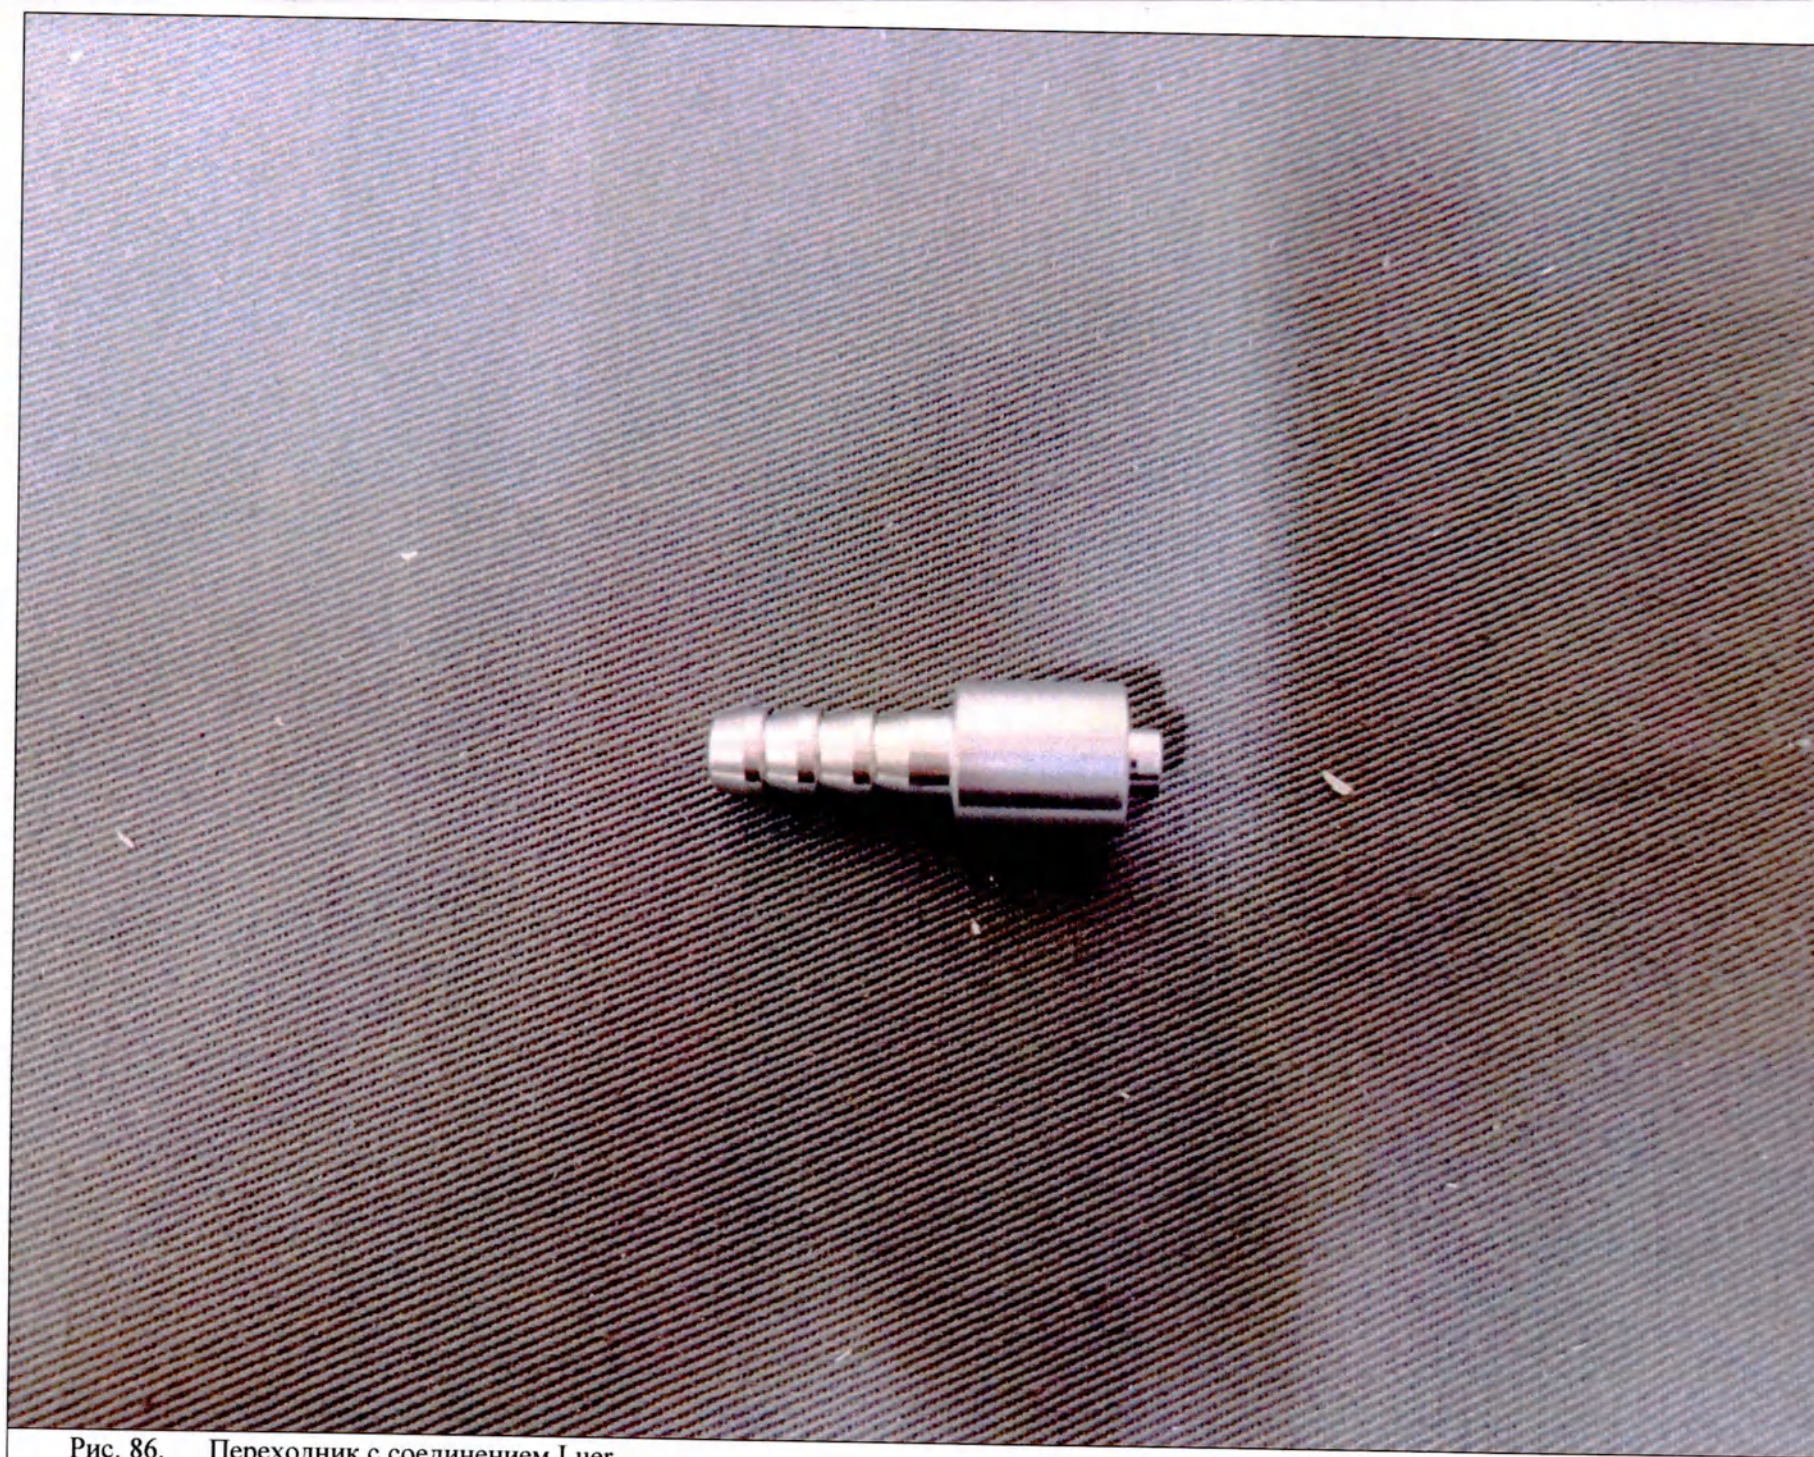


Рис. 86. Переходник с соединением Luer

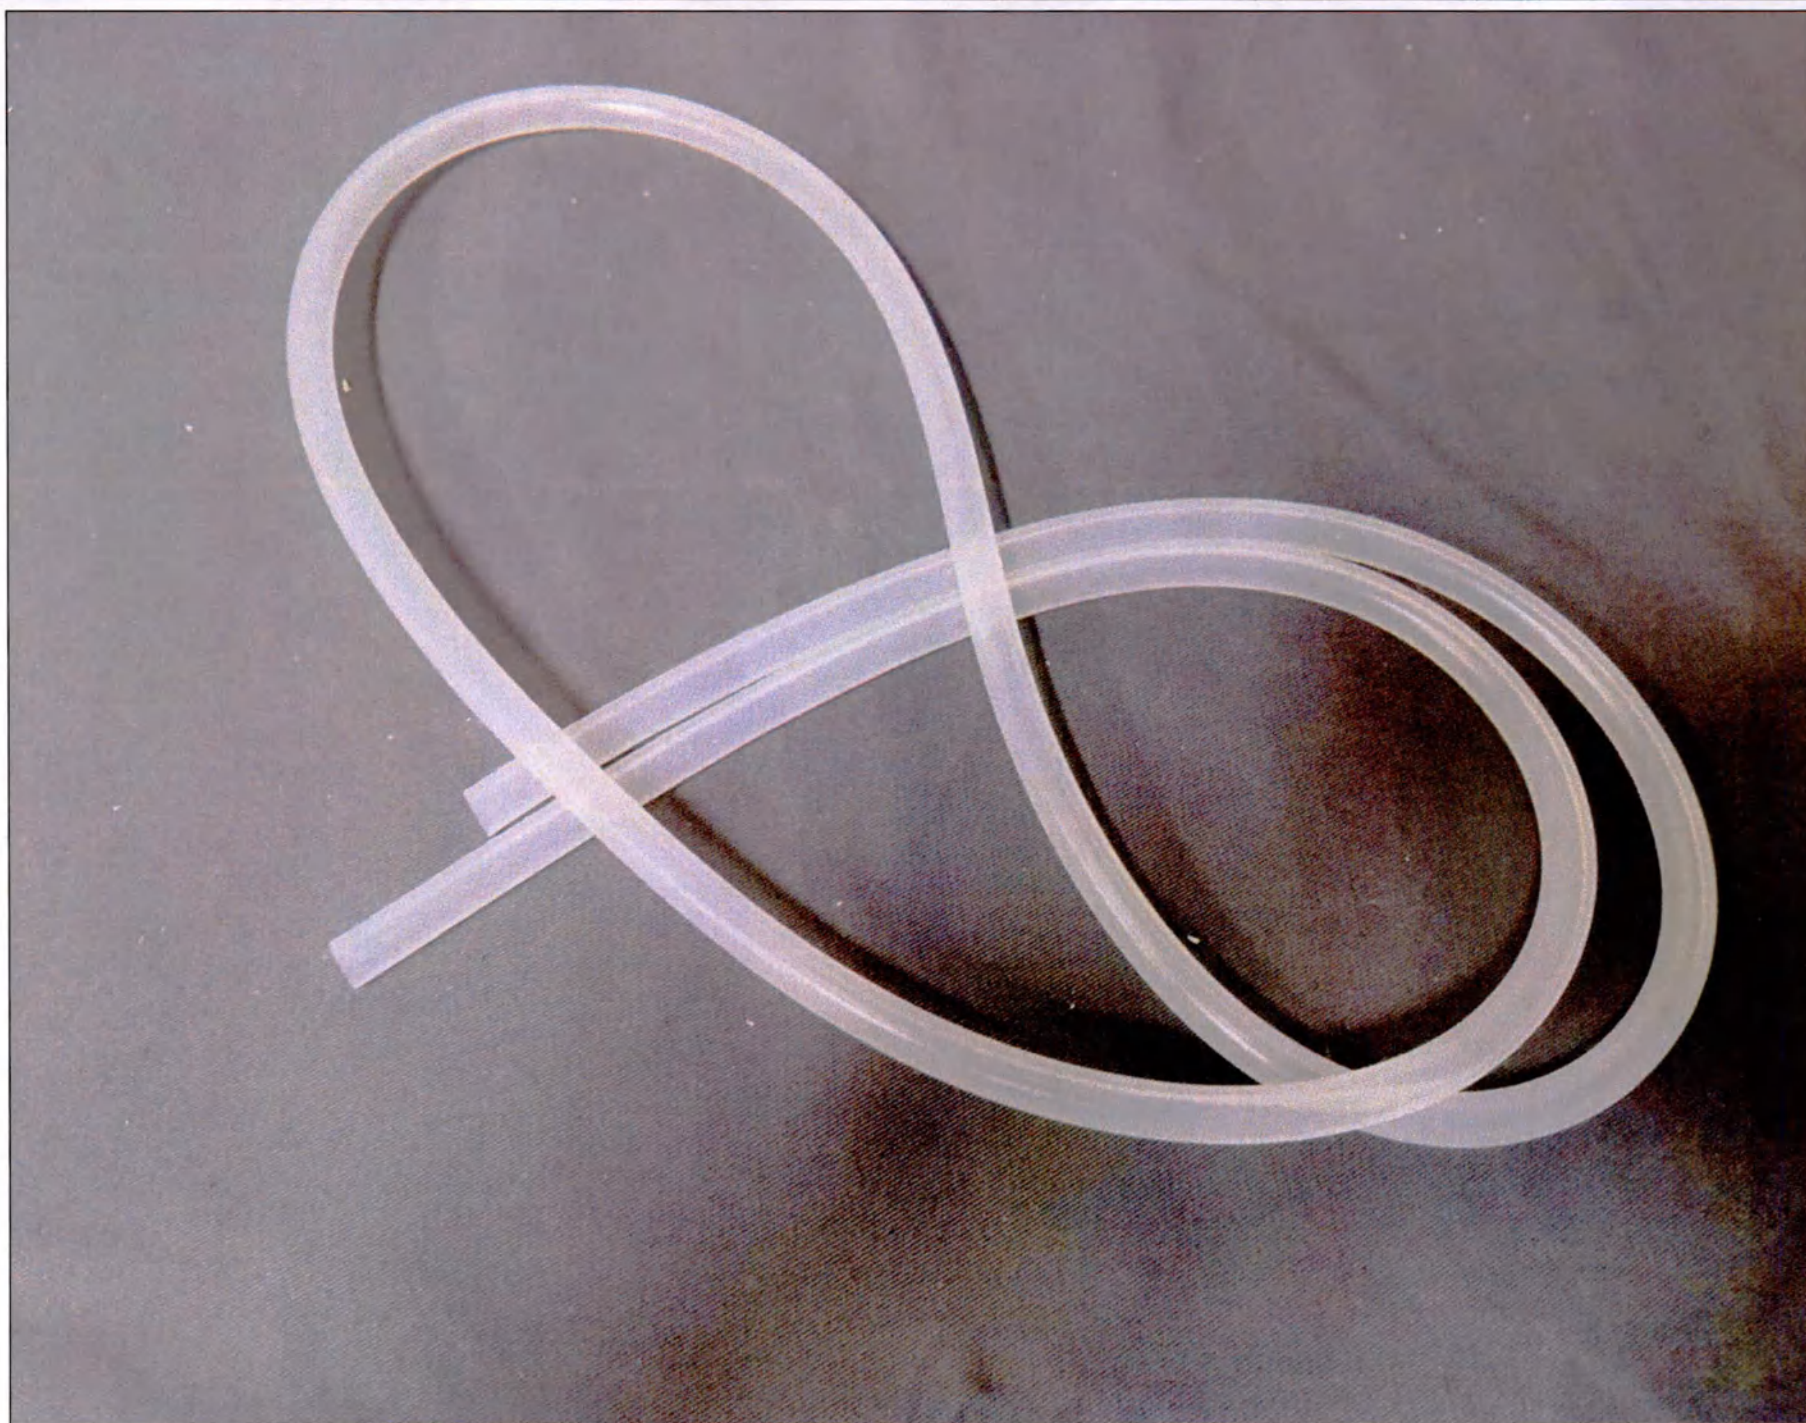


Рис. 87. Трубка для промывания, диаметр 9 мм, длина 140 см

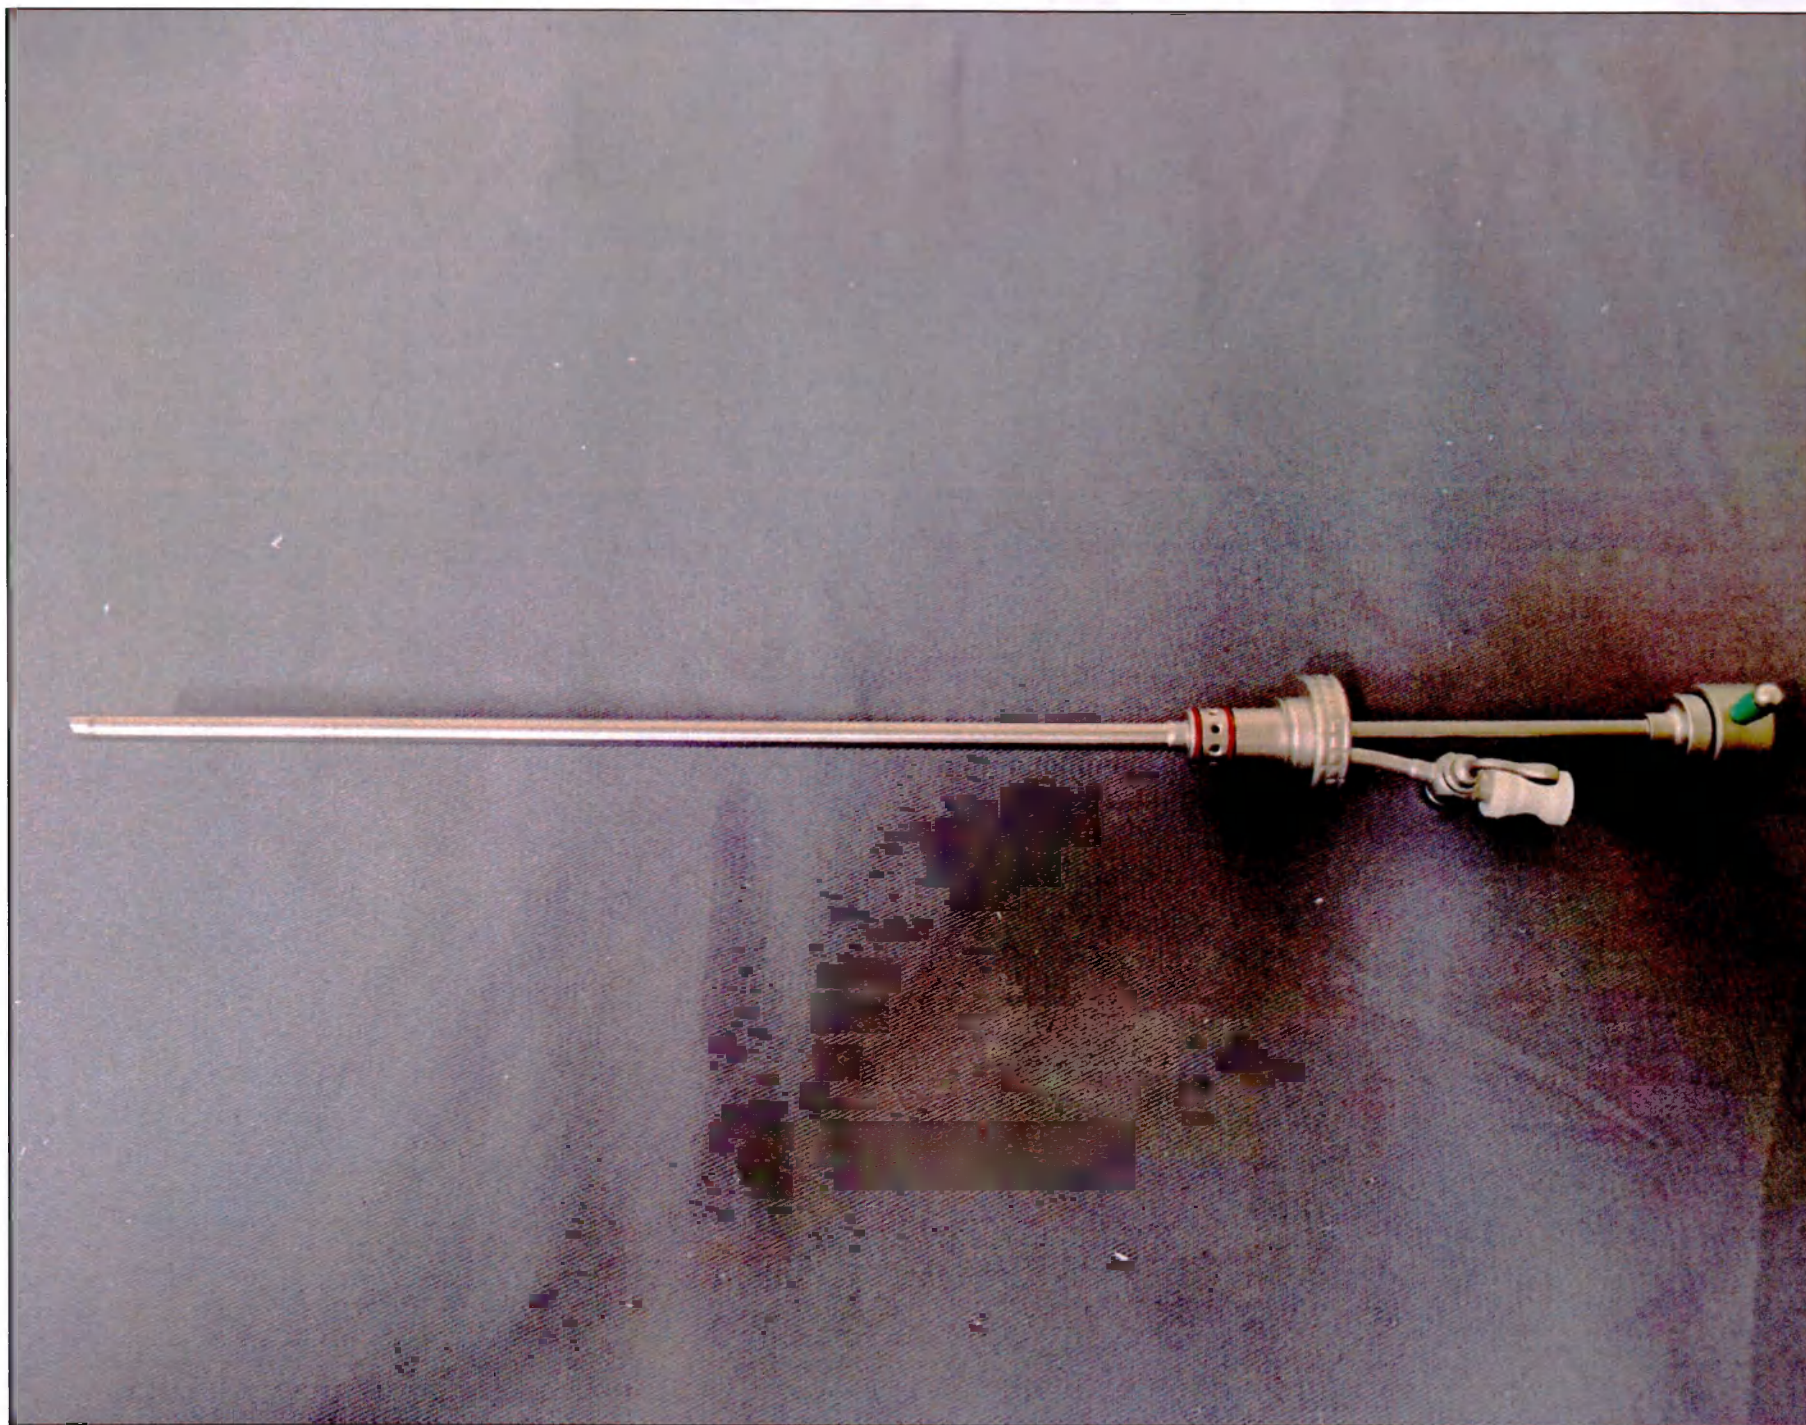


Рис. 88. Переходной мостик, телескопический, с инструментальным каналом 15 Шр

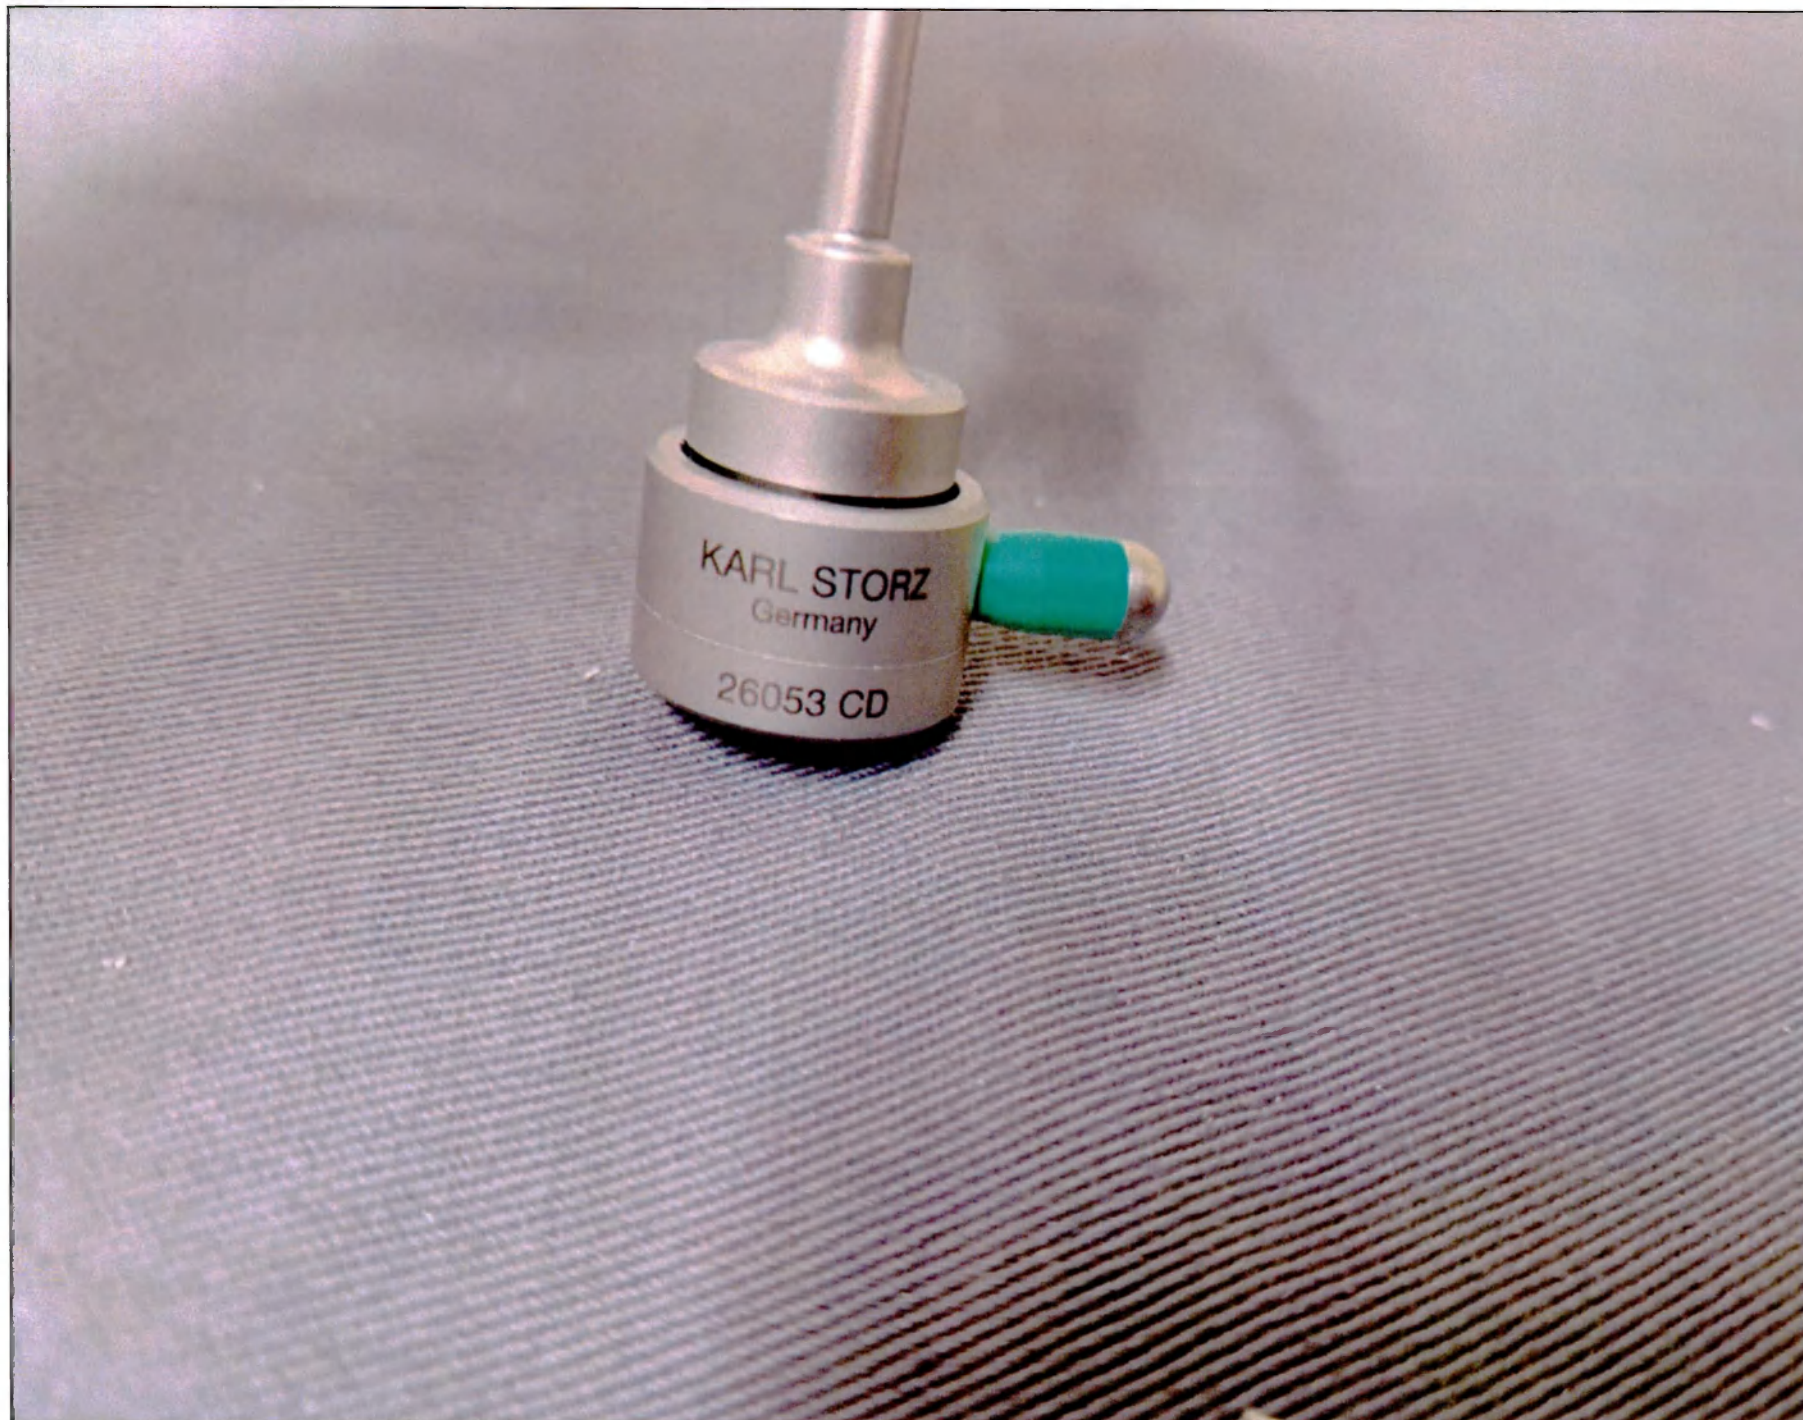


Рис. 89. Переходной мостик, телескопический, с инструментальным каналом 15 Шр

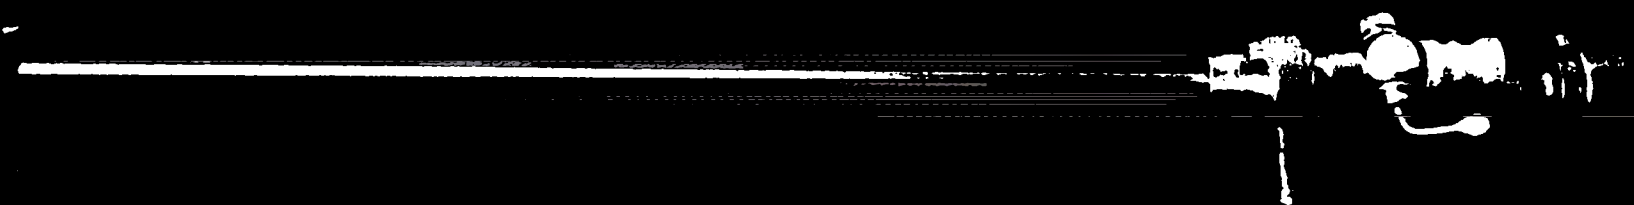


Рис. 90. Переходной мостик, телескопический, с инструментальным каналом 5 Шр.



Рис. 91. Переходной мостик, телескопический, с инструментальным каналом 5 Шр

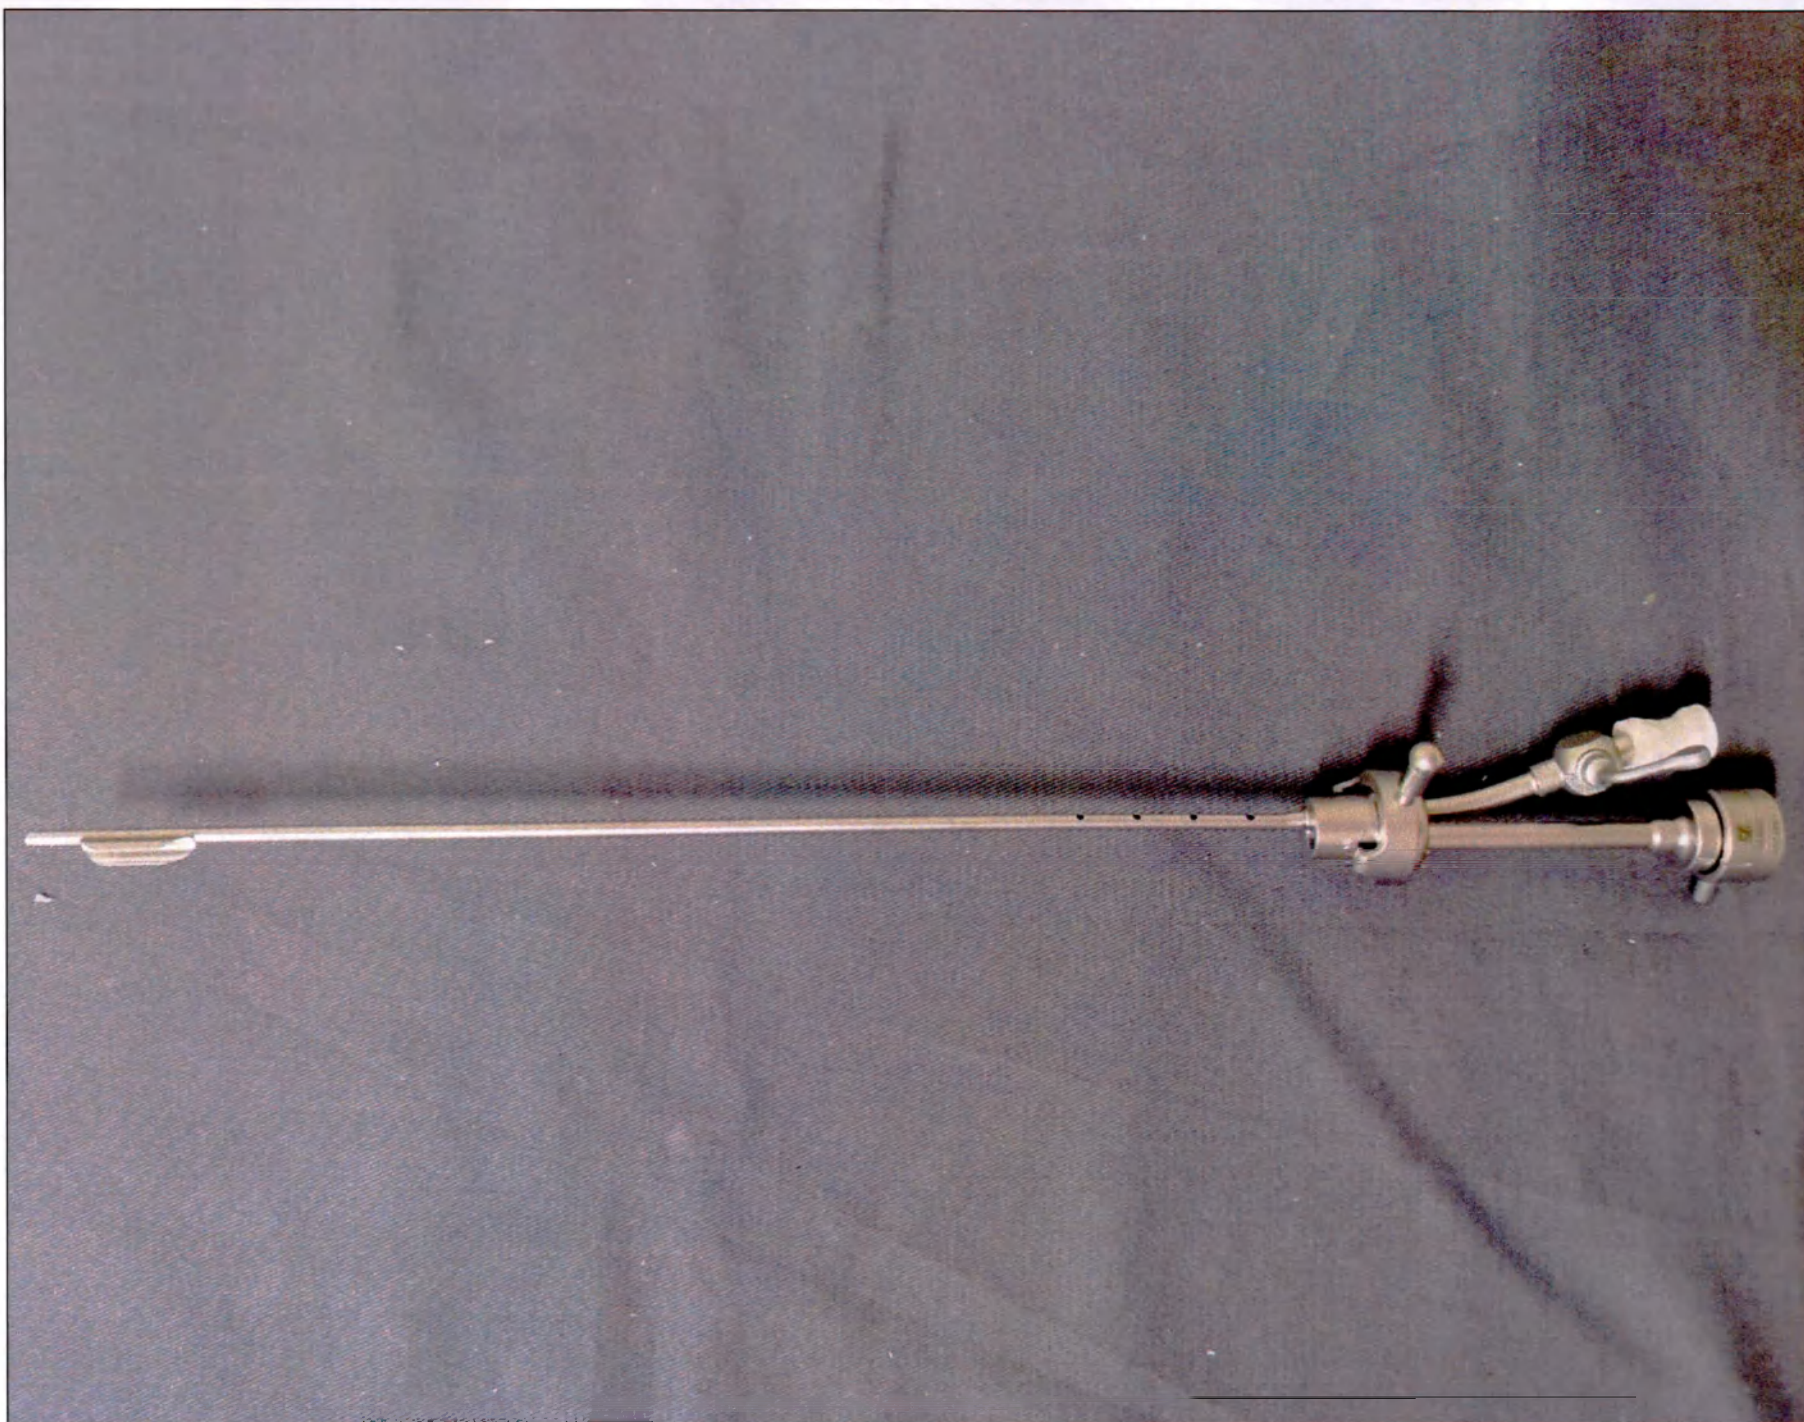


Рис. 92. Переходной мостик, телескопический, с инструментальным каналом, размер 5 Шр.

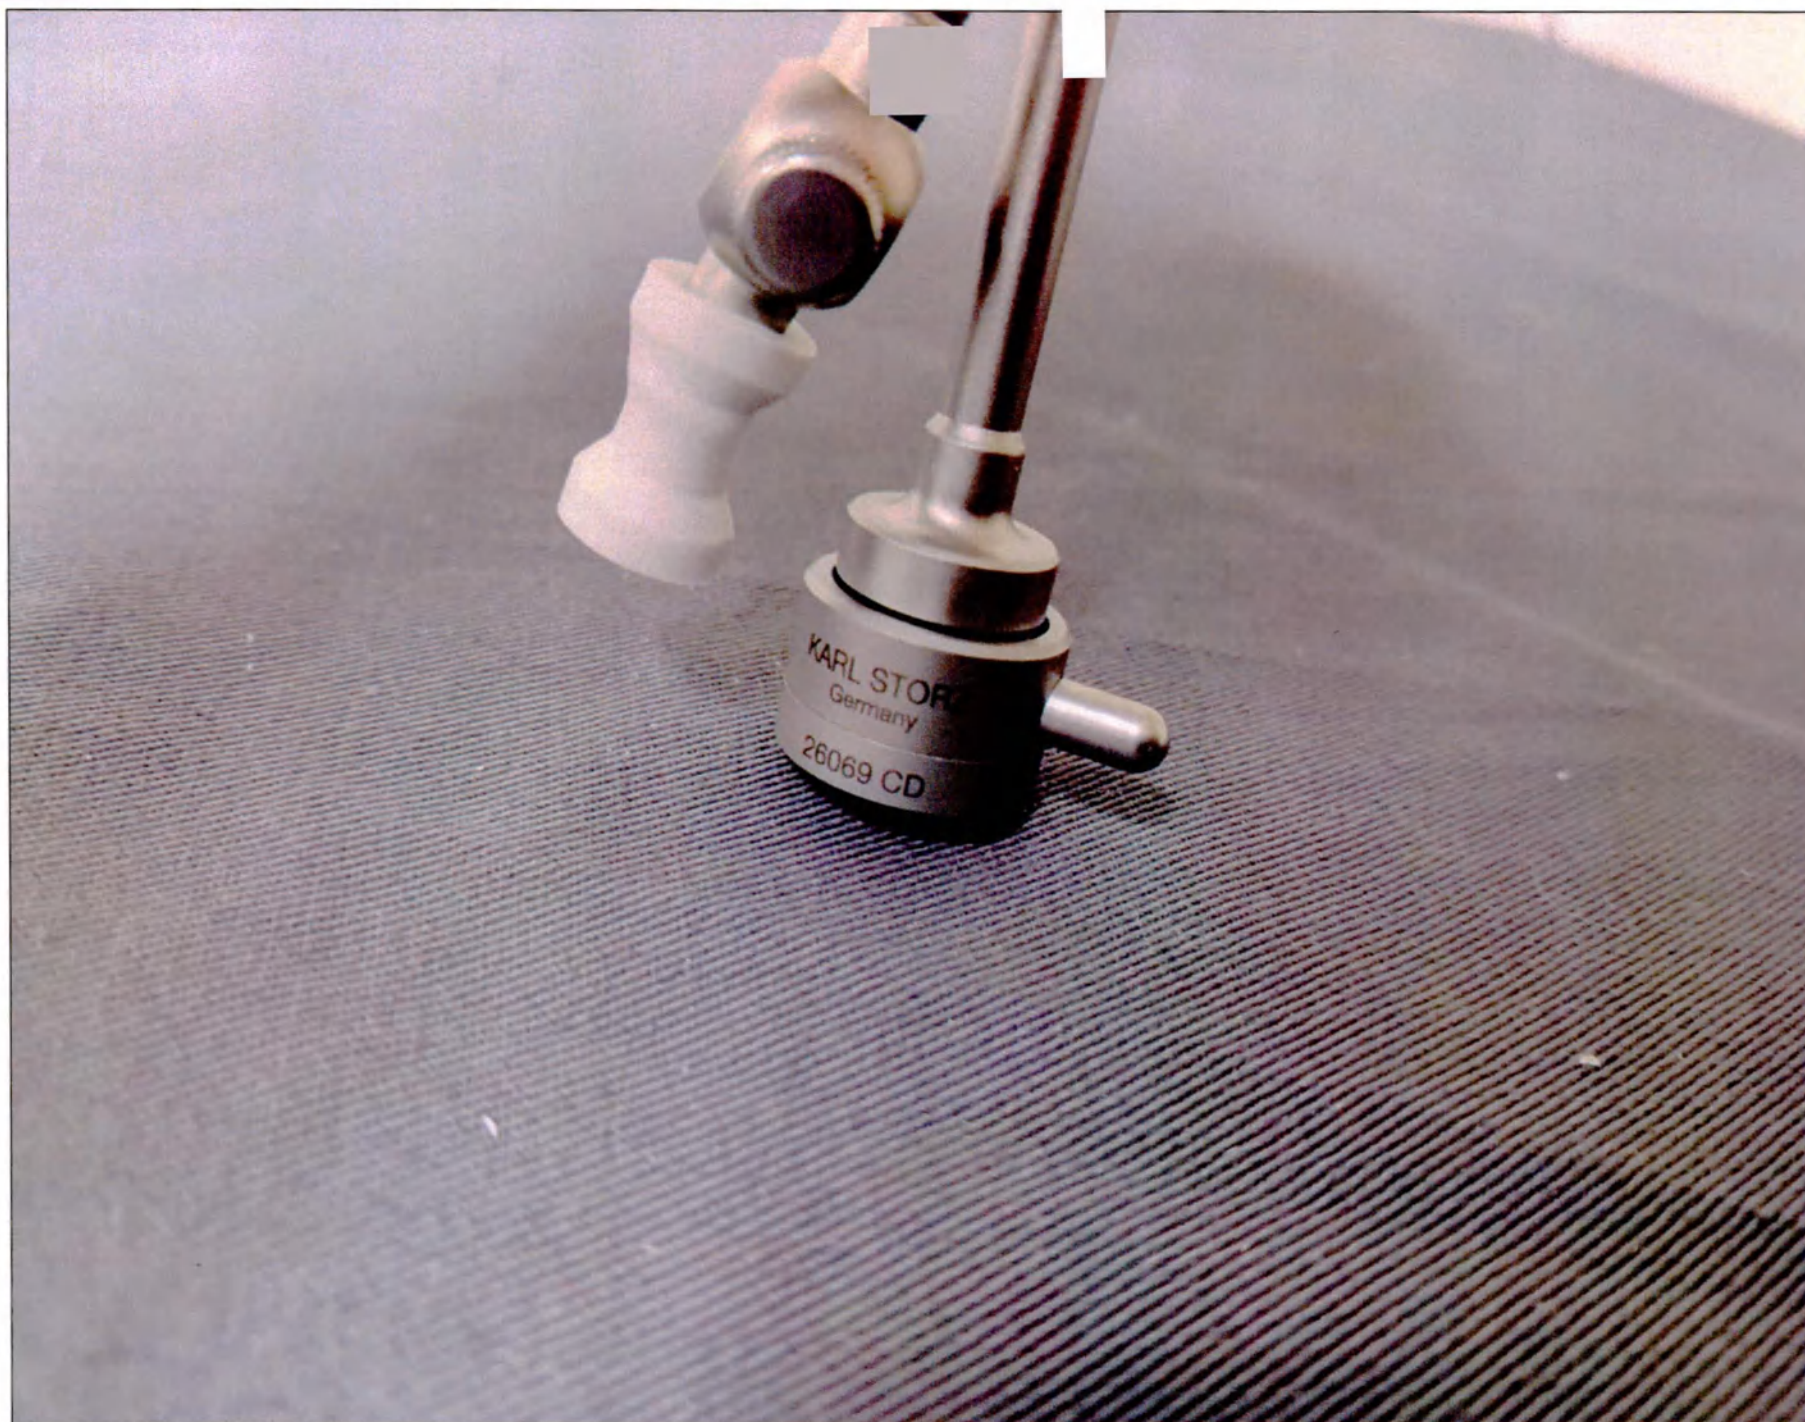


Рис. 93. Переходной мостик, телескопический, с инструментальным каналом, размер 5 Шр.

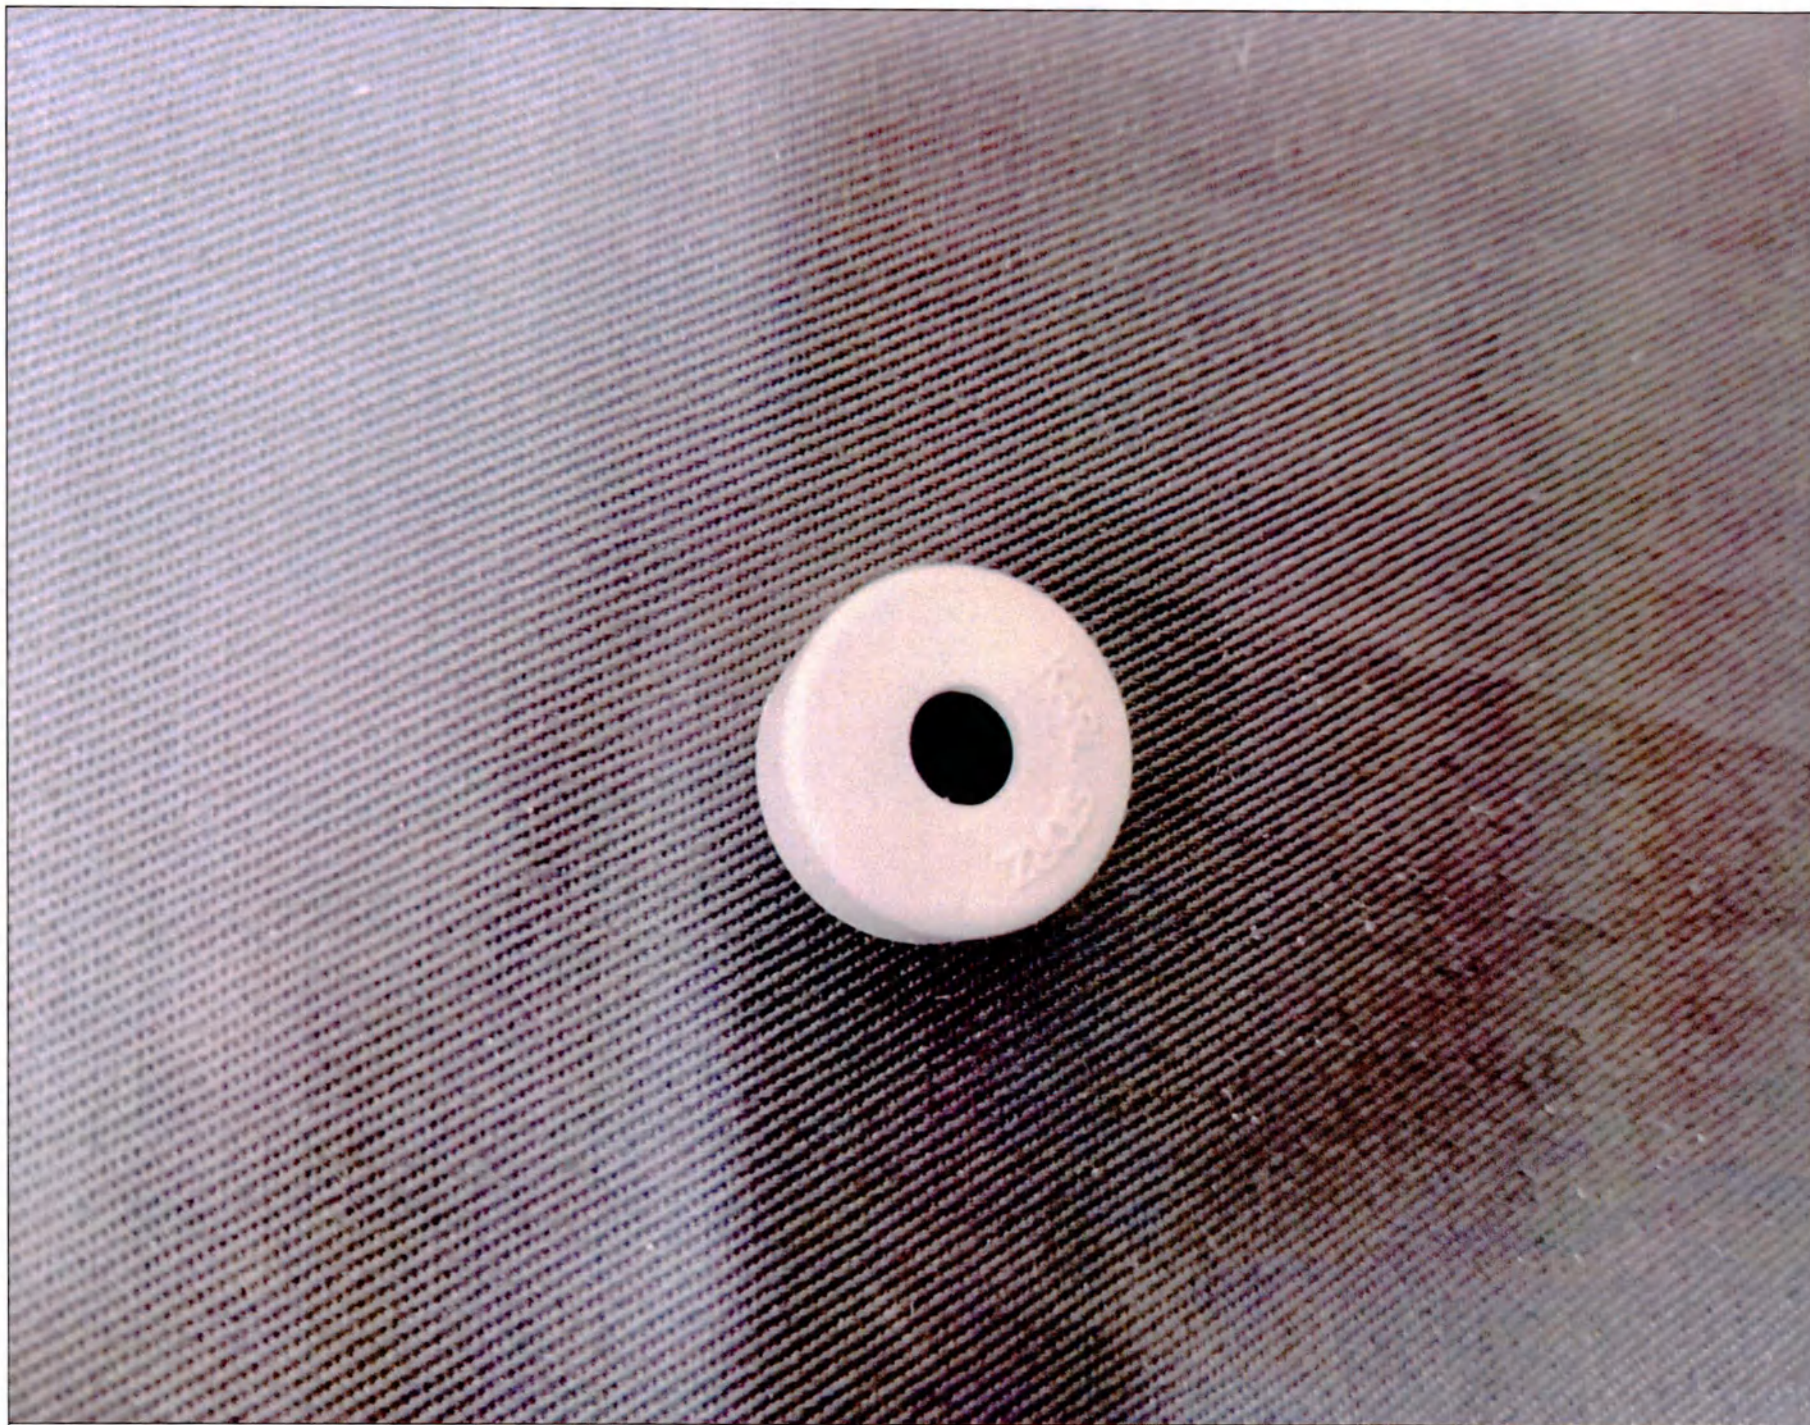


Рис. 94. Колпачок уплотняющий – 10 шт./уп



Рис. 95. Кран запорный для ирригационного канала



Рис. 96. Кран запорный с рукояткой

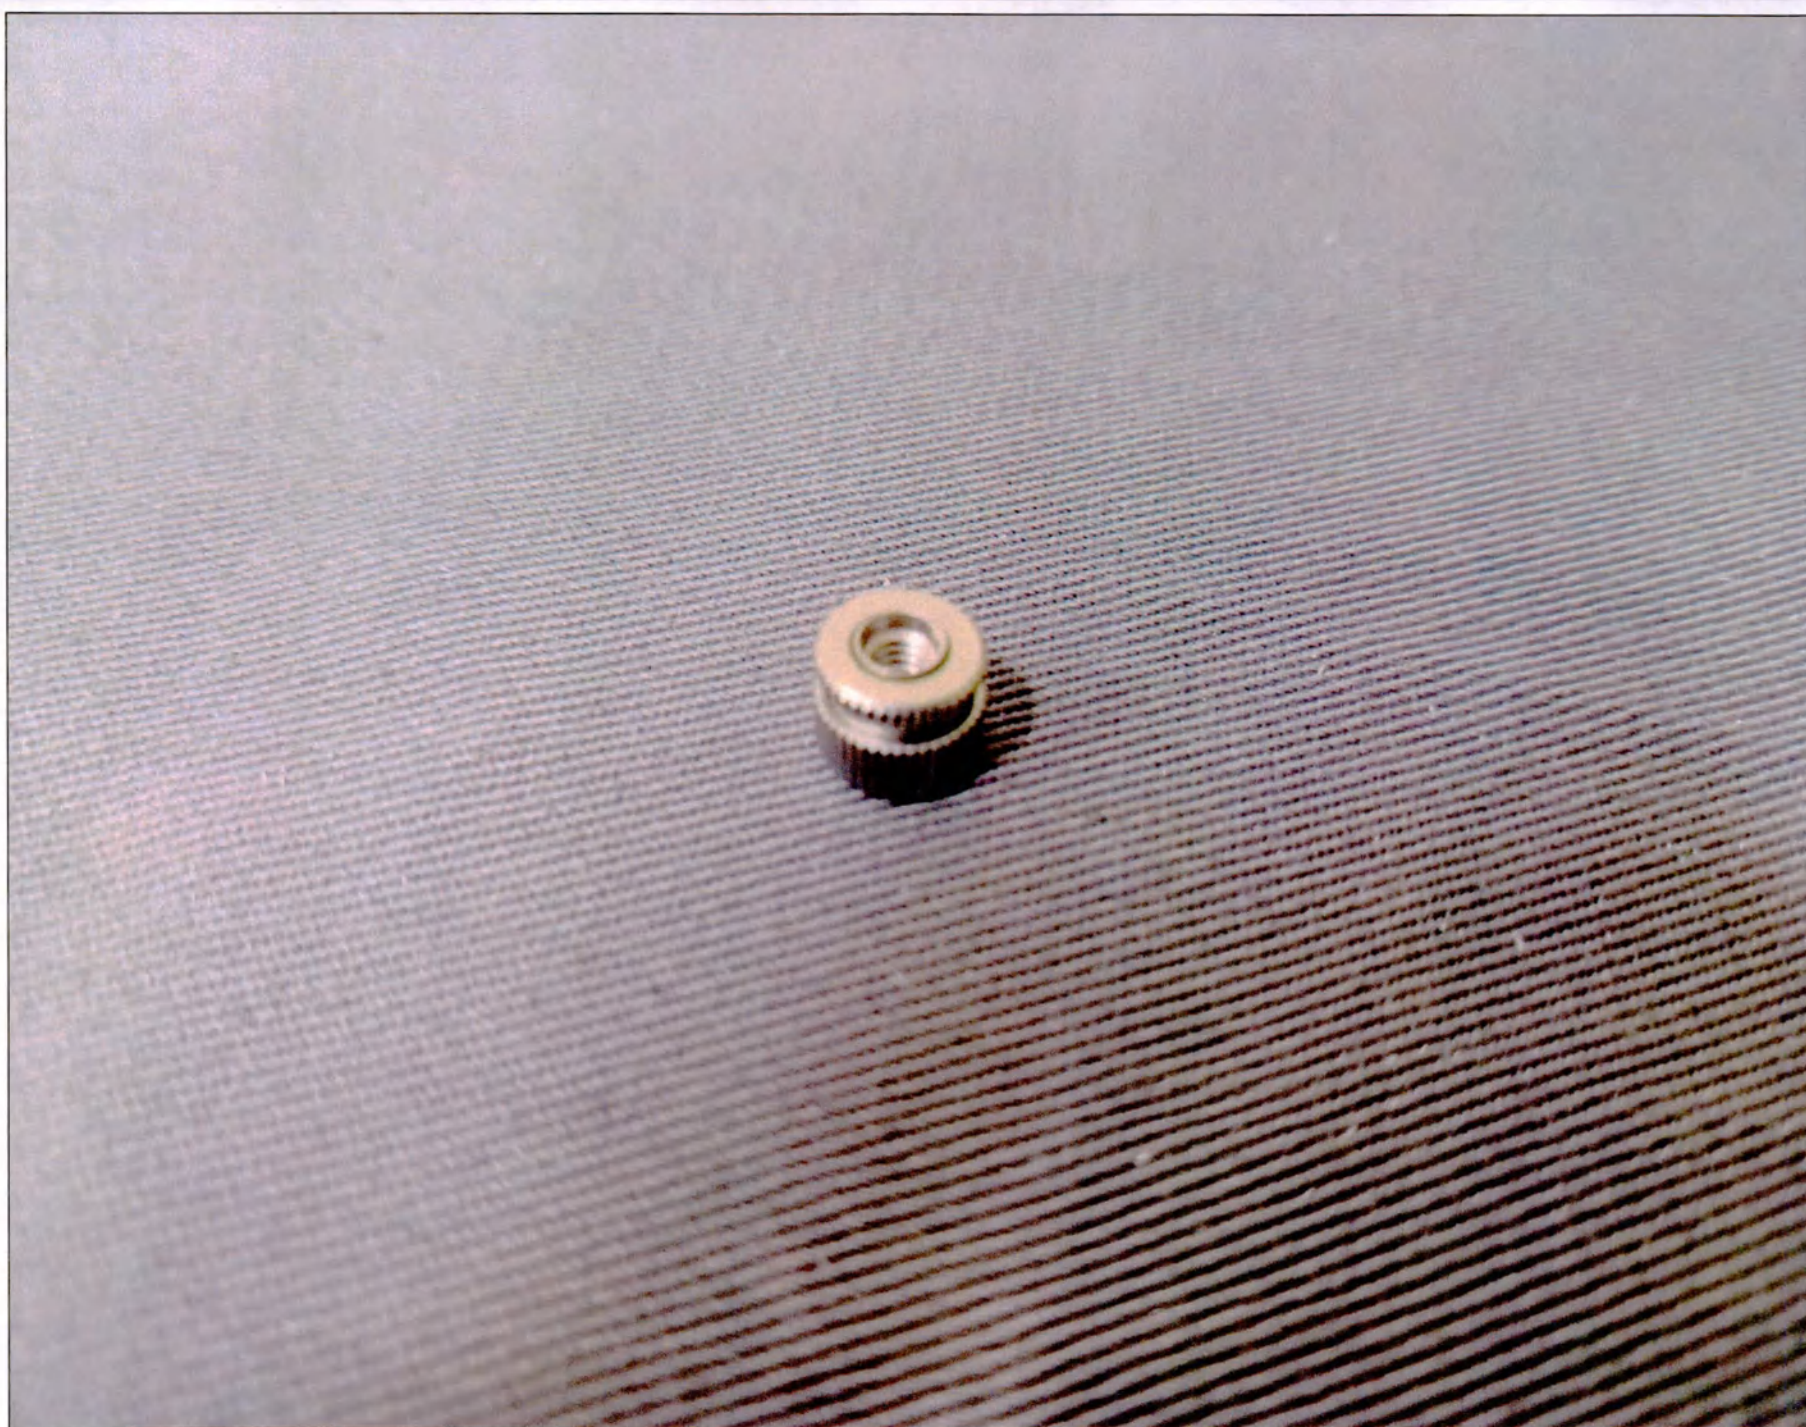


Рис. 97. Колпачок пружинный



Рис. 98. Колпачок уплотнительный, диаметр 0,8 мм – 10 шт./уп.

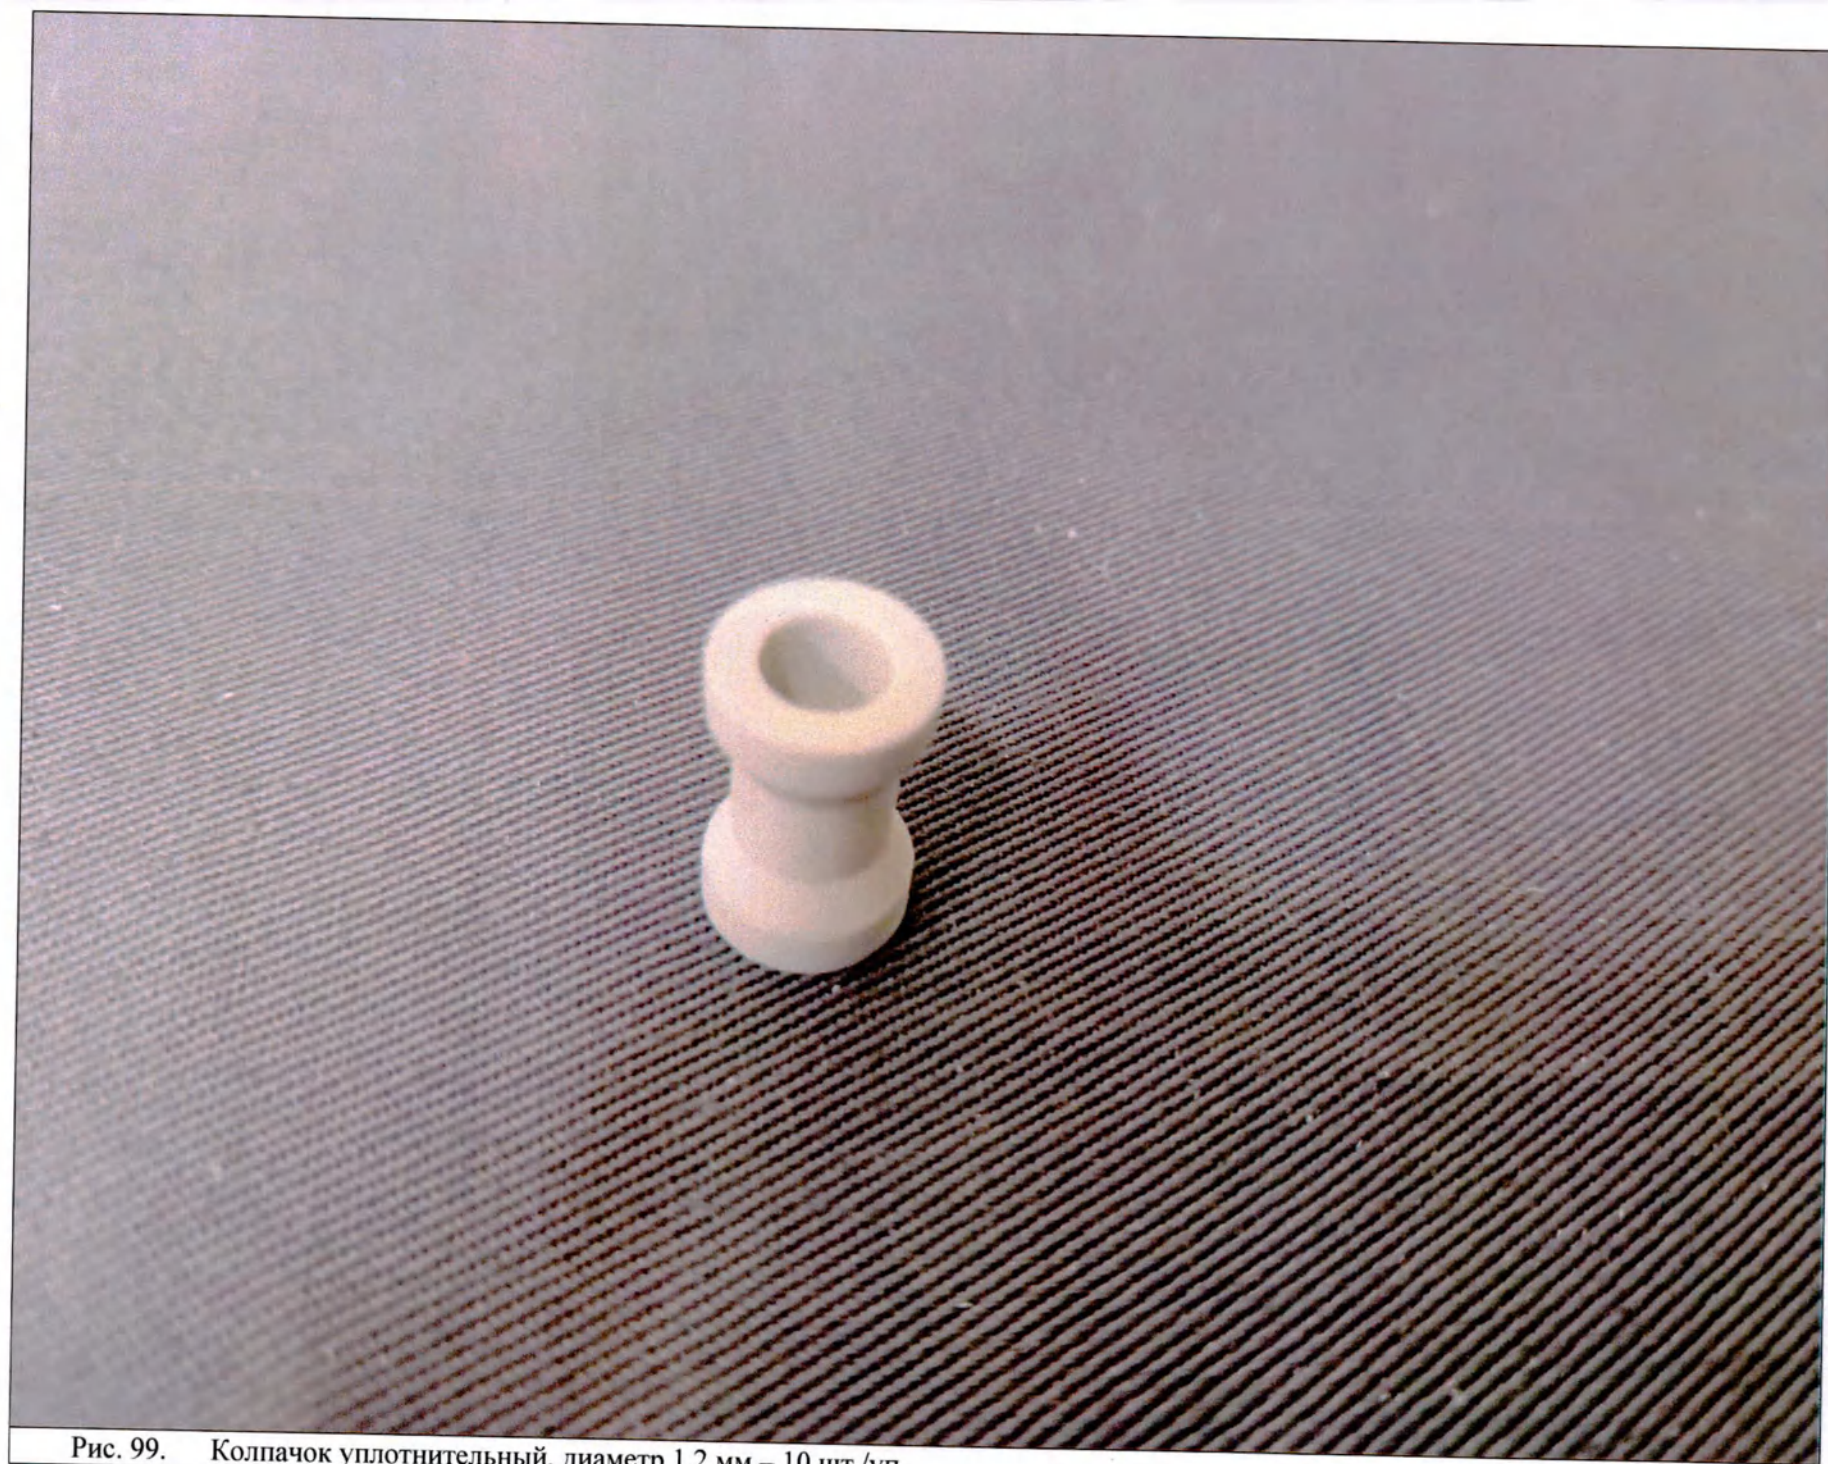


Рис. 99. Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм – 10 шт./уп.

Рис. 100. Кольцо прокладочное, внутренний диаметр 11 мм, внешний диаметр 13 мм – 10 шт./уп.



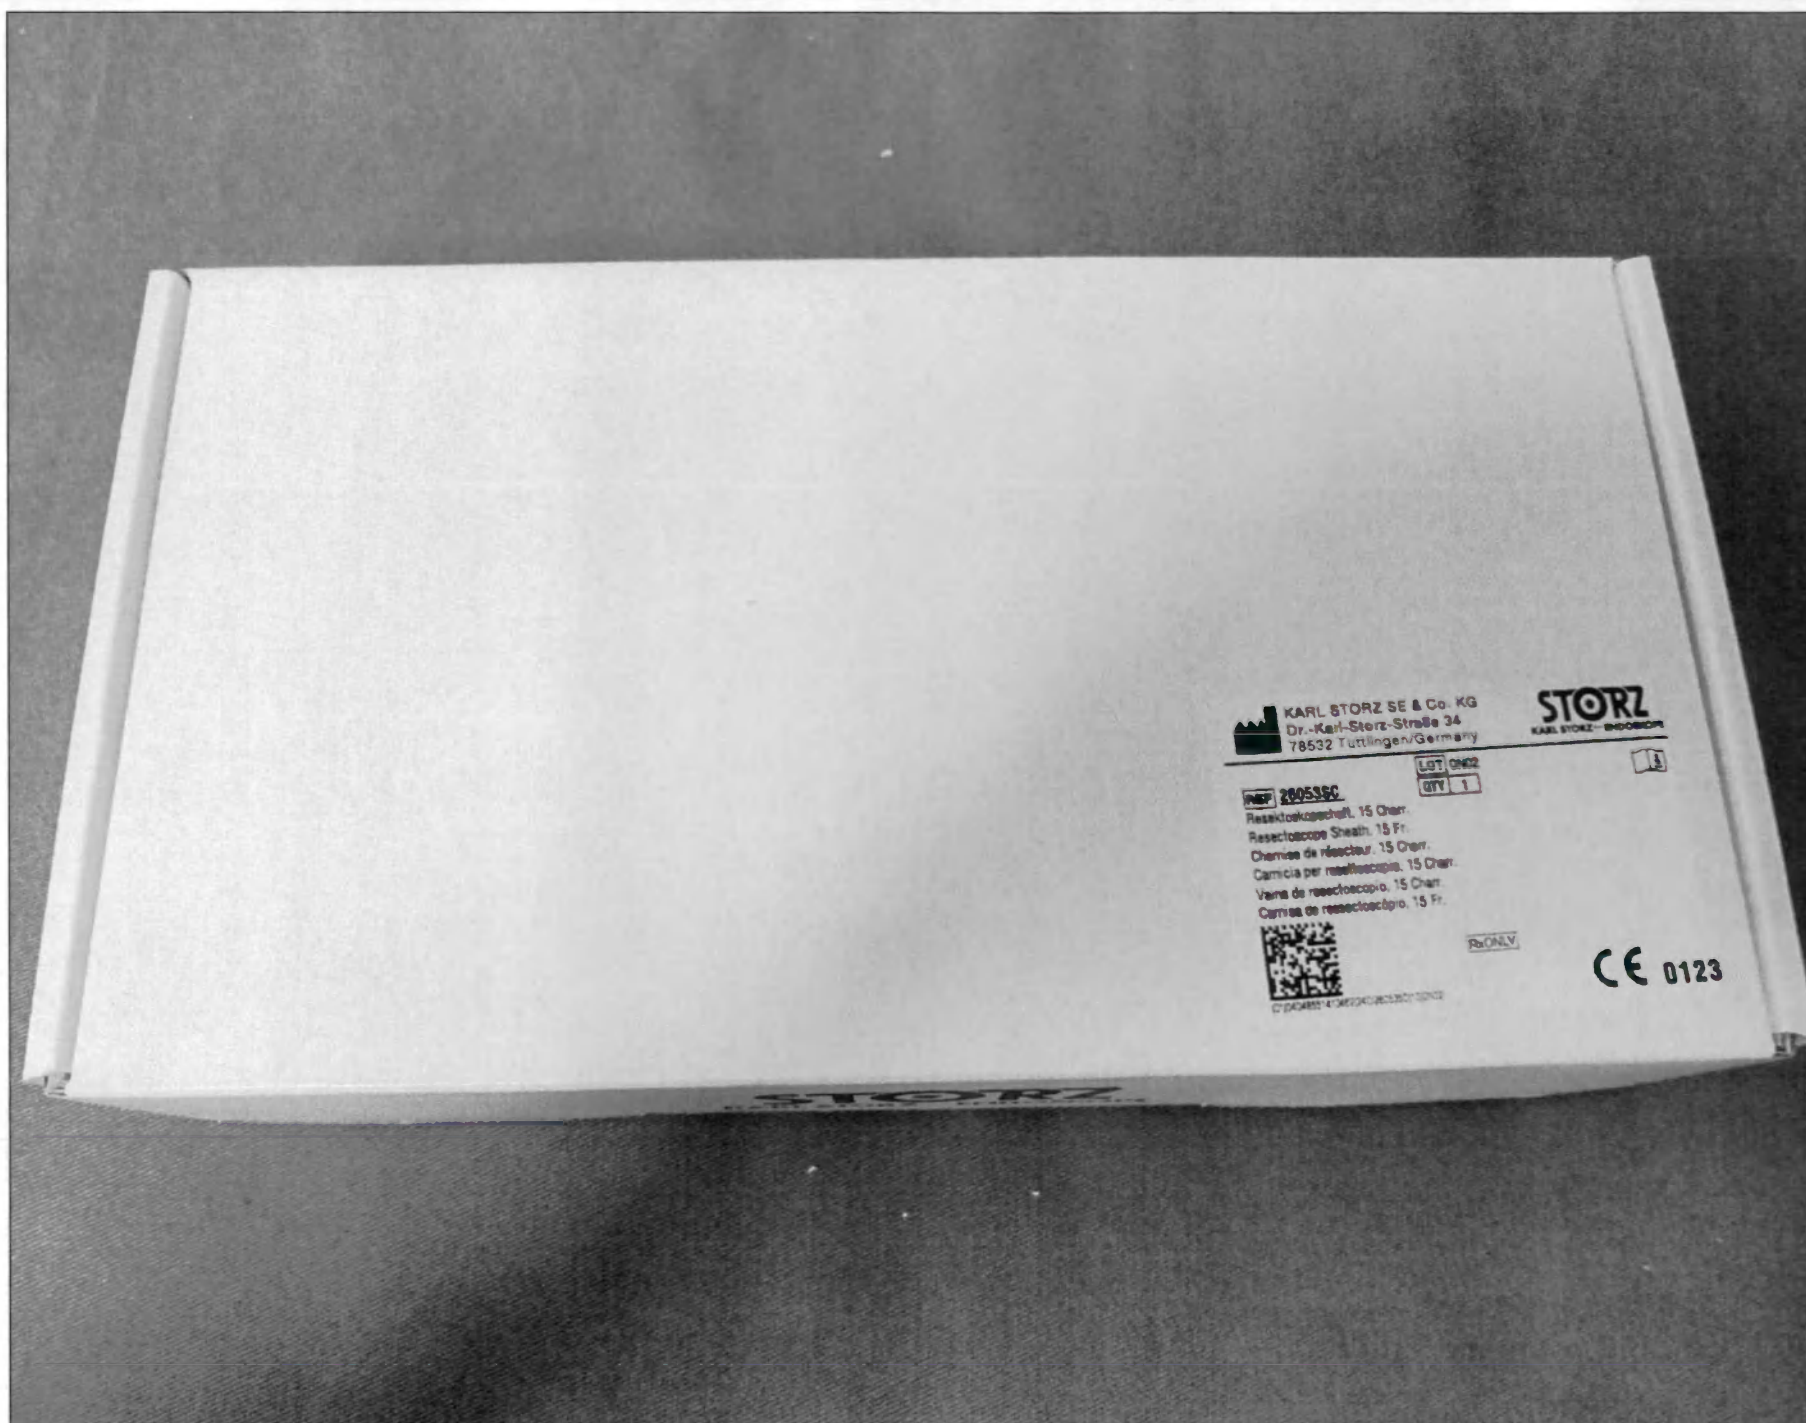


Рис. 101. Пример вторичной упаковки



Рис. 102. Пример вторичной упаковки



Рис. 103. Пример вторичной упаковки

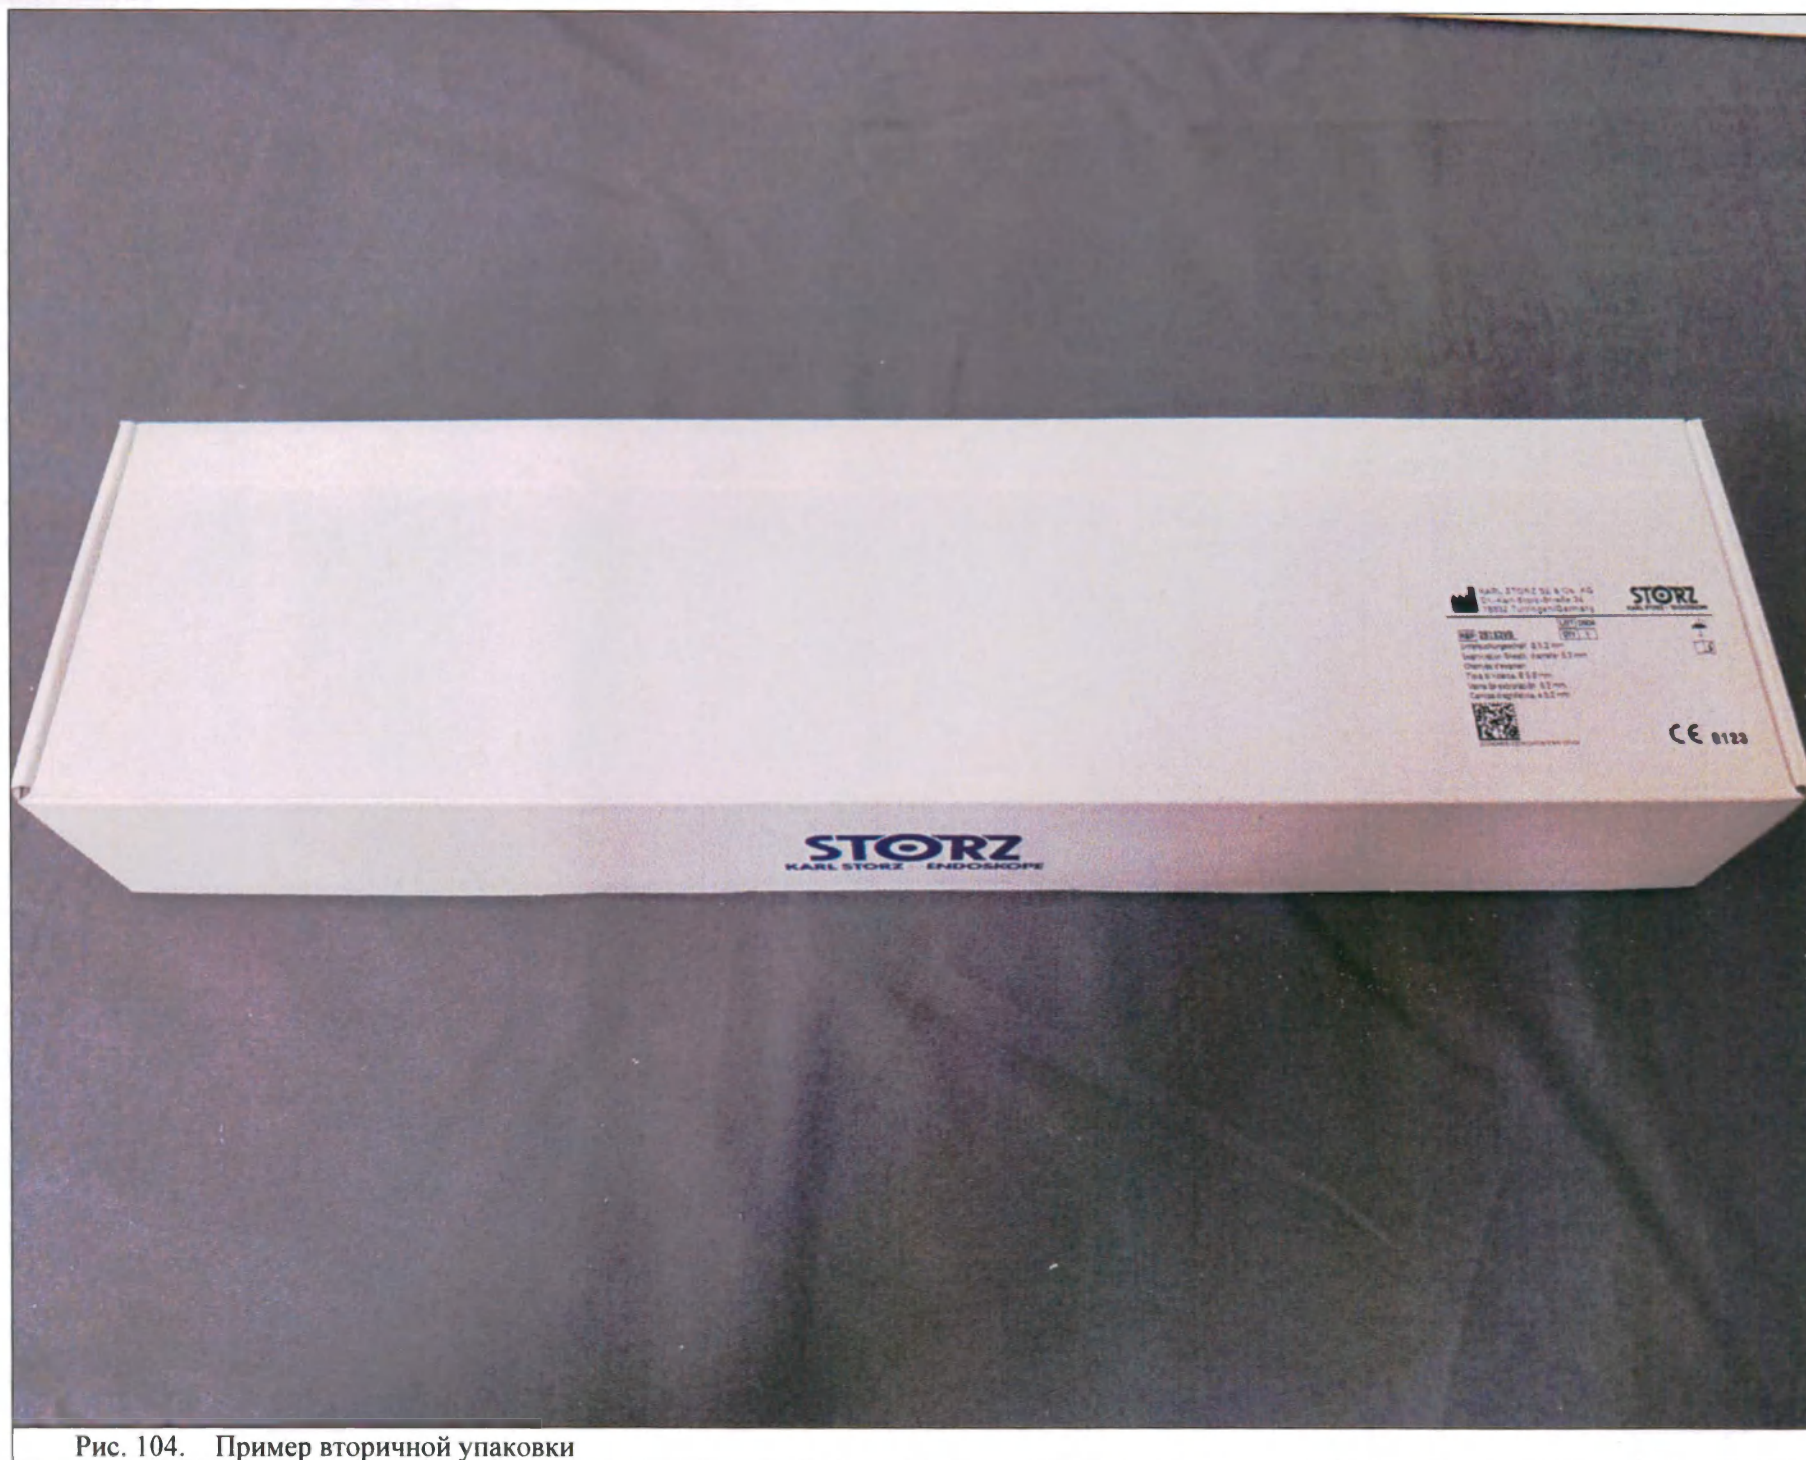


Рис. 104. Пример вторичной упаковки



Рис. 105. Пример вторичной упаковки



Рис. 106. Пример вторичной упаковки



Рис. 107. Пример первичной упаковки

 **KARL STORZ SE & Co. KG**
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 2615480


LOT PN02

QTY 1

Außenschaft n. BETTOCCHI®
BETTOCCHI® Outer Sheath
Chemise ext. d'après BETTOCCHI®
Camicia esterna sec. BETTOCCHI®
Vaina exterior de BETTOCCHI®
Camisa externa de BETTOCCHI®



1010404655123010102615480(1 D)PN02



CE 0123

Рис. 108. Пример первичной упаковки



Рис. 109. Пример первичной упаковки

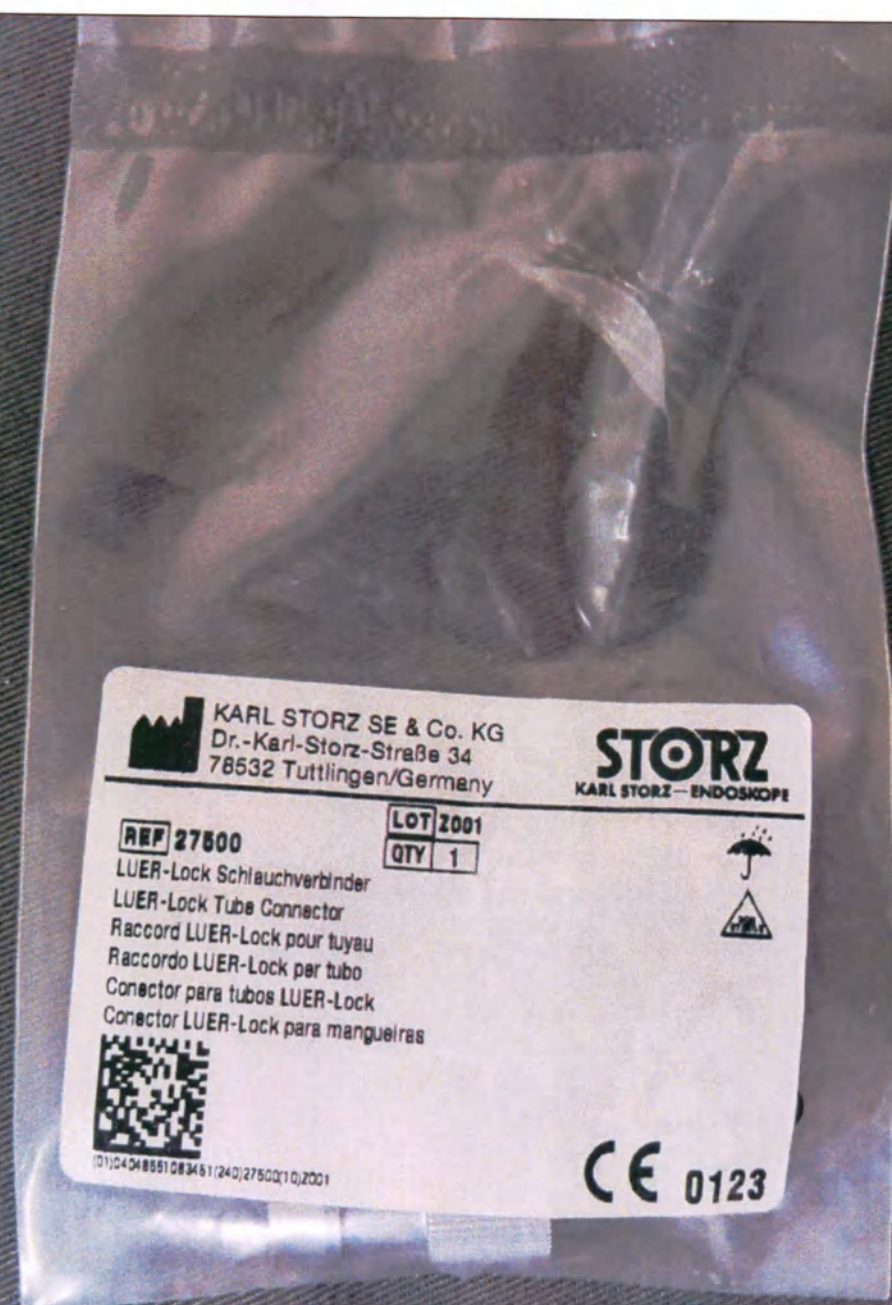


Рис. 110. Пример индивидуальной упаковки



Рис. 111. Пример индивидуальной упаковки

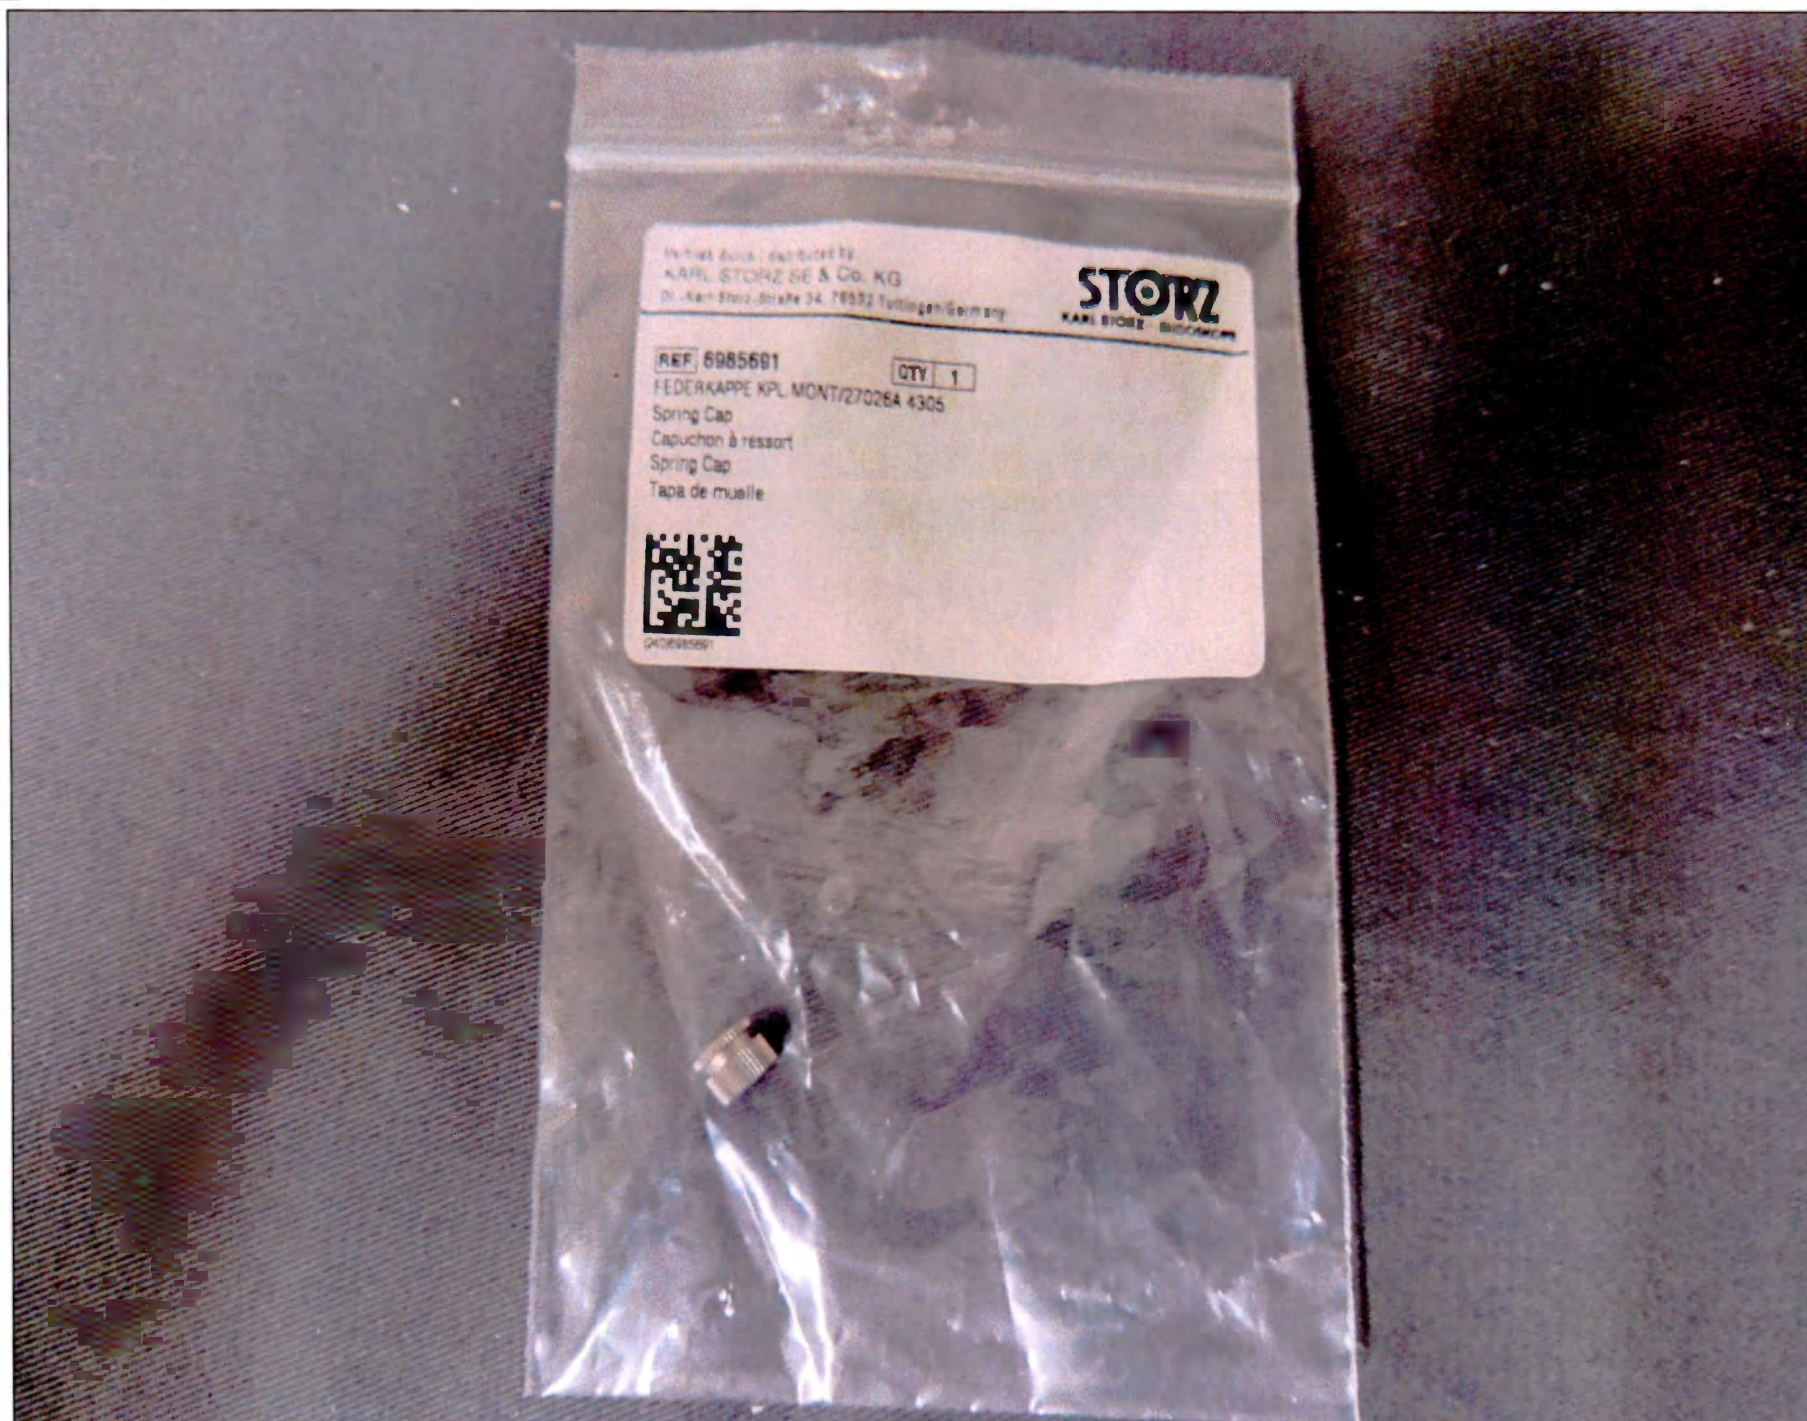


Рис. 112. Пример индивидуальной упаковки

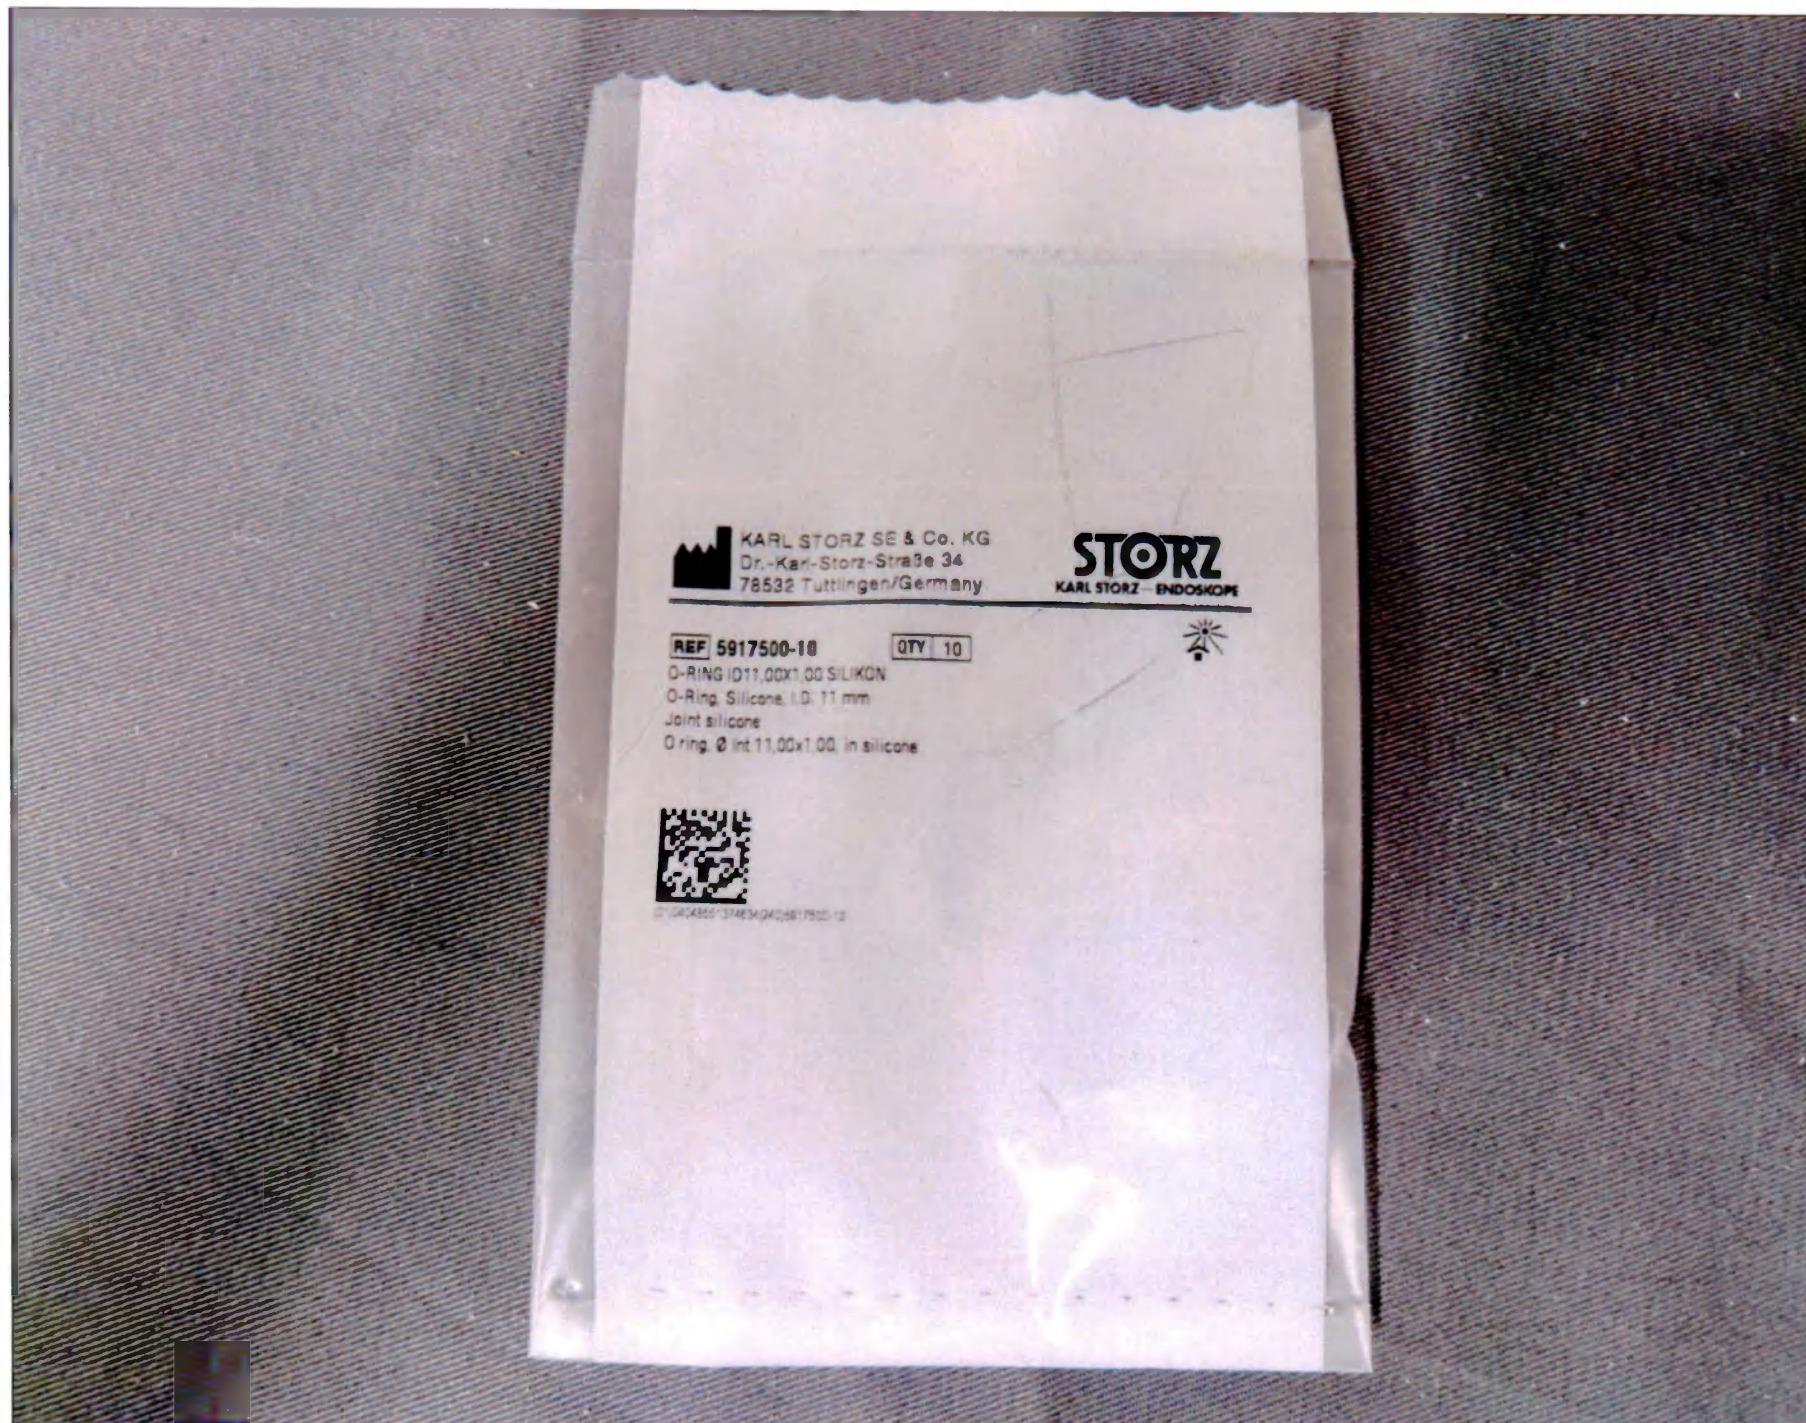


Рис. 113. Пример индивидуальной упаковки



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 26053SC

LOT ON02

QTY 1



Resektoskopschaft, 15 Charr.

Resectoscope Sheath, 15 Fr.

Chemise de résecteur, 15 Charr.

Camicia per resettoscopio, 15 Charr.

Vaina de resectoscopio, 15 Charr.

Camisa de ressectoscópio, 15 Fr.



RxONLY

CE 0123

(01)04048551410462(240)26053SC(10)ON02

Рис. 114. Пример маркировки на вторичной упаковке



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany


STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPF

REF 26154B0

LOT PN02

QTY 1

Außenschaft n. BETTOCCHI®
BETTOCCHI® Outer Sheath
Chemise ext. d'après BETTOCCHI®
Camicia esterna sec. BETTOCCHI®
Vaina exterior de BETTOCCHI®
Camisa externa de BETTOCCHI®



01)04548551230244(240)26154B0(10)PN02

CE 0123

Рис. 115. Пример маркировки на вторичной упаковке

Инструкция по эксплуатации
«Тубус гинекологический для создания эндоскопического доступа в вариантах исполнения, с принадлежностями»

Instructions for use
«Gynecologic sheath for creating endoscopic access in variants, with accessories»

Год выпуска или пересмотра инструкции: 2024

Рис. 116. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье

26053SC

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOP

Тубус гинекологический для создания эндоскопического доступа в вариантах исполнения с принадлежностями:

Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 15 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания

РУ № _____ ОТ _____

Информация о сроке службы – см. инструкцию по эксплуатации

Производитель KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532
Tuttlingen / Germany (Германия)

Уполномоченный представитель на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью
КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК
(ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, г. Москва,
Дербеневская набережная, 7, стр. 4

Рис. 117. Макет русскоязычной маркировки на примере варианта исполнения: Тубус гинекологического резектоскопа для постоянного промывания, внешний, 15 Шр., с двумя кранами, с замком быстрого смыкания/размыкания.




Рис. 118. Пример стикера с символами «Дата изготовления» и «Н» (для изделий, изготовленных из коррозионностойкой стали), которым дополняется маркировка изделия



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 119

_____ листах

