

ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Сюн Вэй.
« » 2023 г.


ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СЫСОВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Разбавитель проб для анализаторов серии СХ для диагностики in vitro

варианты исполнения:

- 1) Разбавитель проб (DF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 10 мл

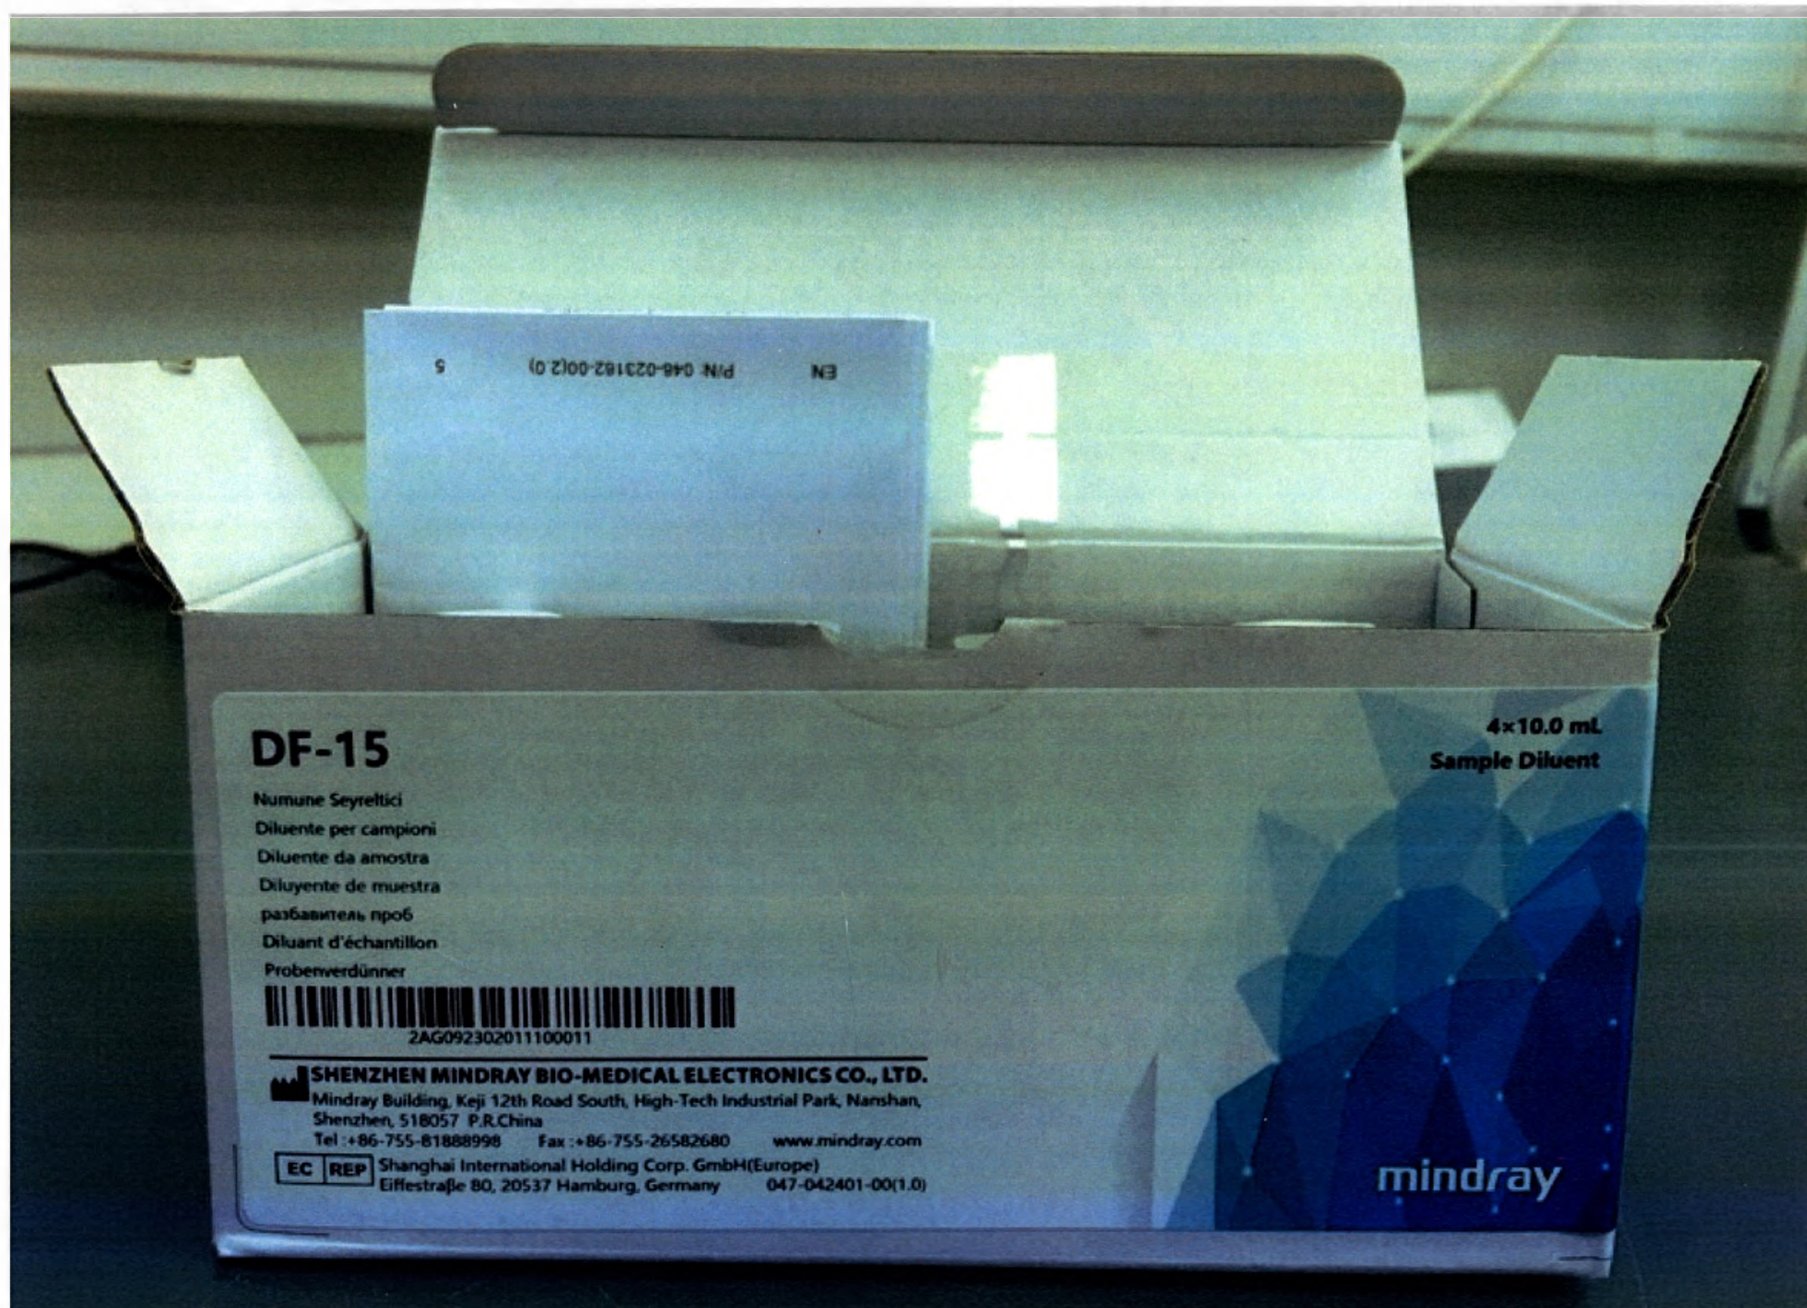

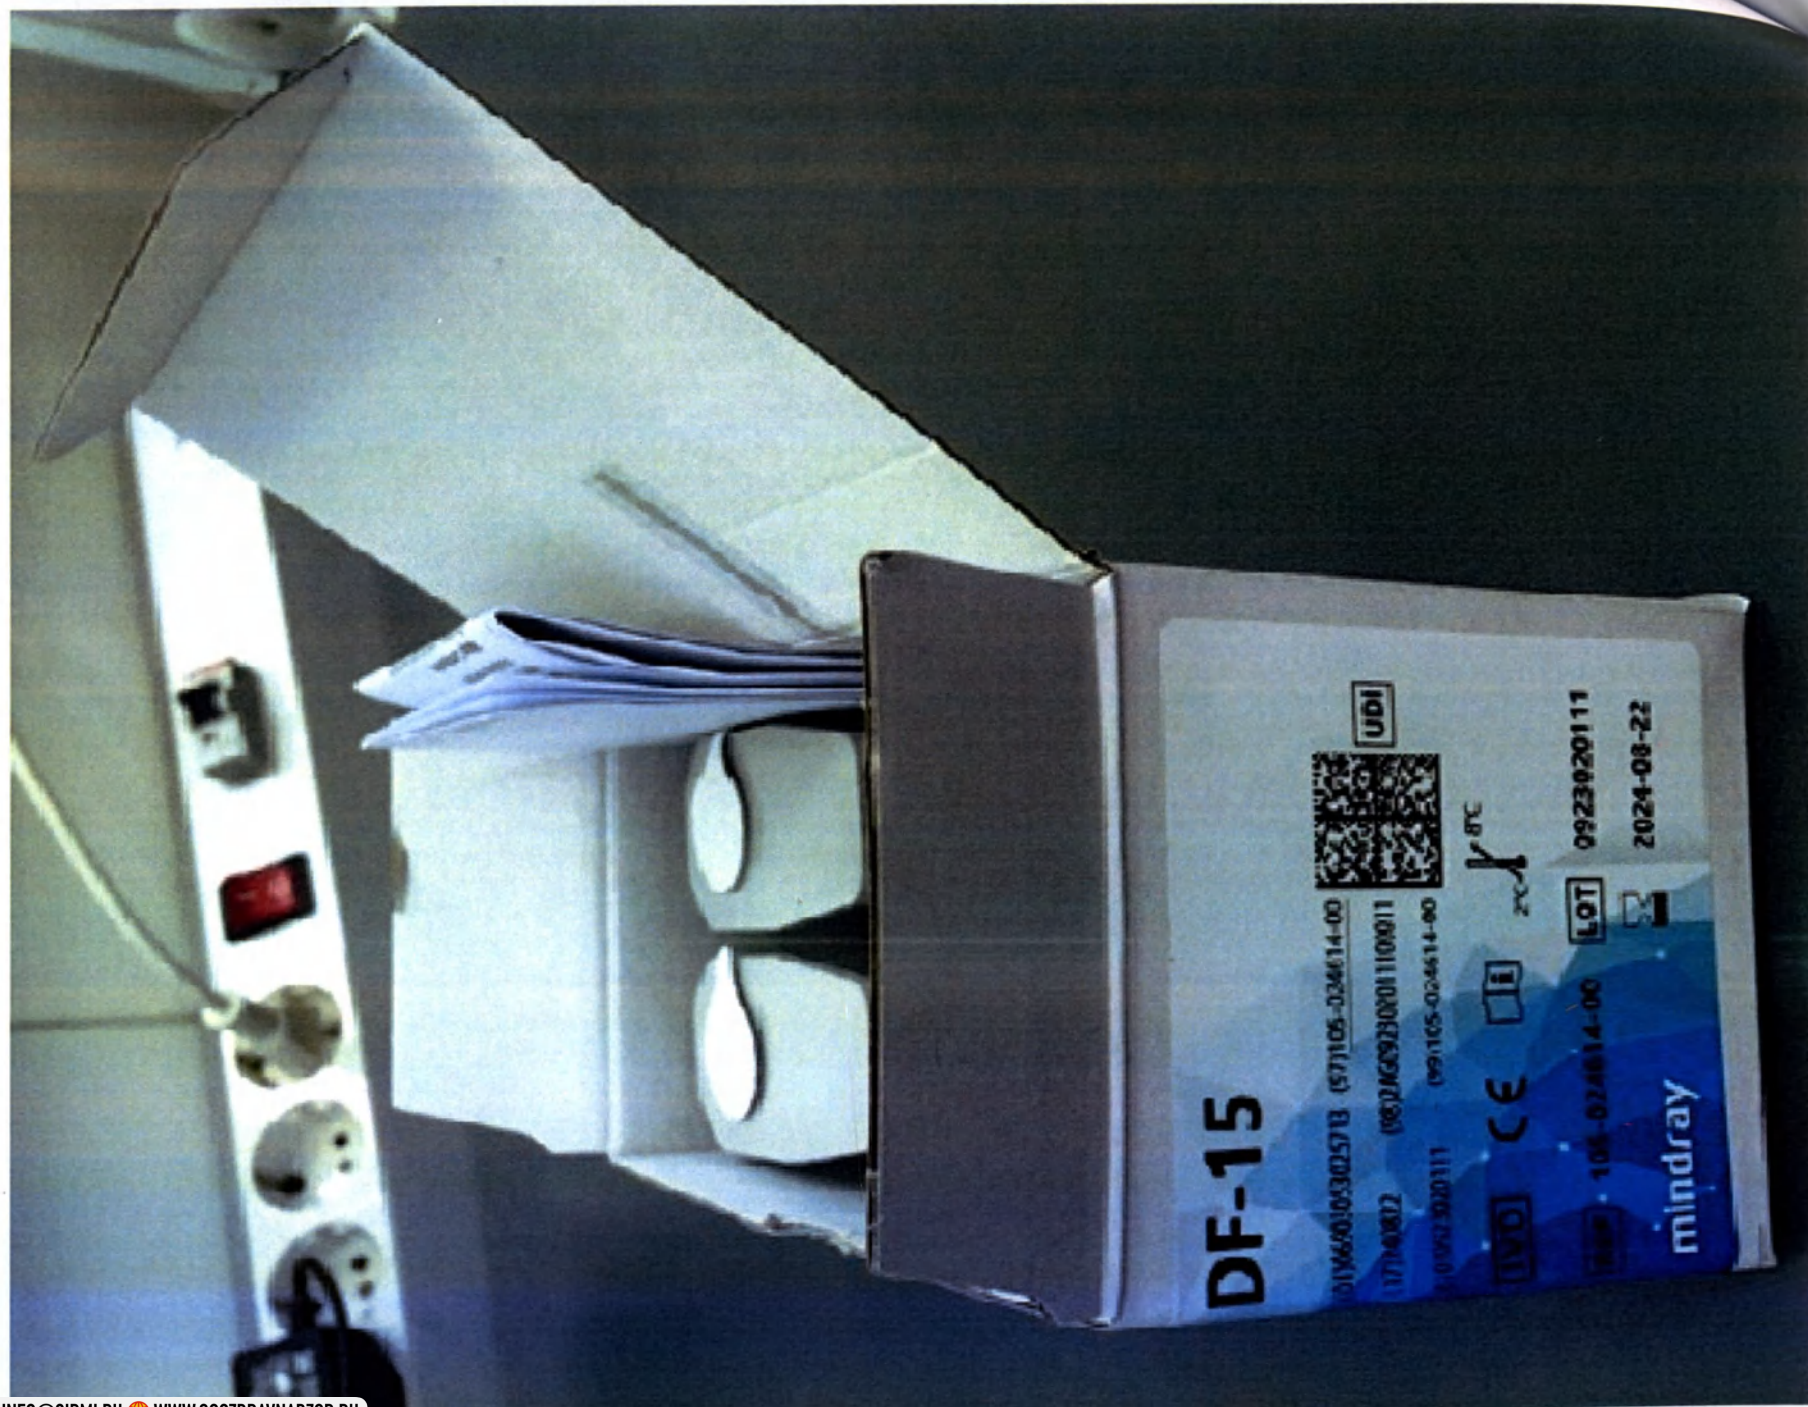

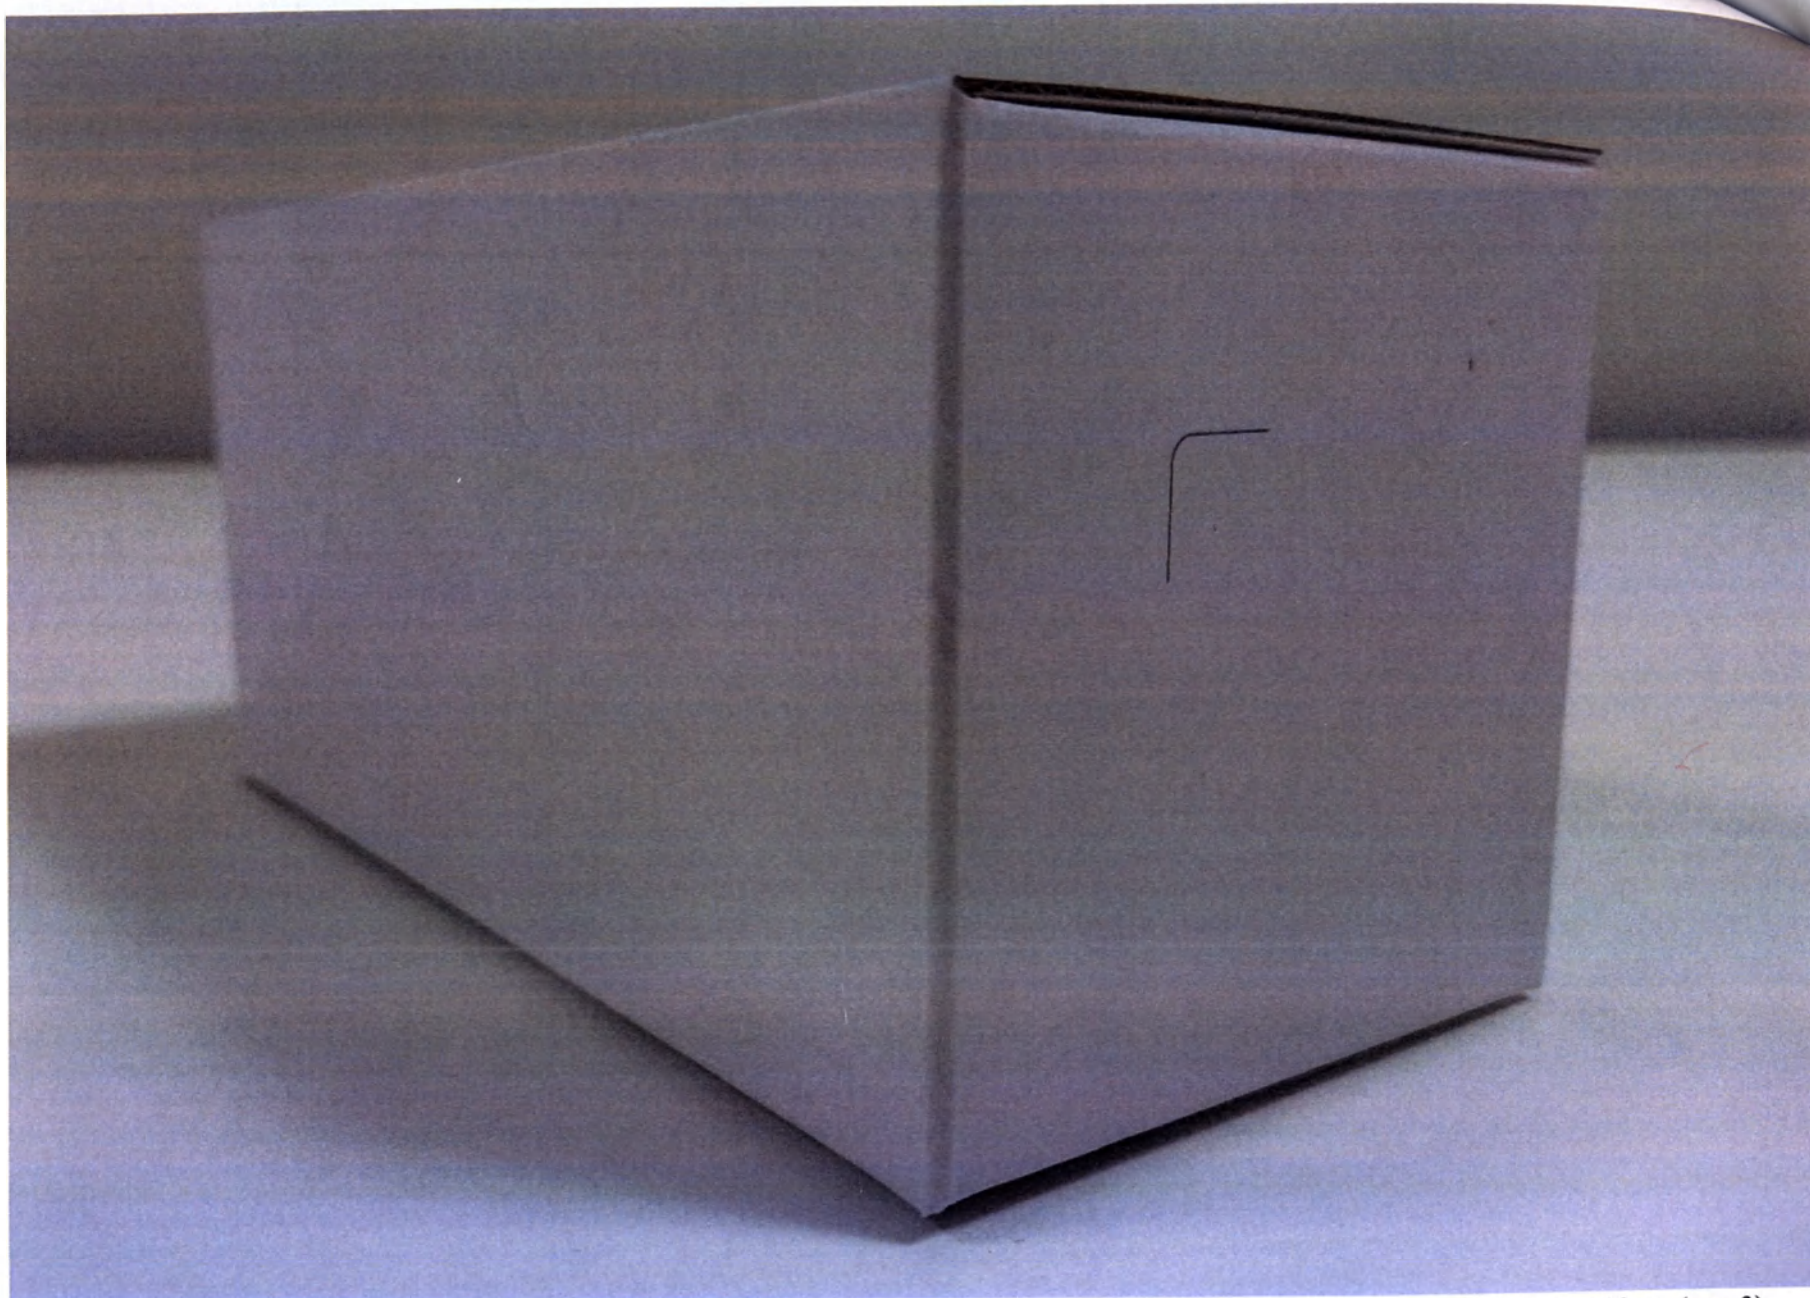


Рисунок 3. Внешняя упаковка Разбавитель проб (DF-15) для анализаторов серии CX для диагностики *in vitro*, 4 кассеты x 10 мл (вид 3)



Рисунок 4. Внешняя упаковка Разбавитель проб (DF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 10 мл (вид 4)




Рисунок 5. Кассеты Разбавитель проб (DF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 10 мл



Рисунок 6. Кассета Разбавитель проб (DF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 10 мл (вид 1)



Рисунок 7. Кассета Разбавитель проб (DF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 10 мл (вид 2)

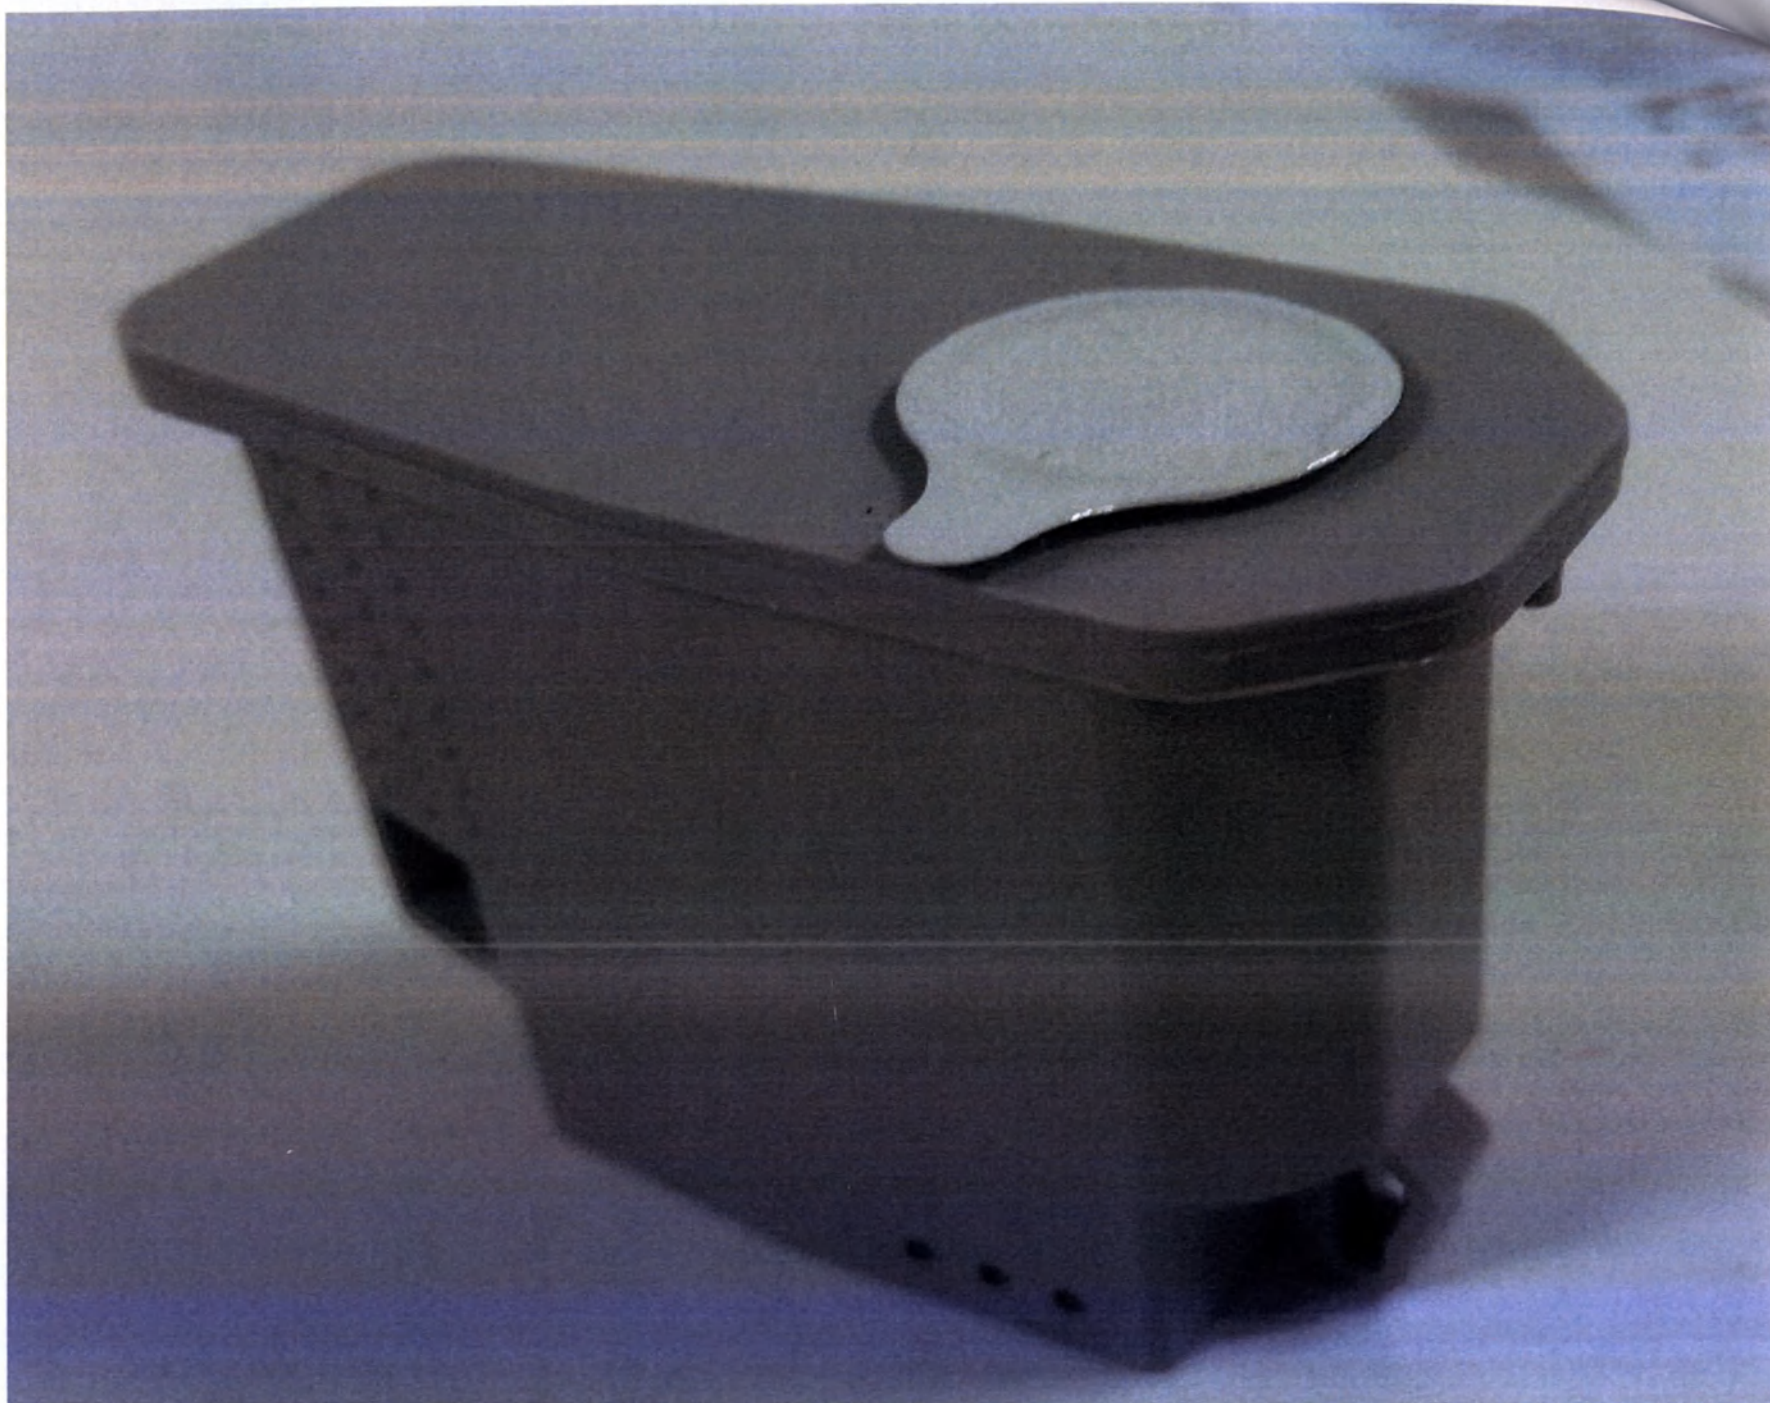

2) Разбавитель проб (AF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 20 мл



Рисунок 9. Внешняя упаковка Разбавитель проб (AF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 20 мл (вид 1)

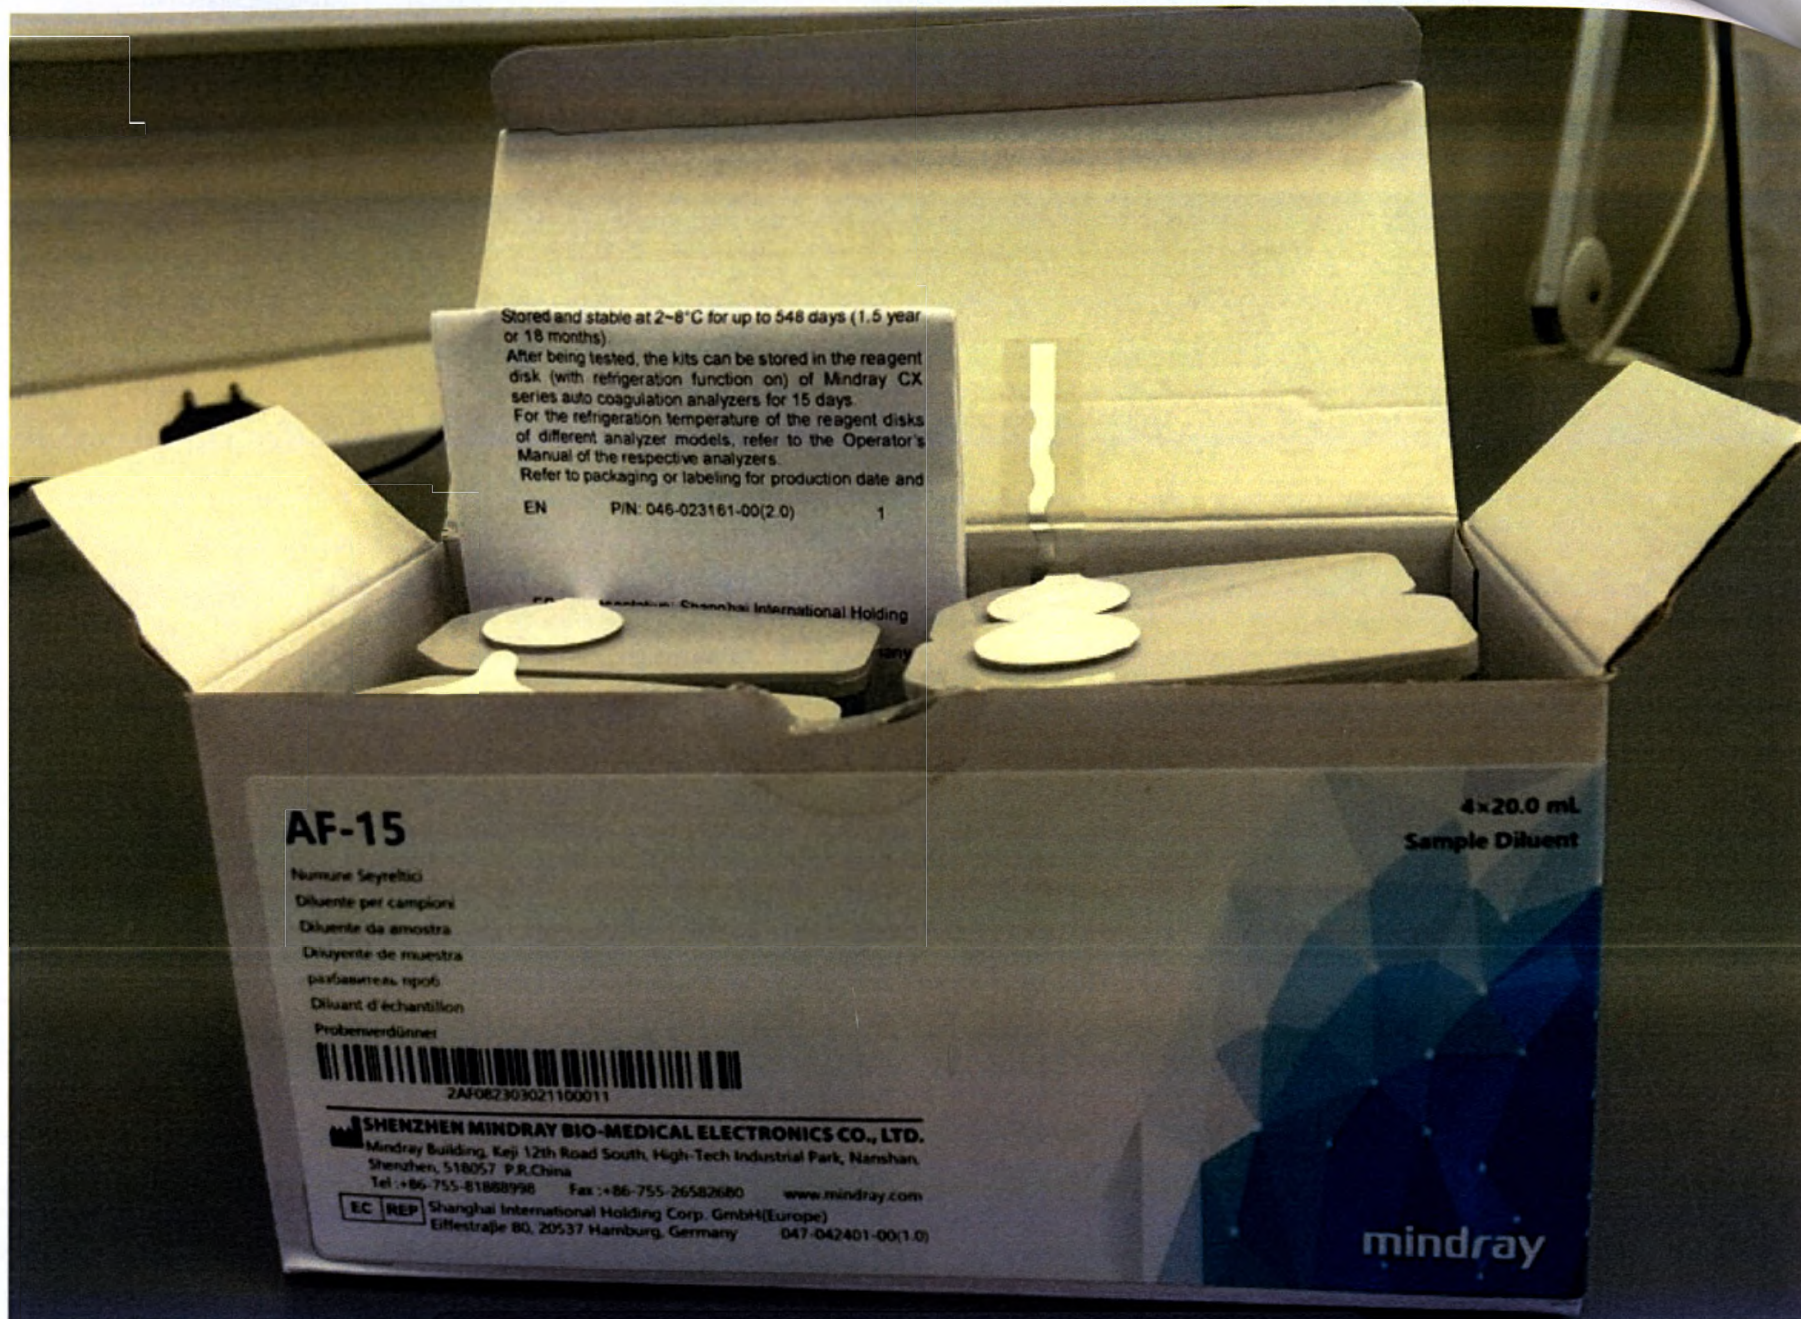


Рисунок 10. Внешняя упаковка Разбавитель проб (AF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 20 мл (вид 2)

AF-15

(01)06903053025706 (97)105-024613-00

(17)240321 (98)2AF082208011100011

(10)0822080111 (99)105-024613-00



UDI

IVD

CE



2°C 8°C

REF

105-024613-00

LOT

0822080111

mindray



2024-03-21

Рисунок 11. Внешняя упаковка Разбавитель проб (AF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 20 мл (вид 3)

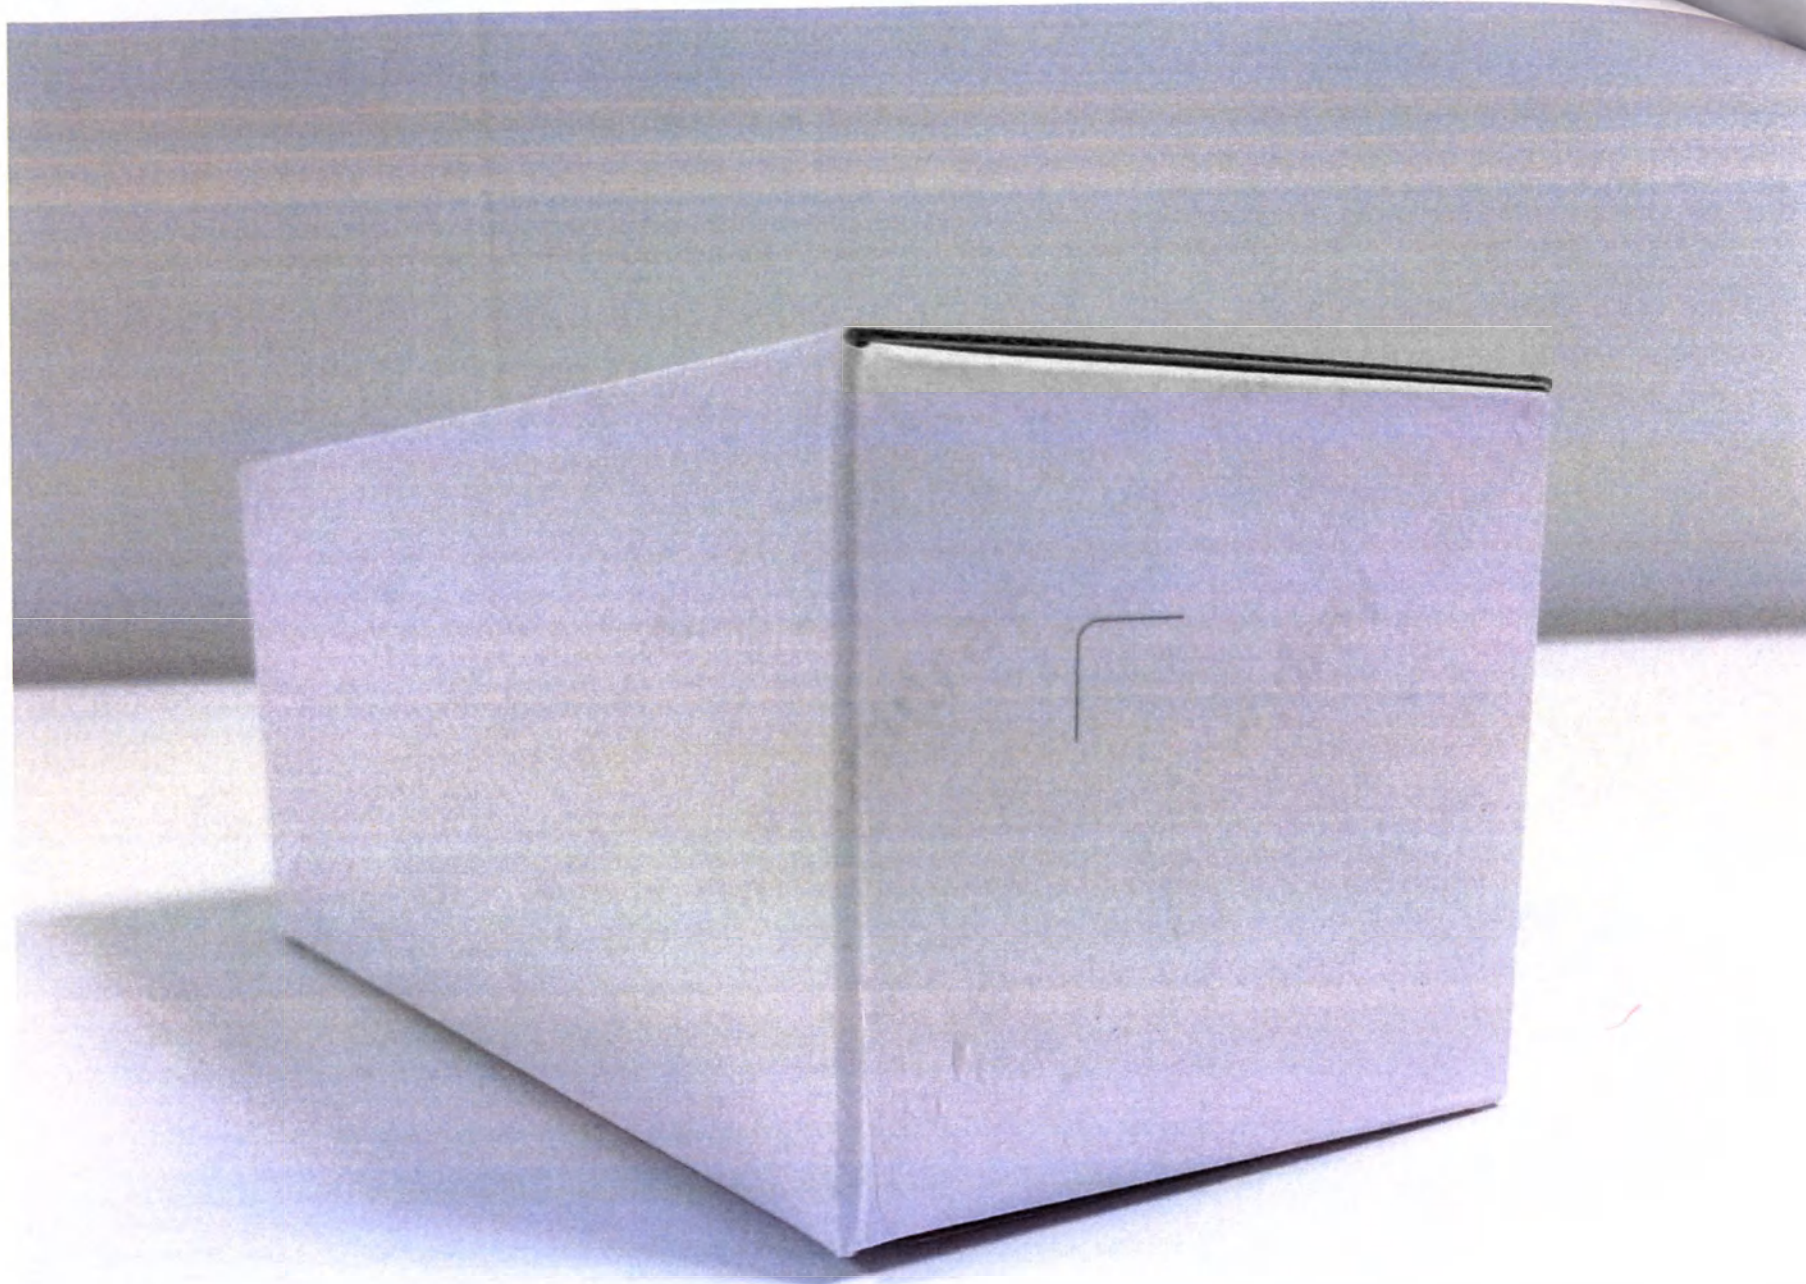


Рисунок 12. Внешняя упаковка Разбавитель проб (AF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 20 мл (вид 4)

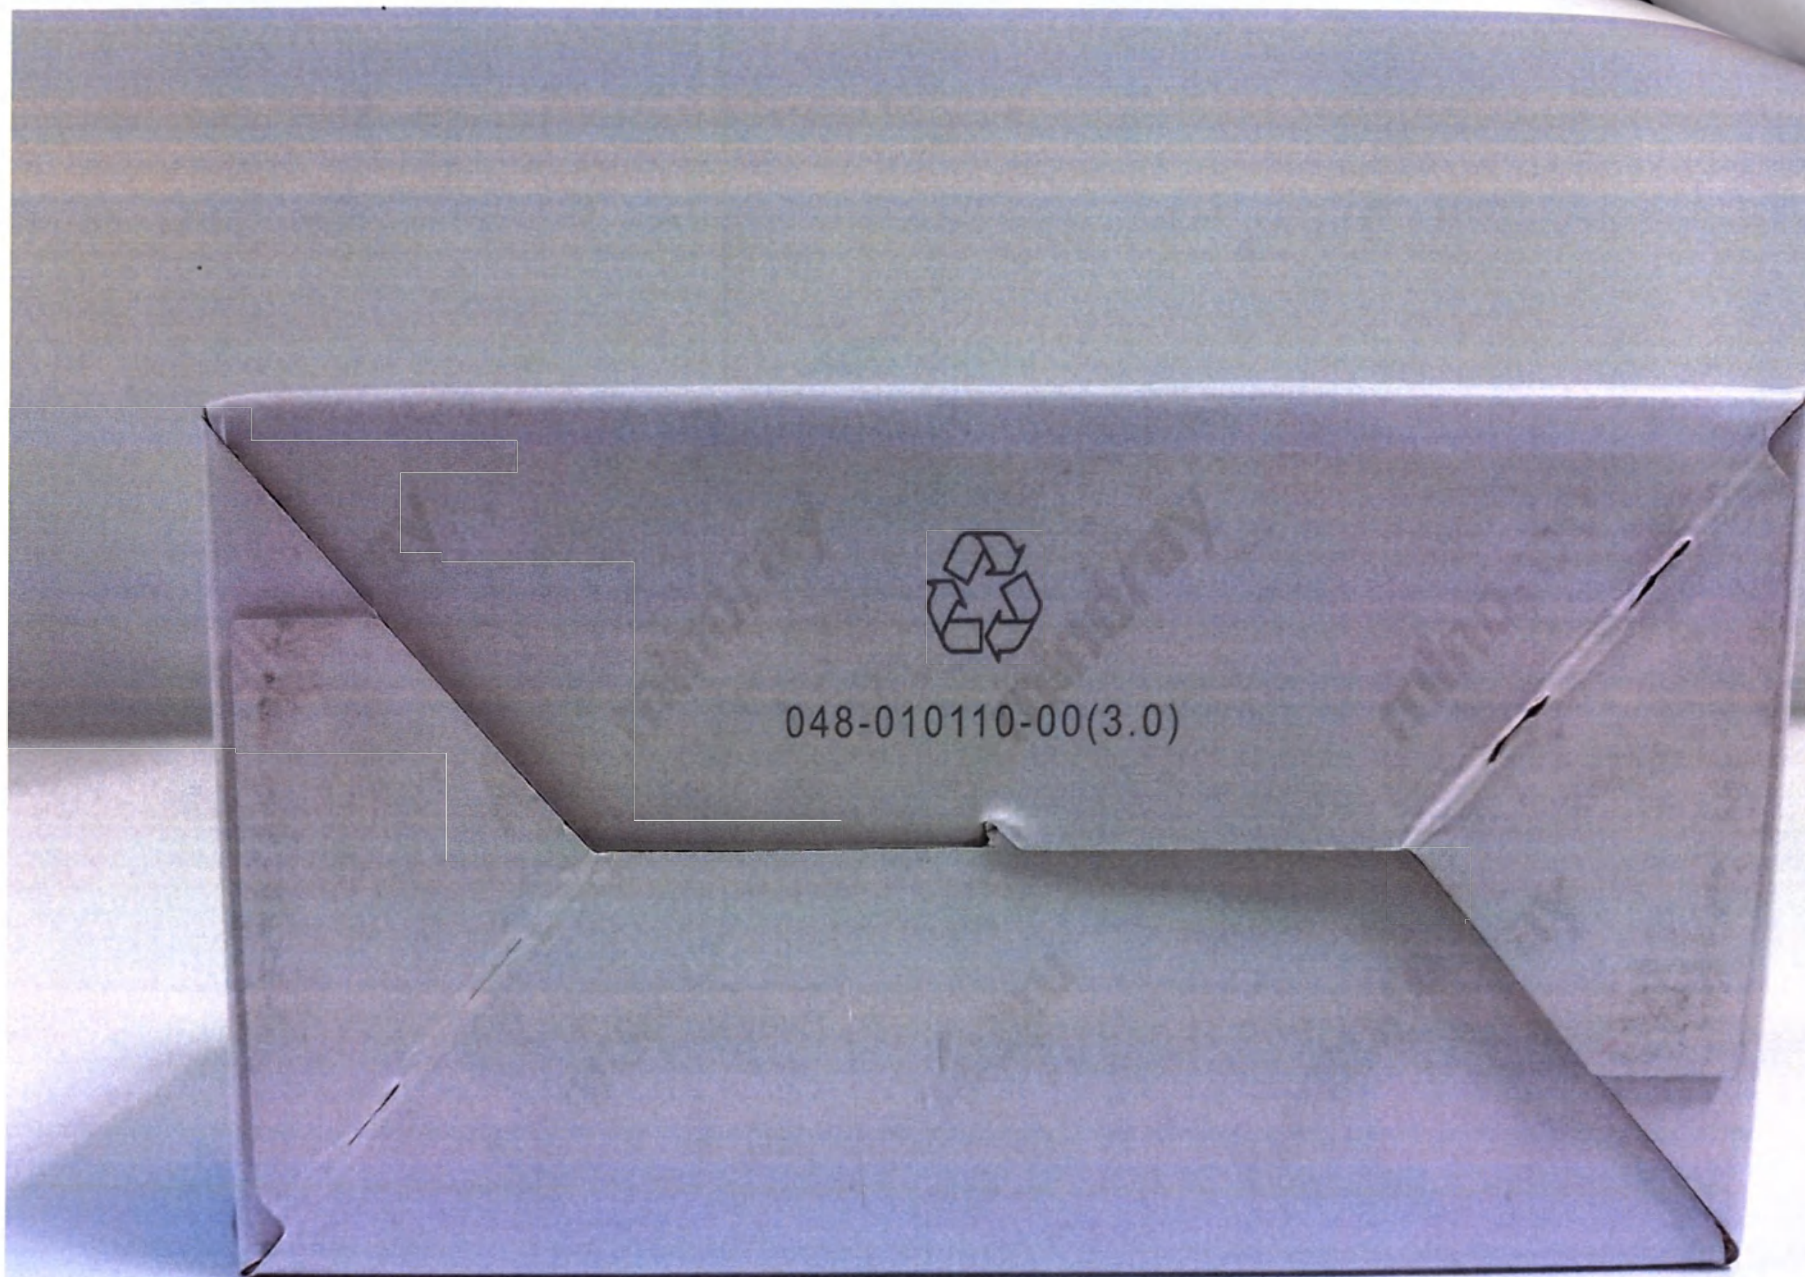


Рисунок 13. Внешняя упаковка Разбавитель проб (AF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 20 мл (вид 5)



Рисунок 14. Кассеты Разбавитель проб (AF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 20 мл



Рисунок 15. Кассета Разбавитель проб (AF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 20 мл (вид 1)



Рисунок 16. Кассета Разбавитель проб (AF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 20 мл (вид 2)

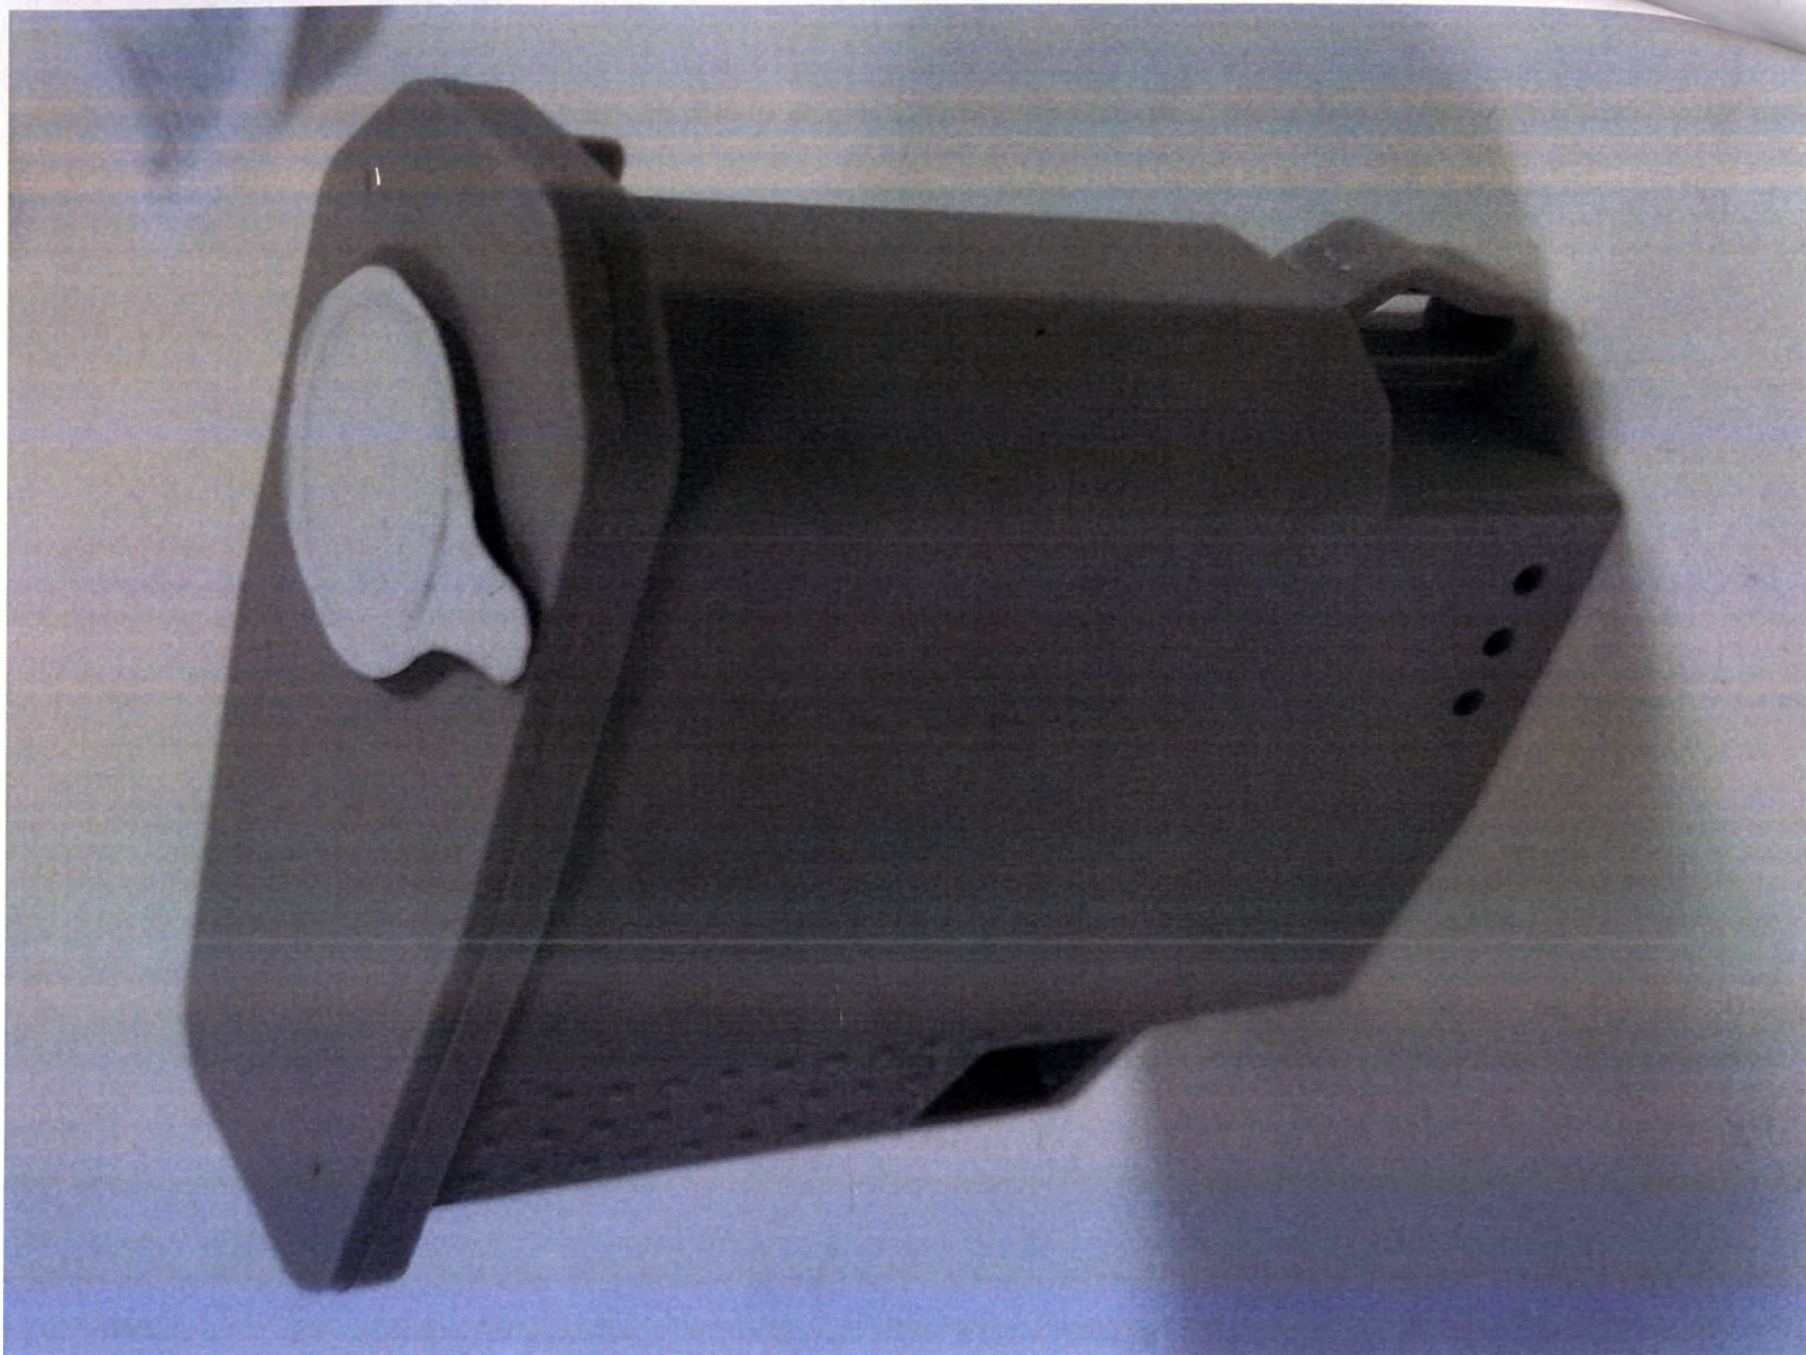


Рисунок 17. Кассета Разбавитель проб (AF-15) для анализаторов серии CX для диагностики in vitro, 4 кассеты x 20 мл (вид 3)

ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ



ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СЫСОЕВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ