



ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Сюн Вэй.
2023 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СЫСоева Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований
(Coag Con) в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для
диагностики in vitro

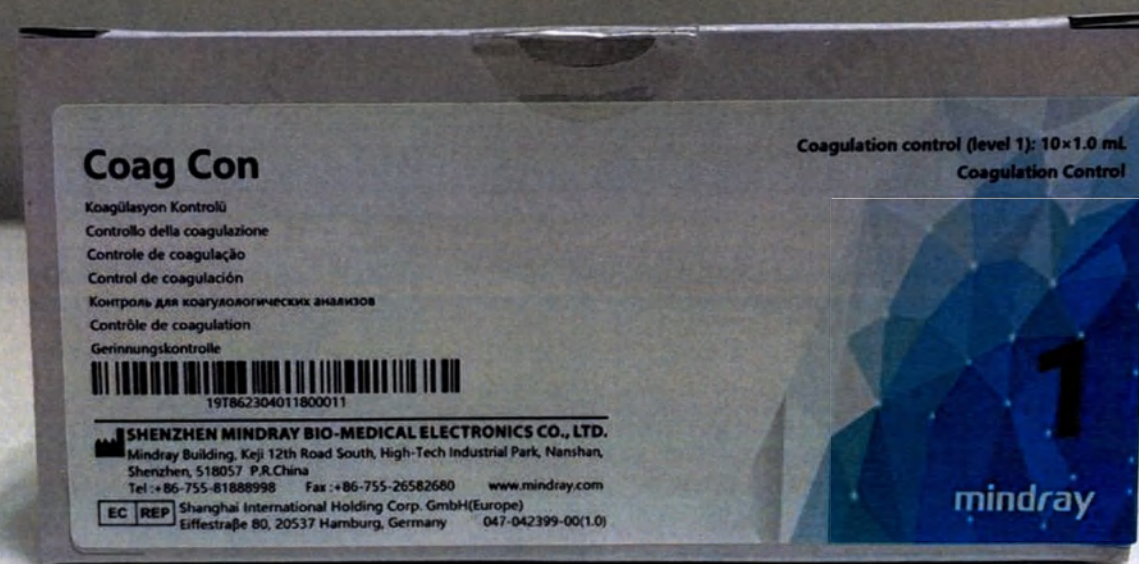


Рисунок 1 Внешняя упаковка Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 1) – 10 фл. х 1,0 мл (вид 1)



Рисунок 2 Внешняя упаковка Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 1) – 10 фл. х 1,0 мл (вид 2)



Рисунок 3 Внешняя упаковка Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 1) – 10 фл. x 1,0 мл (вид 3)



Рисунок 4 Внешняя упаковка Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 1) – 10 фл. х 1,0 мл (вид 4)

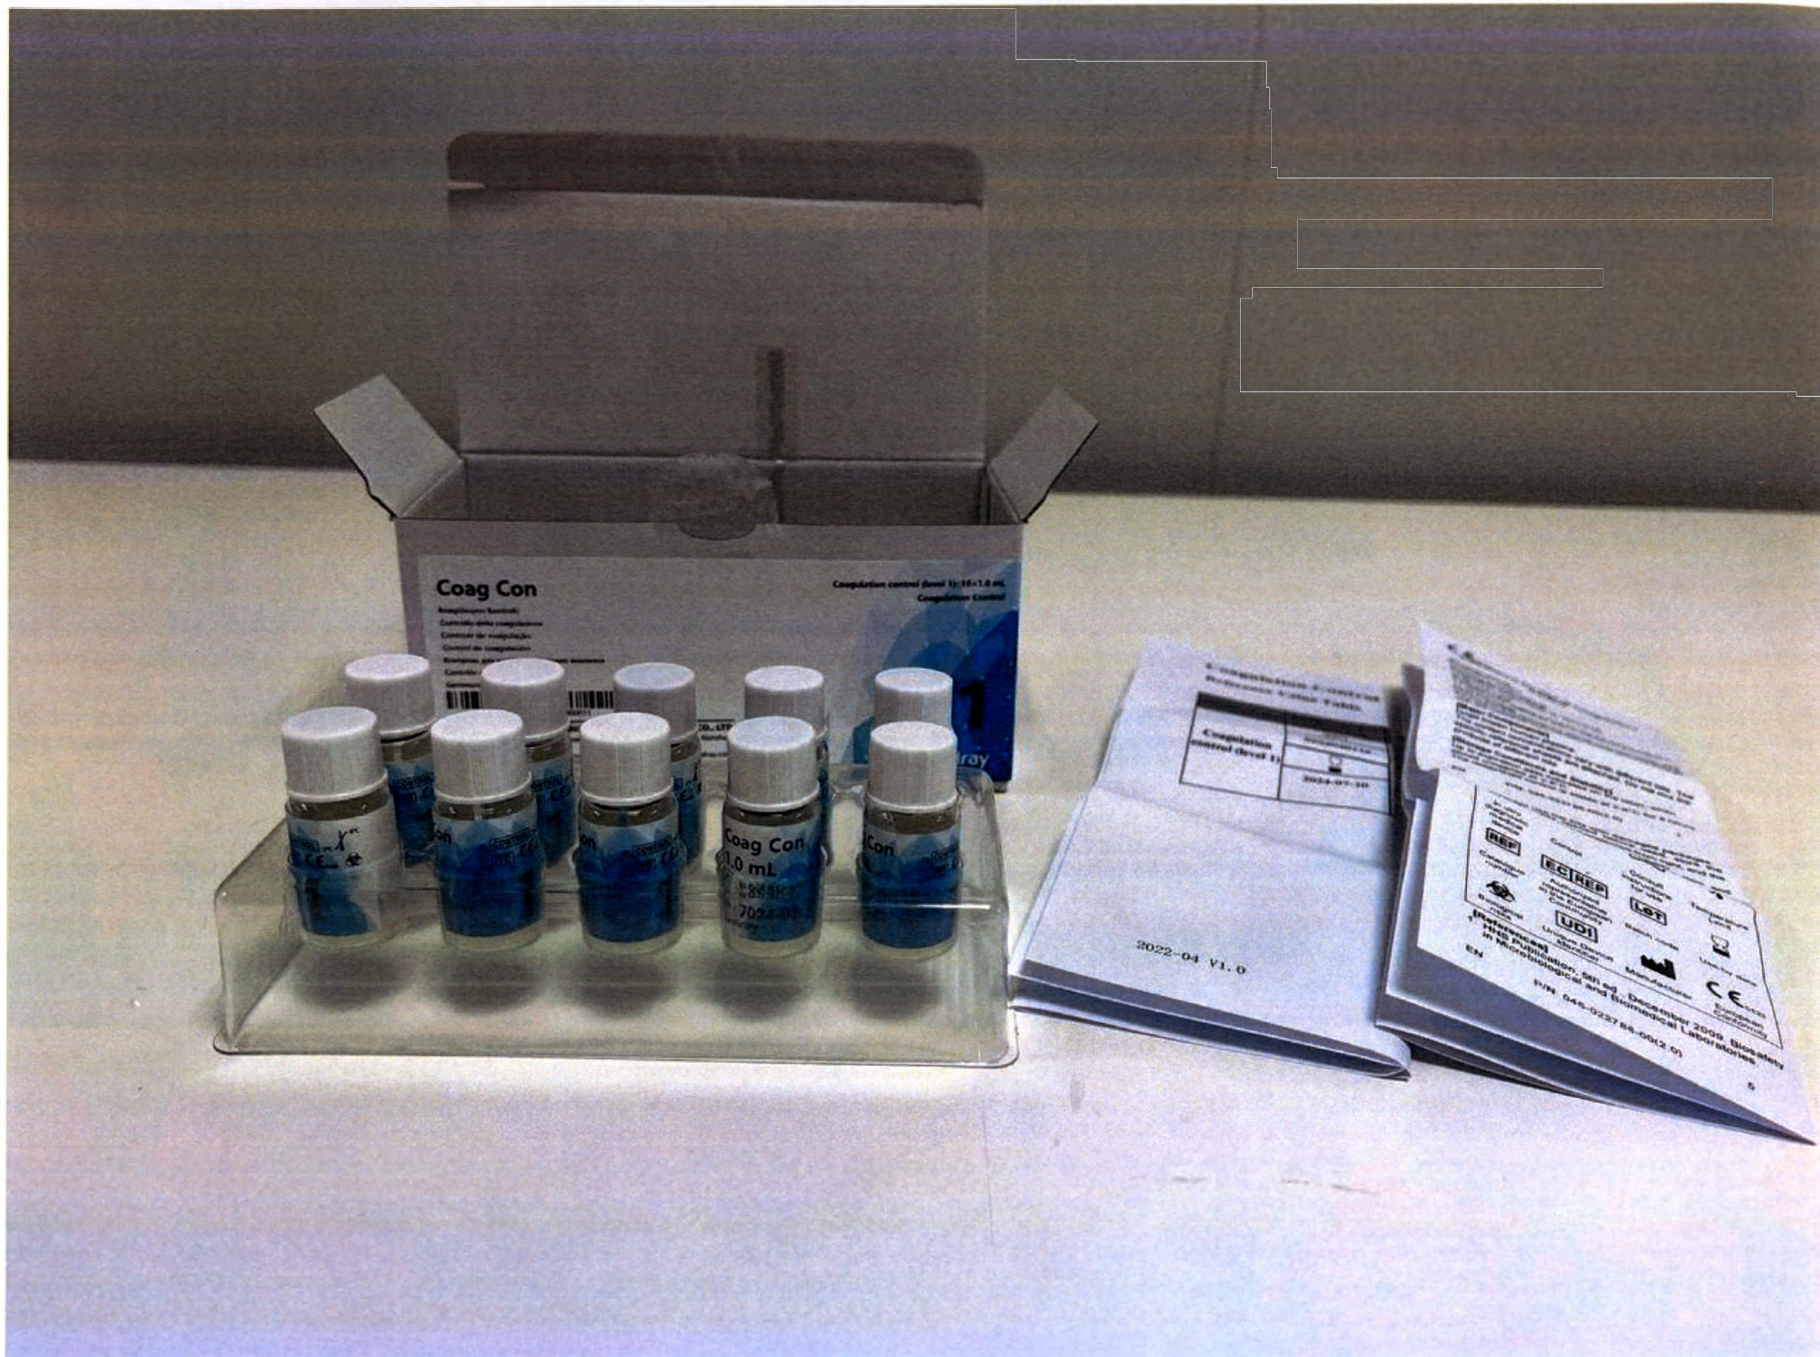


Рисунок 5 Общий вид Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики *in vitro* (уровень 1) – 10 фл. х 1,0 мл



Рисунок 6 Общий вид Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) (уровень 1) – 10 фл. х 1,0 мл (вид 1)



Рисунок 7 Общий вид Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) (уровень 1) – 10 фл. х 1,0 мл (вид 2)

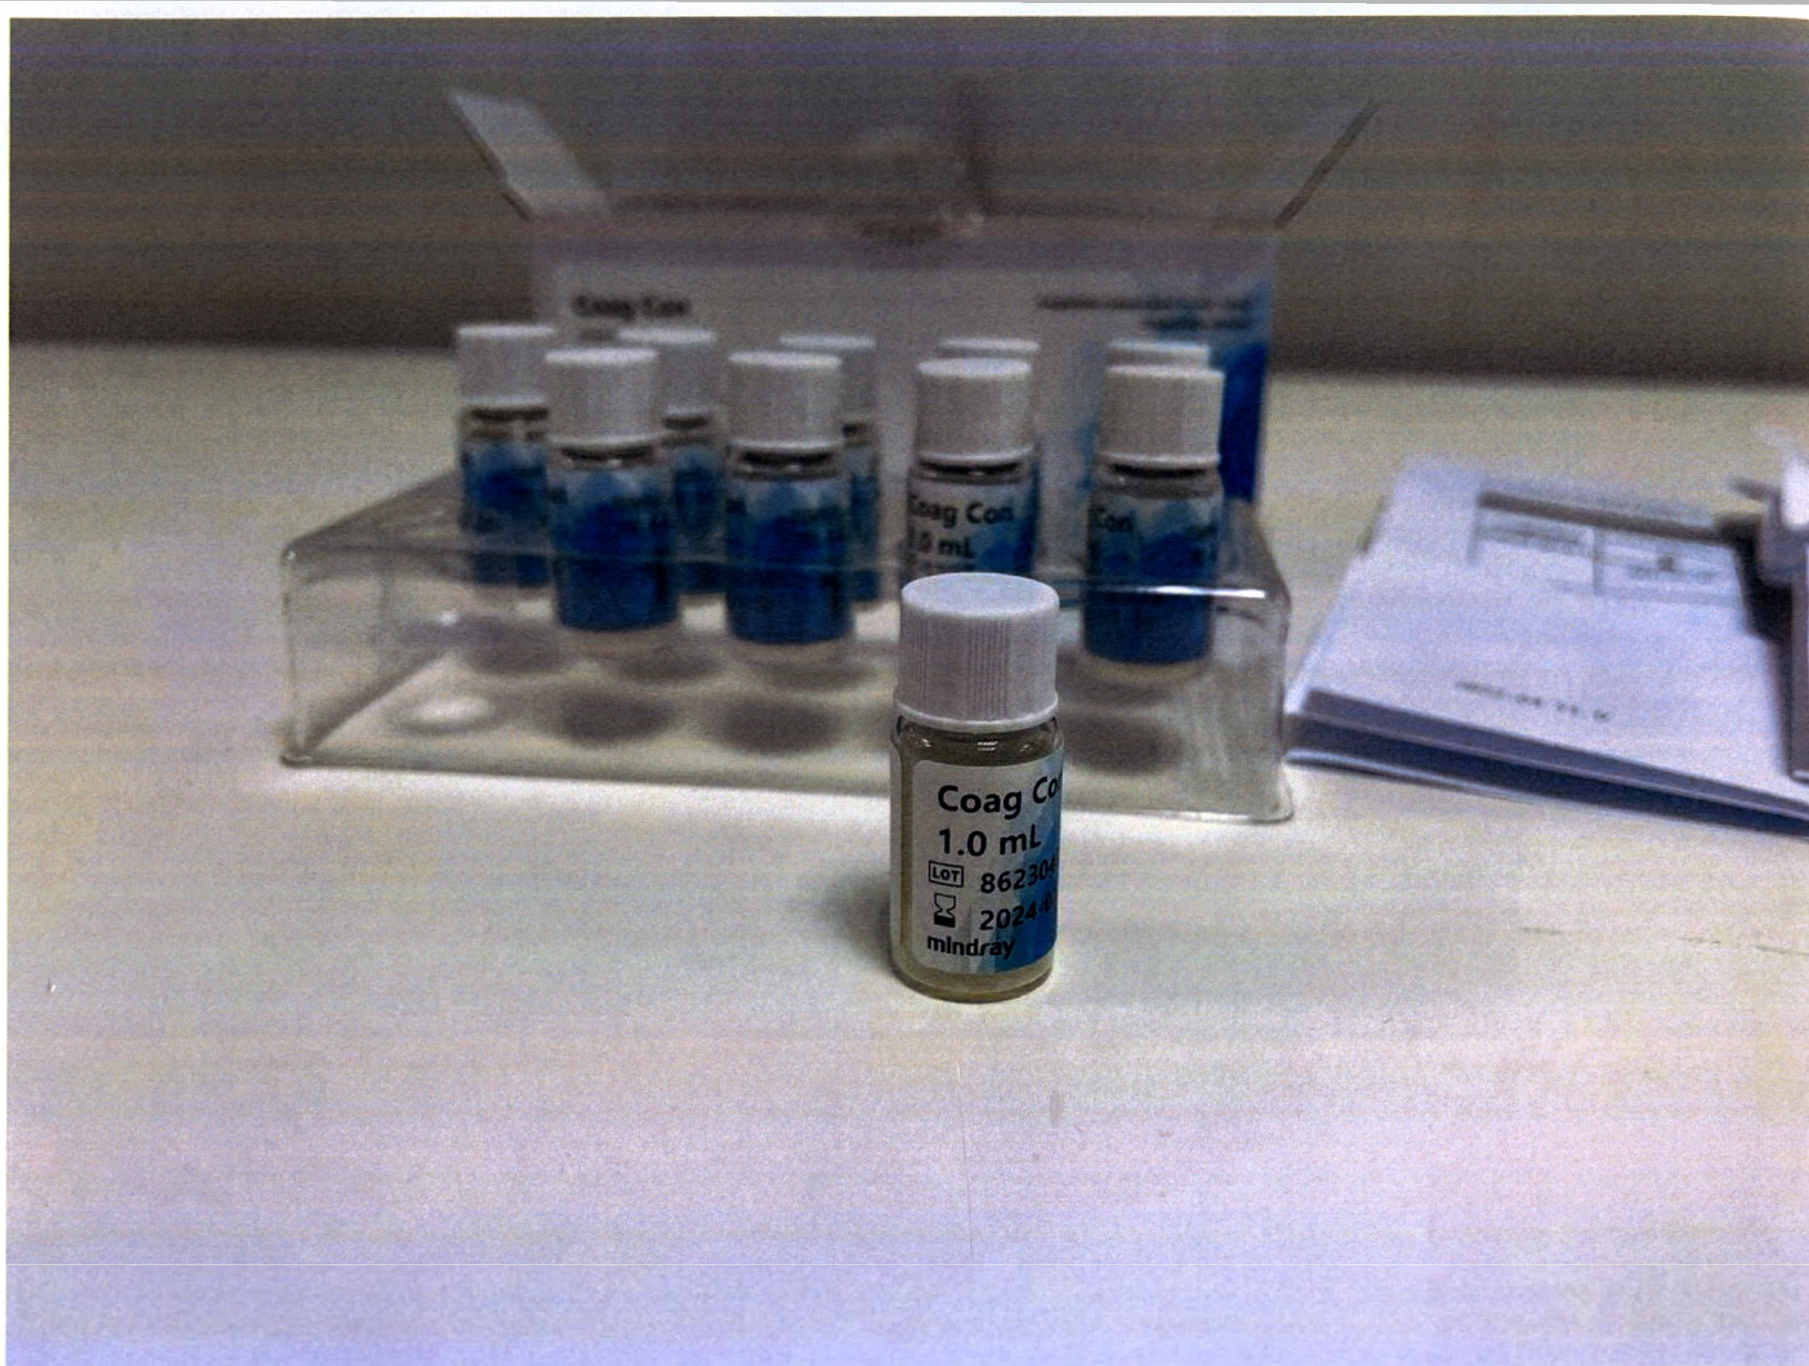


Рисунок 8 Общий вид Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) (уровень 1) – 10 фл. х 1,0 мл (вид 3)

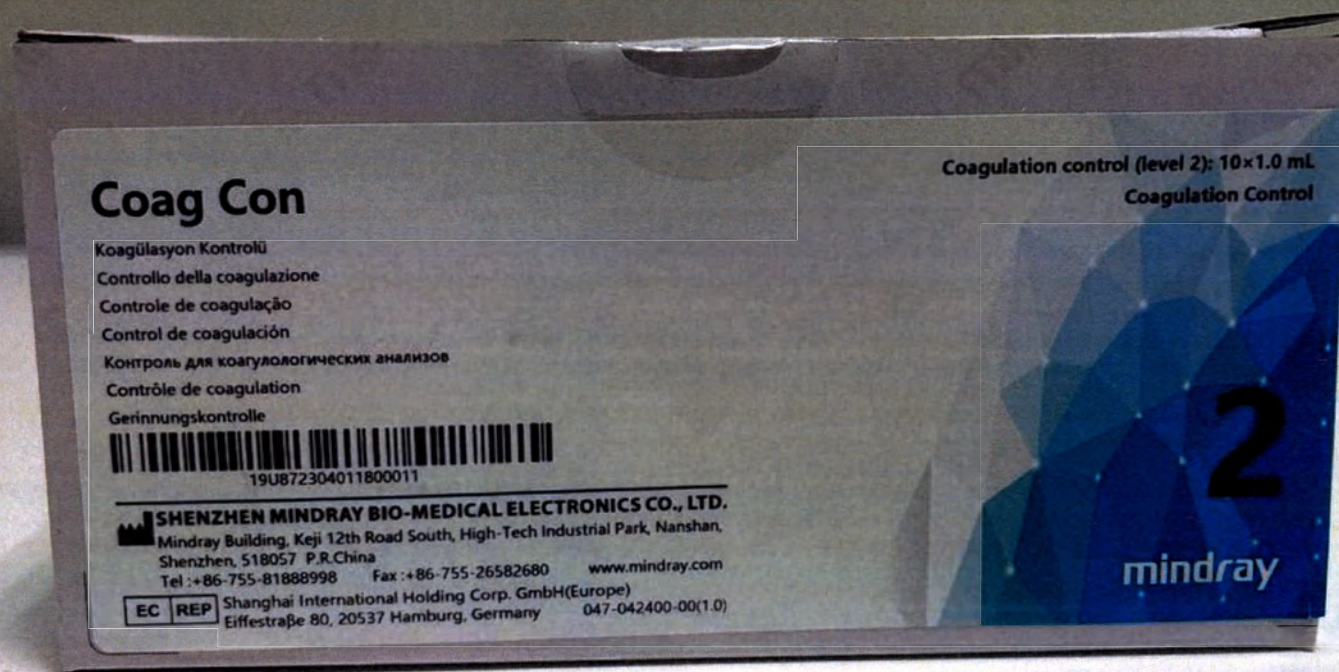


Рисунок 9 Внешняя упаковка Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 2) – 10 фл. х 1,0 мл (вид 1)



Рисунок 10 Внешняя упаковка Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 2) – 10 фл. х 1,0 мл (вид 2)



Рисунок 11 Внешняя упаковка Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) в клиническом образце человека на анализаторах серии СХ для диагностики in vitro (уровень 2) – 10 фл. х 1,0 мл (вид 3)



Рисунок 12 Общий вид Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) (уровень 2) – 10 фл. х 1,0 мл (вид 1)

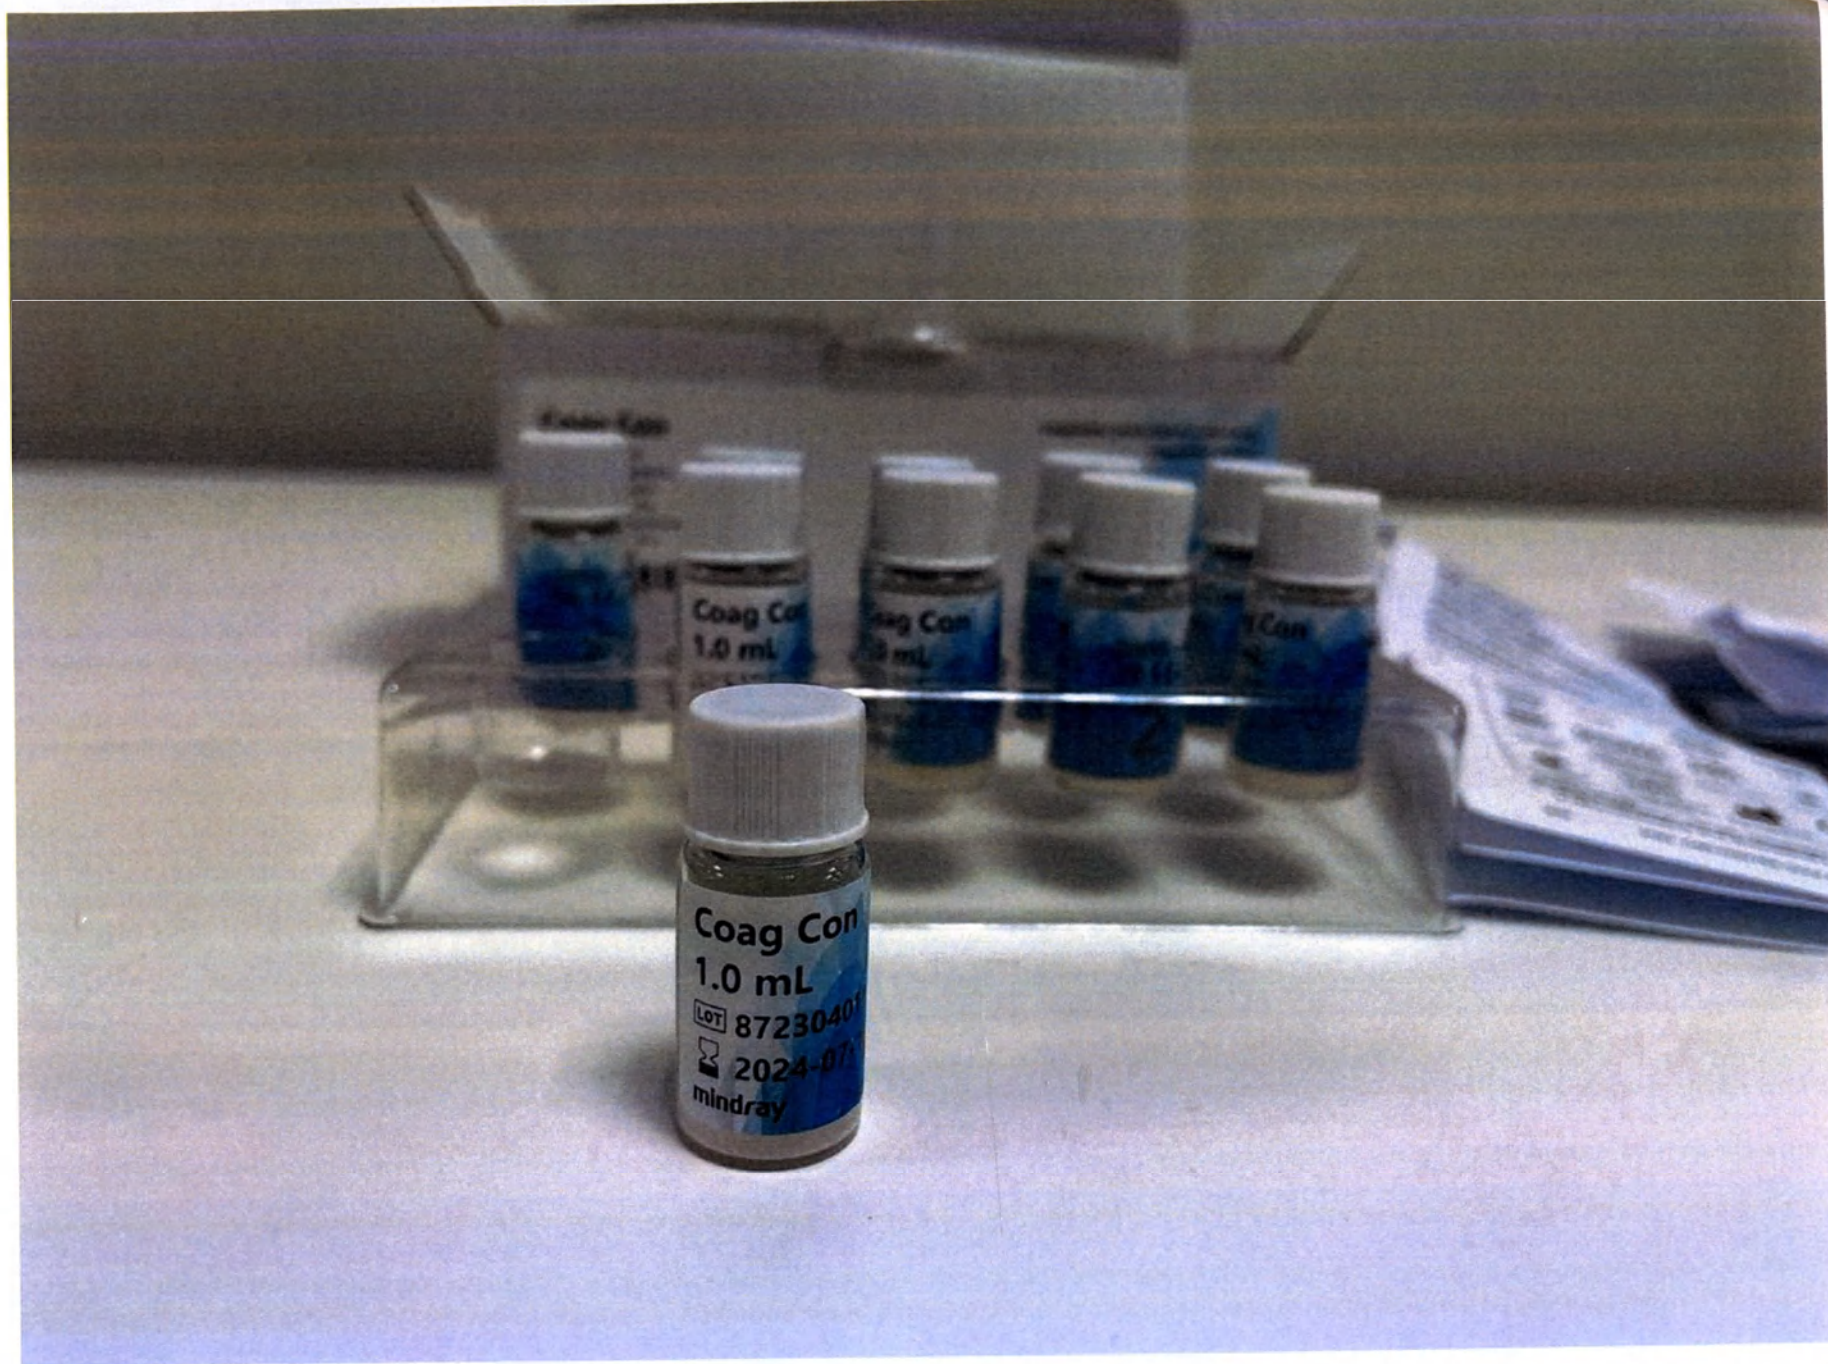


Рисунок 13 Общий вид Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) (уровень 2) – 10 фл. х 1,0 мл (вид 2)

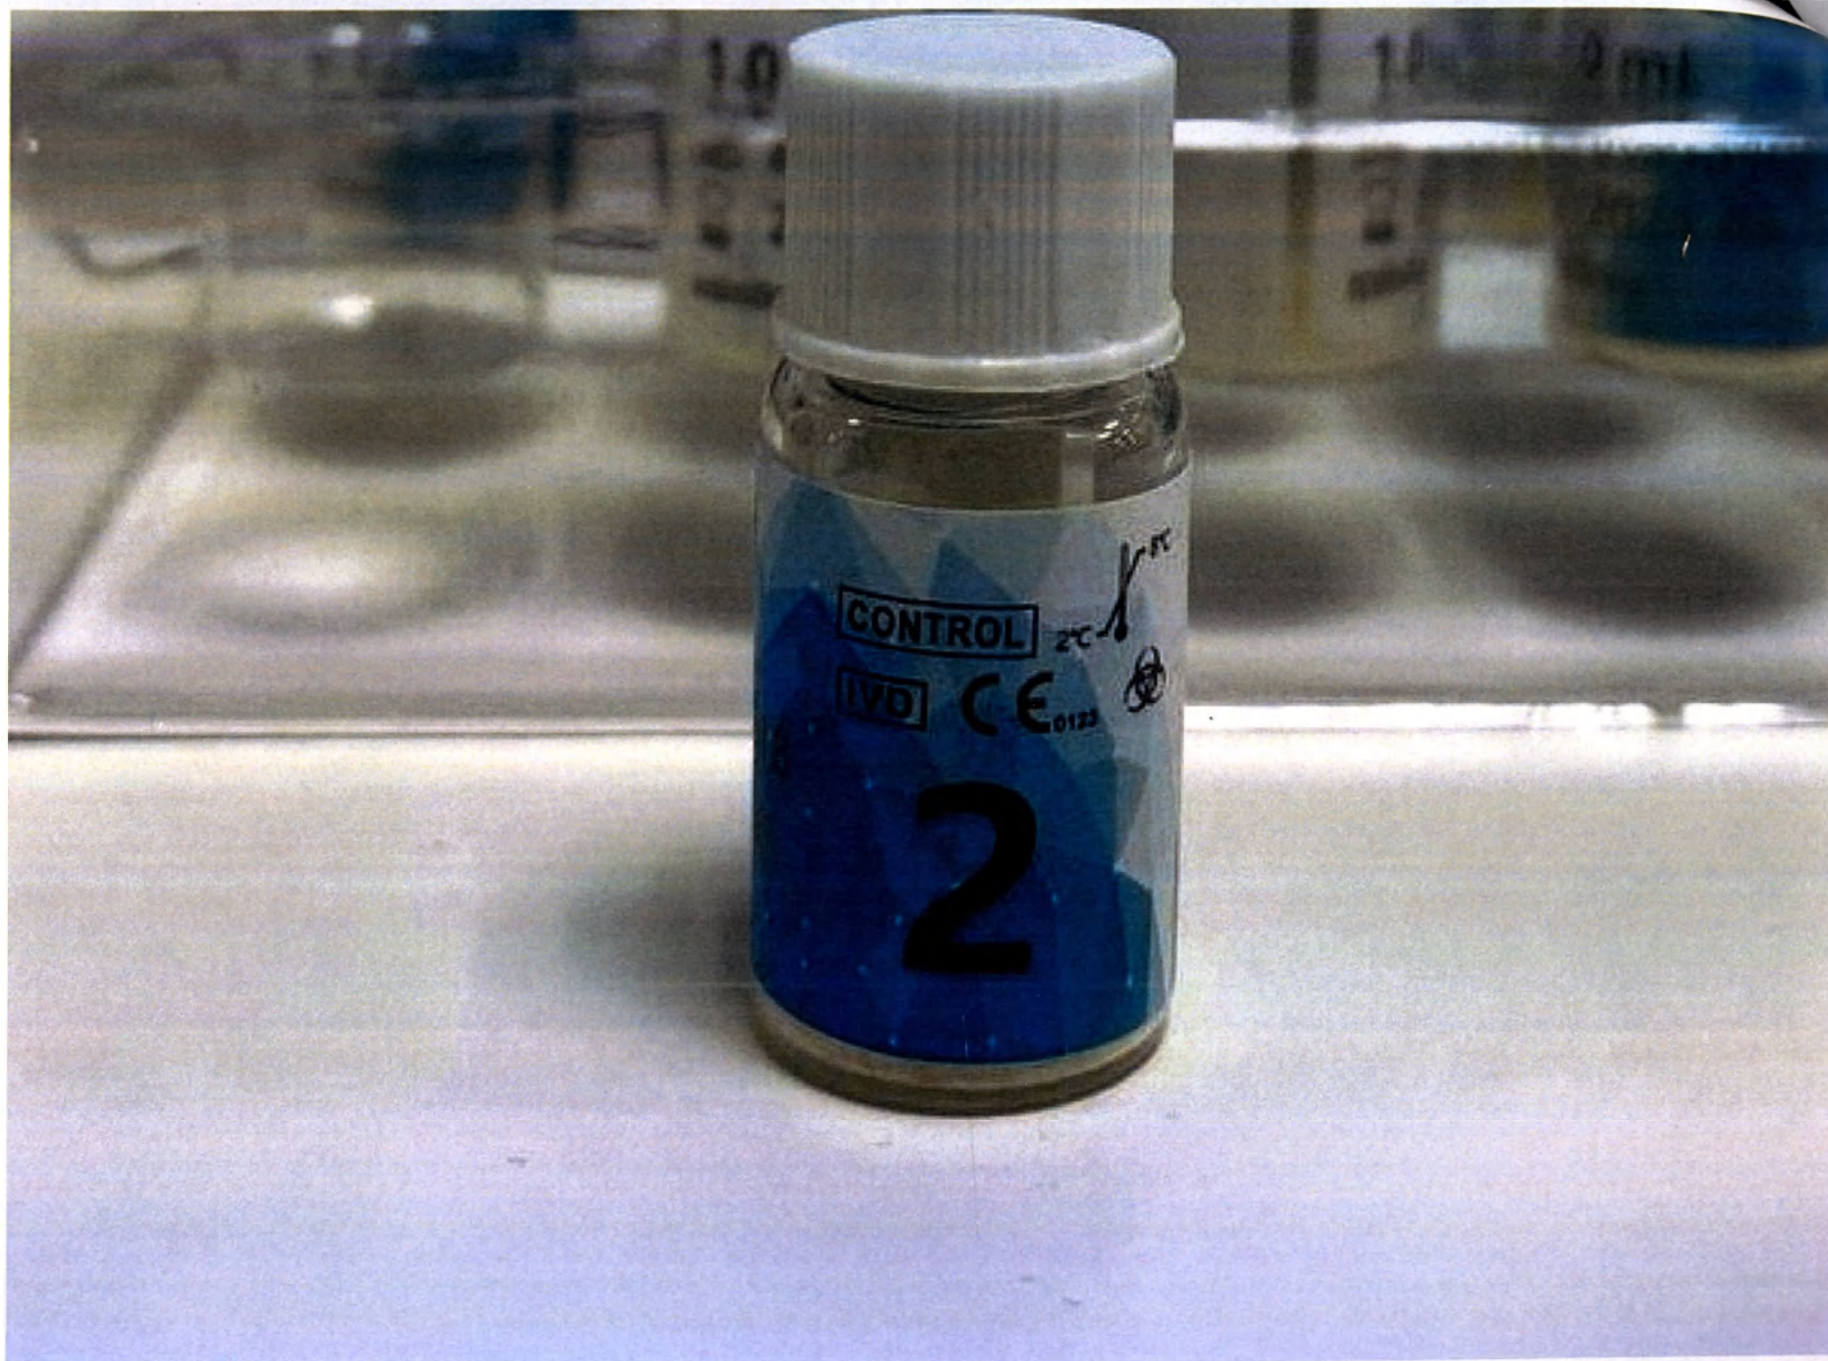


Рисунок 14 Общий вид Материал контрольный для оценки качества коагулологических исследований (Coag Con) (уровень 2) – 10 фл. х 1,0 мл (вид 3)

ПРОШЕТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
ВЛИСТ



ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СЫСОВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ