

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«09» февраля 2024 г.

М.П.




Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ТГ» для количественного определения тиреоглобулина (ТГ, Тg) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-234-65614693-2022»

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.)



Пароизоляционные крышки

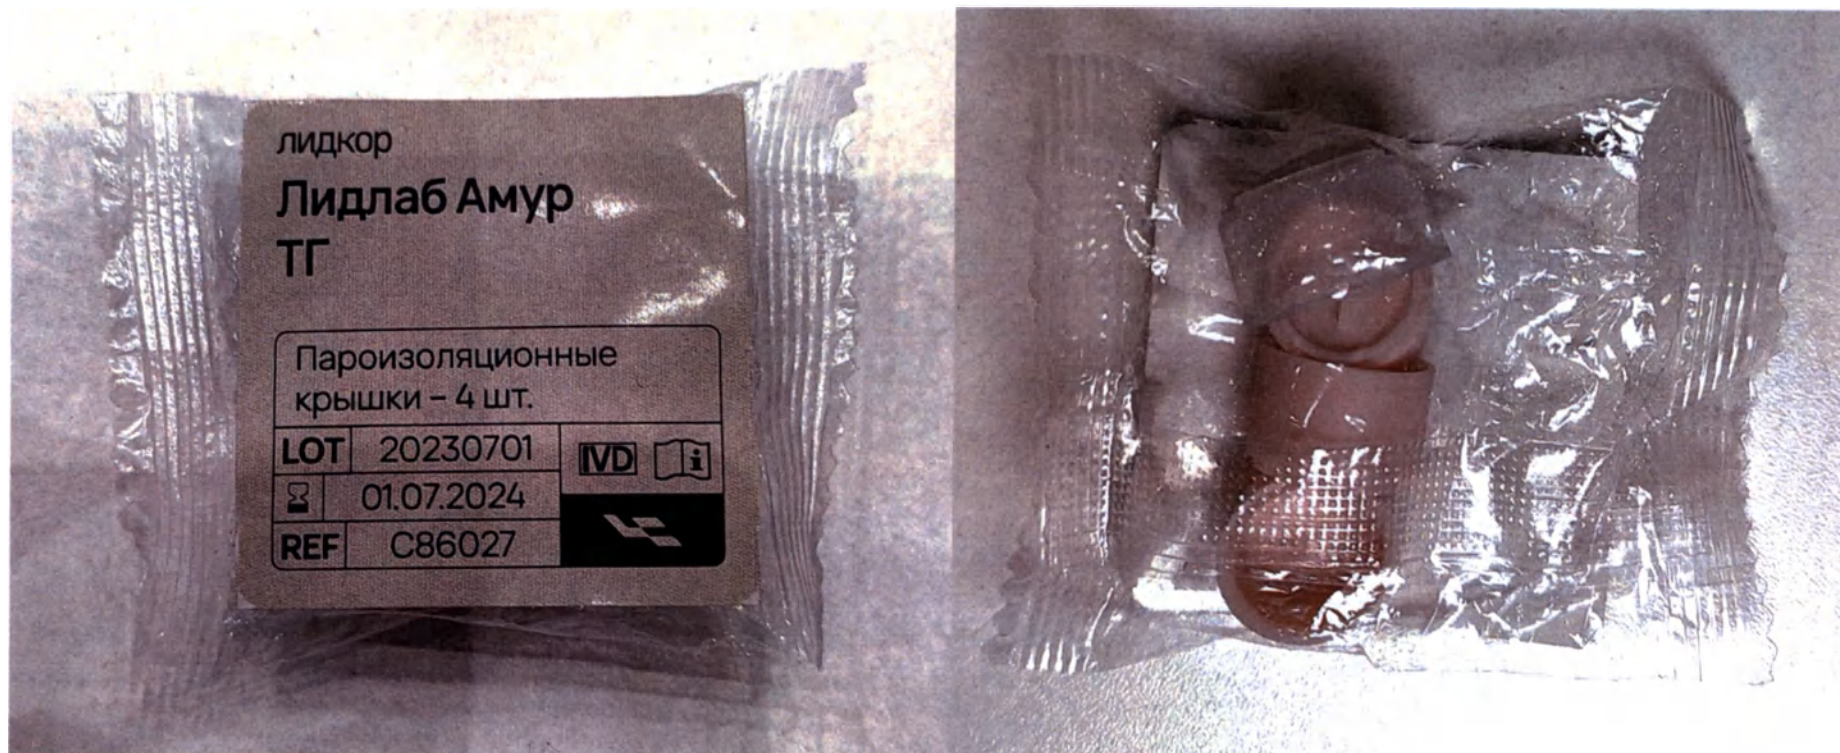

Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон



Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон



Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон





Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)



ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТГ» для
количественного определения тиреоглобулина
(ТГ, Tg) в сыворотке и плазме крови человека
методом иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-234-65614693-
2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, За

Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)

лидлаб






**Лидлаб Амур
ТГ**

Набор реагентов на 200 тестов

YNLO


Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 18 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C86027
-----	----------	------------	-----	--------


Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)

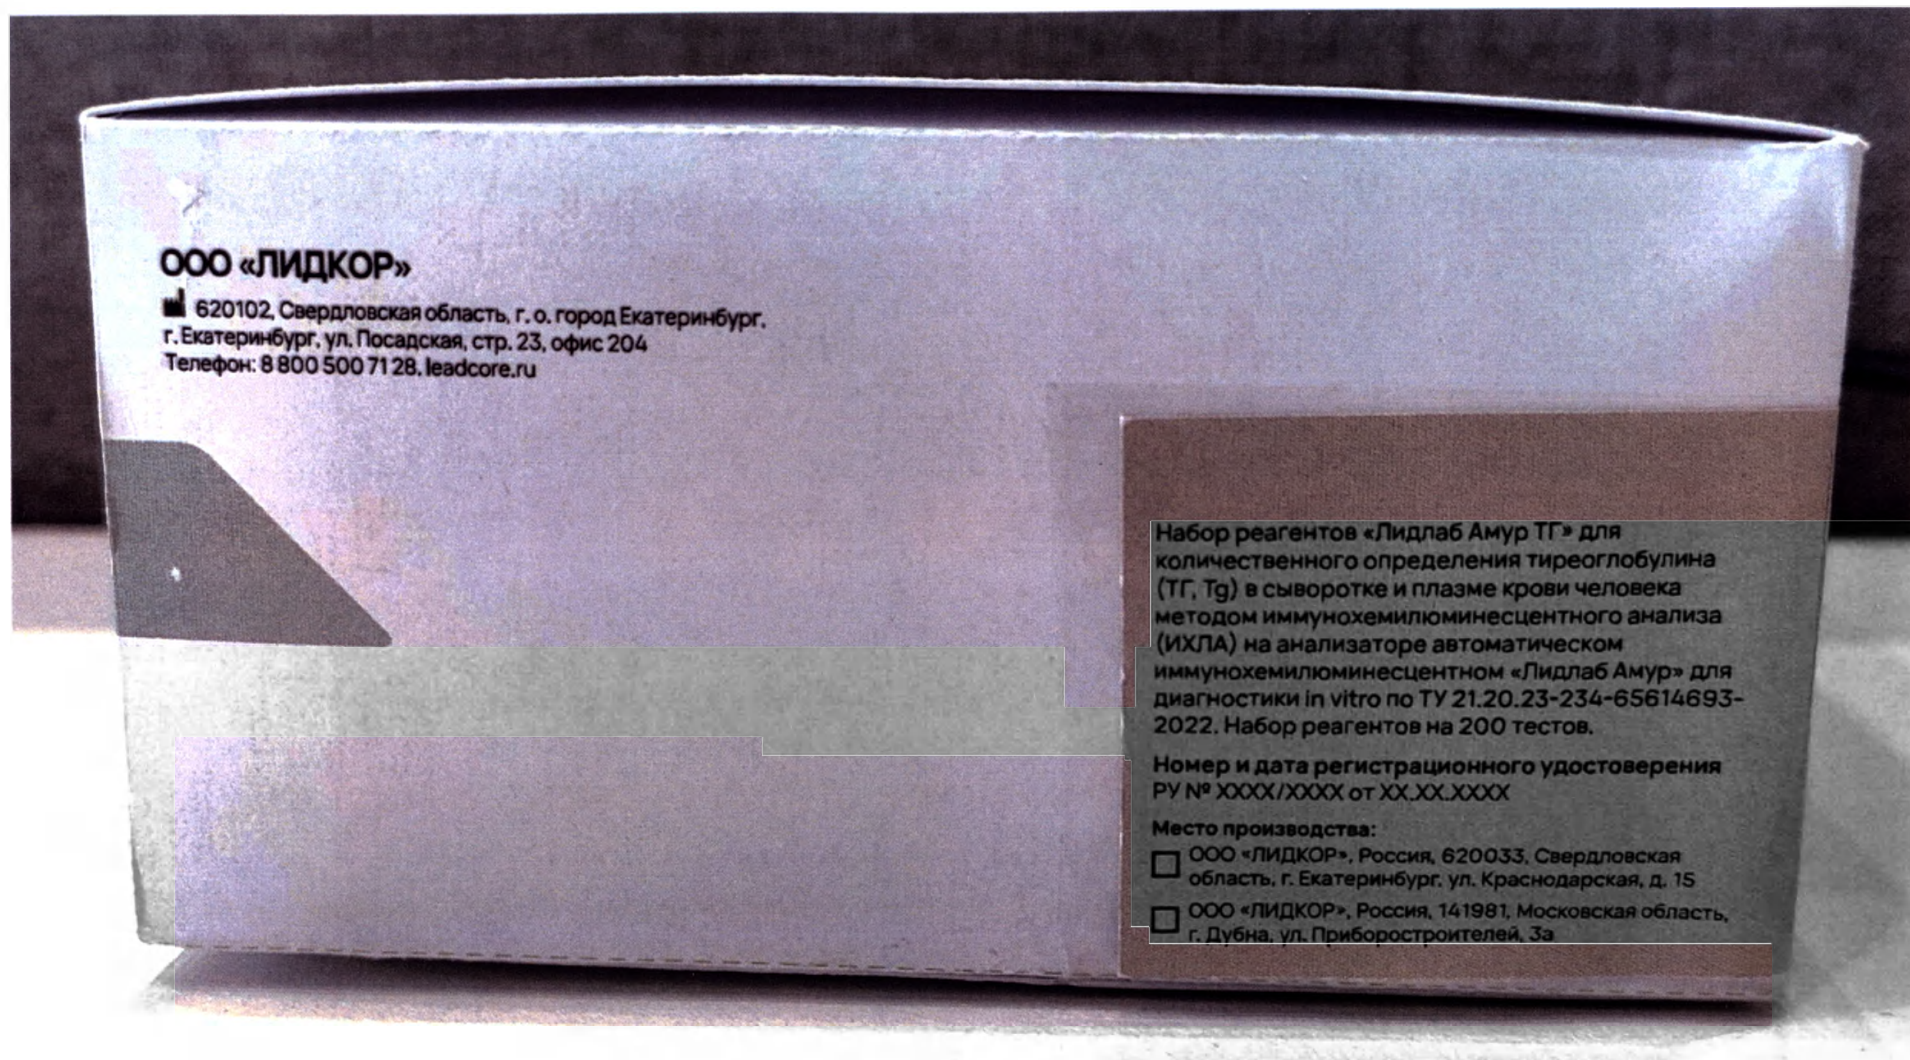


Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)

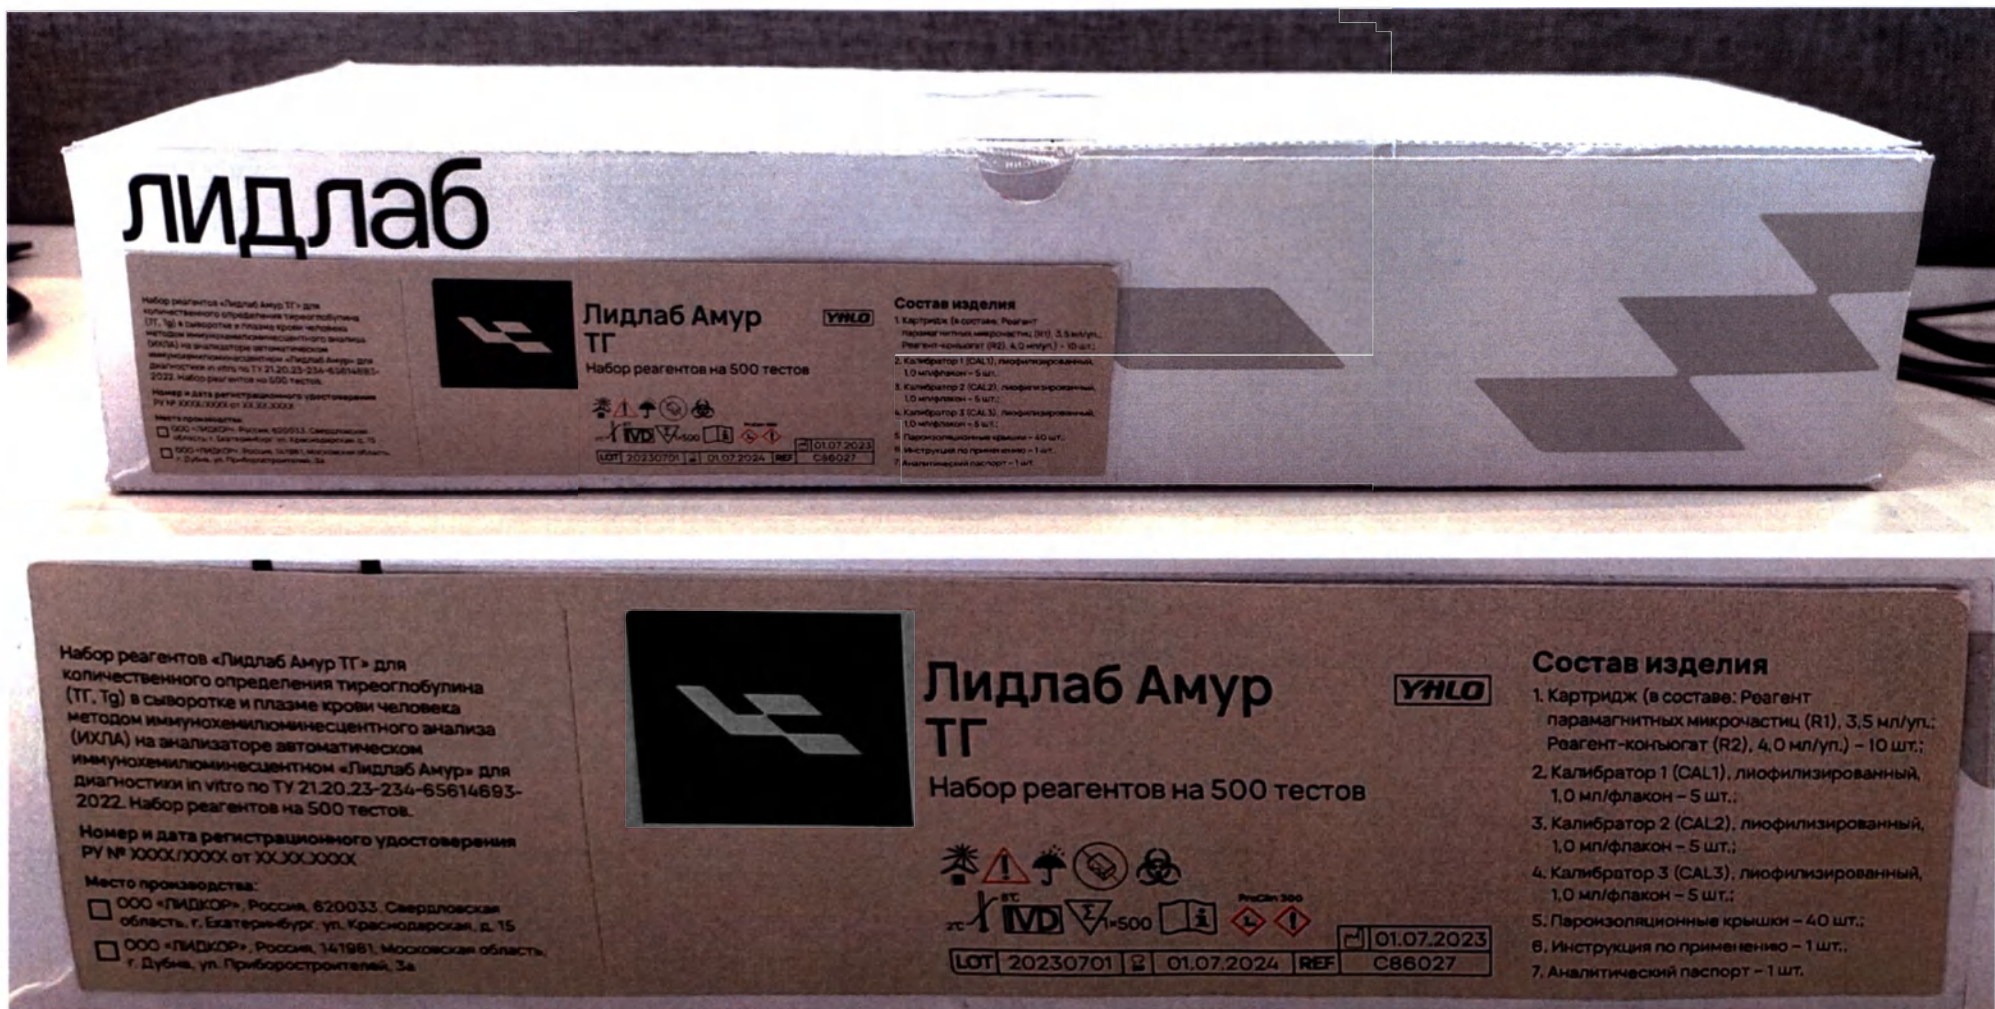

Потребительская упаковка 500 тестов (вид спереди)

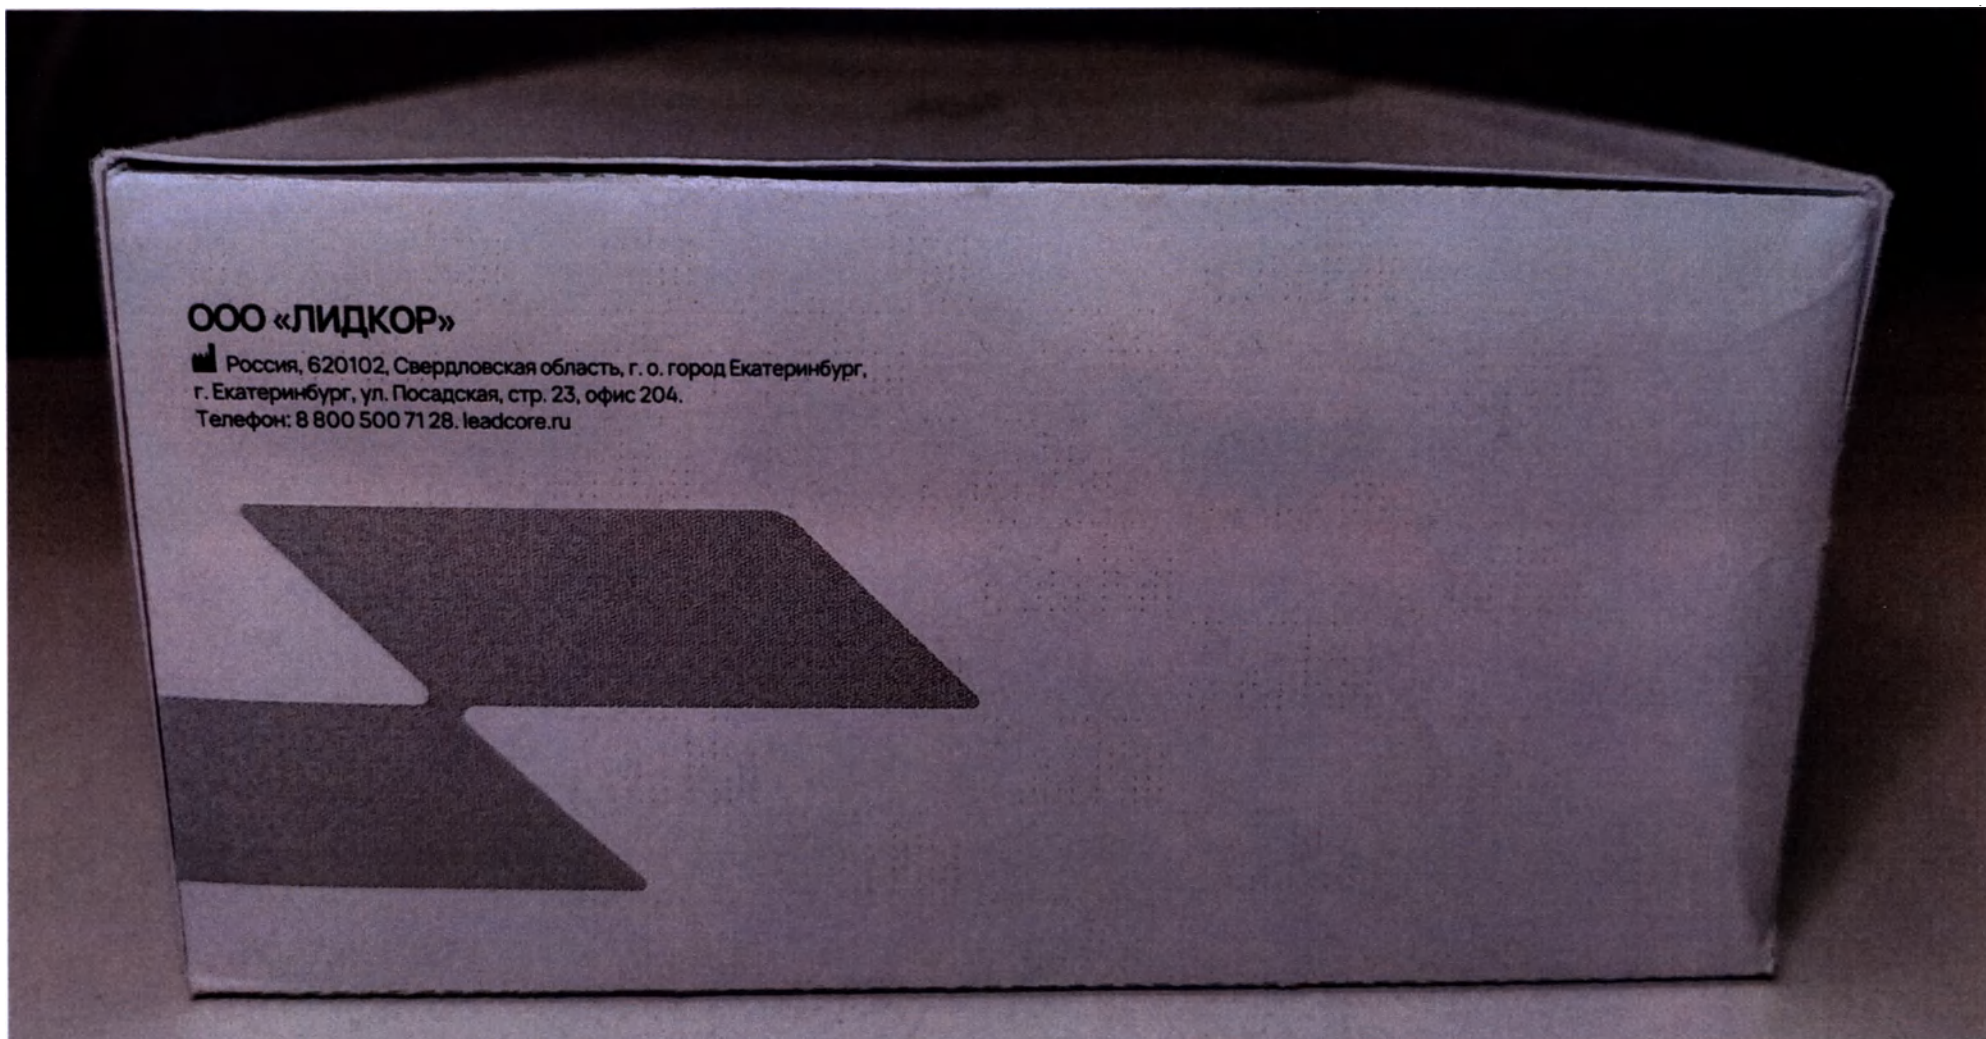

Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)

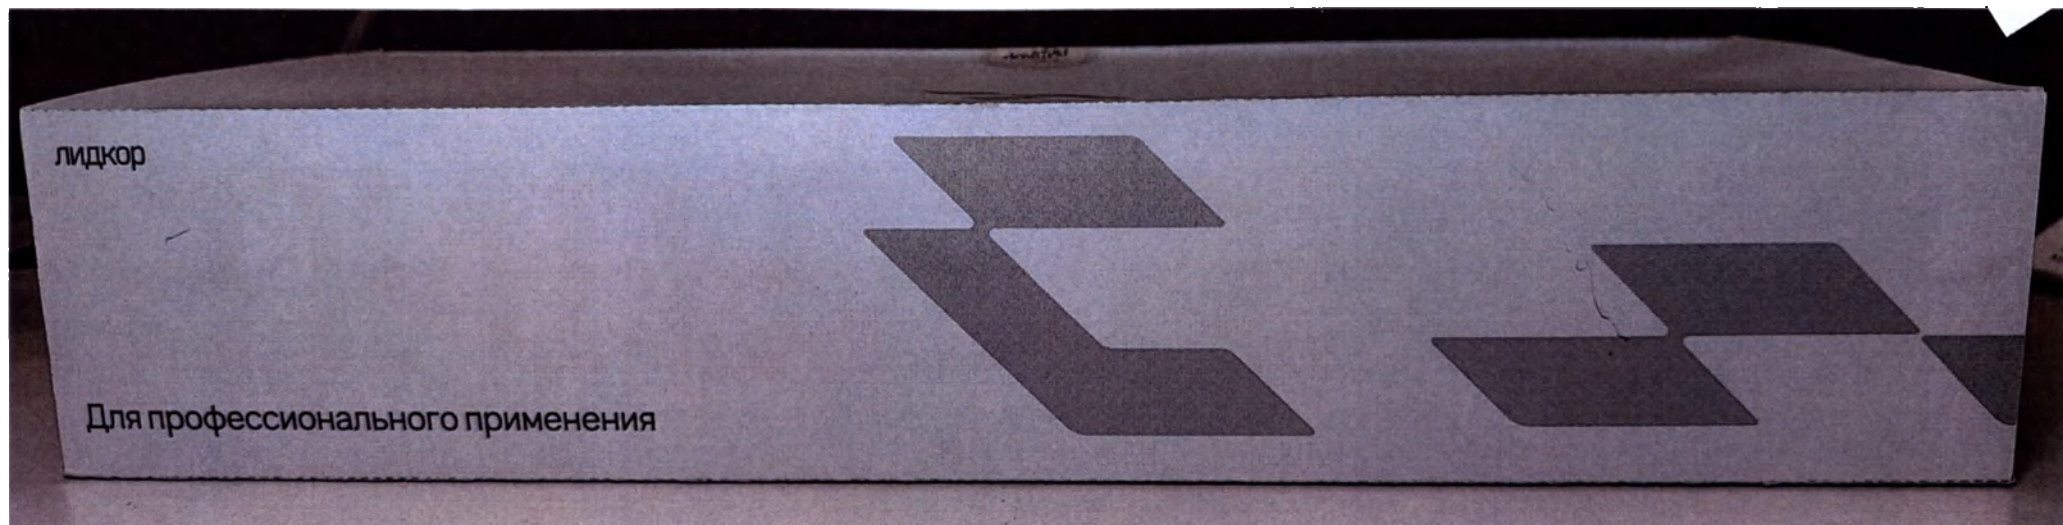

Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)

лидлаб



Набор реагентов «Лидлаб Амур ТГ» для количественного определения тиреоглобулина (ТГ, Тg) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилюминесцентного «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-234-85614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX.XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красnodарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



**Лидлаб Амур
ТГ**
Набор реагентов на 1000 тестов



LOT 20230701 01.07.2024 REF C86027

YHLO

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамгнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
5. Паронизационные крышки – 80 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТГ» для количественного определения тиреоглобулина (ТГ, Тg) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилюминесцентного «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-234-85614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.


Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX.XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красnodарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



**Лидлаб Амур
ТГ**
Набор реагентов на 1000 тестов



LOT 20230701 01.07.2024 REF C86027

YHLO


Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамгнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
5. Паронизационные крышки – 80 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Потребительская упаковка 1000 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)

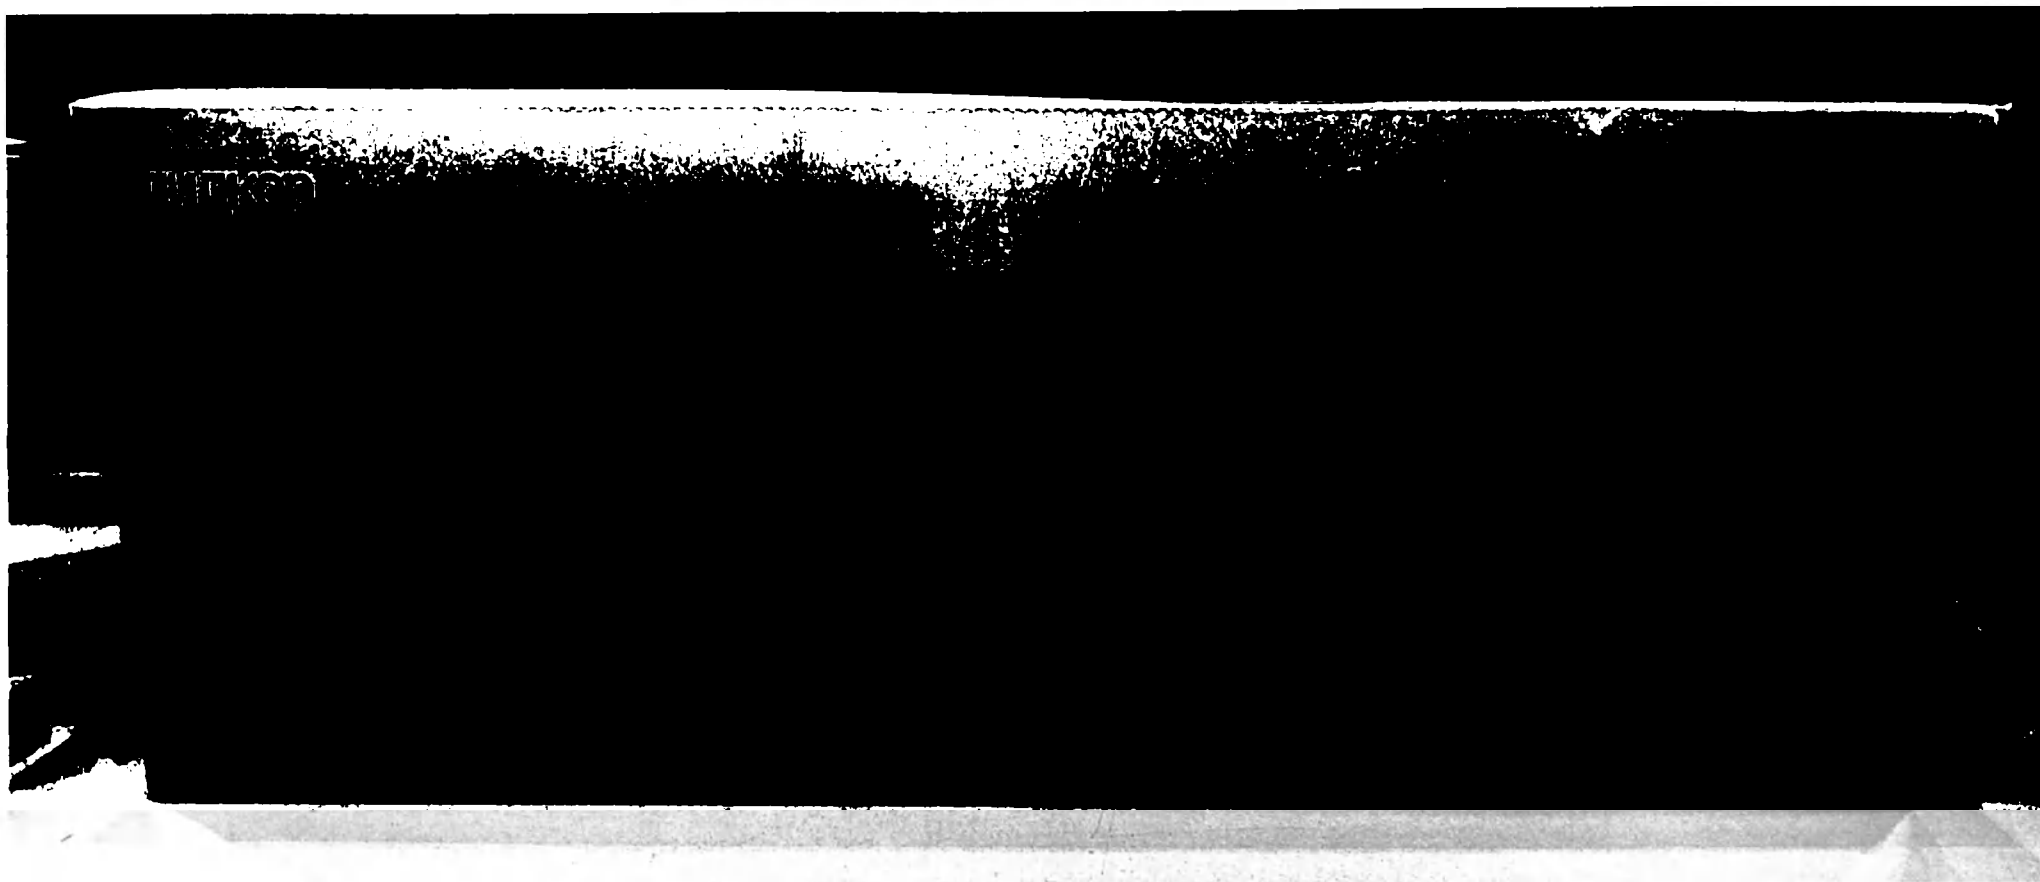

Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)



Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.

Групповое фото.



Транспортная упаковка







Набор реагентов «Лидлаб Амур ТГ» для количественного определения тиреоглобулина (ТГ, Tg) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-234-65614693-2022



Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023	
LOT	20230701	01.07.2024	REF C86027



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

24 (двадцать четыре) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут


«01» июля 2023 г.




МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ТГ» для количественного определения тиреоглобулина (ТГ, Tg) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-234-65614693-2022»

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.;
Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.)

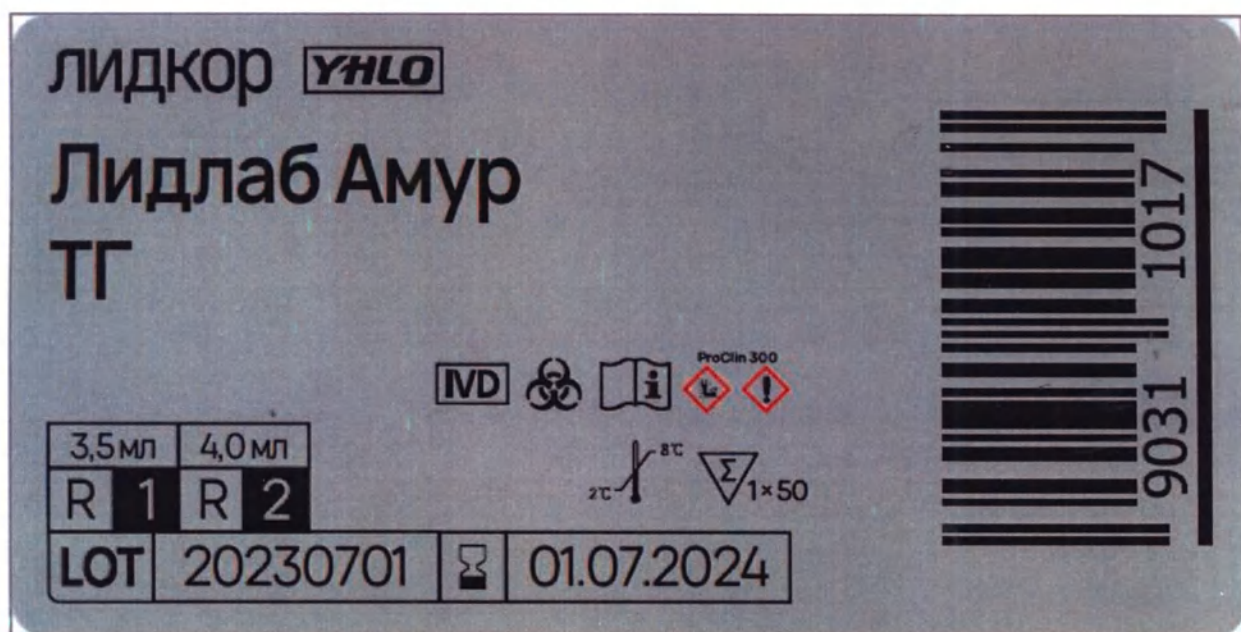

Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

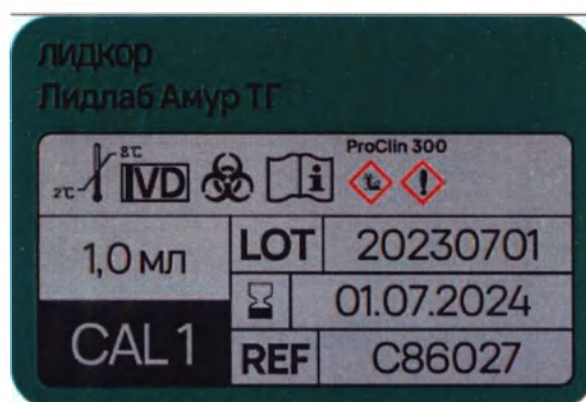


Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон




Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон



Пароизоляционные крышки

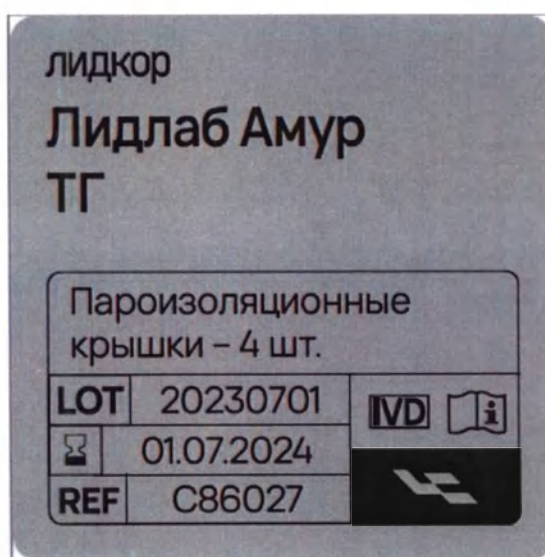

QR-code

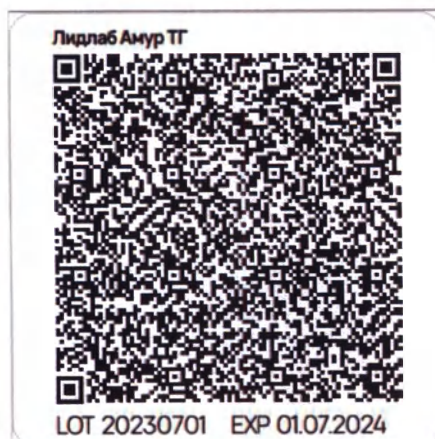

Наклейка



Потребительская упаковка

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТГ» для количественного определения тиреоглобулина (ТГ, Тg) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-234-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XXX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур ТГ

Набор реагентов на 100 тестов

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТГ» для количественного определения тиреоглобулина (ТГ, Тg) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-234-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XXX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур ТГ

Набор реагентов на 200 тестов

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТГ» для количественного определения тиреоглобулина (ТГ, Тg) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-234-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XXX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур ТГ

Набор реагентов на 500 тестов

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.) – 10 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТГ» для количественного определения тиреоглобулина (ТГ, Тg) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-234-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XXX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а


Лидлаб Амур ТГ

Набор реагентов на 1000 тестов


Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Потребительская коробка

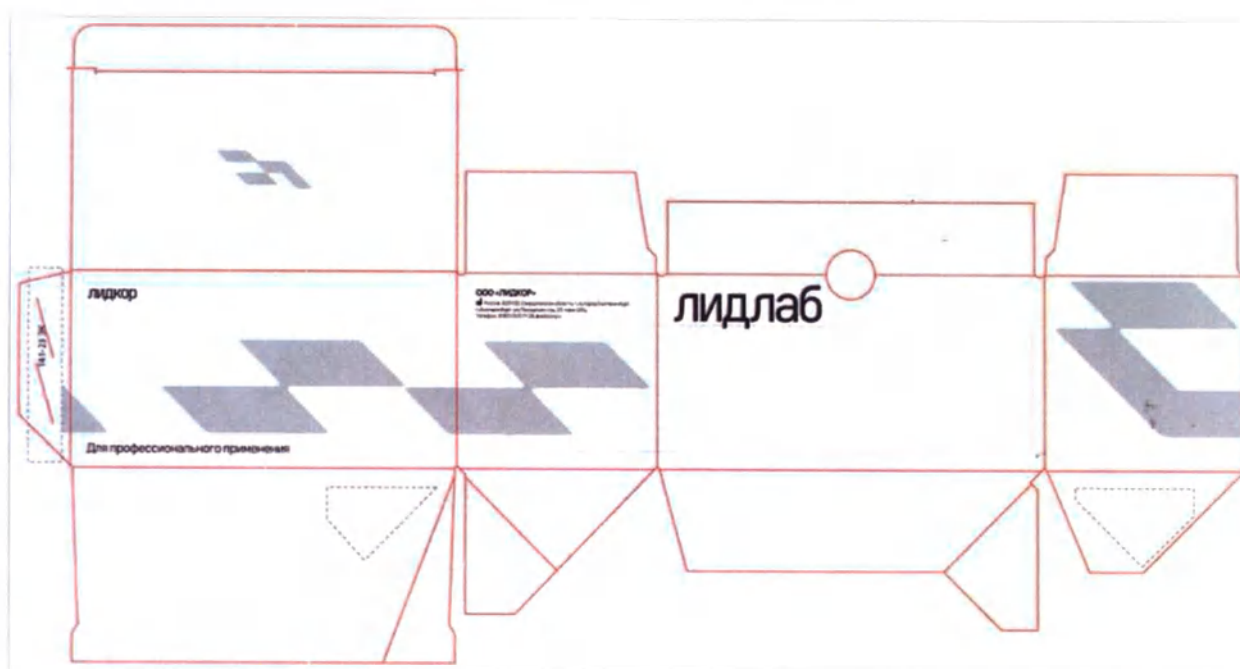

Транспортная упаковка

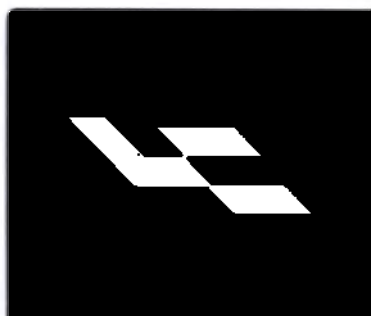

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТГ» для количественного определения тиреоглобулина (ТГ, Tg) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-234-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86027



Набор реагентов «Лидлаб Амур ТГ» для количественного определения тиреоглобулина (ТГ, Tg) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-234-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86027




Набор реагентов «Лидлаб Амур ТГ» для количественного определения тиреоглобулина (ТГ, Tg) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-234-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86027

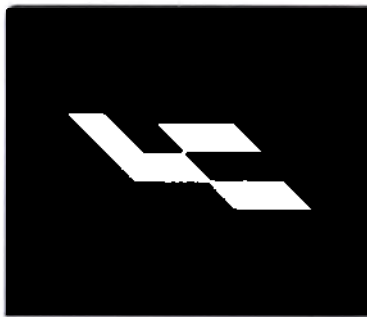

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТГ» для количественного определения тиреоглобулина (ТГ, Тg) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-234-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86027

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (семь) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

