

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут




2024 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ЛГ» для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ, LH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 223-65614693-2022»


2023

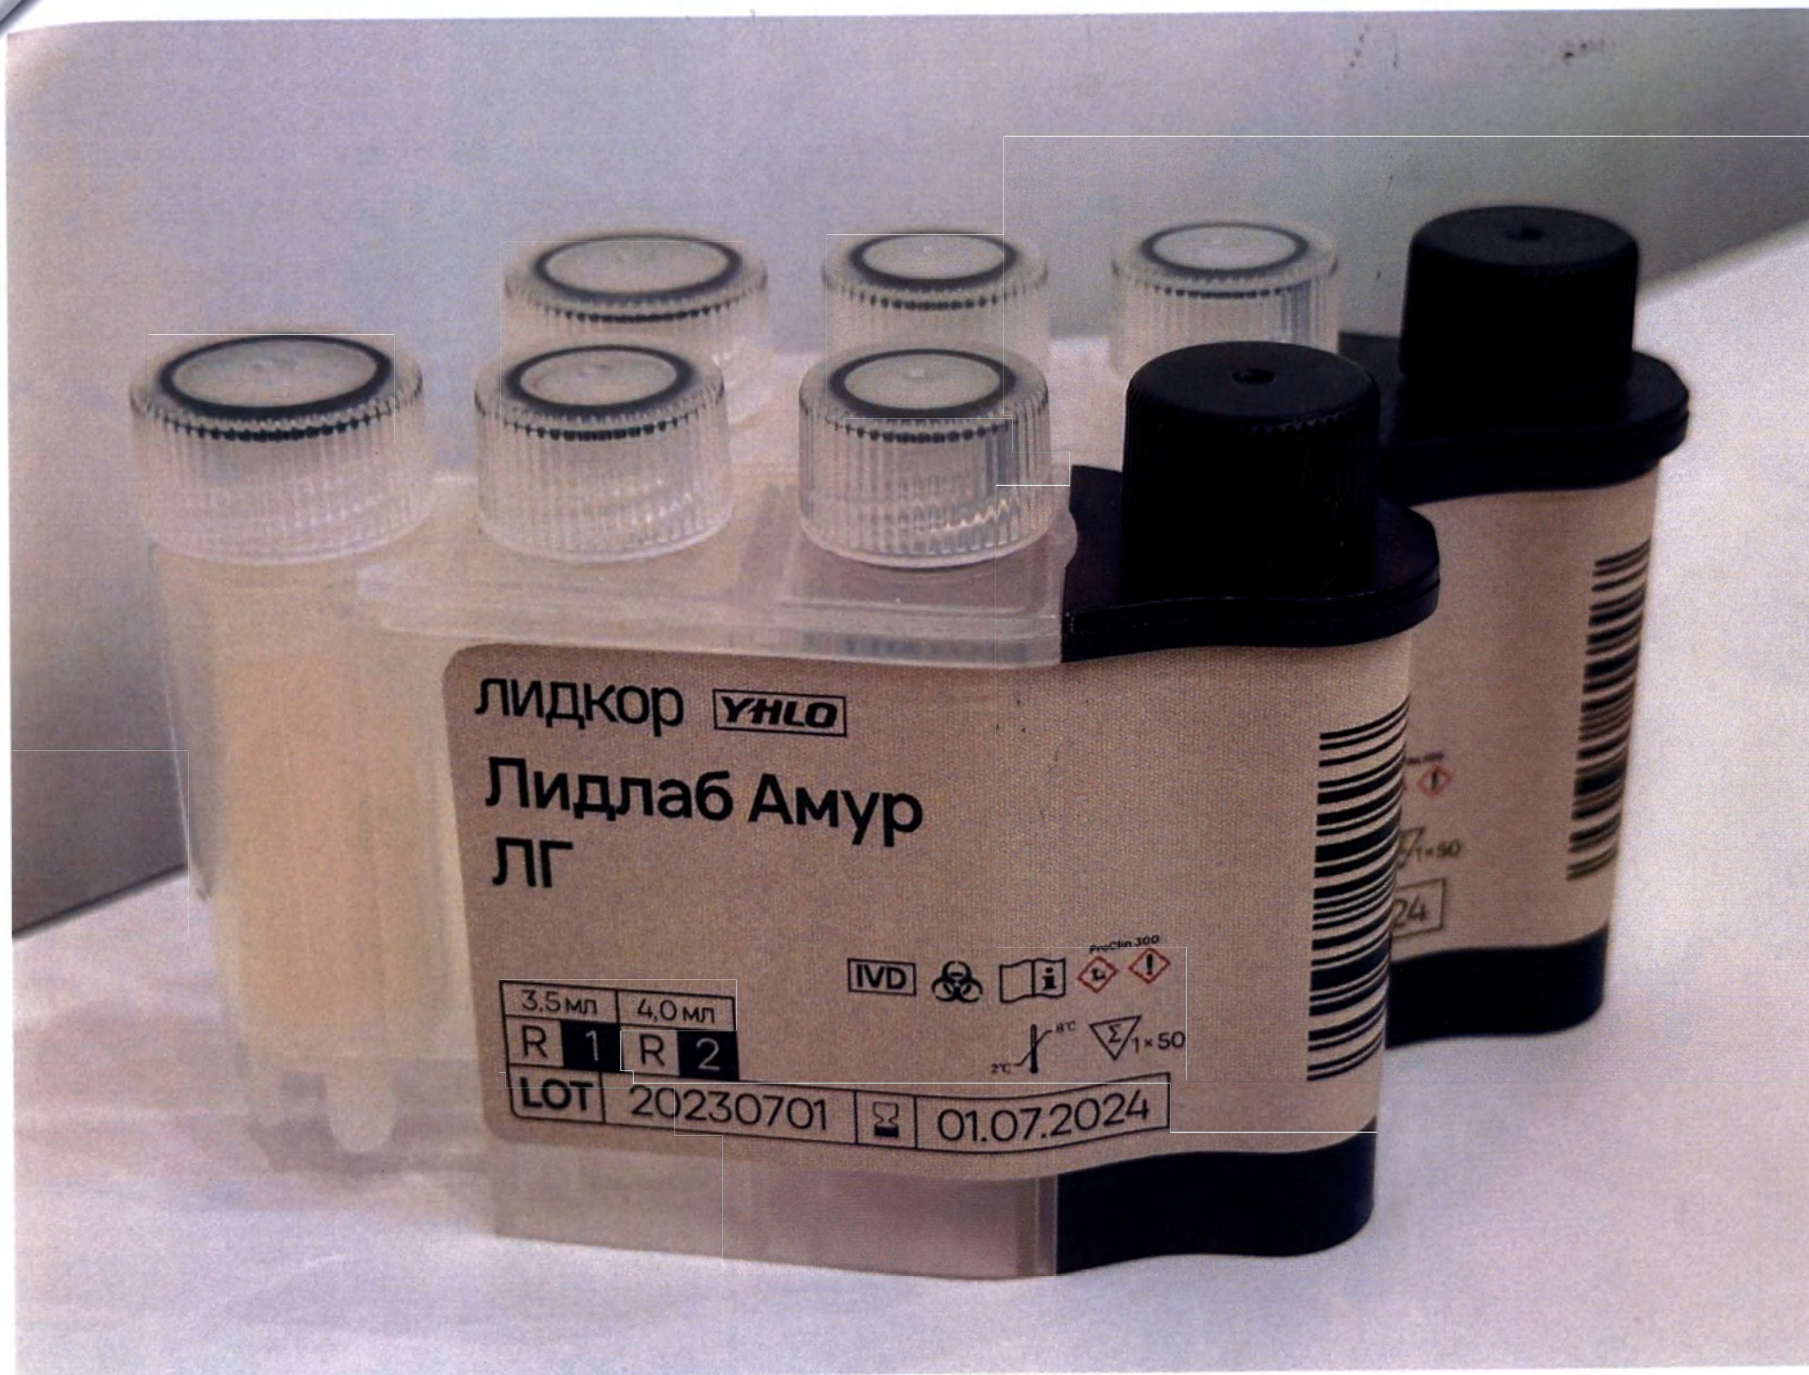

Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)

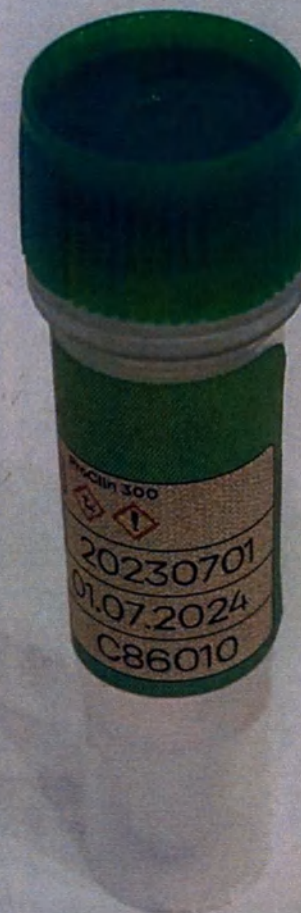

Калибратор 1 (CAL1)

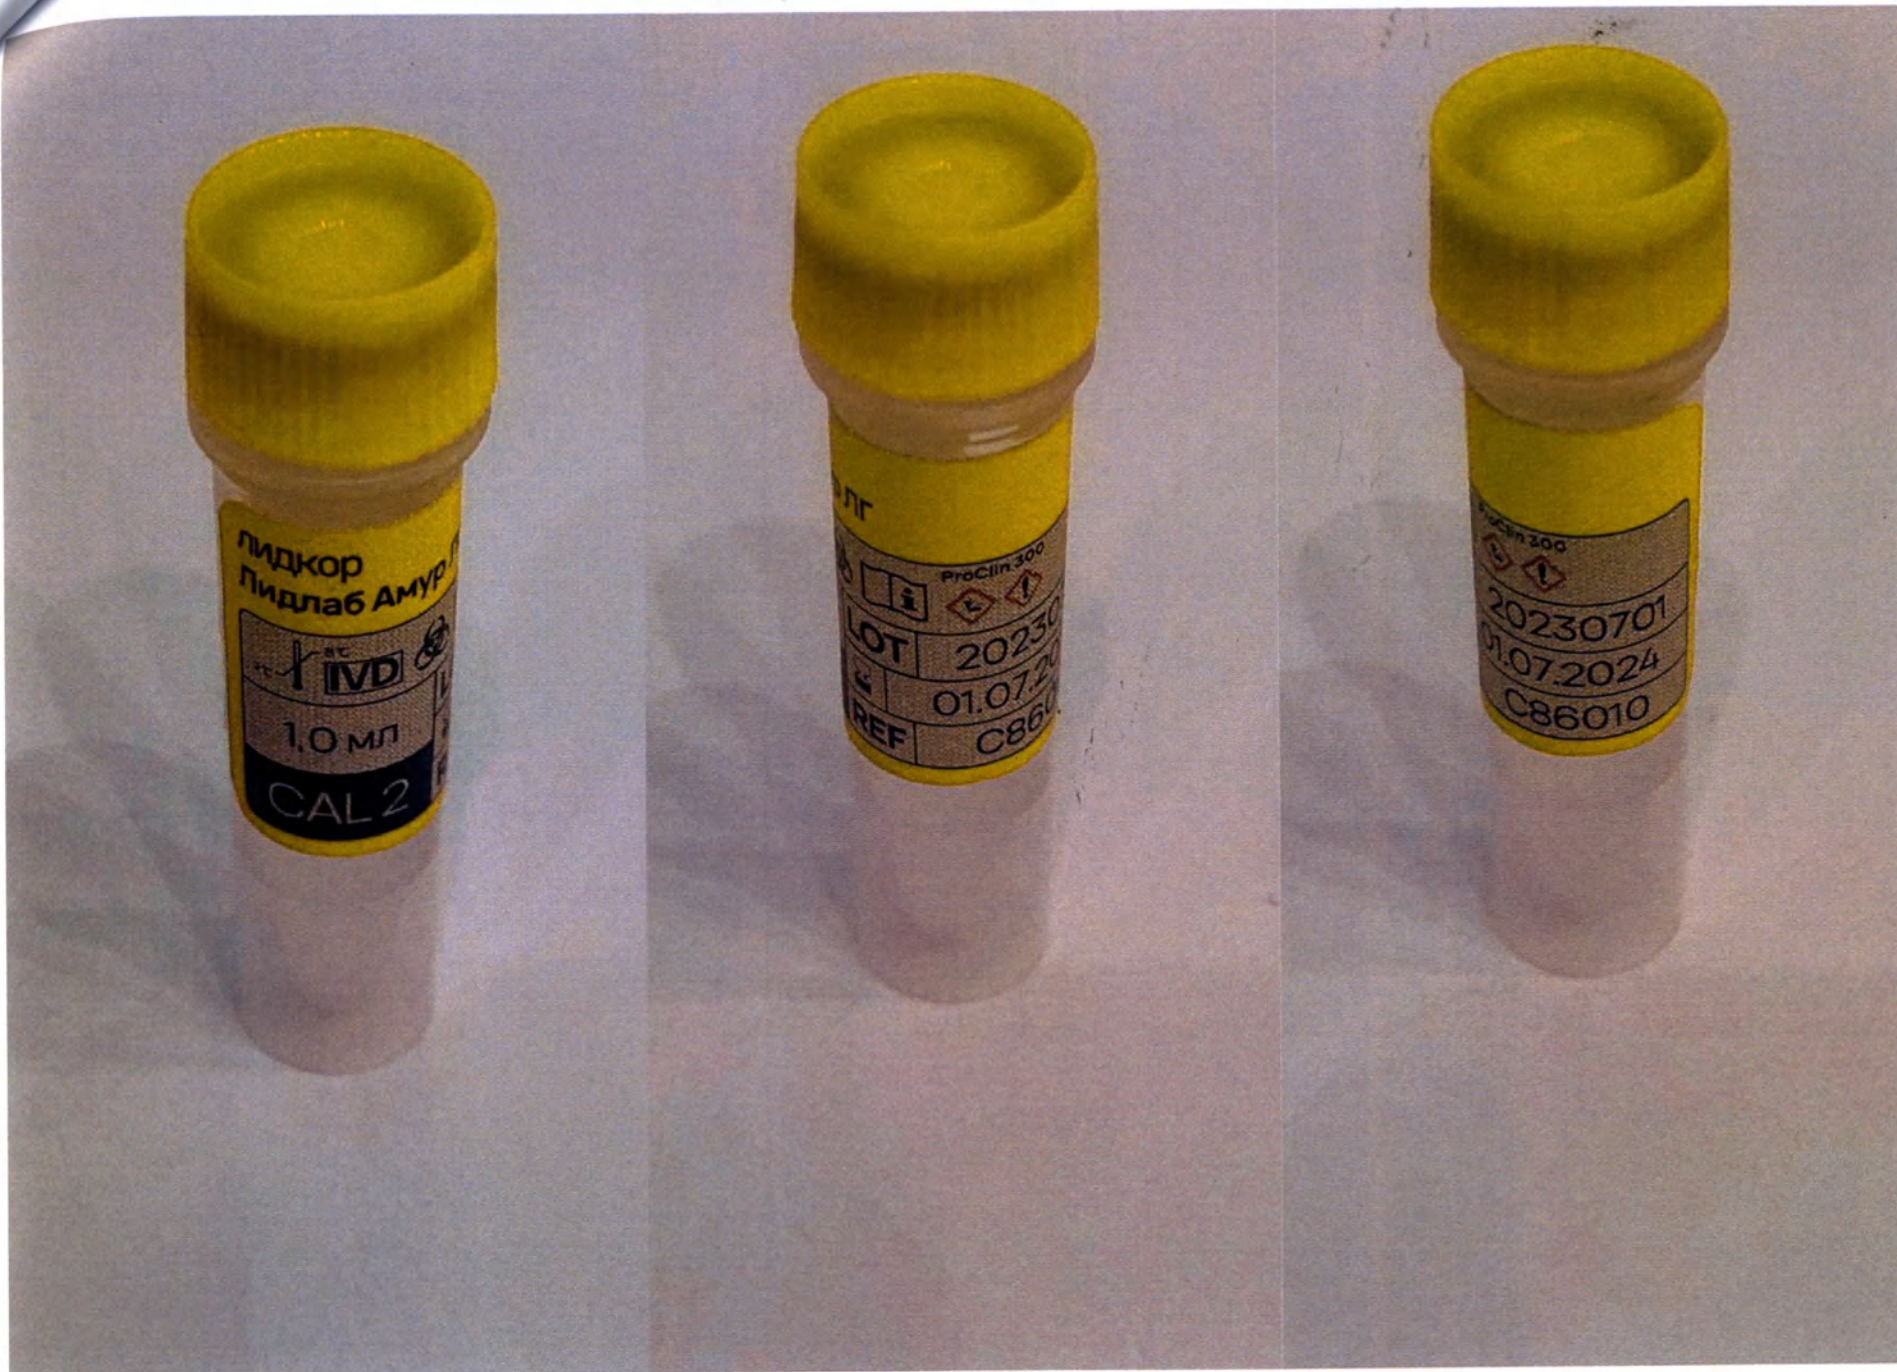



Калибратор 3 (CAL3)

лидлаб

лидкор




Лидлаб Амур
ЛГ

Набор реагентов на 100 тестов


YHLO

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4.0 мл/уп.) - 2 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон - 1 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон - 1 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон - 1 шт.
5. Пароизоляционные крышки - 8 шт.
6. Инструкция по применению - 1 шт.
7. Аналитический паспорт - 1 шт.

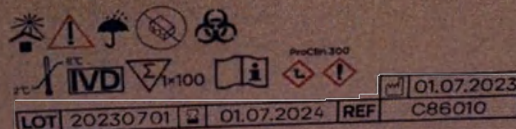

Набор реагентов на 100 тестов

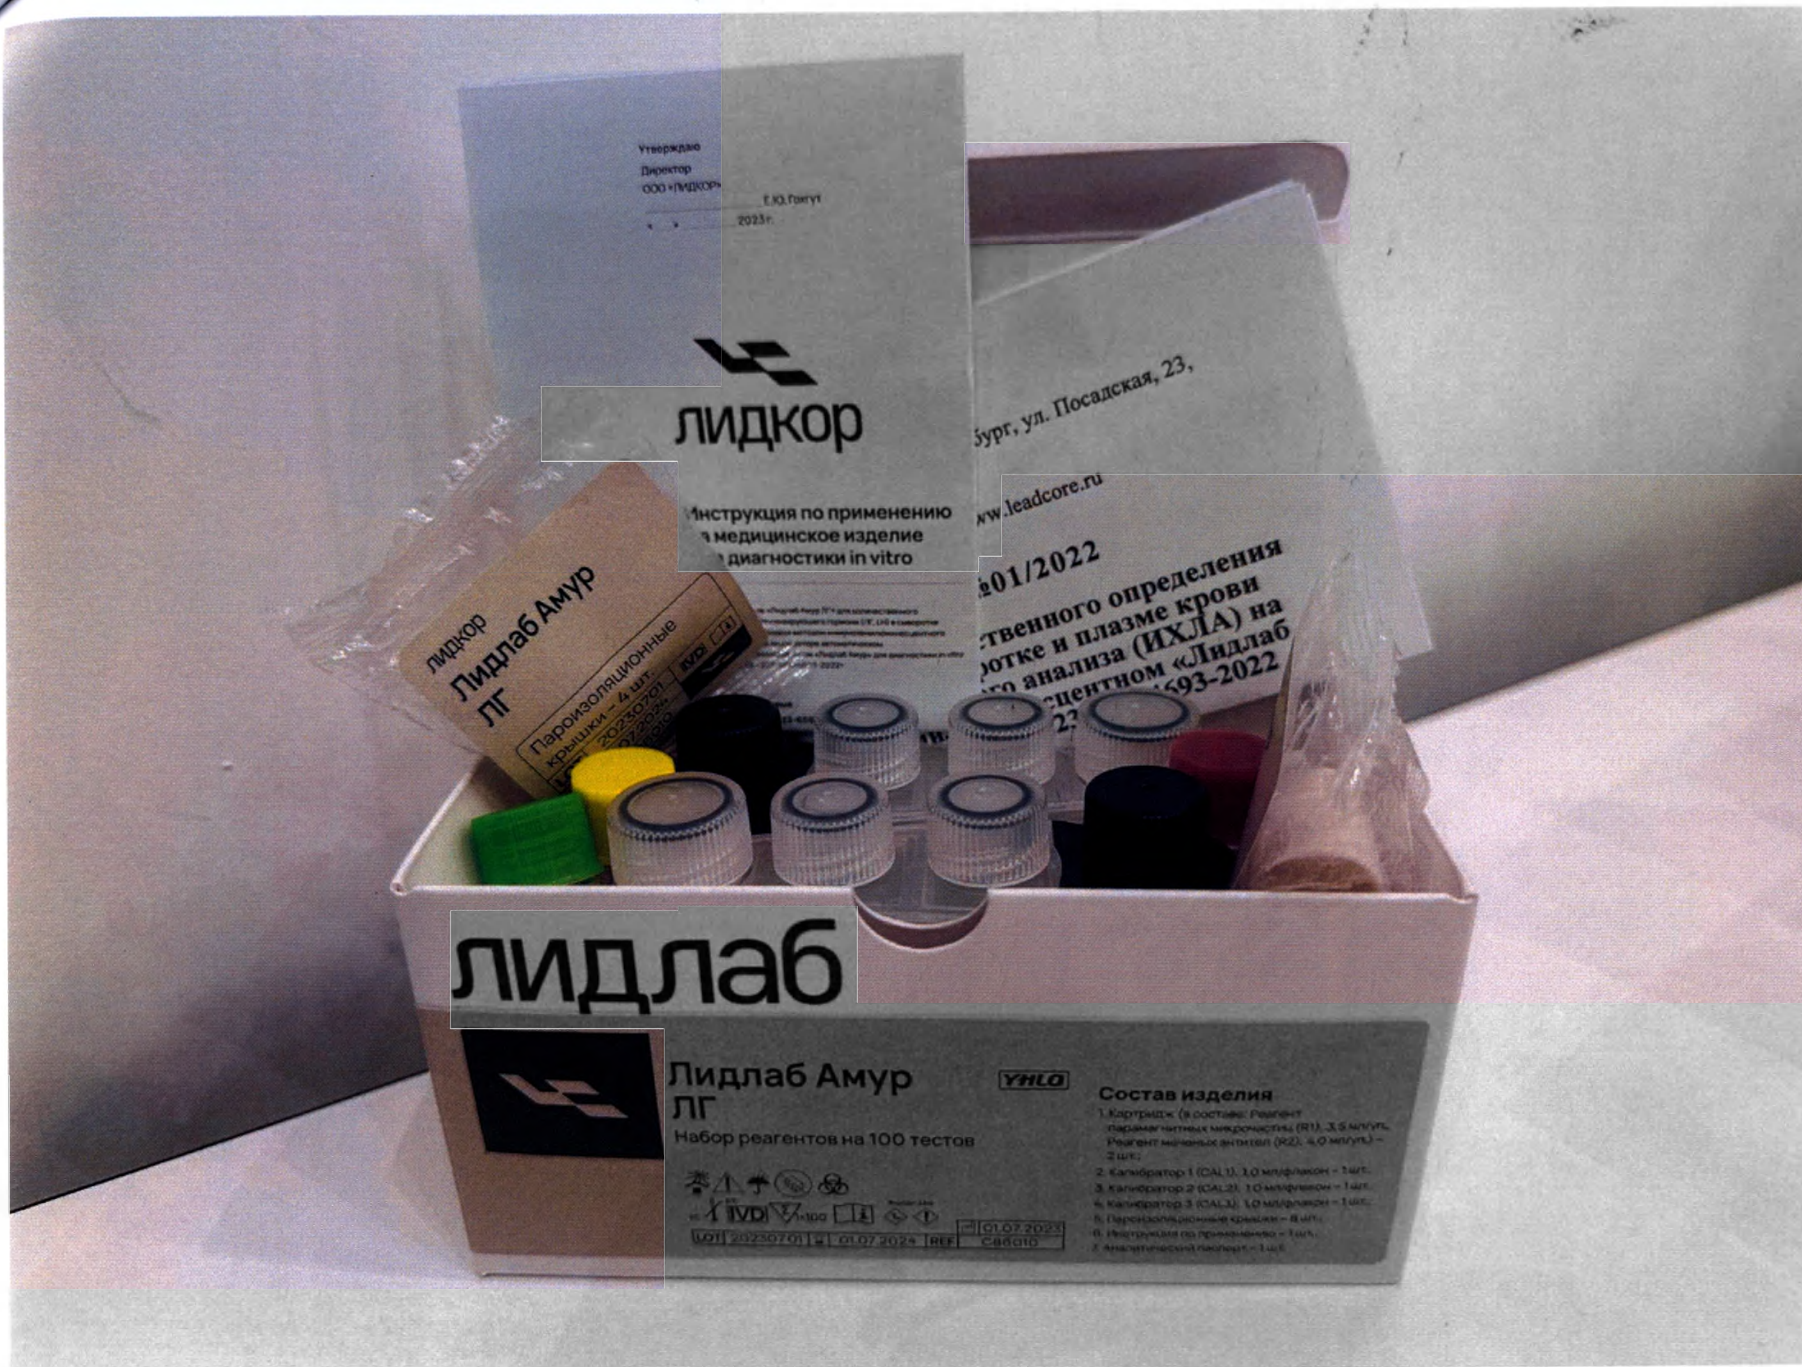

Набор реагентов на 100 тестов

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур ЛГ» для
количественного определения лютеинизирующего
гормона (ЛГ, LH) в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 223-65614693-
2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Набор реагентов на 100 тестов (другая сторона коробки)

лидлаб



**Лидлаб Амур
ЛГ**
Набор реагентов на 200 тестов




ИВД 200
LOT 20230701 01.07.2024 REF C8601Q

YHLO

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,15 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 18 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов на 200 тестов

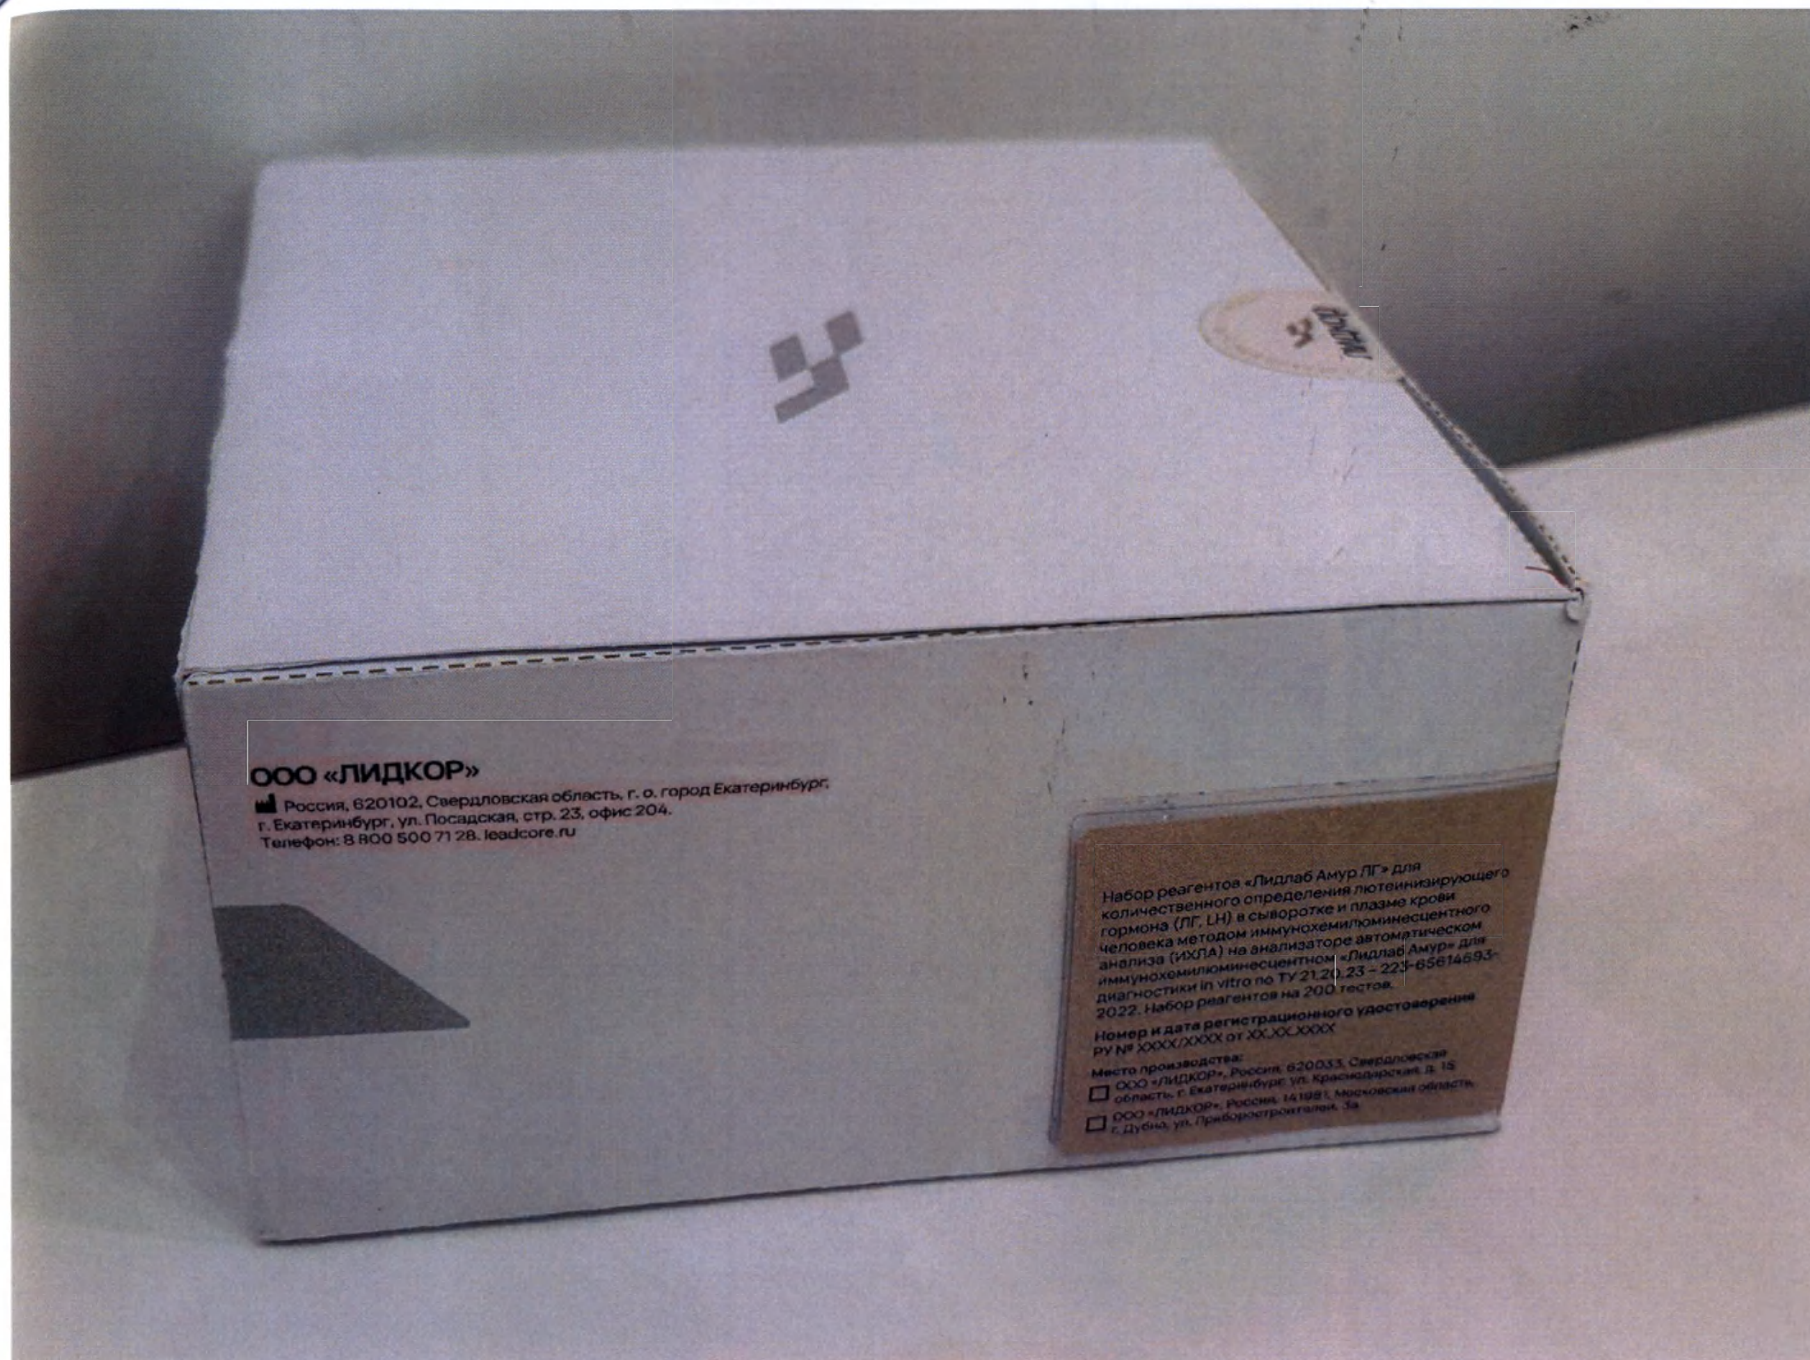

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур ЛГ» для
количественного определения лютеинизирующего
гормона (ЛГ, LH) в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.21.23 – 223-65614693-
2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Красноварская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроительная, 3а

Набор реагентов на 200 тестов (другая сторона коробки)



Набор реагентов на 500 тестов



Набор реагентов на 1000 тестов

лидкор
Лидлаб Амур
ЛГ

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT	20230701	IVD 
	01.07.2024	
REF	C86010	

лидкор
Лидлаб Амур
ЛГ

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT	20230701	IVD 
	01.07.2024	
REF	C86010	

Пароизоляционные крышки



Транспортная тара и ее маркировка



Набор реагентов «Лидлаб Амур ЛГ» для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ, LH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 223-65614693-

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU полнения: Набор реагентов на 100 тестов; Набор реагентов на 200 тестов; Набор реагентов на 500 тестов; Набор реагентов на 1000 тестов

15 (Летнаряво) л

_____/Е. Ю. Гохгут/

