

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут


«01» июля 2023 г.




МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**«Набор реагентов «Лидлаб Амур СК-МВ» для количественного определения
миокардиального изофермента креатинкиназы (СК-МВ) в сыворотке и
плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-274-65614693-2022»**

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.;
Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)

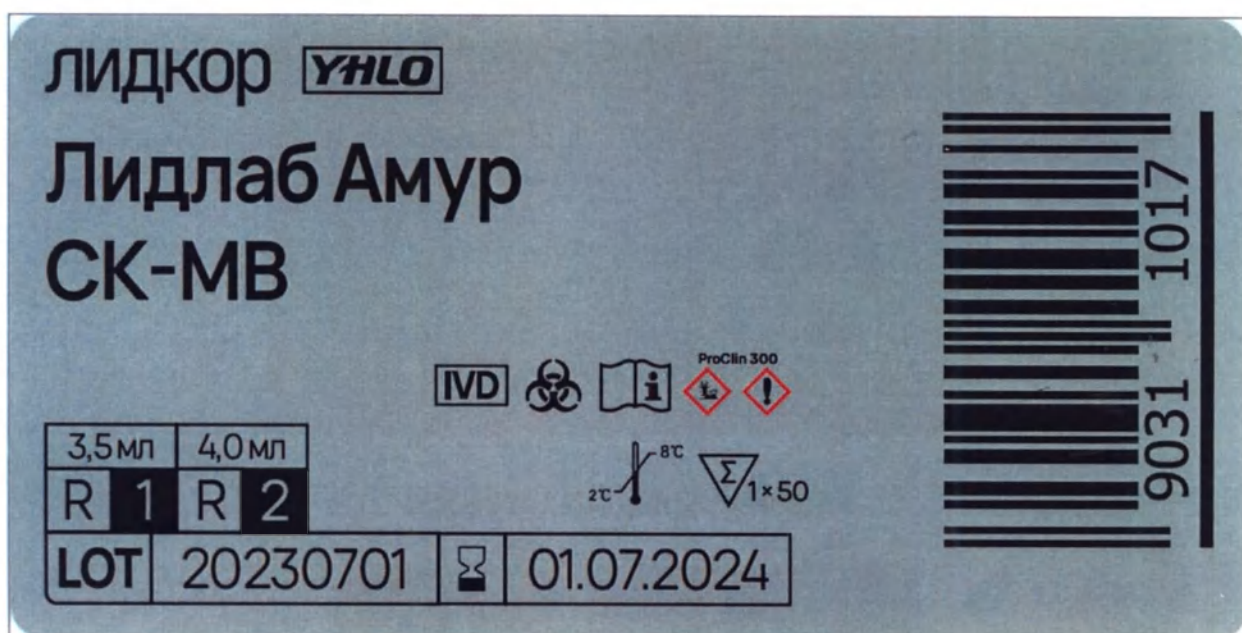

Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

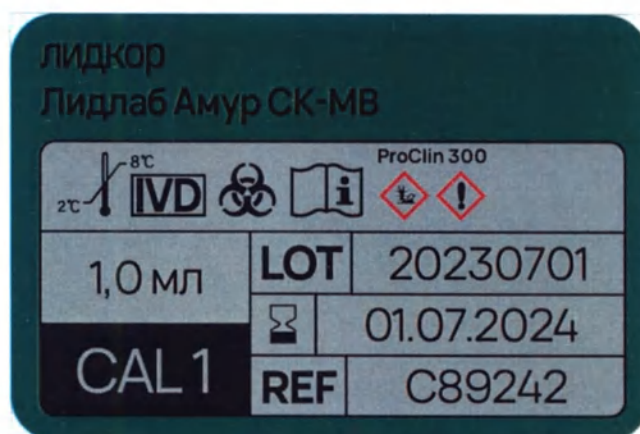

Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон



Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон



Пароизоляционные крышки



QR-code




Наклейка




Потребительская упаковка

Набор реагентов «Лидлаб Амур СК-МВ» для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы (СК-МВ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-274-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX Место производства: ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноварская, д. 15 ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а		Лидлаб Амур СК-МВ Набор реагентов на 100 тестов		Состав изделия - Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.; - Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.; - Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.; - Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.; - Пароизоляционные крышки – 8 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт.; - Аналитический паспорт – 1 шт.;
Набор реагентов «Лидлаб Амур СК-МВ» для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы (СК-МВ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-274-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX Место производства: ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноварская, д. 15 ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а		Лидлаб Амур СК-МВ Набор реагентов на 200 тестов		Состав изделия - Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.; - Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.; - Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.; - Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.; - Пароизоляционные крышки – 16 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт.; - Аналитический паспорт – 1 шт.;
Набор реагентов «Лидлаб Амур СК-МВ» для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы (СК-МВ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-274-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX Место производства: ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноварская, д. 15 ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а		Лидлаб Амур СК-МВ Набор реагентов на 500 тестов		Состав изделия - Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 10 шт.; - Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.; - Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.; - Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.; - Пароизоляционные крышки – 40 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт.; - Аналитический паспорт – 1 шт.;
Набор реагентов «Лидлаб Амур СК-МВ» для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы (СК-МВ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-274-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX Место производства: ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноварская, д. 15 ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а		Лидлаб Амур СК-МВ Набор реагентов на 1000 тестов		Состав изделия - Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.; - Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.; - Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.; - Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.; - Пароизоляционные крышки – 80 шт.; - Инструкция по применению – 1 шт.; - Аналитический паспорт – 1 шт.;

Потребительская коробка

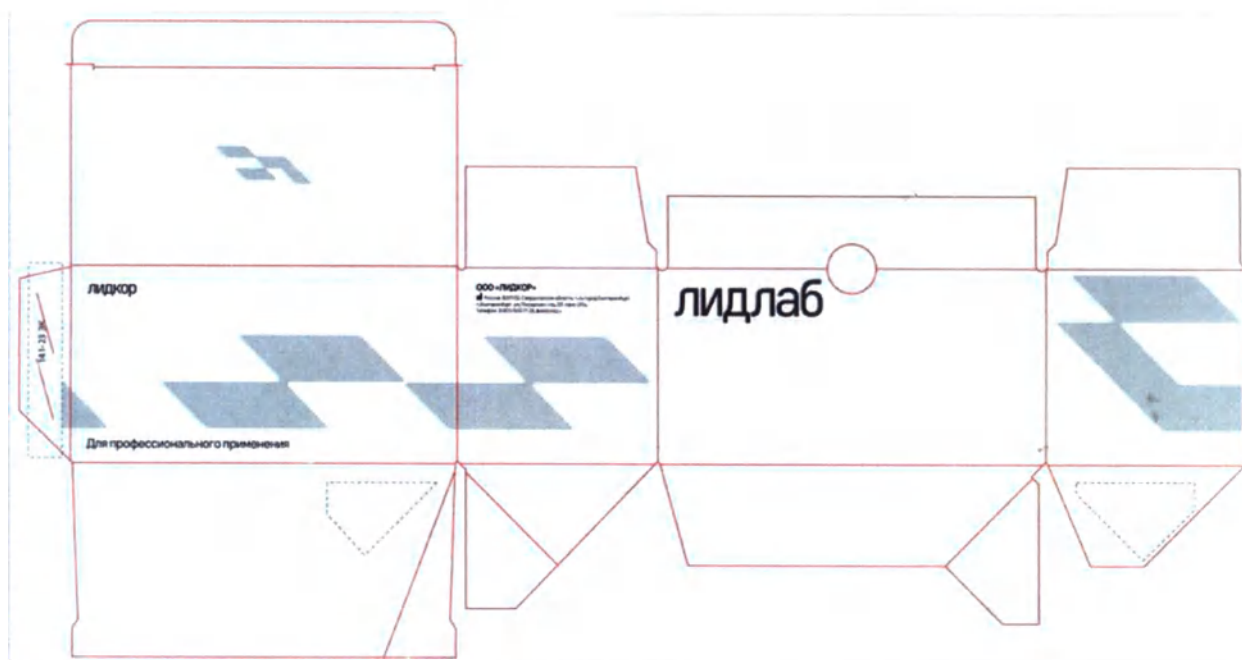

Транспортная упаковка

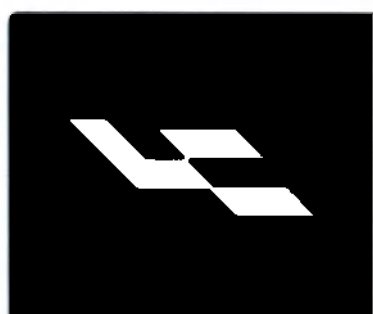

Набор реагентов «Лидлаб Амур СК-МВ» для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы (СК-МВ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-274-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89242



Набор реагентов «Лидлаб Амур СК-МВ» для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы (СК-МВ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-274-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89242




Набор реагентов «Лидлаб Амур СК-МВ» для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы (СК-МВ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-274-65614693-2022




Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89242

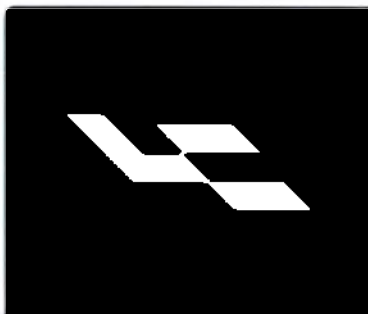

Набор реагентов «Лидлаб Амур СК-МВ» для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы (СК-МВ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-274-65614693-2022

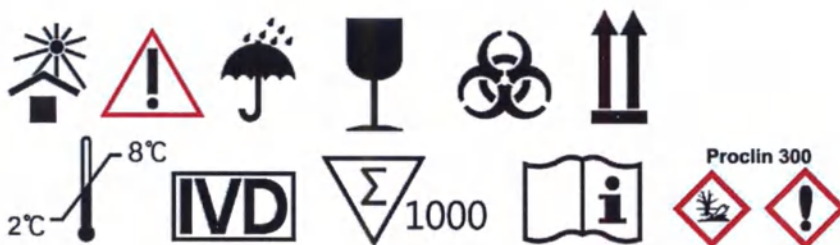

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89242

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (семь) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»



Е. Ю. Гохгут/

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.

М.П.



Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов «Лидлаб Амур СК-МВ» для количественного определения миокардиального изофермента креатинкиназы (СК-МВ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-274-65614693-2022»


Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)




Пароизоляционные крышки



Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

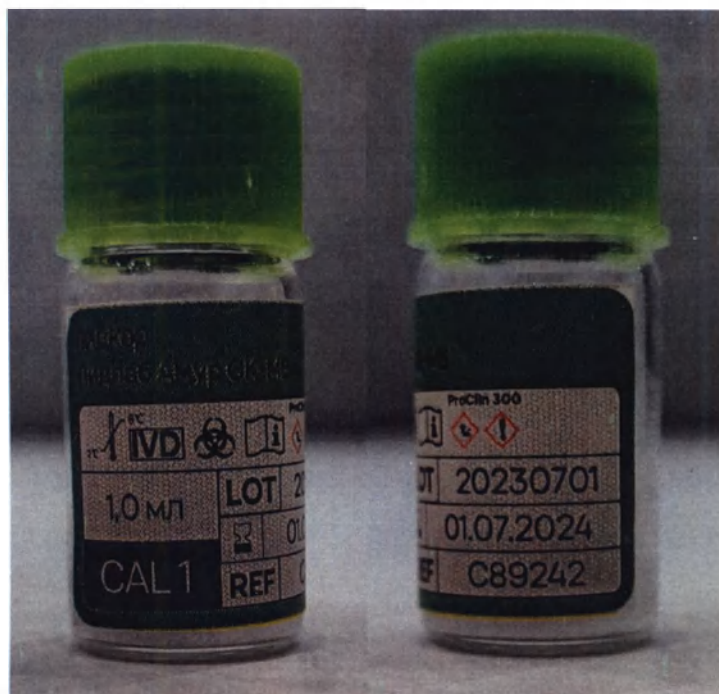


Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

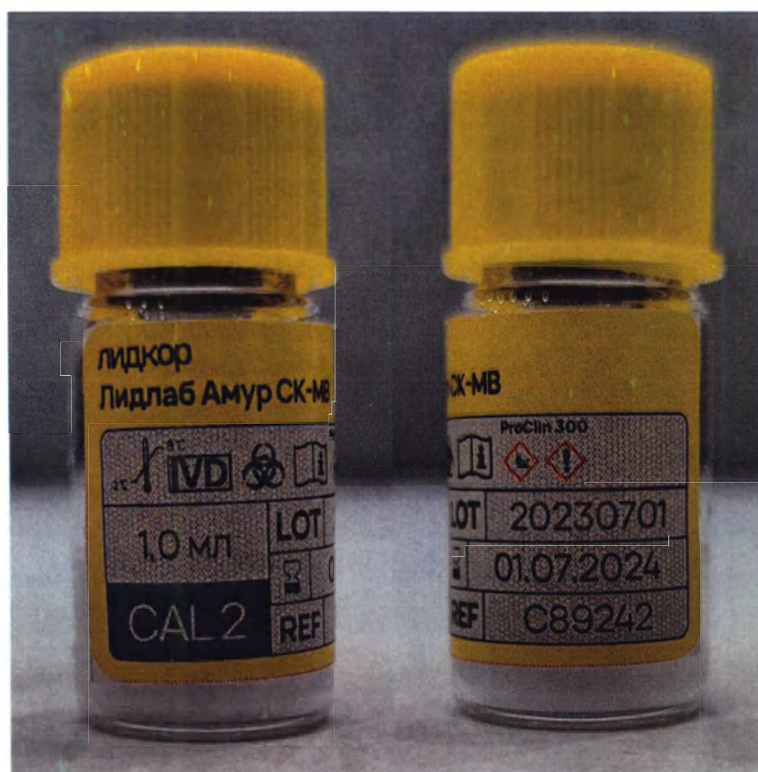

Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон



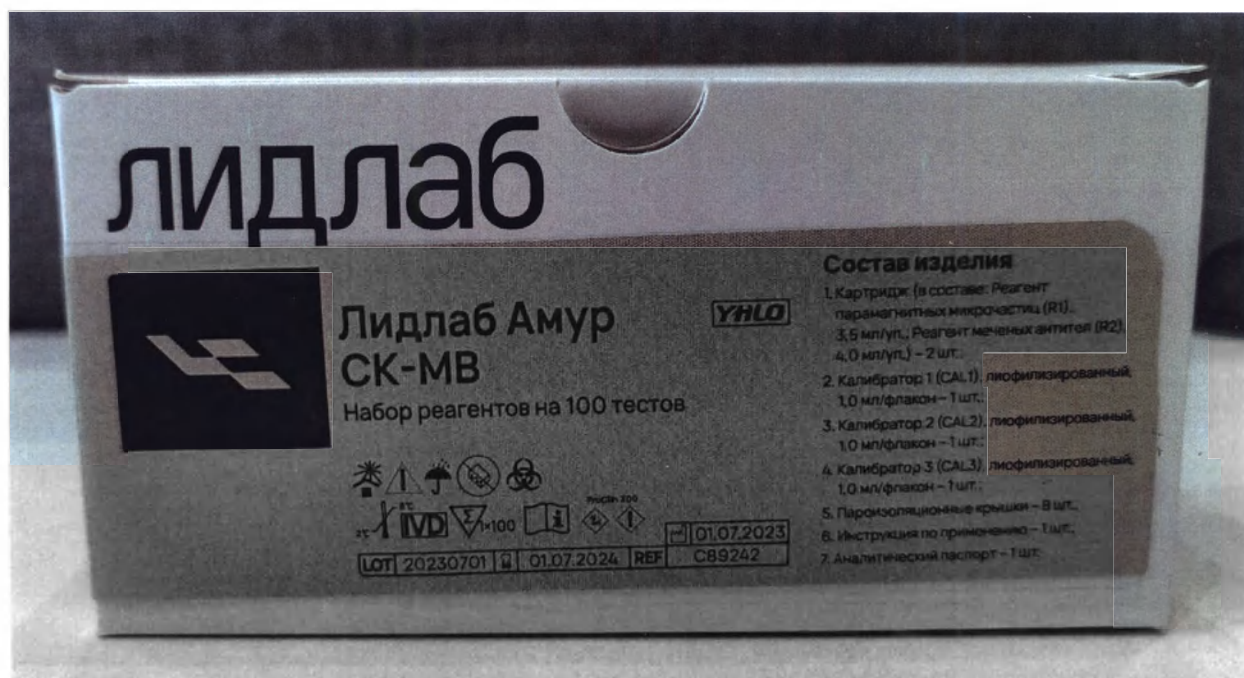


Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)




Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)

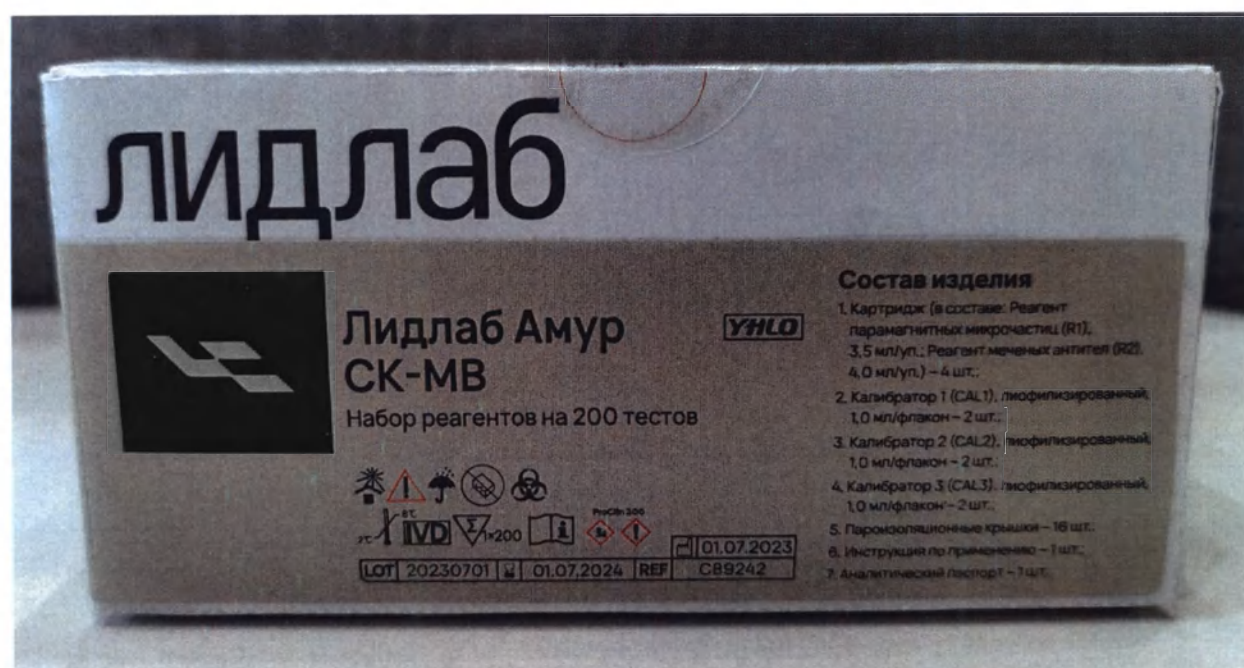

Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)

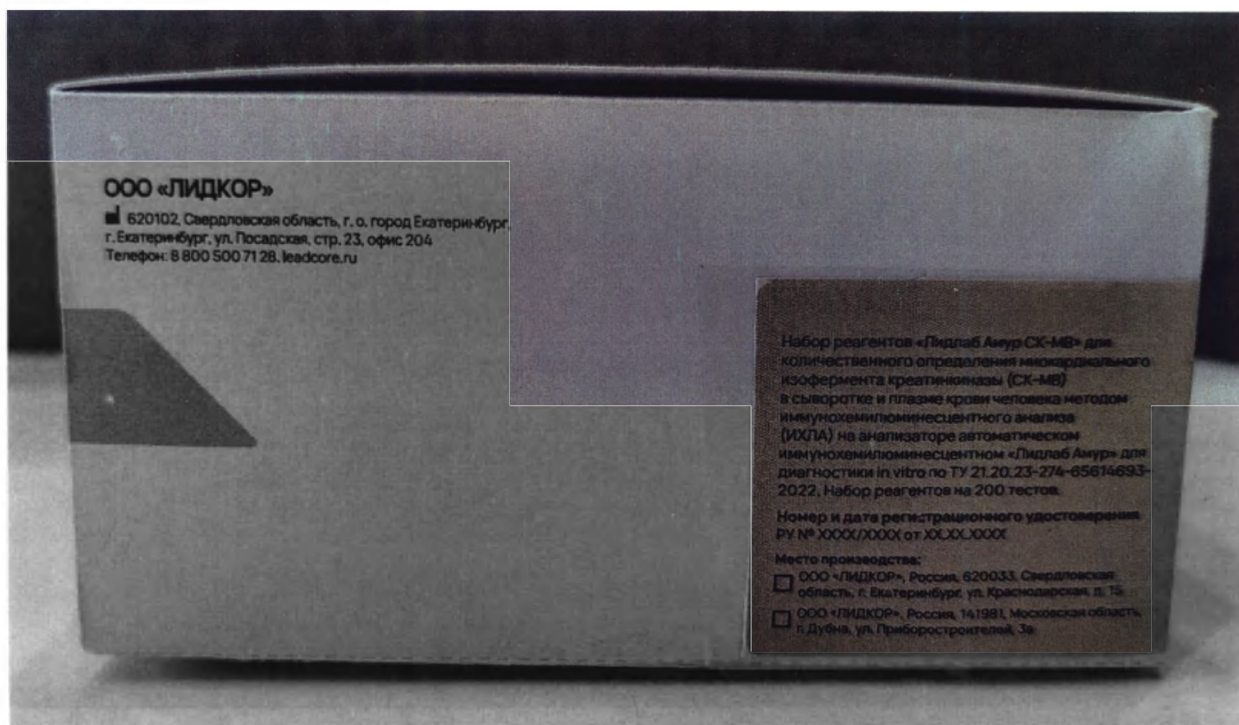


Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)



Потребительская упаковка 500 тестов (вид спереди)

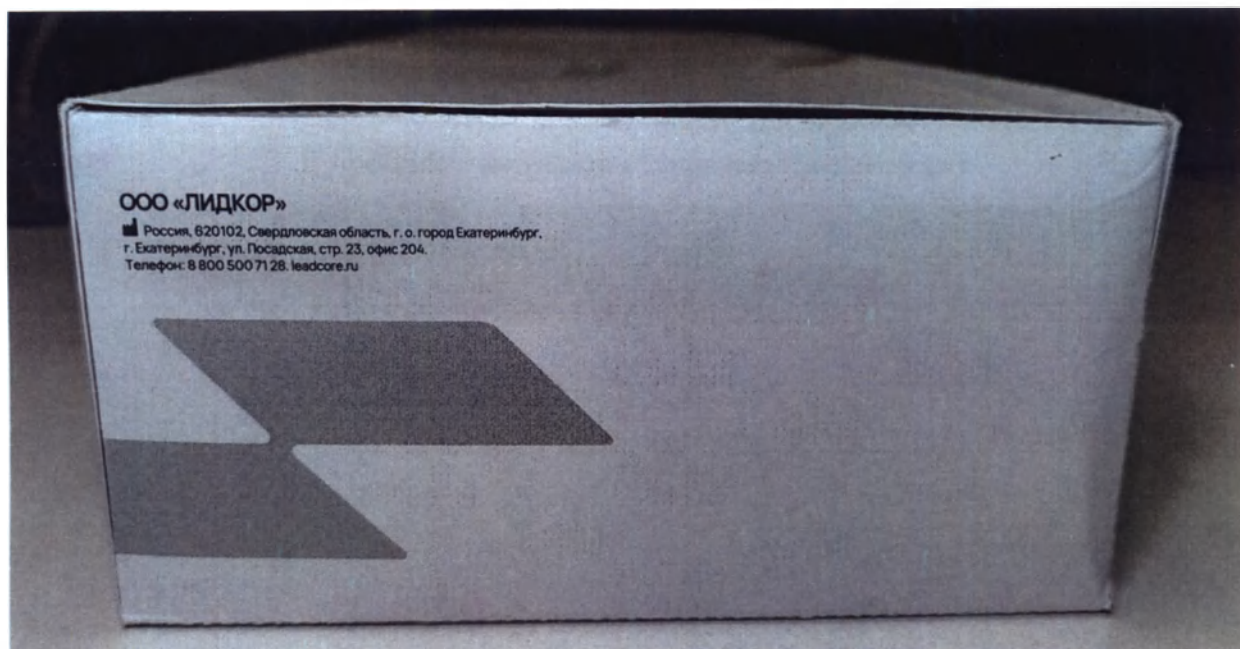

Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)




Потребительская упаковка 1000 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)

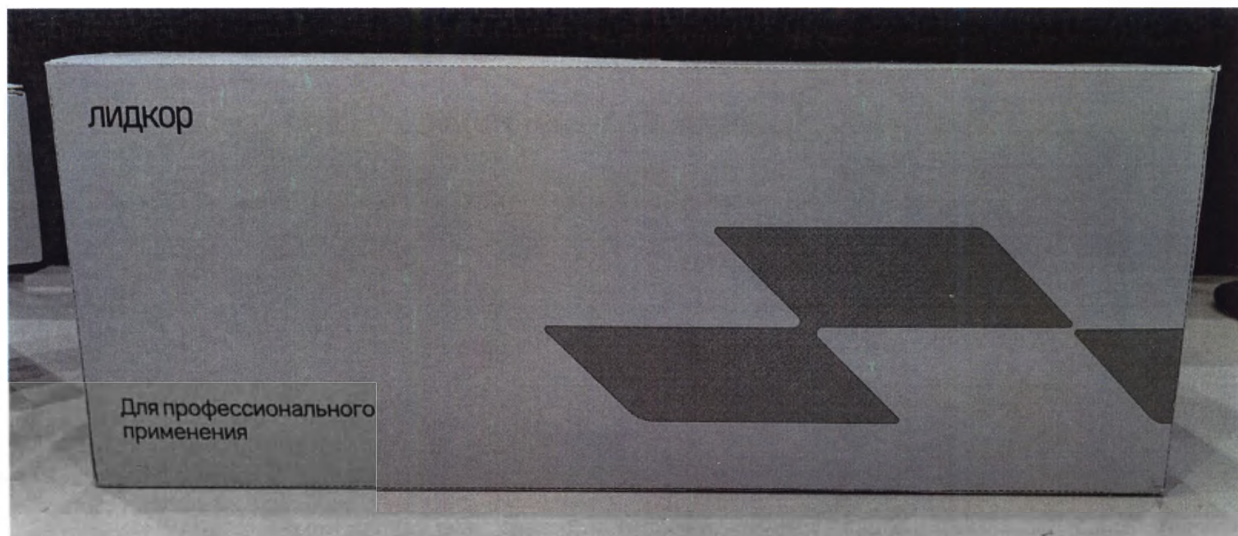

Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)

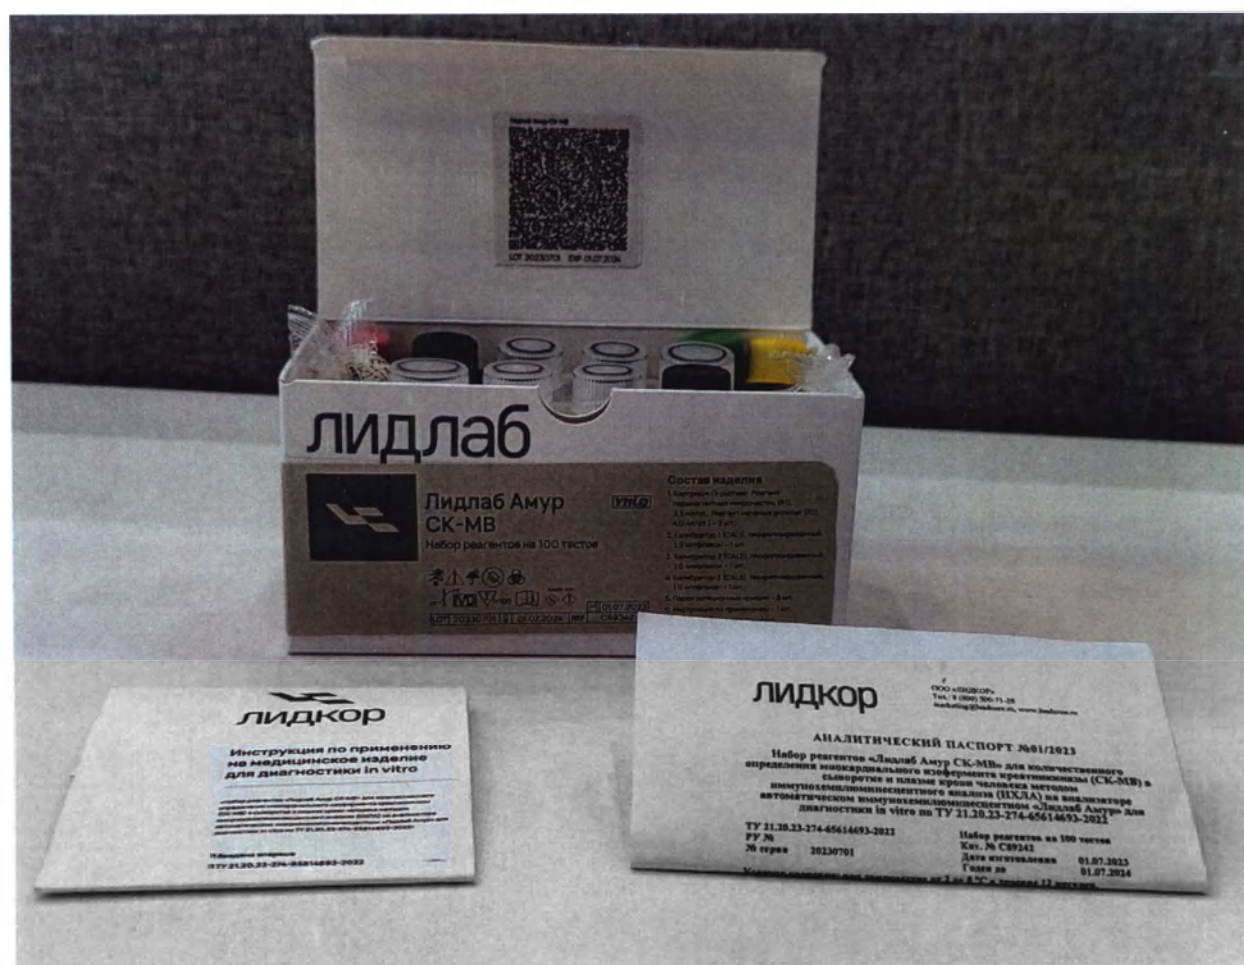


Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.

Групповое фото.



Транспортная упаковка



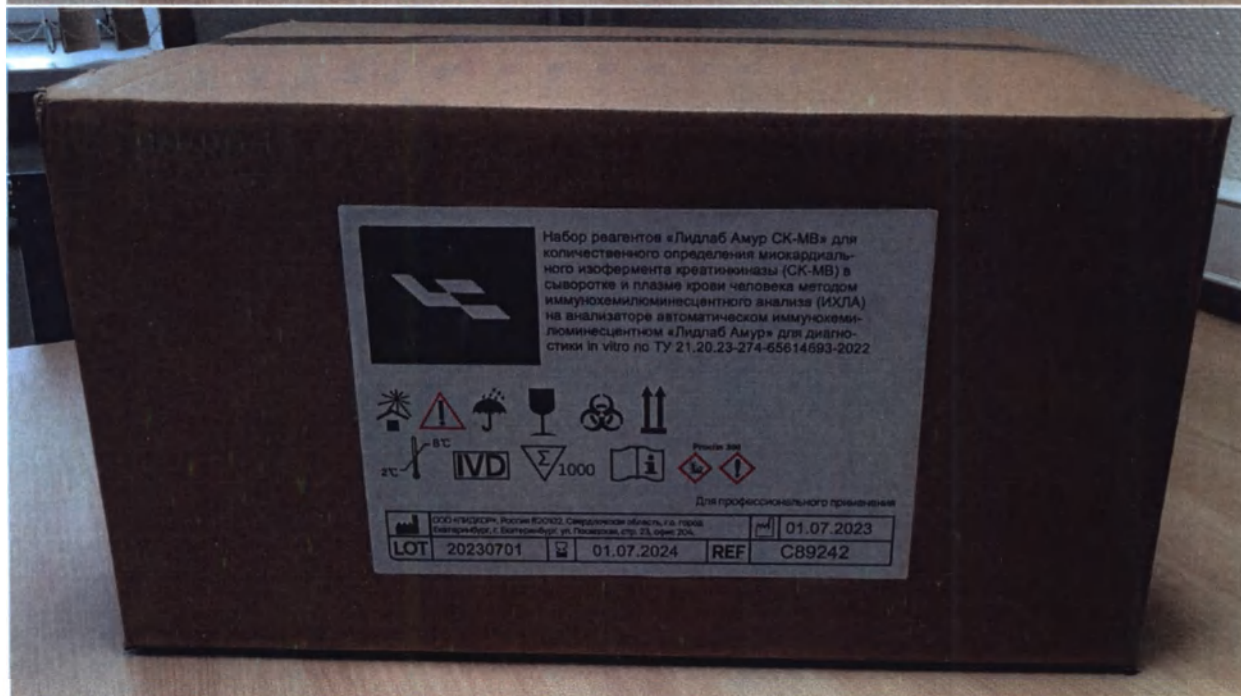

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

В. Прикарев) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

Е. Ю. Гохгут /Е. Ю. Гохгут/

