

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут


июля 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**«Набор реагентов «Лидлаб Амур Пролактин» для количественного
определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека методом
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе
автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 226-65614693-2022»**

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.;
 Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)

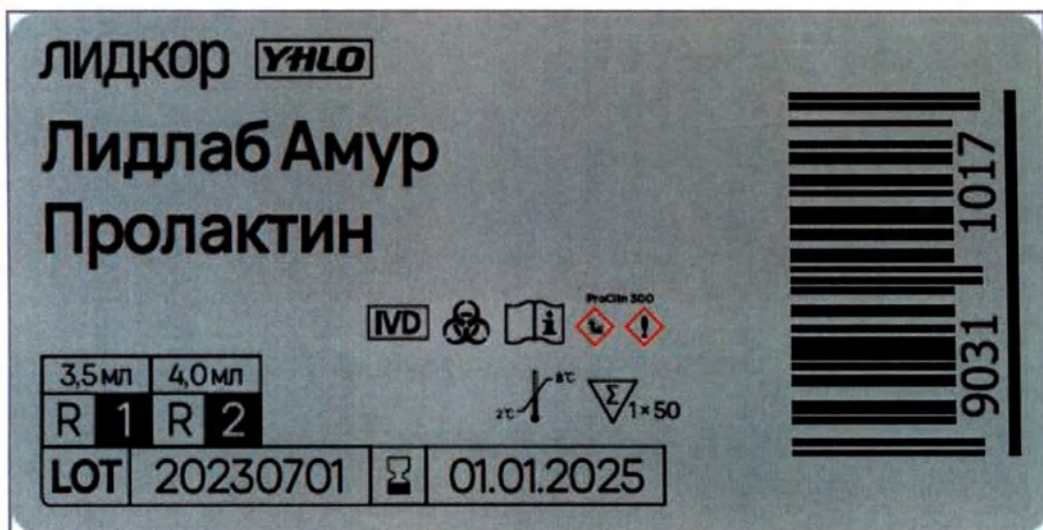

Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон




Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон



Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон



Пароизоляционные крышки

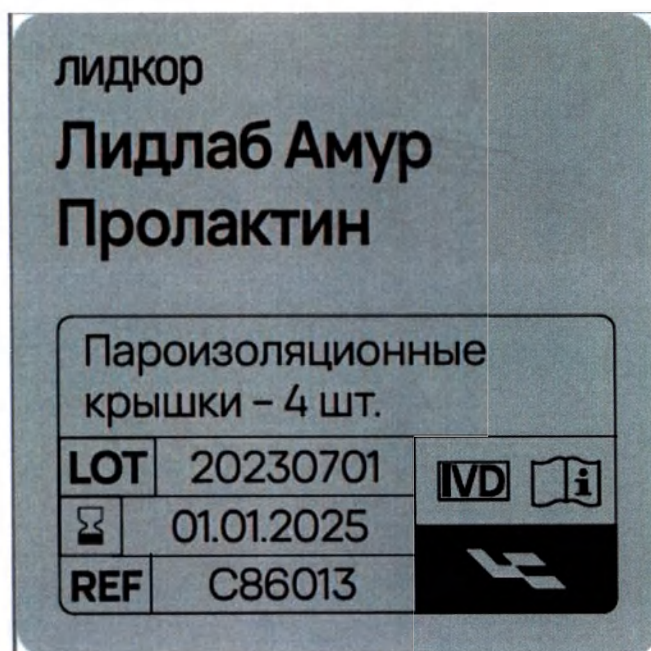

QR-code



Наклейка



Потребительская упаковка

Набор реагентов «Лидлаб Амур Пролактин» для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 226-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XXXX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур Пролактин

Набор реагентов на 100 тестов

LOT 20230701 01.01.2025 REF C86013

01.07.2023

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2) 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 флакон;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 флакон;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 флакон;
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Пролактин» для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 226-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XXXX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур Пролактин

Набор реагентов на 200 тестов

LOT 20230701 01.01.2025 REF C86013

01.07.2023

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2) 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 флакона;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 флакона;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 флакона;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Пролактин» для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 226-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XXXX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур Пролактин

Набор реагентов на 500 тестов

LOT 20230701 01.01.2025 REF C86013

01.07.2023

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2) 4,0 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 флаконов;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 флаконов;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 флаконов;
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Пролактин» для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 226-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XXXX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур Пролактин

Набор реагентов на 1000 тестов


LOT 20230701 01.01.2025 REF C86013

01.07.2023


Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2) 4,0 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 флаконов;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 флаконов;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 флаконов;
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.


Потребительская коробка

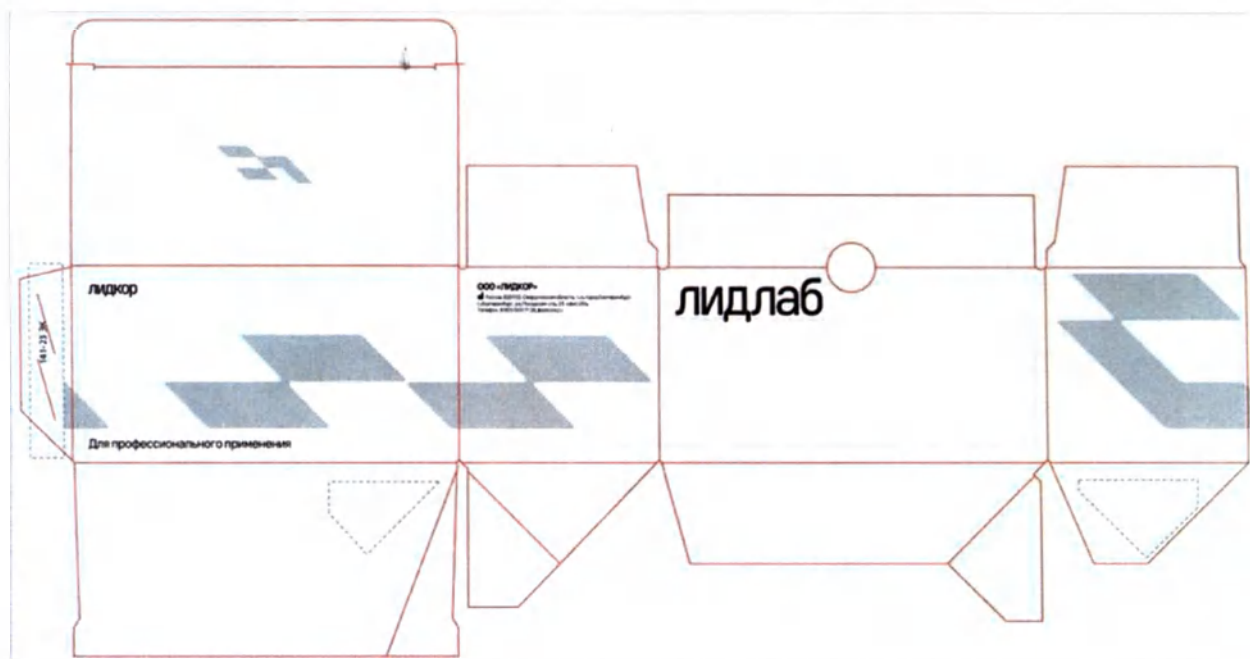

Транспортная упаковка

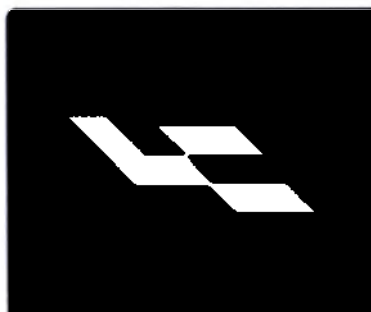


Набор реагентов «Лидлаб Амур Пролактин» для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-226-65614693-2022

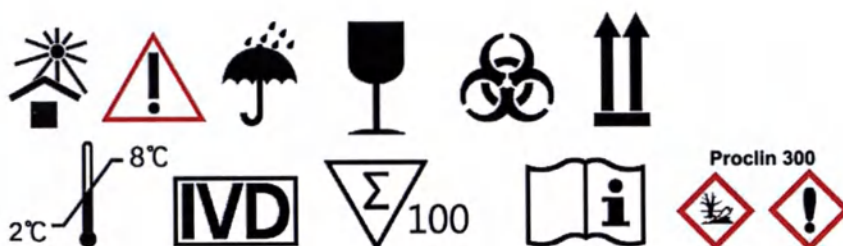


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025	REF	C86013

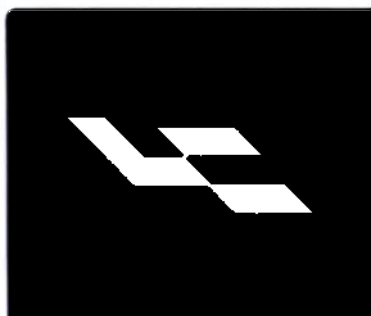


Набор реагентов «Лидлаб Амур Пролактин» для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-226-65614693-2022

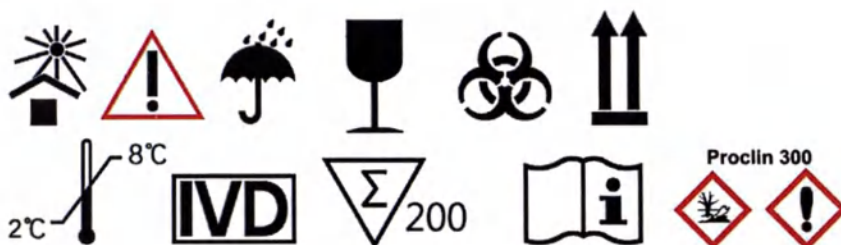

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025
REF	C86013		

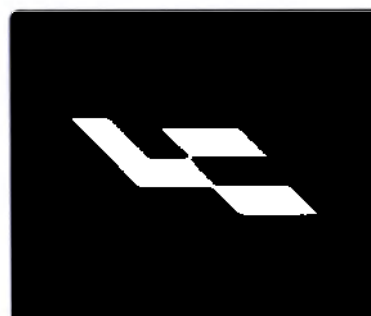


Набор реагентов «Лидлаб Амур Пролактин» для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-226-65614693-2022




Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025
REF	C86013		

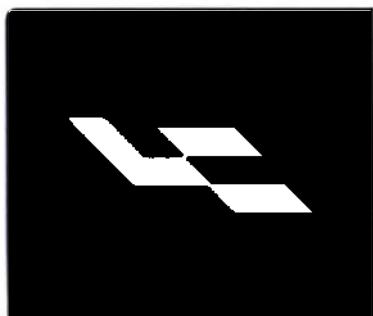

Набор реагентов «Лидлаб Амур Пролактин» для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-226-65614693-2022

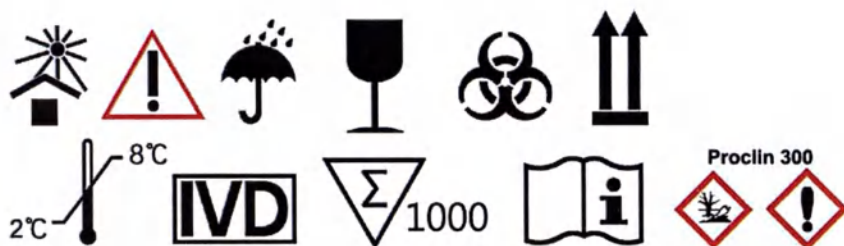

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025	REF	C86013

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (семь) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»



/Е. Ю. Гохгут/

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.


М.П.



Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Пролактин» для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 226-65614693-2022»


Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)

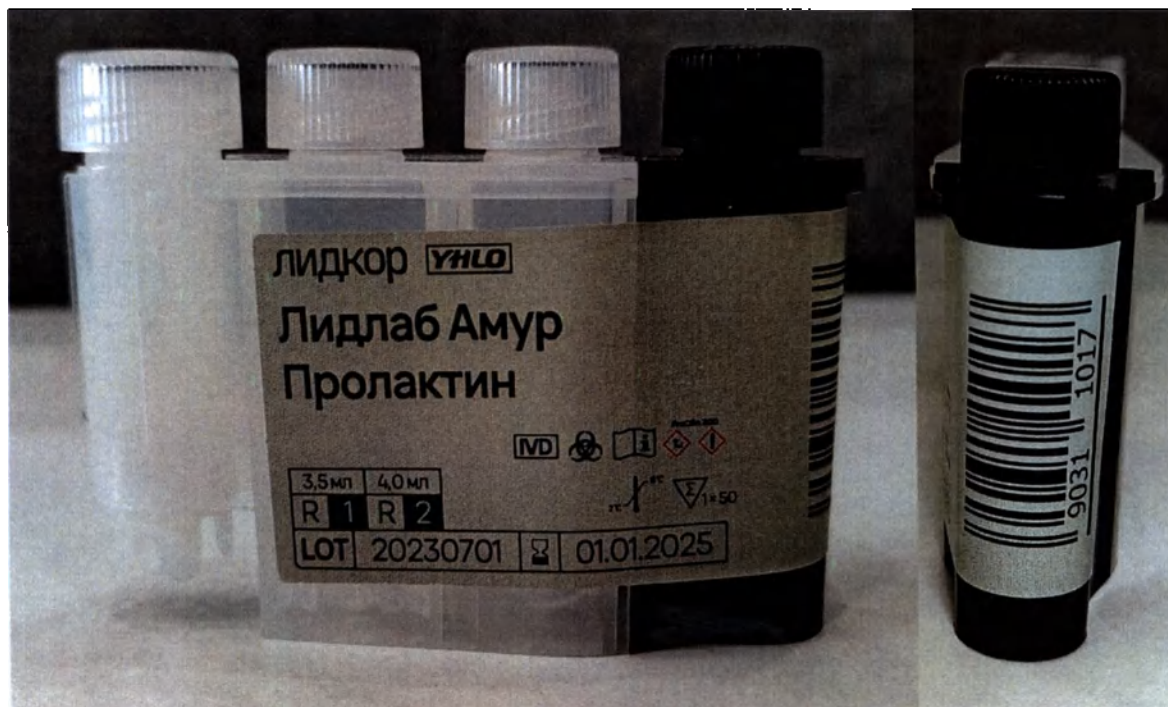


Пароизоляционные крышки




Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

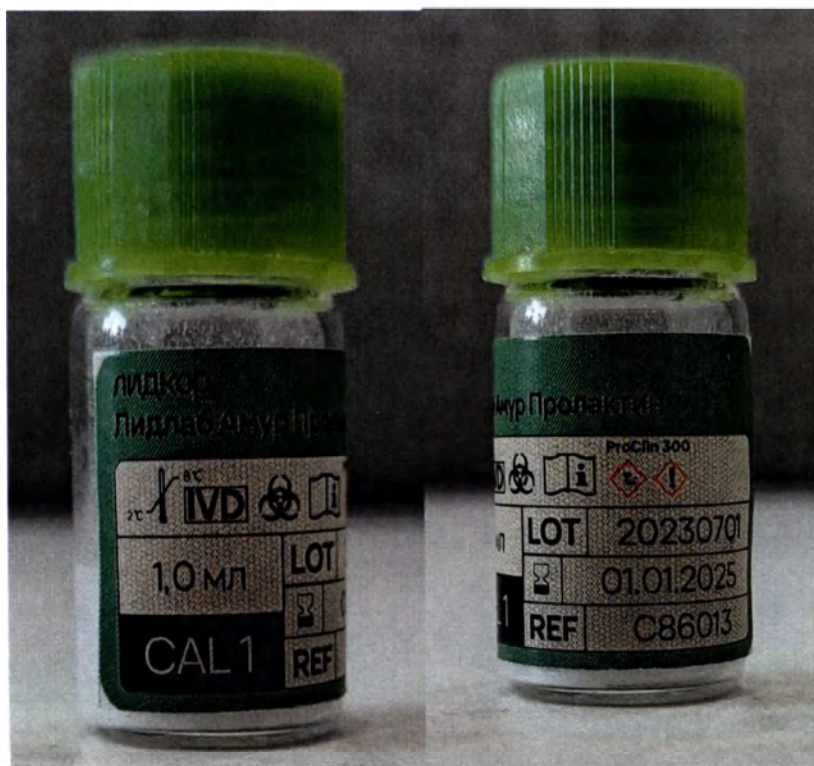

Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

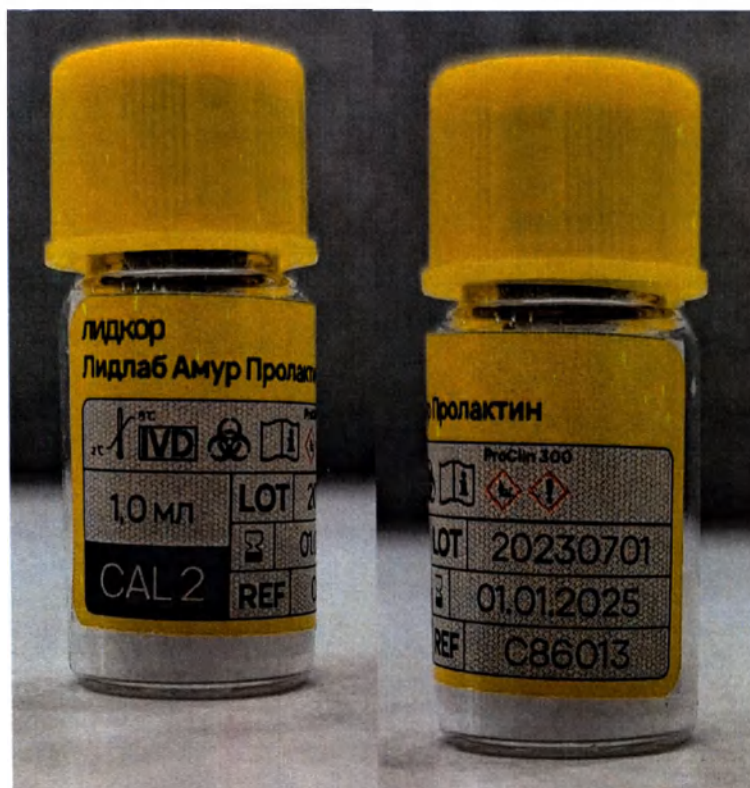

Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

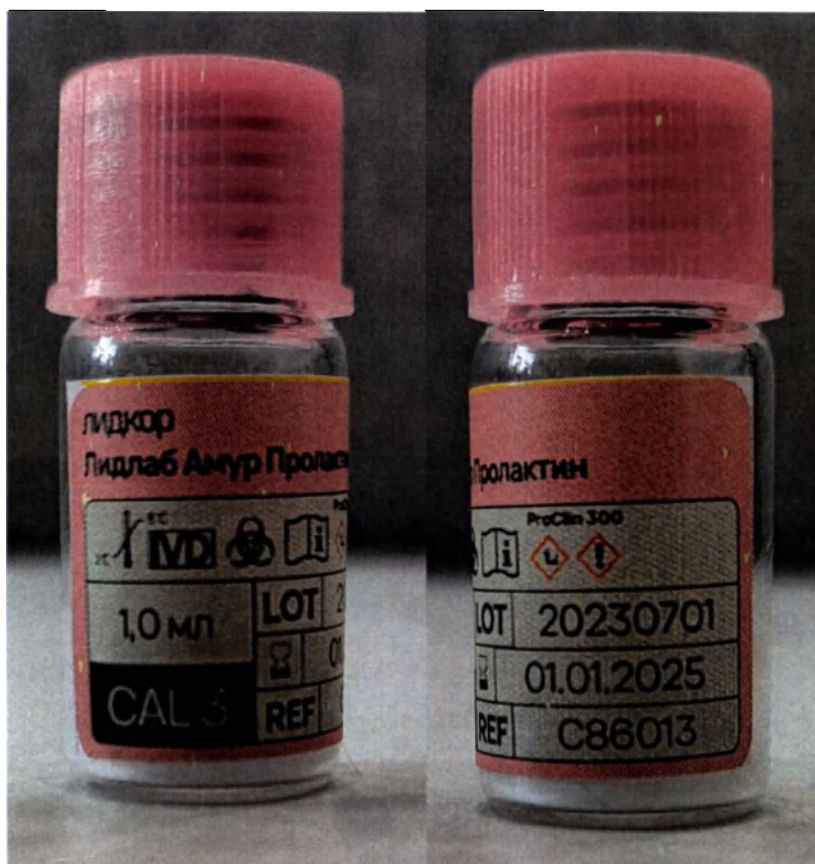



Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)




Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)



Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)

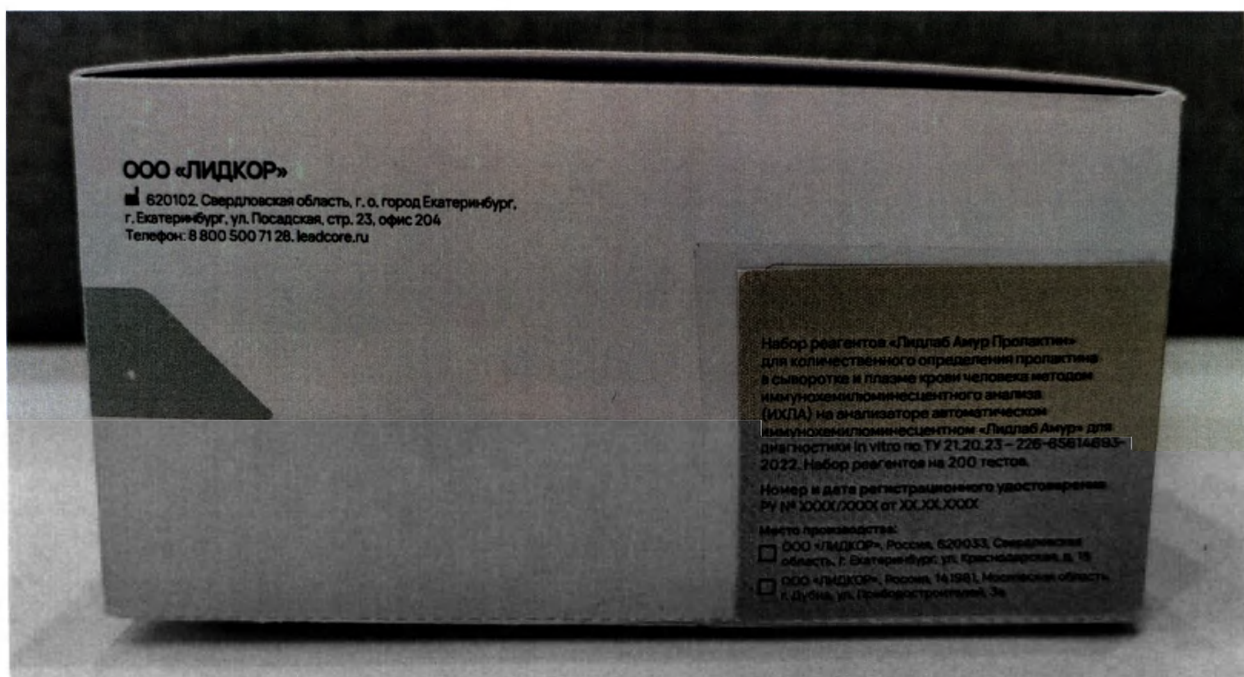


Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)



Потребительская упаковка 500 тестов (вид спереди)

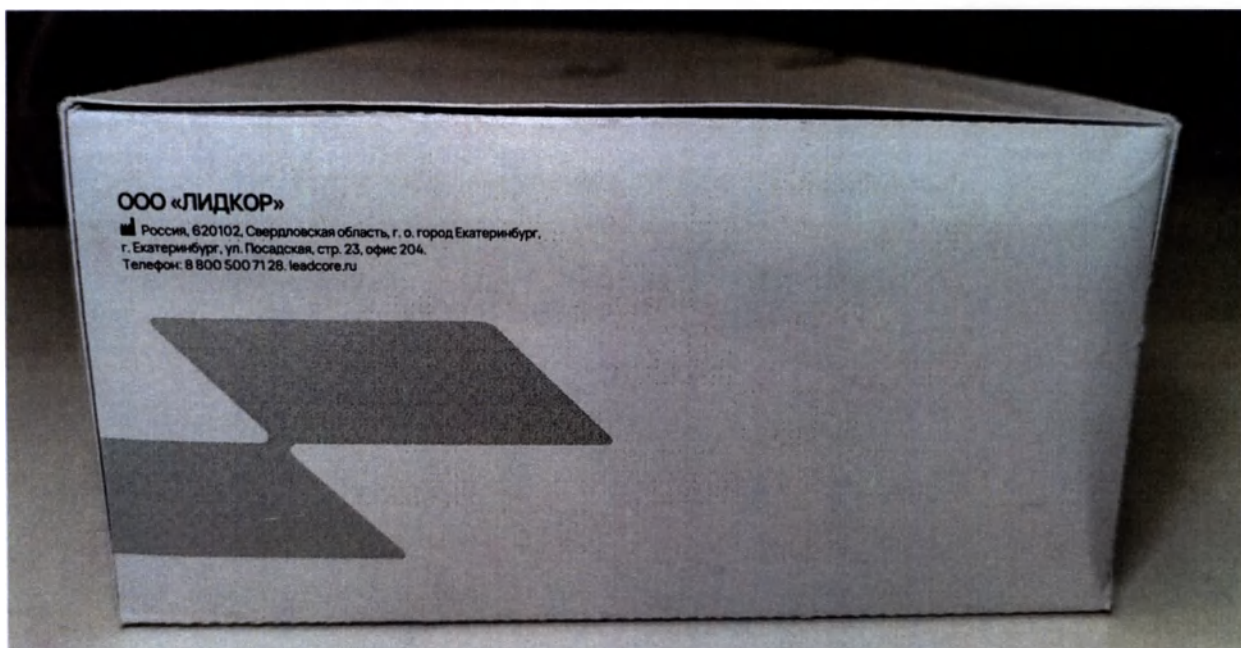

Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)




Потребительская упаковка 1000 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)

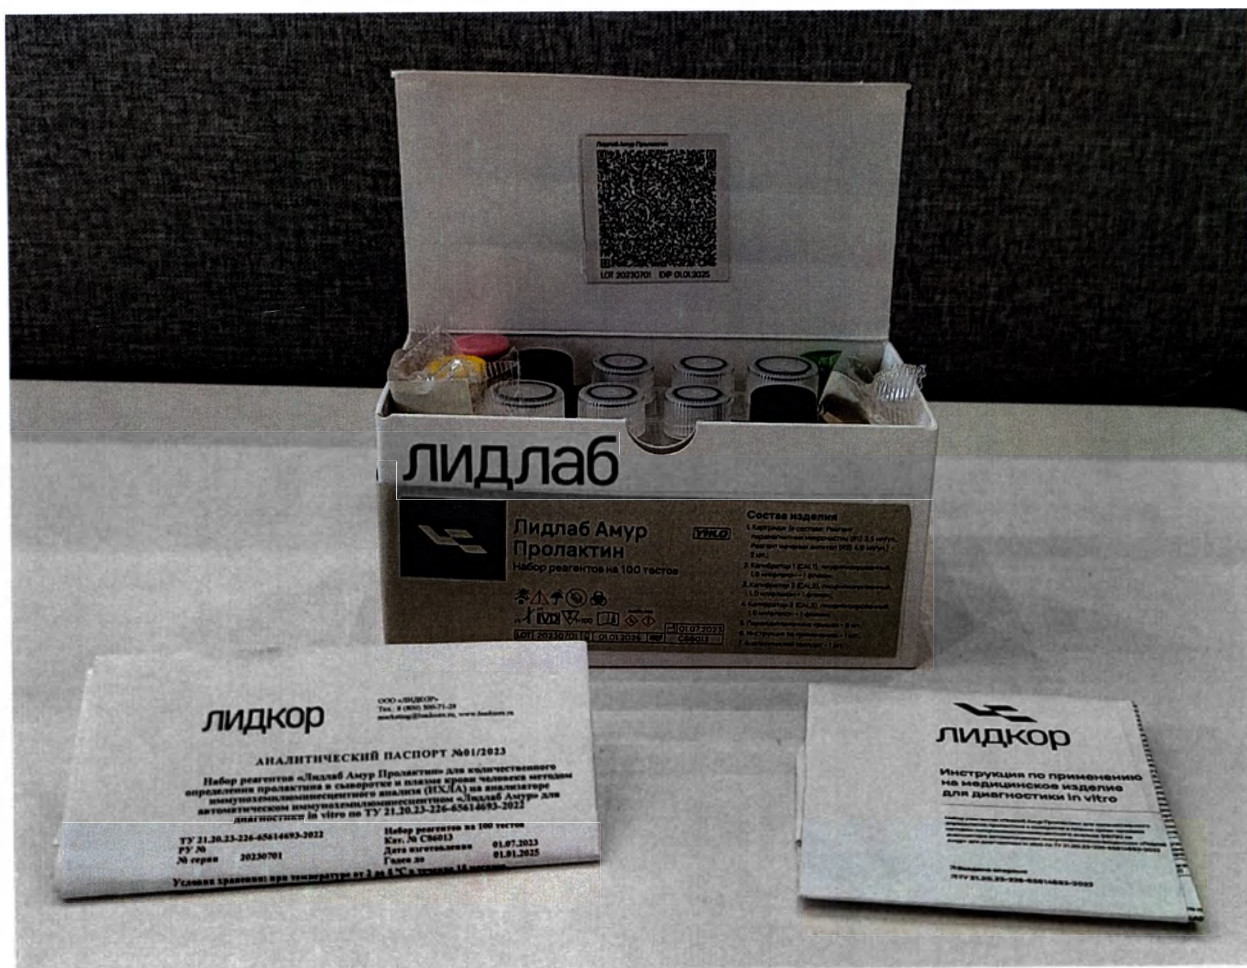




Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.

Групповое фото.



Транспортная упаковка

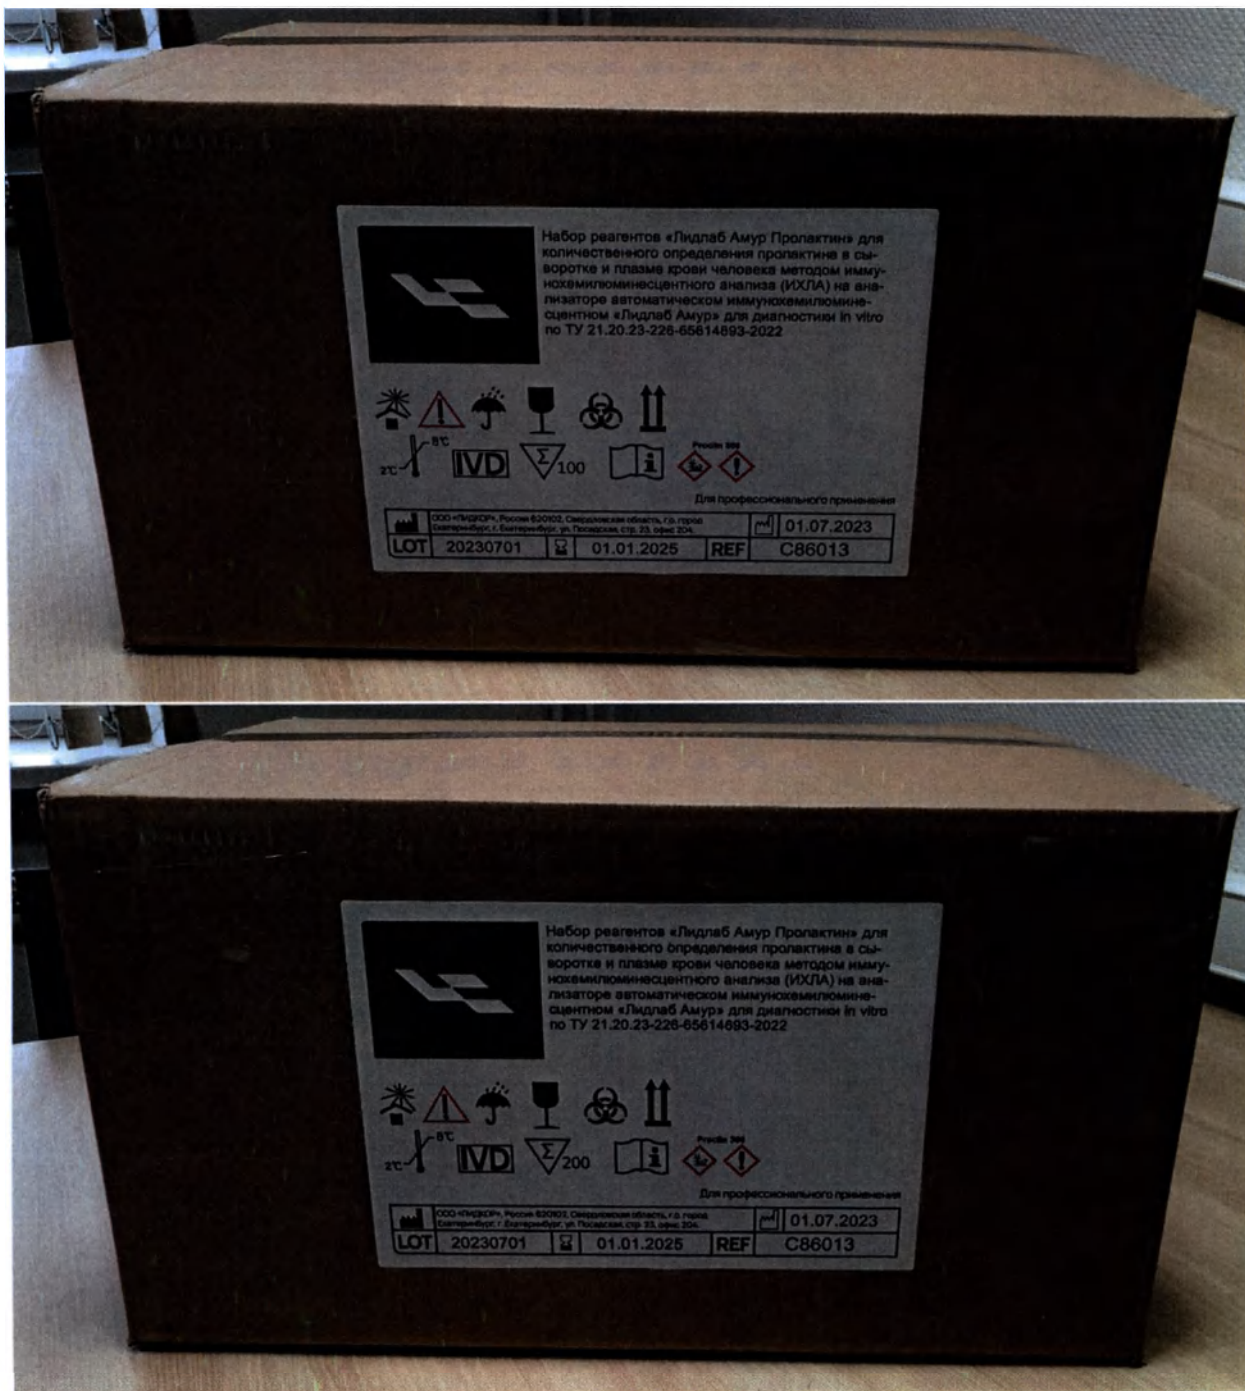

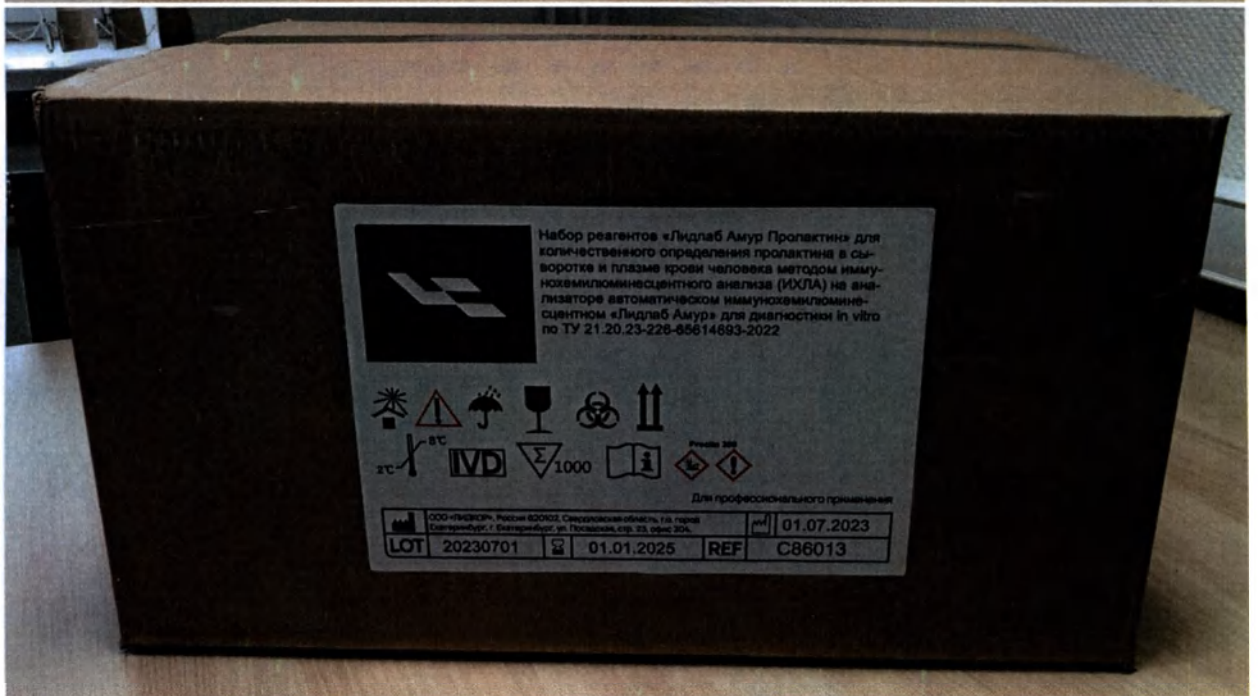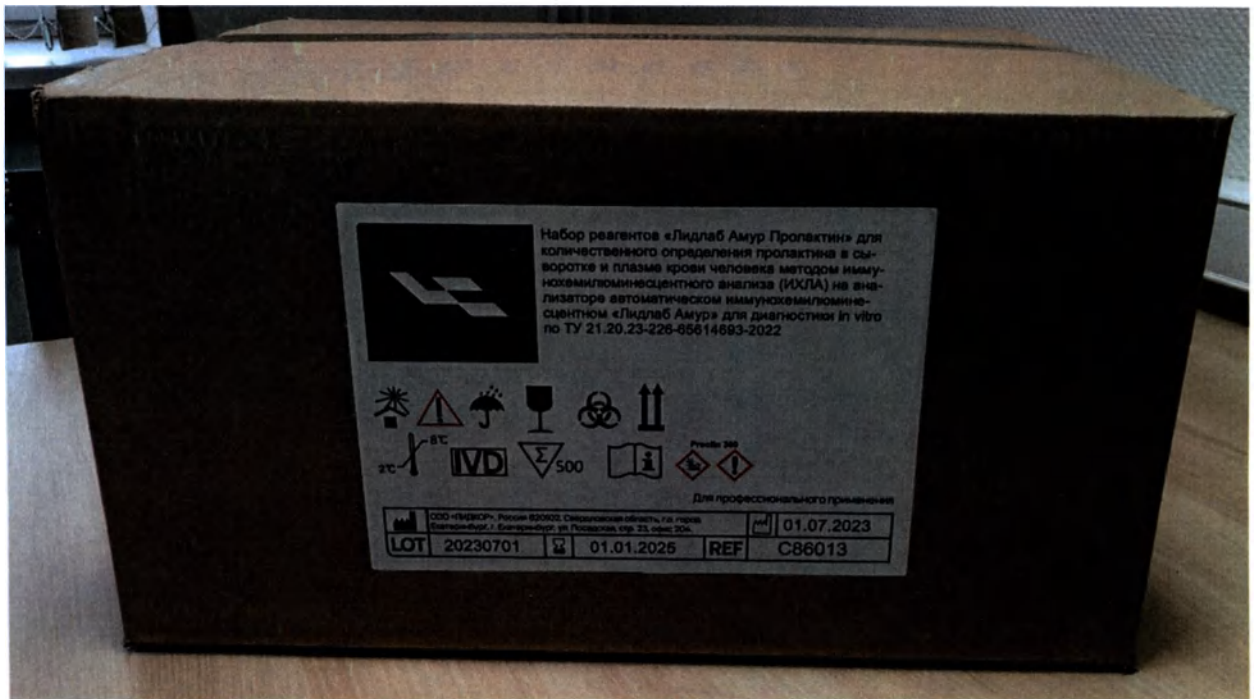

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

13 (приложить) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

