

ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Сюн Вэй.
2023 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СЫСОВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (АТ III
Con) методом хромогенного анализа в клиническом образце человека на
анализаторах серии СХ для диагностики in vitro

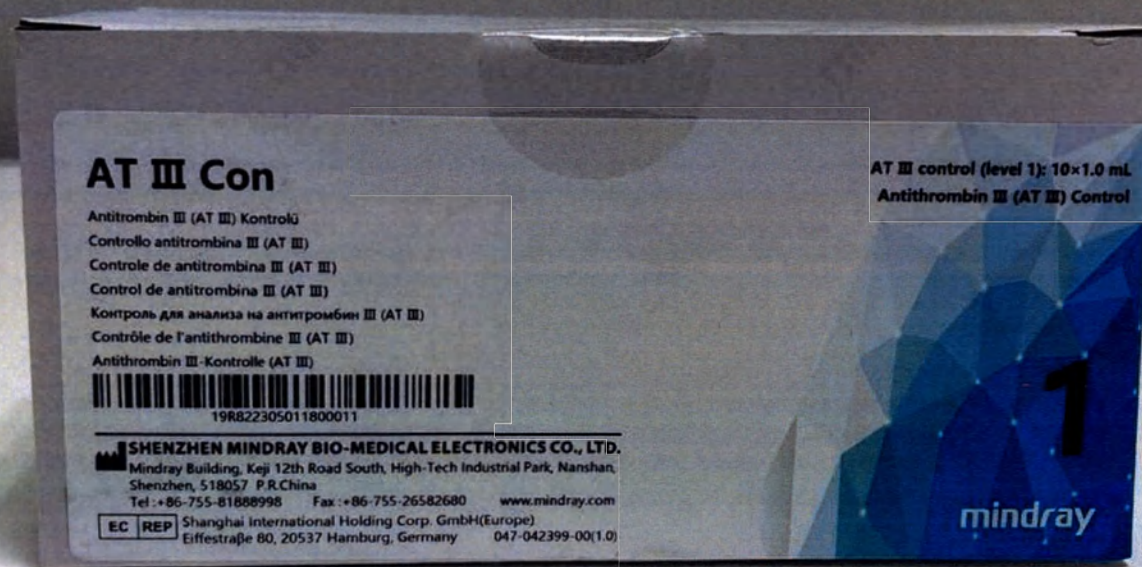


Рисунок 1 Внешняя упаковка Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (AT III Con) методом хромогенного анализа в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 1) 10 фл. x 1,0 мл (вид 1)

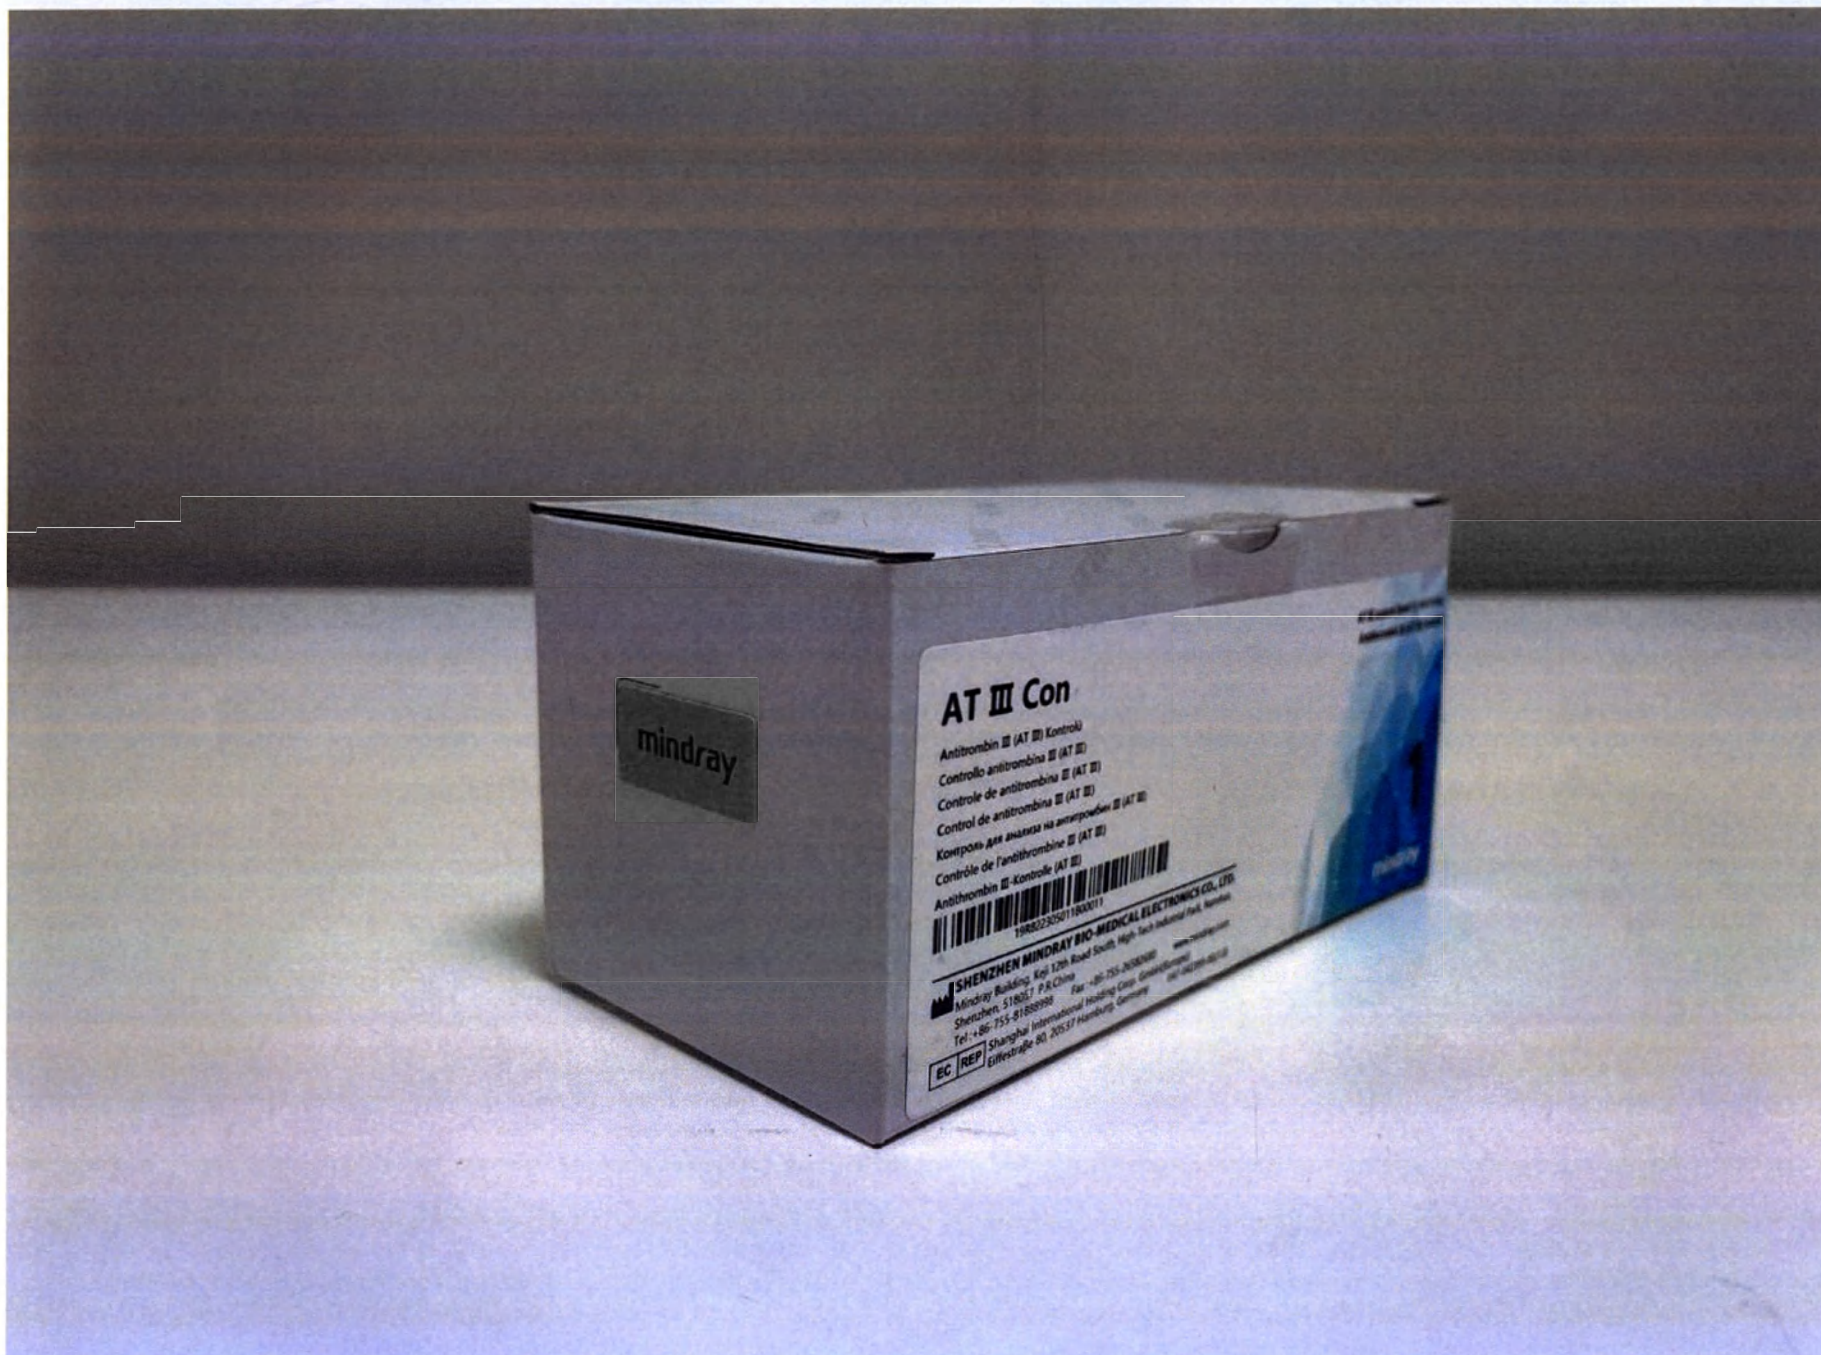


Рисунок 2 Внешняя упаковка Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (AT III Con) методом хромогенного анализа в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 1) 10 фл. x 1,0 мл (вид 2)

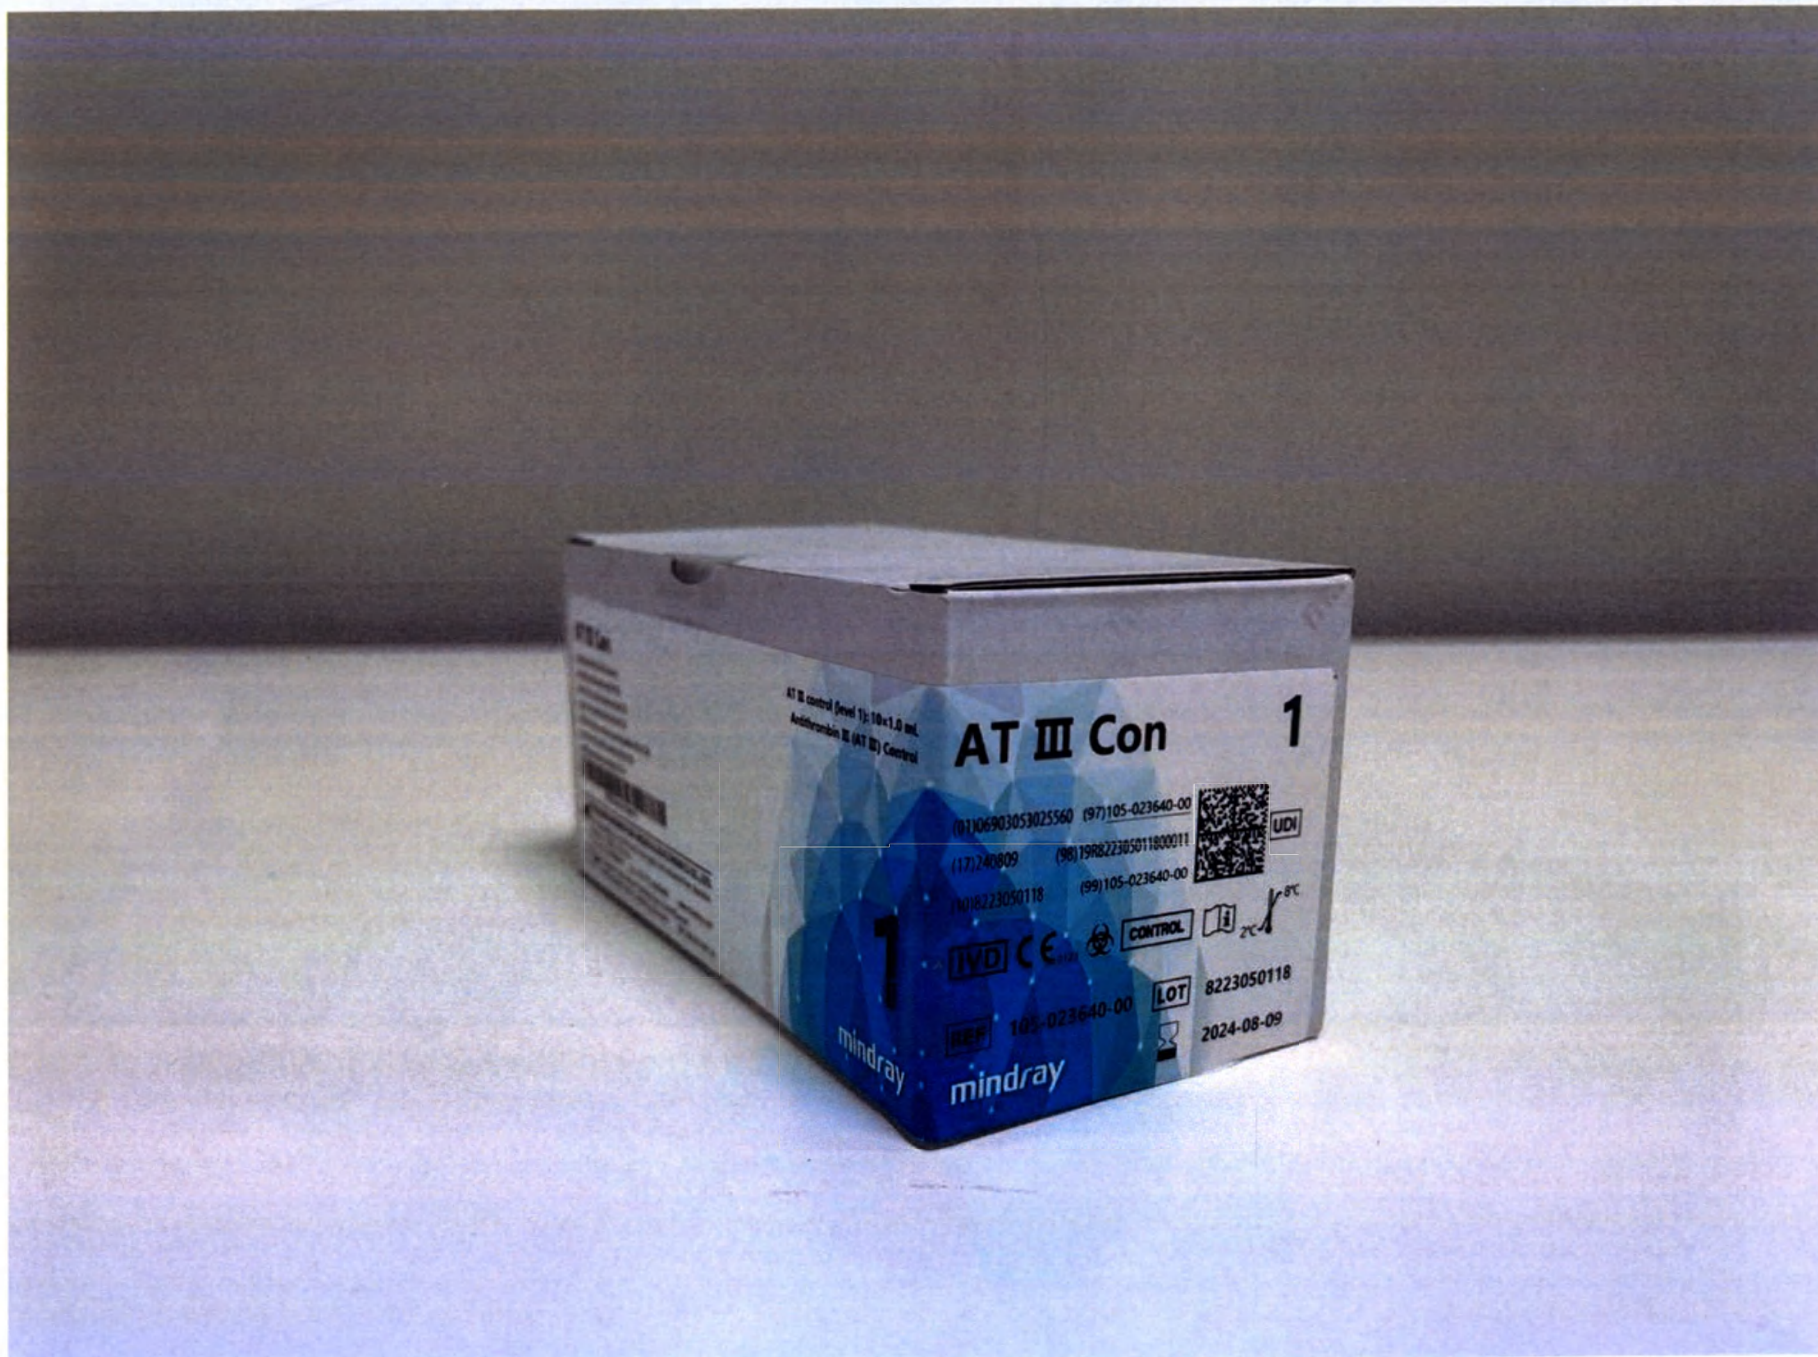


Рисунок 3 Внешняя упаковка Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (AT III Con) методом хромогенного анализа в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 1) 10 фл. x 1,0 мл (вид 3)



Рисунок 4 Внешняя упаковка Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (АТ III Con) методом хромогенного анализа в клиническом образце человека на анализаторах серии СХ для диагностики in vitro (уровень 1) 10 фл. x 1,0 мл (вид 4)

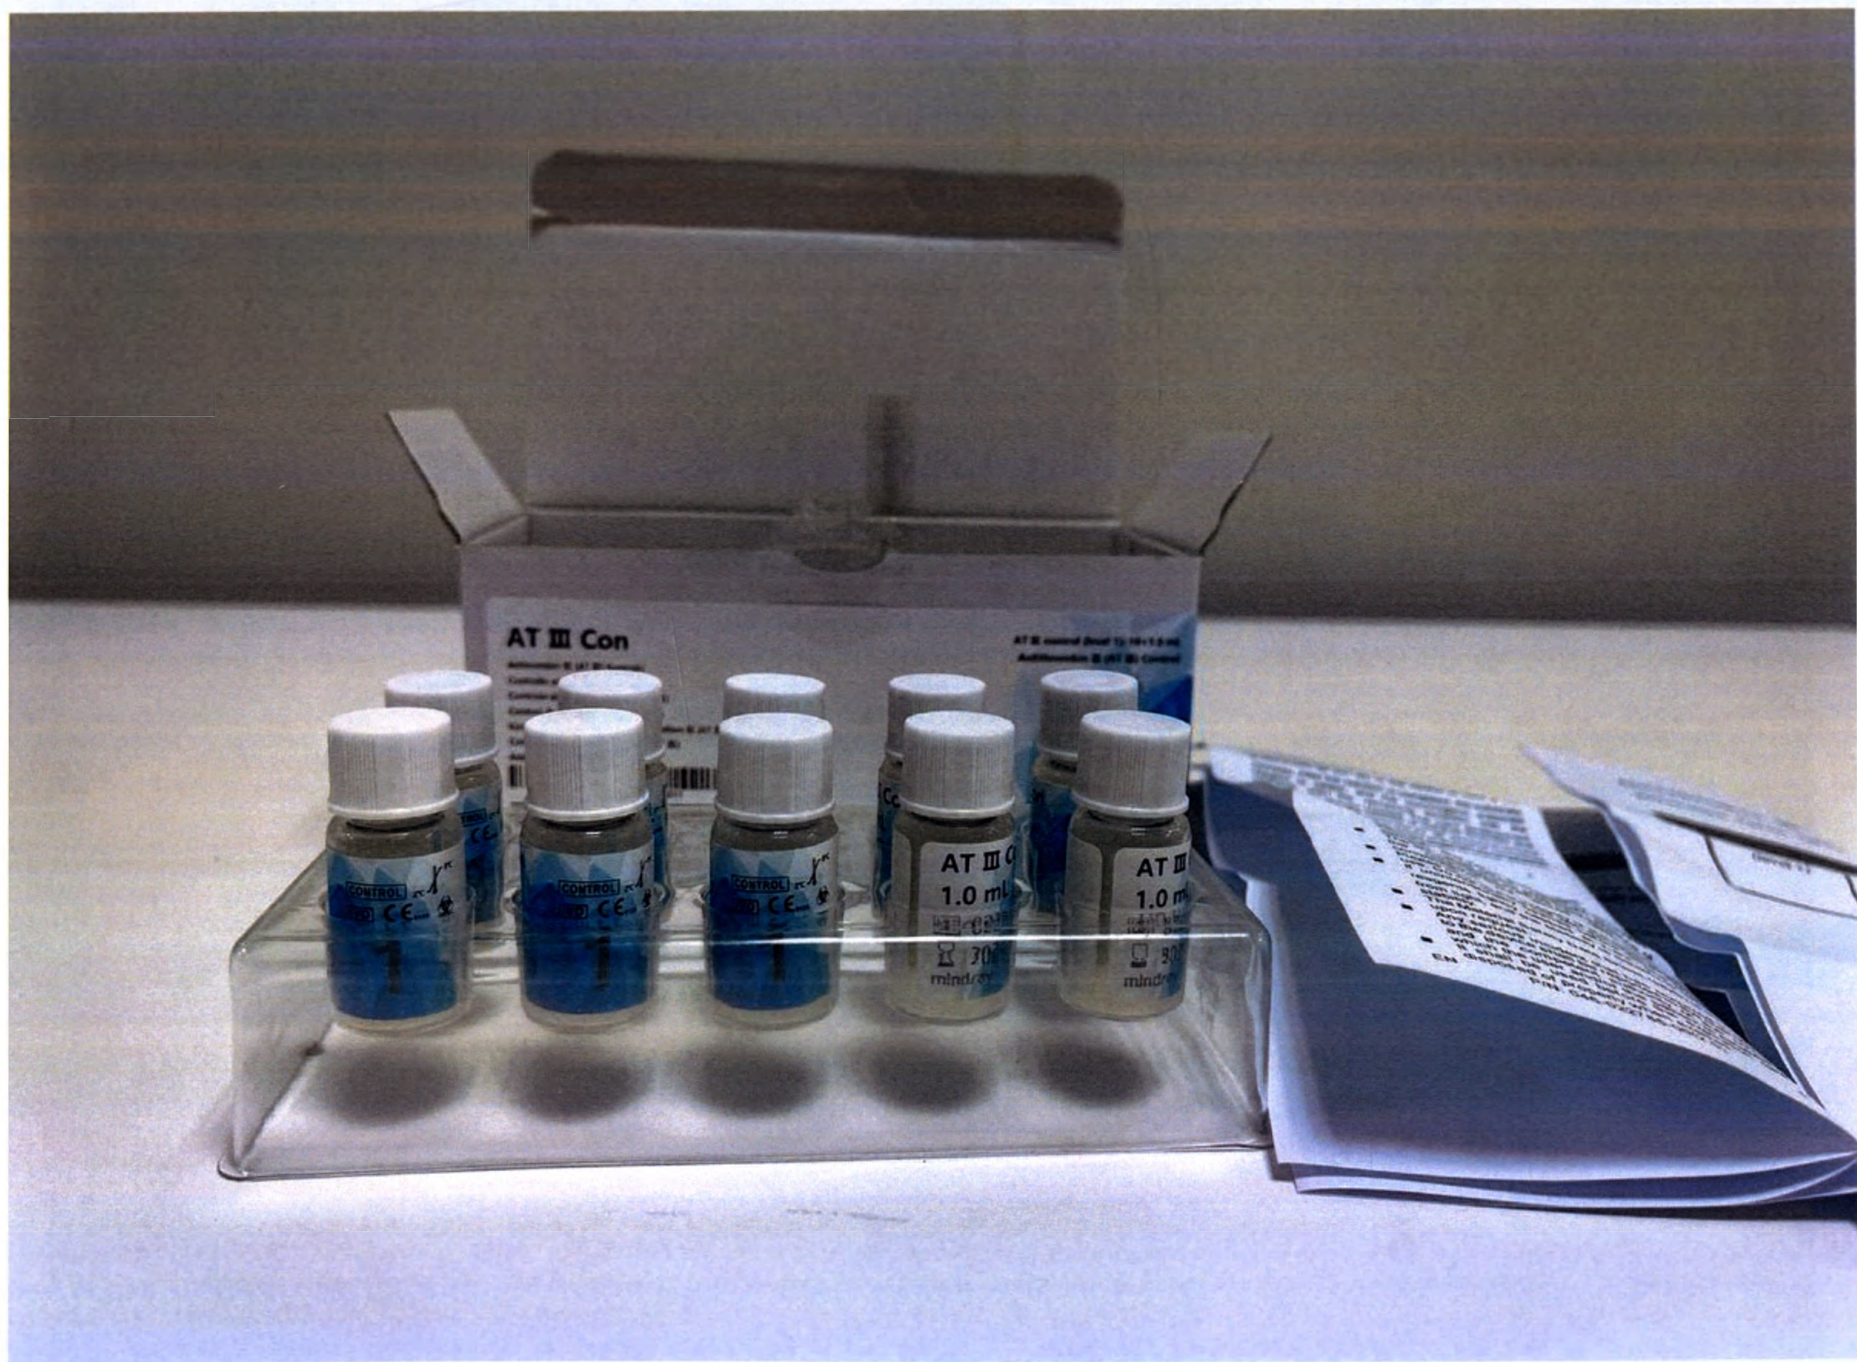


Рисунок 5 Общий вид Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (AT III Con) методом хромогенного анализа в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 1) 10 фл. x 1,0 мл

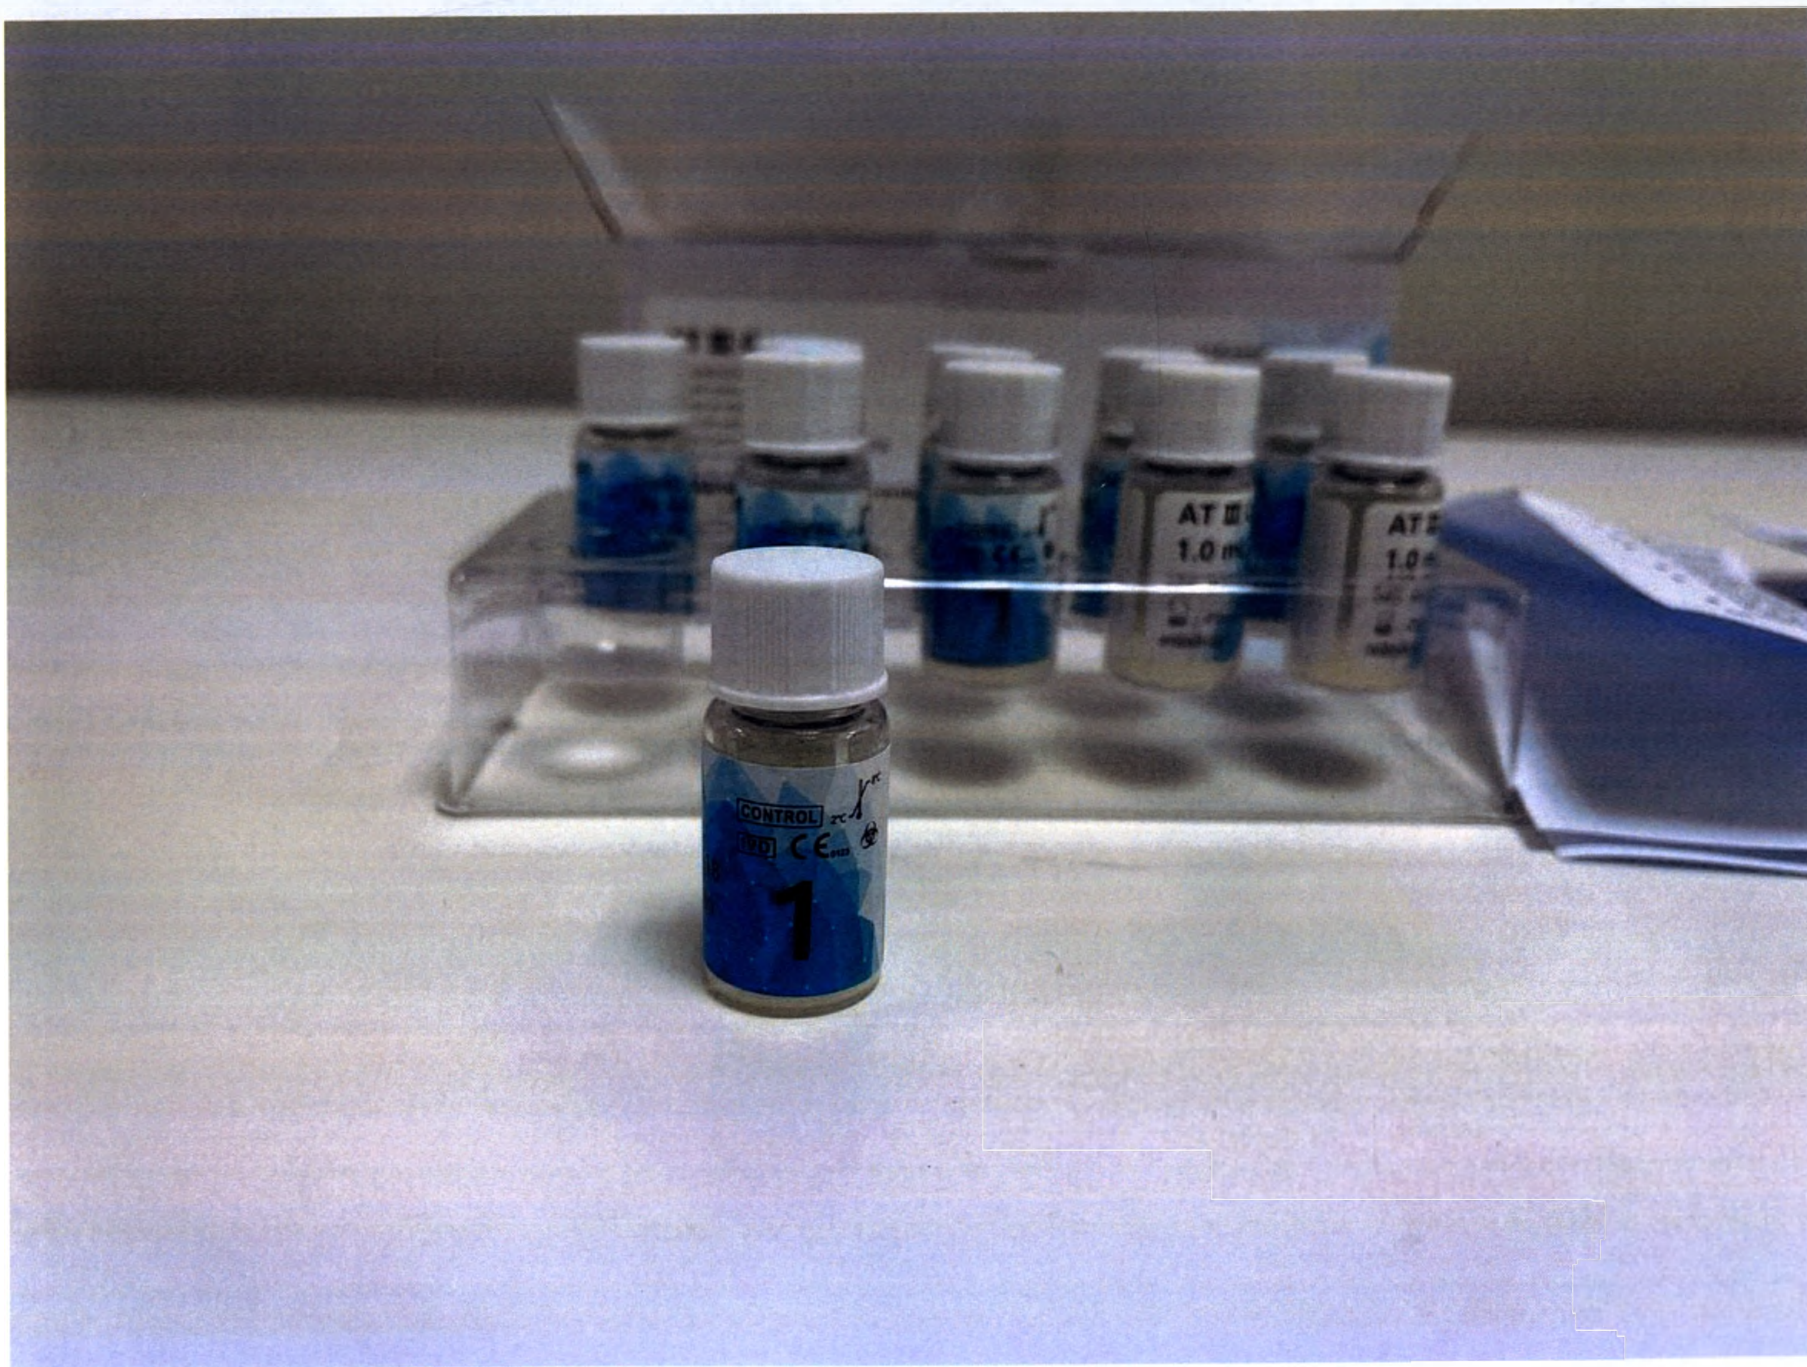


Рисунок 6 Флакон Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (АТ III Con) (уровень 1) (вид 1)

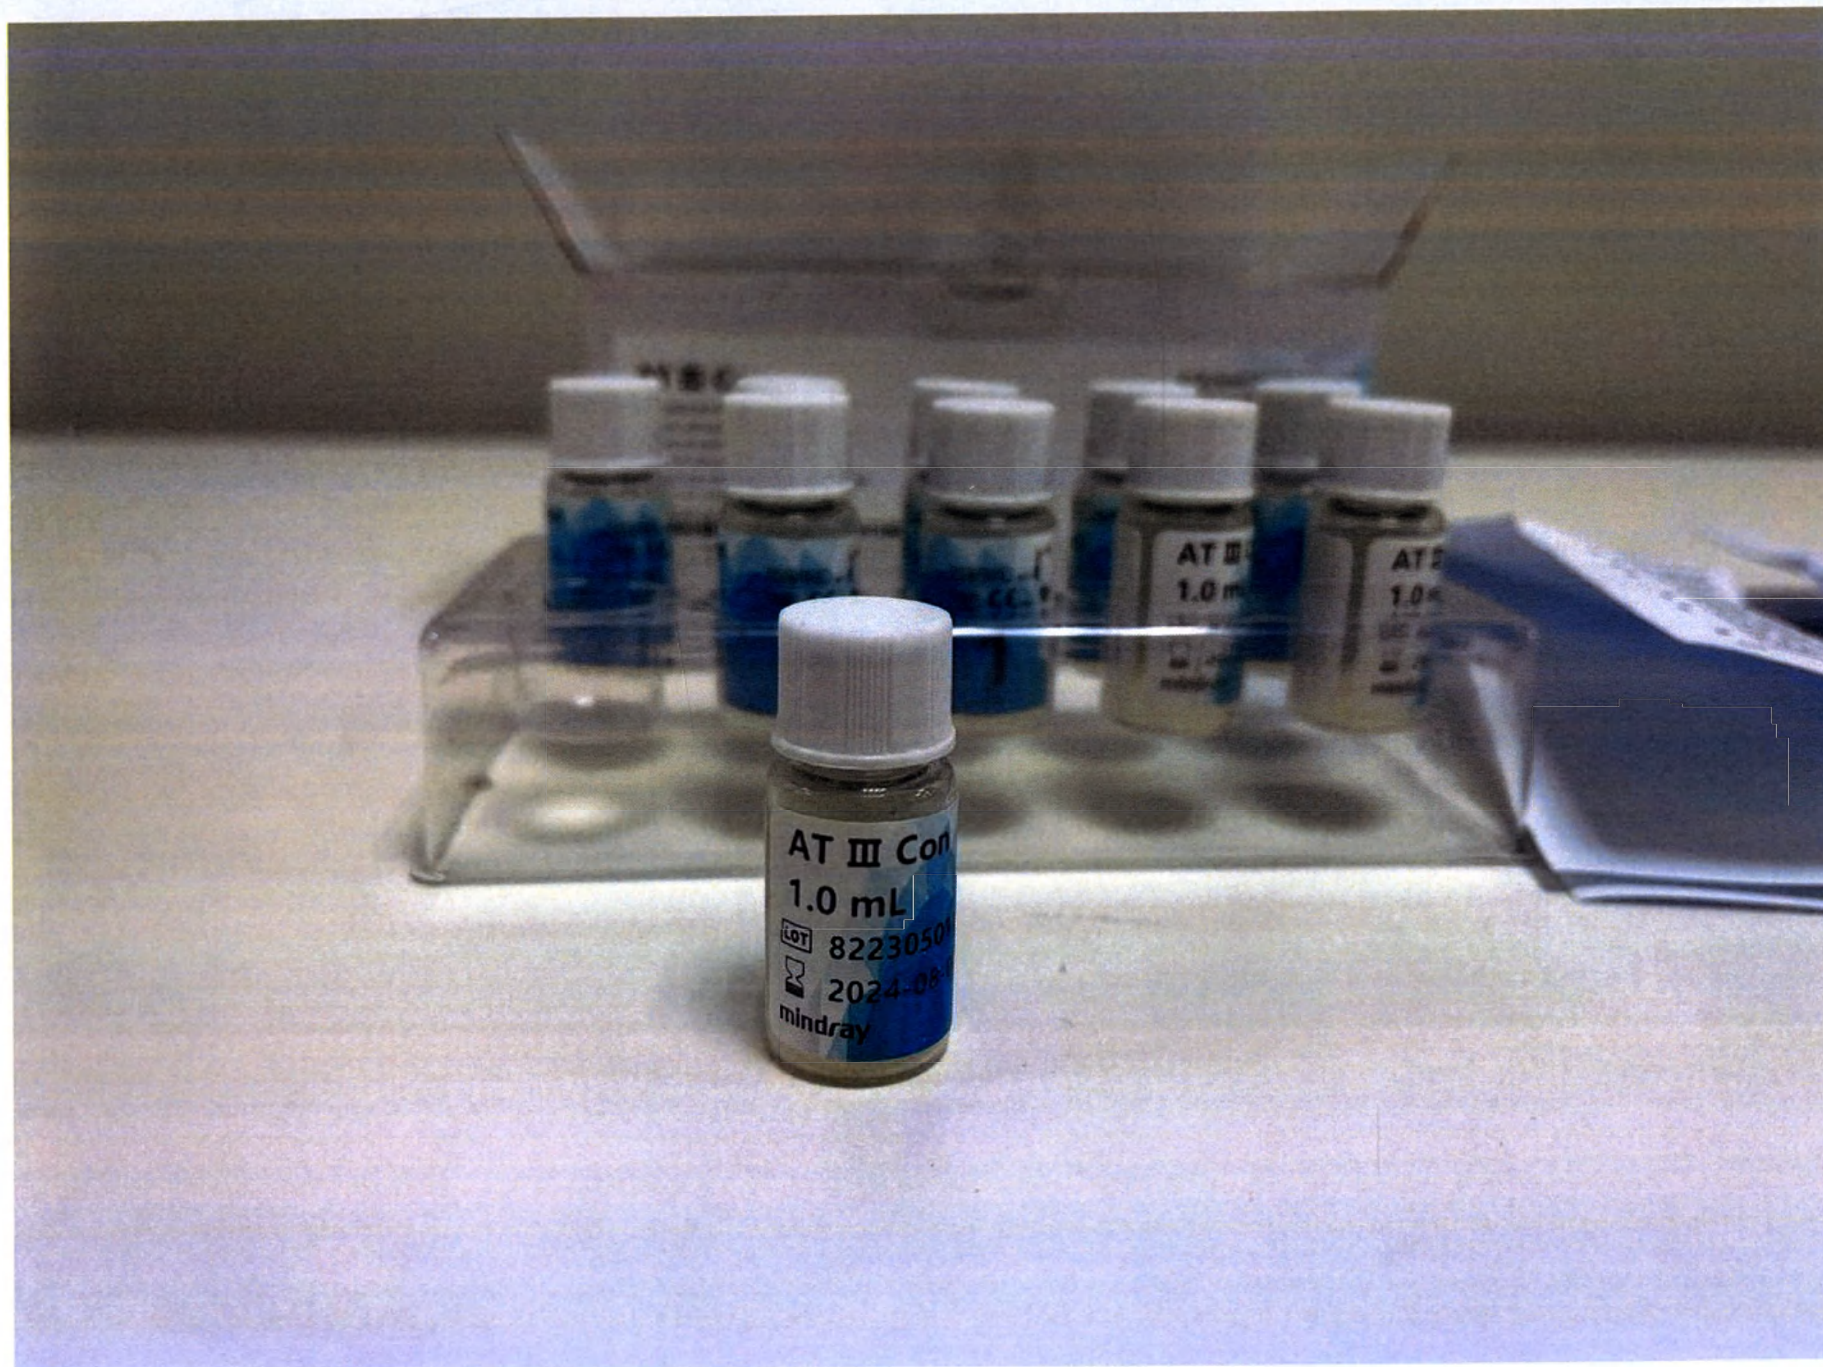


Рисунок 7 Флакон Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (АТ III Con) (уровень 1) (вид 2)



Рисунок 8 Флакон Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (АТ III Con) (уровень 1) (вид 3)

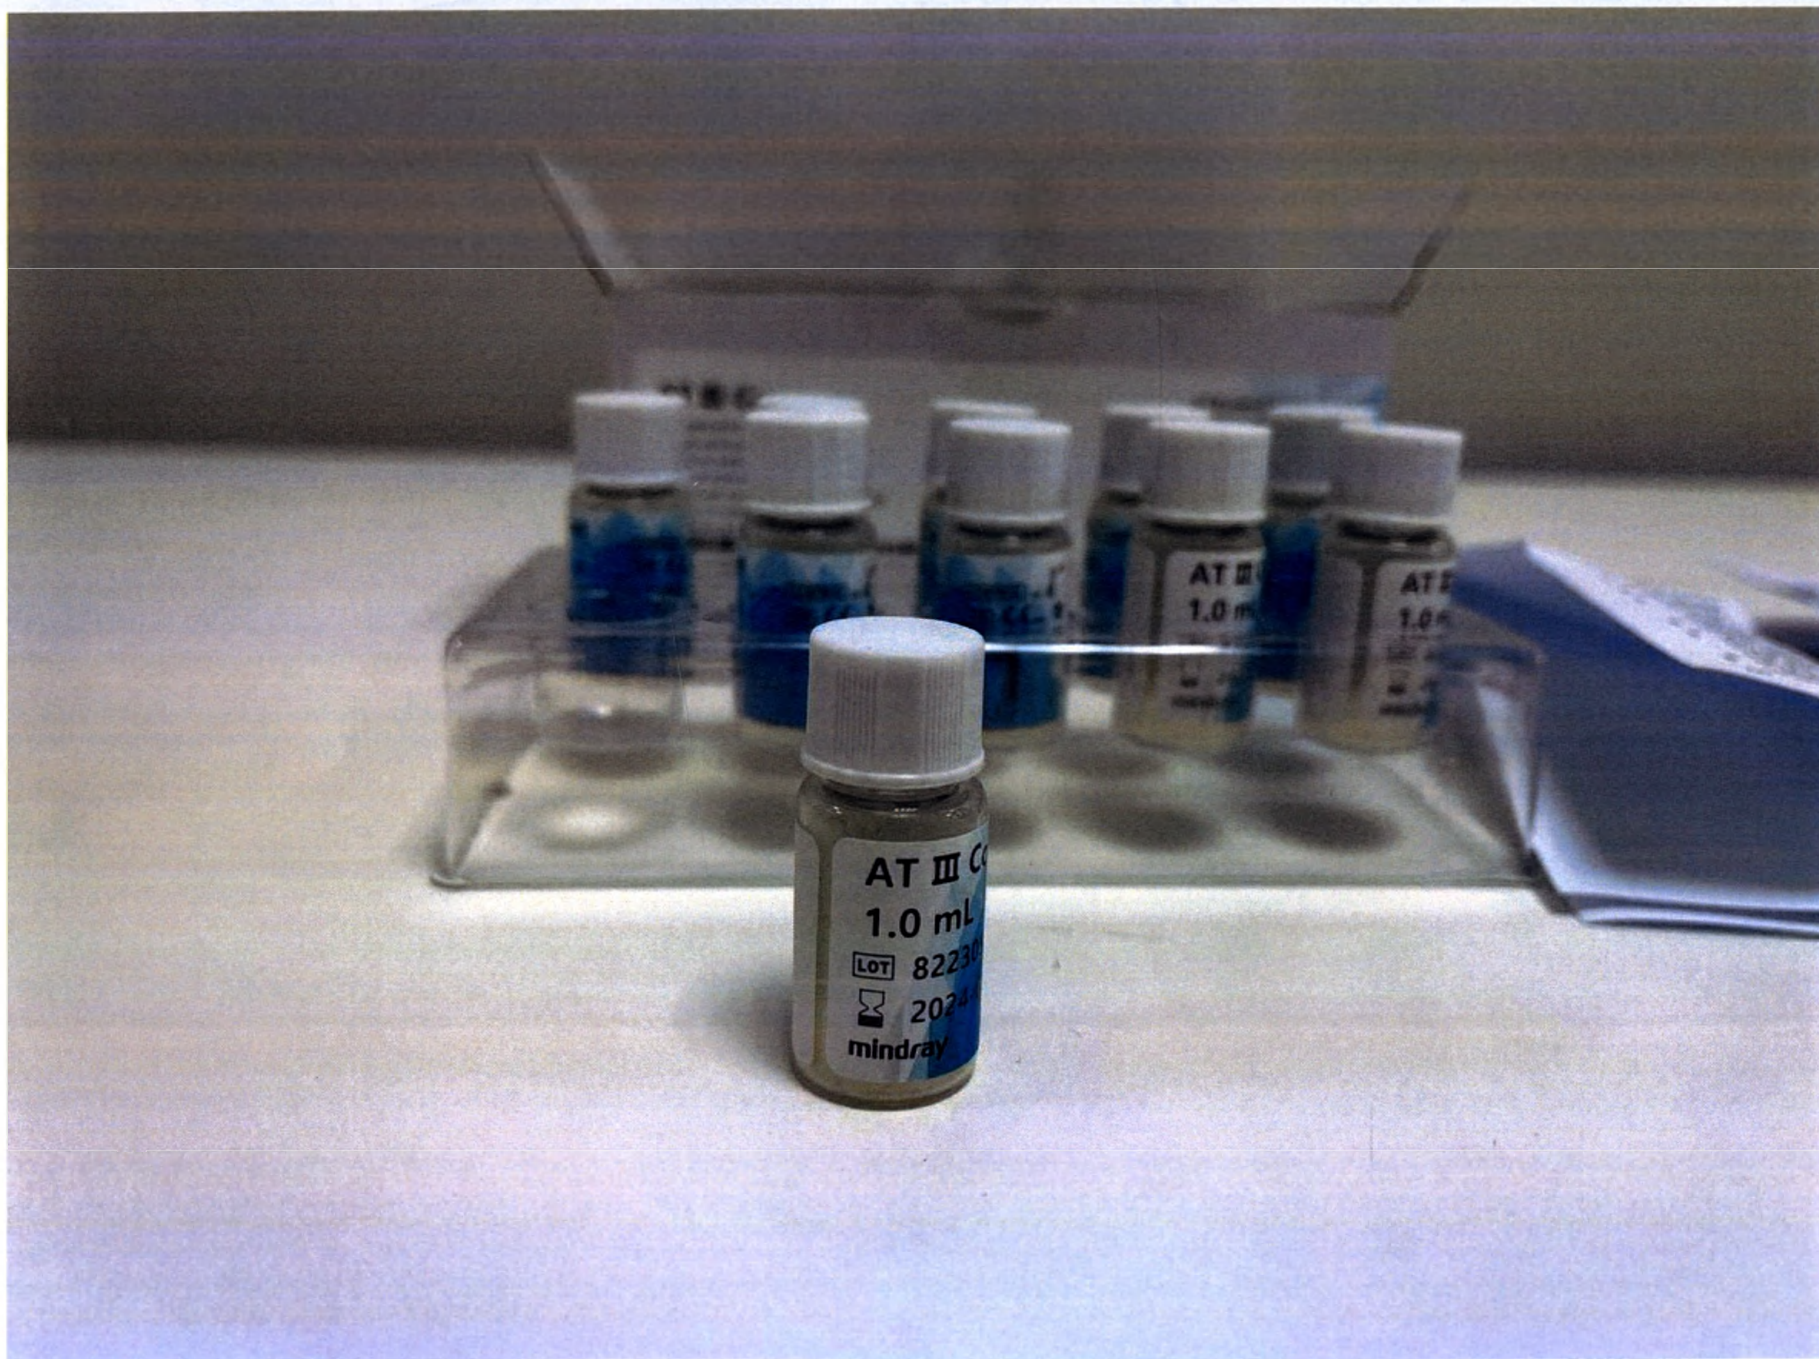


Рисунок 9 Флакон Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (AT III Con) (уровень 1) (вид 4)



Рисунок 10 Внешняя упаковка Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (АТ III Con) методом хромогенного анализа в клиническом образце человека на анализаторах серии СХ для диагностики in vitro (уровень 2) 10 фл. х 1,0 мл (вид 1)

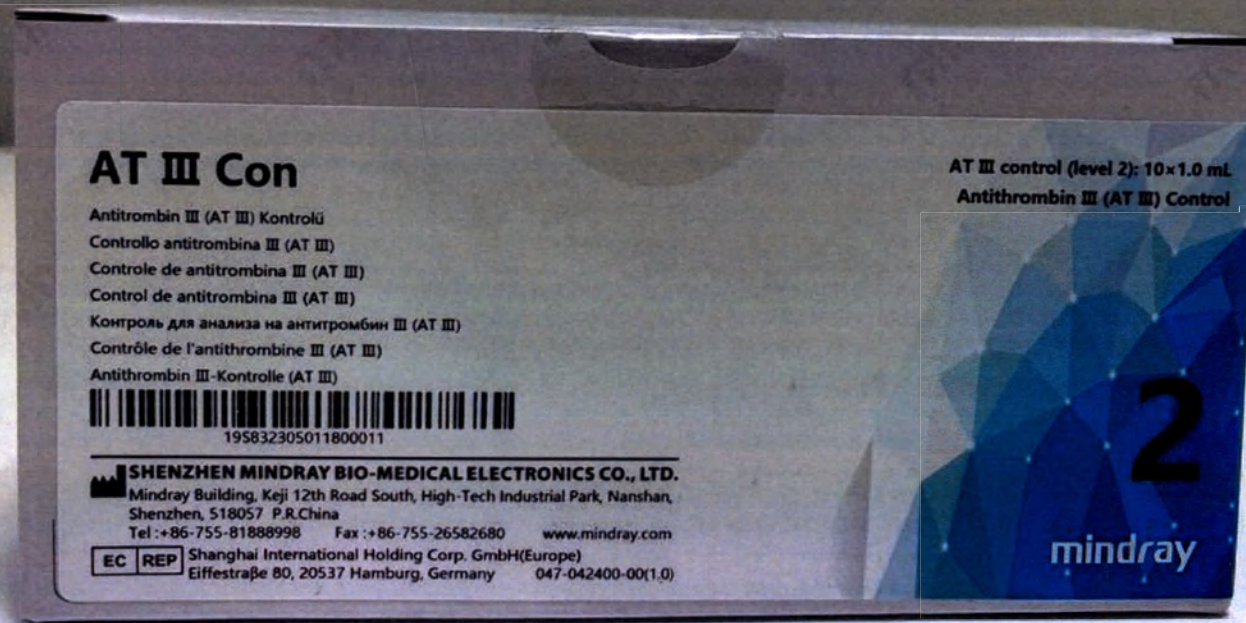


Рисунок 11 Внешняя упаковка Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (AT III Con) методом хромогенного анализа в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 2) 10 фл. х 1,0 мл (вид 2)



Рисунок 12 Внешняя упаковка Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (АТ III Con) методом хромогенного анализа в клиническом образце человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro (уровень 2) 10 фл. x 1,0 мл (вид 3)

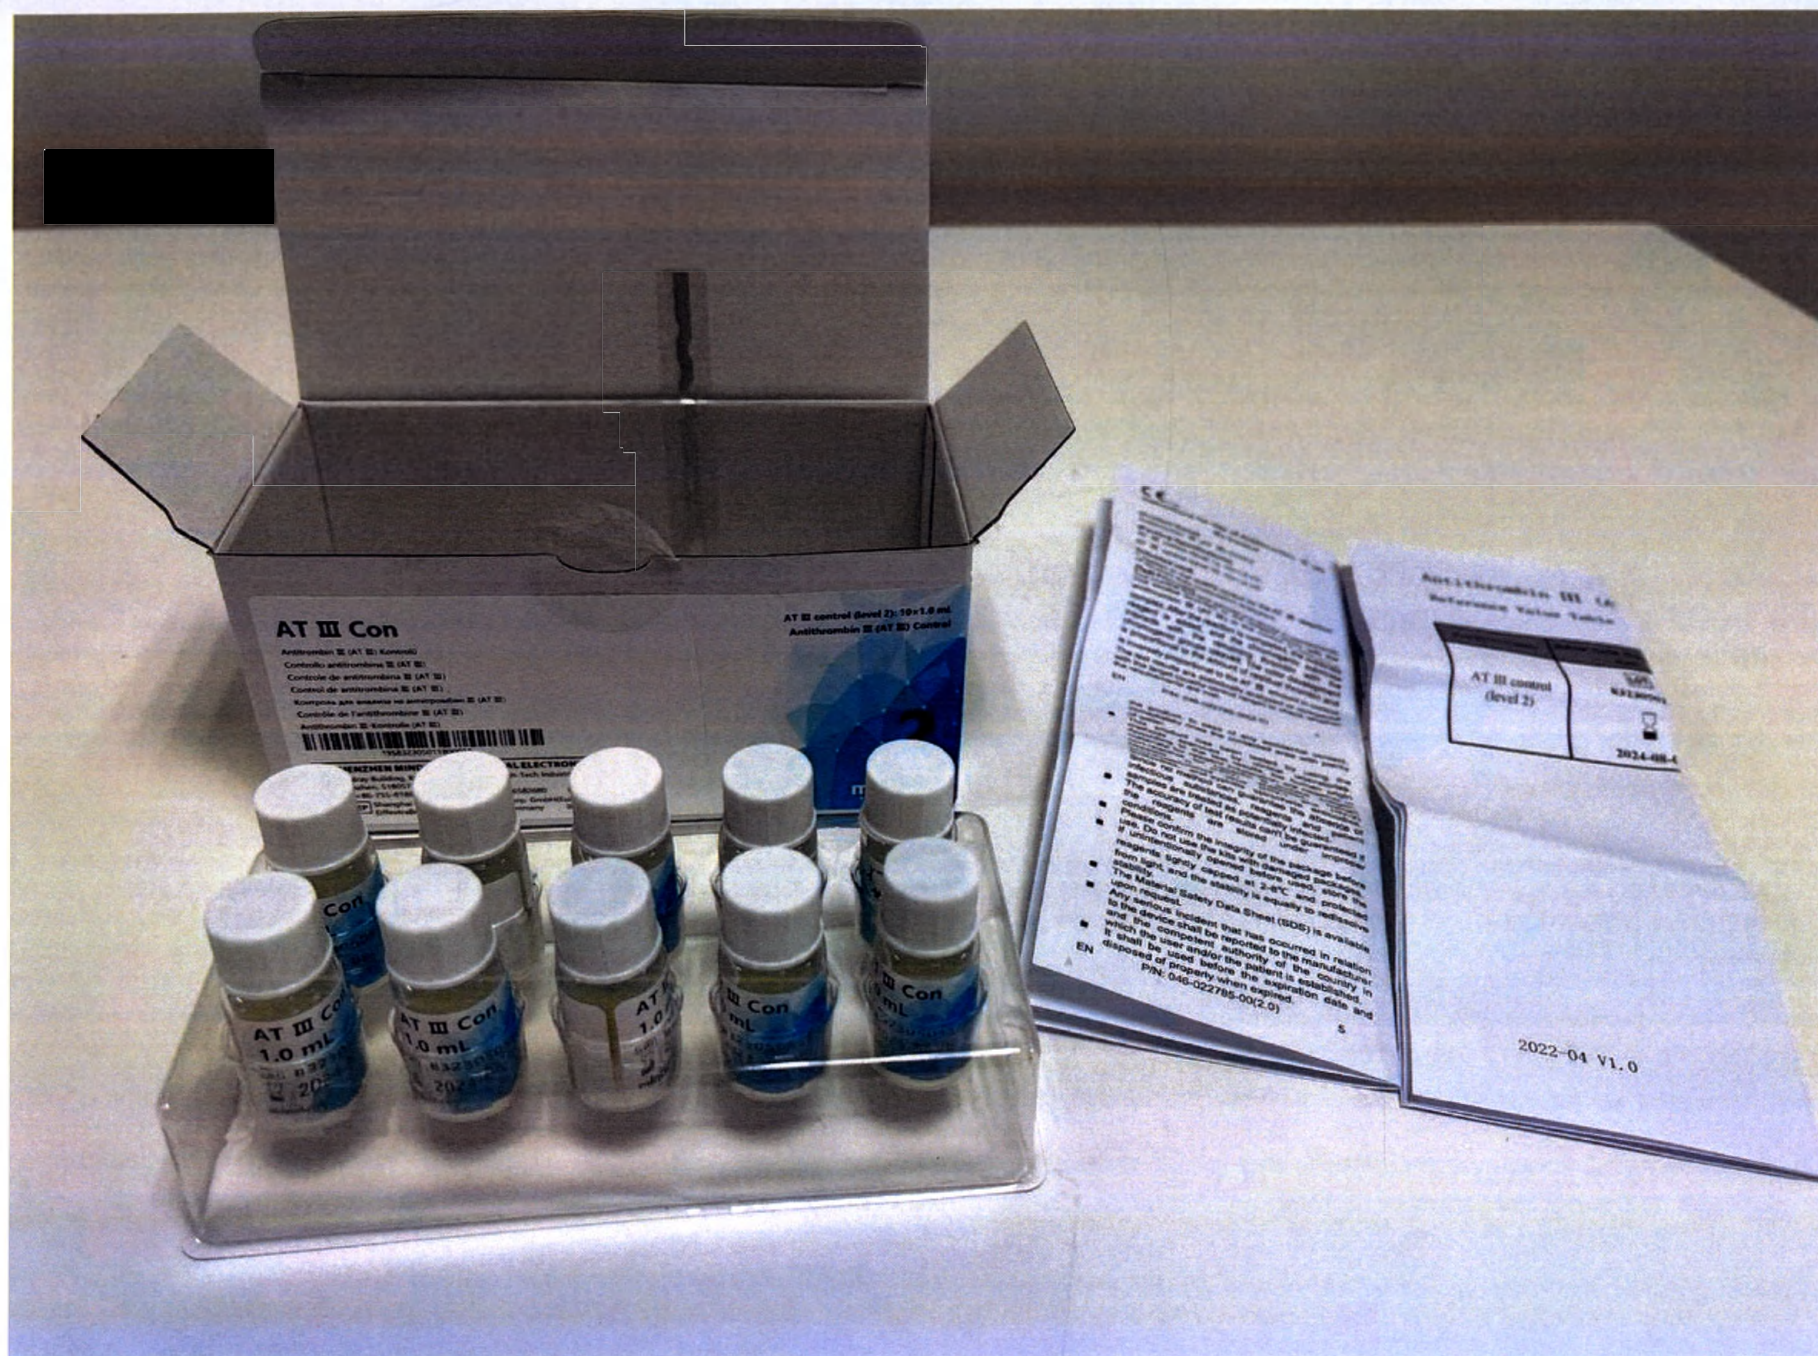


Рисунок 13 Общий вид Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (АТ III Con) методом хромогенного анализа в клиническом образце человека на анализаторах серии СХ для диагностики in vitro (уровень 2) 10 фл. х 1,0 мл

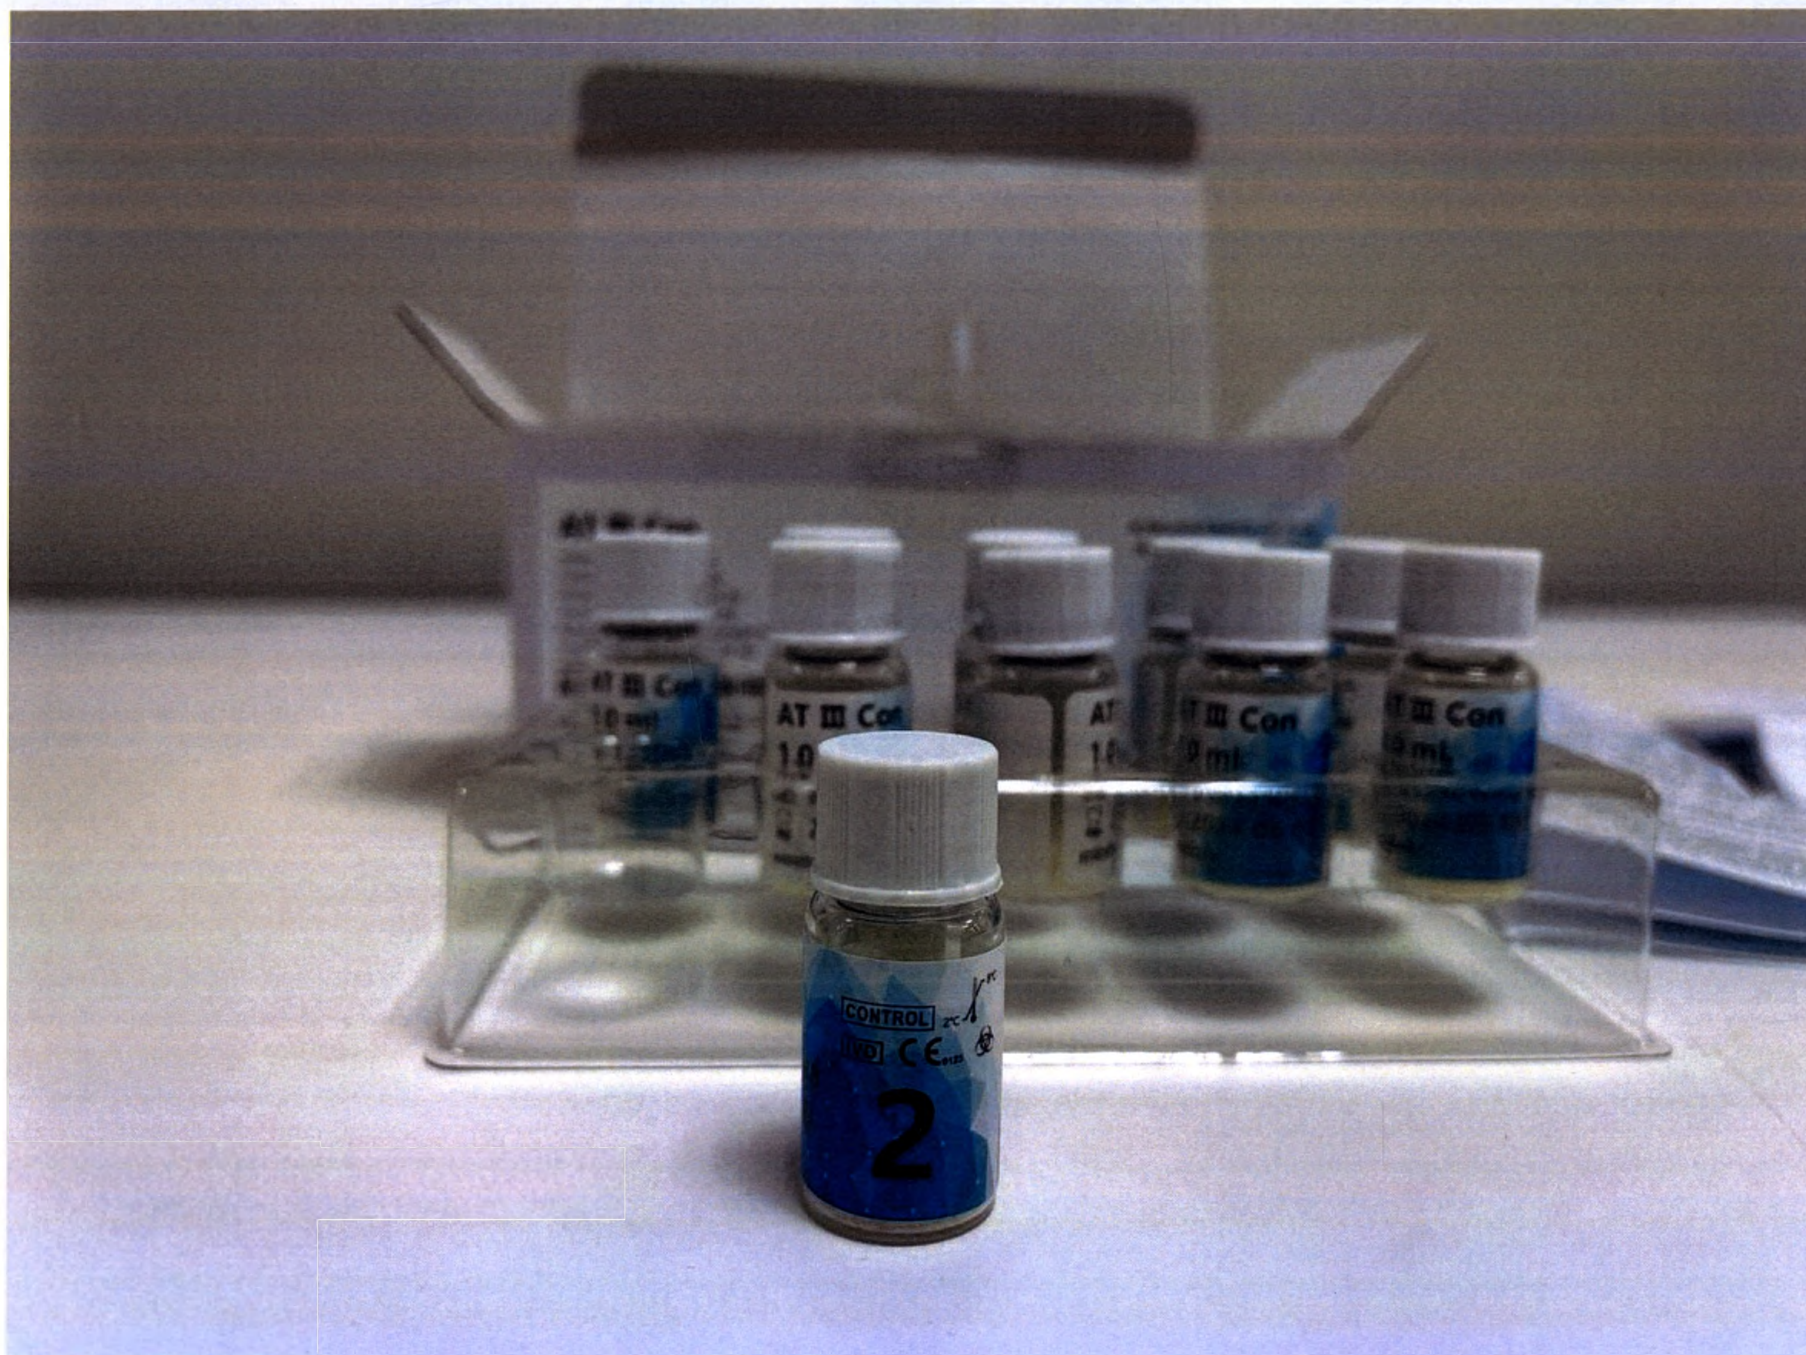


Рисунок 14 Флакон Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (АТ III Con) (уровень 2) (вид 1)

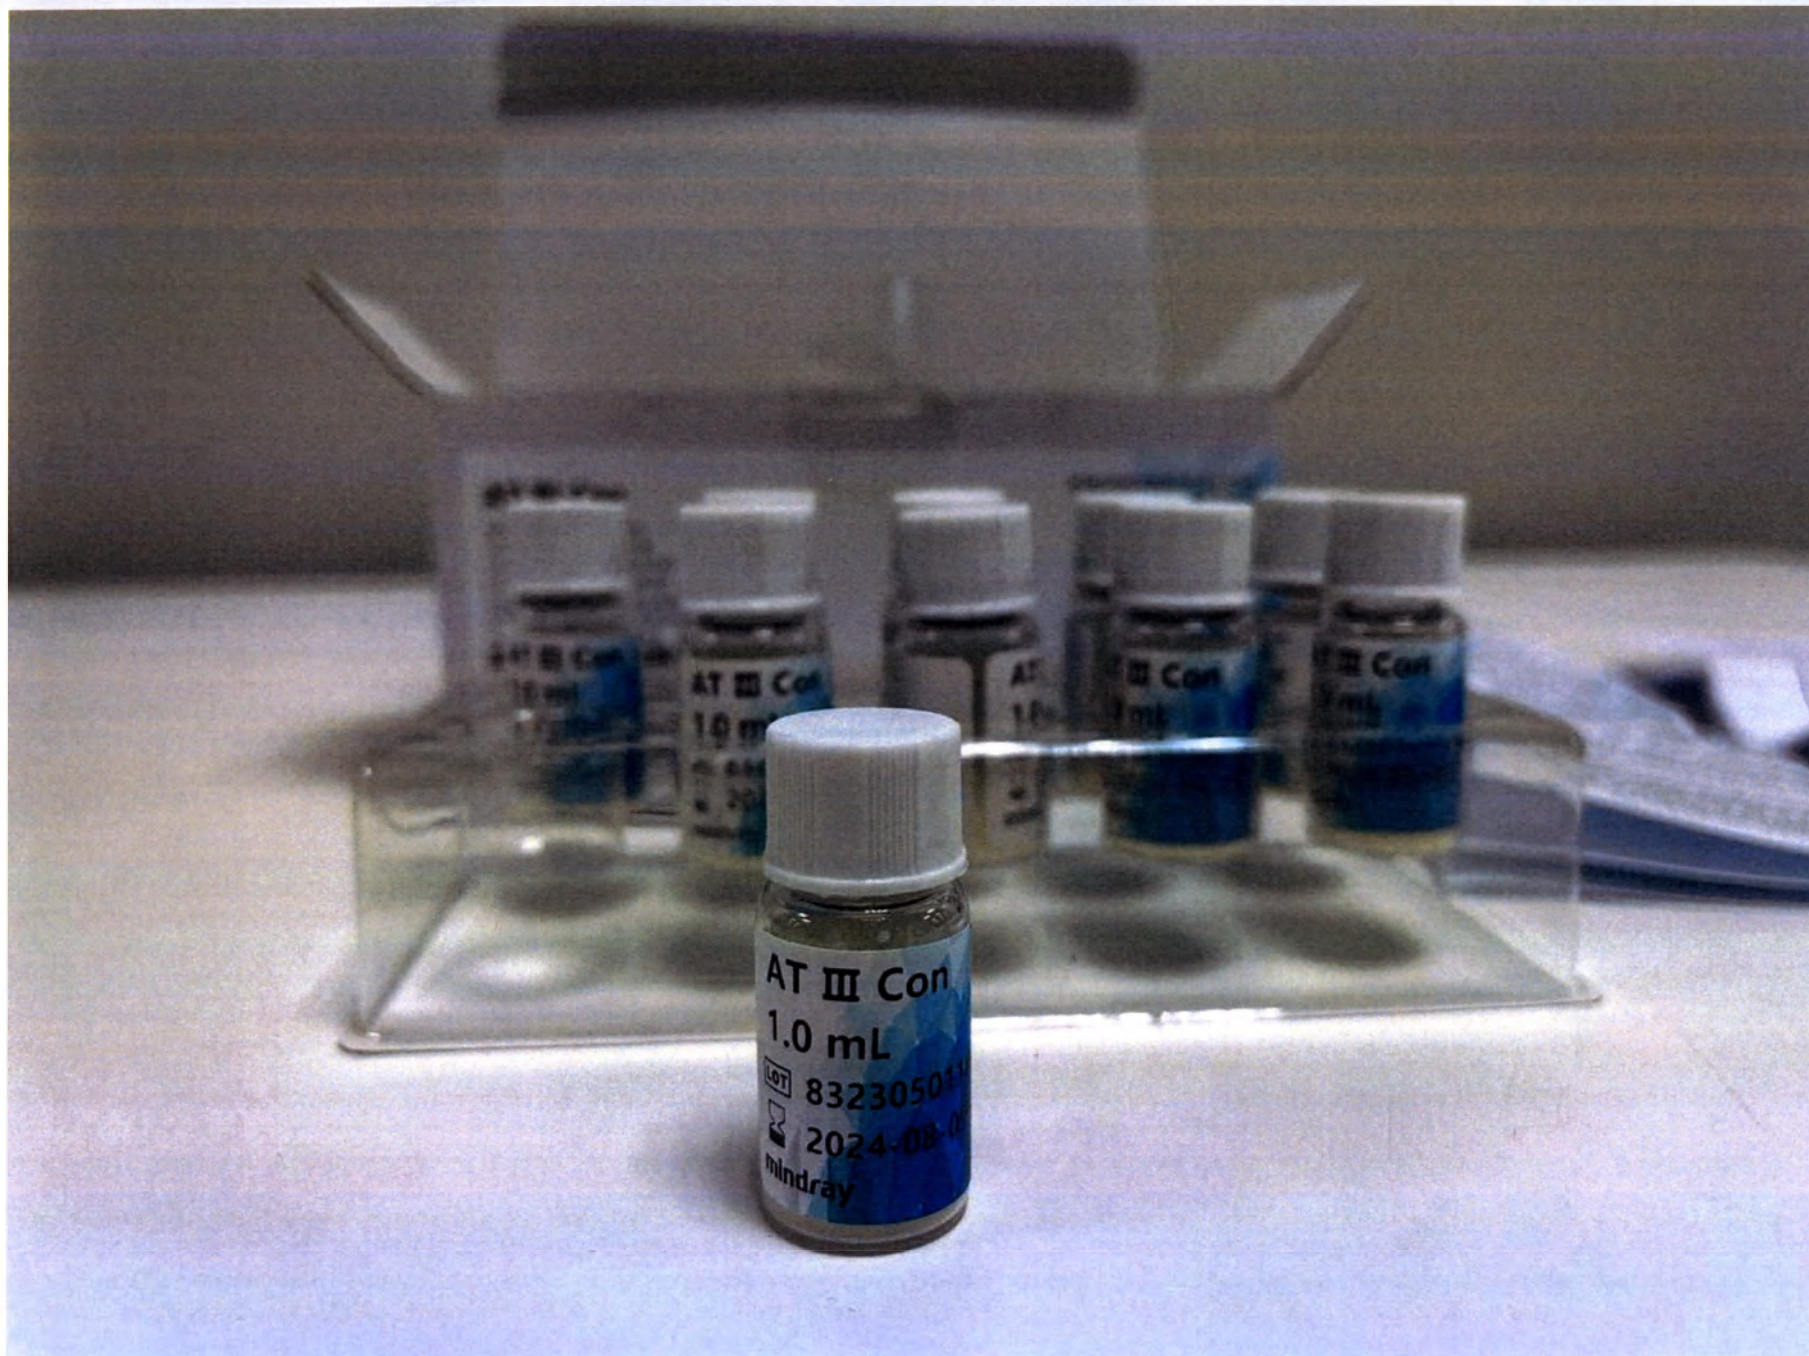


Рисунок 15 Флакон Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (AT III Con) (уровень 2) (вид 2)

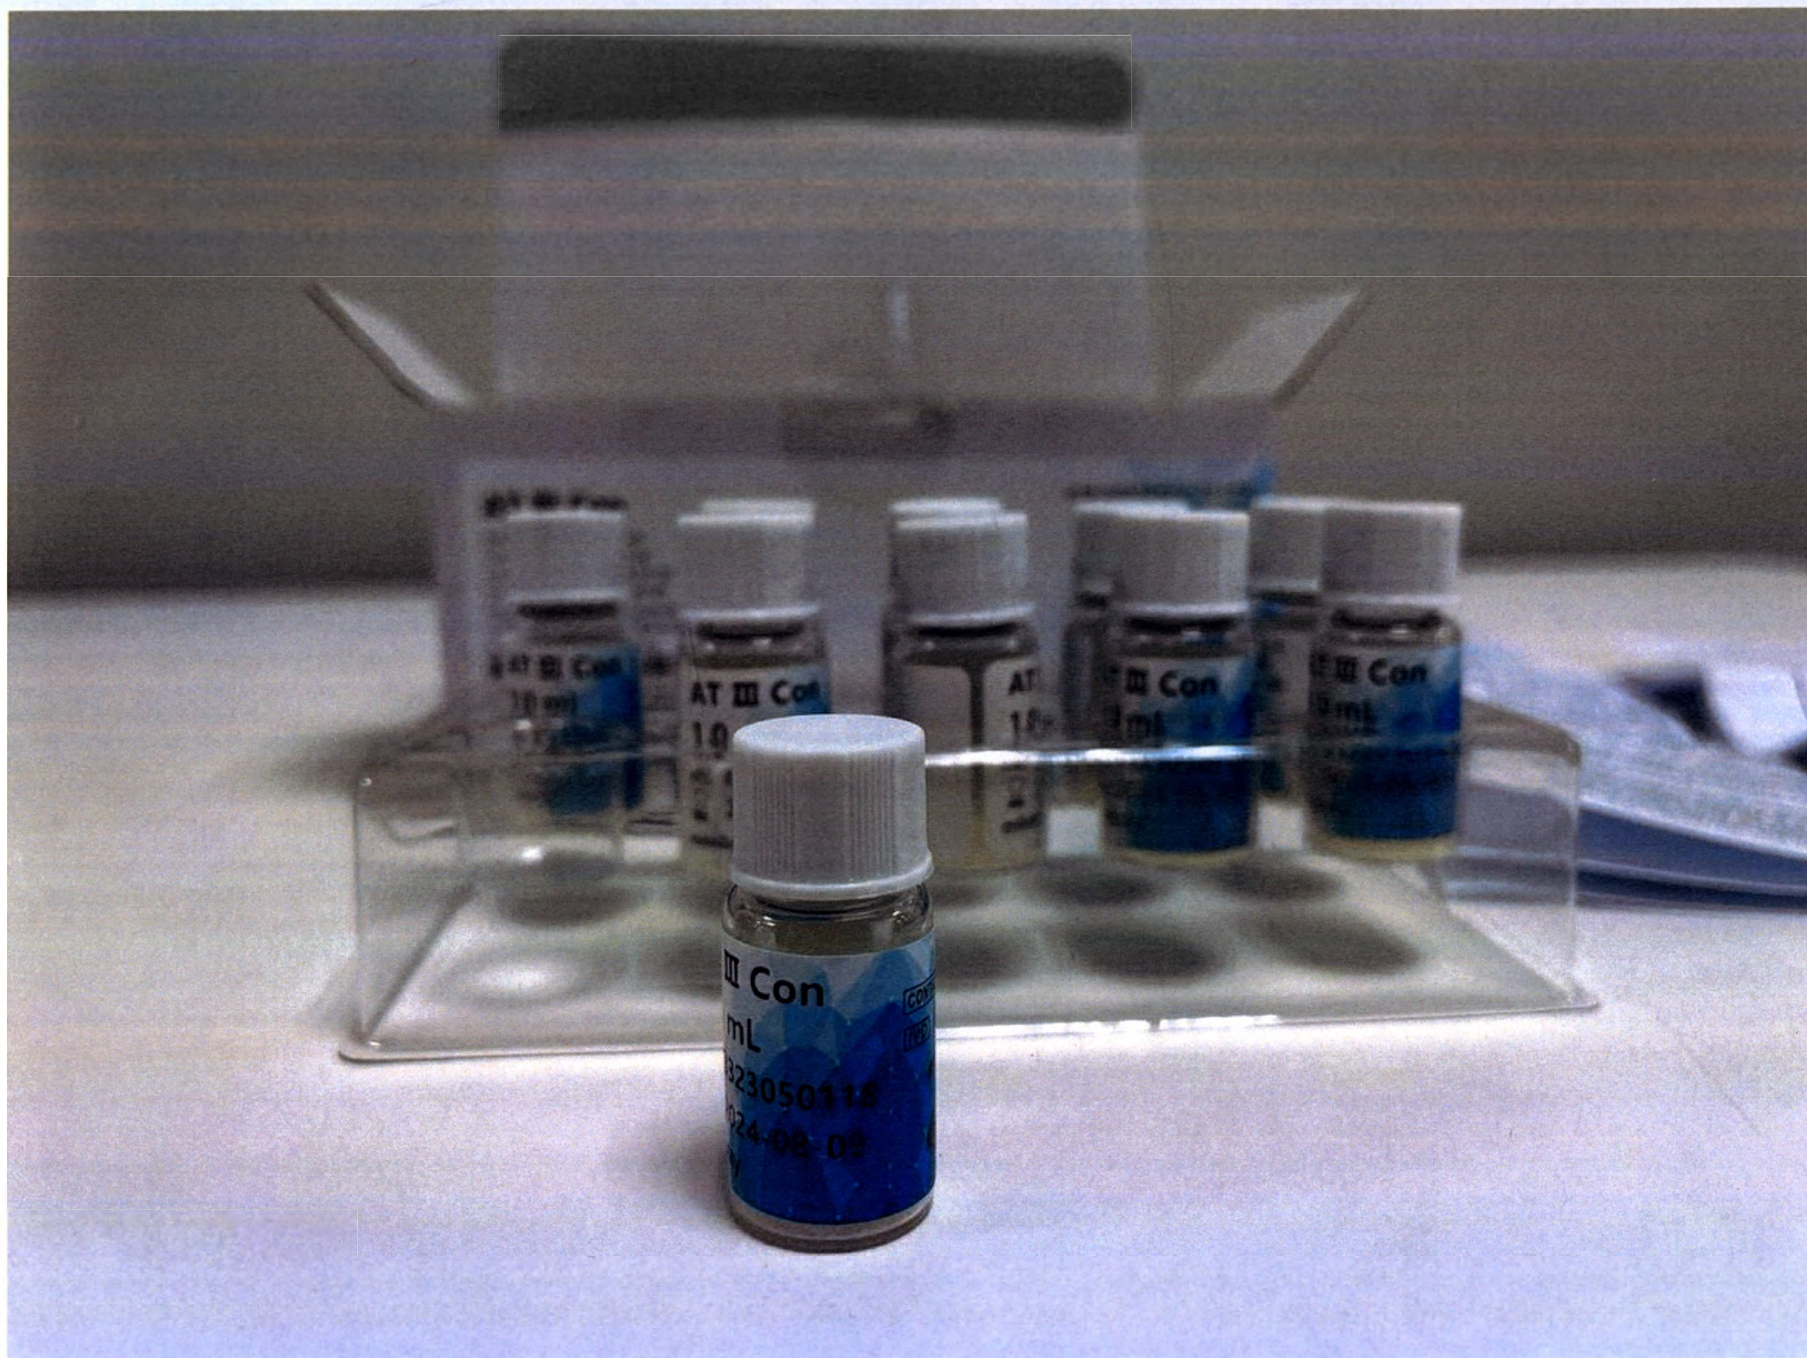


Рисунок 16 Флакон Материал контрольный для оценки качества определения антитромбина III (АТ III Con) (уровень 2) (вид 3)



ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СЫСОВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ