

Фотографические изображения
медицинского изделия

Диллюент для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в вариантах исполнения

Генеральный директор АО «СДС» Новикова Елена Борисовна


(Ф.И.О. руководителя юридического лица или иного лица,
имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

07 08 2024г.

М.П.



(Подпись)

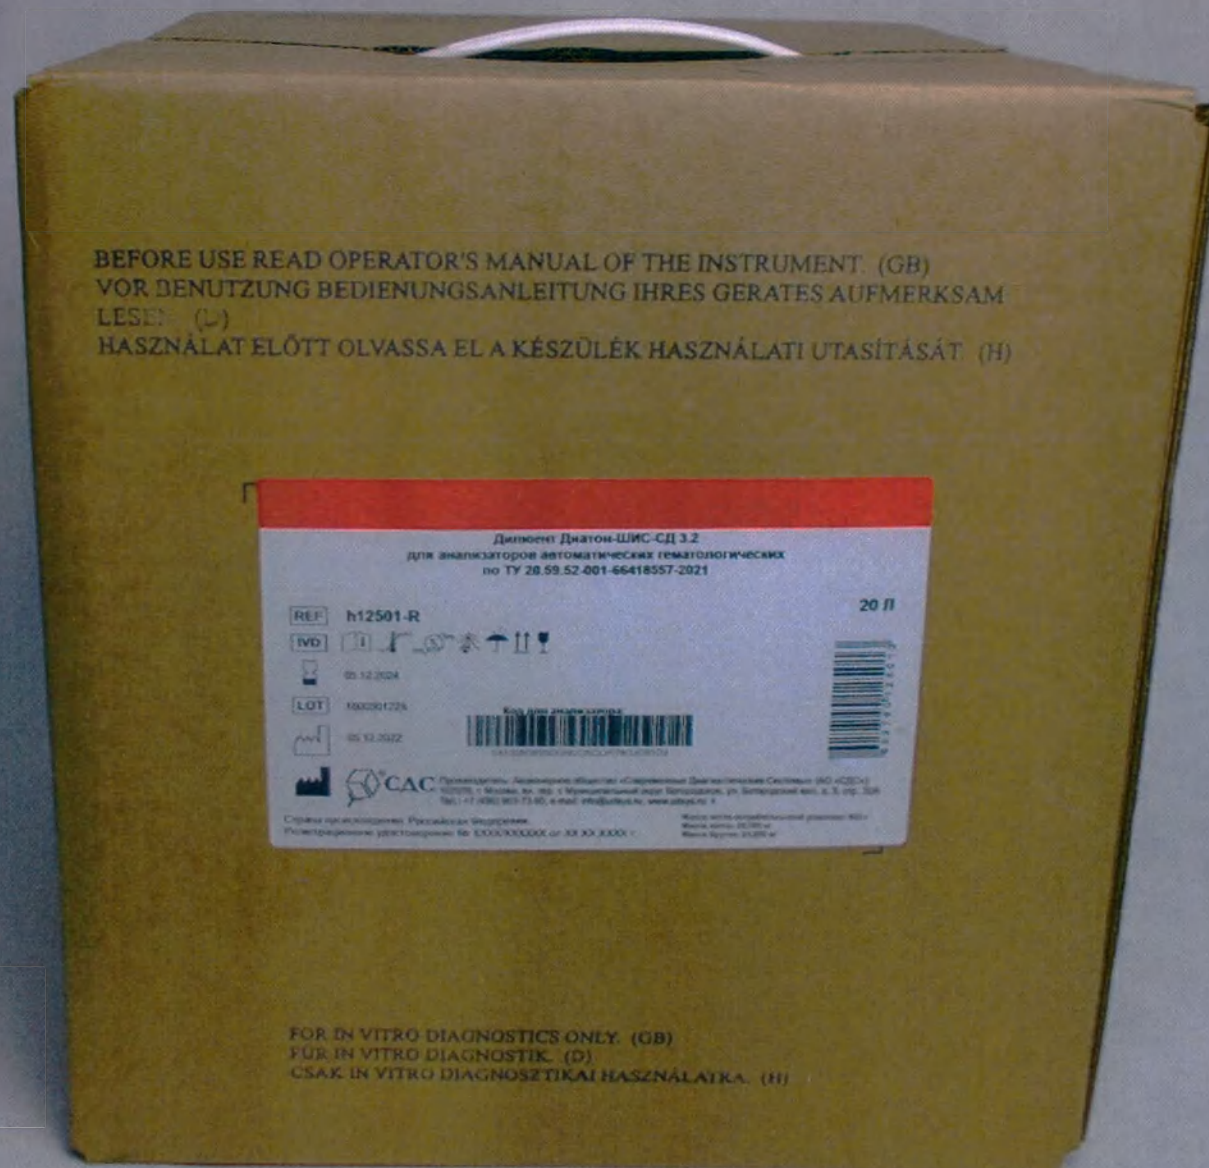

BEFORE USE READ OPERATOR'S MANUAL OF THE INSTRUMENT. (GB)
VOR BENUTZUNG BEDIENTUNGSANLEITUNG IHRES GERATES AUFMERKSAM
LESEN. (D)
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁSÁT. (H)

Дилуент Диатон-ШИС-СД 3.2
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021

REF: h12501-R

20 л

IVD:

EXP: 05.12.2024

LOT: 16X0201226

EXP: 05.12.2022



САС

Производитель: Лаборатория «Системы» «Системные Диагностикальные Системы» (АО «СДС») 125010, г. Москва, ул. 1-я Маршальская, д. 10/1, стр. 10/1, 10/1-17 (400) 903-73-60, e-mail: info@diagnostics.ru, www.diagnostics.ru

Справка происхождения: Российская Федерация

Регистрационное удостоверение № 1000000000 от 30.09.2020 г.

Масса нетто (содержимого) (г): 400
Масса брутто (г): 400
Масса нетто (г): 400

FOR IN VITRO DIAGNOSTICS ONLY. (GB)
FÜR IN VITRO DIAGNOSTIK. (D)
CSAK IN VITRO DIAGNOSZTIKAI HASZNÁLATRA. (H)

Рис. 1. Дилуент Диатон-ШИС-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.

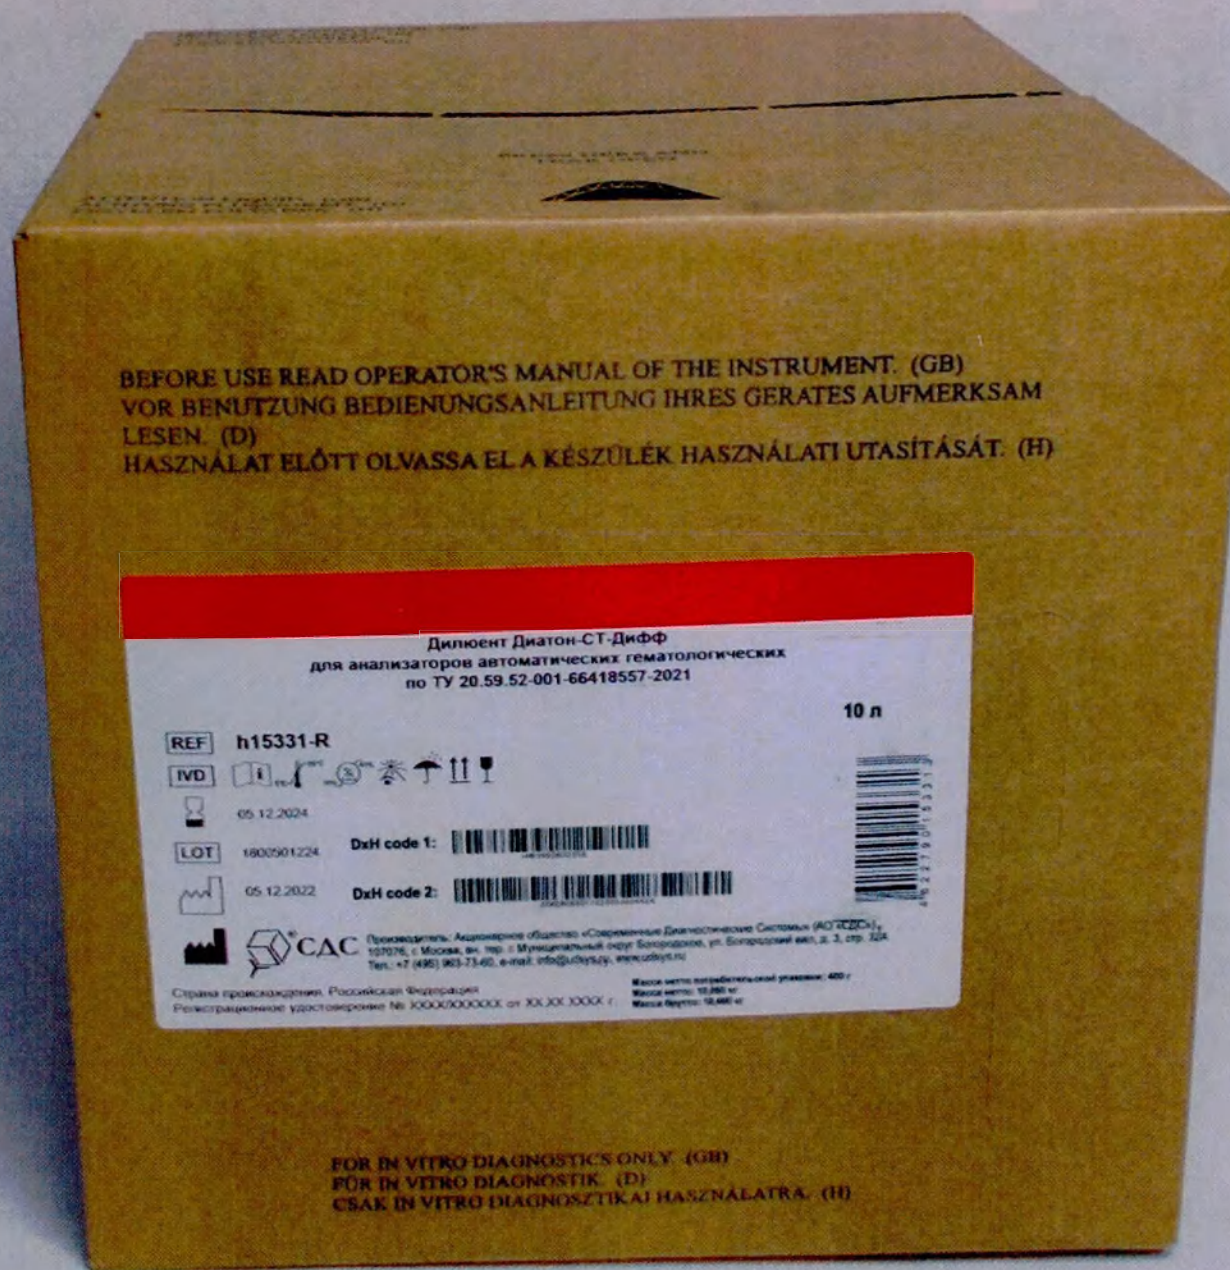


Рис. 2. Дилюент Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.

BEFORE USE READ OPERATOR'S MANUAL OF THE INSTRUMENT. (GB)
VOR BENUTZUNG BEDIENTUNGSANLEITUNG IHRES GERATES AUFMERKSAM
LESEN! (D)
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁSÁT. (H)

Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021

REF h15301-R 20 л

IVD

05.12.2024

LOT 1800904224

05.12.2022

DxH code 1: [Barcode]

DxH code 2: [Barcode]

Производитель: Акционерное общество «Омские Диагностические Системы» (АО «ОДС»)
401799, г. Омск, ул. 100-л. Бухаринский переулок, 10, Омская обл., г. Омск, 644000, РФ.
Тел.: +7 (950) 960-72-80, e-mail: info@omdiagnostics.ru, www.omdiagnostics.ru

Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXXXXXXXX от XXXXXXXX г.

Масса нетто (содержимого) упаковки: 20 л
Масса брутто: 21,500 кг

FOR IN VITRO DIAGNOSTICS ONLY. (GB)
FÜR IN VITRO DIAGNOSTIK. (D)
CSAK IN VITRO DIAGNOSZTIKAI HASZNÁLATRA. (H)

Рис. 3. Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 4. Дилуэнт Диатон-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.

BEFORE USE READ OPERATOR'S MANUAL OF THE INSTRUMENT. (GB)
VOR BENUTZUNG BEDIENTUNGSANLEITUNG IHRES GERÄTES AUFMERKSAM
LESEN. (D)
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁSÁT. (H)

Дилуэнт Диатон Дифф. ЛМЖ
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021

20 л

REF h20201-R

IVD

05.12.2024

LOT 1800501224

05.12.2022

Код для анализатора

Производитель: Акционерное общество «Системные Диагностические Системы» (АО «СДС»),
125080, г. Москва, вл. 180, г. Муниципальный округ Ботанический, ул. Ботанический вл. д. 3, стр. 32А.
Тел: +7 (495) 963-73-65, e-mail: info@sdss.ru

Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Масса нетто потребительской упаковки: 900 г
Масса нетто: 20,900 кг
Масса брутто: 21,800 кг

FOR IN VITRO DIAGNOSTICS ONLY. (GB)
FÜR IN VITRO DIAGNOSTIK. (D)
CSAK IN VITRO DIAGNOSZTIKAI HASZNÁLATRA. (H)

Рис. 5. Дилуэнт Диатон Дифф. ЛМЖ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 6. Дилуент Диадифтон Аргос/Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 8. Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 9. Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦП для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 10. Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 11. Дилуэнт Диагн-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 12. Диллюент универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

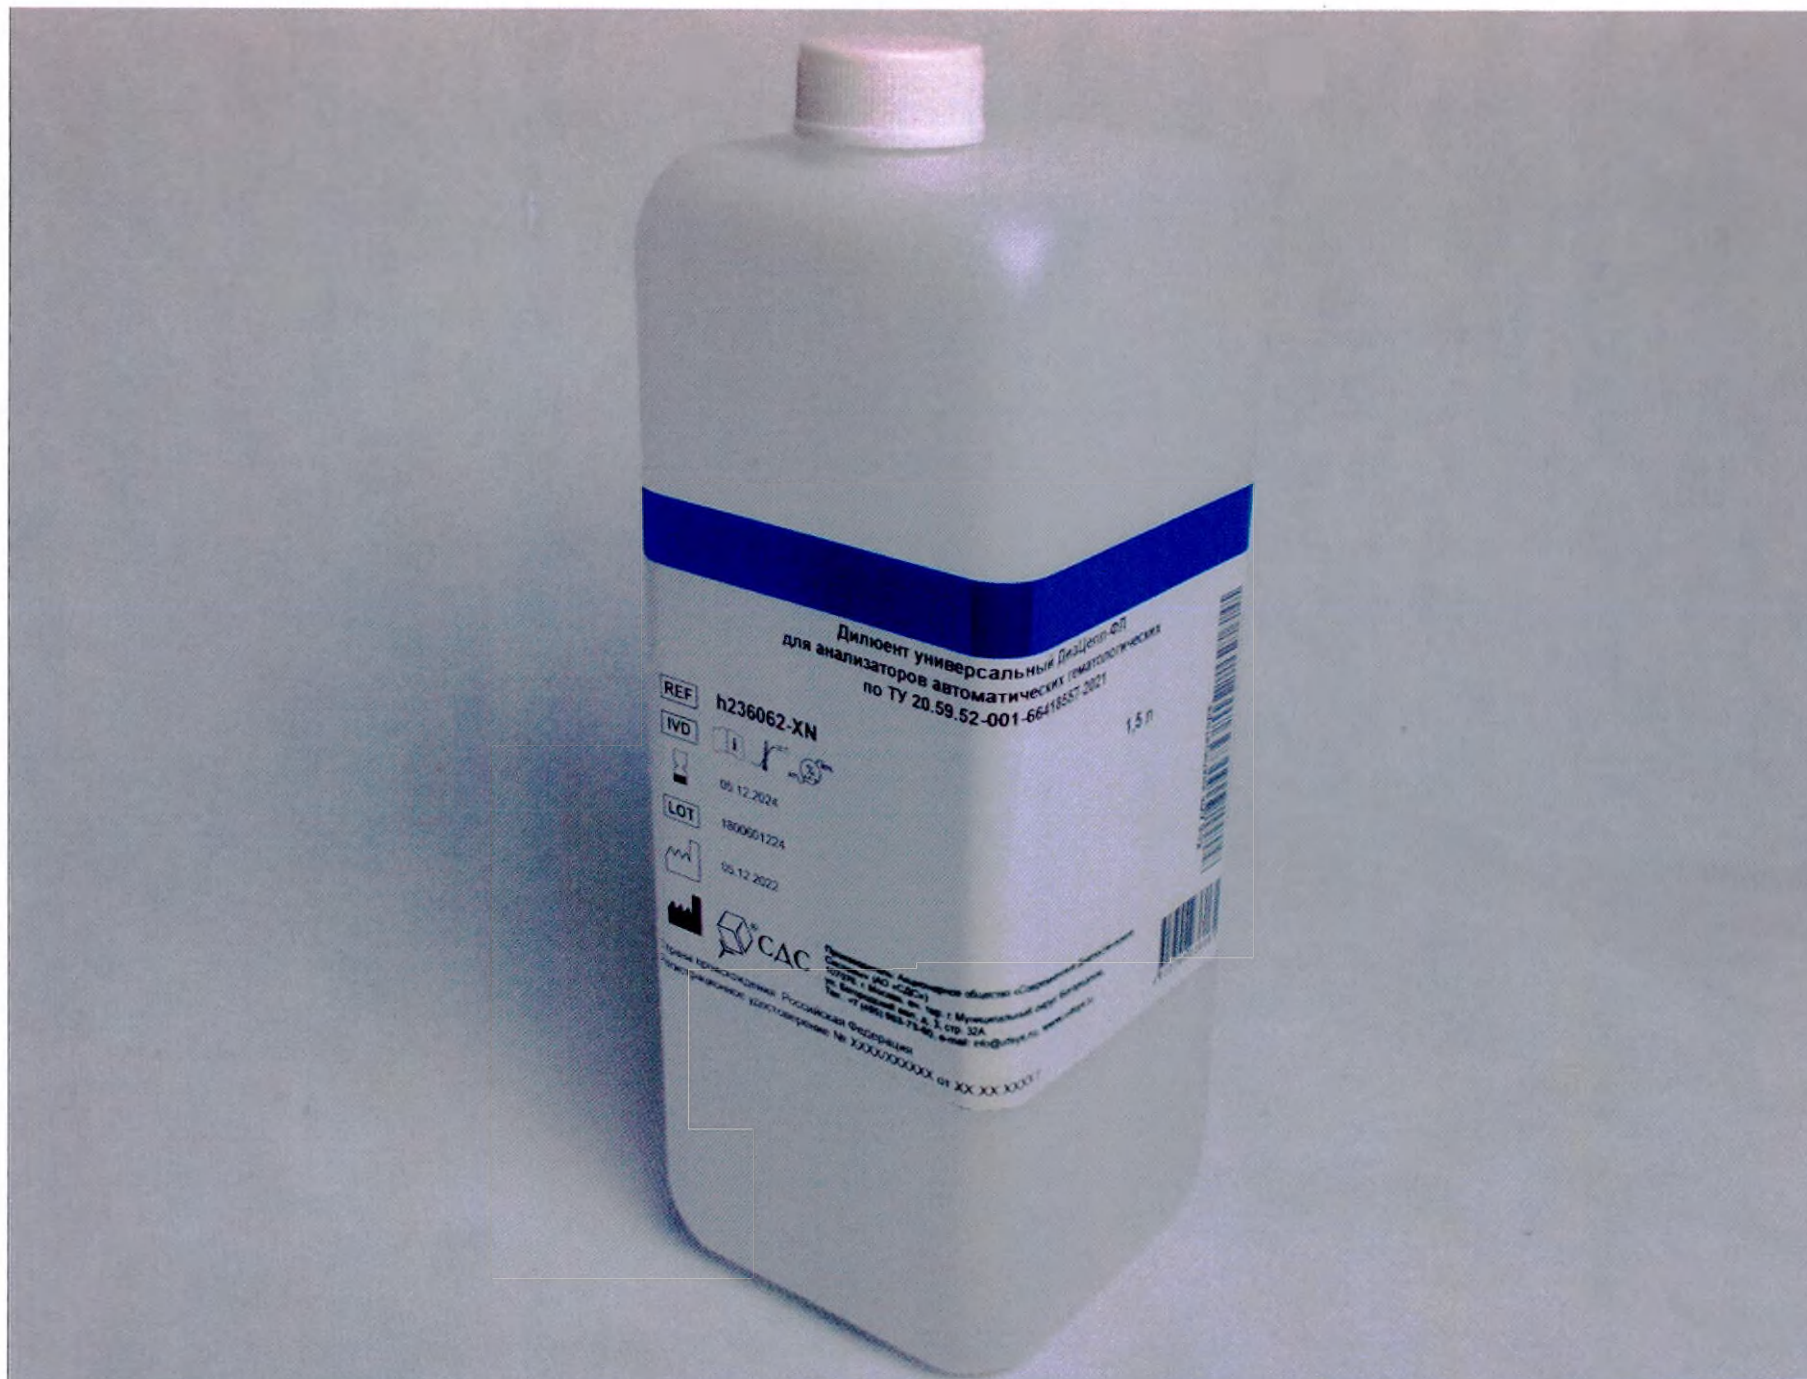


Рис. 13. Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 14. Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 15. Дилуэнт Диареф-Сearч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 17. Дилуэнт ДМ-53Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.

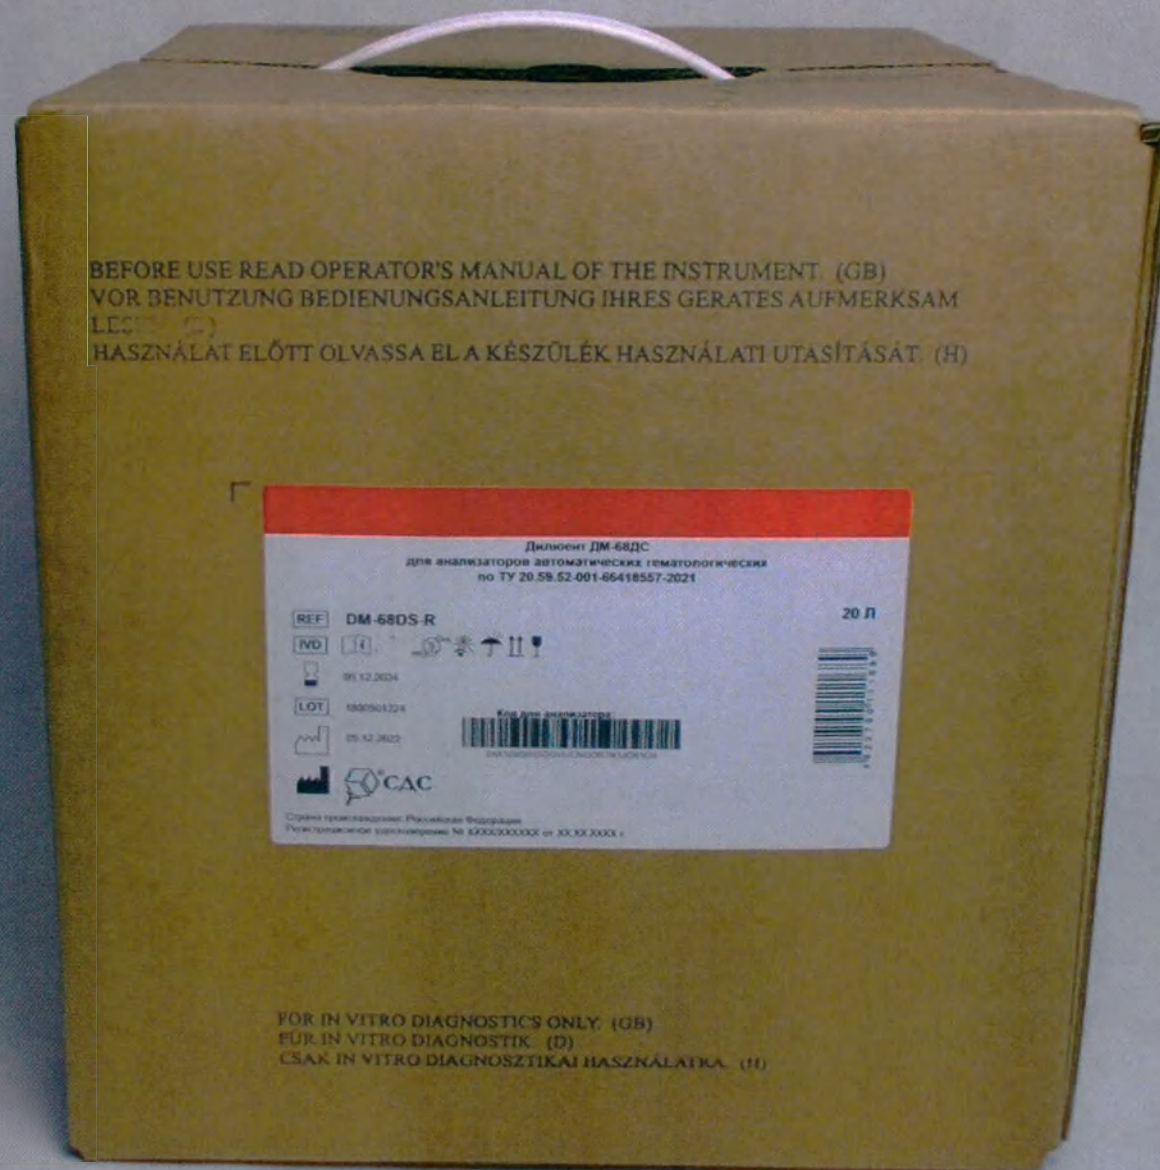


Рис. 18. Дилуэнт ДМ-68ДС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.

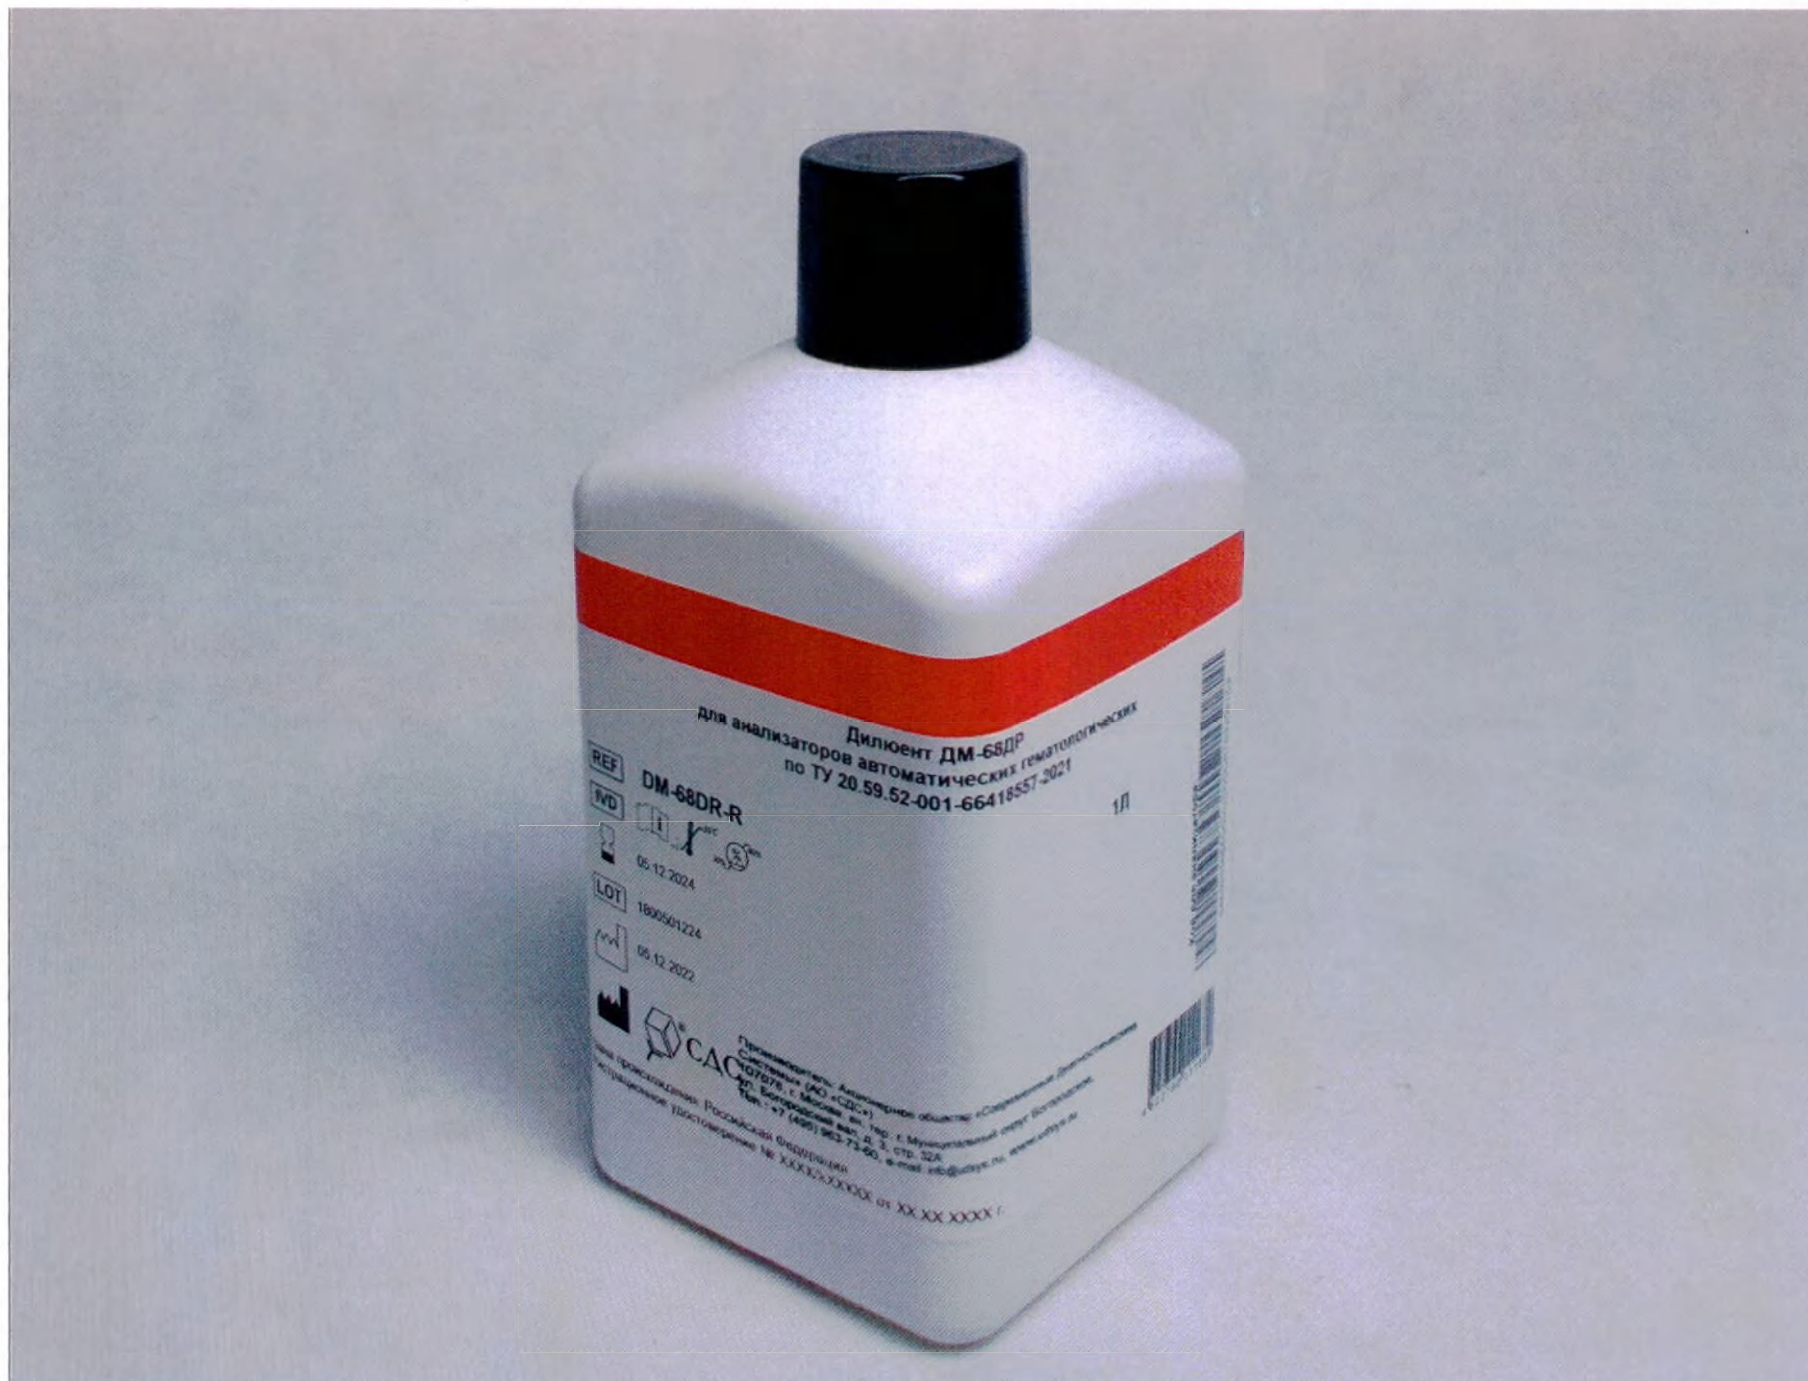


Рис. 19. Дилуэнт ДМ-68ДР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка.



Рис. 20. Дилуэнт ДиаПерокс Шис А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 2,725 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

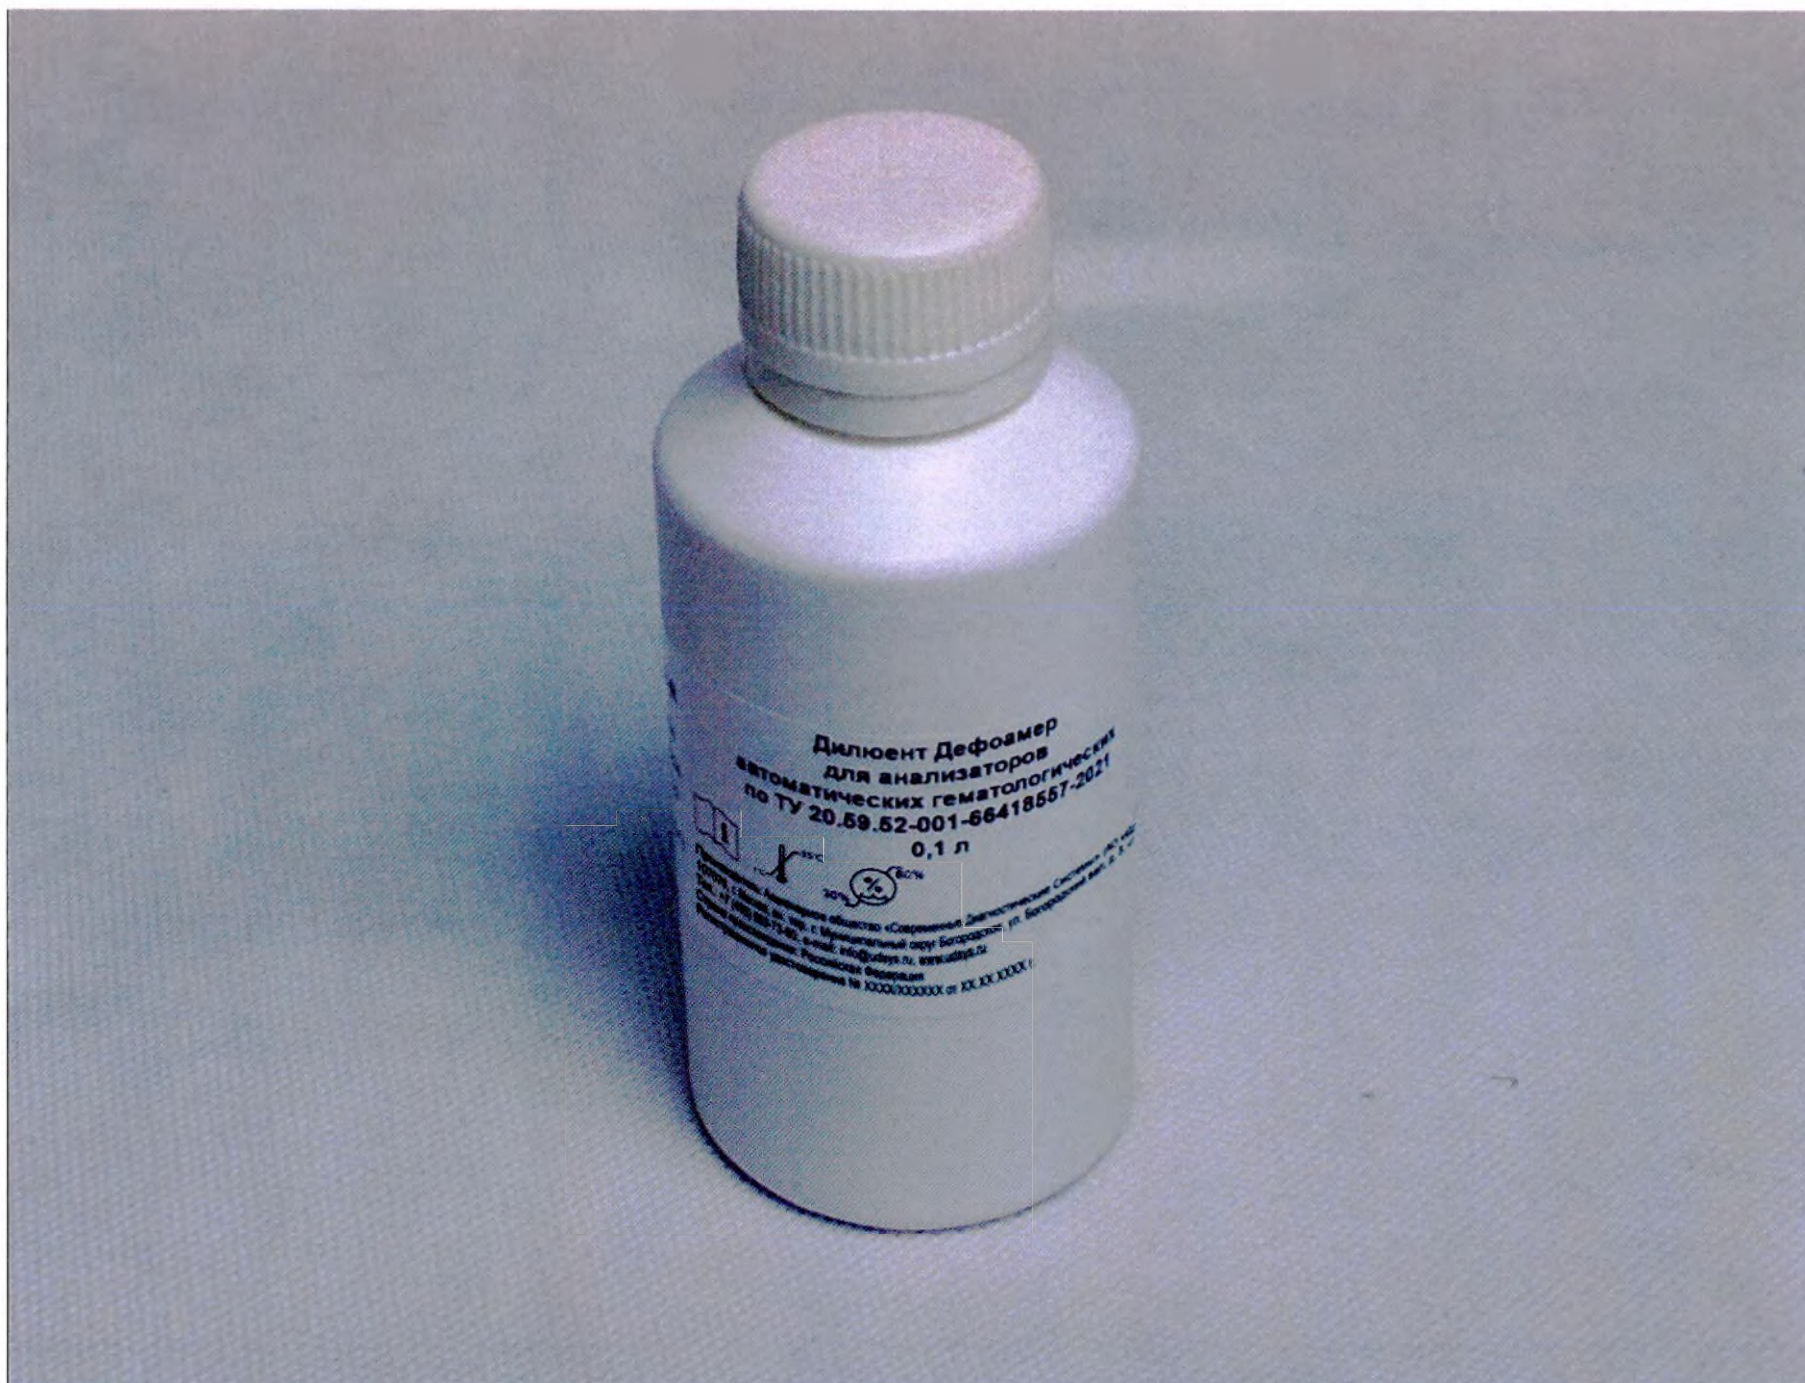


Рис. 21. Дилуэнт Дефоамер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 0,1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 22. Дилуент ДиаШис Ринз А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 23. Дилуент ДиаПак АСТ Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 15 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 24. Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л. Пример транспортной упаковки, размер 355 × 350 × 260 мм.



Рис. 25. Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л. Пример транспортной упаковки, размер 185 × 390 × 260 мм.



Рис. 26. Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л. Пример транспортной упаковки, размер 200 × 200 × 200 мм.



Е.Б. Новикова

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Дилуэнт для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в вариантах исполнения

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Дилуэнт для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в вариантах исполнения:

1. Дилуэнт для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 в вариантах исполнения:

1. Дилуэнт Дилатон-ШИС-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

2. Дилуэнт Дилатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л;

3. Дилуэнт Дилатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

4. Дилуэнт Дилатон-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

5. Дилуэнт Дилатон Дифф. ЛМЖ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

6. Дилуэнт Дилатон Аргос/Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

7. Дилуэнт универсальный Дилатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л;

8. Дилуэнт универсальный Дилатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

9. Дилуэнт универсальный Дилатон-ЦП для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л;

10. Дилуэнт универсальный Дилатон-ЦП для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

11. Дилуэнт Дилатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

12. Дилуэнт универсальный Дилатон-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л;

13. Дилуэнт универсальный Дилатон-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л;

14. Дилуэнт универсальный Дилатон-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л;

15. Дилуэнт Дилатон-Сепар-И-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л;

16. Дилуэнт ДМ-30Л для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

17. Дилуэнт ДМ-50Л для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

18. Дилуэнт ДМ-53Л для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л;

Рис. 27. Инструкция по применению



Рис. 28. Макеты транспортной (потребительской) упаковки: Дилуэнт Диатон-ШИС-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; Дилуэнт Диатон-СТ-Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021(канистра 10 л, канистра 20 л); Дилуэнт Диатон-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л.

Дилуэнт Диатон Дифф. ЛМЖ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 REF h20201-R 20 л IVD        ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXXX  ДД.ММ.ГГГГ  Код для анализатора:   CAC Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Масса нетто потребительской упаковки: 900 г Масса нетто: 20,000 кг Масса брутто: 20,900 кг	Дилуэнт Диадифтон Аргос/Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 REF h20301P-R 20 л IVD        ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXXX  ДД.ММ.ГГГГ  Код для анализатора:   CAC Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Масса нетто потребительской упаковки: 900 г Масса нетто: 20,040 кг Масса брутто: 20,940 кг
Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 REF h23111-R 10 л IVD        ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXXX  ДД.ММ.ГГГГ  Код для анализатора:   CAC Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Масса нетто потребительской упаковки: 400 г Масса нетто: 10,030 кг Масса брутто: 10,430 кг	Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021 REF h23101-R 20 л IVD        ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXXX  ДД.ММ.ГГГГ  Код для анализатора:   CAC Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Масса нетто потребительской упаковки: 900 г Масса нетто: 20,040 кг Масса брутто: 20,940 кг

Рис. 29. Макеты транспортной (потребительской) упаковки: Дилуэнт Диатон Дифф. ЛМЖ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; Дилуэнт Диадифтон Аргос/Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; Дилуэнт универсальный Диатон-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л.

Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦП
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021

REF h231012-XN **20 л**

IVD      

 ДД.ММ.ГГГГ

LOT XXXXXXXXXX

 ДД.ММ.ГГГГ

Код для анализатора:



64 A5 0 N5 6 55 GGRUC NOOR 7 N3 J ON 1 D9

 **САС**

Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru

Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Масса нетто потребительской упаковки: 900 г
Масса брутто: 20,960 кг

Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦП
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021

REF h231011-XN **10 л**

IVD      

 ДД.ММ.ГГГГ

LOT XXXXXXXXXX

 ДД.ММ.ГГГГ

Код для анализатора:



64 A5 0 N5 6 55 GGRUC NOOR 7 N3 J ON 1 D9

 **САС**

Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru

Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Масса нетто потребительской упаковки: 400 г
Масса нетто: 10,830 кг
Масса брутто: 10,638 кг

Дилуэнт Диашис-СИС
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021

REF h23202-R **20 л**

IVD      

 ДД.ММ.ГГГГ

LOT XXXXXXXXXX

 ДД.ММ.ГГГГ

Код для анализатора:



64 A5 0 N5 6 55 GGRUC NOOR 7 N3 J ON 1 D9

 **САС**

Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru

Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Масса нетто потребительской упаковки: 900 г
Масса нетто: 20,960 кг
Масса брутто: 20,988 кг

Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021

REF h236064-XN **5 л**

IVD      

 ДД.ММ.ГГГГ

LOT XXXXXXXXXX

 ДД.ММ.ГГГГ

Код для анализатора:



64 A5 0 N5 6 55 GGRUC NOOR 7 N3 J ON 1 D9

 **САС**

Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru

Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Масса нетто потребительской упаковки: 298 г
Масса нетто: 5,040 кг
Масса брутто: 5,290 кг

Рис. 30. Макеты транспортной (потребительской) упаковки: Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦП для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 10 л; Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ЦП для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; Дилуэнт Диашис-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 5 л.

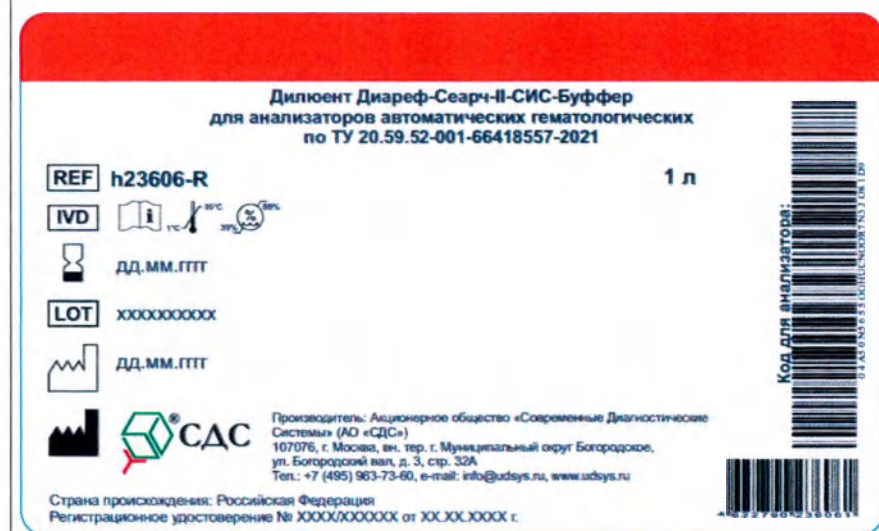
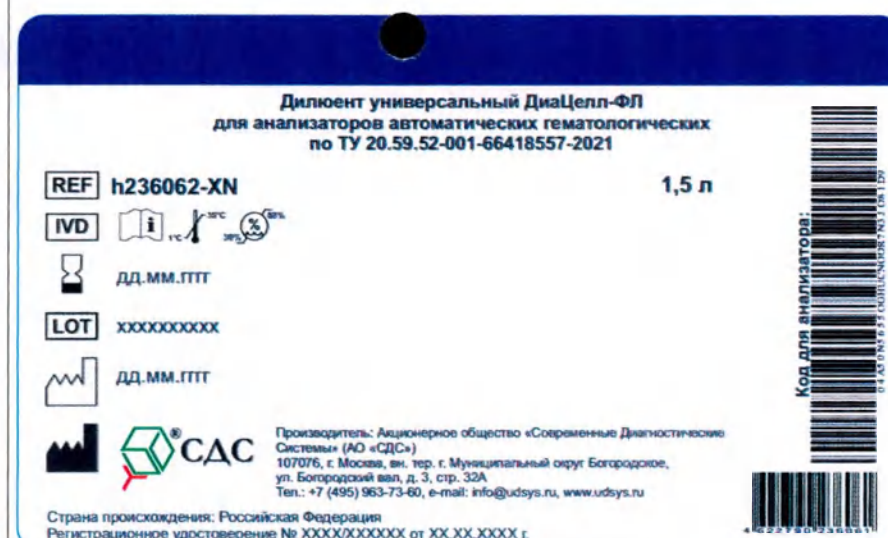
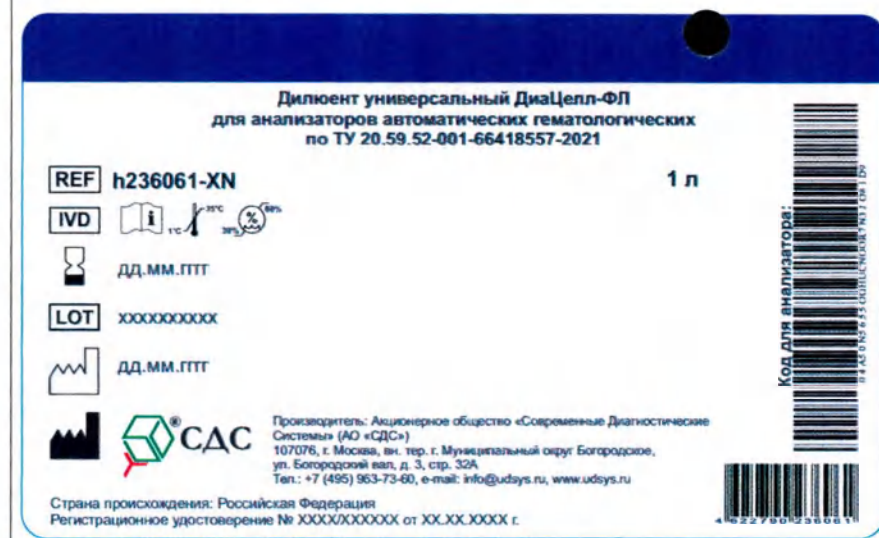


Рис. 31. Макеты первичной (потребительской) упаковки: Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; Дилуэнт Диареф-Сearч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; Дилуэнт ДМ-68ДР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л.

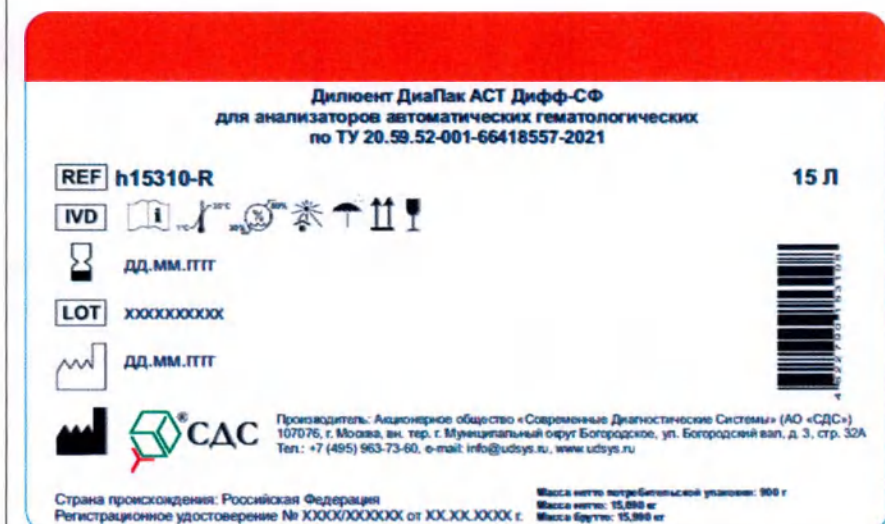


Рис. 32. Макеты транспортной (потребительской) упаковки: Дилуэнт ДМ-30Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; Дилуэнт ДМ-50Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; Дилуэнт ДМ-53Д для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; Дилуэнт ДиаПак АСТ Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 15 л.



Рис. 33. Макеты транспортной (потребительской) упаковки: Дилуэнт ДМ-68ДС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; Дилуэнт ДиаШис Ринз А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 20 л; Дилуэнт ДиаПак АСТ Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, канистра 15 л.



Рис. 34. Макеты первичной (потребительской) упаковки: Дилуэнт ДиаПерокс Шис А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 2,725 л; Дилуэнт Дефоамер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 0,1 л.

**Дилуэнт универсальный ДиаЦелл
для анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-001-66418557-2021**

REF h236061-XN Кол-во флаконов 10x1 л

IVD       

ДД.ММ.ГГГГ Масса нетто потребительской упаковки: 85 г

LOT XXXXXXXXXXXX Масса нетто: 10,93 кг

ДД.ММ.ГГГГ Масса брутто: 11,93 кг

ДД.ММ.ГГГГ

 **СДС**

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 1222790 236061

**Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ
для анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-001-66418557-2021**

REF h236062-XN Кол-во флаконов 6x1,5 л

IVD       

ДД.ММ.ГГГГ Масса нетто потребительской упаковки: 130 г

LOT XXXXXXXXXXXX Масса нетто: 9,852 кг

ДД.ММ.ГГГГ Масса брутто: 10,852 кг

ДД.ММ.ГГГГ

 **СДС**

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 1222790 236061

**Дилуэнт Диареф-Сearч-II-СИС-Буффер
для анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-001-66418557-2021**

REF h23606-R Кол-во флаконов 2x1 л

IVD       

ДД.ММ.ГГГГ Масса нетто потребительской упаковки: 85 г

LOT XXXXXXXXXXXX Масса нетто: 2,186 кг

ДД.ММ.ГГГГ Масса брутто: 3,186 кг

ДД.ММ.ГГГГ

 **СДС**

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 1222790 236061

**Дилуэнт ДМ-68ДР для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-001-66418557-2021**

REF DM-68DR-R Кол-во флаконов 6x1 л

IVD       

ДД.ММ.ГГГГ Масса нетто потребительской упаковки: 85 г

LOT XXXXXXXXXXXX Масса нетто: 6,558 кг

ДД.ММ.ГГГГ Масса брутто: 7,558 кг

ДД.ММ.ГГГГ

 **СДС**

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 1222790 111689

Рис. 35. Макеты транспортной упаковки: Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л; Дилуэнт универсальный ДиаЦелл-ФЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1,5 л; Дилуэнт Диареф-Сearч-II-СИС-Буффер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1л; Дилуэнт ДМ-68ДР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 1 л.



Рис. 36. Макеты транспортной упаковки: Дилуэнт ДиаПерокс Шис А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 2,725 л; Дилуэнт Дефоамер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-001-66418557-2021, флакон 0,1 л.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 57 листов (-а)
Генеральный директор АО «СДС»
Новикова Е. Б. 

