

Фотографические изображения
медицинского изделия

реагент для лизиса клеток крови для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 в вариантах исполнения

Генеральный директор АО «СДС» Новикова Елена Борисовна

(Ф.И.О. руководителя юридического лица или иного лица,
имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

"07" июня 2024 г.

М.П.



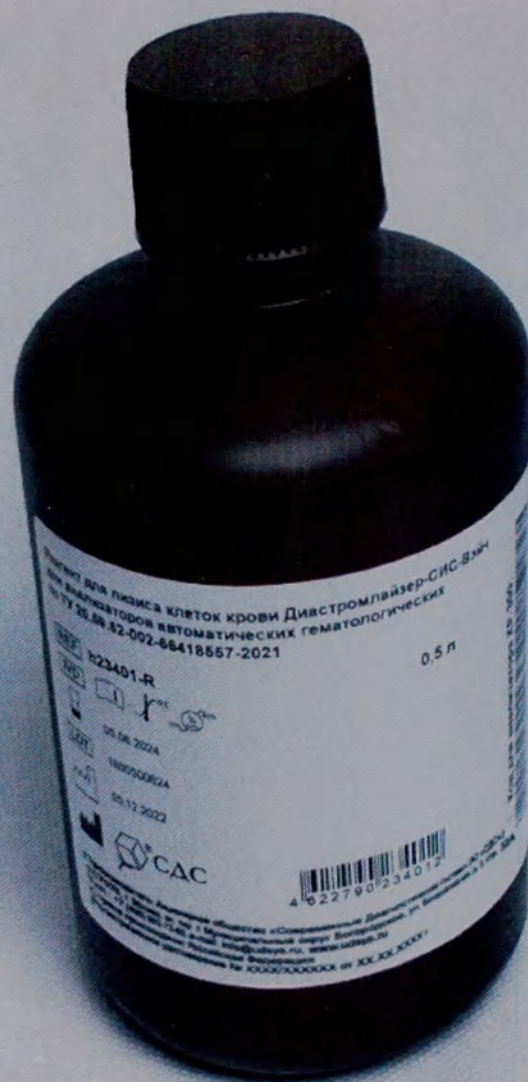


Рис. 1. Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-Вэйч для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 2. Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 3. Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.

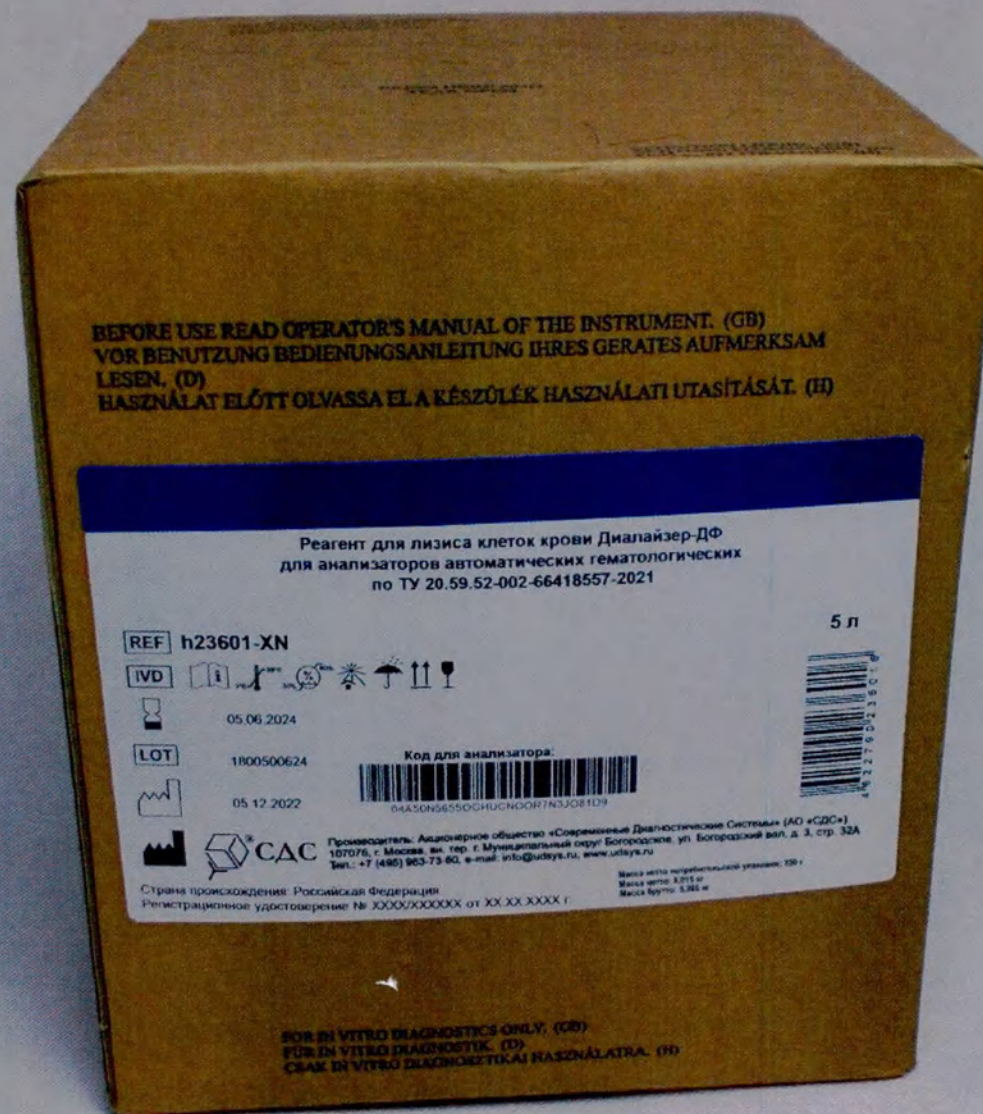


Рис. 4. Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.

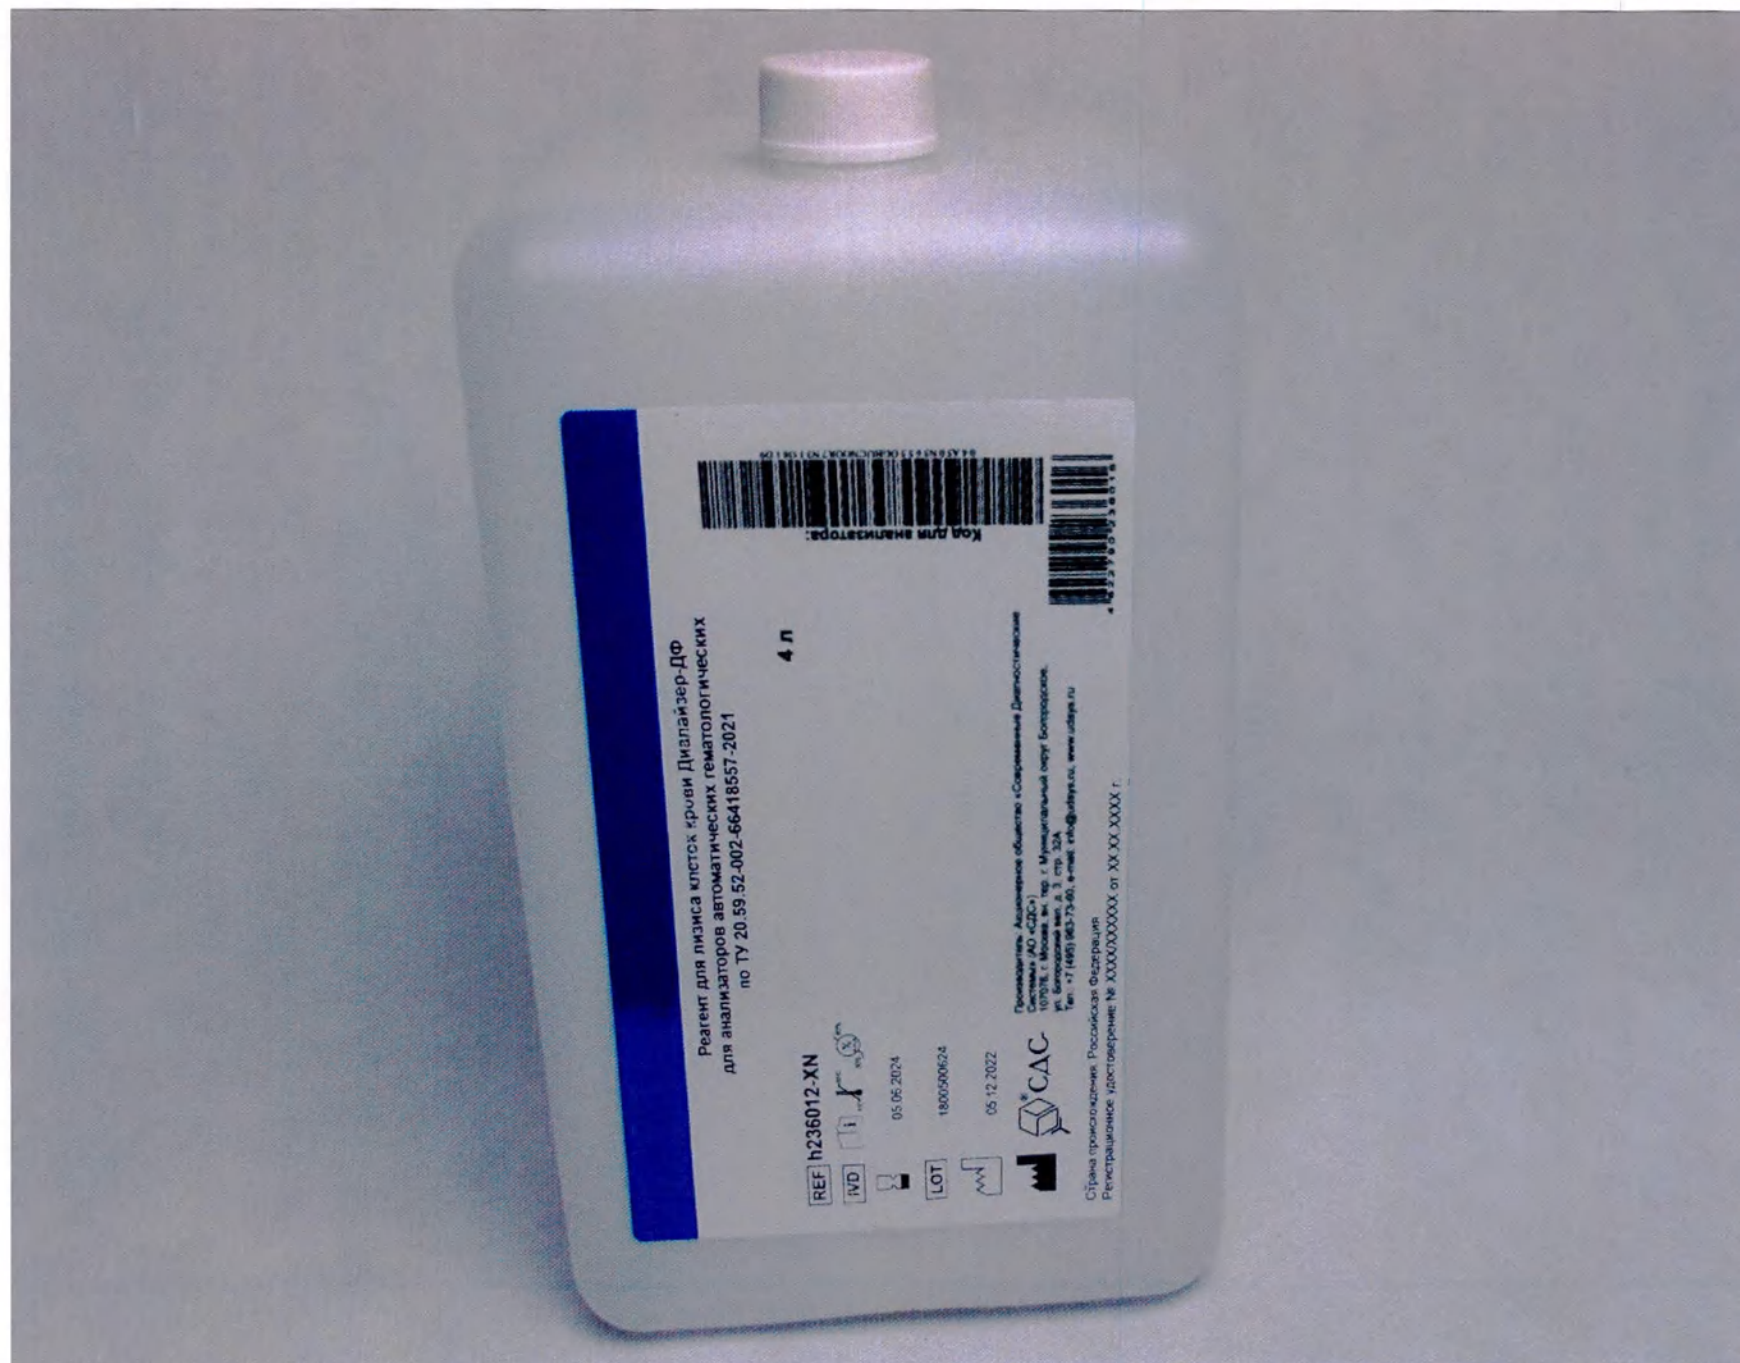


Рис. 5. Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 6. Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

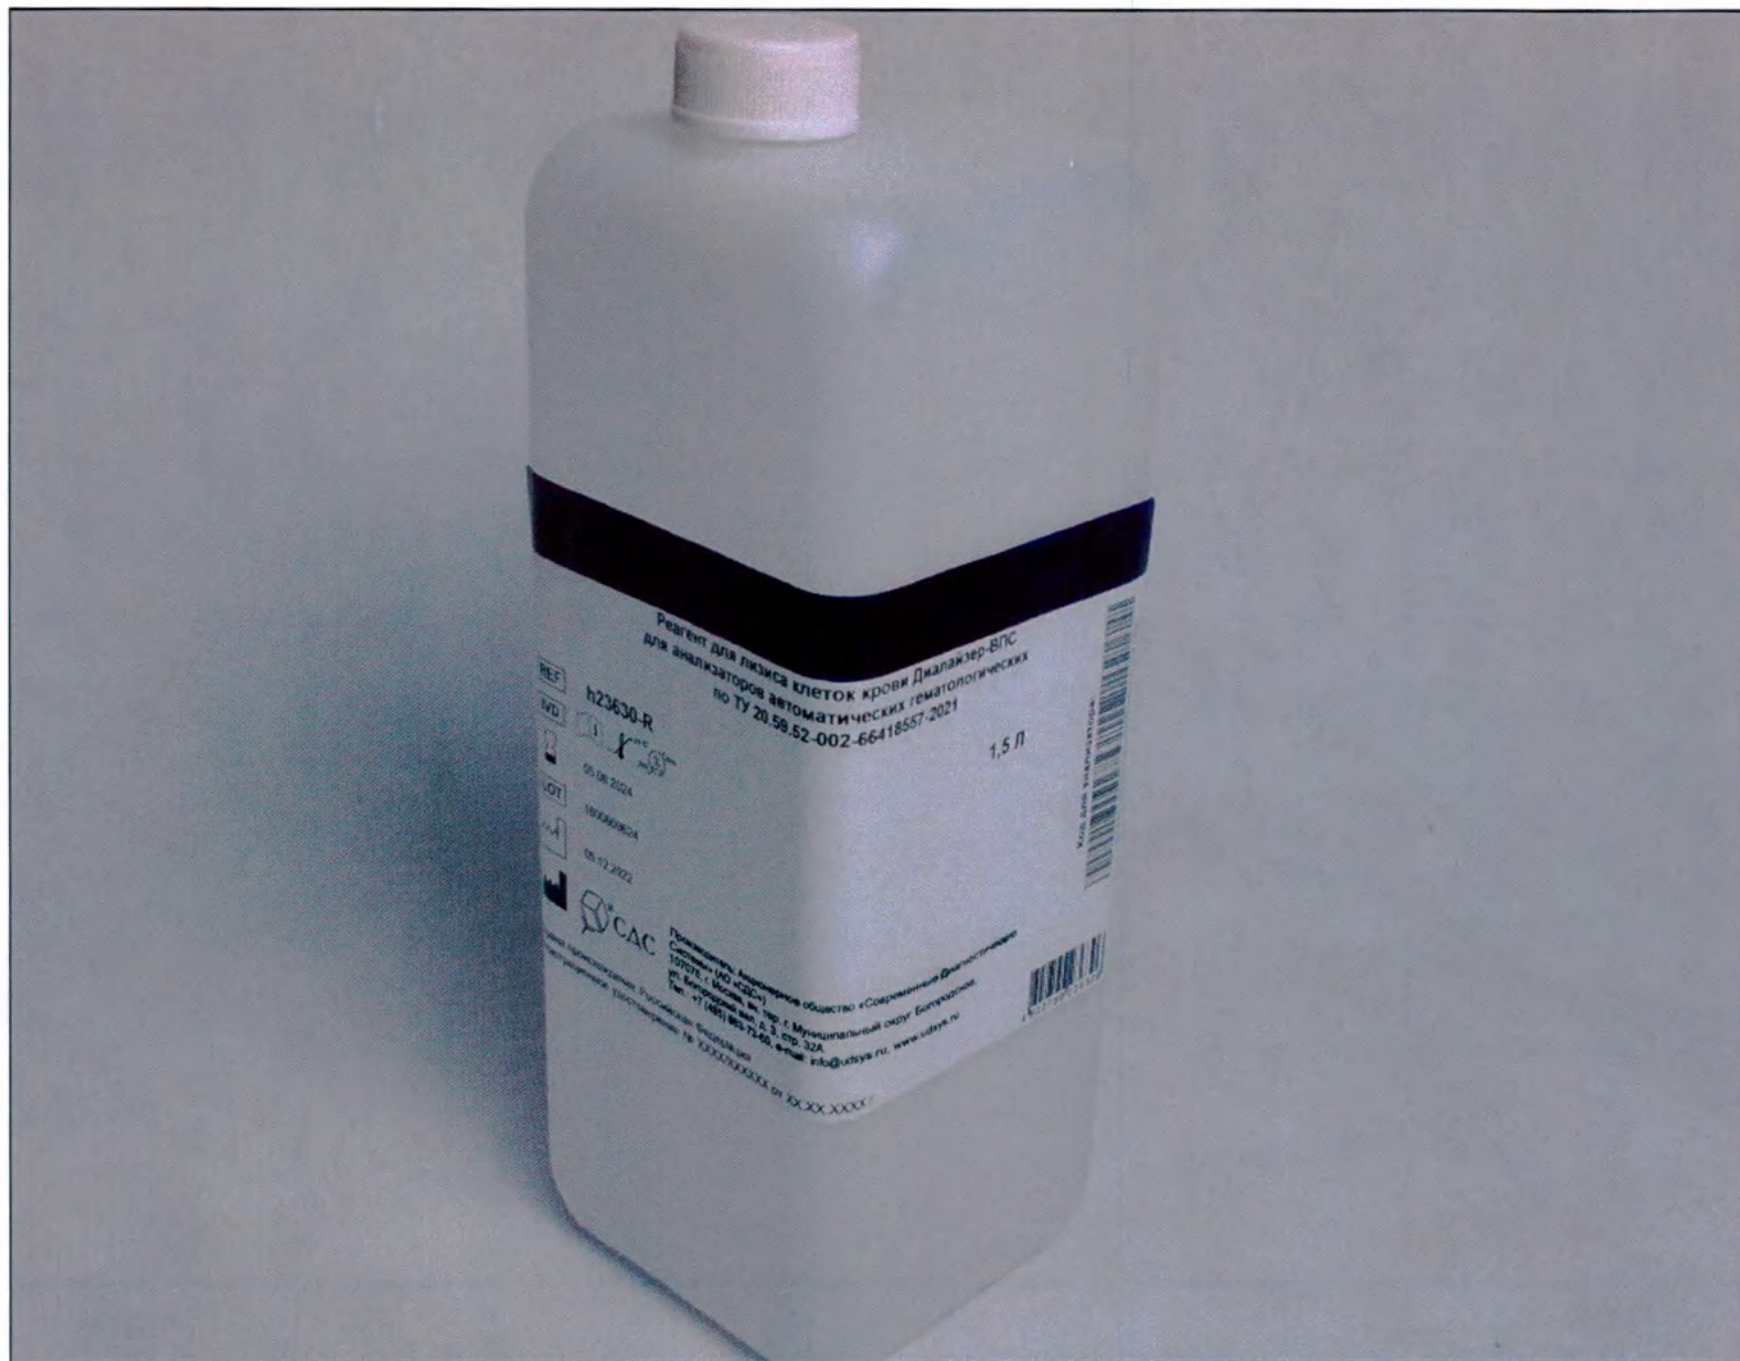


Рис. 7. Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

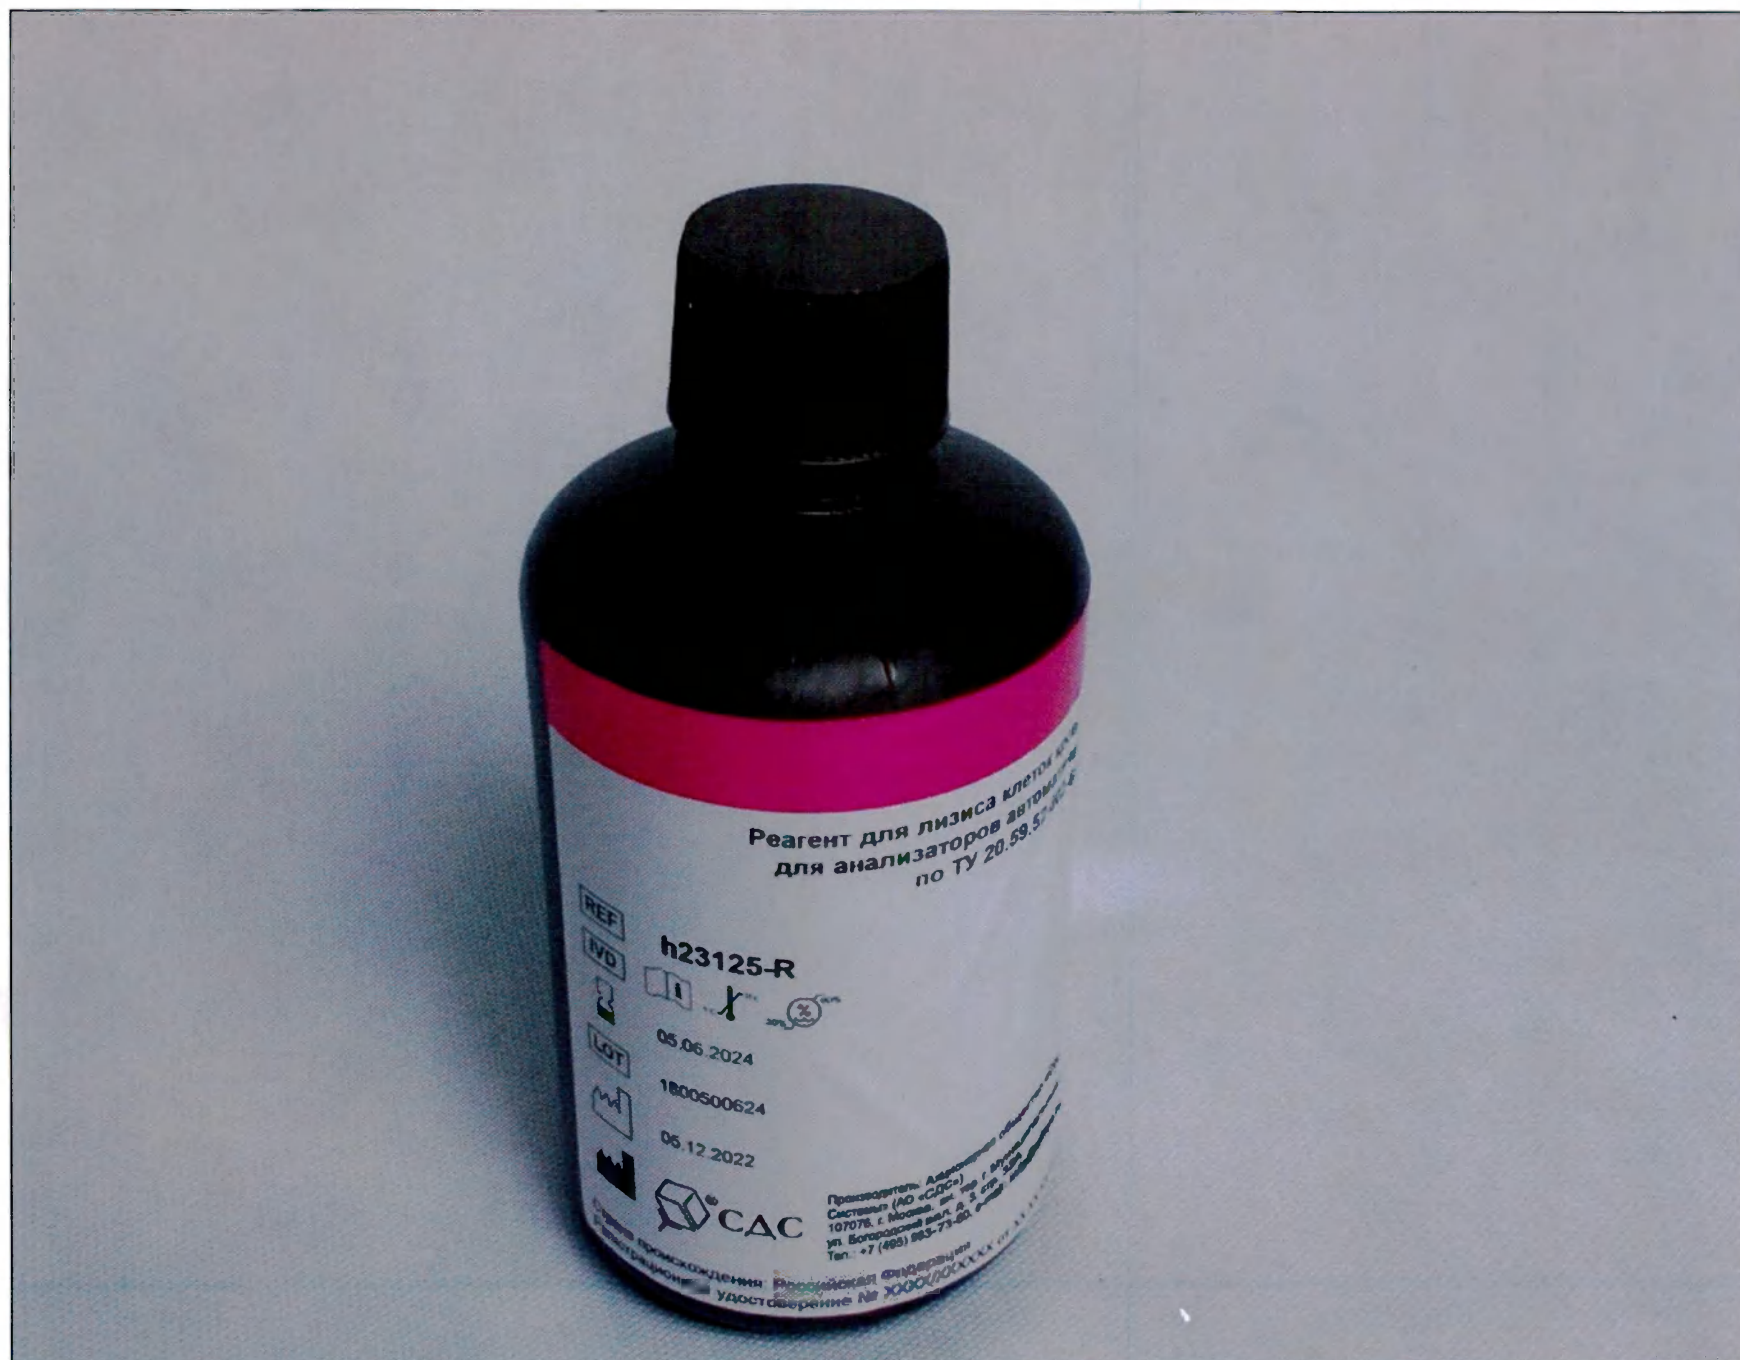


Рис. 8. Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 9. Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.

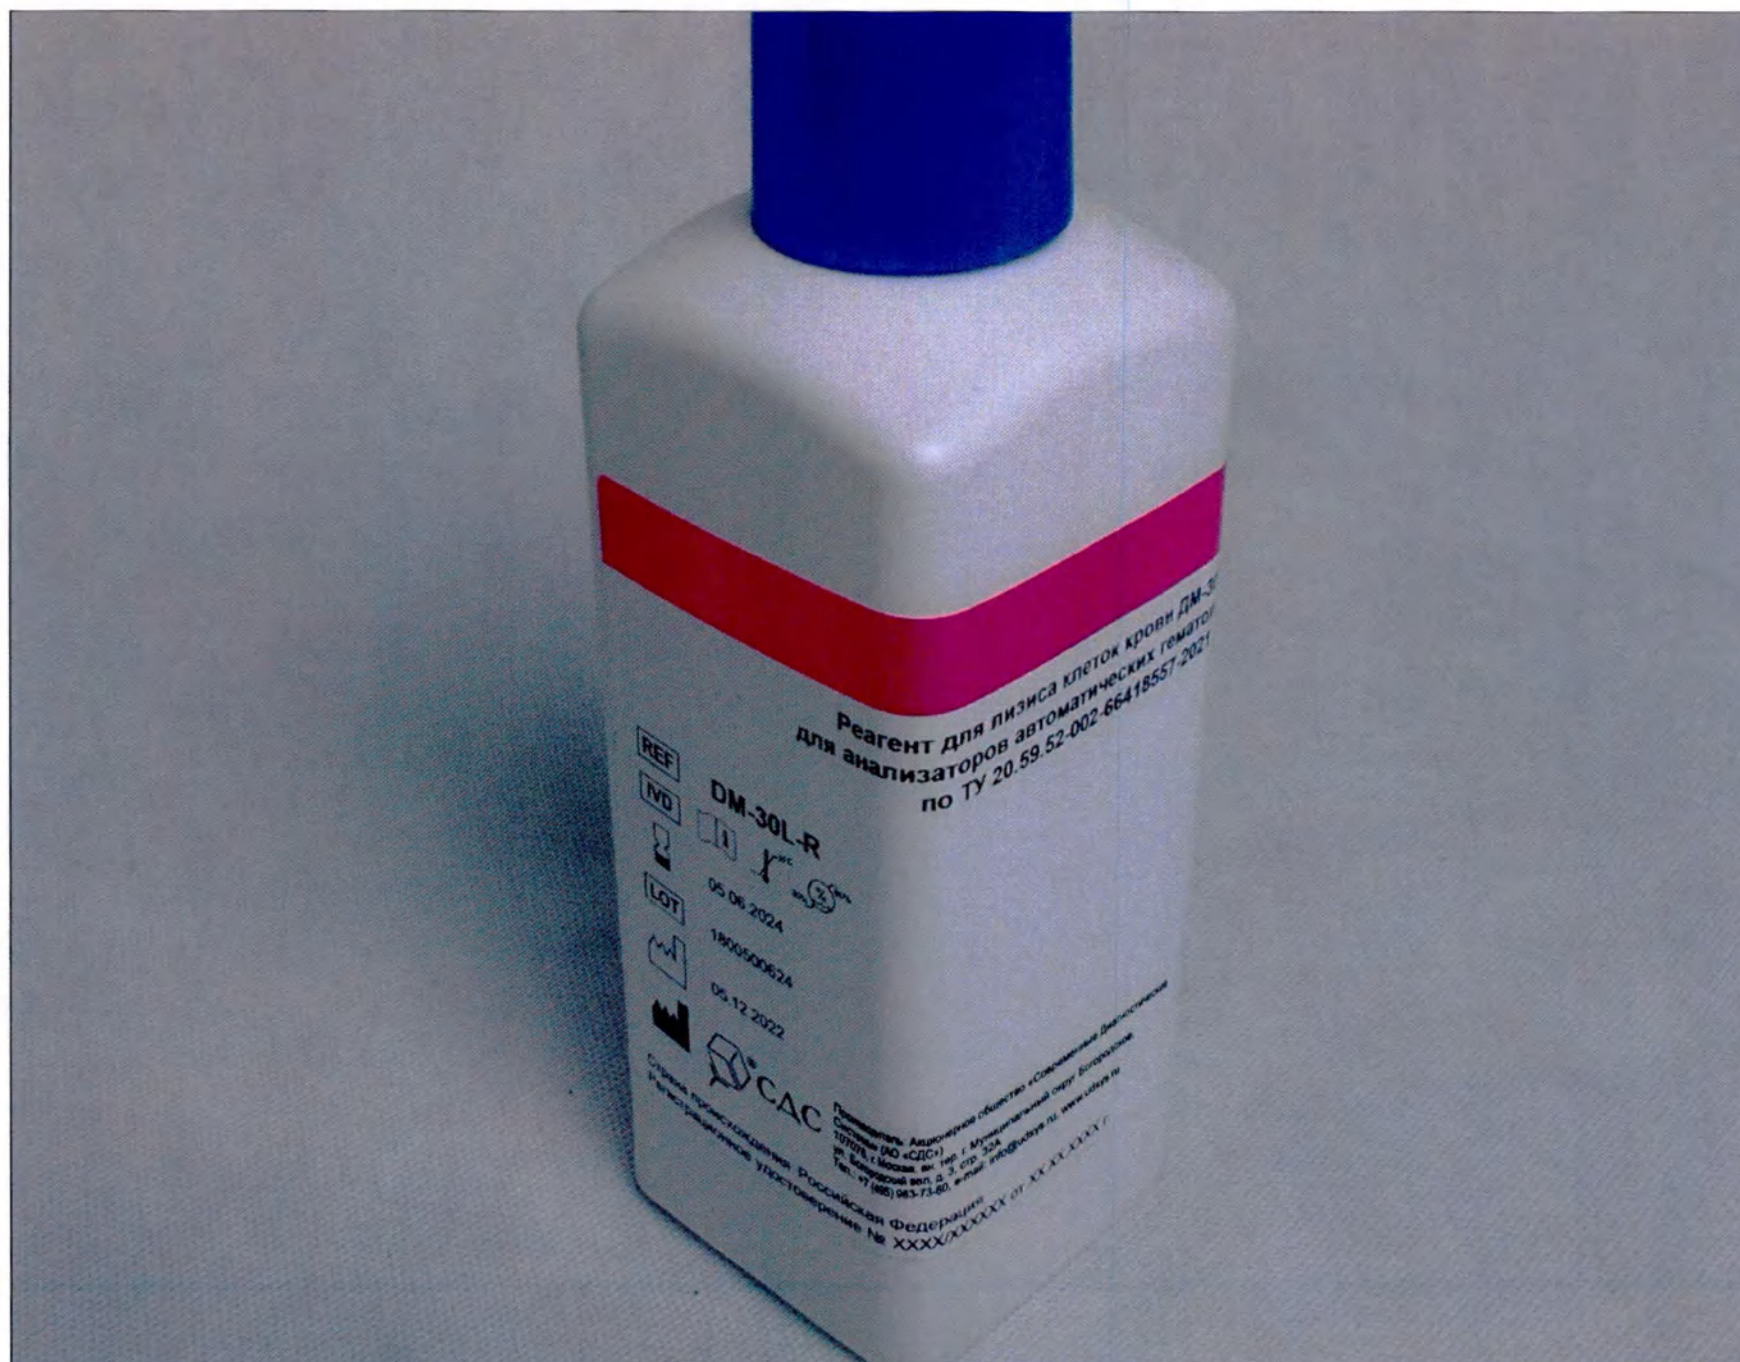


Рис. 10. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-30 ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

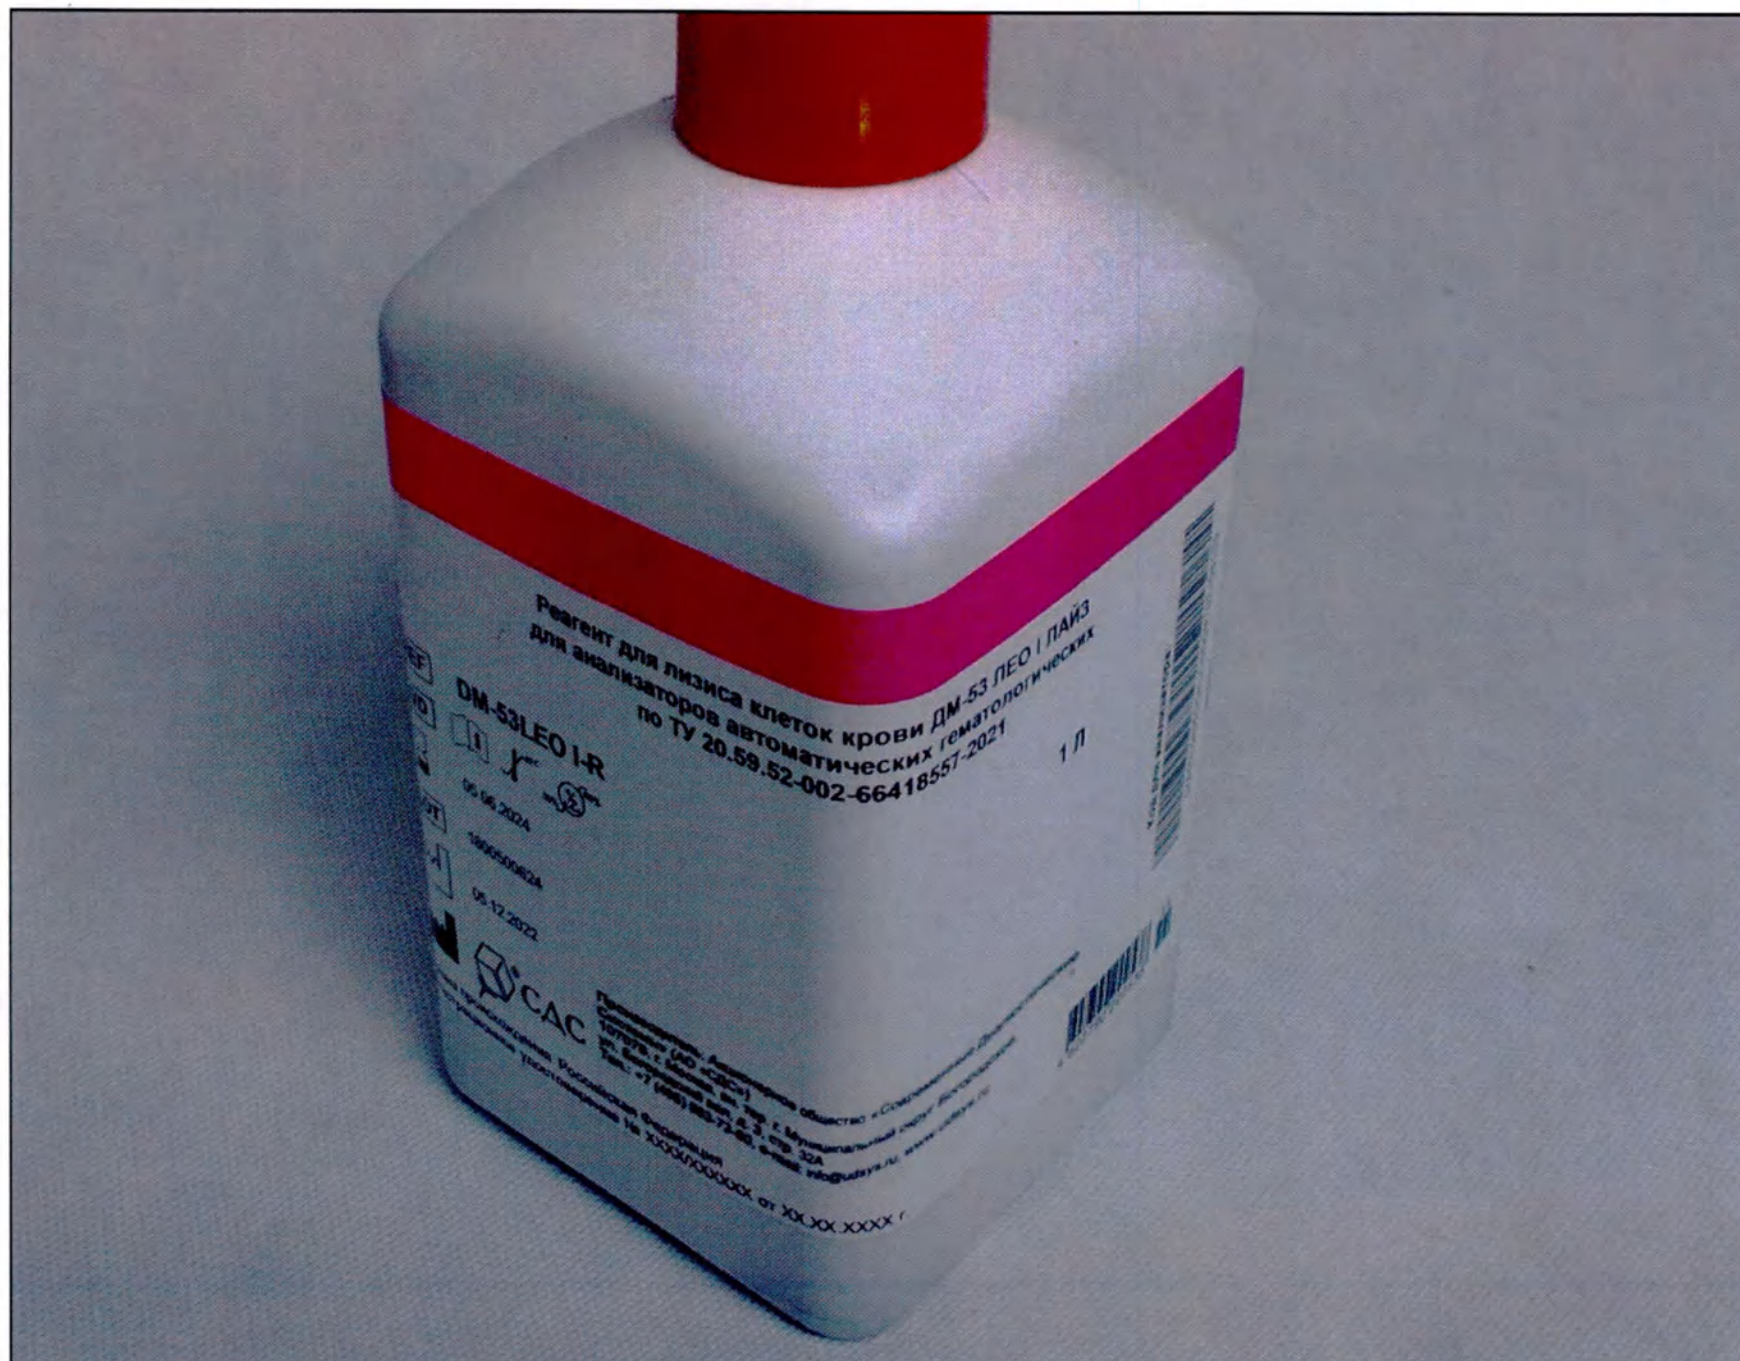


Рис. 11. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53 ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 12. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛЕО II ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,4 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

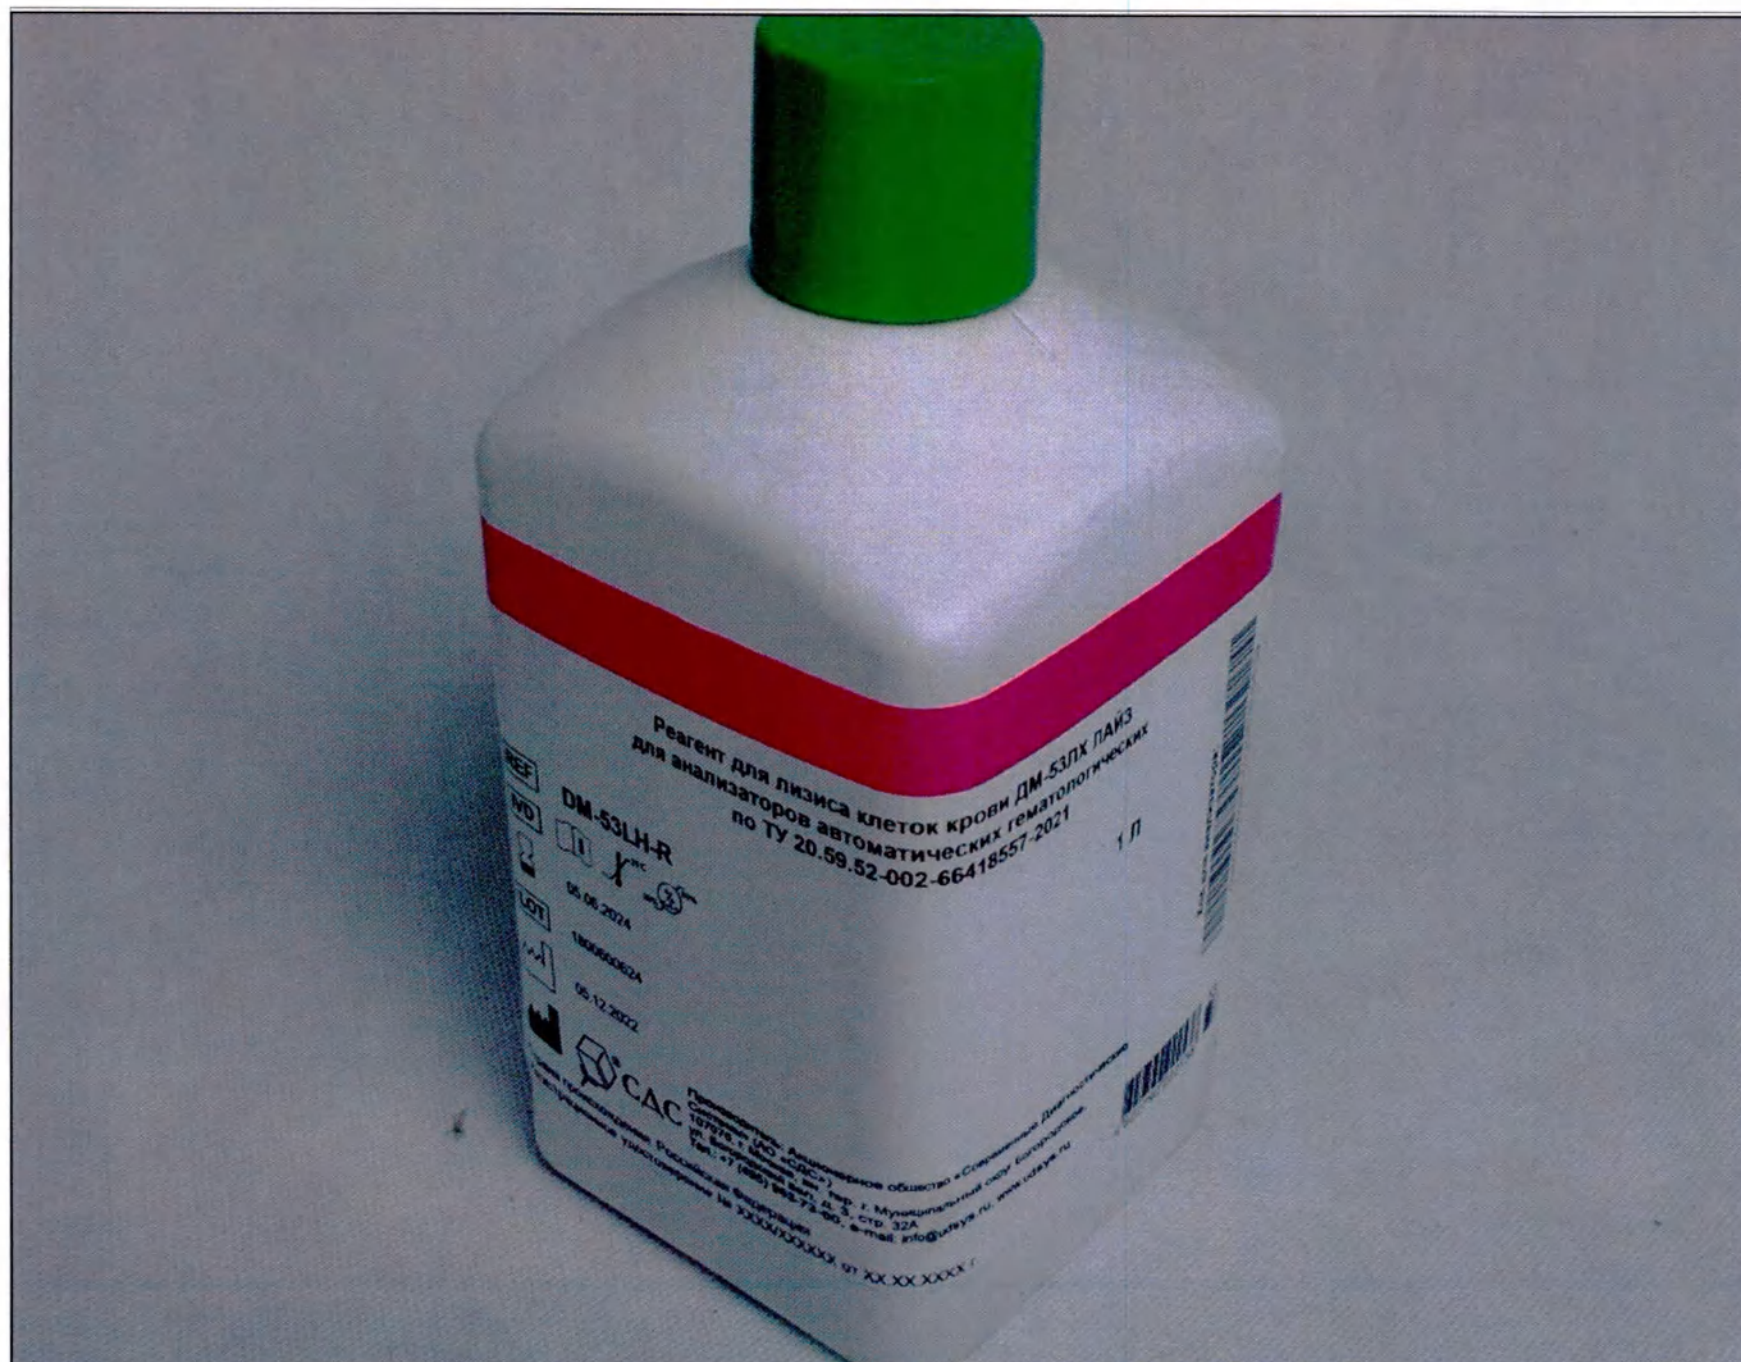


Рис. 13. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

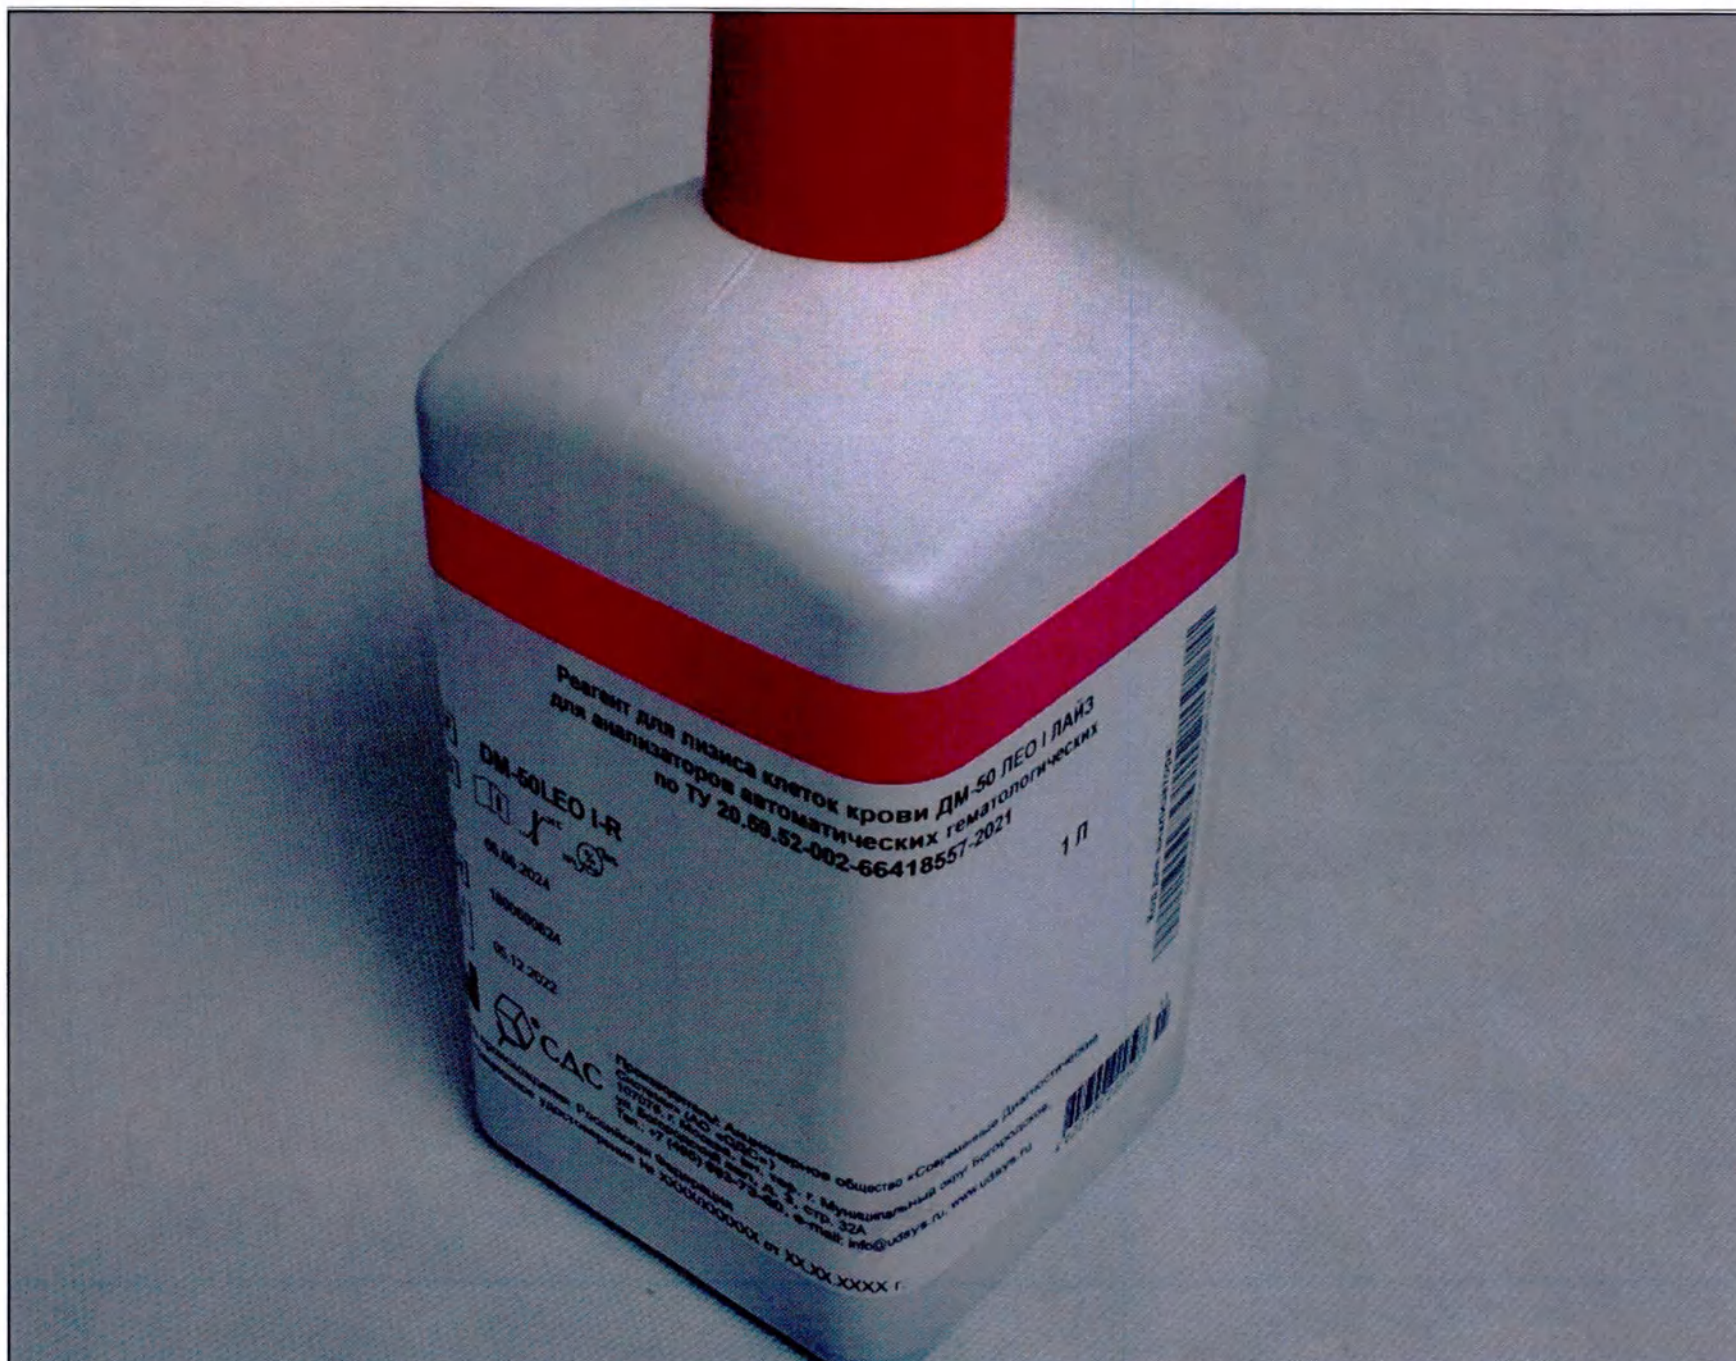


Рис. 14. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 15. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 LX ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

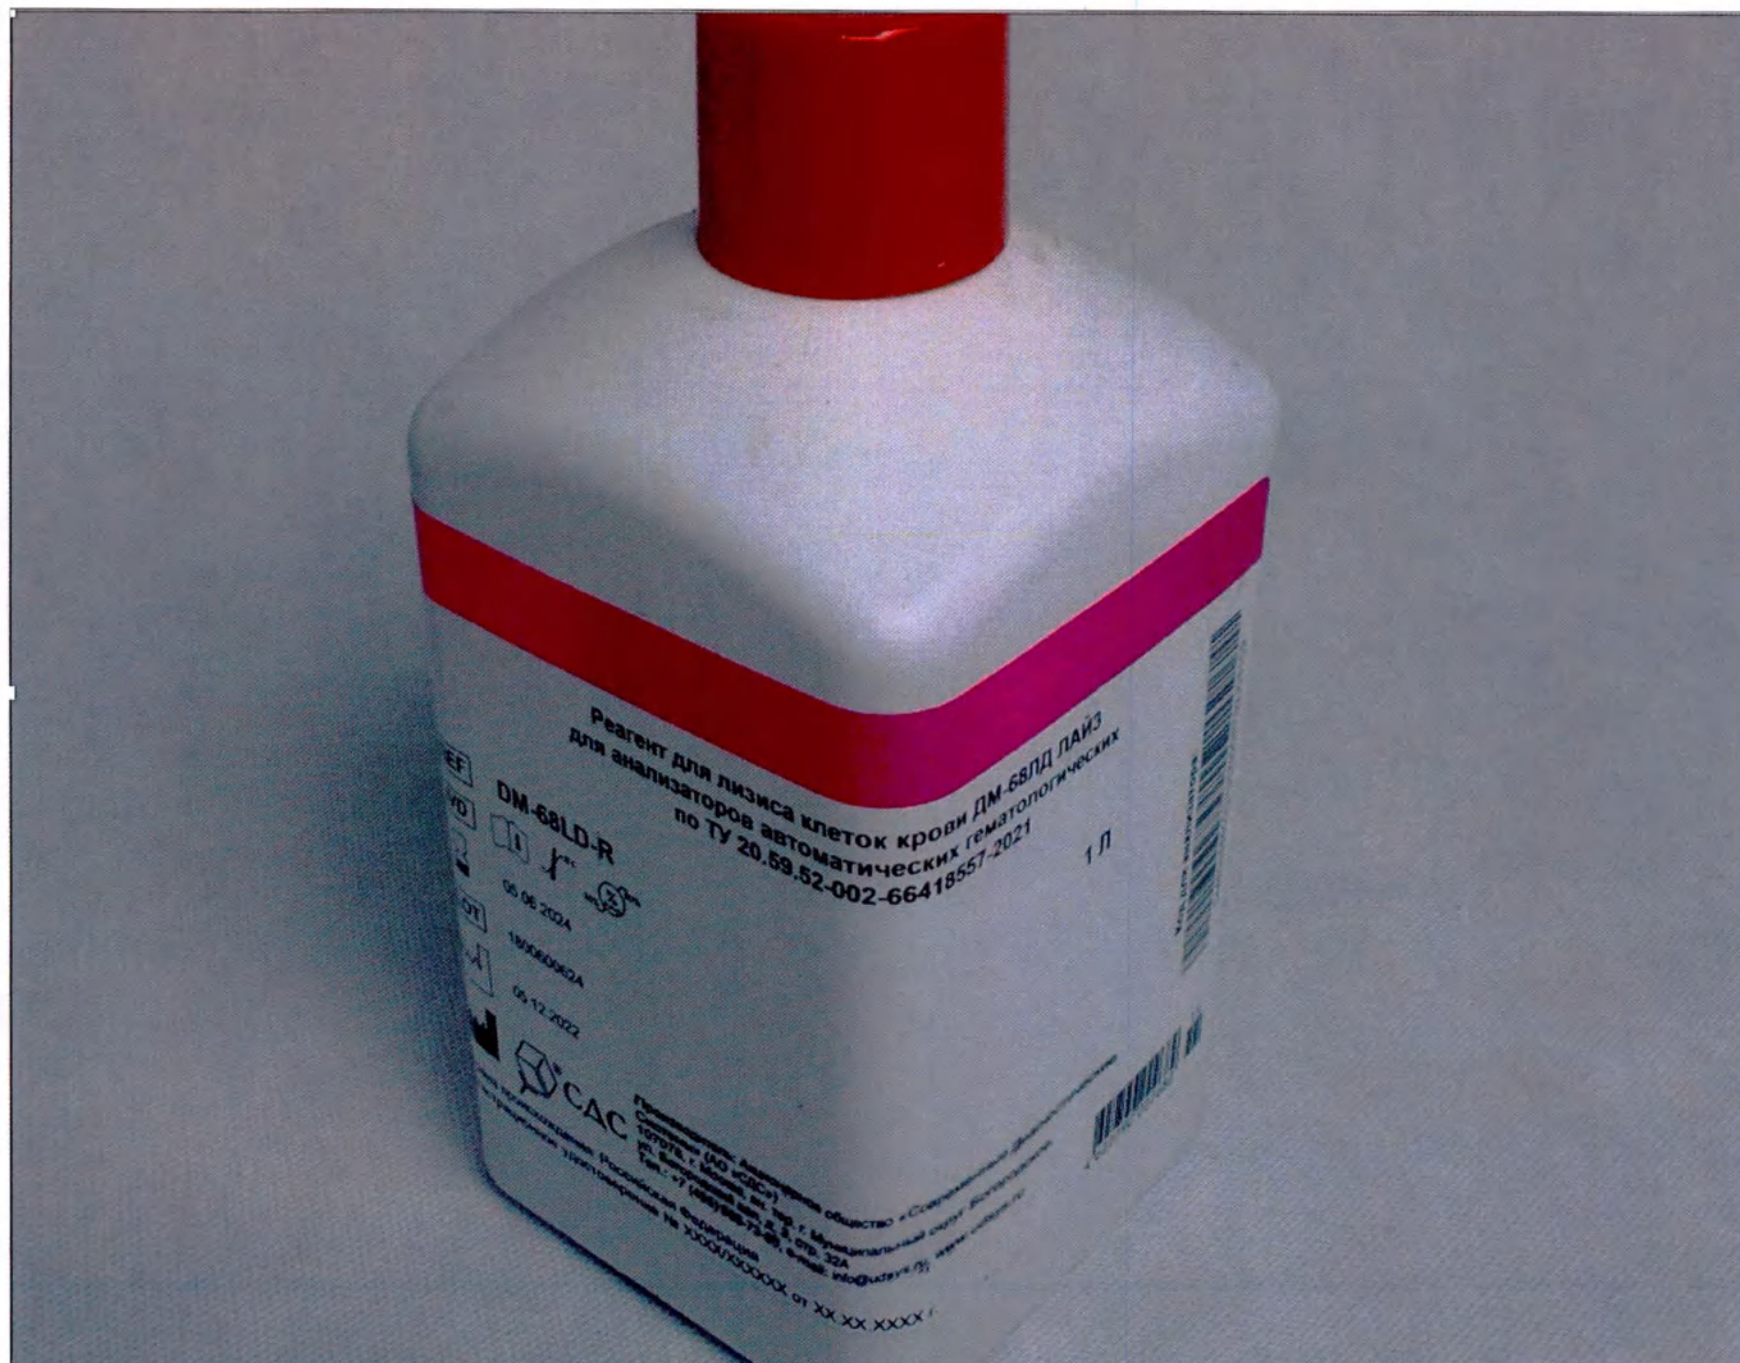


Рис. 16. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛД ЛАИЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

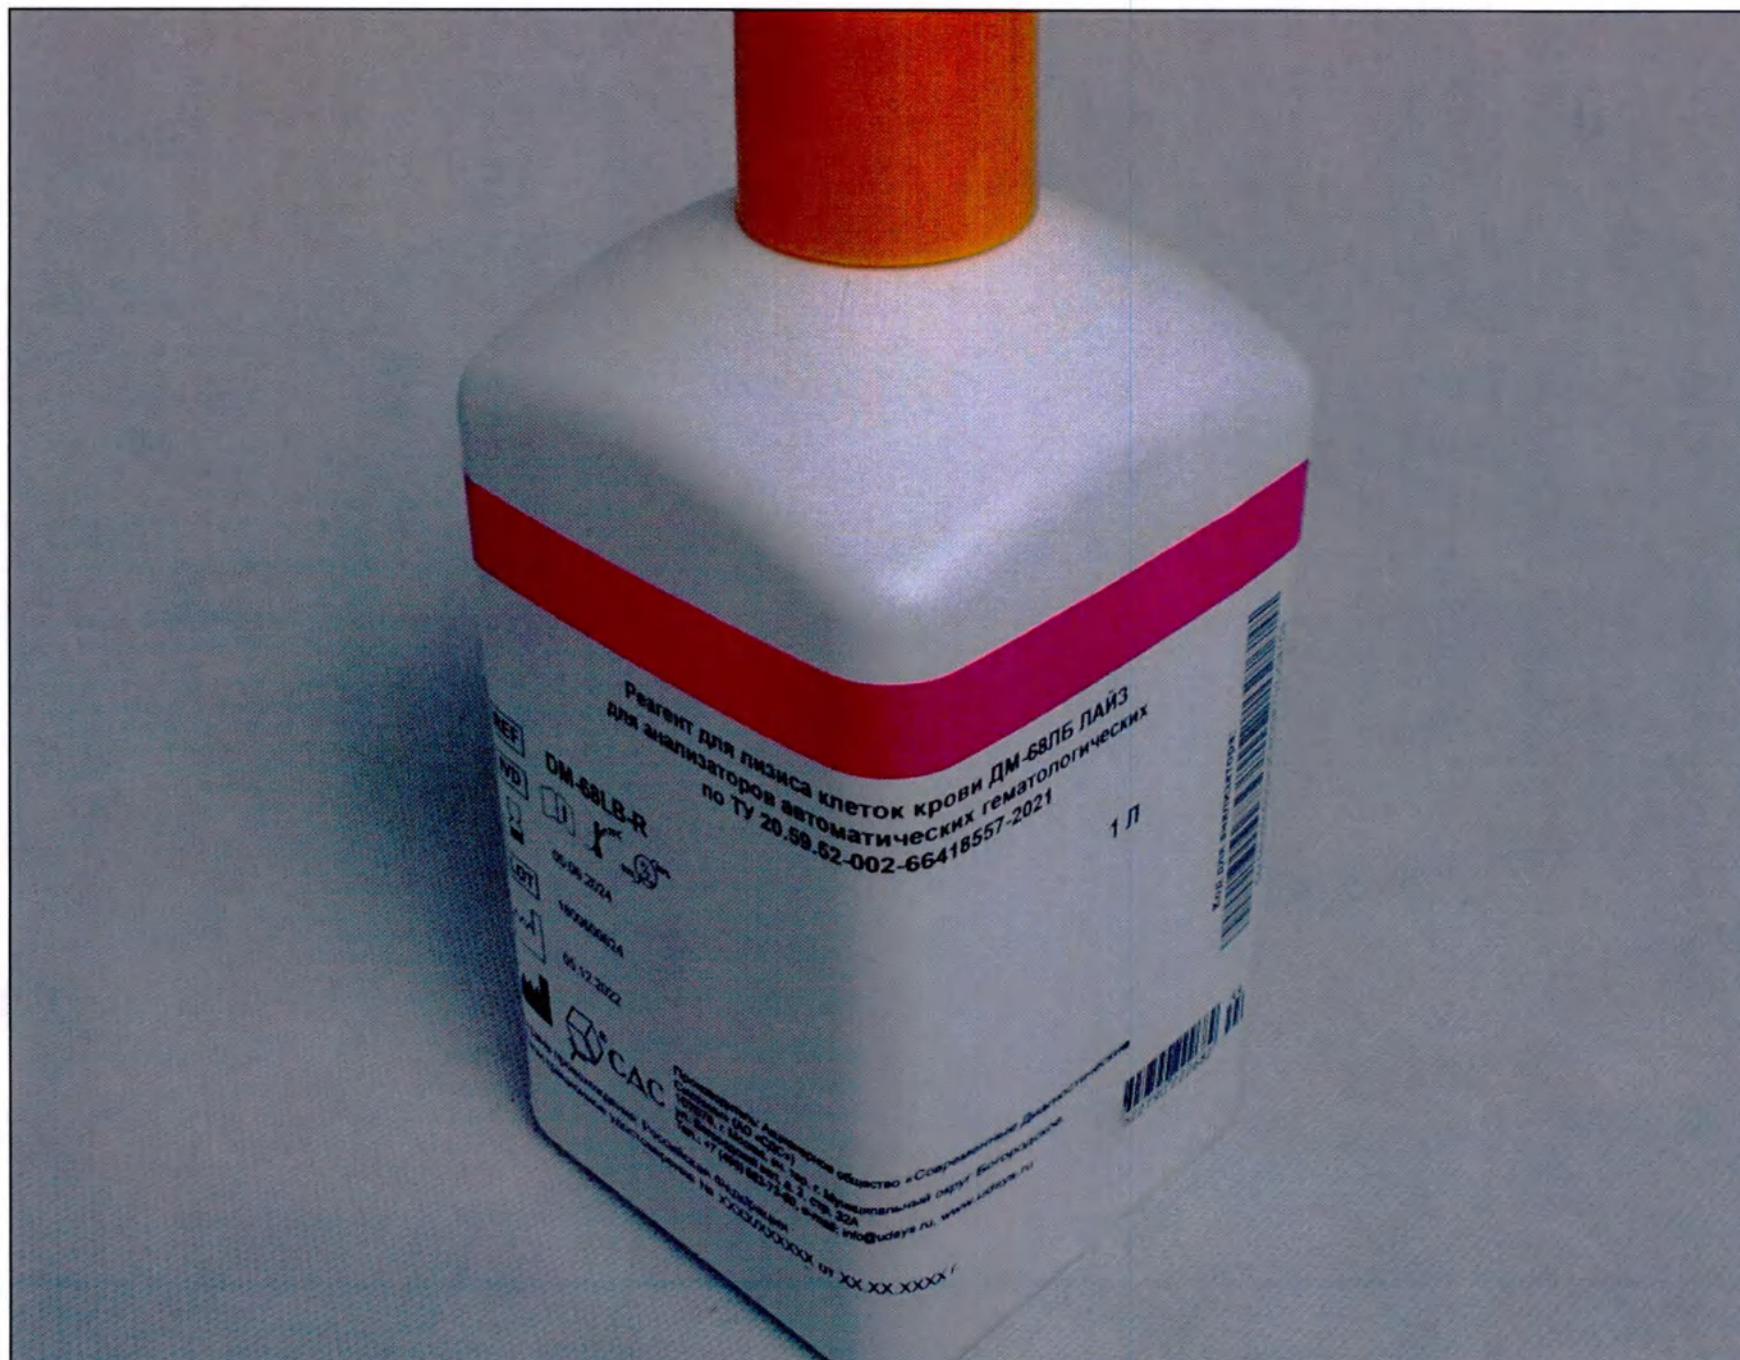


Рис. 17. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛБ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

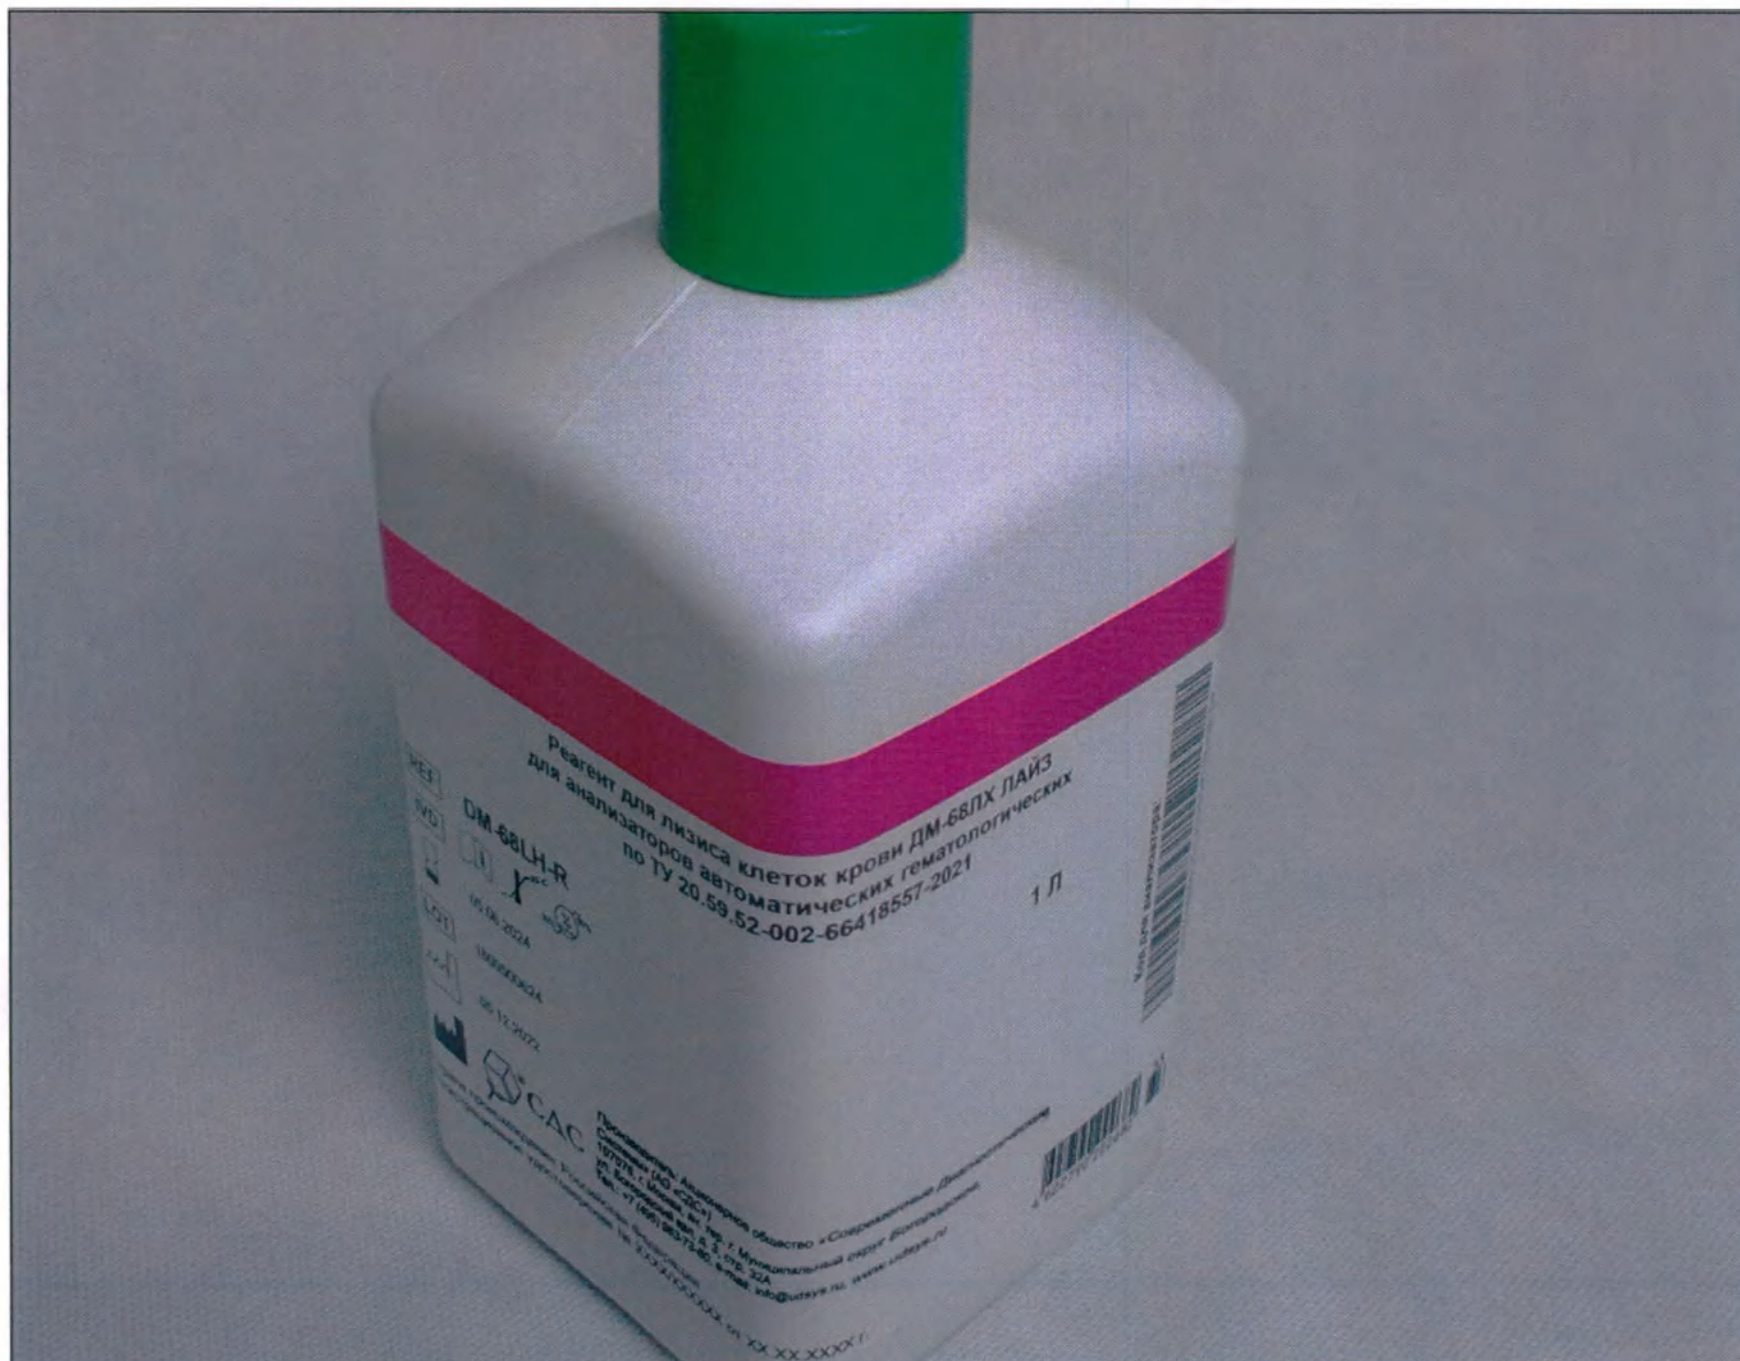


Рис. 18. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛХ ЛАИЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

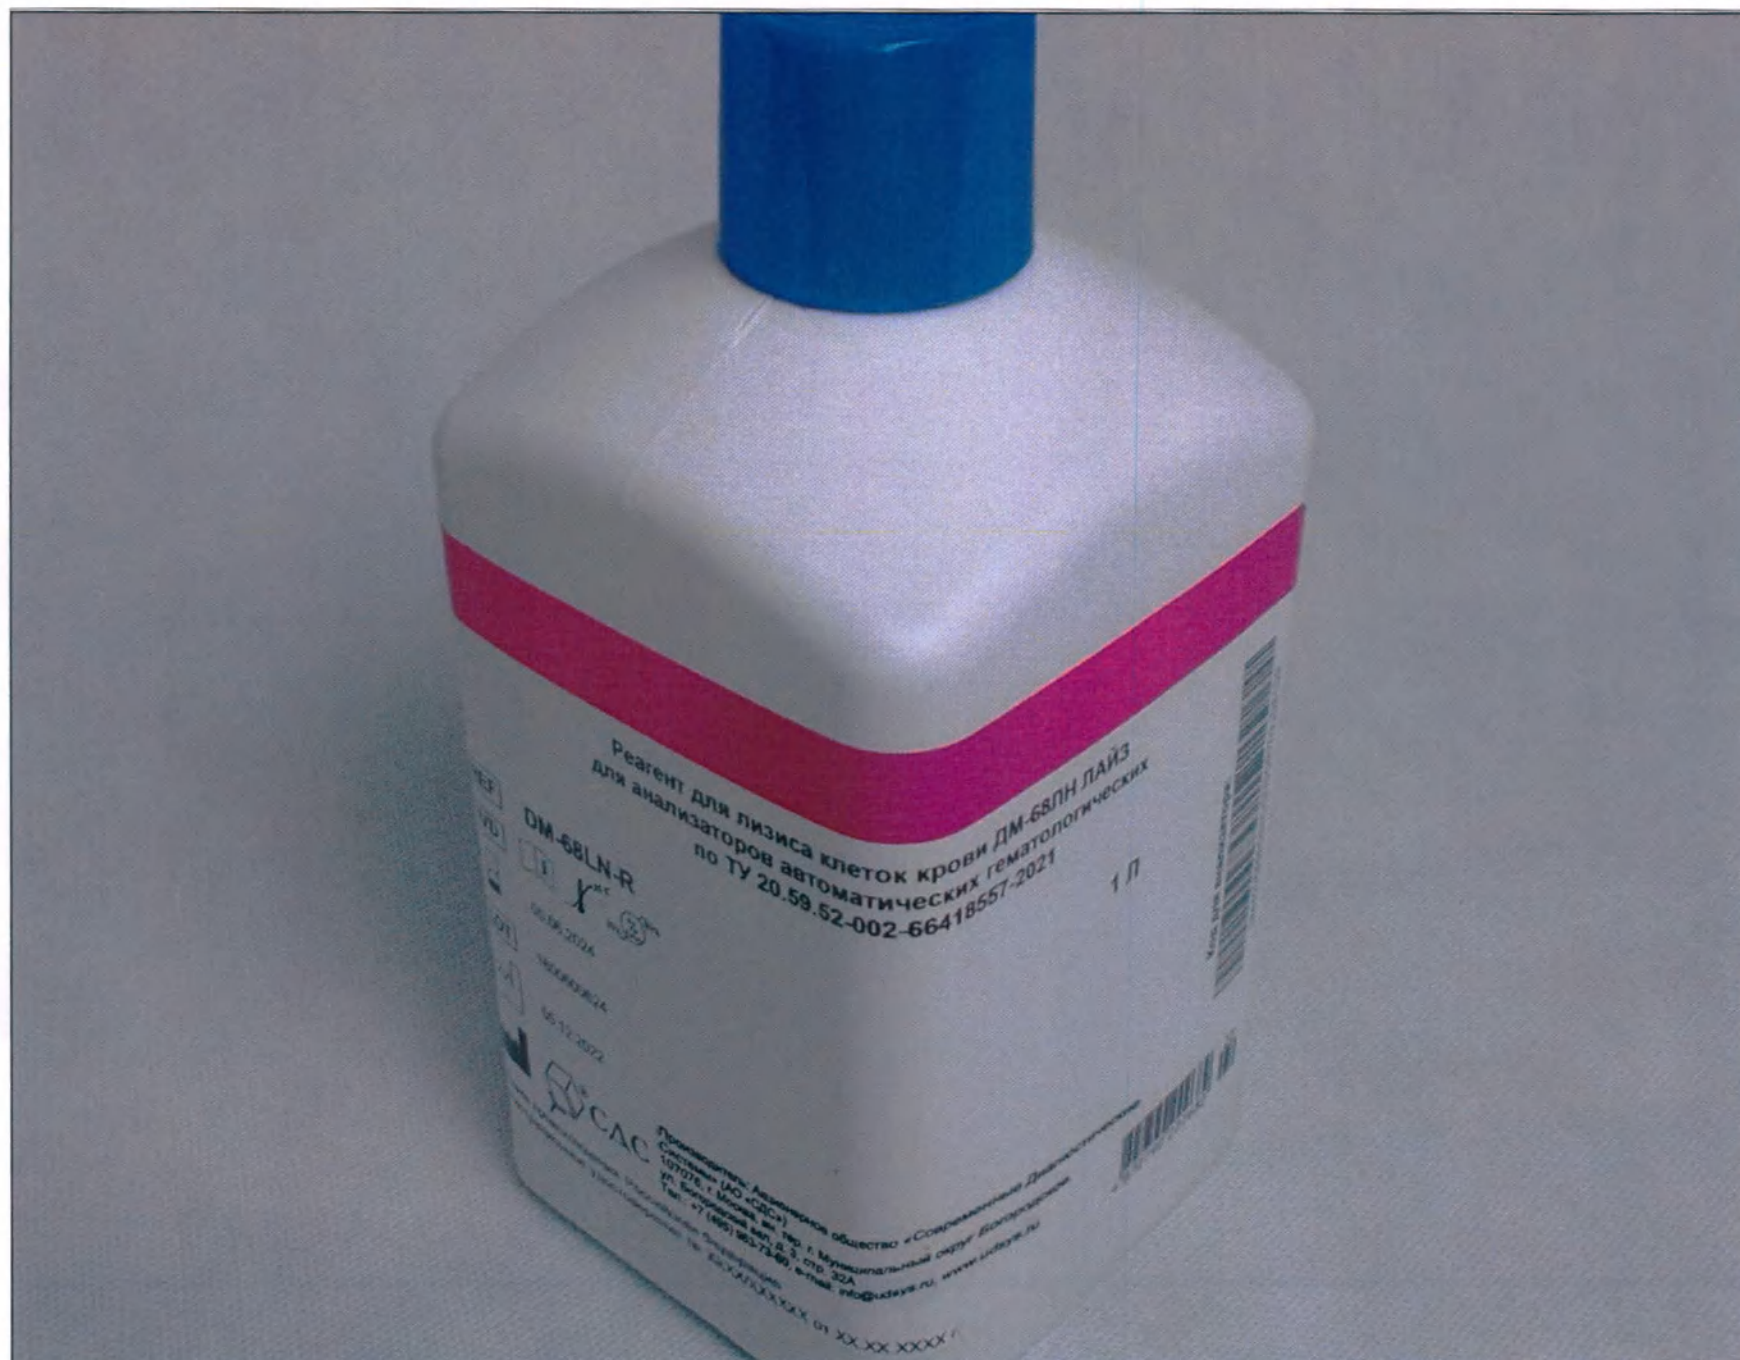


Рис. 19. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛН ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 20. Реагент для лизиса клеток крови ДИАЛАЙЗ-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 21. Реагент для лизиса клеток крови ДИАГЛОБИН-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 22. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Дифф-ЛМЖ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 23. Реагент для лизиса клеток крови Диафикс ЕО 5 Дифф.П60 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 24. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,4 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

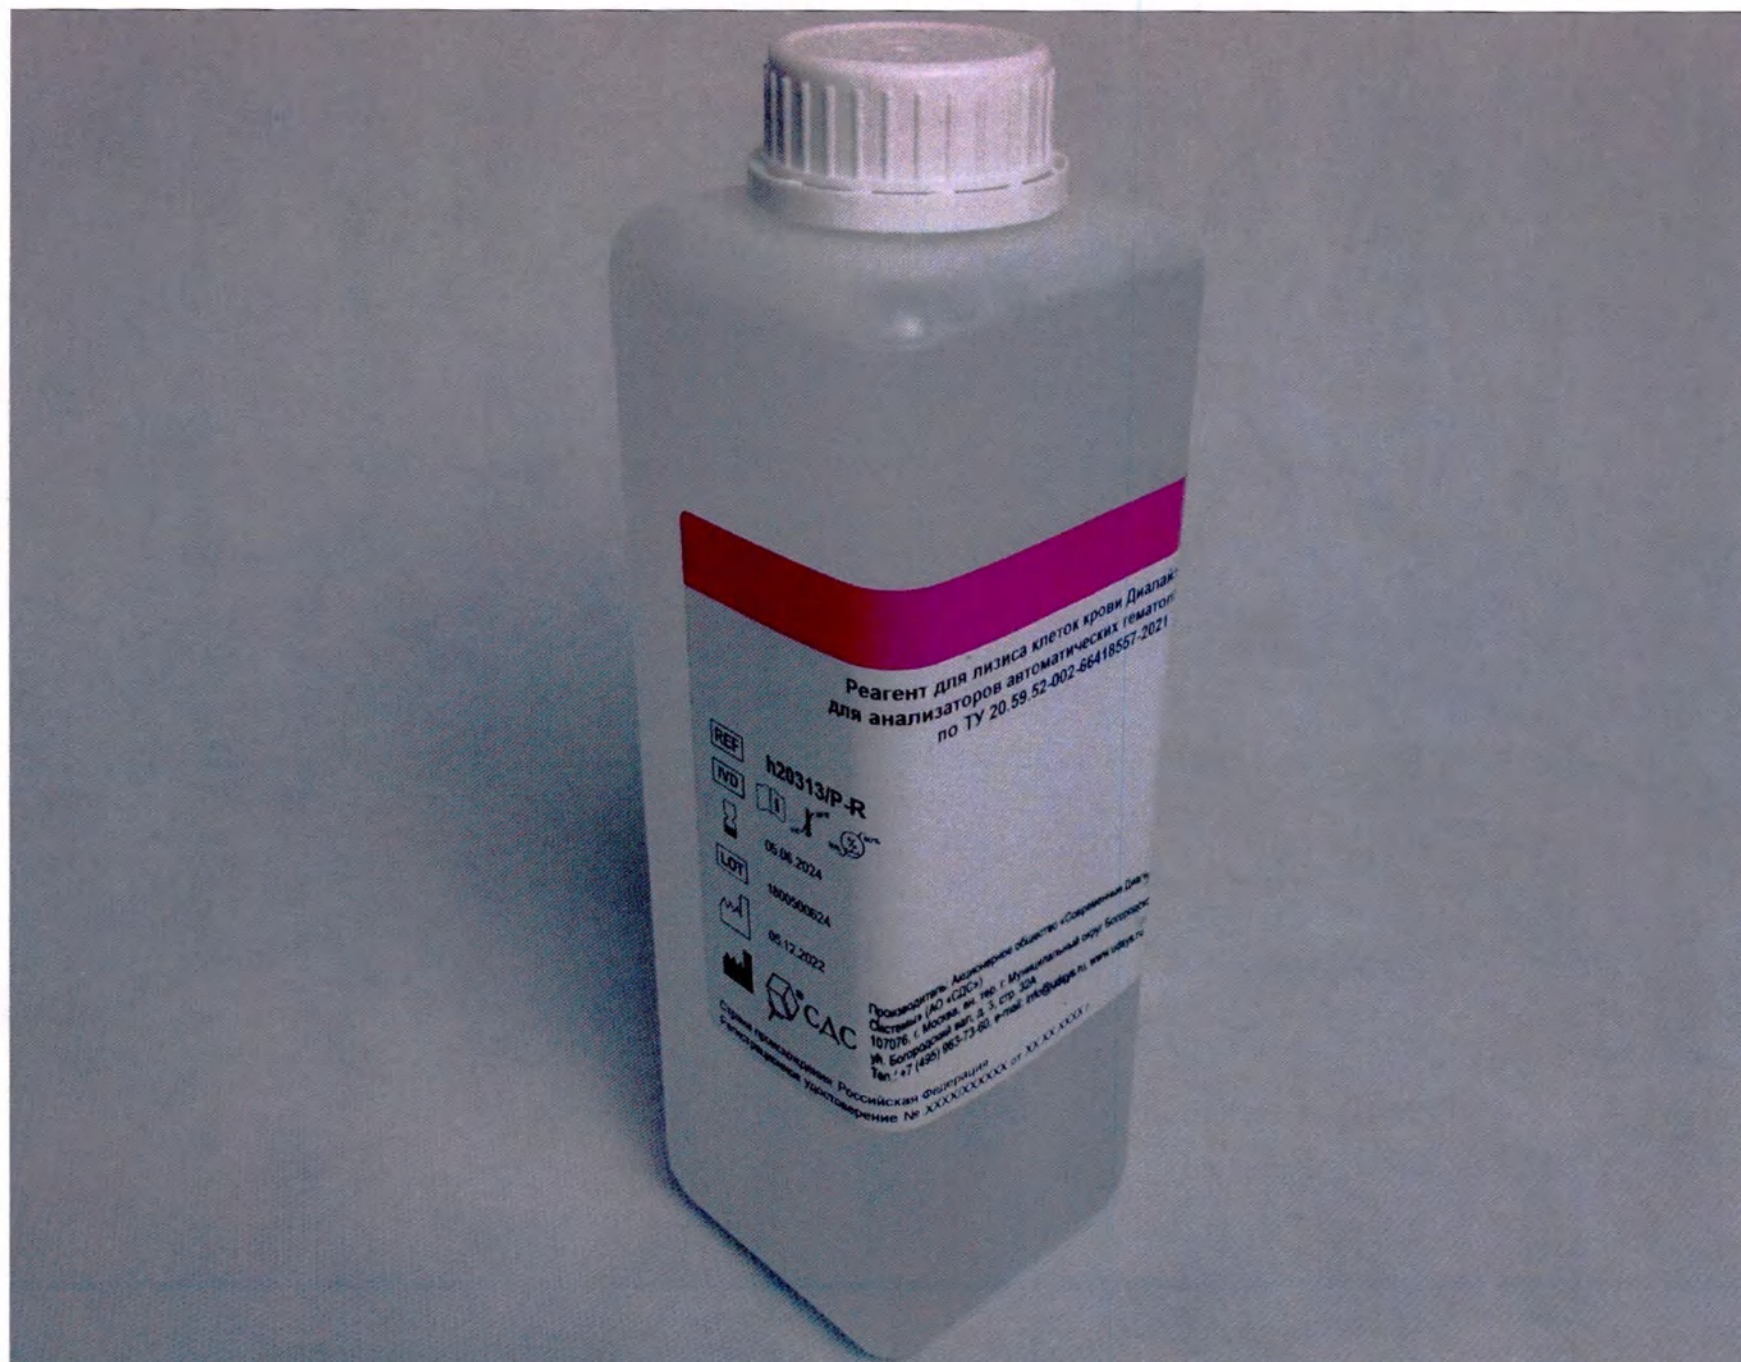


Рис. 26. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Базо II для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 27. Реагент для лизиса клеток крови Диафикс ЭО 5 Дифф.П120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 28. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Базо 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 29. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.

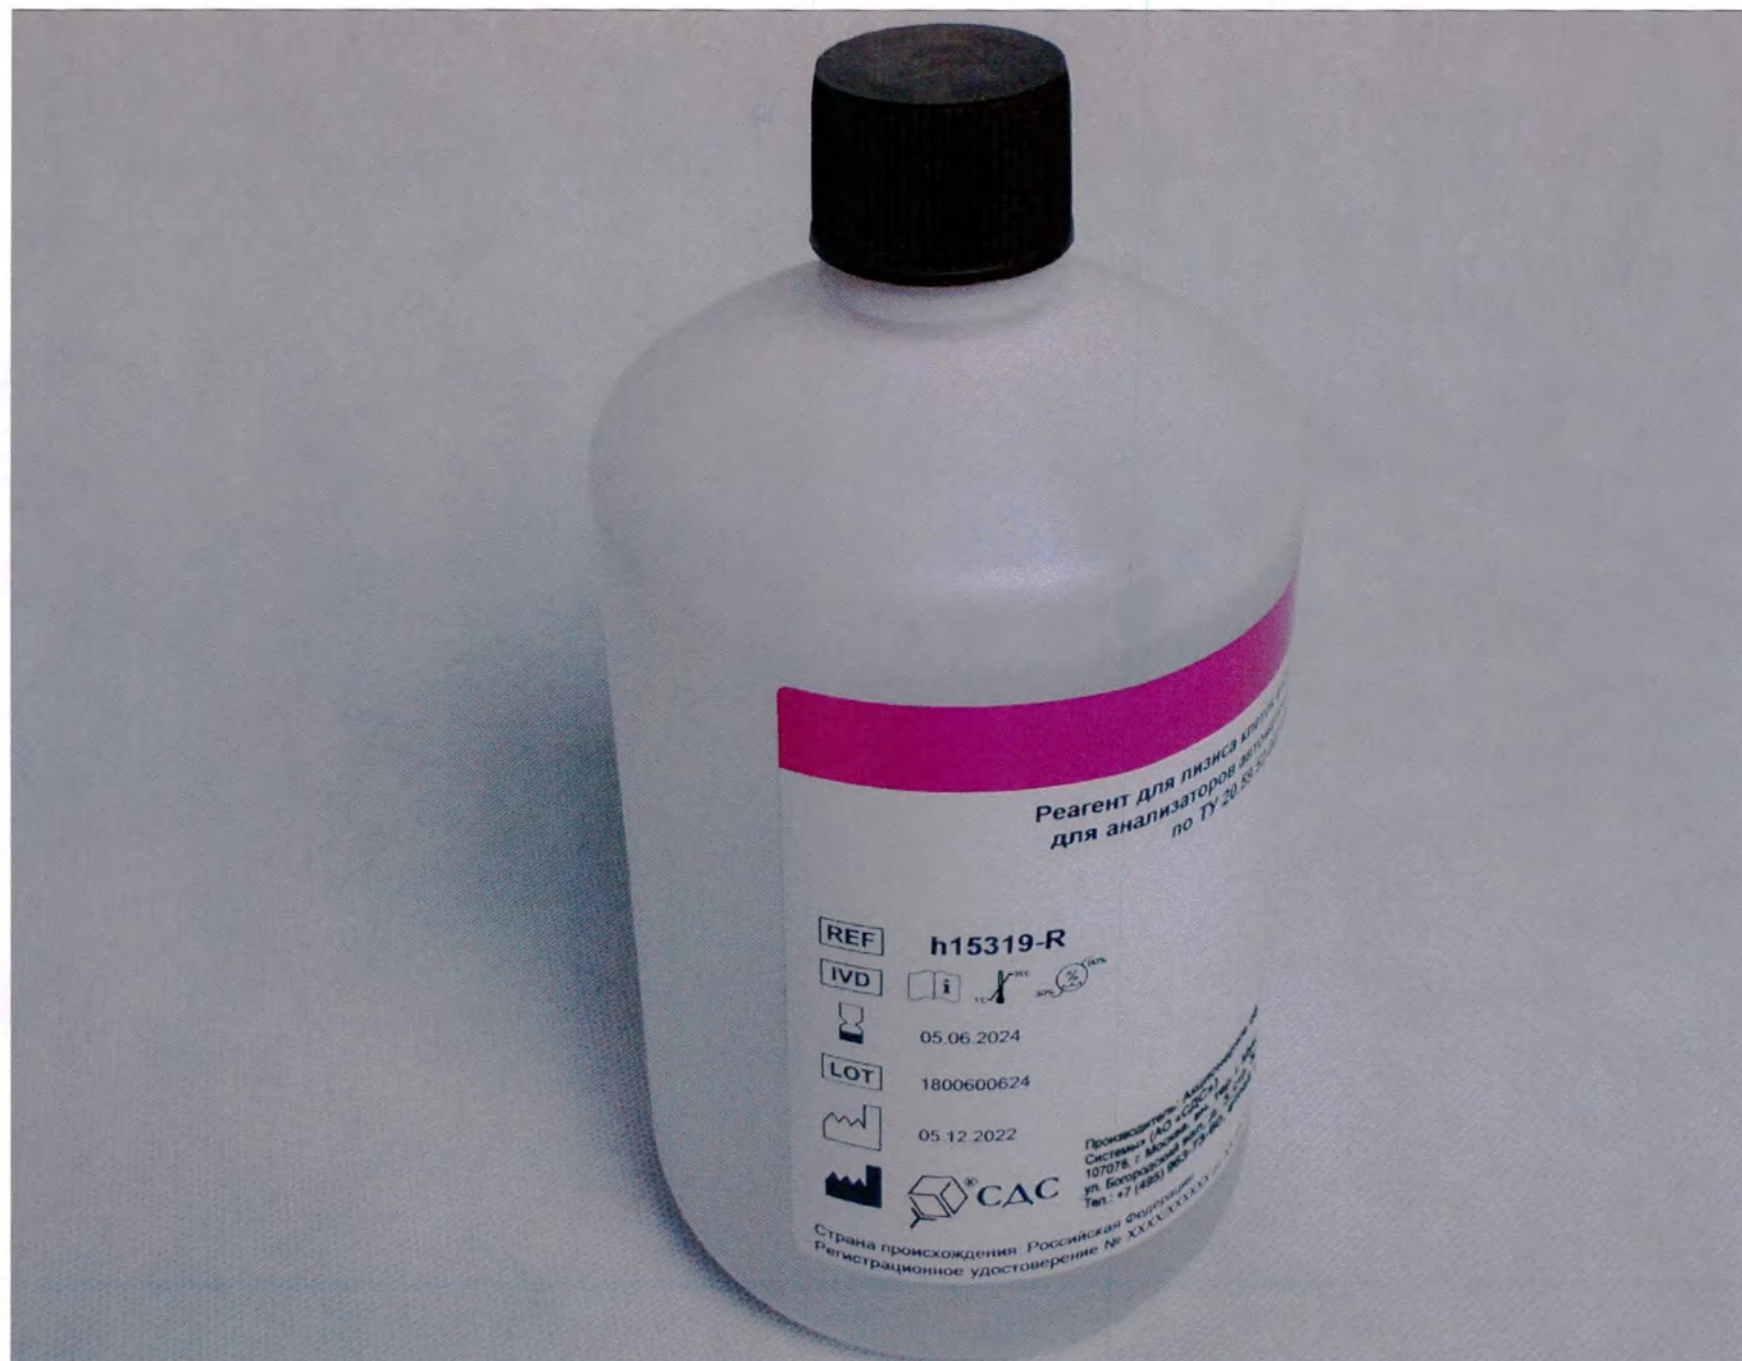


Рис. 30. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 31. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 33. Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,85 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

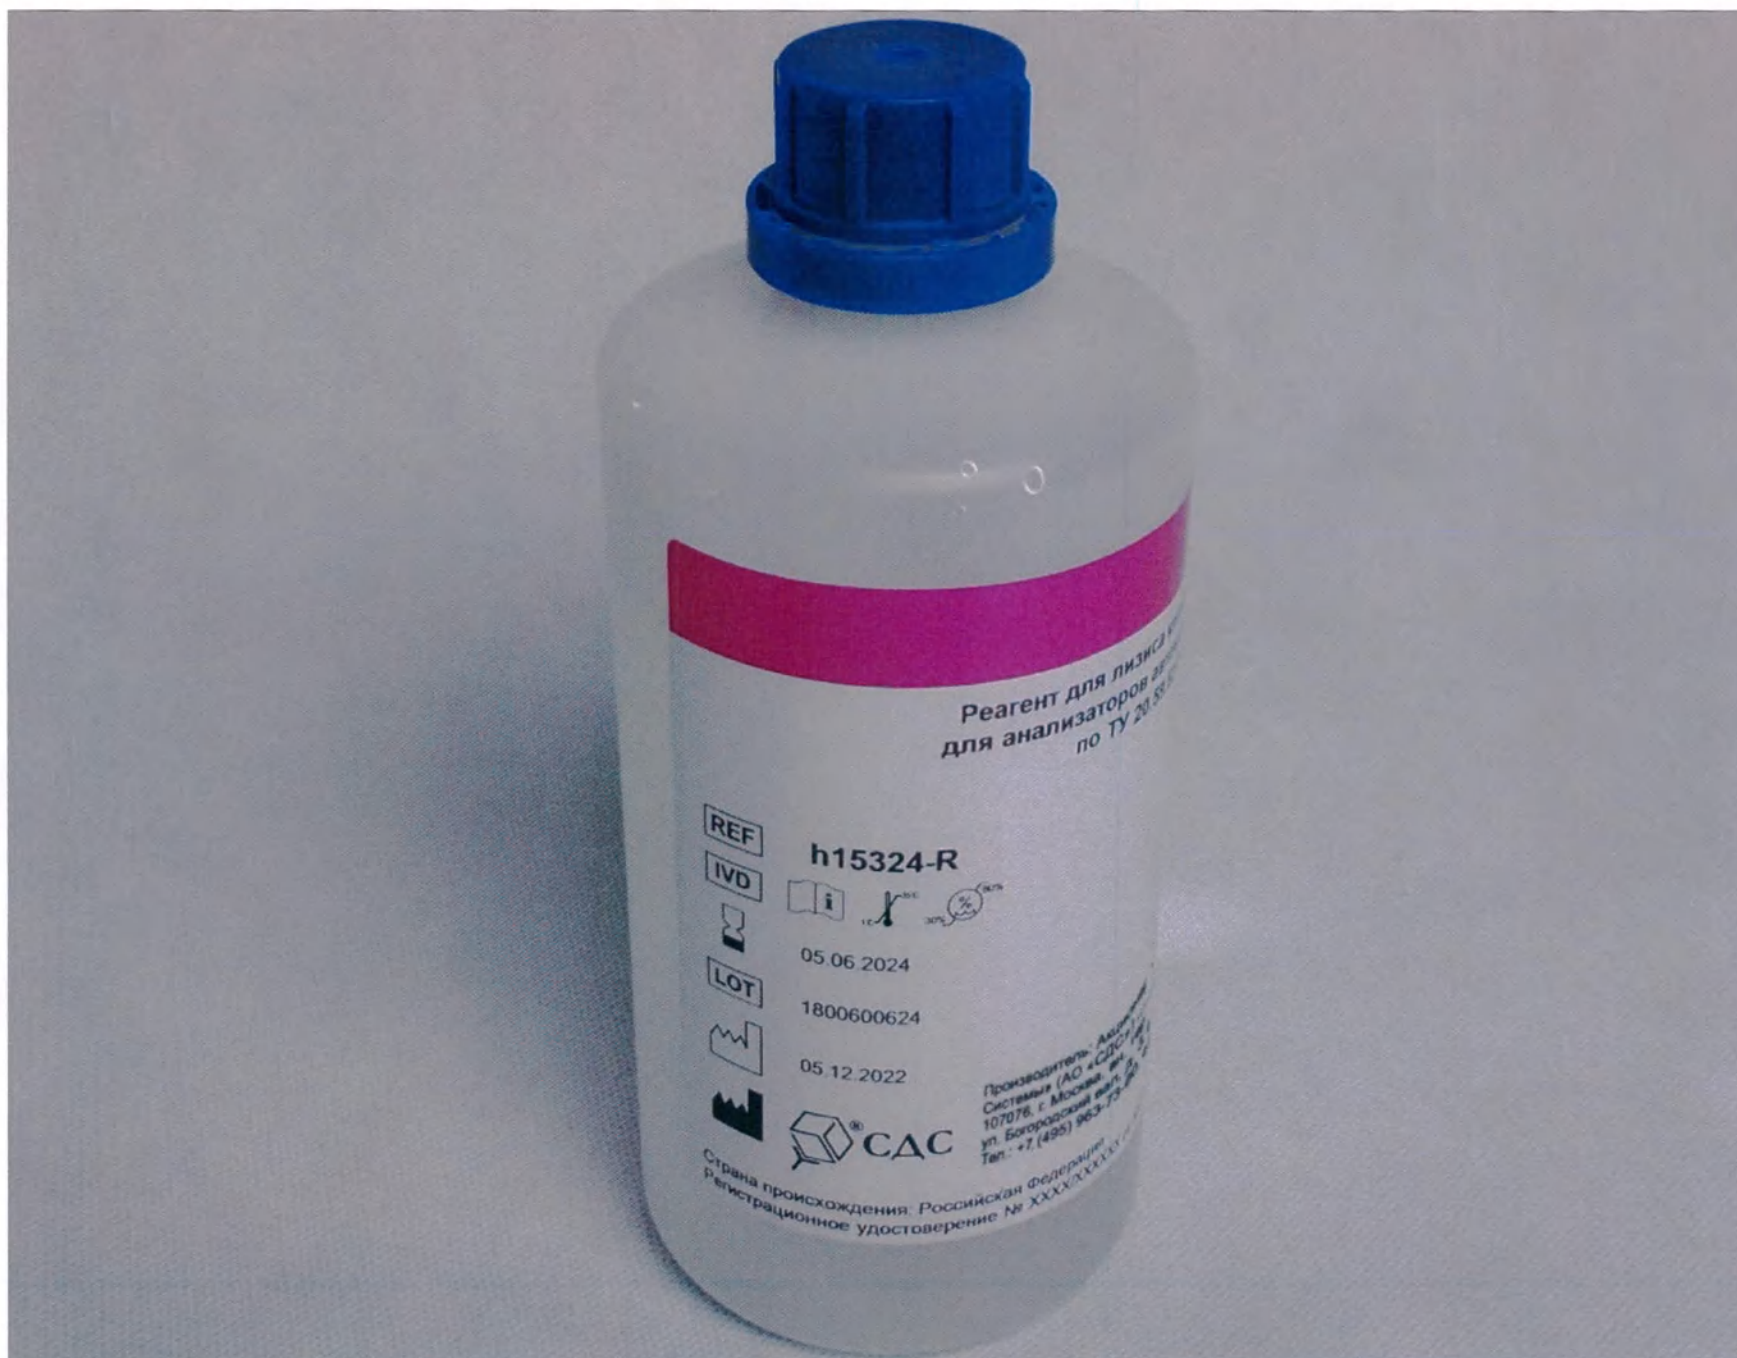


Рис. 34. Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 35. Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,35 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

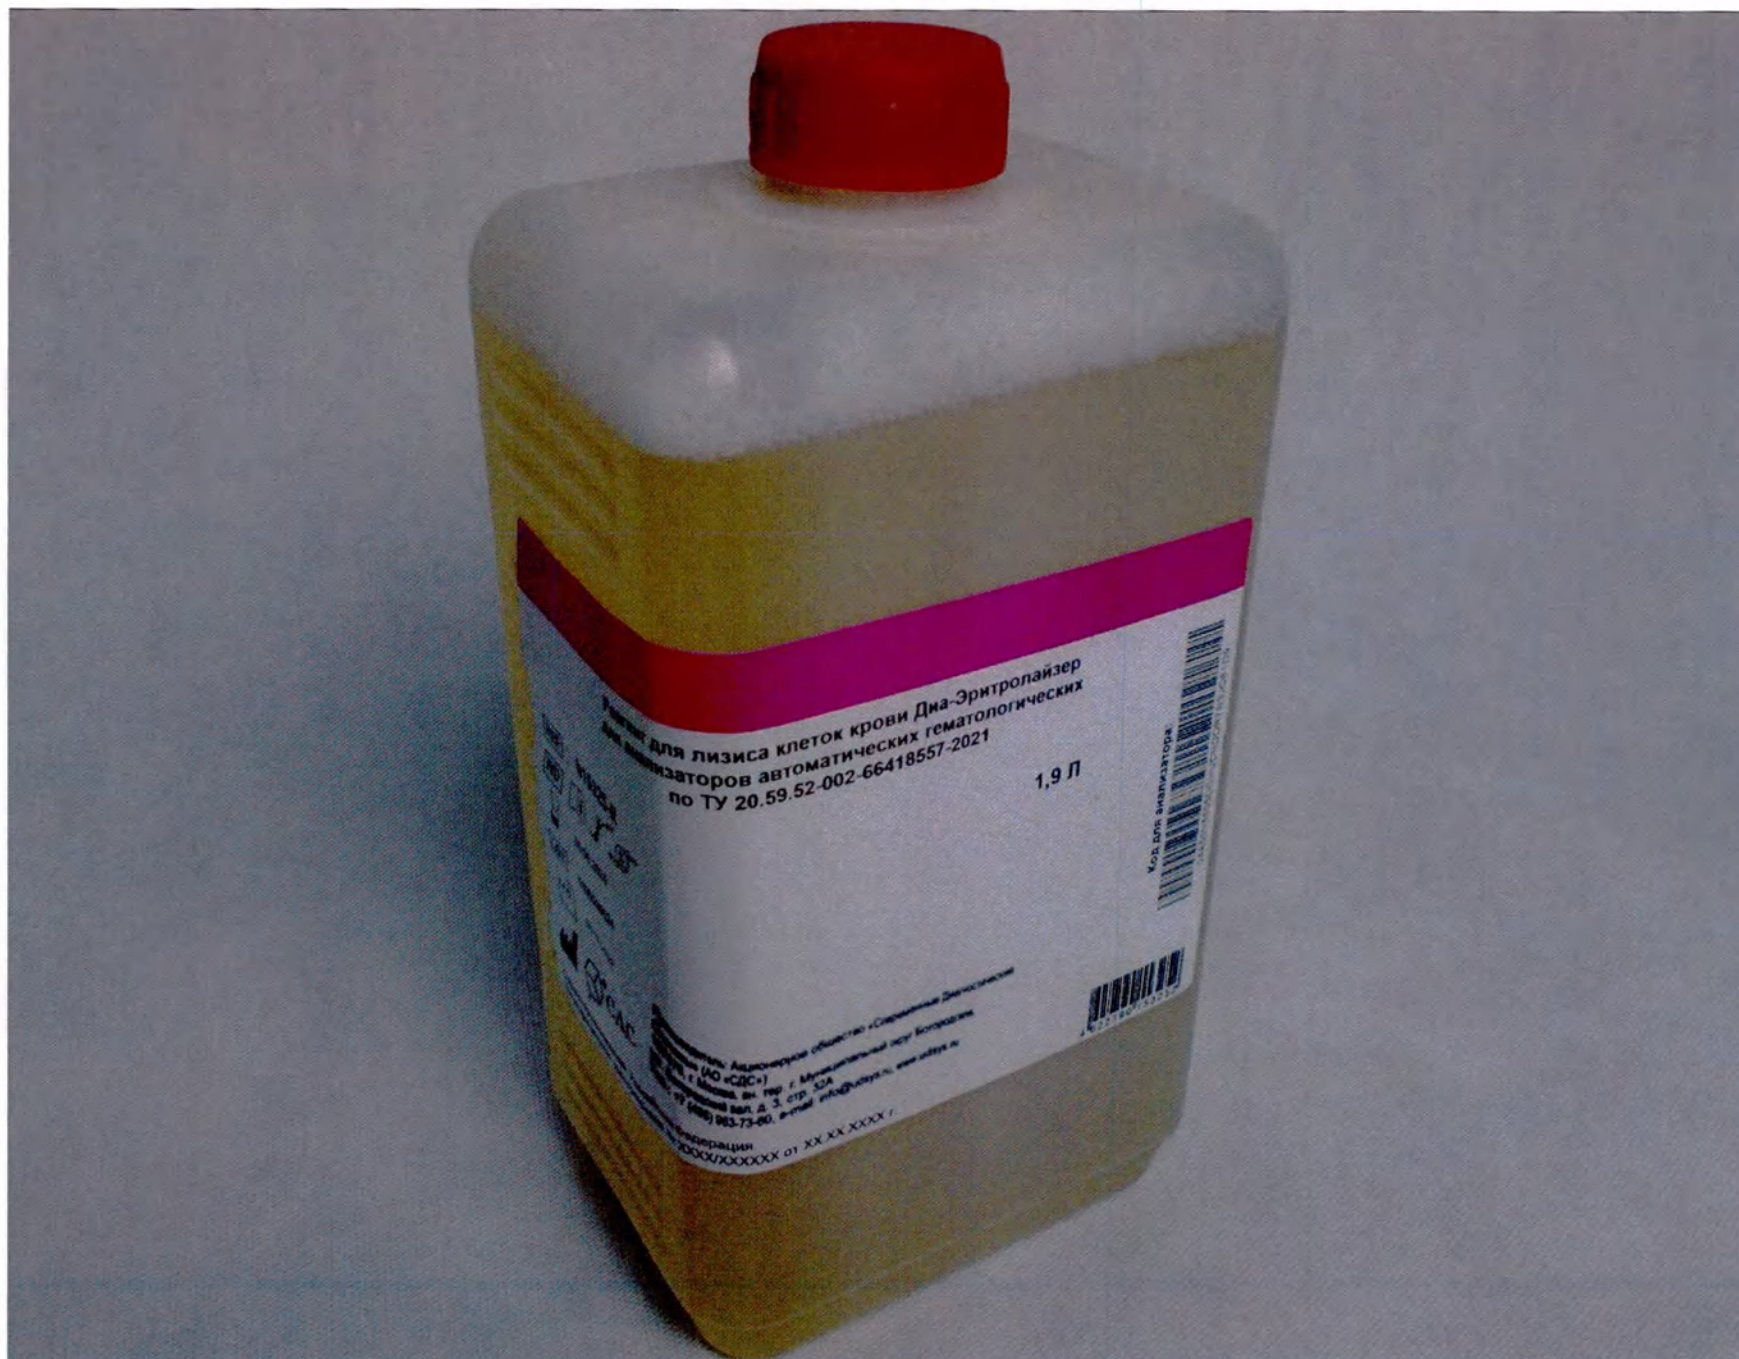


Рис. 36. Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,9 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

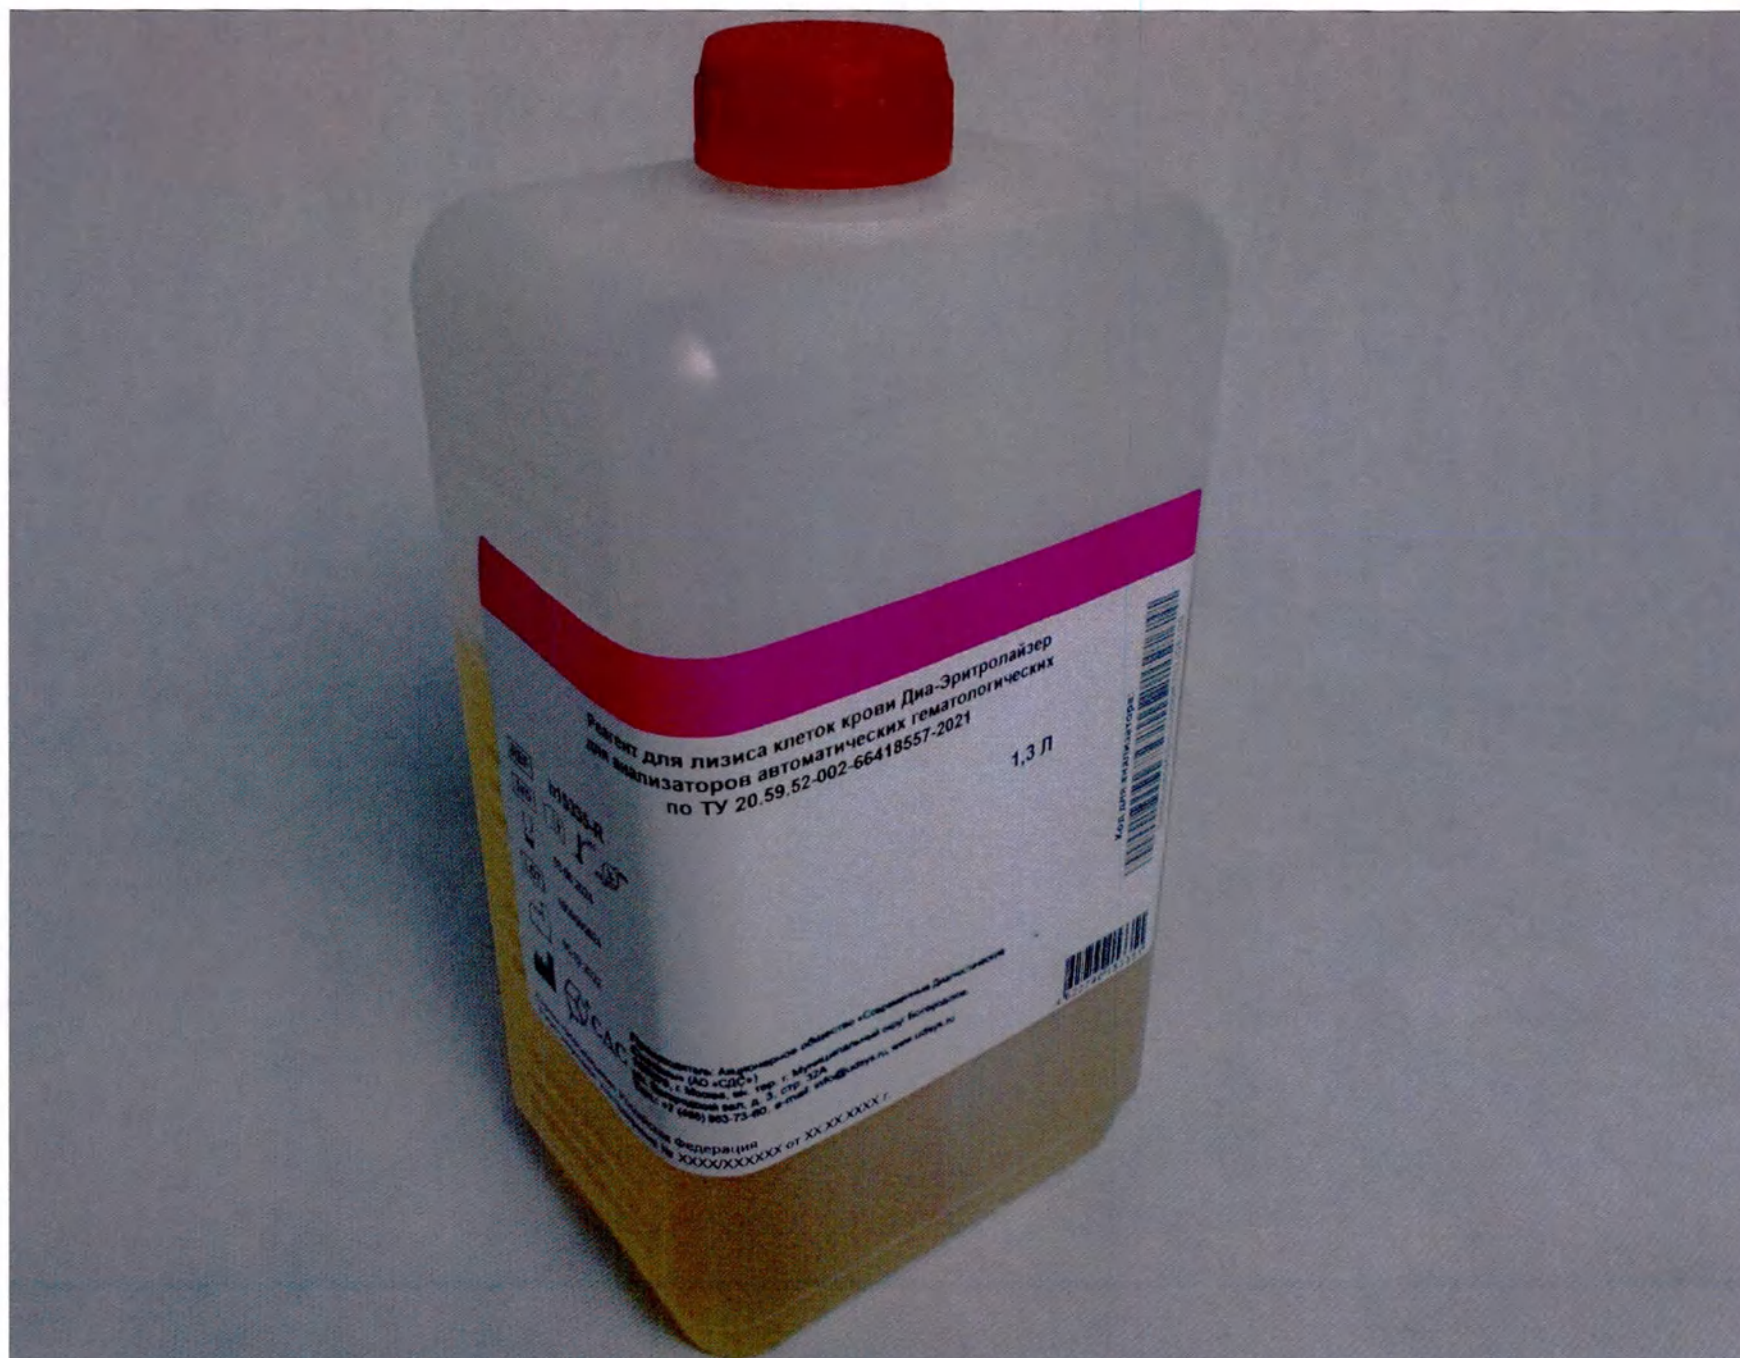


Рис. 37. Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,3 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 38. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.

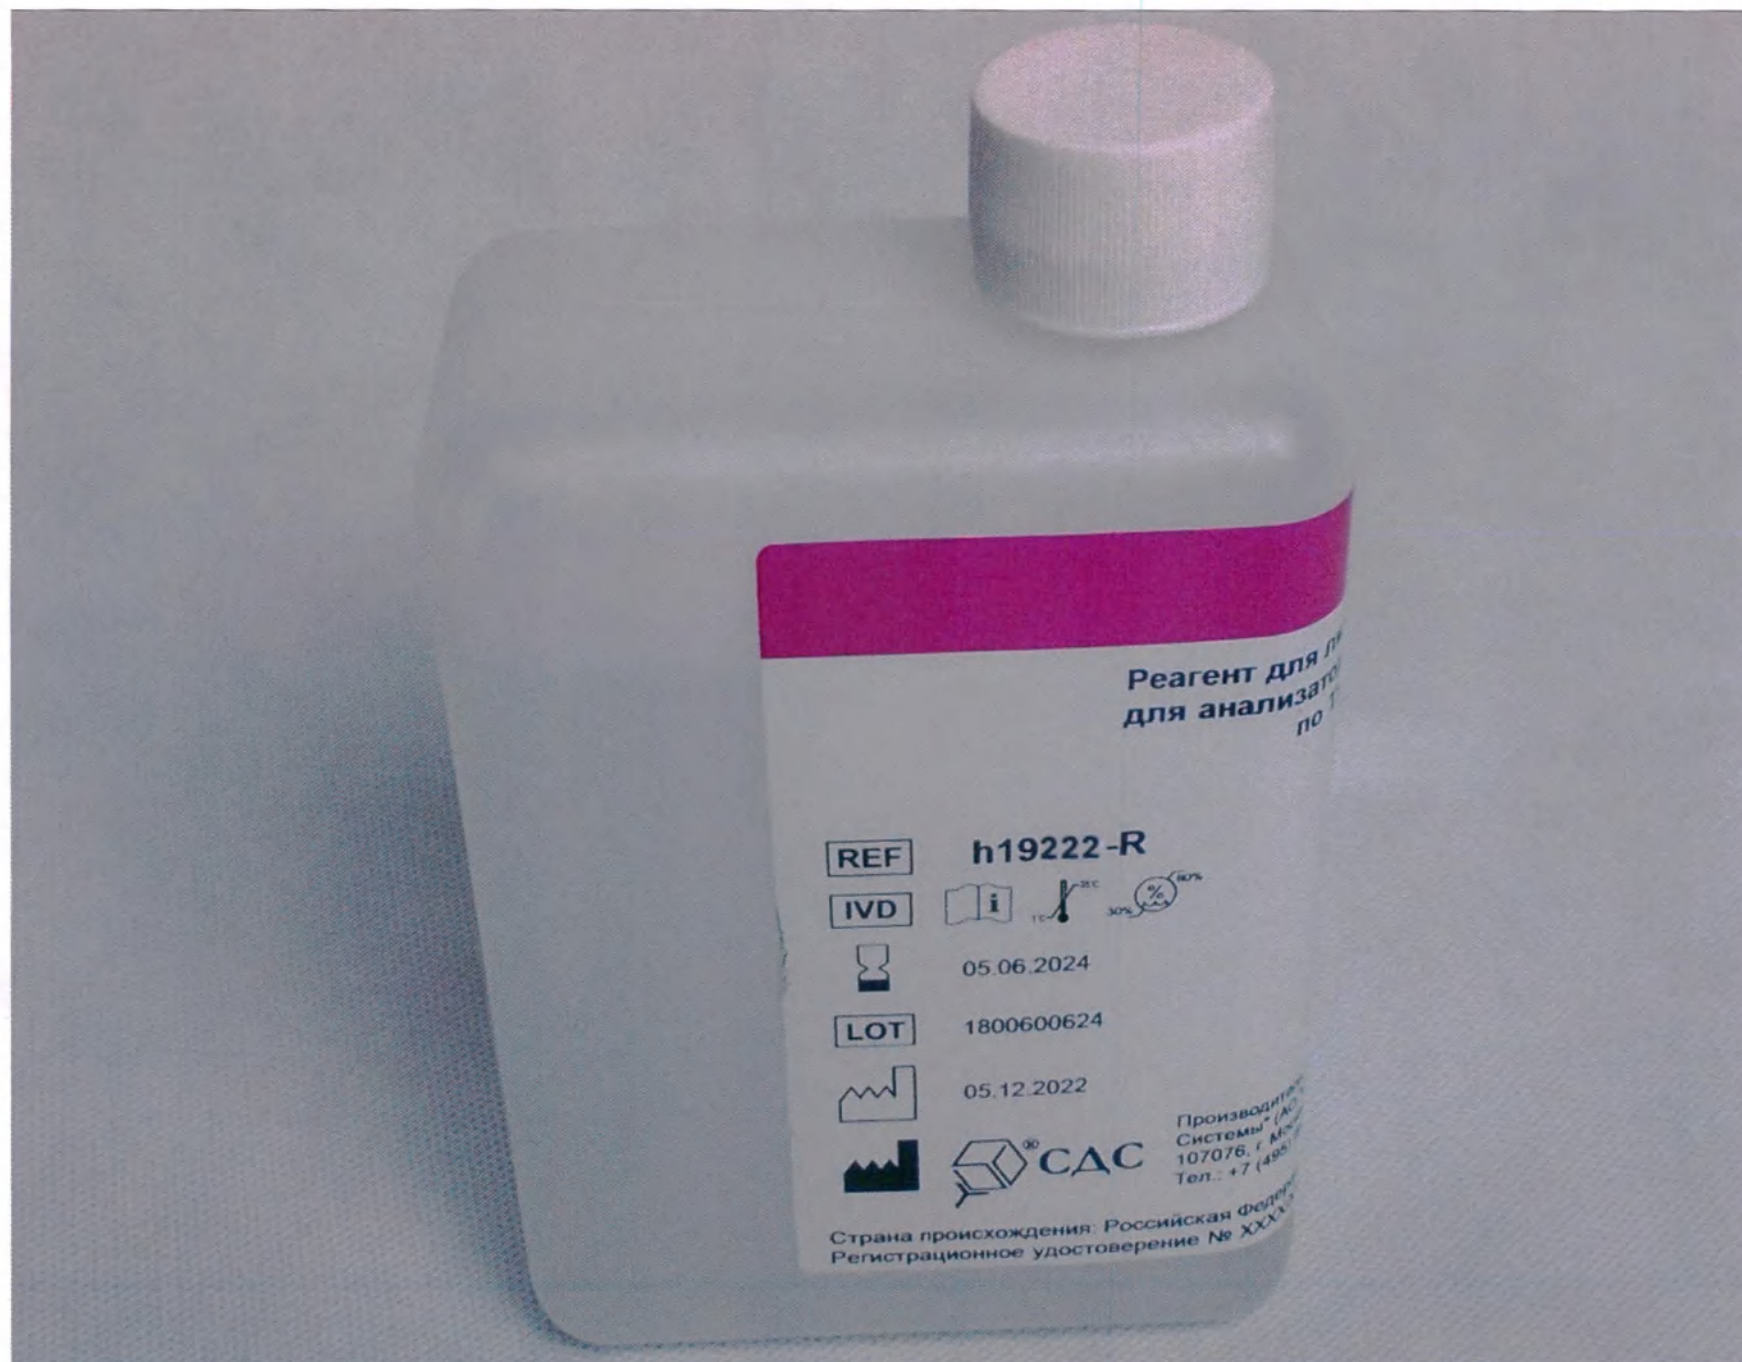


Рис. 39. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 40. Реагент для лизиса клеток крови Диатерг-НК для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.

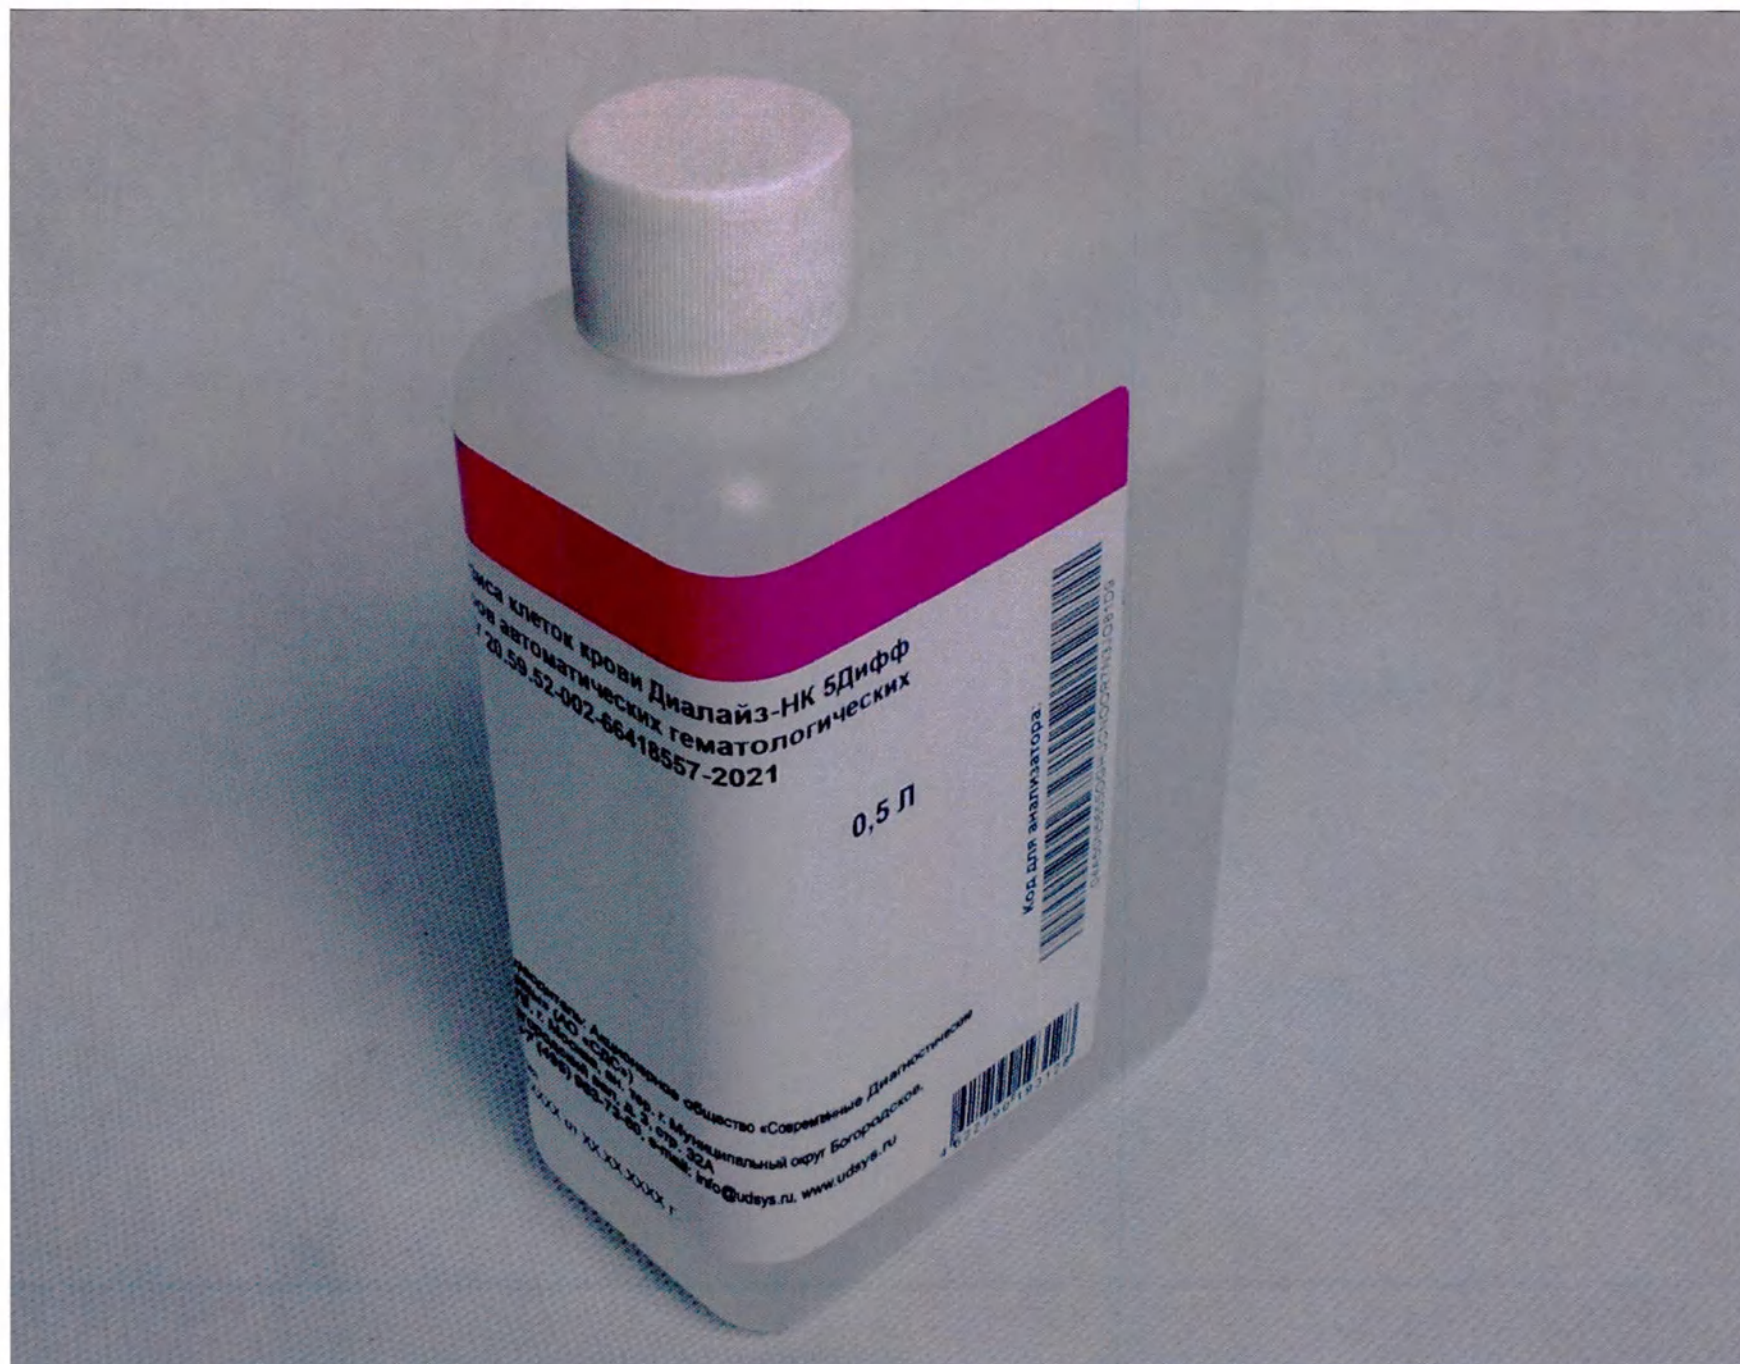


Рис. 41. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 42. Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 43. Реагент для лизиса клеток крови Диабазо А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

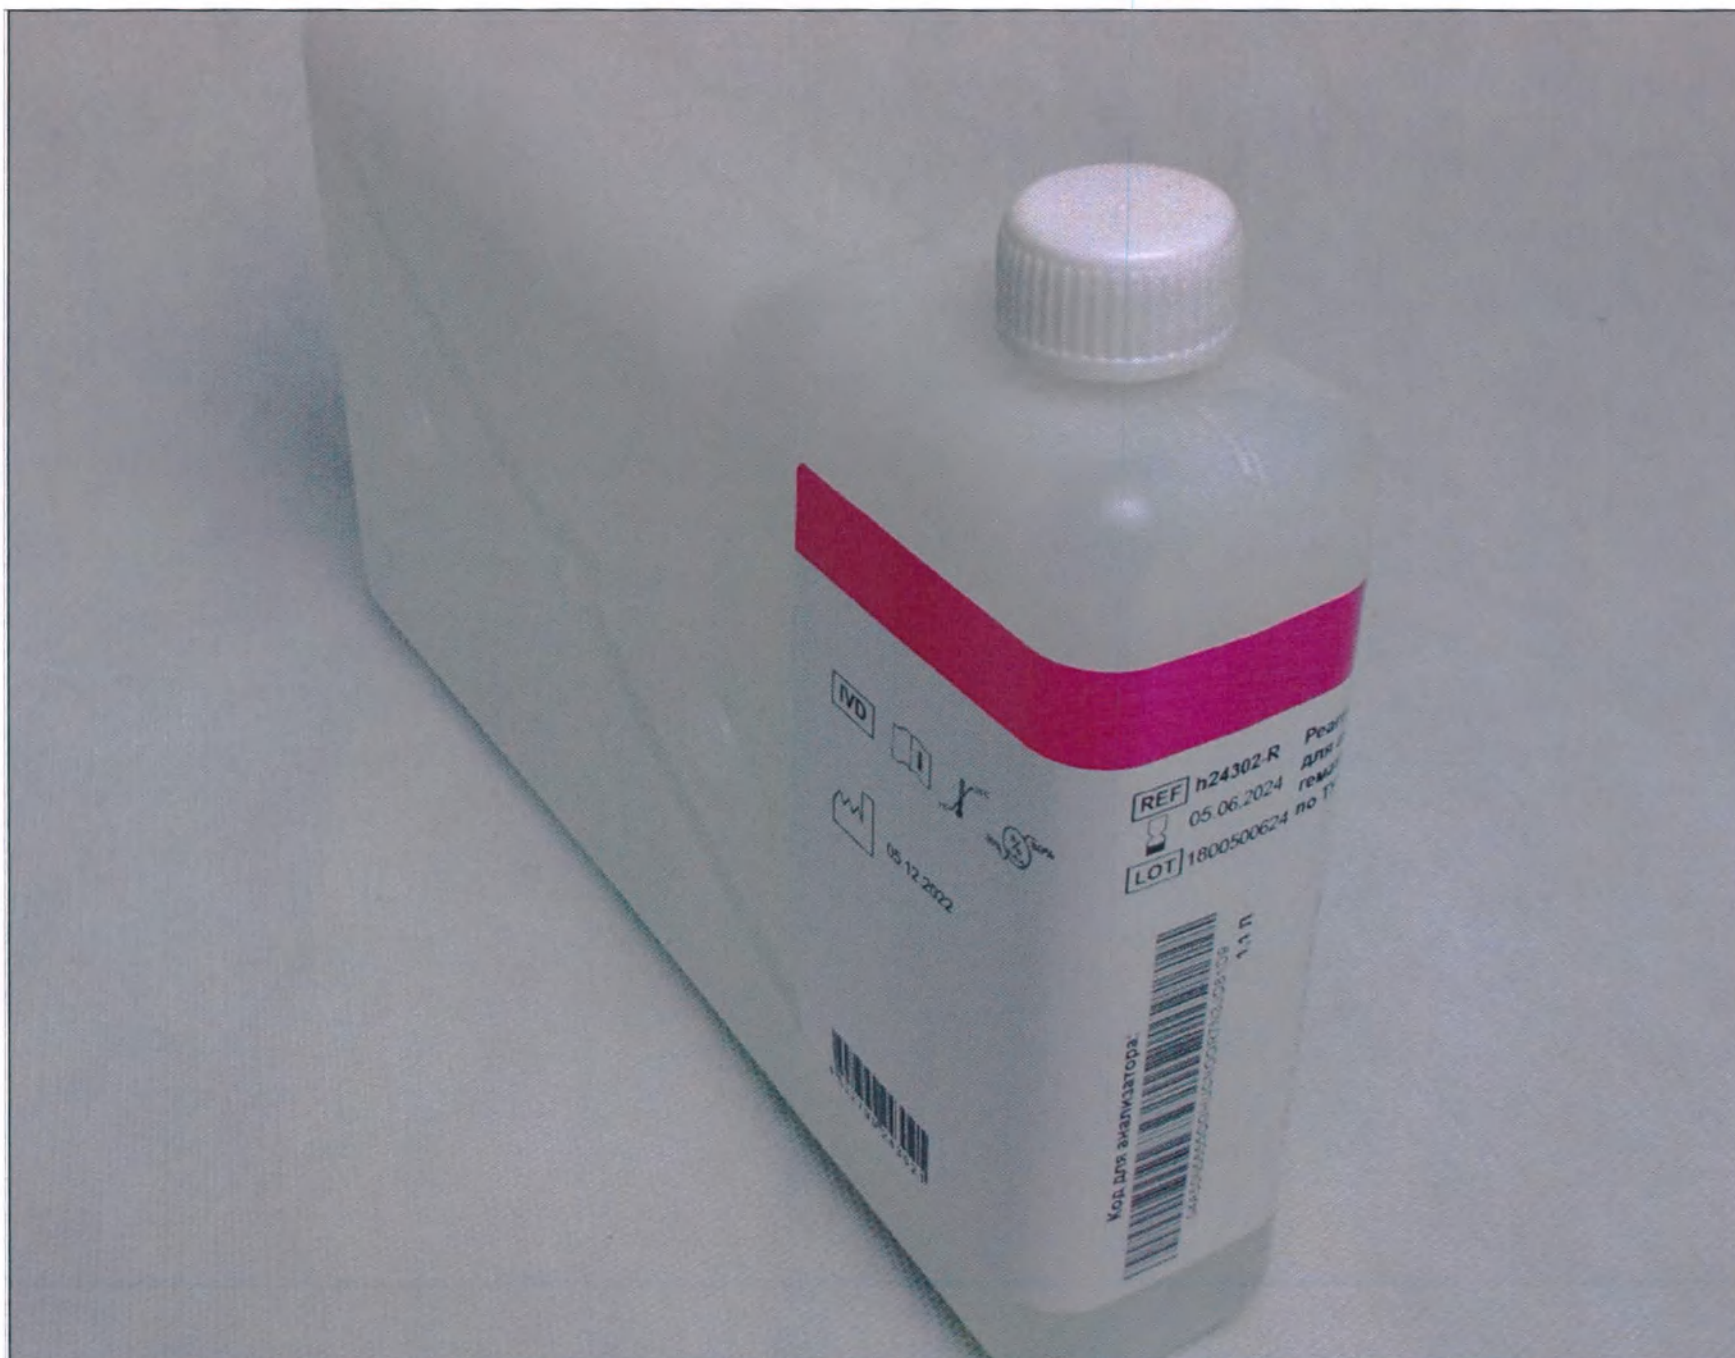


Рис. 44. Реагент для лизиса клеток крови ДиаЭйчб А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 45. Реагент для лизиса клеток крови Диа-РБЦ/ПЛТ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 2,7 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

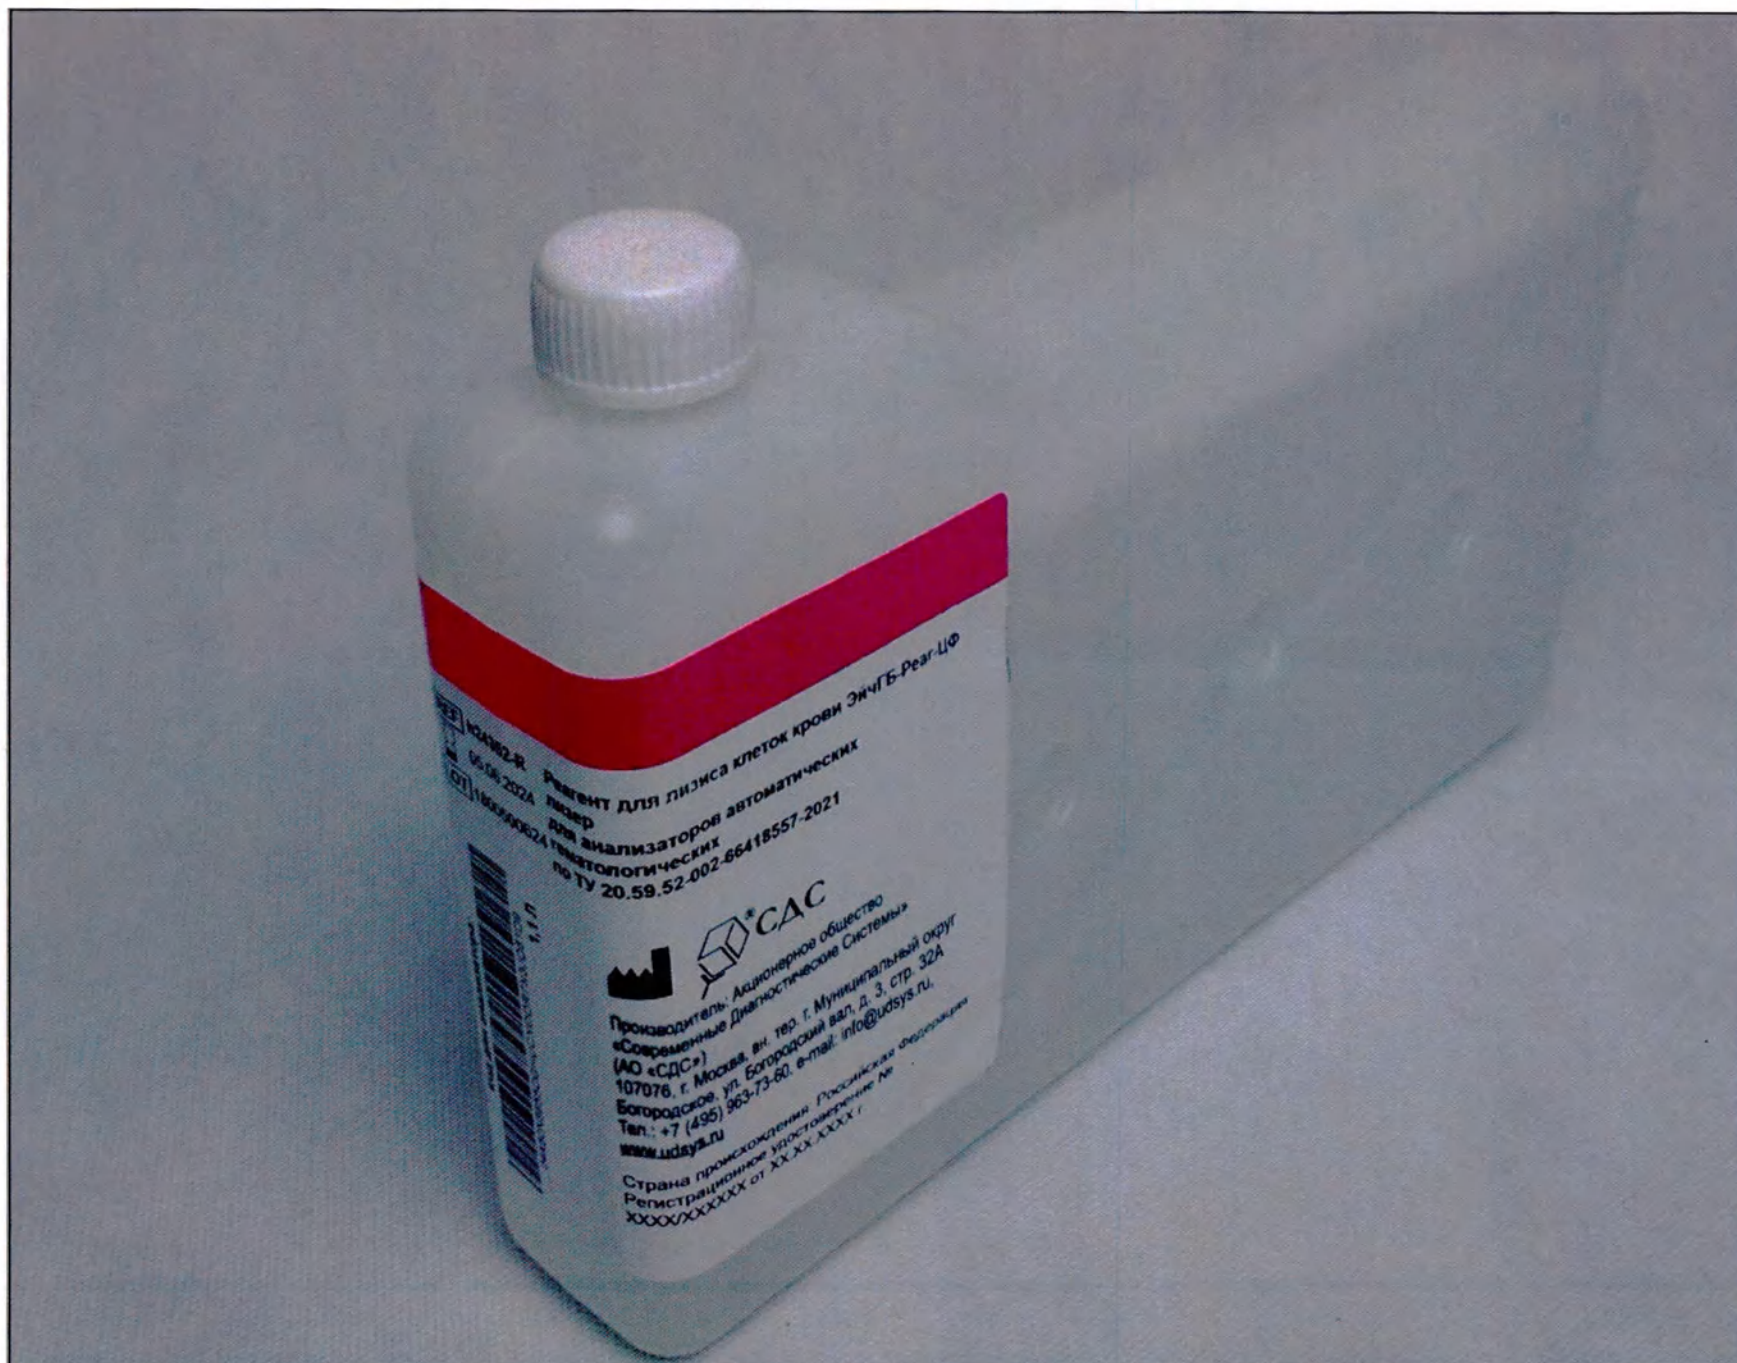


Рис. 46. Реагент для лизиса клеток крови ЭйчГБ-Реаг-ЦФ лизер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 47. Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-Вэйч для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л. Пример транспортной упаковки, размер 355 × 350 × 260 мм.



Рис. 48. Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-Вэйч для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л. Пример транспортной упаковки, размер 185 × 390 × 260 мм.



Рис. 49. Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-Вэйч для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л. Пример транспортной упаковки, размер 200 × 200 × 200 мм.



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Реагент для лизиса клеток крови для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 в вариантах исполнения

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Реагент для лизиса клеток крови для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 в вариантах исполнения

1. Реагент для лизиса клеток крови для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 в вариантах исполнения

1. Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ИВВ4 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л;

2. Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;

3. Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-АПД для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;

4. Реагент для лизиса клеток крови Диавайер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л;

5. Реагент для лизиса клеток крови Диавайер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л;

6. Реагент для лизиса клеток крови Диавайер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л;

7. Реагент для лизиса клеток крови Диавайер-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л;

8. Реагент для лизиса клеток крови Диавайер-СИС-СЭИЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л;

9. Реагент для лизиса клеток крови Диавайер-СИС-СЭИЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л;

10. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-30 ЛАИЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л;

11. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53 ЛЕО I ЛАИЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;

12. Реагент для лизиса клеток крови ДП-33 ЛЕО II ЛАИЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,4 л;

13. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛХ ЛАИЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;

14. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛЕО I ЛАИЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;

15. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛХ ЛАИЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;

16. Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛД ЛАИЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л;

Рис. 50. Инструкция по применению



Рис. 51. Макеты первичной (потребительской) упаковки: Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-Вэйч для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л.

Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF h23125-R 0,5 л IVD     ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXXX  ДД.ММ.ГГГГ  САС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Код для анализатора: 	Реагент для лизиса клеток крови ДМ-30 ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF DM-30L-R 0,5 л IVD     ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXXX  ДД.ММ.ГГГГ  САС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Код для анализатора: 
Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53 ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF DM-53LEO I-R 1 л IVD     ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXXX  ДД.ММ.ГГГГ  САС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Код для анализатора: 	Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛЕО II ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF DM-53LEO II-R 0,4 л IVD     ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXXX  ДД.ММ.ГГГГ  САС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Код для анализатора: 

Рис. 52. Макеты первичной (потребительской) упаковки: Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; Реагент для лизиса клеток крови ДМ-30 ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53 ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛЕО II ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,4 л.



Рис. 53. Макеты первичной (потребительской) упаковки: Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛД ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л.

Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛБ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF DM-68LB-R 1 л IVD ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXX ДД.ММ.ГГГГ САС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Код для анализатора: 	Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF DM-68LH-R 1 л IVD ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXX ДД.ММ.ГГГГ САС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Код для анализатора:
Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛН ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF DM-68LN-R 1 л IVD ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXX ДД.ММ.ГГГГ САС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Код для анализатора: 	Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Дифф-ЛМЖ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF h20212-R 1 л IVD ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXX ДД.ММ.ГГГГ САС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Код для анализатора:

Рис. 54. Макеты первичной (потребительской) упаковки: Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛБ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛН ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Дифф-ЛМЖ для анализаторов автоматических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л.

Реагент для лизиса клеток крови Диафикс ЕО 5 Дифф.П60 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF h20314/P60-R 1 л IVD ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXXX ДД.ММ.ГГГГ СДС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Код для анализатора:	Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF h20312P-R 0,4 л IVD ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXXX ДД.ММ.ГГГГ СДС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Код для анализатора:
Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF h20322P-R 1 л IVD ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXXX ДД.ММ.ГГГГ СДС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Код для анализатора:	Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Базо II для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF h20313P-R 1 л IVD ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXXX ДД.ММ.ГГГГ СДС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Код для анализатора:

Рис. 55. Макеты первичной (потребительской) упаковки: Реагент для лизиса клеток крови Диафикс ЕО 5 Дифф.П60 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,4 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Базо II для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л.

**Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021**

REF

h15314-R

IVD

1°C

30°C

30%

LOT

XXXXXXXXXX

ДД.ММ.ГГГГ

0,85 л

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское,
ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru

Страна происхождения: Российская Федерация

Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Код для анализатора:

**Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021**

REF h15324-R	0,5 л	
IVD 		
		
		
LOT XXXXXXXXXX		
		
		

Код для анализатора:


**Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021**

REF h15334-R	0,35 л	
IVD  		
 ДД.ММ.ГГГГ		
LOT XXXXXXXXXX		
 ДД.ММ.ГГГГ		



САС

Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское,
ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru

Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.



**Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021**

REF h15325-R IVD   ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXXX  ДД.ММ.ГГГГ	1,9 л	Код для анализатора: 
---	--------------	--



Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «CДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru

Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Рис. 57. Макеты первичной (потребительской) упаковки: Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,85 л; Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,35 л; Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,9 л.



Рис. 58. Макеты первичной (потребительской) упаковки: Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,3 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диабазо А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л.



Рис. 59. Макеты первичной (потребительской) упаковки: Реагент для лизиса клеток крови ДиаЭйчГБ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л; Реагент для лизиса клеток крови Диа-РБЦ/ПЛТ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 2,7 л; Реагент для лизиса клеток крови ЭйчГБ-Реаг-ЦФ лазер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л.

Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF h23303-R 5 л IVD ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXX Код для анализатора: ДД.ММ.ГГГГ САС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А. Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Масса нетто потребительской упаковки: 250 г Масса нетто: 4,935 кг Масса брутто: 5,185 кг	Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF h23601-R 5 л IVD ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXX Код для анализатора: ДД.ММ.ГГГГ САС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А. Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Масса нетто потребительской упаковки: 250 г Масса нетто: 5,015 кг Масса брутто: 5,265 кг
Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF h23601-XN 5 л IVD ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXX Код для анализатора: ДД.ММ.ГГГГ САС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А. Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Масса нетто потребительской упаковки: 250 г Масса нетто: 5,015 кг Масса брутто: 5,265 кг	Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021 REF h23105-R 5 л IVD ДД.ММ.ГГГГ LOT XXXXXXXXX Код для анализатора: ДД.ММ.ГГГГ САС Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А. Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г. Масса нетто потребительской упаковки: 250 г Масса нетто: 5,015 кг Масса брутто: 5,265 кг

Рис. 60. Макеты транспортной (потребительской) упаковки: Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-ФБА для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-4ДЛ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л.



Рис. 61. Макеты транспортной (потребительской) упаковки: Реагент для лизиса клеток крови ДИАЛАЙЗ-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; Реагент для лизиса клеток крови ДИАГЛОБИН-СД 3.2 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Базо 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л.

Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021		Реагент для лизиса клеток крови Диатерг-НК для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021	
REF h19202-R	5 л	REF h19102-R	5 л
IVD		IVD	
ДД.ММ.ГГГГ		ДД.ММ.ГГГГ	
LOT XXXXXXXXXX	Код для анализатора:	LOT XXXXXXXXXX	Код для анализатора:
ДД.ММ.ГГГГ		ДД.ММ.ГГГГ	
	Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А. Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru		Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А. Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.	Масса нетто потребительской упаковки: 250 г Масса нетто: 4,590 кг Масса брутто: 5,240 кг	Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.	Масса нетто потребительской упаковки: 250 г Масса нетто: 5,035 кг Масса брутто: 5,285 кг


Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021	
REF h19322-R	5 л
IVD	
ДД.ММ.ГГГГ	
LOT XXXXXXXXXX	Код для анализатора:
ДД.ММ.ГГГГ	
	Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А. Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.	Масса нетто потребительской упаковки: 250 г Масса нетто: 5,030 кг Масса брутто: 5,280 кг

Рис. 62. Макеты транспортной (потребительской) упаковки: Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л; Реагент для лизиса клеток крови Диатерг-НК для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021,

ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л.

**Реагент для лизиса клеток крови
Диастромлайзер-СИС-Вэйч для
анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h23401-R **Кол-во флаконов 15x0,5 л**

IVD 

LOT ДД.ММ.ГГГГ
XXXXXXXXXX

Масса нетто потребительской упаковки: 50 г
Масса нетто: 8,2725 кг
Масса брутто: 3,2725 кг


ДД.ММ.ГГГГ

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-80, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.




**Реагент для лизиса клеток крови
Диалайзер-ДФ для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h236013-XN **Кол-во флаконов 4x1,5 л**

IVD 

LOT ДД.ММ.ГГГГ
XXXXXXXXXX

Масса нетто потребительской упаковки: 130 г
Масса нетто: 6,538 кг
Масса брутто: 7,538 кг


ДД.ММ.ГГГГ

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-80, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.




**Реагент для лизиса клеток крови
Диалайзер-ВПС для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h23630-R **Кол-во флаконов 4x1,5 л**

IVD 

LOT ДД.ММ.ГГГГ
XXXXXXXXXX

Масса нетто потребительской упаковки: 130 г
Масса нетто: 6,538 кг
Масса брутто: 7,538 кг


ДД.ММ.ГГГГ

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-80, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.




**Реагент для лизиса клеток крови ДМ-30
ЛАЙЗ для анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF DM-30L-R **Кол-во флаконов 12x0,5 л**

IVD 

LOT ДД.ММ.ГГГГ
XXXXXXXXXX

Масса нетто потребительской упаковки: 50 г
Масса нетто: 6,618 кг
Масса брутто: 7,618 кг

ДД.ММ.ГГГГ

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-80, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.




Рис. 63. Примеры макетов маркировки для транспортной упаковки: Реагент для лизиса клеток крови Диастромлайзер-СИС-Вэйч для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л, Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, канистра 5 л, Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л, Реагент для лизиса клеток крови ДМ-30 ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л.

2021, флакон 1,5 л, Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ВПС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,5 л, Реагент для лизиса клеток крови ДМ-30 ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л.

**Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53
ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF DM-53LEO I-R Кол-во флаконов 8x1 л

IVD       

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 85 г
Масса нетто: 8,664 кг
Масса брутто: 9,664 кг

LOT XXXXXXXXXX

DD.MM.GGGG

 CSC

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 983-73-80, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

612227901222538

**Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛХ
ЛАЙЗ для анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF DM-53LH-R Кол-во флаконов 8x1 л

IVD       

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 85 г
Масса нетто: 8,704 кг
Масса брутто: 9,704 кг

LOT XXXXXXXXXX

DD.MM.GGGG

 CSC

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 983-73-80, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

612227901222538

**Реагент для лизиса клеток крови Диафикс
ЭО 5 Дифф.П120 для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h20314/P120-R Кол-во флаконов 8x1 л

IVD       

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 85 г
Масса нетто: 8,688 кг
Масса брутто: 9,688 кг

LOT XXXXXXXXXX

DD.MM.GGGG

 CSC

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 983-73-80, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

612227901203148

**Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50
ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF DM-50LEO I-R Кол-во флаконов 8x1 л

IVD       

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 85 г
Масса нетто: 8,664 кг
Масса брутто: 9,664 кг

LOT XXXXXXXXXX

DD.MM.GGGG

 CSC

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 983-73-80, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

612227901222507

Рис. 64. Примеры макетов маркировки для транспортной упаковки: Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53 ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л, Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021,

флакон 1 л, Реагент для лизиса клеток крови Диафикс ЭО 5 Дифф.П120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л, Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛЕО I ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л.

**Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50
ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF DM-50LH-R **Кол-во флаконов 15x0,5 л**

IVD       

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 50 г
Масса нетто: 8,2725 кг
Масса брутто: 8,2725 кг

LOT XXXXXXXXXX

DD.MM.GGGG



Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107070, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-00, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 1222790222507

**Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛД
ЛАЙЗ для анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF DM-68LD-R **Кол-во флаконов 8x1 л**

IVD       

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 85 г
Масса нетто: 8,704 кг
Масса брутто: 8,704 кг

LOT XXXXXXXXXX

DD.MM.GGGG



Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107070, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-00, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 1222790222682

**Реагент для лизиса клеток крови
Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h20322P-R **Кол-во флаконов 8x1 л**

IVD       

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 85 г
Масса нетто: 9,664 кг
Масса брутто: 9,664 кг

LOT XXXXXXXXXX

DD.MM.GGGG



Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107070, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-00, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 1222790203223

**Реагент для лизиса клеток крови Диафикс
ЕО 5 Дифф.П60 для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h20314/P60-R **Кол-во флаконов 8x1 л**

IVD       

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 85 г
Масса нетто: 9,688 кг
Масса брутто: 9,688 кг

LOT XXXXXXXXXX

DD.MM.GGGG



Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107070, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-00, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 1222790203148

Рис. 65. Примеры макетов маркировки для транспортной упаковки: Реагент для лизиса клеток крови ДМ-50 ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л, Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛД ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021,

флакон 1 л, Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л, Реагент для лизиса клеток крови Диафикс ЕО 5 Дифф.П60 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л.

**Реагент для лизиса клеток крови
Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h15339-R Кол-во флаконов 12x0,5 л

IVD  35°C  30%  

DD.MM.GGGГ Масса нетто потребительской упаковки: 50 г
Масса нетто: 6,588 кг
Масса брутто: 7,588 кг

LOT XXXXXXXXXXXX

DD.MM.GGGГ

 CAC

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

61222790153393

**Реагент для лизиса клеток крови
Диалайз-НК 5Дифф для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h19312-R Кол-во флаконов 15x0,5 л

IVD  35°C  30%  

DD.MM.GGGГ Масса нетто потребительской упаковки: 50 г
Масса нетто: 8,295 кг
Масса брутто: 9,295 кг

LOT XXXXXXXXXXXX

DD.MM.GGGГ

 CAC

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

61222790193128

**Реагент для лизиса клеток крови
Диалайзер-ДФ для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h236012-XN Кол-во флаконов 5x4 л

IVD  35°C  30%  

DD.MM.GGGГ Масса нетто потребительской упаковки: 200 г
Масса нетто: 21,08 кг
Масса брутто: 22,08 кг

LOT XXXXXXXXXXXX

DD.MM.GGGГ

 CAC

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

612227901236012

**Реагент для лизиса клеток крови
Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h23125-R Кол-во флаконов 8x0,5 л

IVD  35°C  30%  

DD.MM.GGGГ Масса нетто потребительской упаковки: 50 г
Масса нетто: 4,404 кг
Масса брутто: 5,404 кг

LOT XXXXXXXXXXXX

DD.MM.GGGГ

 CAC

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.


612227901231257

Рис. 66. Примеры макетов маркировки для транспортной упаковки: Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ

для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л, Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК 5Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л, Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-ДФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 4 л, Реагент для лизиса клеток крови Диалайзер-СИС-СЭЙЧБ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л.

**Реагент для лизиса клеток крови
ДМ-53ЛЕО II ЛАЙЗ для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF DM-53LEO II-R **Кол-во флаконов 15x0,4 л**

IVD 

LOT ДД.ММ.ГГГГ XXXXXXXXXX

ДД.ММ.ГГГГ

САС


Маасса нетто потребительской упаковки: 40 г
Маасса нетто: 8,8 кг
Маасса брутто: 7,8 кг

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

612227901222538

**Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛБ
ЛАЙЗ для анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF DM-68LB-R **Кол-во флаконов 8x1 л**

IVD 

LOT ДД.ММ.ГГГГ XXXXXXXXXX

ДД.ММ.ГГГГ

САС

Маасса нетто потребительской упаковки: 86 г
Маасса нетто: 8,678 кг
Маасса брутто: 9,678 кг

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

612227901222662

**Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛХ
ЛАЙЗ для анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF	DM-68LH-R	Кол-во флаконов 8x1 л
IVD		
	ДД.ММ.ГГГГ	Масса нетто потребительской упаковки: 85 г
LOT	XXXXXXXXXX	Масса нетто: 8,688 кг
	ДД.ММ.ГГГГ	Масса брутто: 8,688 кг
	Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.	



**Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛН
ЛАЙЗ для анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF	DM-68LN-R	Кол-во флаконов 8x1 л
IVD		
	ДД.ММ.ГГГГ	Масса нетто потребительской упаковки: 85 г
LOT	XXXXXXXXXX	Масса нетто: 8,728 кг
	ДД.ММ.ГГГГ	Масса брутто: 8,728 кг
	Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.	



Рис. 67. Примеры макетов маркировки для транспортной упаковки: Реагент для лизиса клеток крови ДМ-53ЛЕО II ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,4 л, Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛБ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л, Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛХ ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л, Реагент для лизиса клеток крови ДМ-68ЛН ЛАЙЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л.

**Реагент для лизиса клеток крови
Диалайз-Дифф-ЛМЖ для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h20212-R Кол-во флаконов 8x1 л

IVD

ДД.ММ.ГГГГ Масса нетто потребительской упаковки: 86 г
Масса нетто: 8,884 кг
Масса брутто: 9,884 кг

LOT XXXXXXXXXX

ДД.ММ.ГГГГ

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6122279012021271

**Реагент для лизиса клеток крови
Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h20312 P-R Кол-во флаконов 15x0,4 л

IVD

ДД.ММ.ГГГГ Масса нетто потребительской упаковки: 40 г
Масса нетто: 6,588 кг
Масса брутто: 7,688 кг

LOT XXXXXXXXXX

ДД.ММ.ГГГГ

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6122279012031274

**Реагент для лизиса клеток крови
Диалайз-Базо II для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h20313/P-R Кол-во флаконов 8x1 л

IVD

ДД.ММ.ГГГГ Масса нетто потребительской упаковки: 86 г
Масса нетто: 8,888 кг
Масса брутто: 9,888 кг

LOT XXXXXXXXXX

ДД.ММ.ГГГГ

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6122279012031311

**Реагент для лизиса клеток крови
Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h15319-R Кол-во флаконов 8x1 л

IVD

ДД.ММ.ГГГГ Масса нетто потребительской упаковки: 86 г
Масса нетто: 8,884 кг
Масса брутто: 9,884 кг

LOT XXXXXXXXXX

ДД.ММ.ГГГГ

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

612227901531911

Рис. 68. Примеры макетов маркировки для транспортной упаковки: Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Дифф-ЛМЖ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л, Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Аргос Пентра для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,4 л, Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-Базо II для анализаторов автоматических гематологических

по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л, Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1 л

**Реагент для лизиса клеток крови
Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h15349-R **Кол-во флаконов 40x0,3 л**

IVD

DD.MM.YYYY **Масса нетто потребительской упаковки: 50 г**

LOT XXXXXXXXXX **Масса нетто: 13,876 кг**

DD.MM.YYYY **Масса брутто: 14,876 кг**

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6122279011534981

**Реагент для лизиса клеток крови
Диа-Стабилайзер для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h15314-R **Кол-во флаконов 8x0,85 л**

IVD

DD.MM.YYYY **Масса нетто потребительской упаковки: 70 г**

LOT XXXXXXXXXX **Масса нетто: 7,6778 кг**

DD.MM.YYYY **Масса брутто: 8,6778 кг**

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6122279011531461

**Реагент для лизиса клеток крови
Диа-Стабилайзер для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h15324-R **Кол-во флаконов 15x0,5 л**

IVD

DD.MM.YYYY **Масса нетто потребительской упаковки: 70 г**

LOT XXXXXXXXXX **Масса нетто: 8,78 кг**

DD.MM.YYYY **Масса брутто: 9,78 кг**

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6122279011532451

**Реагент для лизиса клеток крови
Диа-Стабилайзер для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h15334-R **Кол-во флаконов 40x0,35 л**

IVD

DD.MM.YYYY **Масса нетто потребительской упаковки: 70 г**

LOT XXXXXXXXXX **Масса нетто: 17,248 кг**

DD.MM.YYYY **Масса брутто: 18,248 кг**

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6122279011533441

Рис. 69. Примеры макетов маркировки для транспортной упаковки: Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-СТ-Дифф-СФ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,3 л, Реагент для лизиса

клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,85 л, Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л, Реагент для лизиса клеток крови Диа-Стабилайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,35 л

**Реагент для лизиса клеток крови
Диа-Эритролайзер для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h15325-R **Кол-во флаконов 4x1,9 л**

IVD

DD.MM.YYYY **Масса нетто потребительской упаковки: 150 г**

LOT XXXXXXXXXX **Масса нетто: 3,1772 кг**

DD.MM.YYYY **Масса брутто: 3,1772 кг**

DD.MM.YYYY

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6122279011532521

**Реагент для лизиса клеток крови
Диа-Эритролайзер для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h15335-R **Кол-во флаконов 4x1,3 л**

IVD

DD.MM.YYYY **Масса нетто потребительской упаковки: 150 г**

LOT XXXXXXXXXX **Масса нетто: 5,7844 кг**

DD.MM.YYYY **Масса брутто: 5,7844 кг**

DD.MM.YYYY

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6122279011533511

**Реагент для лизиса клеток крови
Диалайз-НК Дифф для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h19222-R **Кол-во флаконов 15x0,5 л**

IVD

DD.MM.YYYY **Масса нетто потребительской упаковки: 50 г**

LOT XXXXXXXXXX **Масса нетто: 8,295 кг**

DD.MM.YYYY **Масса брутто: 9,295 кг**

DD.MM.YYYY

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6122279011931281

**Реагент для лизиса клеток крови Диабазо
A120 для анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**

REF h24301-R **Кол-во флаконов 4x1,1 л**

IVD

DD.MM.YYYY **Масса нетто потребительской упаковки: 130 г**

LOT XXXXXXXXXX **Масса нетто: 4,8024 кг**

DD.MM.YYYY **Масса брутто: 5,8024 кг**

DD.MM.YYYY

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6122279012430141

Рис. 70. Примеры макетов маркировки для транспортной упаковки: Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,9 л, Реагент для лизиса клеток крови Диа-Эритролайзер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,3 л, Реагент для лизиса клеток крови Диалайз-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 0,5 л, Реагент для лизиса клеток крови Диабазо А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л



**Реагент для лизиса клеток крови
ЭйчГБ-Реаг-ЦФ лизер для анализаторов
автоматических гематологических по ТУ
20.59.52-002-66418557-2021**


REF	h24352-R	Кол-во флаконов 4x1,1 л	
IVD			
	ДД.ММ.ГГГГ	Масса нетто потребительской упаковки: 130 г	
LOT	XXXXXXXXXX	Масса нетто: 4,8696 кг	
	ДД.ММ.ГГГГ	Масса брутто: 5,9698 кг	
		Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru Страна происхождения: Российская Федерация Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.	



Рис. 71. Примеры макетов маркировки для транспортной упаковки: Реагент для лизиса клеток крови ДиаЭйчгб А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л, Реагент для лизиса клеток крови Диа-РБЦ/ПЛТ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 2,7 л, Реагент для лизиса клеток крови ЭйчГБ-Реаг-ЦФ лизер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-002-66418557-2021, флакон 1,1 л.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 73 листов (-а)
Генеральный директор АО «СДС»
Новикова Е. Б.

