

Фотографические изображения
медицинского изделия


Моющий раствор для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021 в вариантах исполнения

Генеральный директор АО «СДС» Новикова Елена Борисовна

(Ф.И.О. руководителя юридического лица или иного лица,
имеющего право действовать от имени этого юридического лица)

"07" 06 20__ г.

М.П.




(Подпись)

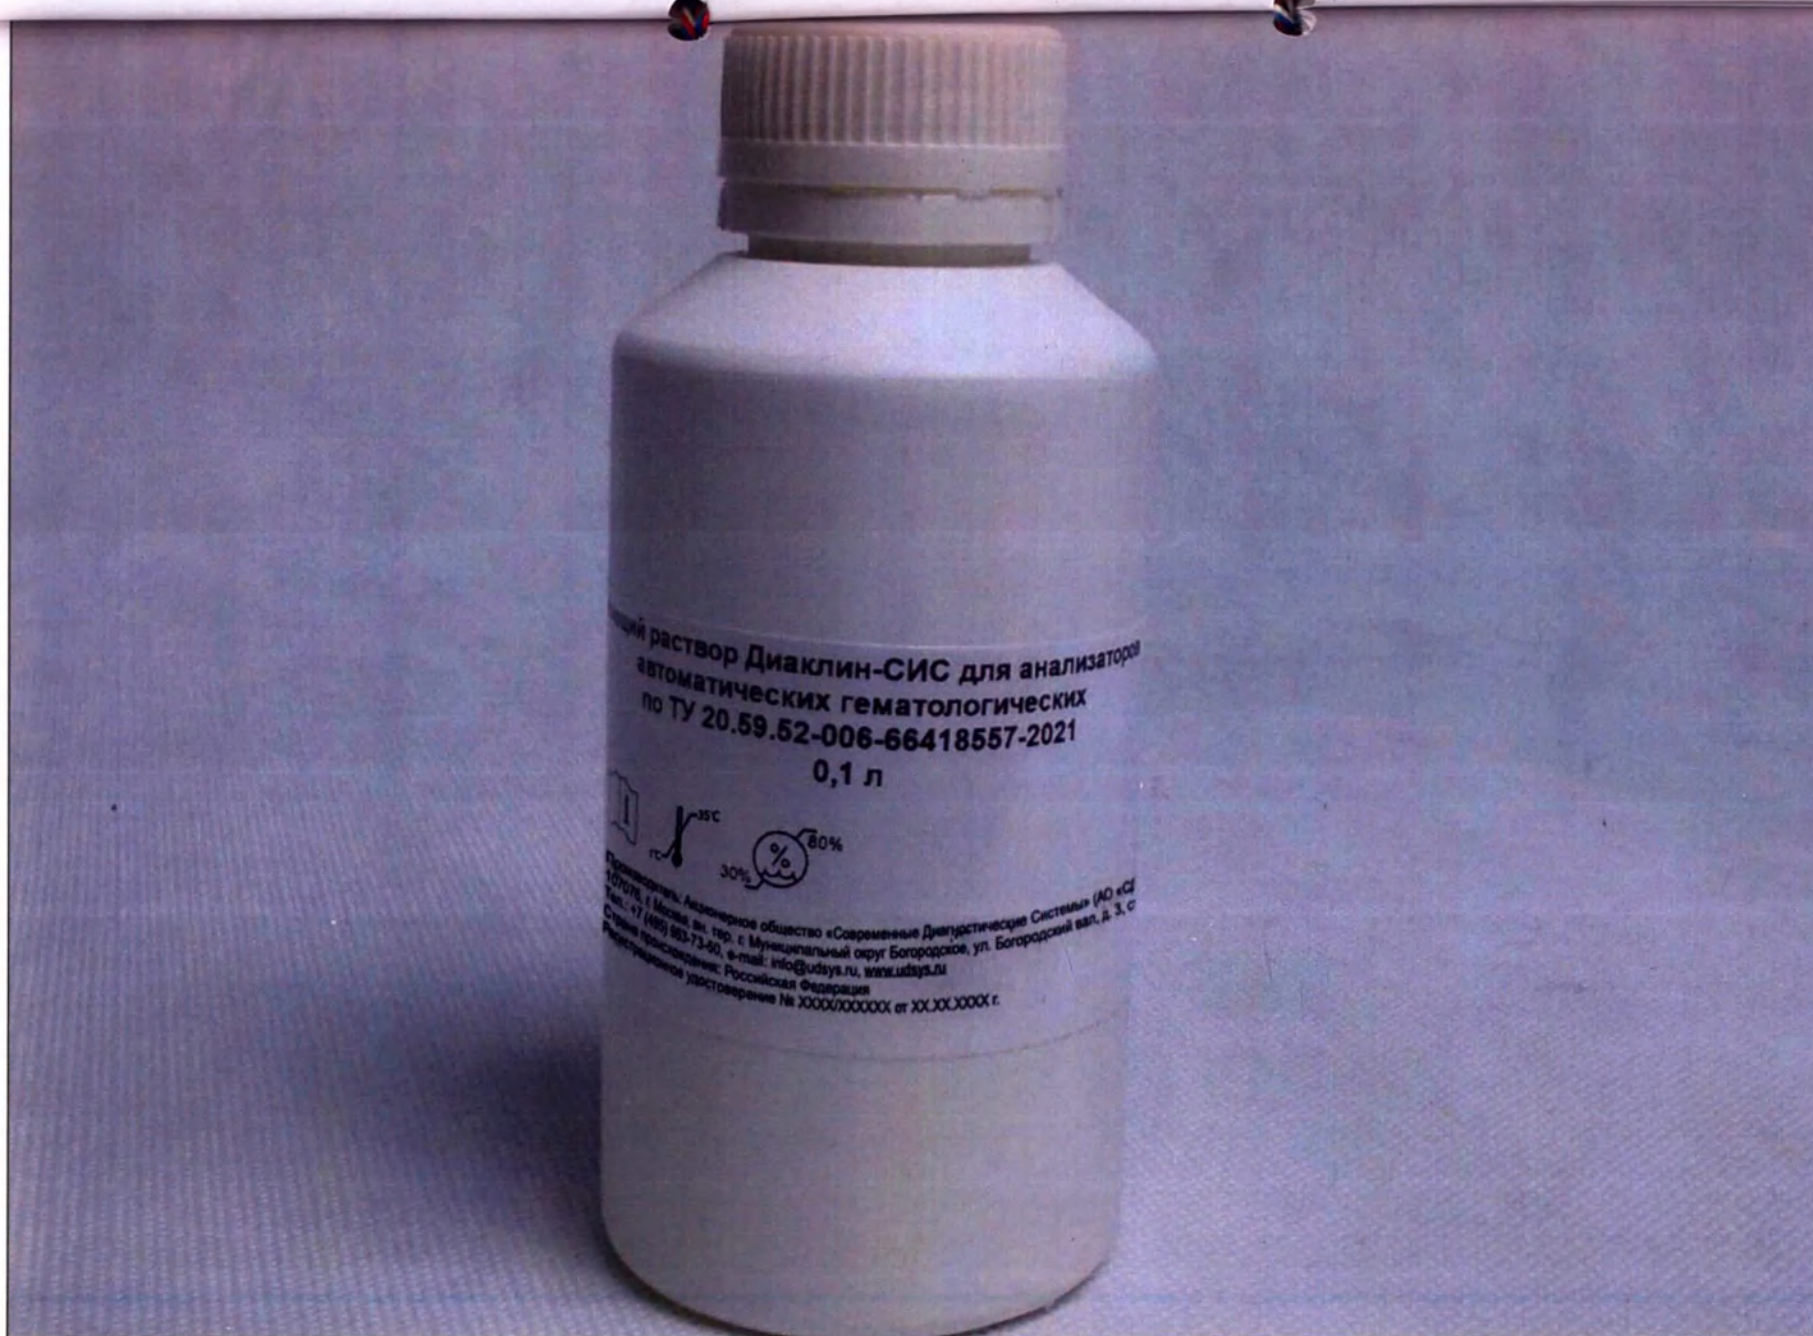


Рис. 1. Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-



Рис. 3. Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021 флакон 0.05 л Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

Моющий раствор Диаклин-СИС
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021

REF h23146-R

IVD   



05.06.2024

LOT

1800500624



05.12.2022



 СДС

Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы»
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородская, д. 1
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Рис. 4. Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 5. Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л. Первичная (потребительская) упаковка

BEFORE USE READ OPERATOR'S MANUAL OF THE INSTRUMENT. (GB)
 VOR BENUTZUNG BEDIENTUNGSANLEITUNG IHRES GERATES AUFMERKSAM
 LESTEN. (D)
 HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁSÁT. (H)

Моющий раствор ДМ-30 РИНЗ
 для анализаторов автоматических гематологических
 по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021

20 Л

REF DM-30R-R

IVD

05.06.2024

LOT 1800500624

05.12.2022

Код для анализатора:

04450805950GHU 36530

Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС»)
 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
 Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru

Страна происхождения: Российская Федерация
 Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Масса нетто потребительской упаковки: 950 г
 Масса нетто: 20,950 кг
 Масса брутто: 20,950 кг

FOR IN VITRO DIAGNOSTICS ONLY. (GB)
 FOR IN VITRO DIAGNOSTIK. (D)
 CSAK IN VITRO DIAGNOSZTIKAI HASZNÁLATRA. (H)

Рис. 6. Моющий раствор ДМ-30 РИНЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 20 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.

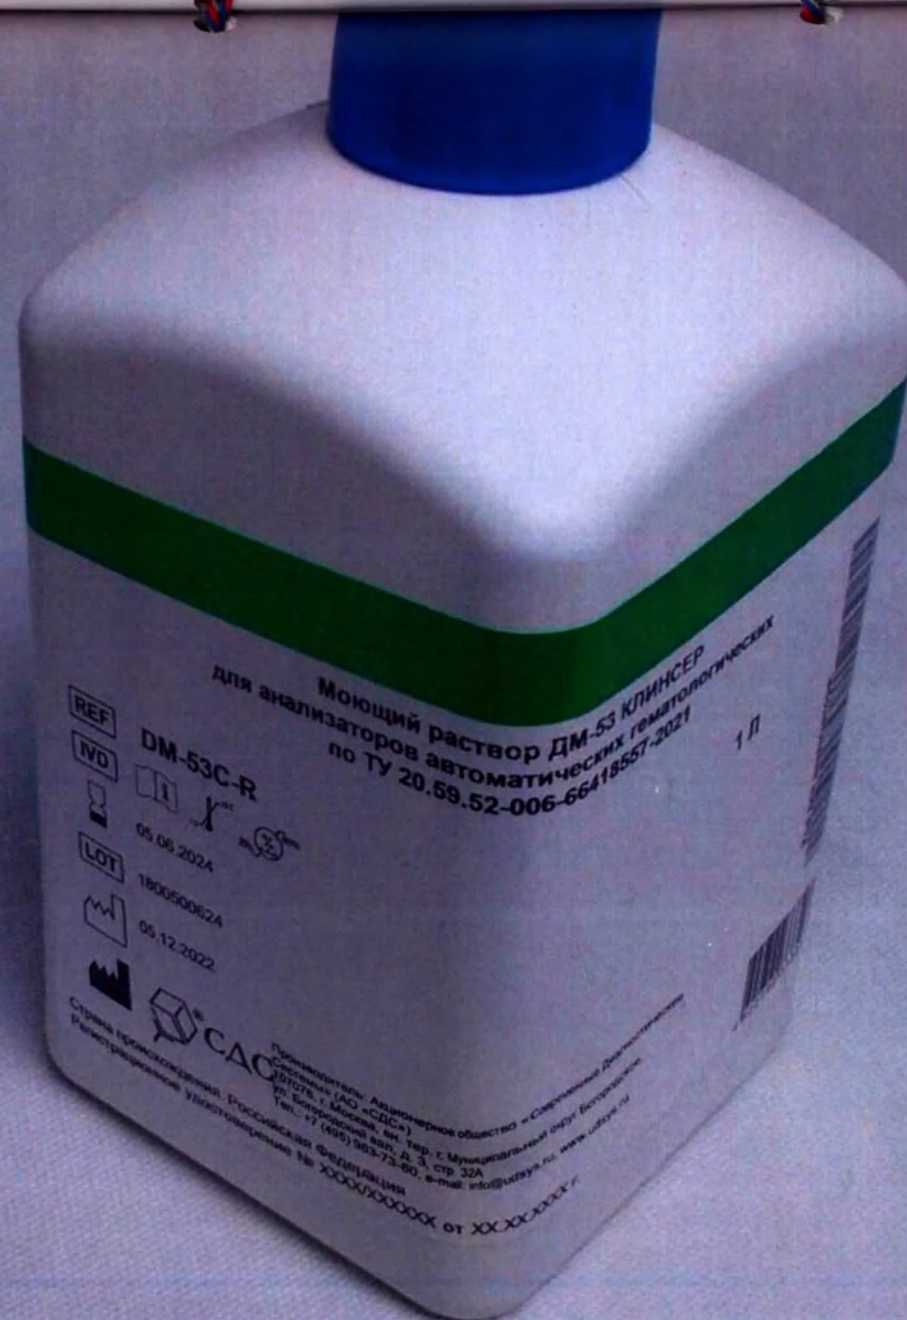


Рис. 7. Моющий раствор ДМ-53 КЛИНСЕР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021. флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

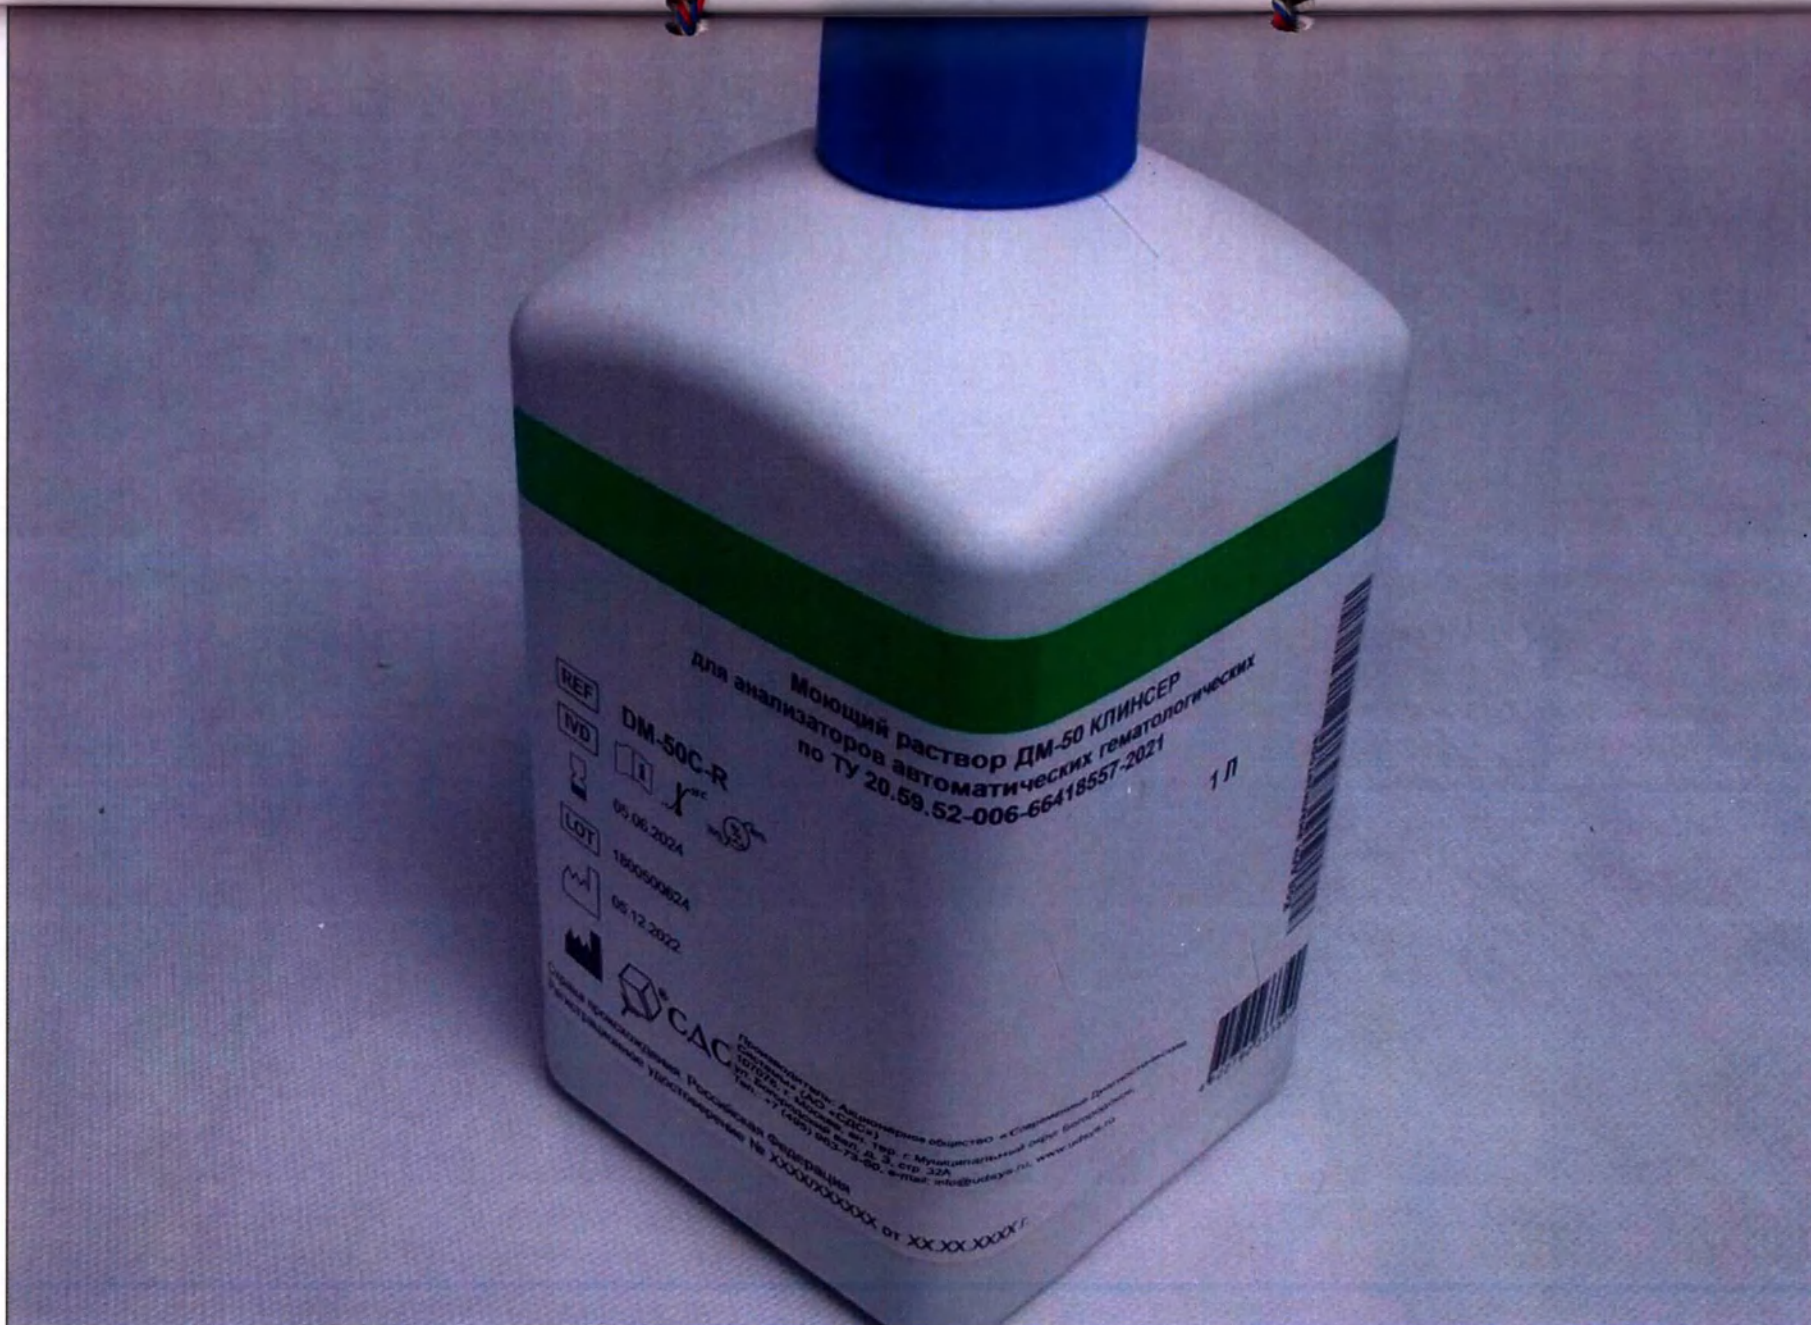


Рис. 8. Моющий раствор ДМ-50 КЛИНСЕР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

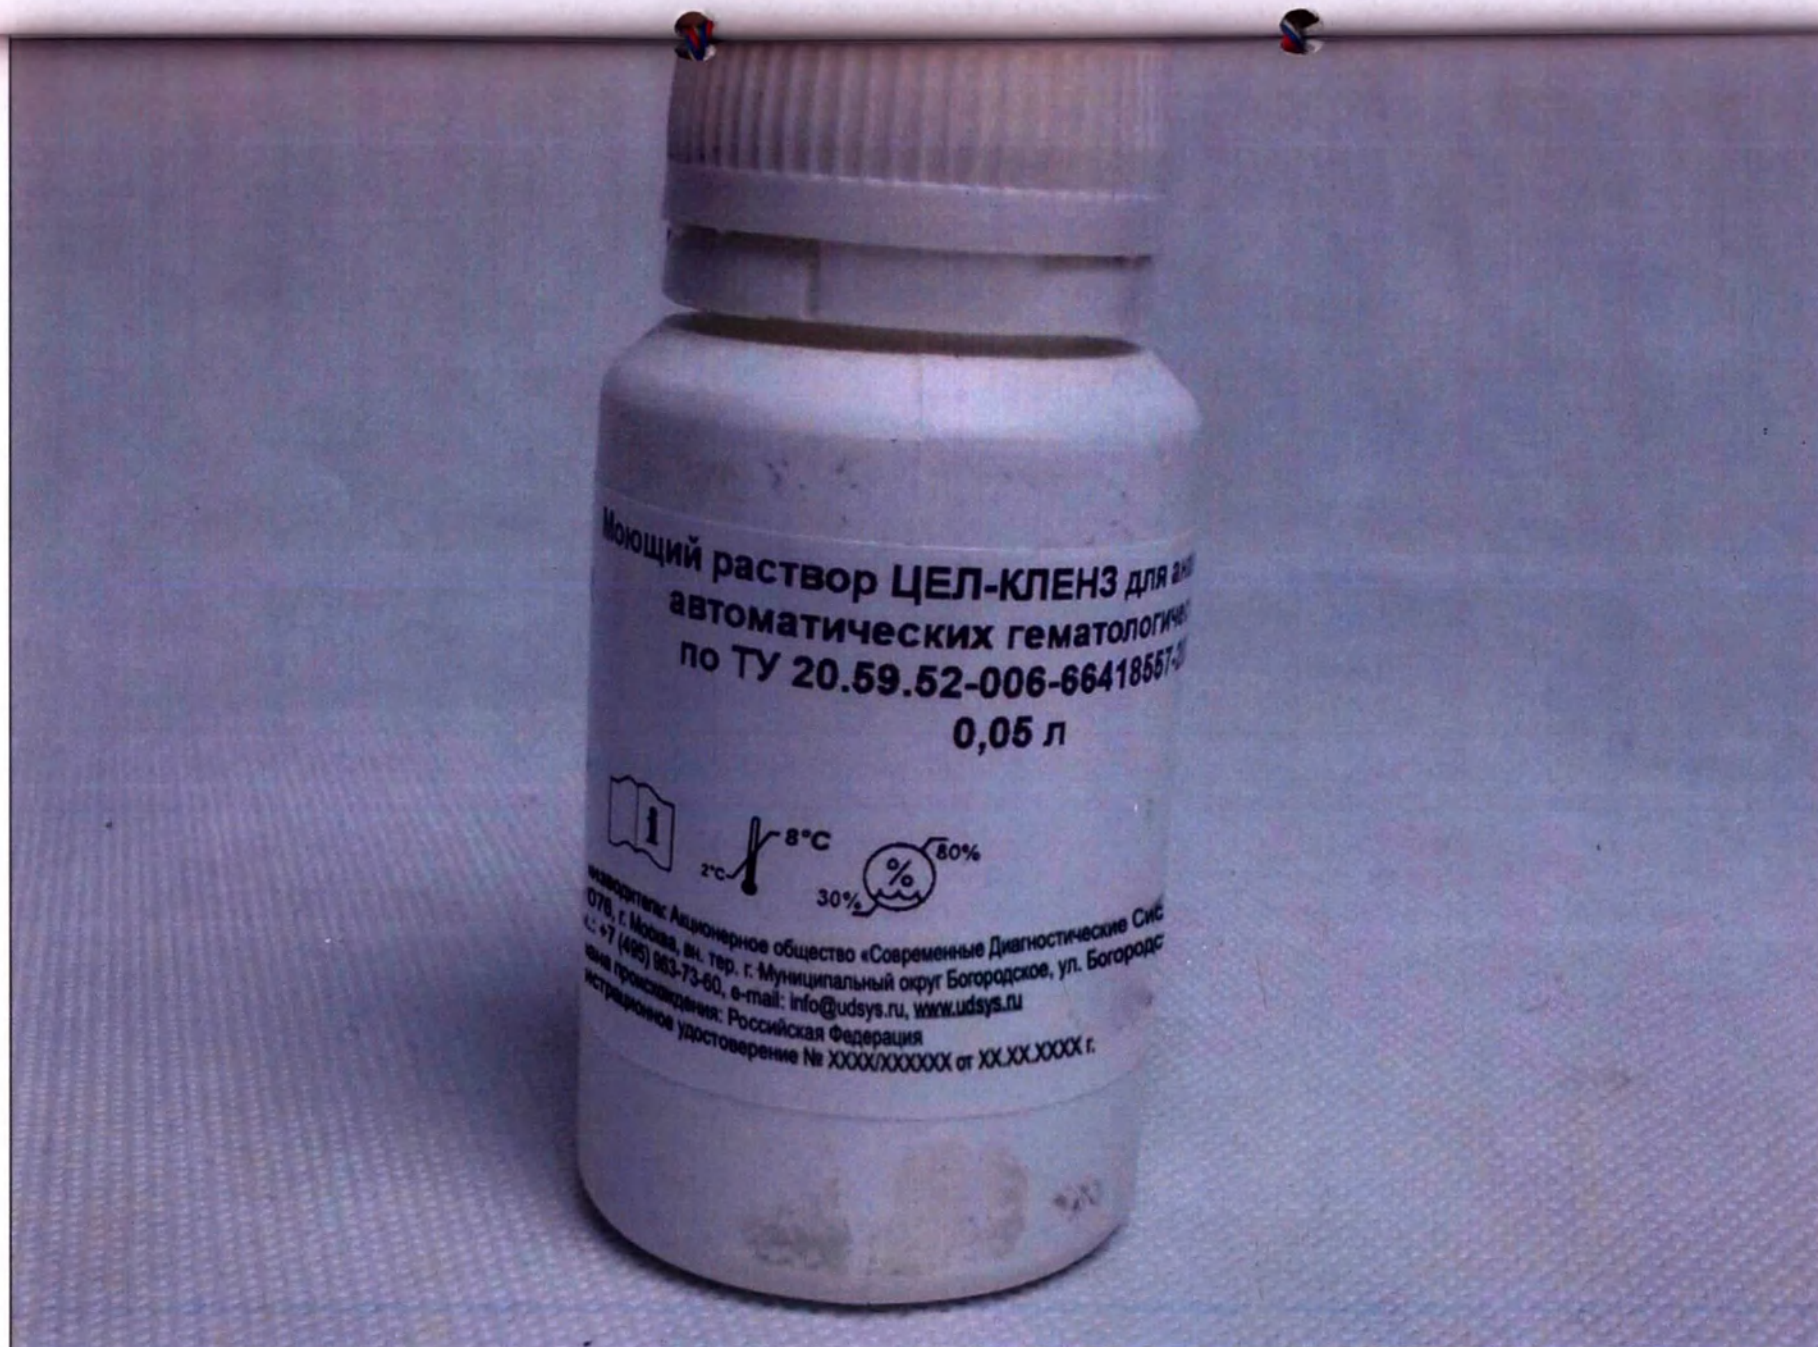


Рис. 9. Моющий раствор ЦЕЛ-КЛЕНЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-01, флякон 0,05 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

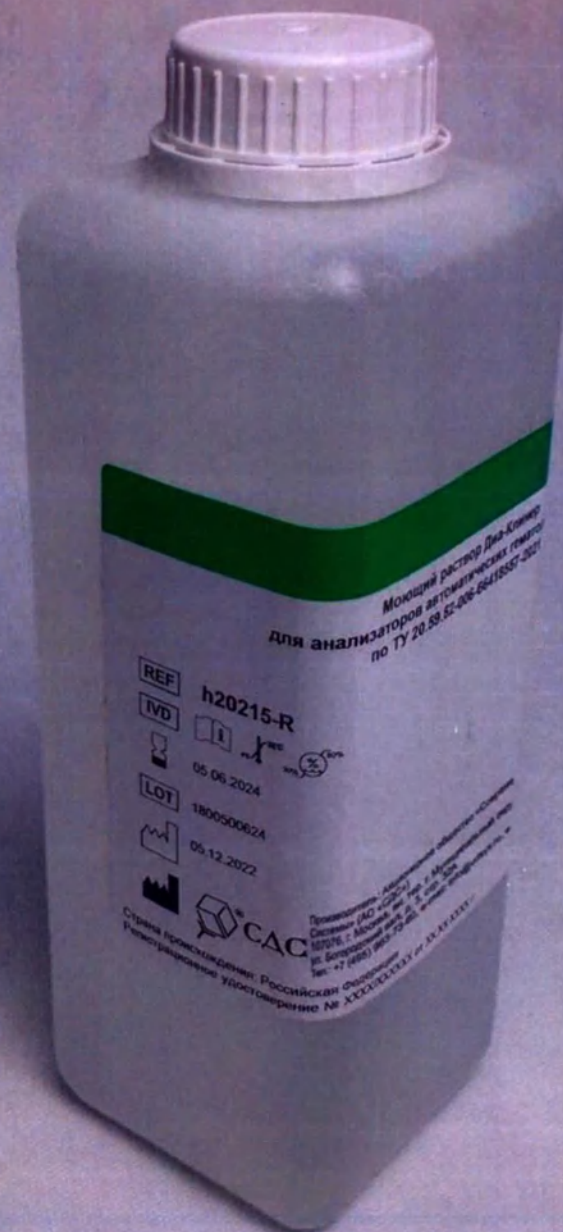


Рис. 10. Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

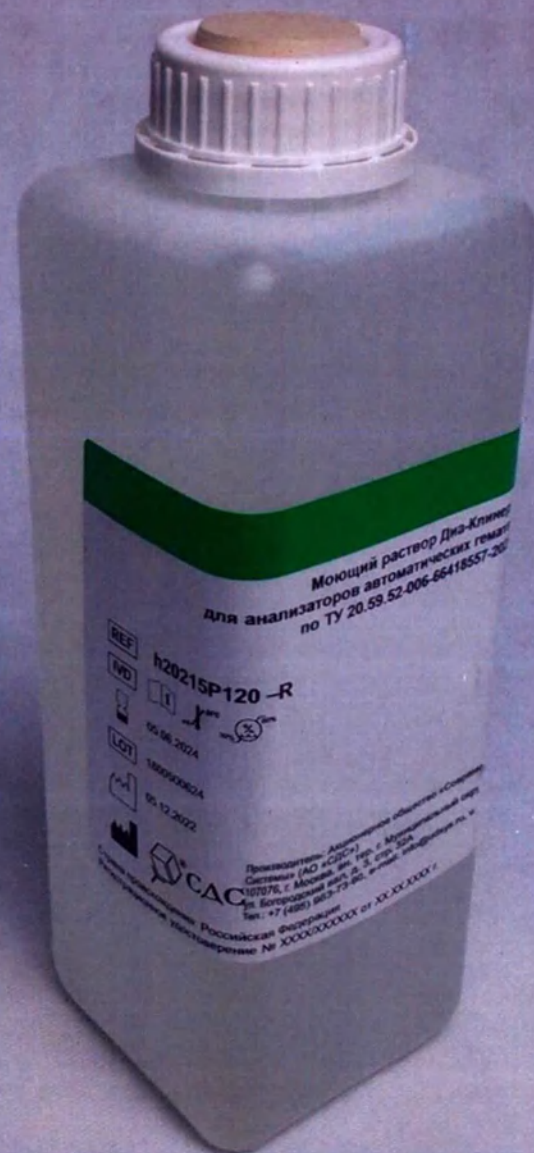


Рис. 11. Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л с резиновой вставкой. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

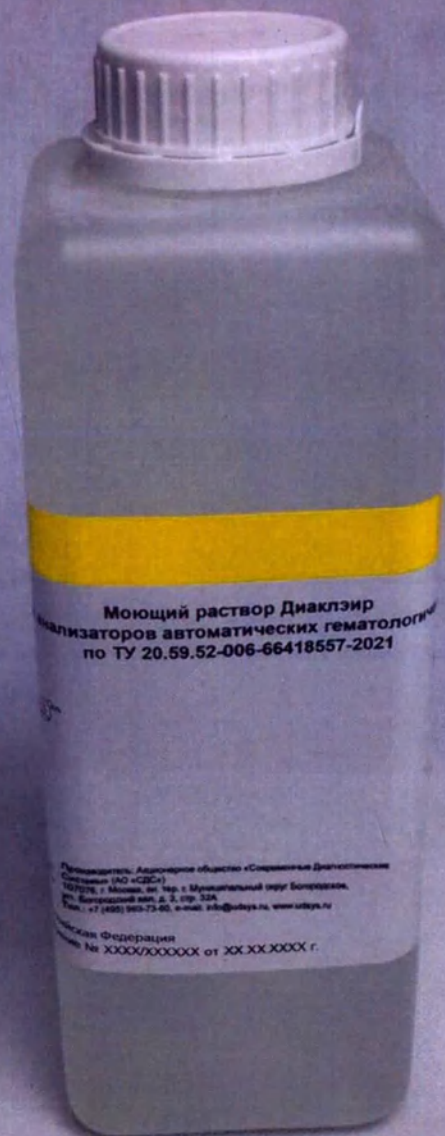


Рис. 12. Моющий раствор Диаклэир для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, форма 1. Производитель (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 13. Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.



Рис. 14. Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 10 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.

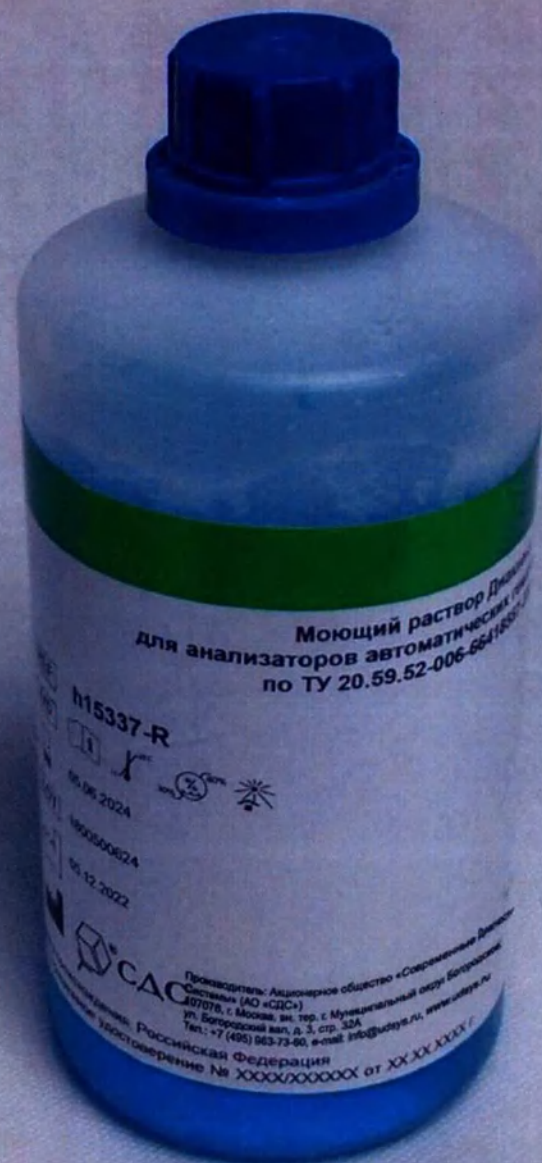


Рис. 15. Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,5 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

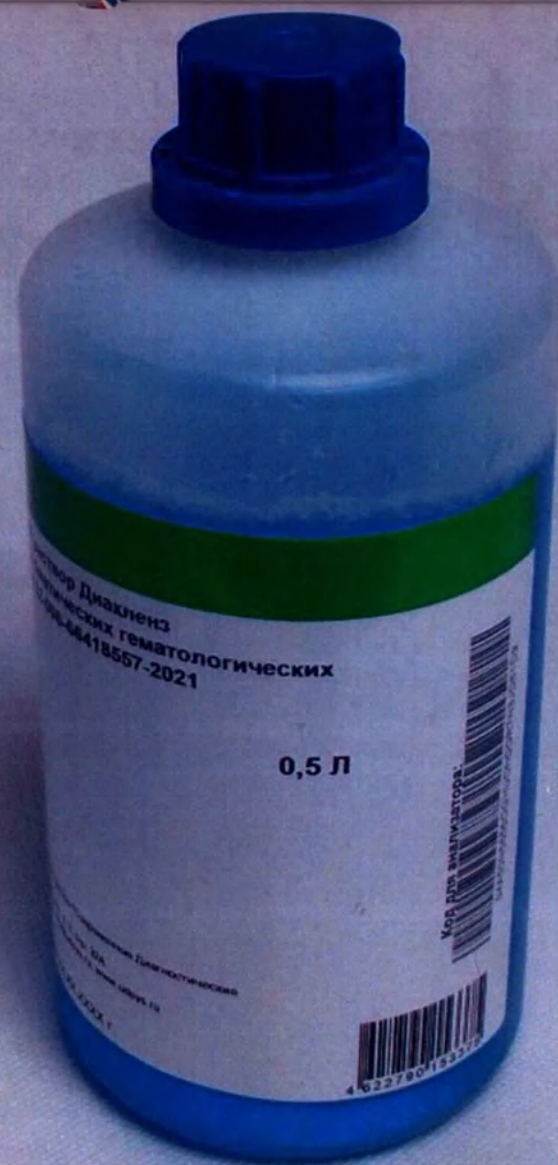



Рис. 16. Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,5 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).

BEFORE USE READ OPERATOR'S MANUAL OF THE INSTRUMENT. (GB)
VOR BENÜTZUNG BEDIENTUNGSANLEITUNG IHRES GERÄTES AUFMERKSAM
LESEN. (D)
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI UTASÍTÁSÁT. (H)

раствор Диаклин-НК Дифф
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021

5 л

REF h19203-R

MD 

 05.06.2024

LOT 1800500624

 05.12.2022

Код для анализатора:

04A50N56550GHUCNOORTN3J061D9


4 227901 9203 9



Производитель: Акционерное общество «Соед.» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udeys.ru, www.udeys.ru

Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Масса нетто потребительской упаковки: 200 г
Масса нетто: 5,000 кг
Масса брутто: 5,215 кг

FOR IN VITRO DIAGNOSTICS ONLY. (GB)
FOR IN VITRO DIAGNOSTIK. (D)
CSAK IN VITRO DIAGNOSZTIKAI HASZNÁLATRA. (H)

Рис. 17. Моющий раствор Диаклин-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л. Транспортная (потребительская) картонная упаковка.

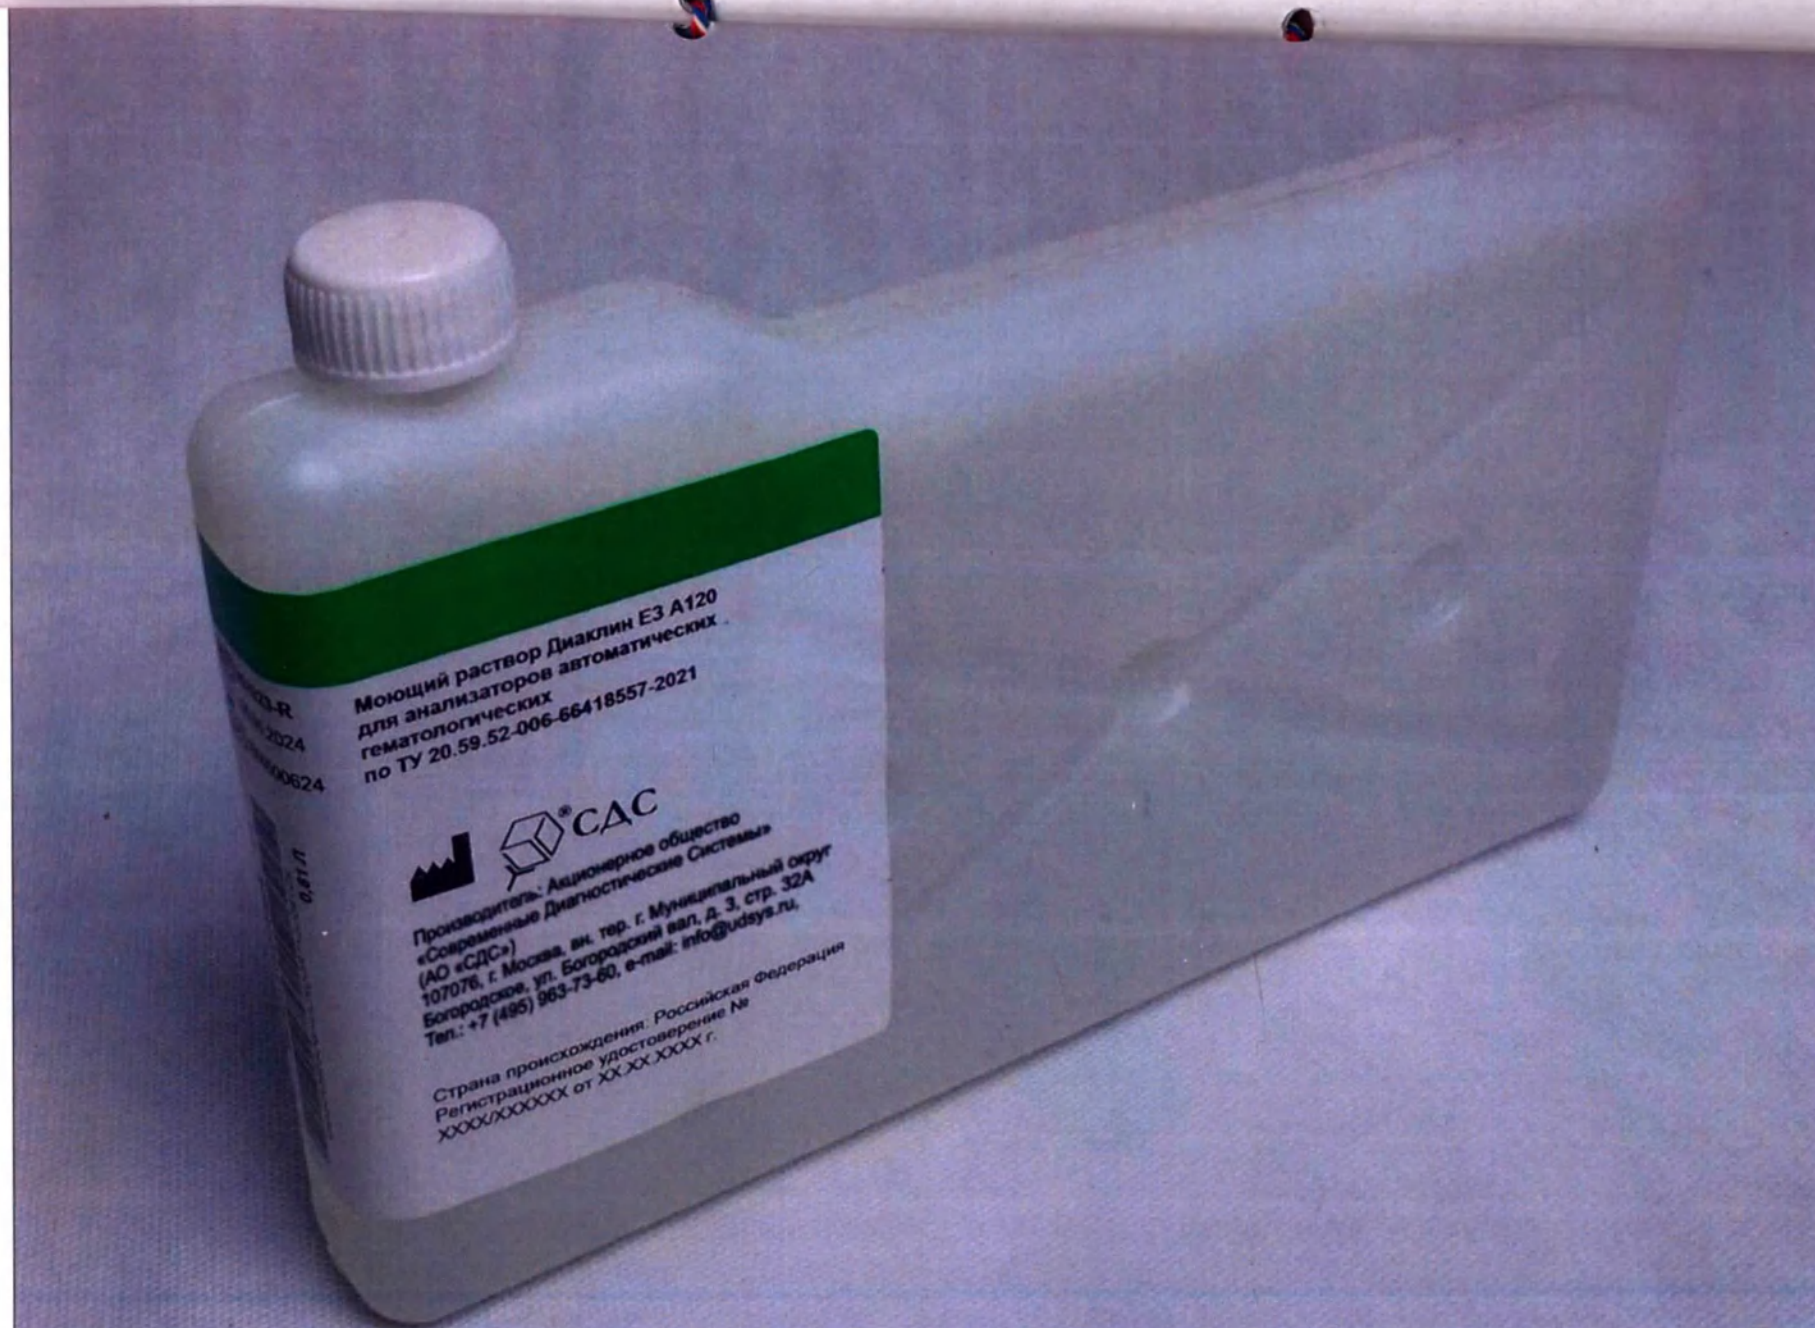


Рис. 18. Моющий раствор Диаклин ЕЗ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,81 л. Первичная (потребительская) упаковка (вид сбоку).



Рис. 19. Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л. Пример транспортной упаковки, размер 355 × 350 × 260 мм.



Рис. 20. Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л. Пример транспортной упаковки, размер 185 × 390 × 260 мм.



Рис. 21. Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л. Пример транспортной упаковки, размер 200 × 200 × 200 мм.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Мощный реактор для анализаторов автоматических тематологических
по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021 в параватах истониния

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- Мощный реактор для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021 в параватах истониния
1. Мощный реактор для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021 в параватах истониния
2. Мощный реактор Динамик-СИС для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0.1 л;
3. Мощный реактор Динамик-СИС для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0.05 л;
4. Мощный реактор Динамик-СИС для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0.2 л;
5. Мощный реактор Динамик-СИС для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0.004 л;
6. Мощный реактор ДМ-50 РИИЗ для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л;
7. Мощный реактор ДМ-50 КЛИНЕР для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л;
8. Мощный реактор ДМ-53 КЛИНЕР для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л;
9. Мощный реактор Динамик-СИС для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л;
10. Мощный реактор Динамик-СИС для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л;
11. Мощный реактор Динамик-СИС для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л;
12. Мощный реактор Динамик-СИС для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л;
13. Мощный реактор Динамик-СИС для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л;
14. Мощный реактор Динамик-СИС для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л;
15. Мощный реактор Динамик-СИС для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л;
16. Мощный реактор Динамик-СИС для анализаторов автоматических тематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л;

Рис. 22. Инструкция по применению

Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021
0,1 л

REF h23126-R
IVD
ДД.ММ.ГГГГ
LOT XXXXXXXXXX
ДД.ММ.ГГГГ

35°C 30% 80%

Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС»), 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021
0,05 л

REF h23136-R
IVD
ДД.ММ.ГГГГ
LOT XXXXXXXXXX
ДД.ММ.ГГГГ

35°C 30% 80%

Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС»), 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021
0,2 л

REF h23146-R
IVD
ДД.ММ.ГГГГ
LOT XXXXXXXXXX
ДД.ММ.ГГГГ

35°C 30% 80%

Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС»), 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021
0,004 л

REF h23156-R-auto
IVD
ДД.ММ.ГГГГ
LOT XXXXXXXXXX
ДД.ММ.ГГГГ

35°C 30% 80%

Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС»), 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Рис. 23. Макеты первичной (потребительской) упаковки: Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.




Рис. 24. Макеты первичной (потребительской) упаковки: Моющий раствор ДМ-53 КЛИНСЕР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л; Моющий раствор ДМ-50 КЛИНСЕР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л; Моющий раствор ЦЕЛ-КЛЕНЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л.



Рис. 25. Макеты первичной (потребительской) упаковки: Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л с резиновой вставкой; Моющий раствор Диаклзир для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л; Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,5 л; Моющий раствор Диаклин ЕЗ А120 для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,81 л.

Моющий раствор ДМ-30 РИНЗ
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021

REF DM-30R-R 20 л

IVD       

 ДД.ММ.ГГГГ

LOT XXXXXXXXX

 ДД.ММ.ГГГГ

Код для анализатора:




 **САС** Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru

Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Масса нетто потребительской упаковки: 900 г
Масса нетто: 20,960 кг
Масса брутто: 20,960 кг

Моющий раствор Диакленз
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021

REF h15307-R 5 л

IVD       

 ДД.ММ.ГГГГ

LOT XXXXXXXXX

 ДД.ММ.ГГГГ

Код для анализатора:





 **САС** Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru

Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Масса нетто потребительской упаковки: 250 г
Масса нетто: 5,020 кг
Масса брутто: 5,270 кг

Моющий раствор Диакленз
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021

REF h15327-R 10 л

IVD       

 ДД.ММ.ГГГГ

LOT XXXXXXXXX

 ДД.ММ.ГГГГ

Код для анализатора:





 **САС** Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru

Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Масса нетто потребительской упаковки: 400 г
Масса нетто: 10,540 кг
Масса брутто: 10,440 кг

Моющий раствор Диаклин-НК Дифф
для анализаторов автоматических гематологических
по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021

REF h19203-R 5 л

IVD       

 ДД.ММ.ГГГГ

LOT XXXXXXXXX

 ДД.ММ.ГГГГ

Код для анализатора:




 **САС** Производитель: Акционерное общество «Современные Диагностические Системы» (АО «СДС») 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru

Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Масса нетто потребительской упаковки: 250 г
Масса нетто: 5,065 кг
Масса брутто: 5,315 кг

Рис. 26. Макеты транспортной (потребительской) упаковки: Моющий раствор ДМ-30 РИНЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 20 л; Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л; Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 10 л; Моющий раствор Диаклин-НК Дифф для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, канистра 5 л.

**Моющий раствор Диаклин-СИС для
анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-006-66418557-2021**

REF h23126-R **Кол-во флаконов 40x0,1 л**

IVD

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 30 г
MASSA NETTO 5,464 кг
MASSA BRUTTO 6,464 кг

LOT XXXXXXXXXX

DD.MM.GGGG

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 222790 231264

**Моющий раствор Диаклин-СИС для
анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-006-66418557-2021**

REF h23136-R **Кол-во флаконов 80x0,05 л**

IVD

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 20 г
MASSA NETTO 5,864 кг
MASSA BRUTTO 6,864 кг

LOT XXXXXXXXXX

DD.MM.GGGG

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 222790 231363

**Моющий раствор Диаклин-СИС для
анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-006-66418557-2021**

REF h23146-R **Кол-во флаконов 35x0,2 л**

IVD

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 50 г
MASSA NETTO 9,212 кг
MASSA BRUTTO 10,212 кг

LOT XXXXXXXXXX

DD.MM.GGGG

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 222790 231462

**Моющий раствор Диаклин-СИС для
анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-006-66418557-2021**

REF h23156-R-auto **Кол-во флаконов 300x0,004 л**

IVD

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 5 г
MASSA NETTO 2,7792 кг
MASSA BRUTTO 3,7792 кг

LOT XXXXXXXXXX

DD.MM.GGGG

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 222790 231561

Рис. 27. Примеры макетов маркировки для транспортной упаковки: Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,1 л; Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,2 л; Моющий раствор Диаклин-СИС для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,004 л.

**Моющий раствор ДМ-53 КЛИНСЕР для
анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-006-66418557-2021**

REF DM-53C-R **Кол-во флаконов 10x1 л**

IVD

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 85 г

LOT XXXXXXXXXXXX Масса нетто: 10,89 кг

DD.MM.GGGG Масса брутто: 11,89 кг

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-80, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

**Моющий раствор ДМ-50 КЛИНСЕР для
анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-006-66418557-2021**

REF DM-50C-R **Кол-во флаконов 6x1 л**

IVD

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 85 г

LOT XXXXXXXXXXXX Масса нетто: 6,534 кг

DD.MM.GGGG Масса брутто: 7,534 кг

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-80, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

**Моющий раствор ЦЕЛ-КЛЕНЗ для
анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-006-66418557-2021**

REF h50111-R **Кол-во флаконов 30x0,05 л**

IVD

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 20 г

LOT XXXXXXXXXXXX Масса нетто: 2,1645 кг

DD.MM.GGGG Масса брутто: 3,1645 кг

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-80, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

**Моющий раствор Диа-Клинер для
анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-006-66418557-2021**

REF h20215-R **Кол-во флаконов 2x1 л**

IVD

DD.MM.GGGG Масса нетто потребительской упаковки: 85 г

LOT XXXXXXXXXXXX Масса нетто: 2,178 кг

DD.MM.GGGG Масса брутто: 3,178 кг

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107078, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-80, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

Рис. 28. Примеры макетов маркировки для транспортной упаковки: Моющий раствор ДМ-53 КЛИНСЕР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л; Моющий раствор ДМ-50 КЛИНСЕР для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л; Моющий раствор ЦЕЛ-КЛЕНЗ для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,05 л; Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л.

**Моющий раствор Диа-Клинер для
анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-006-66418557-2021**

REF h2015P120 -R **Кол-во флаконов 6x1 л**

IVD       

ДД.ММ.ГГГГ **Масса нетто потребительской упаковки: 85 г**

LOT XXXXXXXXXXXX **Масса нетто: 6,534 кг**

ДД.ММ.ГГГГ **Масса брутто: 7,534 кг**

ДД.ММ.ГГГГ

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 4222790202158

**Моющий раствор Диаклэир для
анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-006-66418557-2021**

REF h20113-R **Кол-во флаконов 2x1 л**

IVD       

ДД.ММ.ГГГГ **Масса нетто потребительской упаковки: 85 г**

LOT XXXXXXXXXXXX **Масса нетто: 2,186 кг**

ДД.ММ.ГГГГ **Масса брутто: 3,186 кг**

ДД.ММ.ГГГГ

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 4222790201137

**Моющий раствор Диакленз для
анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-006-66418557-2021**

REF h15337-R **Кол-во флаконов 15x0,5 л**

IVD       

ДД.ММ.ГГГГ **Масса нетто потребительской упаковки: 50 г**

LOT XXXXXXXXXXXX **Масса нетто: 8,28 кг**

ДД.ММ.ГГГГ **Масса брутто: 9,28 кг**

ДД.ММ.ГГГГ

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 4222790153375

**Моющий раствор Диаклин ЕЗ А120 для
анализаторов автоматических
гематологических по ТУ
20.59.52-006-66418557-2021**

REF h24323-R **Кол-во флаконов 8x0,81 л**

IVD       

ДД.ММ.ГГГГ **Масса нетто потребительской упаковки: 130 г**

LOT XXXXXXXXXXXX **Масса нетто: 7,5524 кг**

ДД.ММ.ГГГГ **Масса брутто: 8,5524 кг**

ДД.ММ.ГГГГ

САС

Производитель: Акционерное общество «Современные
Диагностические Системы» (АО «СДС»)
107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Богородское, ул.
Богородский вал, д. 3, стр. 32А
Тел.: +7 (495) 963-73-60, e-mail: info@udsys.ru, www.udsys.ru
Страна происхождения: Российская Федерация
Регистрационное удостоверение № XXXX/XXXXXX от
XX.XX.XXXX г.

6 4222790243236

Рис. 29. Макеты транспортной упаковки: Макеты первичной (потребительской) упаковки: Моющий раствор Диа-Клинер для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л с резиновой вставкой; Моющий раствор Диаклэир для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 1 л; Моющий раствор Диакленз для анализаторов автоматических гематологических по ТУ 20.59.52-006-66418557-2021, флакон 0,5 л; Моющий

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 30 листов (-а)

Генеральный директор АО «СДС»

Новикова Е. Б.

