

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«09» февраля 2024 г.

М.П.



Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Миоглобин» для количественного определения миоглобина (Myoglobin, MYO) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-273-65614693-2022»

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.)



Пароизоляционные крышки

лидкор

Лидлаб Амур
Миоглобин

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701

IVD




01.07.2024

REF


C89241




Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

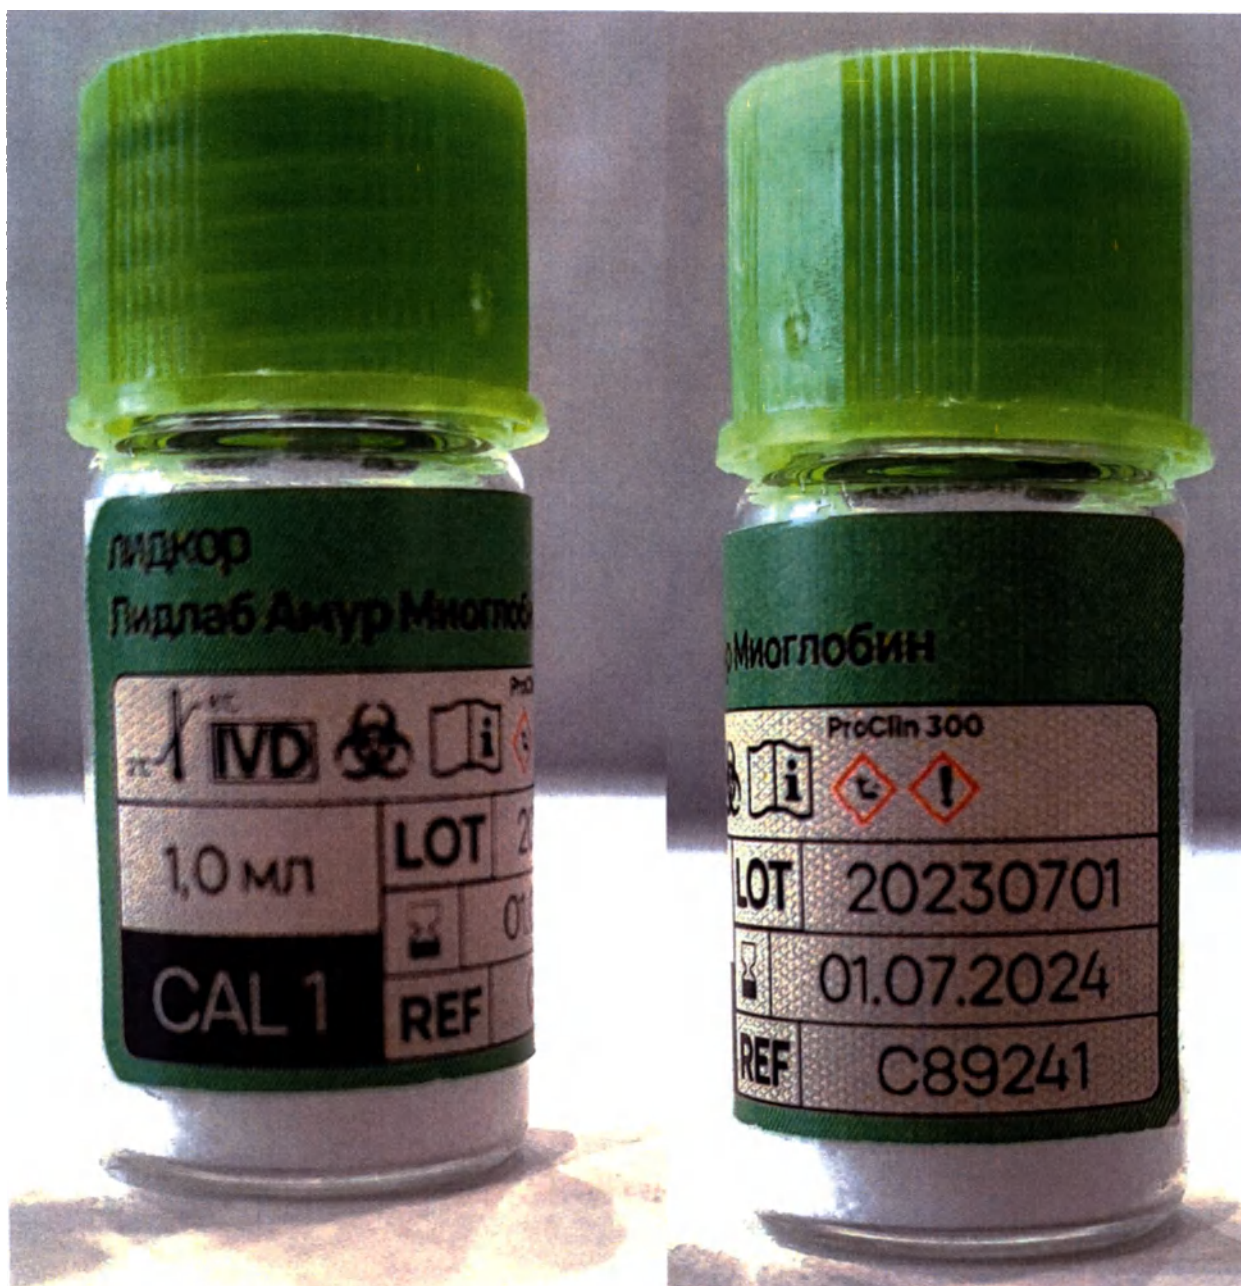

Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

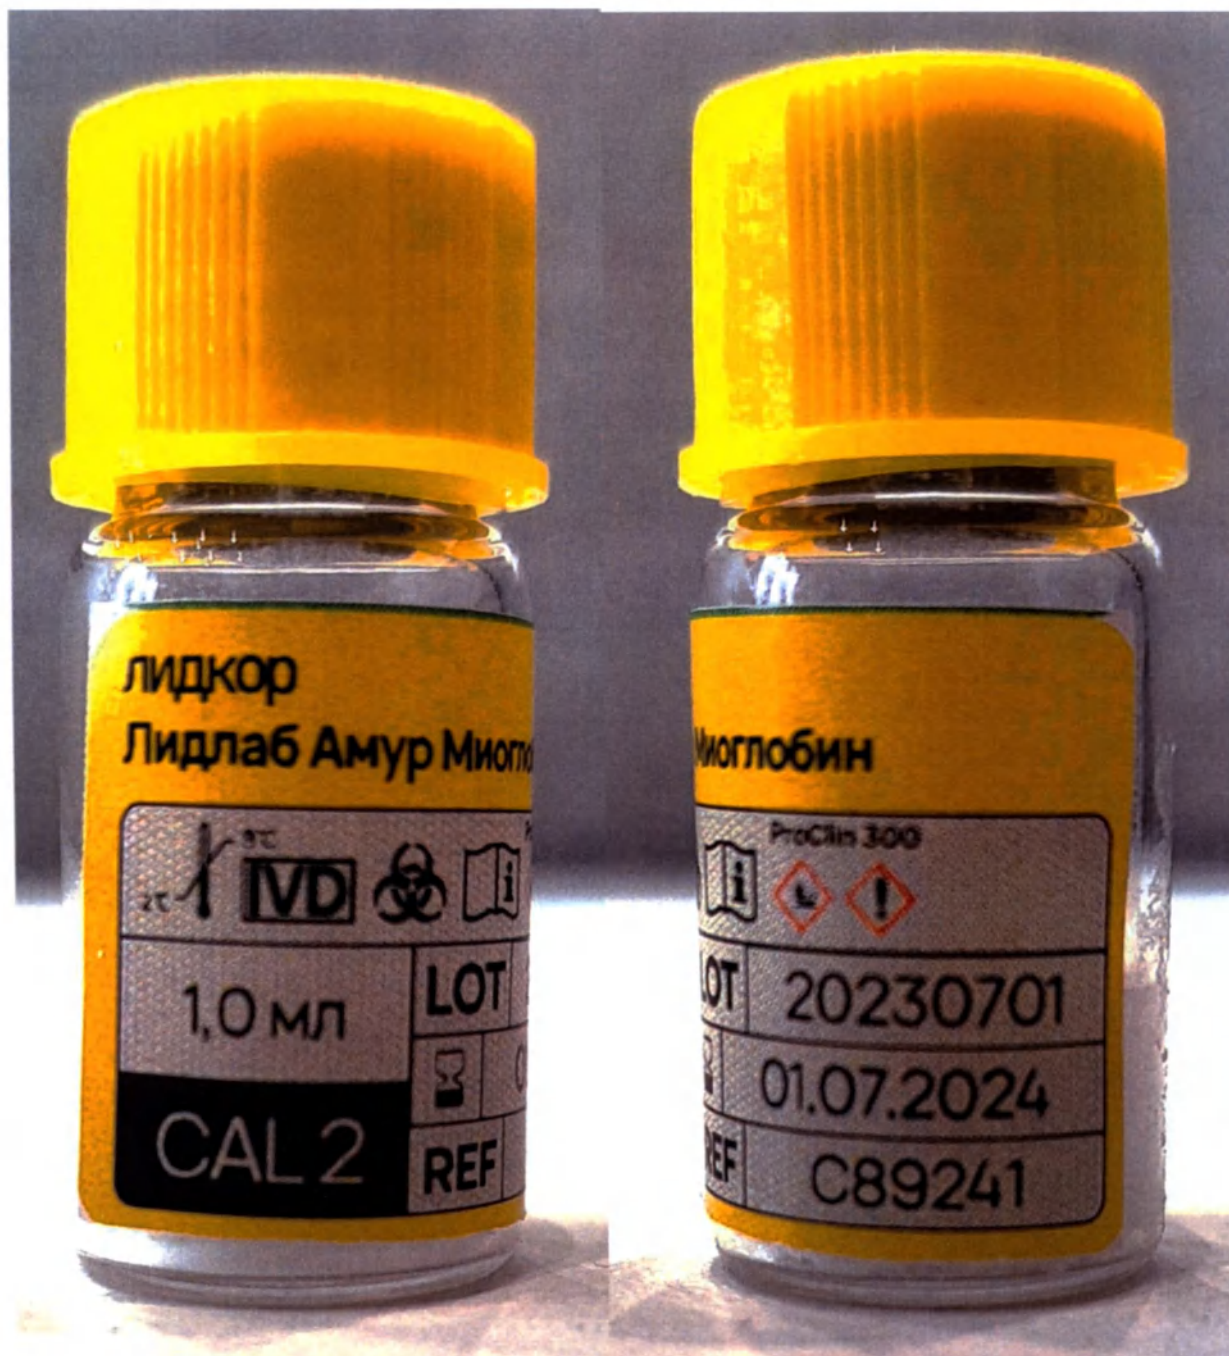

Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

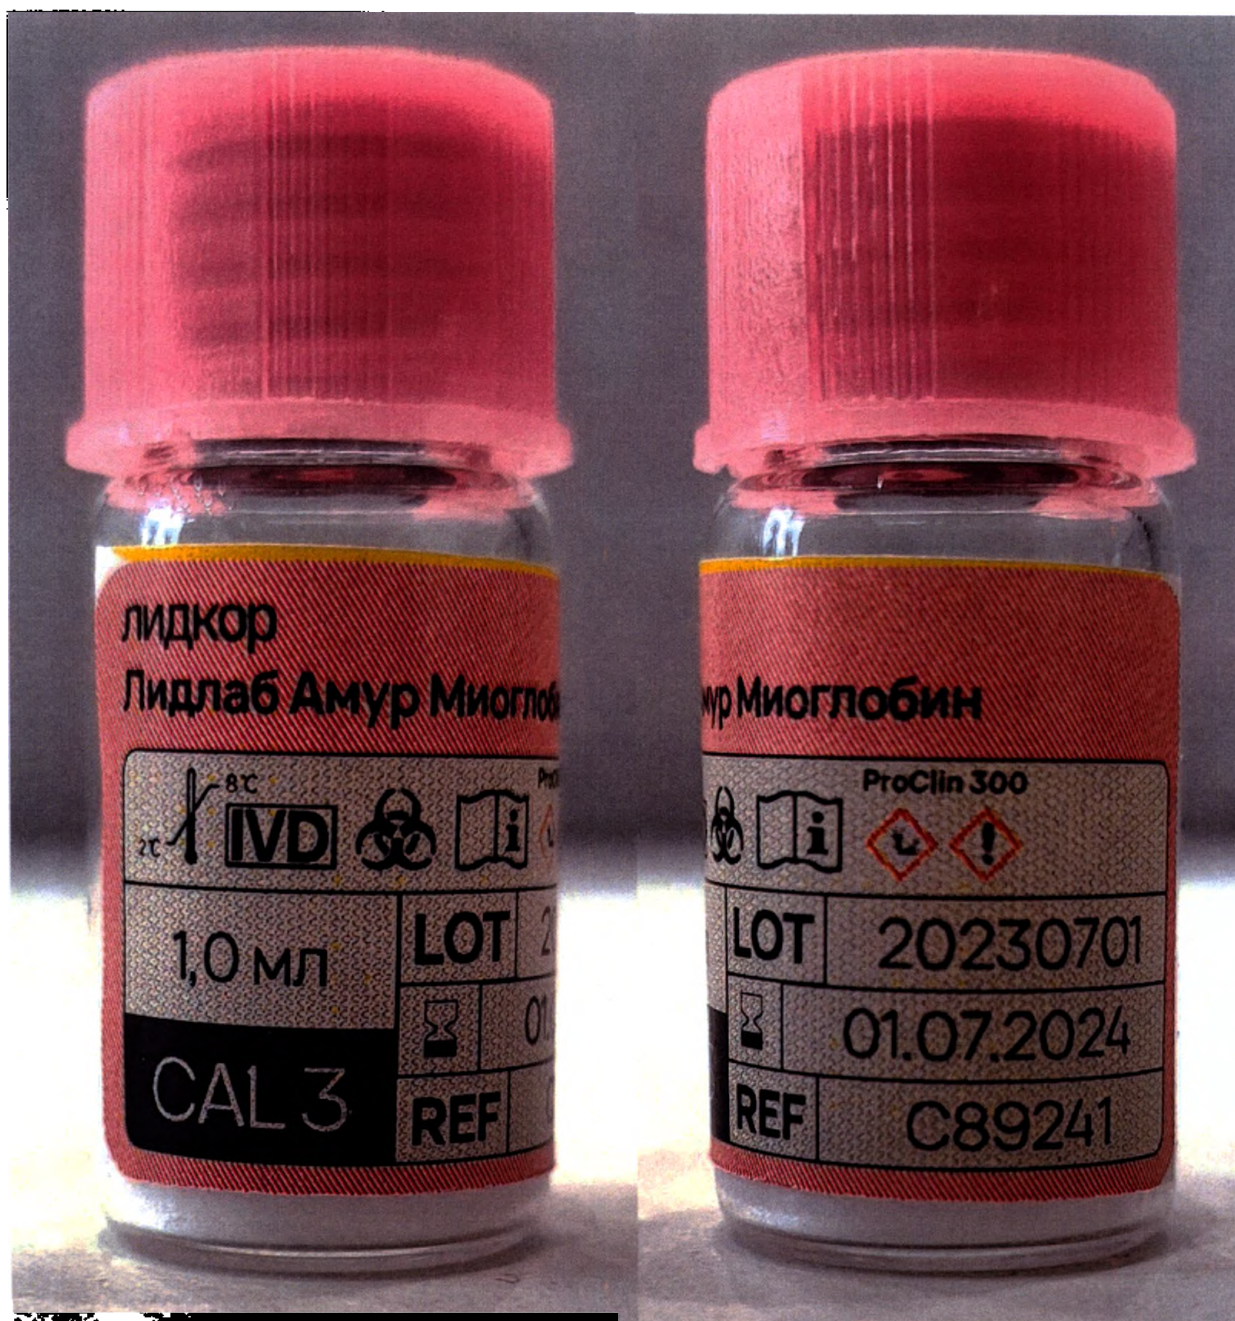

Потребительская упаковка



Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)


лидлаб



Лидлаб Амур Миоглобин

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



IVD

1x200



ProClim 300




01.07.2023

LOT 20230701 01.07.2024 REF C89241

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.


Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)

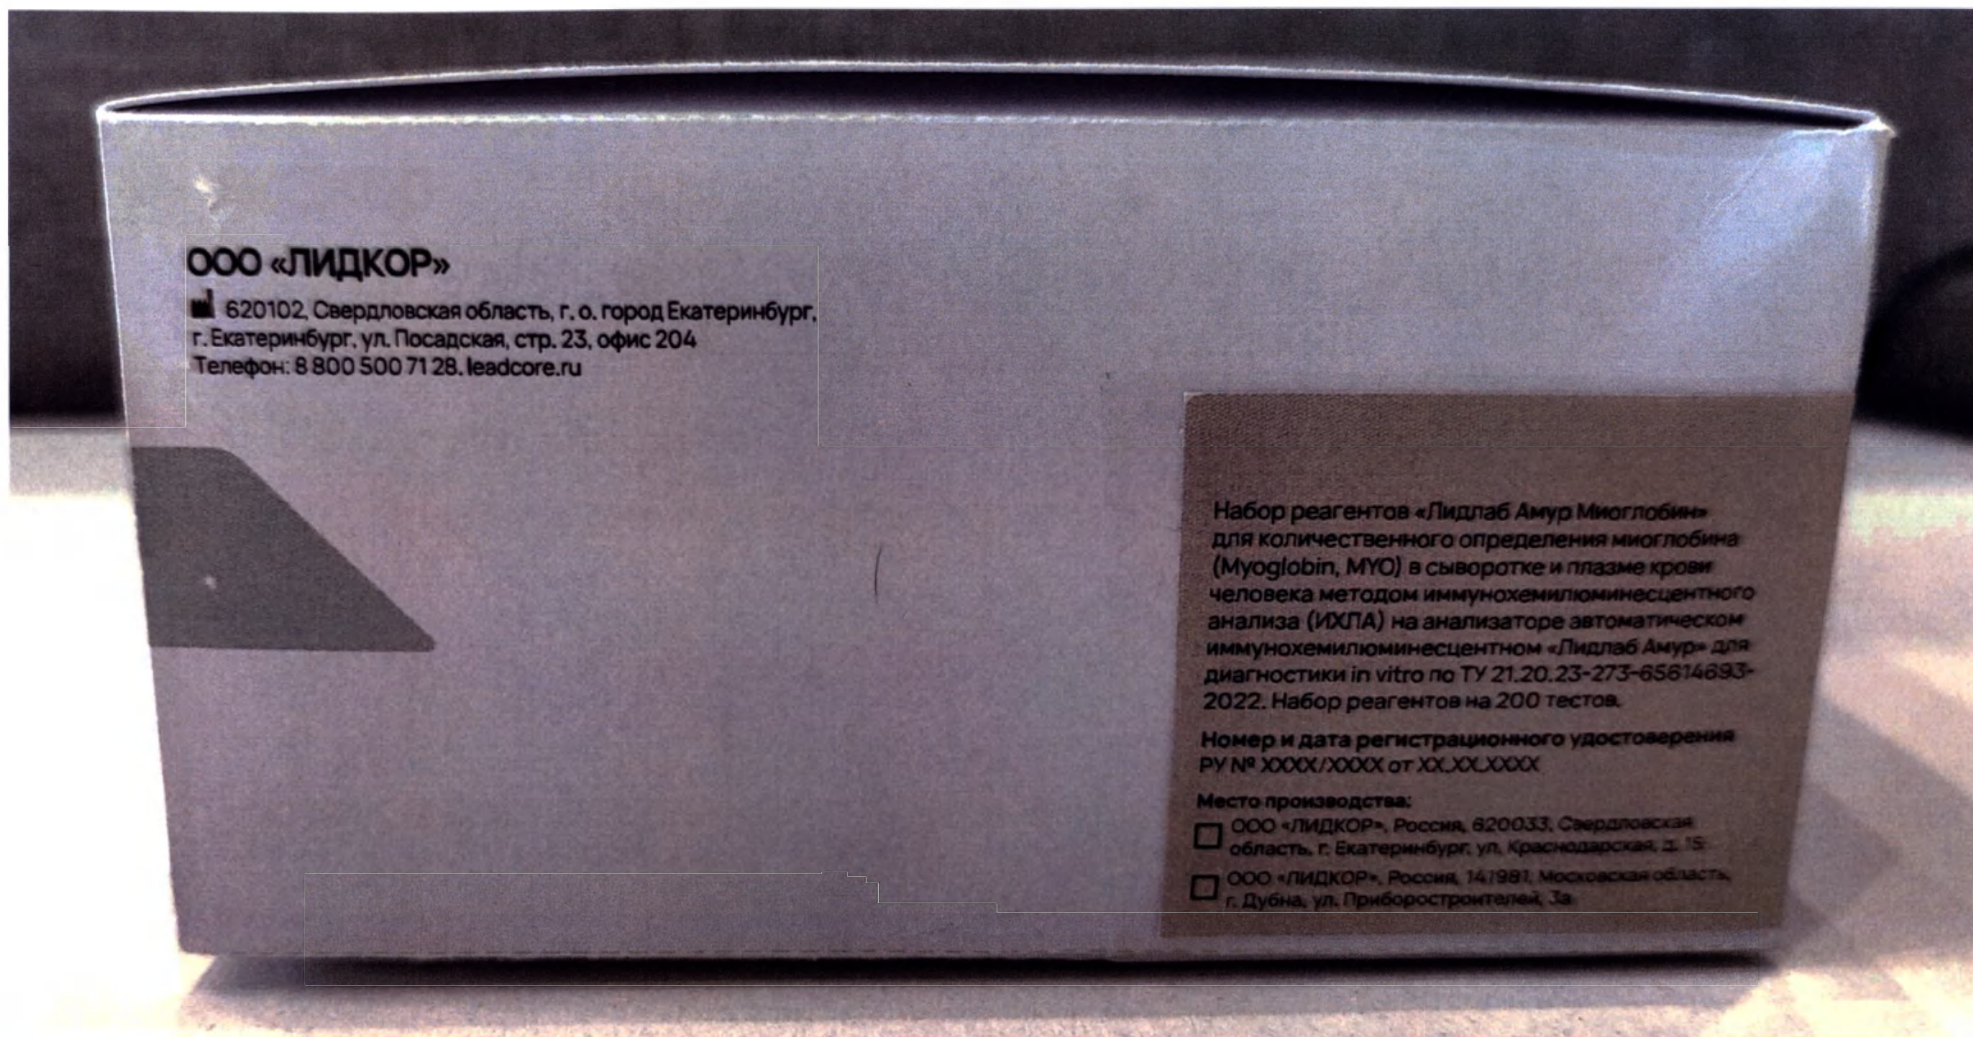


Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)

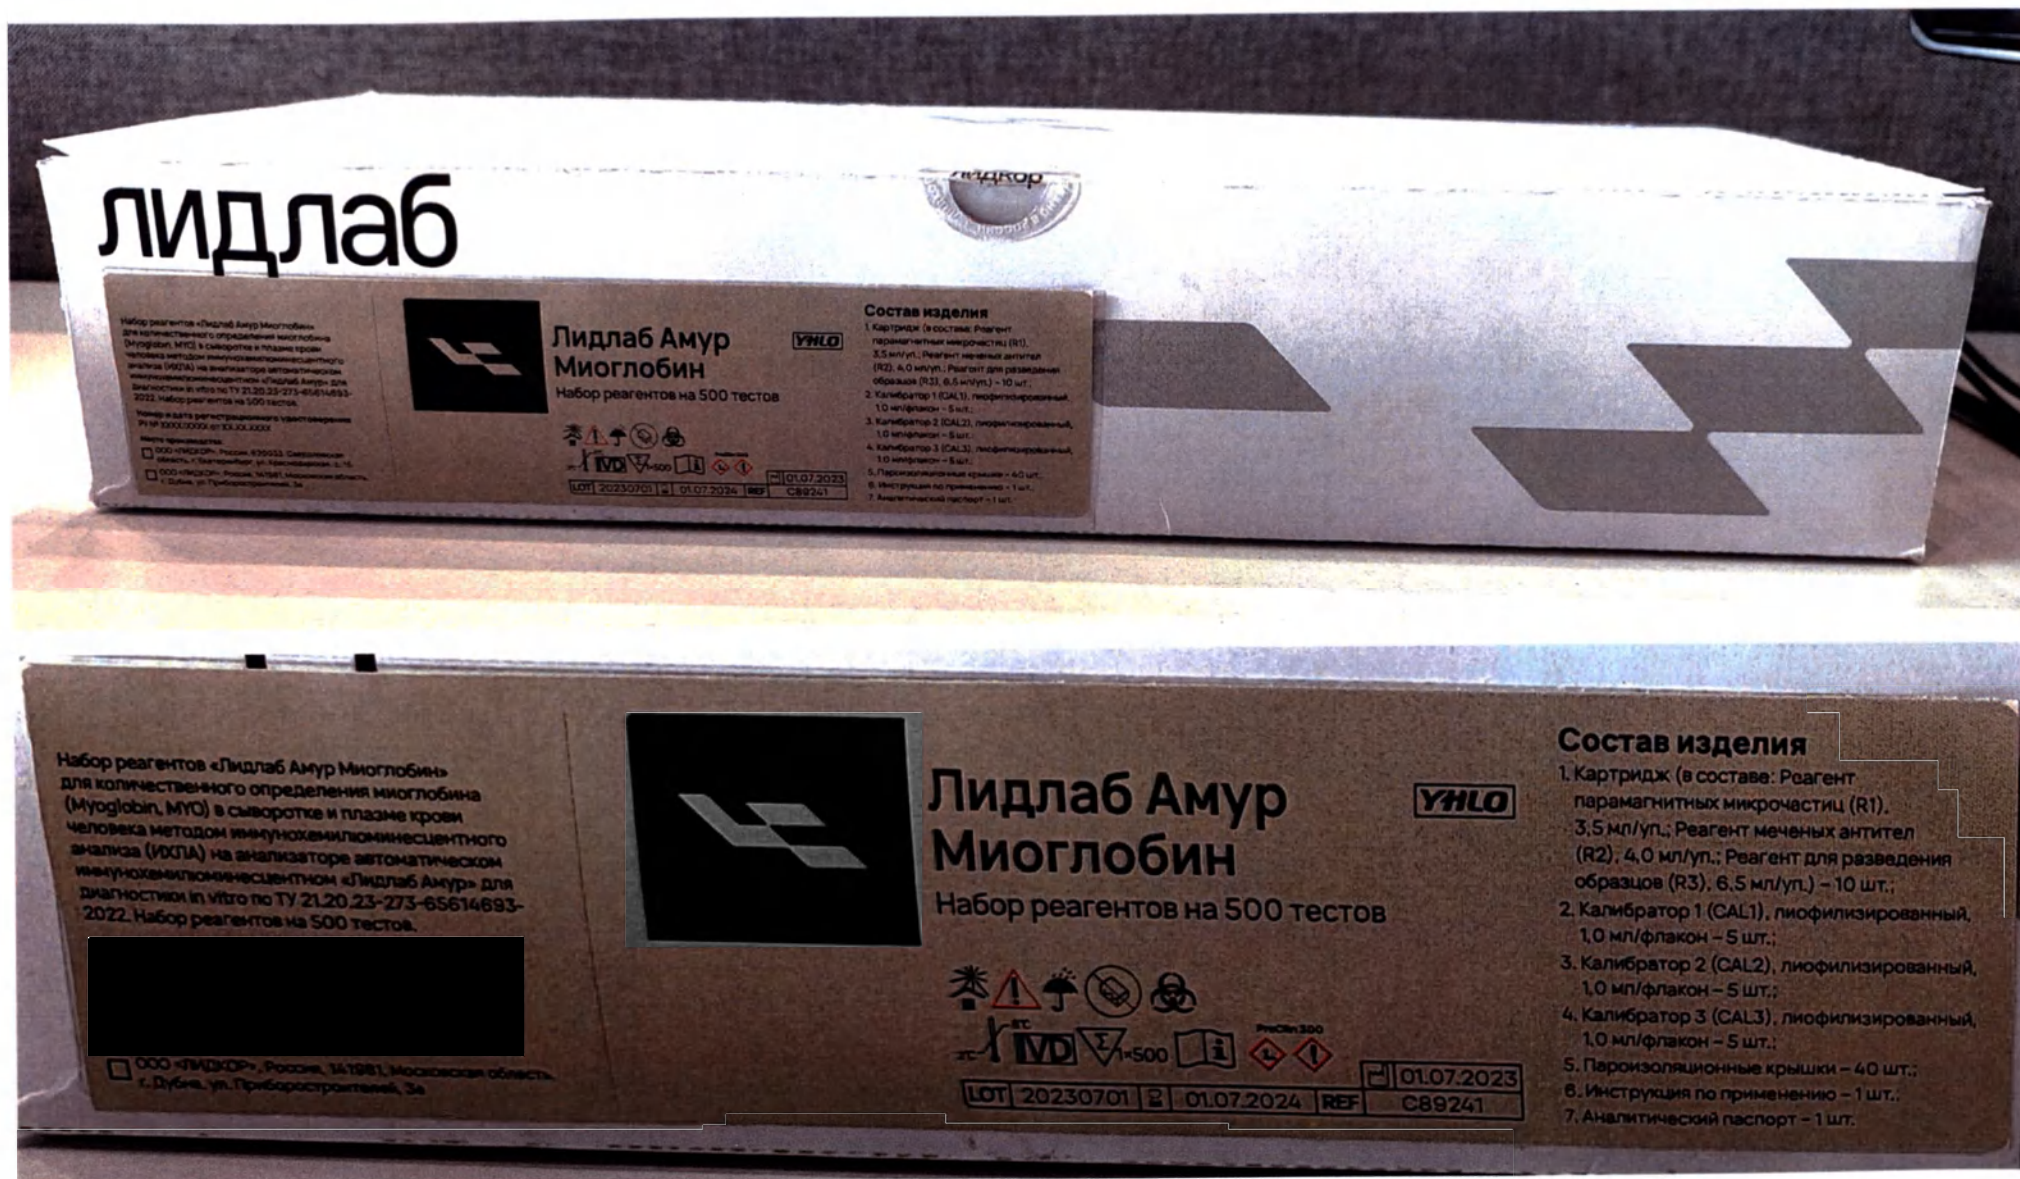

Потребительская упаковка 500 тестов (вид спереди)

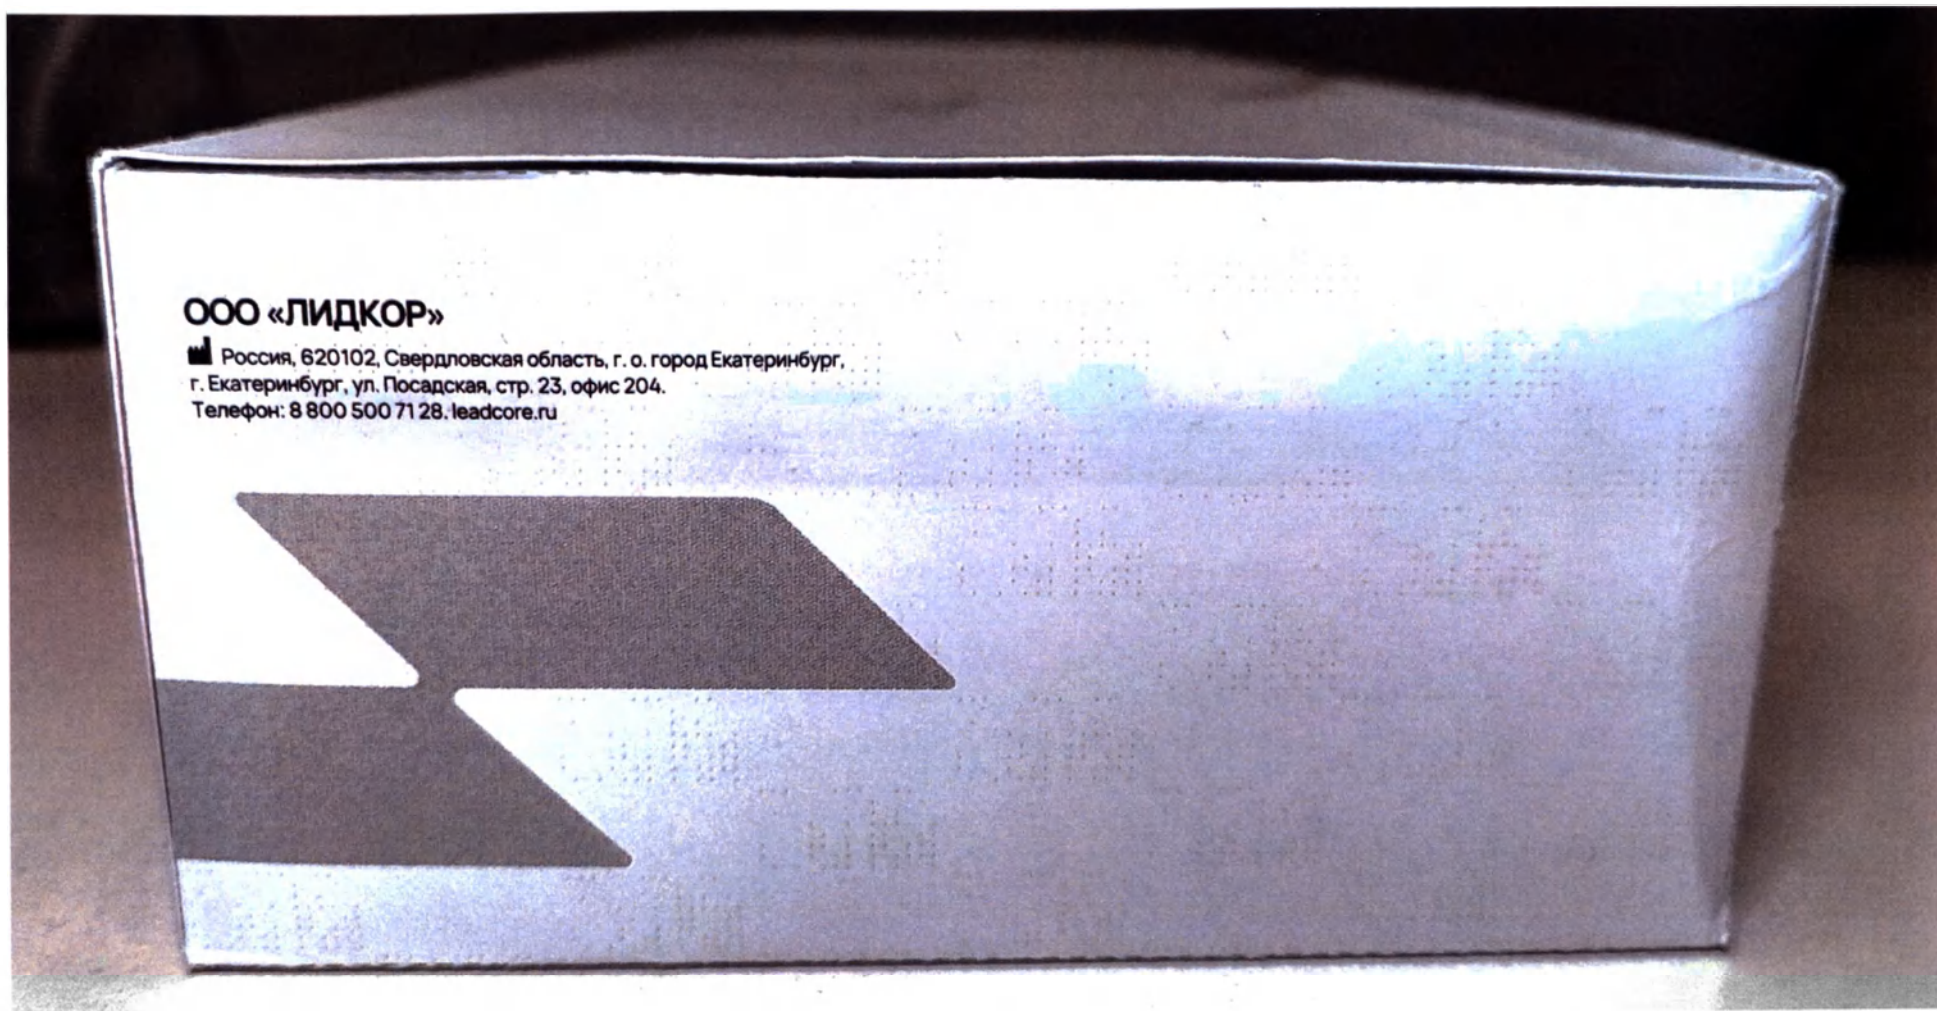

Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)

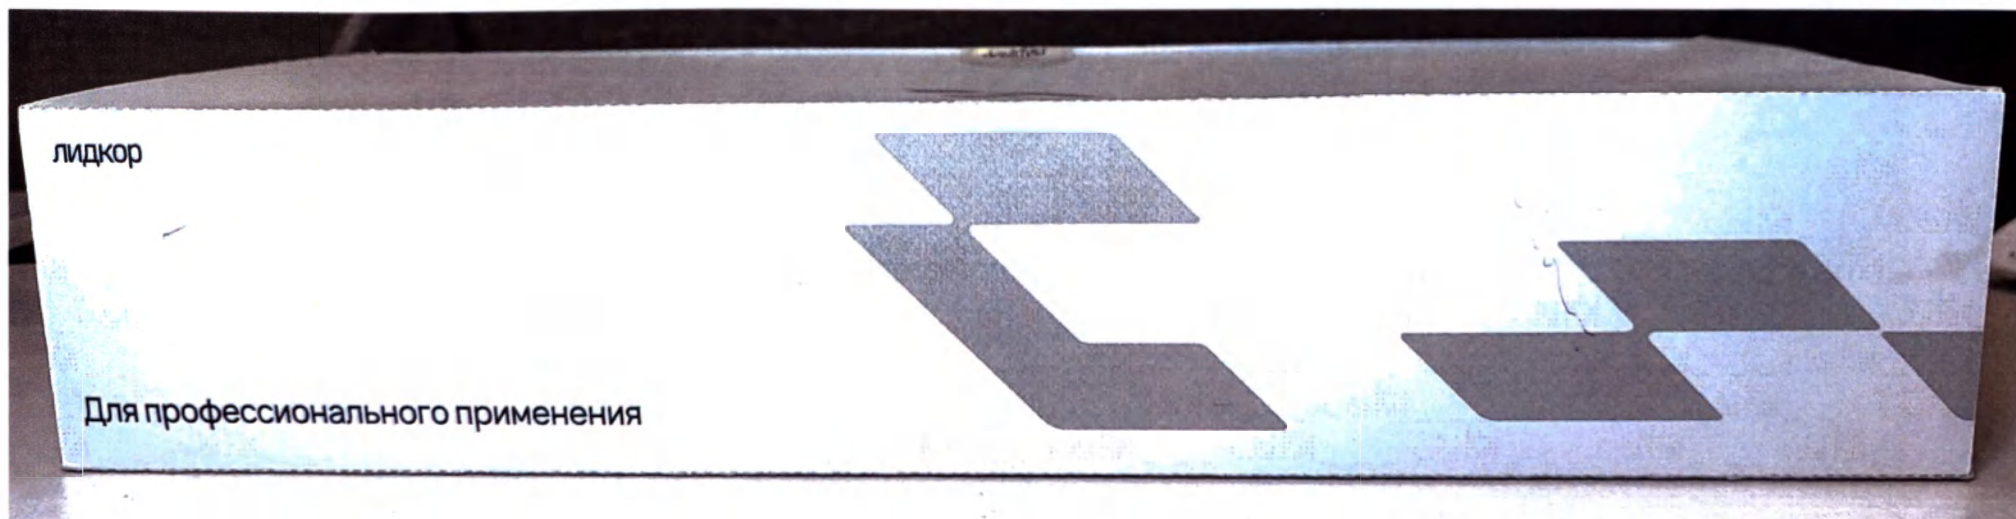

Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)

лидлаб

Набор реагентов «Лидлаб Амур Миоглобин» для количественного определения миоглобина (Myoglobin, MYO) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-273-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


☐ ООО «ЛИДСОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноварская, д. 15

☐ ООО «ЛИДСОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроительная, 3а



Лидлаб Амур
Миоглобин
Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO



LOT 20230701 01.07.2024 REF C88241

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 20 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
5. Паронепроницаемые крышки – 80 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Миоглобин» для количественного определения миоглобина (Myoglobin, MYO) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-273-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


☐ ООО «ЛИДСОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноварская, д. 15

☐ ООО «ЛИДСОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроительная, 3а



Лидлаб Амур
Миоглобин
Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO



LOT 20230701 01.07.2024 REF C88241

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 20 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
5. Паронепроницаемые крышки – 80 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Потребительская упаковка 1000 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)



Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.

Групповое фото.




Транспортная упаковка






Набор реагентов «Лидлаб Амур Миоглобин» для количественного определения миоглобина (Myoglobin, MYO) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-273-65614693-2022

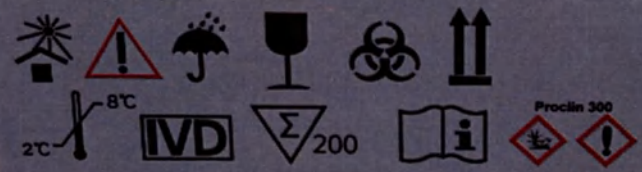


IVD

Σ 200



Для профессионального применения

 ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.			 01.07.2023	
LOT	20230701		01.07.2024	REF C89241

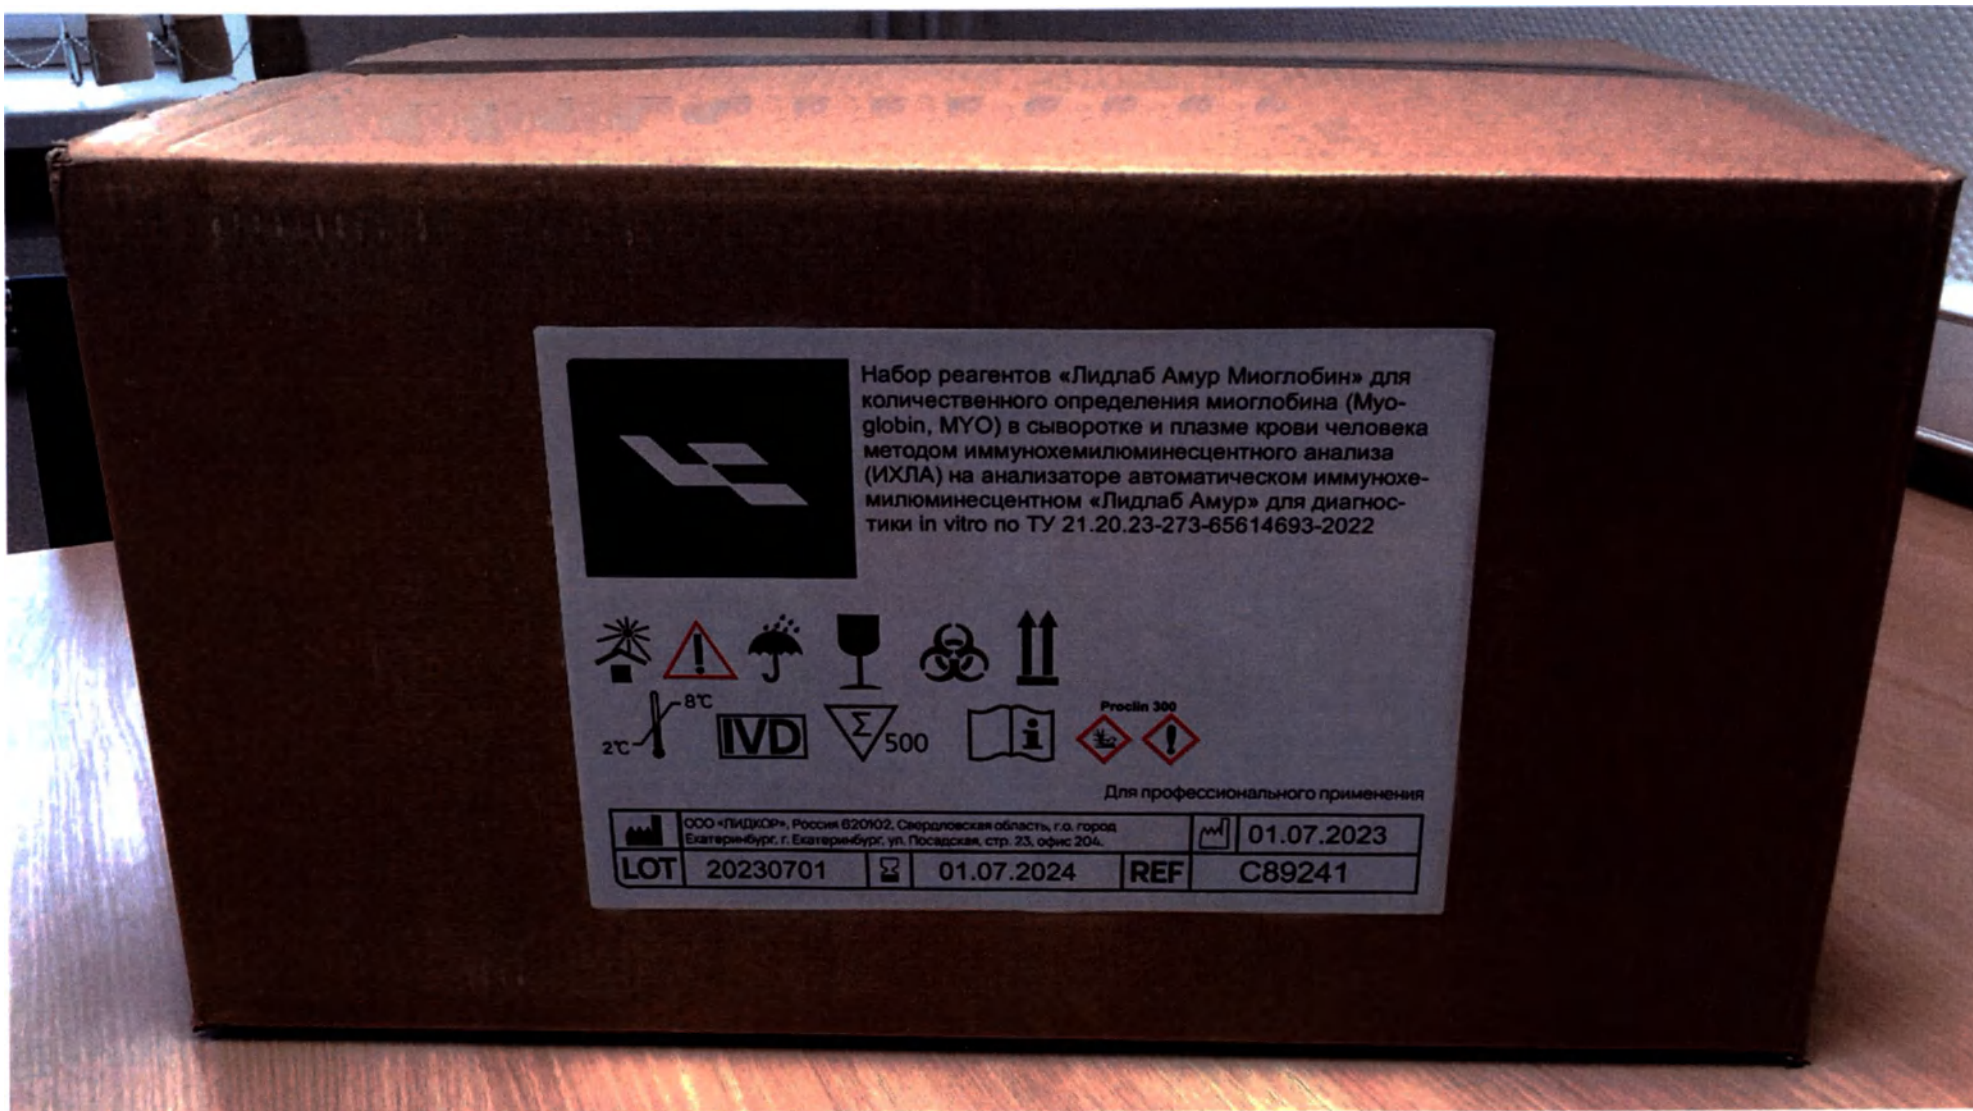



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

24 (двадцать четыре) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

000 /Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут


«01» июля 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Миоглобин» для количественного определения миоглобина (Myoglobin, MYO) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-273-65614693-2022»

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.;
 Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для разведения образцов
 (R3), 6,5 мл/уп.)

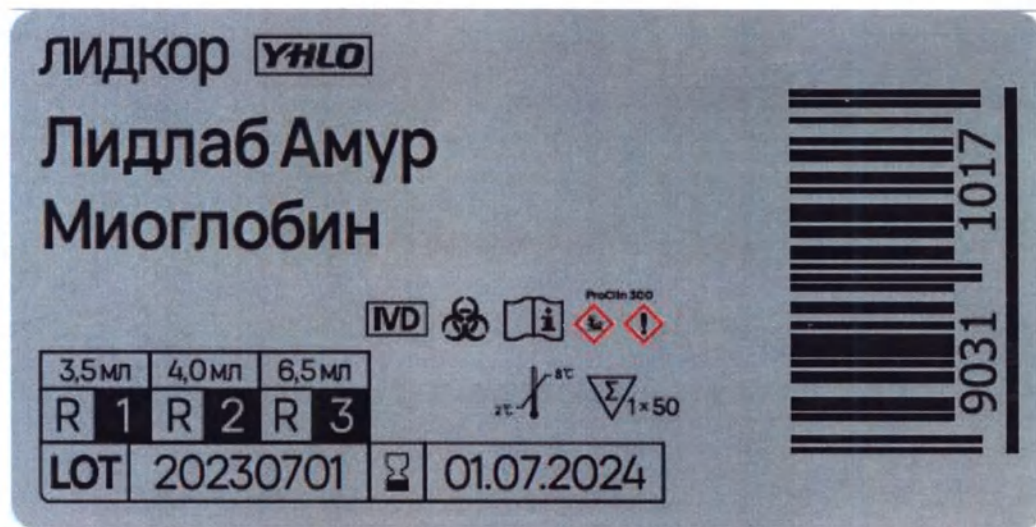

Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон




Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон



Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон



Пароизоляционные крышки

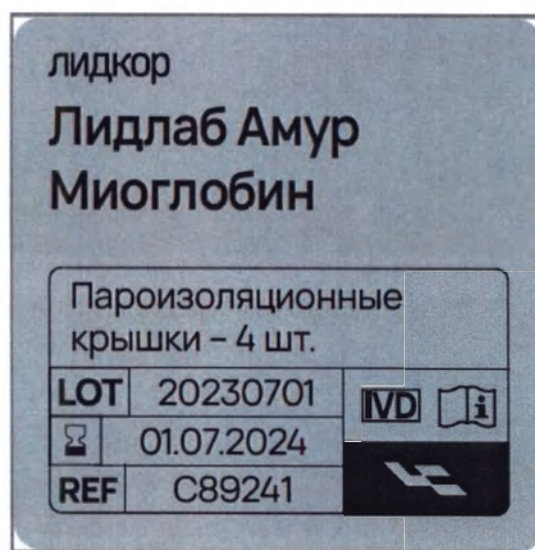

QR-code



Наклейка



Потребительская упаковка

Набор реагентов «Лидлаб Амур Миоглобин» для количественного определения миоглобина (Myoglobin, MYO) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилюминесцентного «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-273-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур Миоглобин

Набор реагентов на 100 тестов

Состав изделия

- Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 2 шт.;
- Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
- Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
- Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
- Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Аналитический паспорт – 1 шт.;

Набор реагентов «Лидлаб Амур Миоглобин» для количественного определения миоглобина (Myoglobin, MYO) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилюминесцентного «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-273-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур Миоглобин

Набор реагентов на 200 тестов

Состав изделия

- Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.;
- Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
- Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
- Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
- Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Аналитический паспорт – 1 шт.;

Набор реагентов «Лидлаб Амур Миоглобин» для количественного определения миоглобина (Myoglobin, MYO) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилюминесцентного «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-273-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур Миоглобин

Набор реагентов на 500 тестов

Состав изделия

- Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 10 шт.;
- Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
- Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
- Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
- Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Аналитический паспорт – 1 шт.;

Набор реагентов «Лидлаб Амур Миоглобин» для количественного определения миоглобина (Myoglobin, MYO) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилюминесцентного «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-273-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а


Лидлаб Амур Миоглобин

Набор реагентов на 1000 тестов


Состав изделия

- Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 20 шт.;
- Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
- Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
- Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
- Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Аналитический паспорт – 1 шт.;

Потребительская коробка

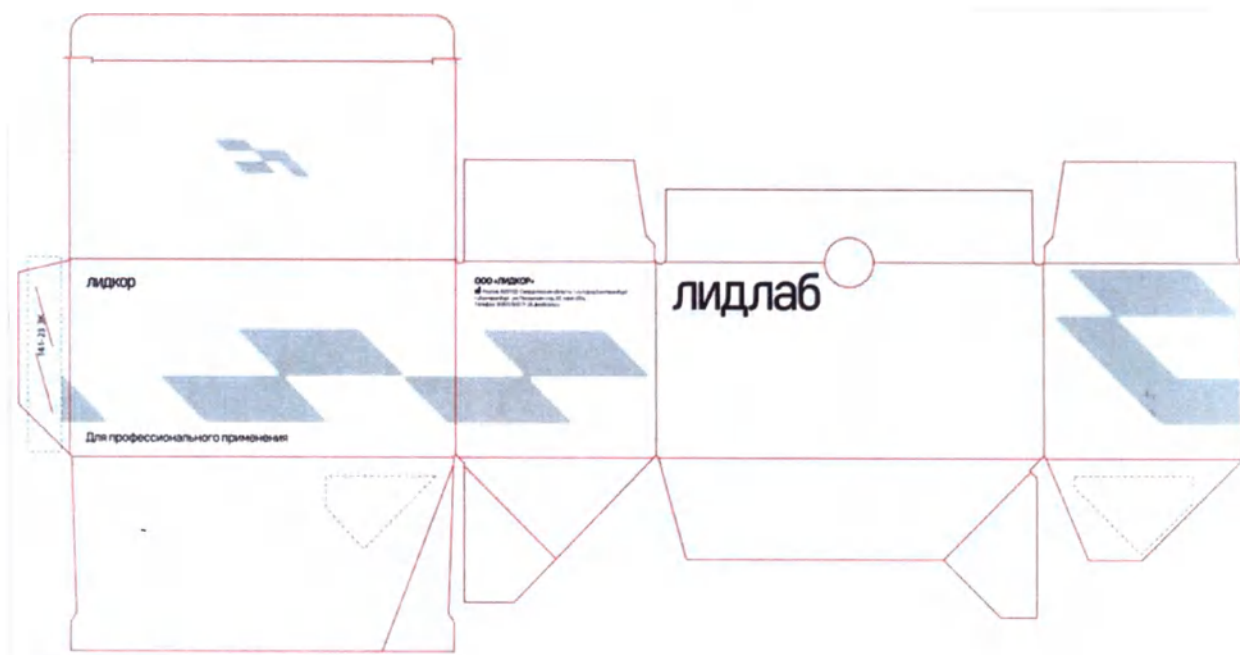

Транспортная упаковка

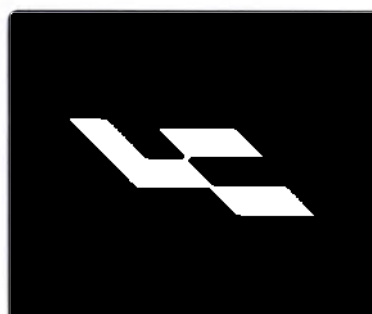


Набор реагентов «Лидлаб Амур Миоглобин» для количественного определения миоглобина (Myoglobin, MYO) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-273-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89241

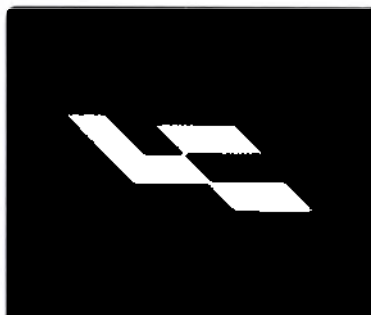


Набор реагентов «Лидлаб Амур Миоглобин» для количественного определения миоглобина (Myoglobin, MYO) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-273-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89241

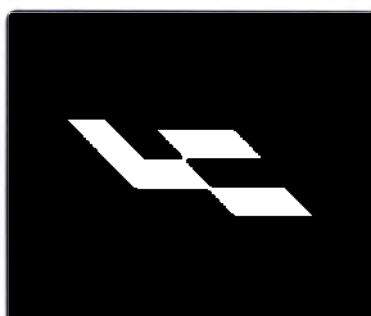

Набор реагентов «Лидлаб Амур Миоглобин» для количественного определения миоглобина (Myoglobin, MYO) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-273-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89241



Набор реагентов «Лидлаб Амур Миоглобин» для количественного определения миоглобина (Myoglobin, MYO) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-273-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89241

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ (ссслб) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/