

Фотографические изображения медицинского изделия

**«Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova,
в вариантах исполнения»,**

производства Fresenius Kabi AG (Фрезениус Каби АГ),
Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, Germany

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела регистрации
медицинских изделий и энтерального питания

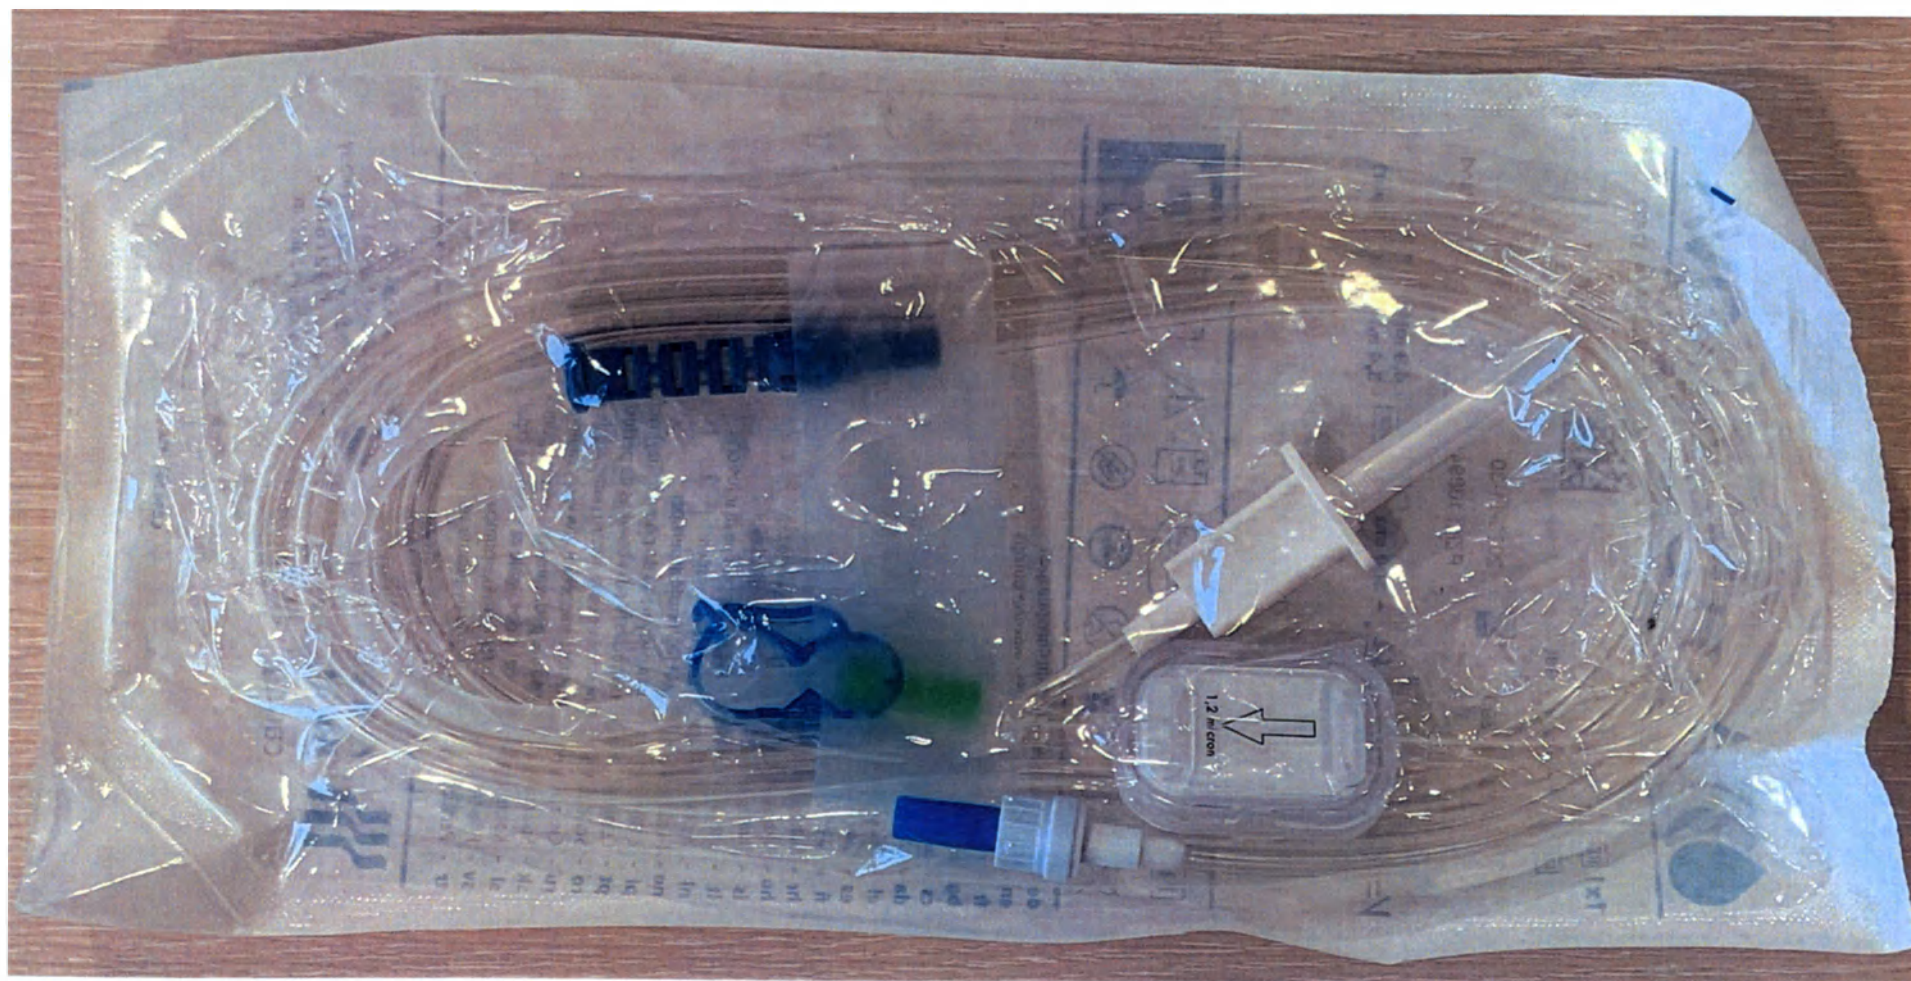
ООО «Фрезениус Каби»

Вицкова Г.Ю.

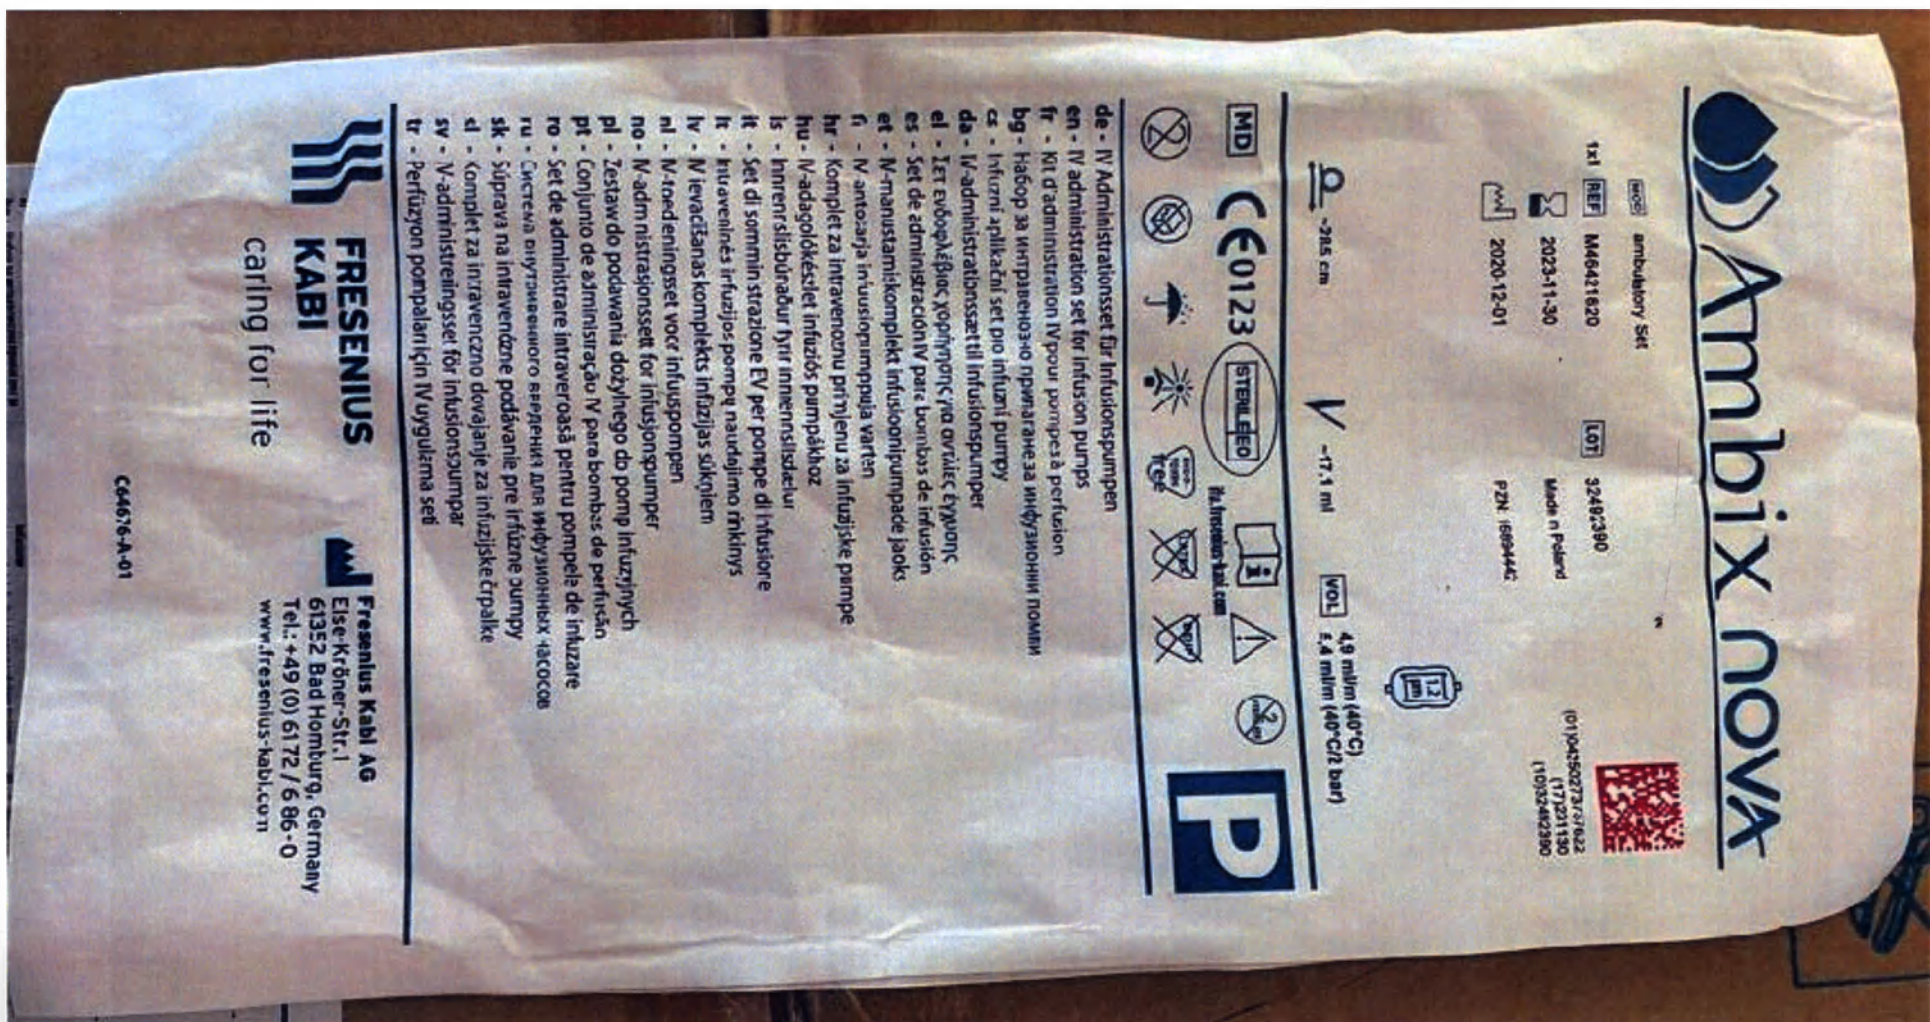
2024



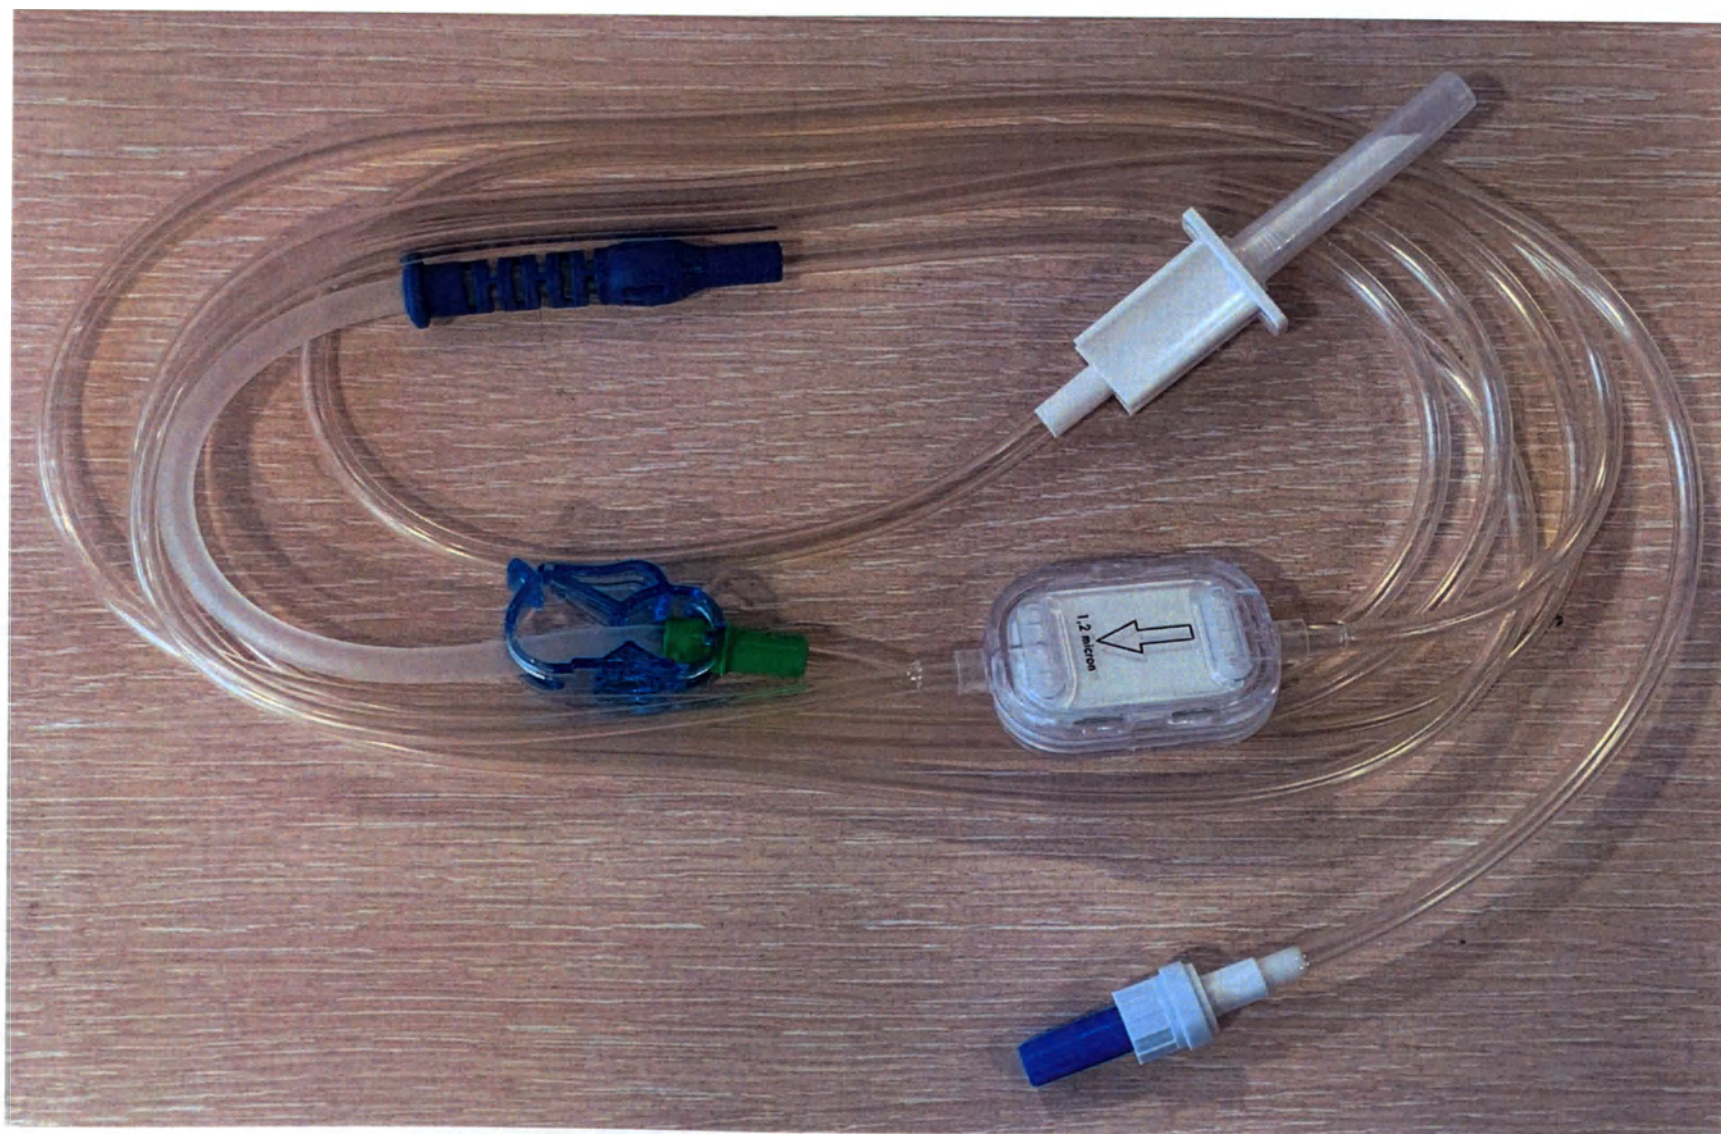
**Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova, в вариантах исполнения:
Вариант исполнения: I. Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova ambulatory Set.
Внешний вид, индивидуальная упаковка.**



Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova, в вариантах исполнения:
 Вариант исполнения I: Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova ambulatory Set.
 Внешний вид, индивидуальная упаковка. Вид сзади. Маркировка



**Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova, в вариантах исполнения:
Вариант исполнения I: Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova ambulatory Set.
Внешний вид.**



Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova, в вариантах исполнения:
Вариант исполнения: I. Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova ambulatory Set

Внешний вид. Транспортная упаковка. Маркировка.

Ambix nova MOD ambulatory Set

15x1 REF M46421820 LOT 32492390 2023-11-30 2020-12-01

MD CE0123 STONILECO ifu.fresenius-kabi.com

P ~285 cm ~17,1 ml 4,9 ml/m (40°C) 5,4 ml/m (40°C/2 bar)

de - IV Administrationsset für Infusionspumpen
en - IV administration set for infusion pumps
fr - Kit d'administration IV pour pompes à perfusion
bg - Набор за интравенозно прилагане за инфузионен помпи
cs - Infuzní aplikační set pro infuzní pumpu
da - IV-administrationsset til infusionspumpe
el - Σετ εγκατάστασης χορήγησης αοράλης έγχυσης
es - Set de administración IV para bombas de infusión
et - IV-manustamiskomplekt infusioonipumpade jaoks
fi - IV-antosara infuusiopumppuja varten
hr - Komplet za intravenoznu primjenu za infuzijske pumpe
hu - IV-adagókékesít infúziós pumpákhoz
is - Innveðnisbúnaður fyrir innveðnisstæðlar
it - Set di somministrazione EV per pompe di infusione
lt - Intraveninės infuzijos pumpų naudojimo rinkinys
lv - IV ievadišanas komplekts infūzijas sūkņiem
nl - IV-toedieningsset voor infusiepompen
no - IV-administrasjonssett for infusionspumpe
pl - Zestaw do podawania dozylnego do pomp infuzyjnych
pt - Conjunto de administração IV para bombas de perfusão
ro - Set de administrare intravenoasă pentru pompele de infuzare
ru - Система внутривенного введения для инфузионных насосов
sk - Súprava na intravenózne podávanie pre infúzne pumpy
sl - Komplet za intravenozno dovajanje za infuzijske črpalke
sv - IV-administreringsset för infusionspumpar
tr - Perfüzyon pompaları için IV uygulama seti

CH-REP and Importer:
Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4
6010 Kriens


FRESENIUS KABI caring for life
Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg, Germany
Tel.: +49 (0) 61 72 / 6 86 - 0
www.fresenius-kabi.com
15xPZN: 16894442

Made in Poland

(01)04250273737639
(17)231130
(10)32492390
M46421820-B-03


Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova, в вариантах исполнения:


Вариант исполнения: I. Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova ambulatory Set Инструкция вкладыш





Ambix nova
M46421820
Ambix nova ambulatory Set


de-Schreibungsanleitung


1 

2 


3 


4 


5 


6 

de-Schreibungsanleitung


7 

8 


9 


10 


11 

12 

de-Schreibungsanleitung


13 

14 

15 

16 

17 

18 

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6

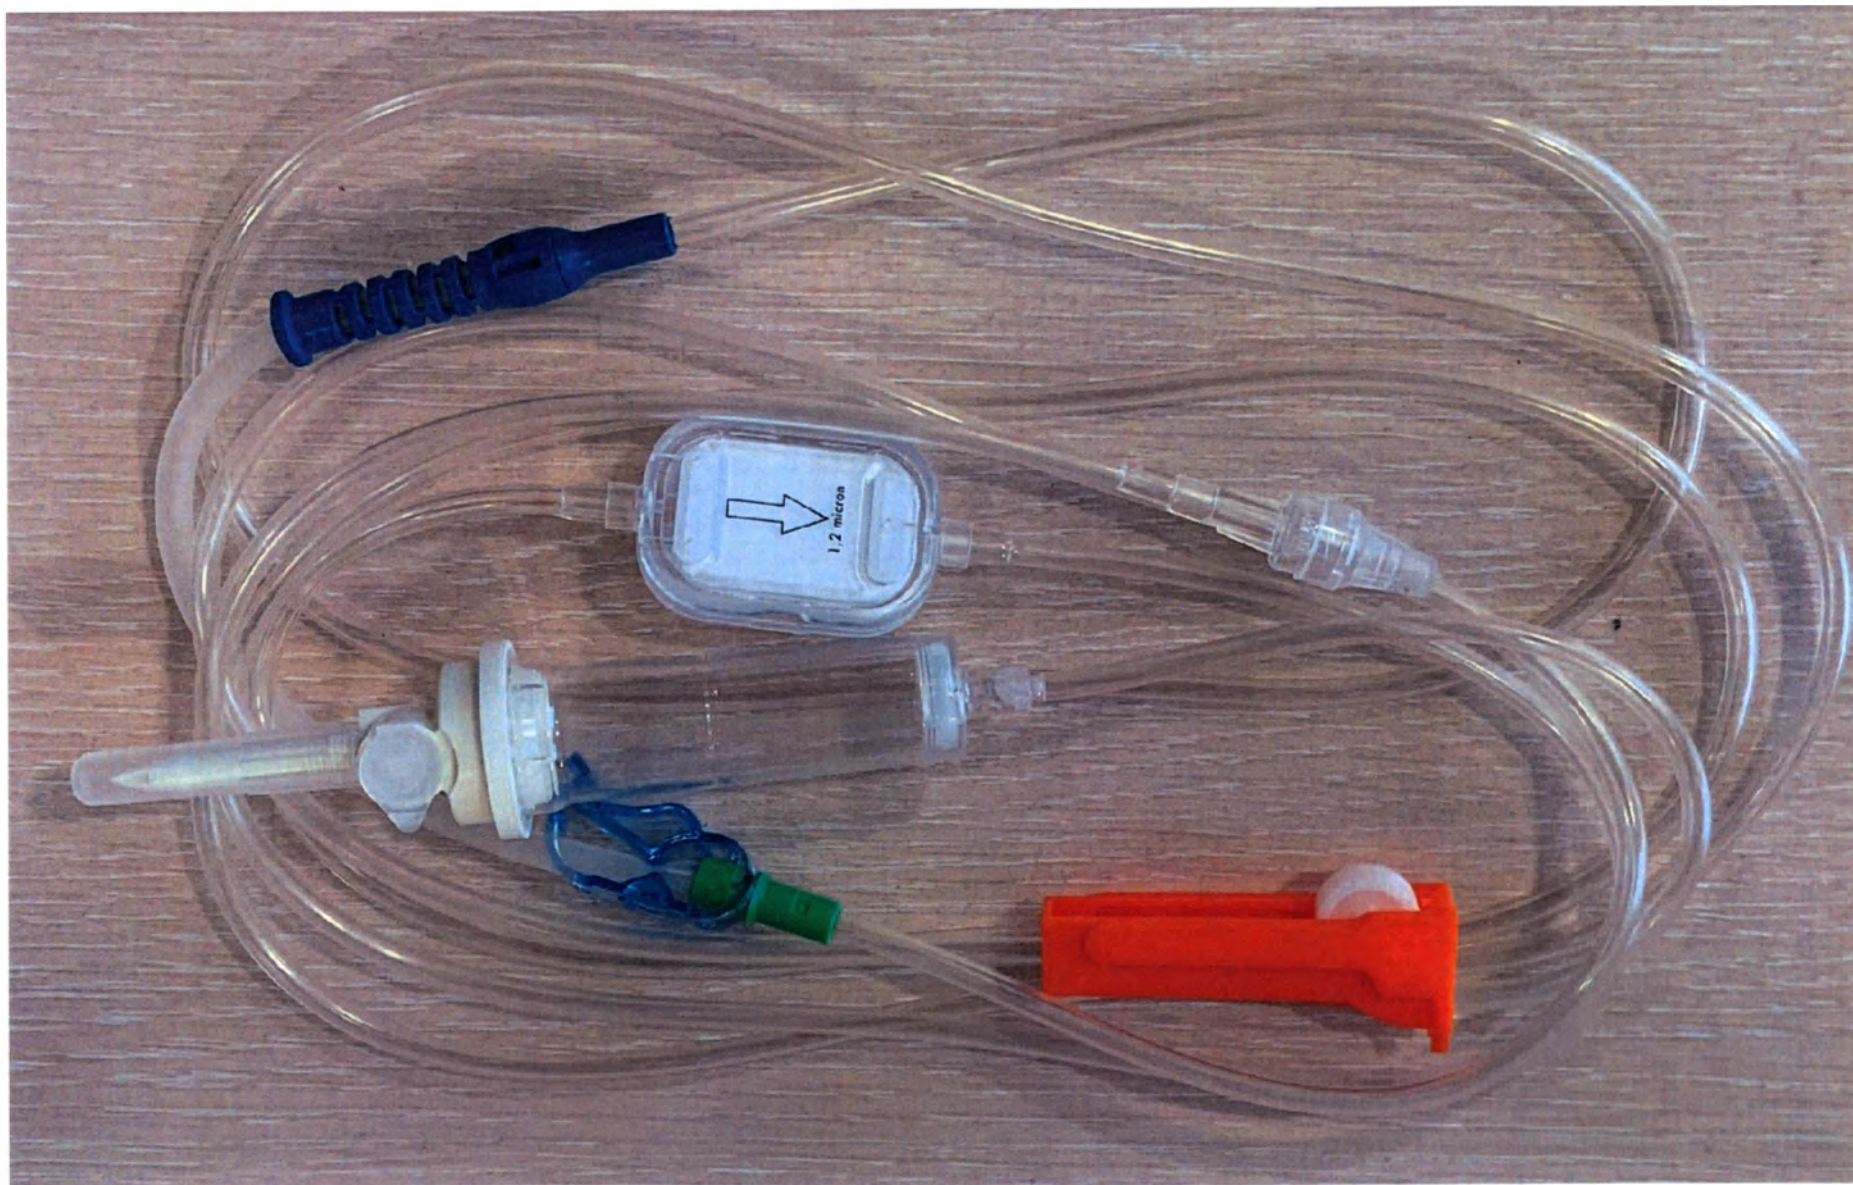
**Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova, в вариантах исполнения:
Вариант исполнения: II. Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova stationary Set.
Внешний вид, в индивидуальной упаковке.**



Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova, в вариантах исполнения:
 Вариант исполнения: II. Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova stationary Set.
 Внешний вид, в индивидуальной упаковке. Вид сзади. Маркировка.



**Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova, в вариантах исполнения:
Вариант исполнения: II. Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova stationary Set
Внешний вид.**



Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova, в вариантах исполнения:
 Вариант исполнения: II. Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova stationary Set
 Внешний вид. Транспортная упаковка. Маркировка.

Ambix nova MOD stationary Set

15x1 REF M46421910 LOT 32473450 2023-11-17 2020-11-18

MD CE 0123 STERILE i.fresenius-kabi.com P ~300 cm ~26,9 ml 4,9 ml/m (40°C) 5,4 ml/m (40°C/2 bar)

die - IV Administrationsset für Infusionspumpen
 en - IV administration set for infusion pumps
 fr - Kit d'administration IV pour pompe à perfusion
 bg - Набор за инфузионна помпа за инфузионна помпа
 cs - Infuzní sada pro infúzní pumpu
 da - IV-administrationsset til infusionspumpe
 el - Set de administratie IV pentru pompa de infuzie
 es - Set de administración IV para bombas de infusión
 et - IV-manustamiskomplekt infusioonipumpade jaoks
 fi - IV-antotusjärjestelmä infuusiopumpun varten
 hr - Komplet za intravenoznu primjenu za infuzijske pumpe
 hu - IV-adagolókészlet infúziós pumpához
 is - Innrennsliðbúnaður fyrir innrennsliðsælar
 it - Set di somministrazione EV per pompe di infusione
 lt - Intraveninės infuzijos pompų naudojimo rinkinys
 lv - IV ievadšanas komplekts infūzijas sūkšiem
 nl - IV-toedieningsset voor infusiepomp
 no - IV-administrasjonssett for infusjonspumper
 pl - Zestaw do podawania dożylnego do pomp infuzyjnych
 pt - Conjunto de administração IV para bombas de perfusão
 ro - Set de administrare intravenoasă pentru pompele de infuzare
 ru - Система внутривенного введения для инфузионных насосов
 sk - Súprava na intravenózne podávanie pre infúzne pumpy
 sl - Komplet za intravenozno dovajanje za infuzijske črpalke
 sv - IV-administreringsset för infusionspumpar
 tr - Perfüzyon pompaları için IV uygulanabilir seti


FRESENIUS KABI caring for life
 Fresenius Kabi AG
 Else-Kröner-Str. 1
 61352 Bad Homburg, Germany
 Tel.: +49 (0) 61 72 / 6 86-0
 www.fresenius-kabi.com

Made in Poland
 15xPZN: 16894459


CH-REP and Importer:
 Fresenius Kabi (Schweiz) AG
 Am Mattenhof 4
 6010 Kriens


(01) 0425027373615
 (17) 231117
 (10) 32473450
 M46421910-B-03


Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova, в вариантах исполнения: Вариант исполнения II: Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova stationary Set Инструкция вкладыш





Ambix nova
M46421910
Ambix nova stationary Set

1 

2 

3 

4 

5 

6 

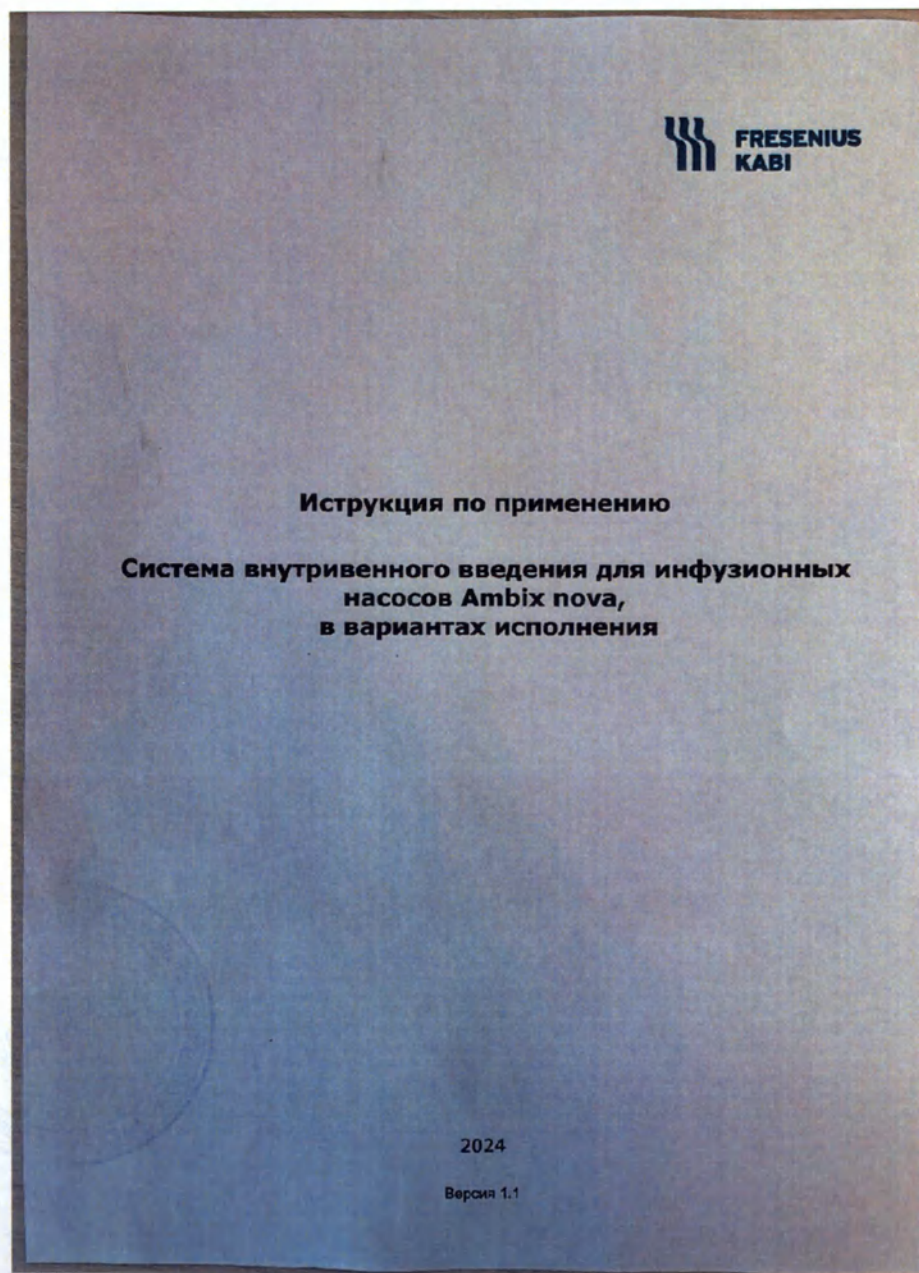
6.1. Подготовка к инфузии:
Убедитесь, что инфузионный насос Ambix nova stationary Set правильно настроен на работу. Проверьте, чтобы инфузионный насос был правильно настроен на работу. Проверьте, чтобы инфузионный насос был правильно настроен на работу. Проверьте, чтобы инфузионный насос был правильно настроен на работу.

6.2. Подготовка к инфузии:
Убедитесь, что инфузионный насос Ambix nova stationary Set правильно настроен на работу. Проверьте, чтобы инфузионный насос был правильно настроен на работу. Проверьте, чтобы инфузионный насос был правильно настроен на работу. Проверьте, чтобы инфузионный насос был правильно настроен на работу.

6.3. Подготовка к инфузии:
Убедитесь, что инфузионный насос Ambix nova stationary Set правильно настроен на работу. Проверьте, чтобы инфузионный насос был правильно настроен на работу. Проверьте, чтобы инфузионный насос был правильно настроен на работу. Проверьте, чтобы инфузионный насос был правильно настроен на работу.

6.4. Подготовка к инфузии:
Убедитесь, что инфузионный насос Ambix nova stationary Set правильно настроен на работу. Проверьте, чтобы инфузионный насос был правильно настроен на работу. Проверьте, чтобы инфузионный насос был правильно настроен на работу. Проверьте, чтобы инфузионный насос был правильно настроен на работу.

**Система внутривенного введения для инфузионных насосов Ambix nova, в вариантах исполнения:
Инструкция по применению**





ООО «Фрезениус Каби»
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Г.Ю. Вицкова
Руководитель отдела регистрации медицинских
изделий
Лист *26*
Действующая на основании Доверенности № L-24-21)
Вицкова Г.Ю.