

ООО «Тринити Медикал Системс»
Генеральный директор
Серегин Р.В.



(Подпись)

2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

**Система оптической когерентной томографии глаза
TowardPi**

Производитель:
TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd.
(ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи Лтд.)

2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Варианты исполнения полностью идентичны внешне, имеют одинаковую конструкционную основу, имеют одинаковое описание/назначение, внешний вид, массу, габаритные размеры - в связи с этим фотографические изображения не дублируются и представлены следующим образом:

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi

TowardPi BM-400K MAX, TowardPi BM-400K, TowardPi BM Lite, TowardPi BM-400K NF.

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi

TowardPi YG-100K MAX, TowardPi YG-100K PRO, TowardPi YG Lite, TowardPi YG-100K NF.

Блок основной для TowardPi BM-400K MAX

Блок основной для TowardPi BM-400K

Блок основной для TowardPi BM Lite

Блок основной для TowardPi BM-400K NF

Блок основной для TowardPi YG-100K MAX

Блок основной для TowardPi YG-100K PRO

Блок основной для TowardPi YG Lite

Блок основной для TowardPi YG-100K NF

Все основные функциональные элементы/части вариантов МИ идентичны, имеют одинаковую конструкционную основу, имеют одинаковое описание/назначение, внешний вид, массу, габаритные размеры - в связи с этим фотографические изображения не дублируются и распространяются на все варианты исполнения:

TowardPi BM-400K MAX,

TowardPi BM-400K,

TowardPi BM Lite,

TowardPi BM-400K NF,

TowardPi YG-100K MAX,

TowardPi YG-100K PRO,

TowardPi YG Lite,

TowardPi YG-100K NF:

Руководство по эксплуатации для всех вариантов исполнения

Чехол пылезащитный для всех вариантов исполнения

Кабель электропитания для всех вариантов исполнения

Блок обработки данных (компьютер PC02) для TowardPi BM-400K MAX, TowardPi BM-400K, TowardPi BM Lite, TowardPi BM-400K NF

Блок обработки данных (компьютер PC01) для TowardPi YG-100K MAX, TowardPi YG-100K PRO, TowardPi YG Lite, TowardPi YG-100K NF

Трансформатор напряжения электросети (IT04) с комплектом крепежных болтов (ØM8 x40мм, 6 шт.) для всех вариантов исполнения

Стол электроподъемный (MT01) для размещения основного блока, трансформатора и компьютера для всех вариантов исполнения

Насадка для сканирования переднего сегмента глаза (AS02) для TowardPi BM-400K MAX, TowardPi BM-400K, TowardPi BM Lite, TowardPi BM-400K NF

Насадка для сканирования переднего сегмента глаза (AS01) для TowardPi YG-100K MAX, TowardPi YG-100K PRO, TowardPi YG Lite, TowardPi YG-100K NF.

Предохранитель, 15 А для всех вариантов исполнения

Предохранитель, 25 А для всех вариантов исполнения

Предохранитель, 3 А для всех вариантов исполнения

Салфетки бумажные одноразовые для всех вариантов исполнения

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi
TowardPi BM-400K MAX, TowardPi BM-400K, TowardPi BM Lite, TowardPi BM-400K NF.



Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi
TowardPi YG-100K MAX, TowardPi YG-100K PRO, TowardPi YG Lite, TowardPi YG-100K NF.



Блок основной для TowardPi BM-400K MAX




Блок основной для TowardPi BM-400K








Блок основной для TowardPi YG-100K MAX

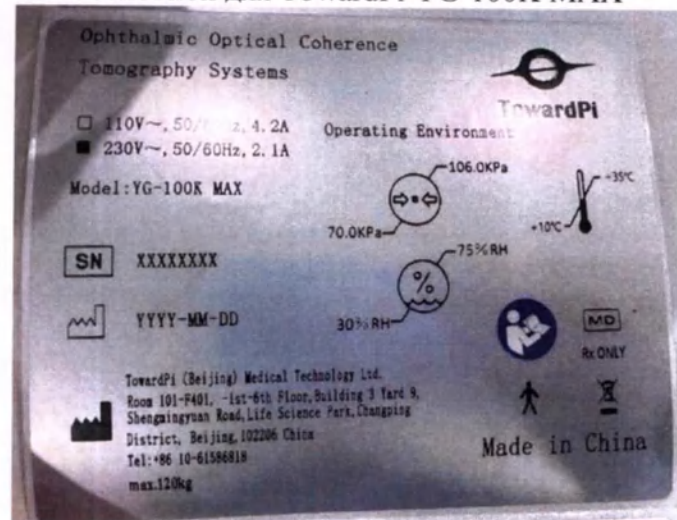


Блок основной для TowardPi YG-100K PRO



Блок основной для TowardPi YG Lite

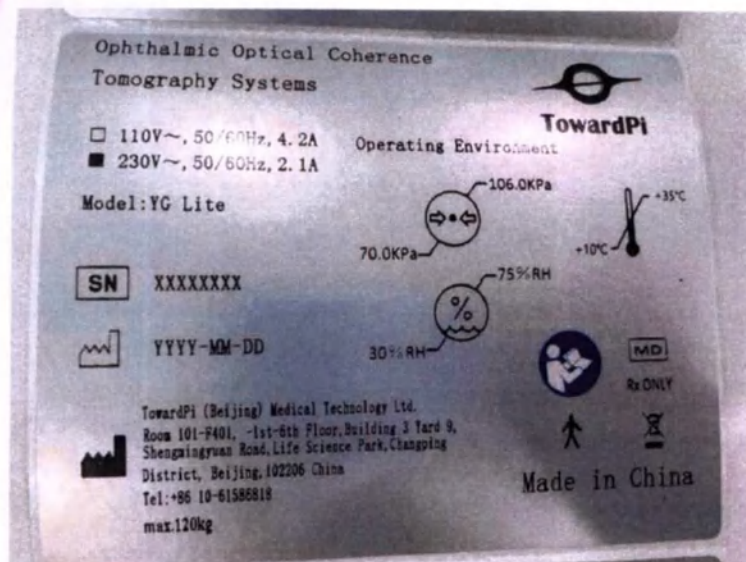

Блок основной для TowardPi YG-100K NF

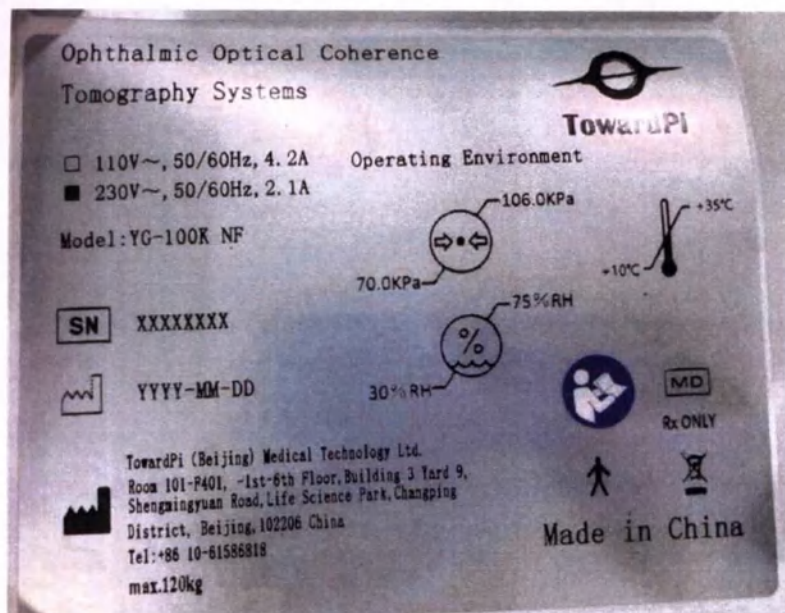

 TowardPi	РЭ производителя на МИ Extract from the manufacturer's technical documentation for MI	Номер документа: RU-2024/03/TowardPi/IFU Document Number: RU-2024/03/TowardPi/IFU	
Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi Optical coherence tomography system of the eye TowardPi		Версия: 1 Version: 1	Страница: 1 из Page: 1 of
Производитель: Manufacturer: TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd. (ТоуардПи (Пекин) Медикал Технологджи Лтд.)	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью "Тринити Медикал Системс" Authorized representative in the Russian Federation: Limited Liability Company "Trinity Medical Systems"	Дата выпуска: 2024-03 Date of issue: 2024-03	

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi

(Настоящая выписка подготовлена для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416)

Производитель:
TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd.

2024


Чехол пылезащитный для всех вариантов исполнения




Кабель электропитания для всех вариантов исполнения




Блок обработки данных (компьютер PC02) для TowardPi BM-400K MAX, TowardPi BM-400K, TowardPi BM Lite, TowardPi BM-400K NF

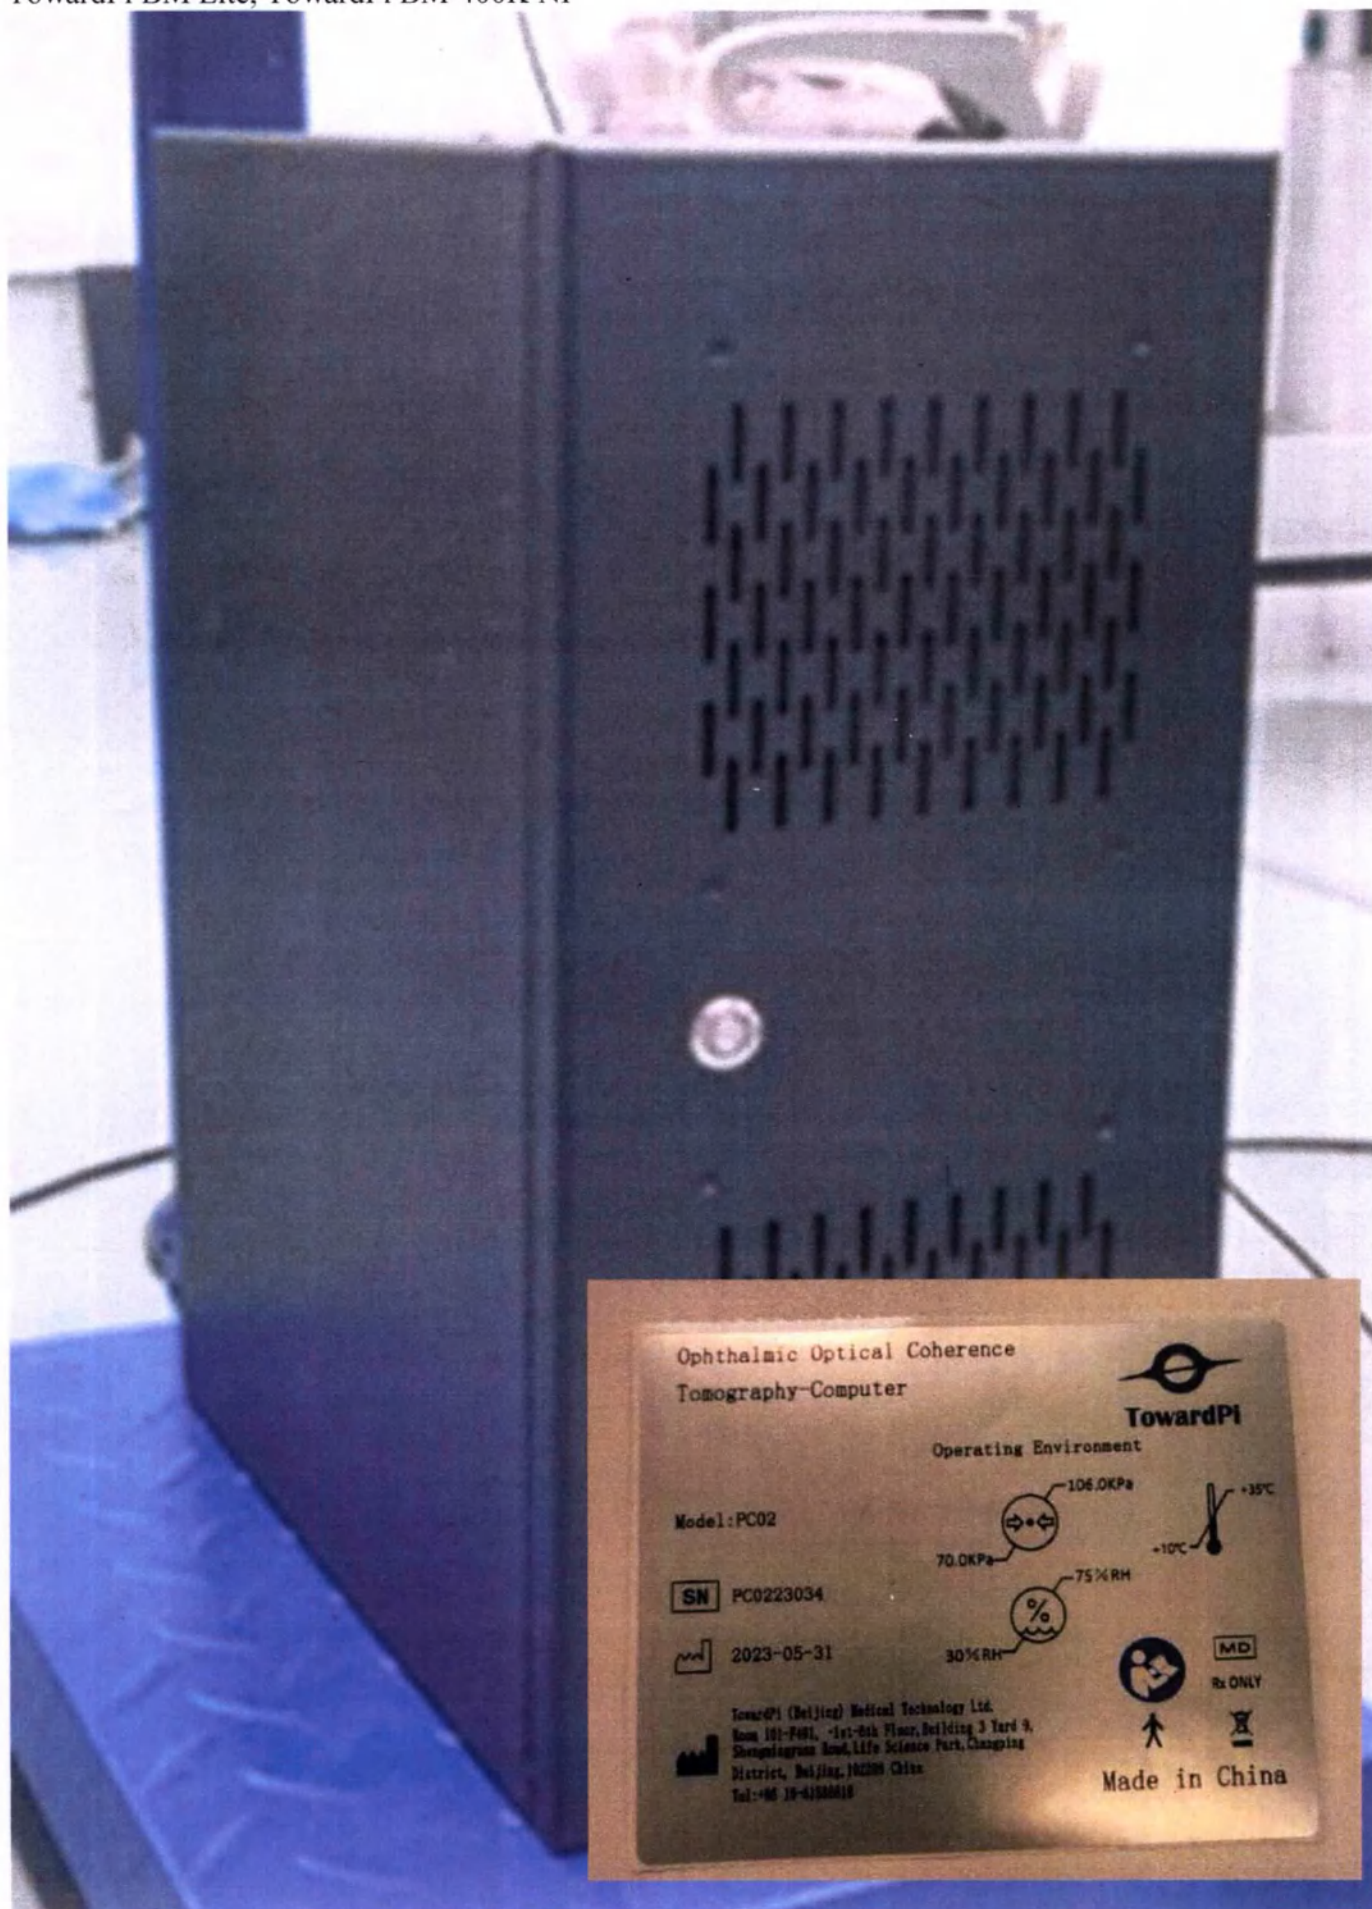

Блок обработки данных (компьютер PC01) для TowardPi YG-100K MAX, TowardPi YG-100K PRO, TowardPi YG Lite, TowardPi YG-100K NF

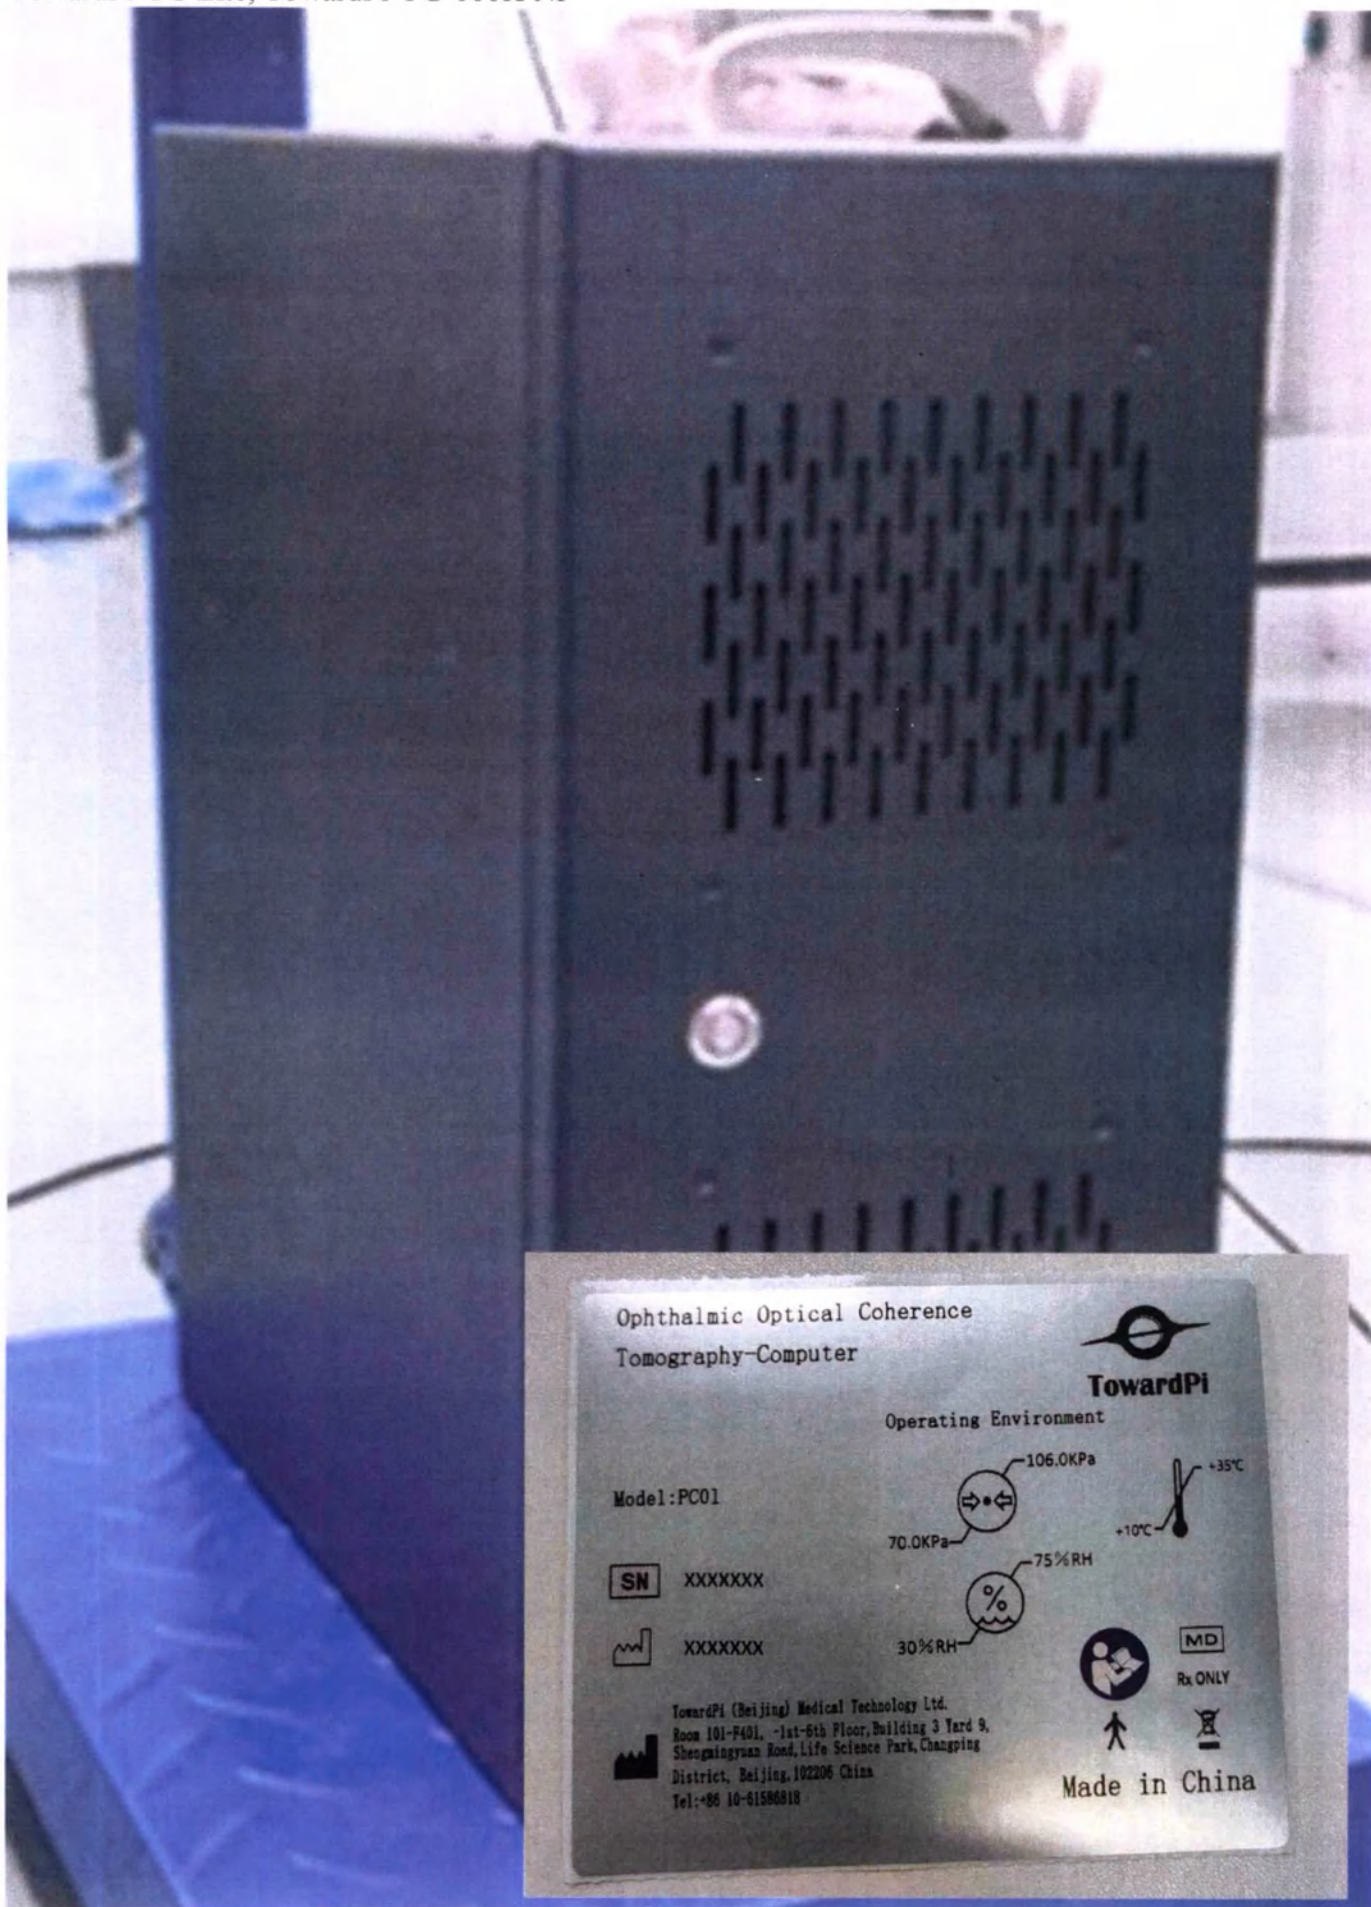

Трансформатор напряжения электросети (IT04) с комплектом крепежных болтов (ØМ8 х40мм, 6 шт.) для всех вариантов исполнения

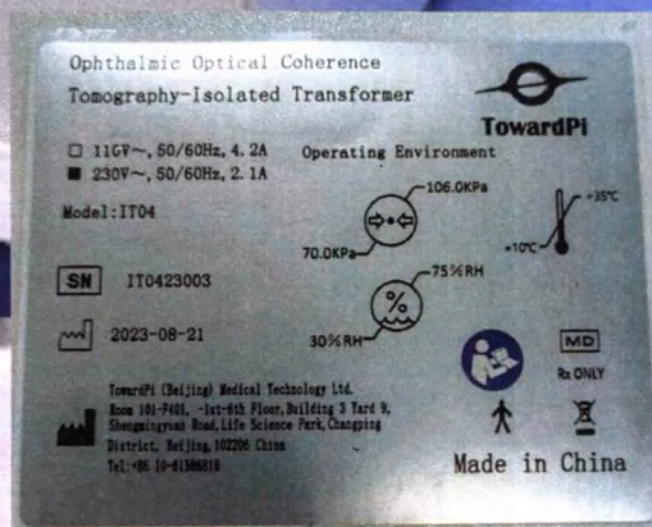

комплект крепежных болтов (ØM8x40мм, 6 шт.) для всех вариантов исполнения



Стол электроподъемный (MT01) для размещения основного блока, трансформатора и компьютера для всех вариантов исполнения



Ophthalmic Optical Coherence
Tomography-System Table

TowardPi

Operating Environment

Model: MT01

SN MT0123034

2023-07-15

106.0KPa
70.0KPa
75%RH
30%RH


+35°C
+10°C

MD
Rx ONLY

Made in China

TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd.
Room 101-F401, -1st-6th Floor, Building 3 Yard 9,
Shengguangyuan Road, Life Science Park, Changping
District, Beijing, 102206 China
Tel: +86 10-61588818

Насадка для сканирования переднего сегмента глаза (AS02) для TowardPi BM-400K MAX, TowardPi BM-400K, TowardPi BM Lite, TowardPi BM-400K NF

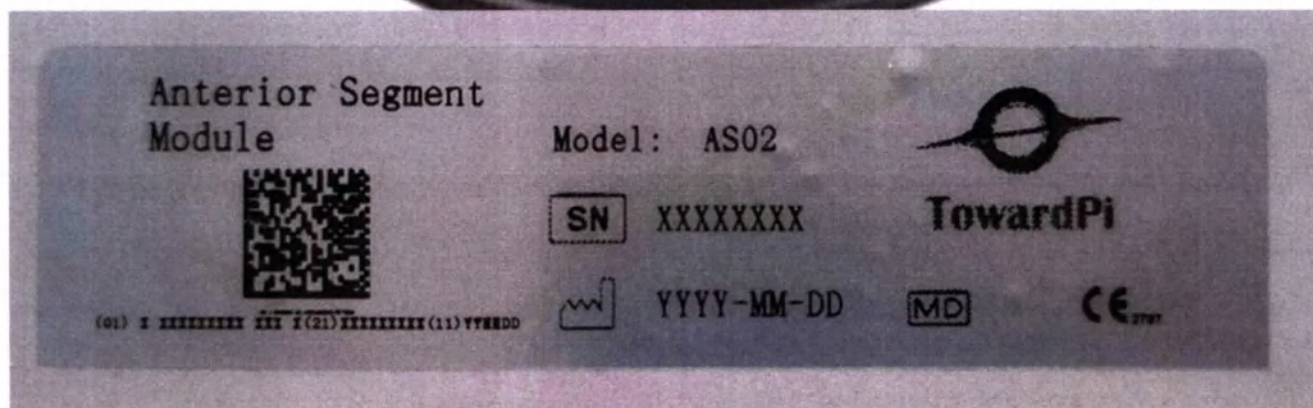

Насадка для сканирования переднего сегмента глаза (AS01) для TowardPi YG-100K MAX, TowardPi YG-100K PRO, TowardPi YG Lite, TowardPi YG-100K NF.



Anterior Segment
Module

Model: AS01



TowardPi



XXXXXXXX



YYYY-MM-DD



(01) X XXXXXXXX XXX X(21)XXXXXXXX(11)TVHDD

Предохранитель, 15 А для всех вариантов исполнения



Предохранитель, 25 А для всех вариантов исполнения



Предохранитель, 3 А для всех вариантов исполнения




Салфетки бумажные одноразовые для всех вариантов исполнения




Индивидуальная маркировка МИ


1. Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi BM-400K MAX:

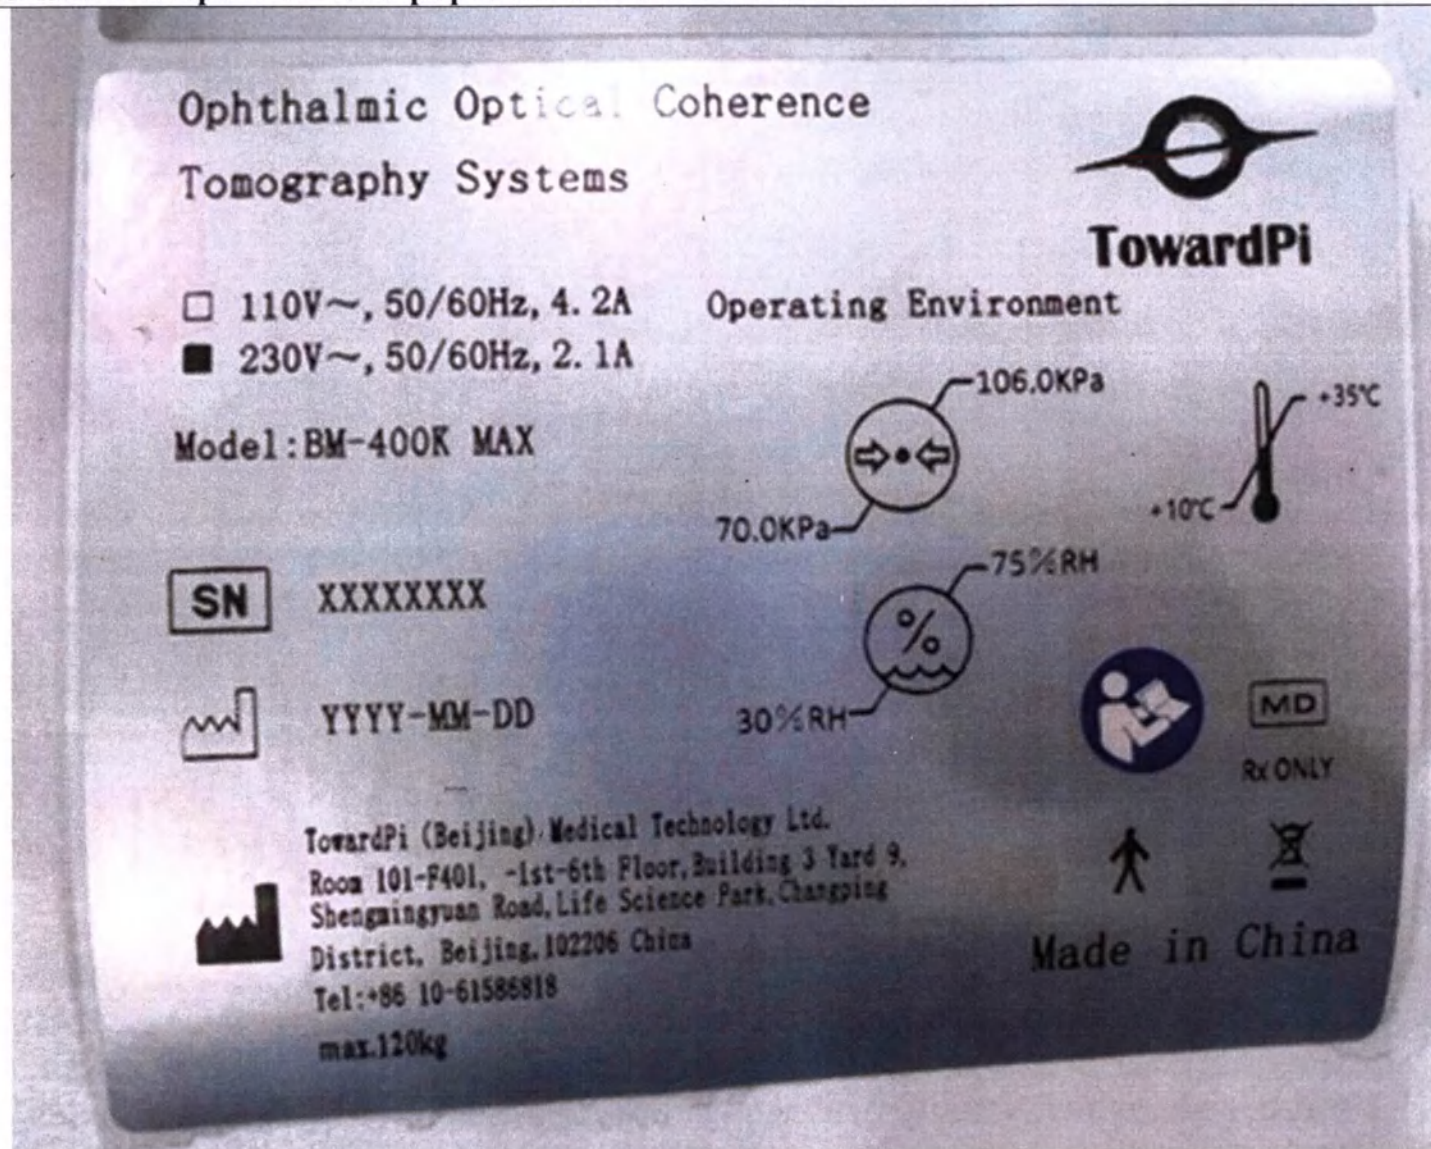


2. Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi BM-400K:

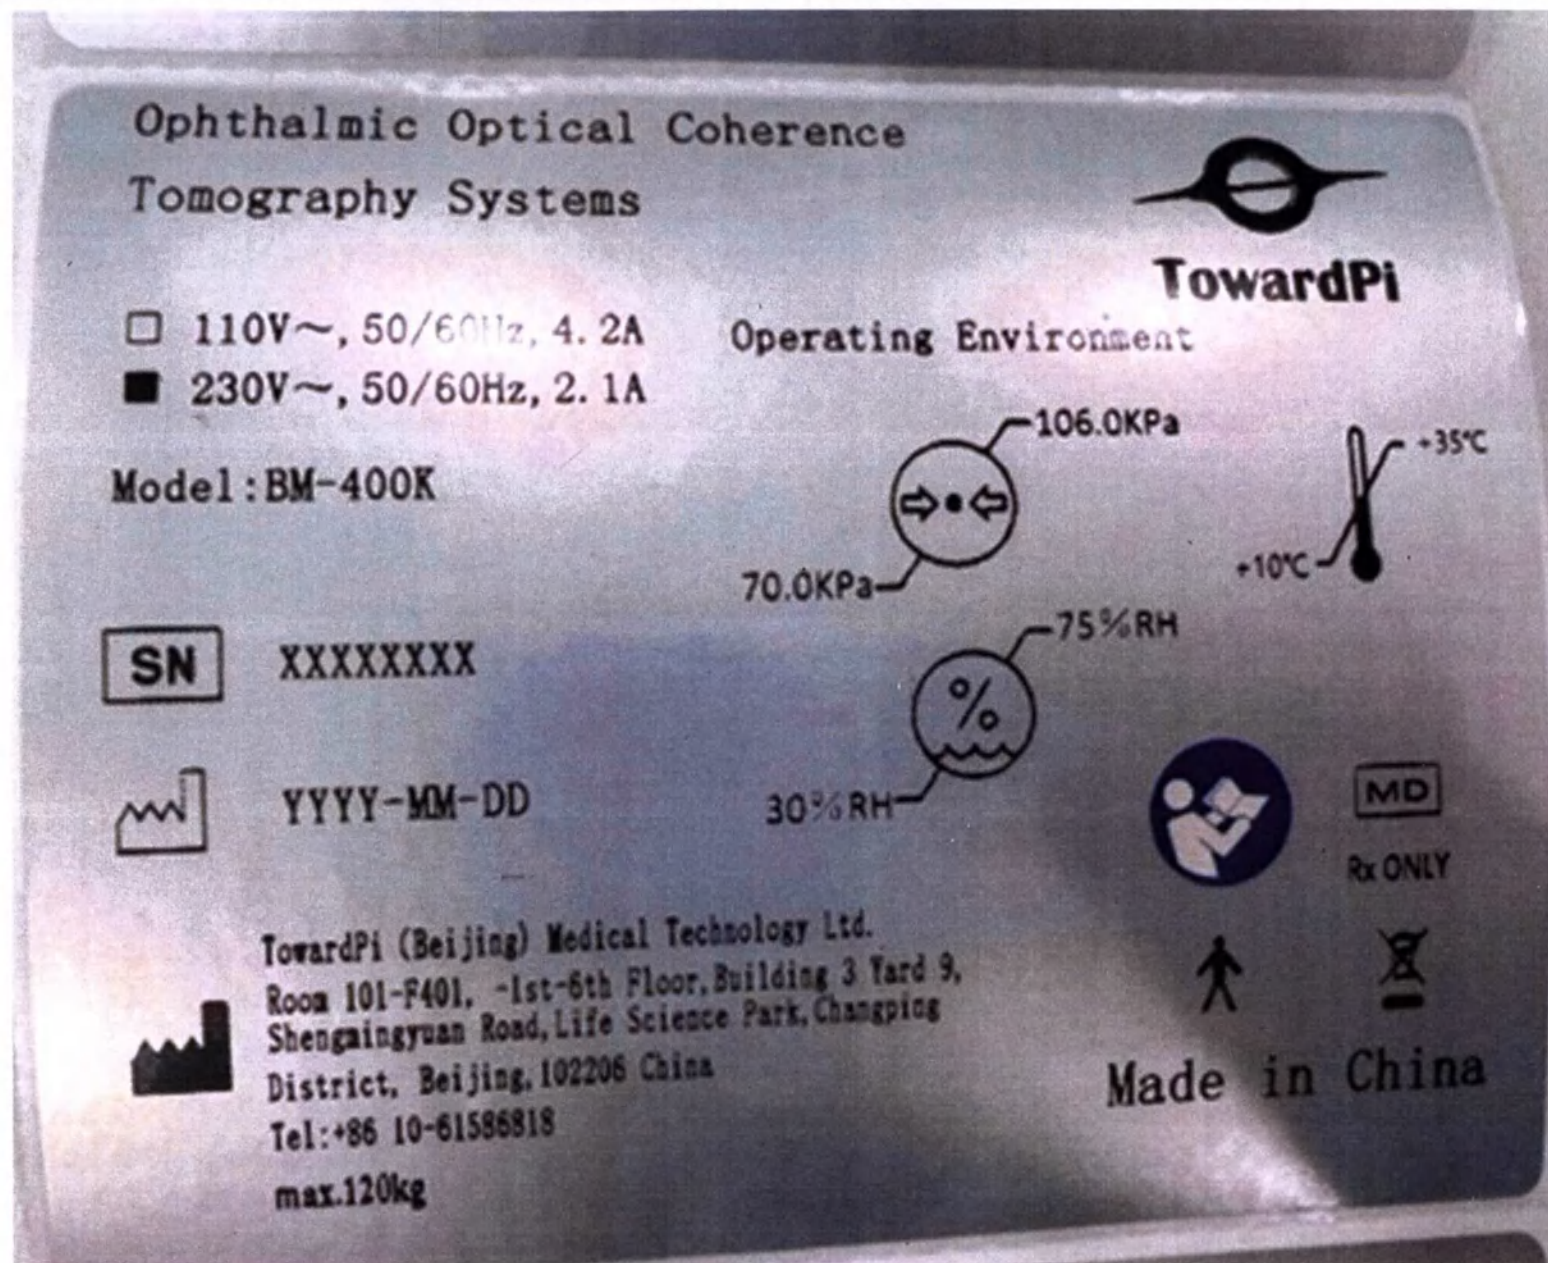


3. Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi BM Lite:

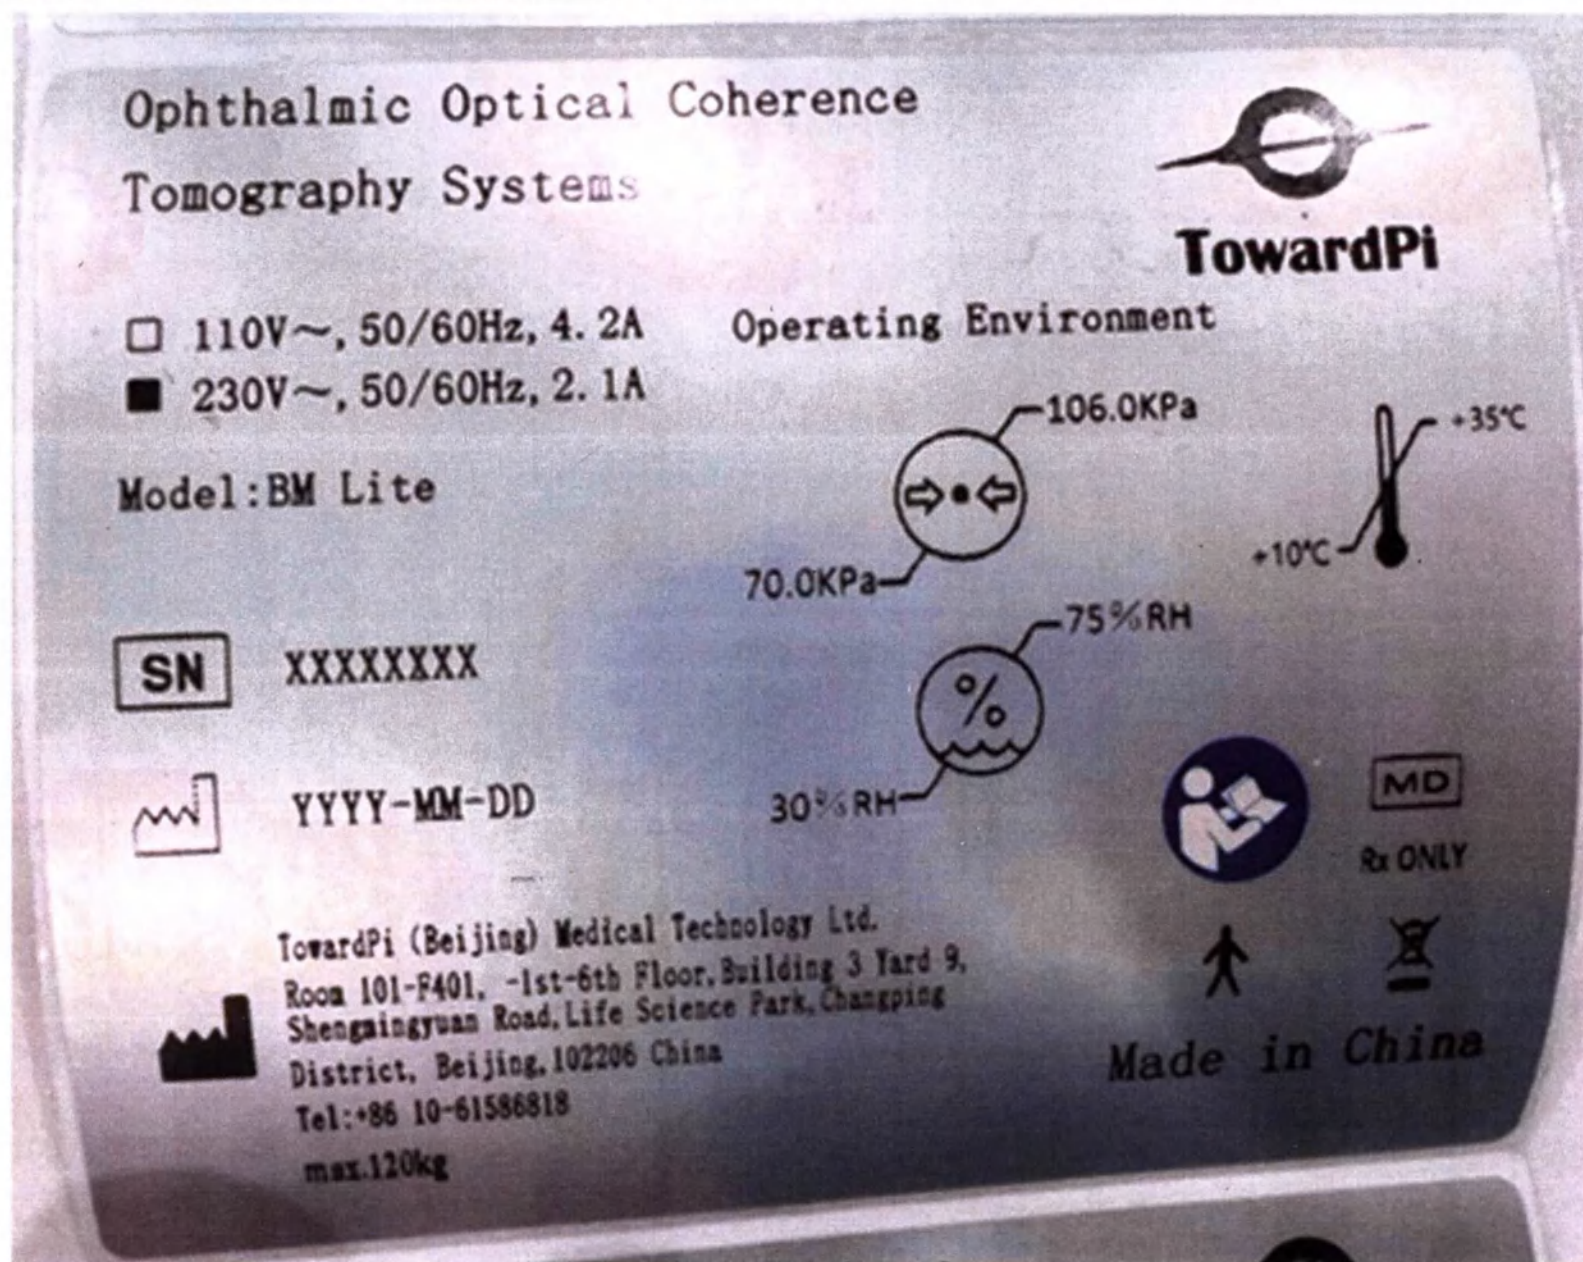


4. Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi BM-400K NF:

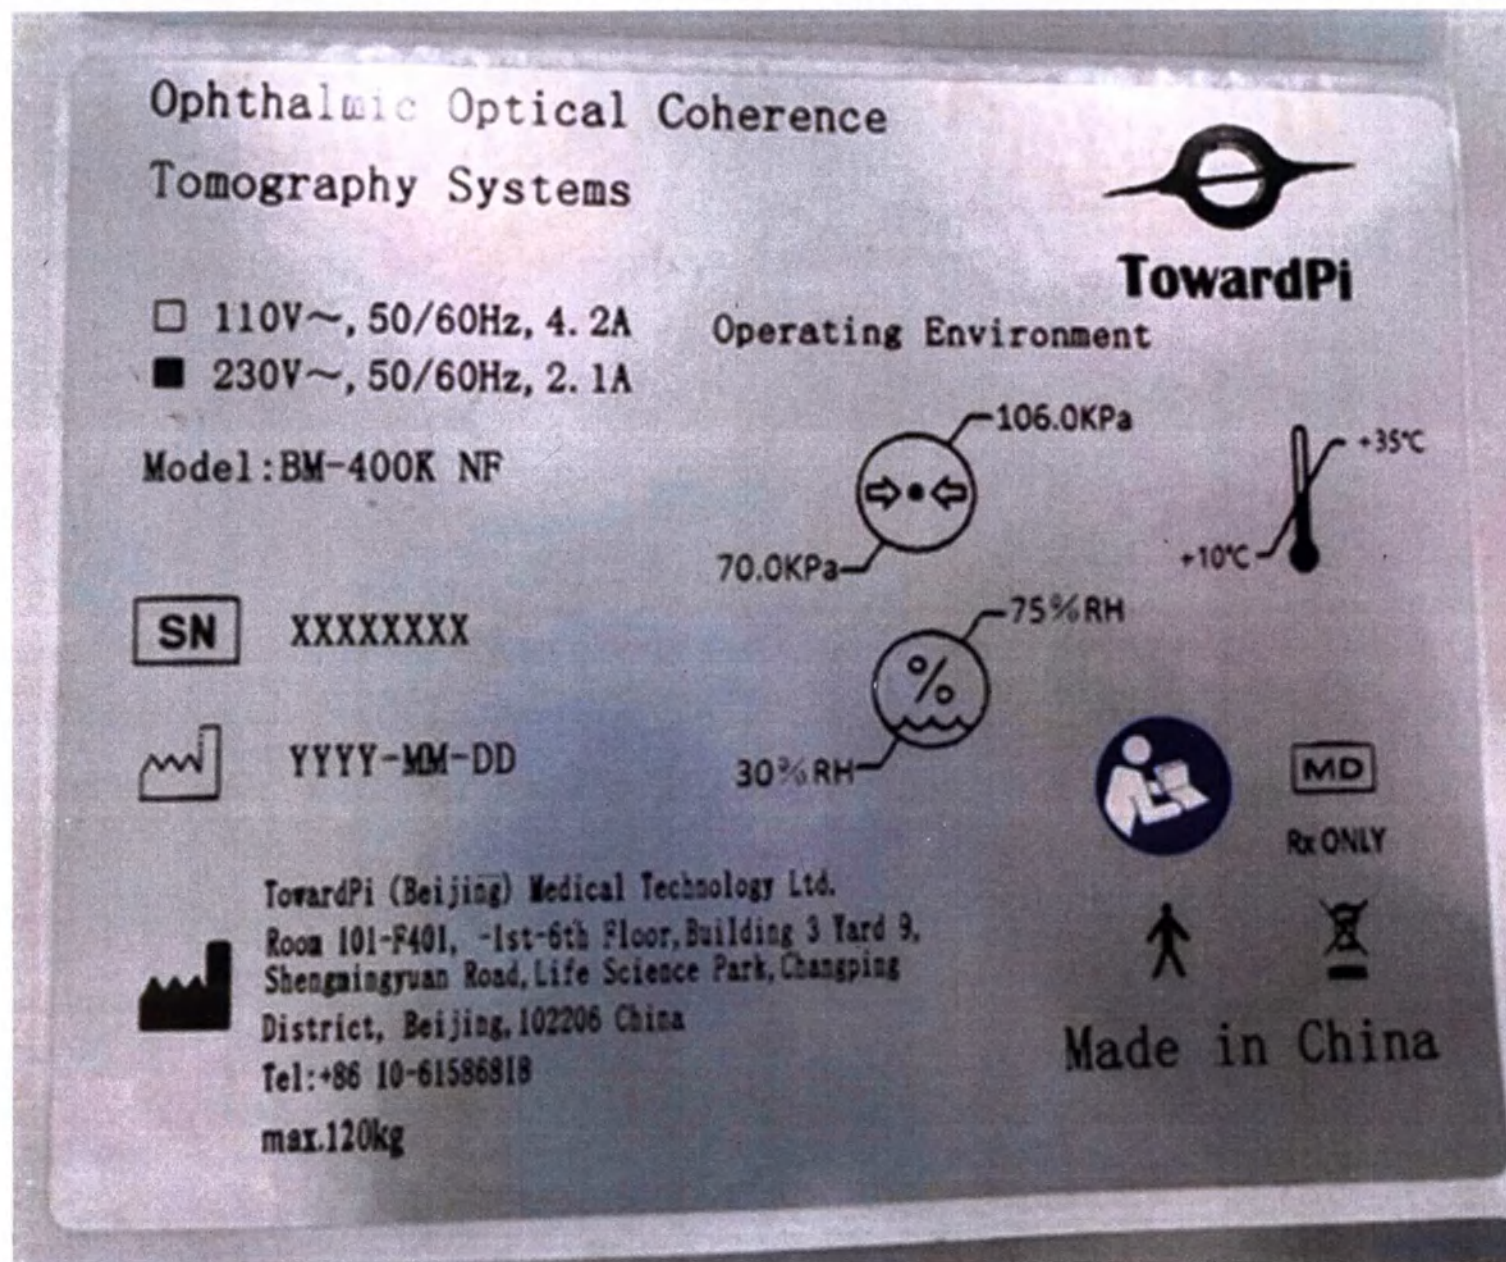


5. Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi YG-100K MAX:

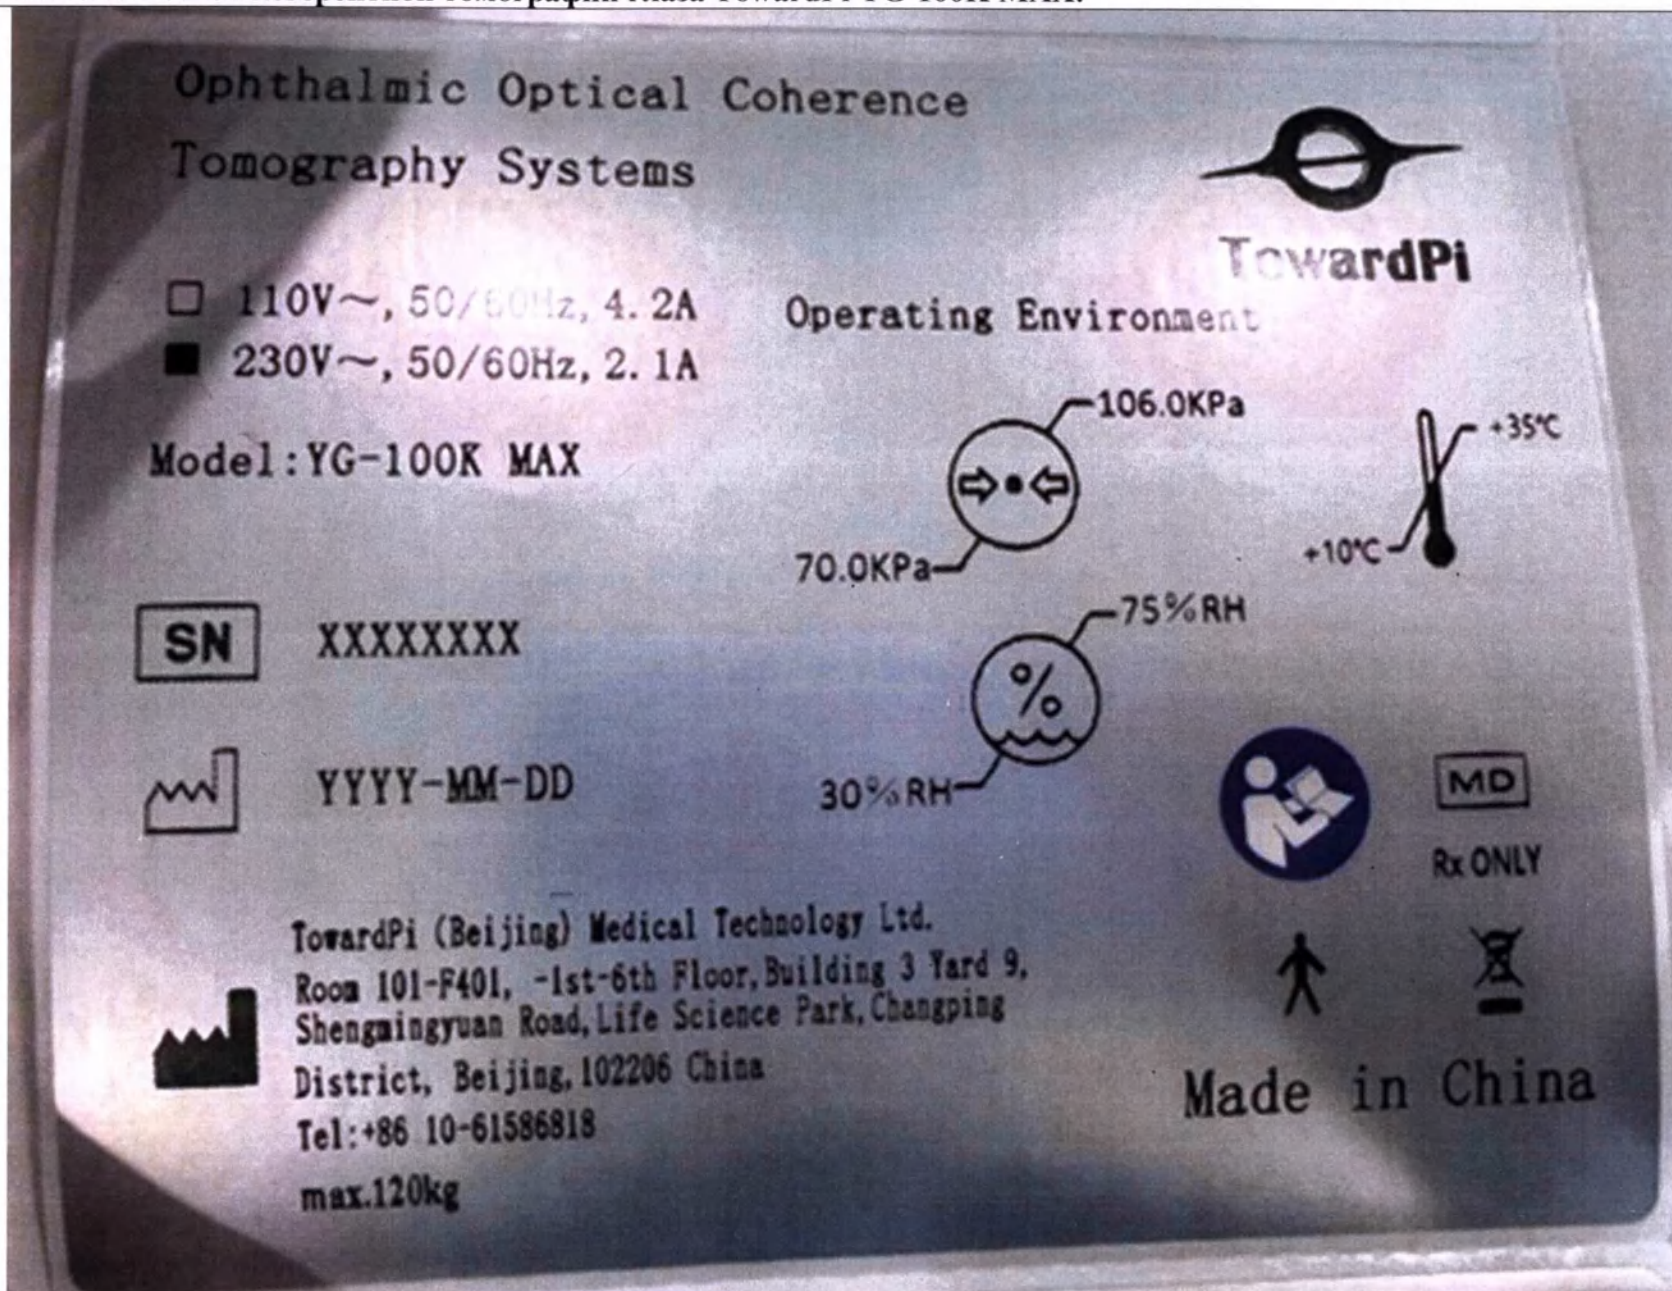


6. Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi YG-100K PRO:

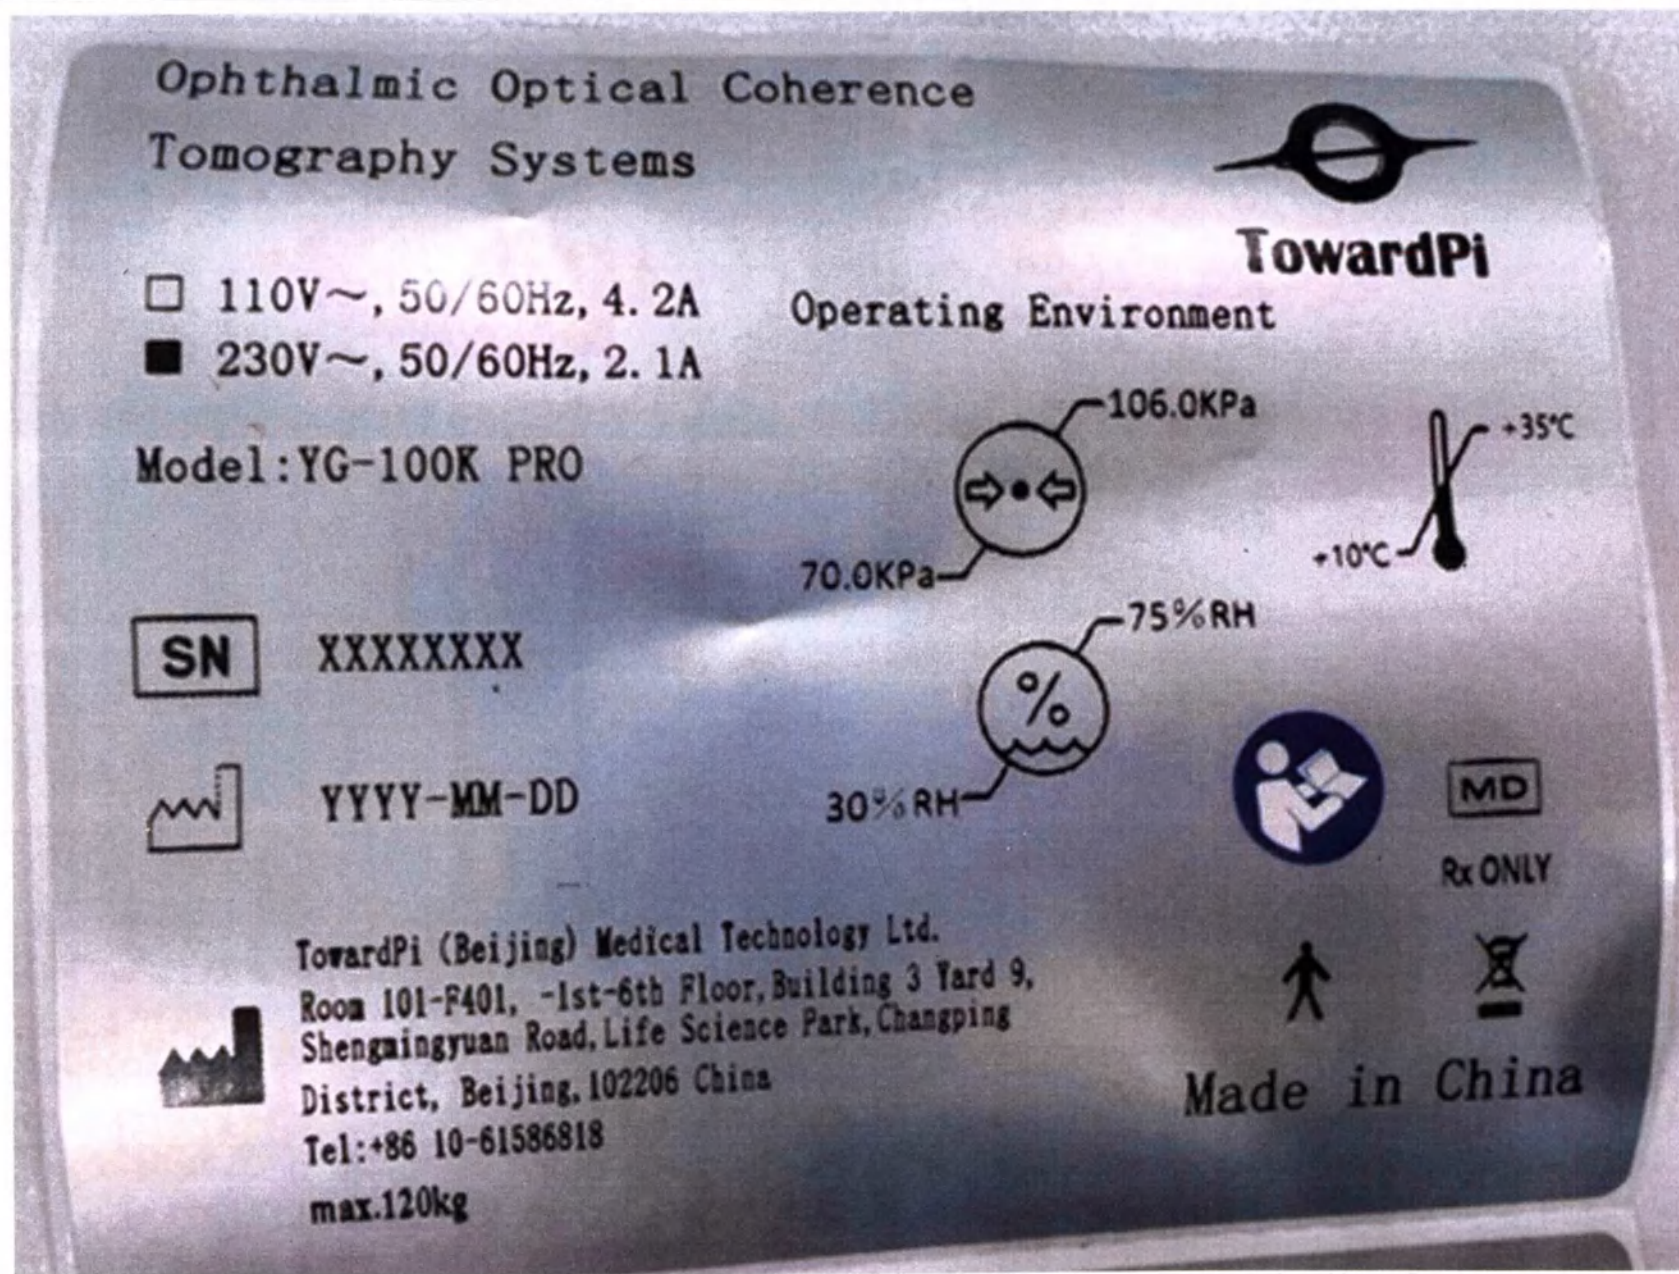

7. Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi YG Lite:

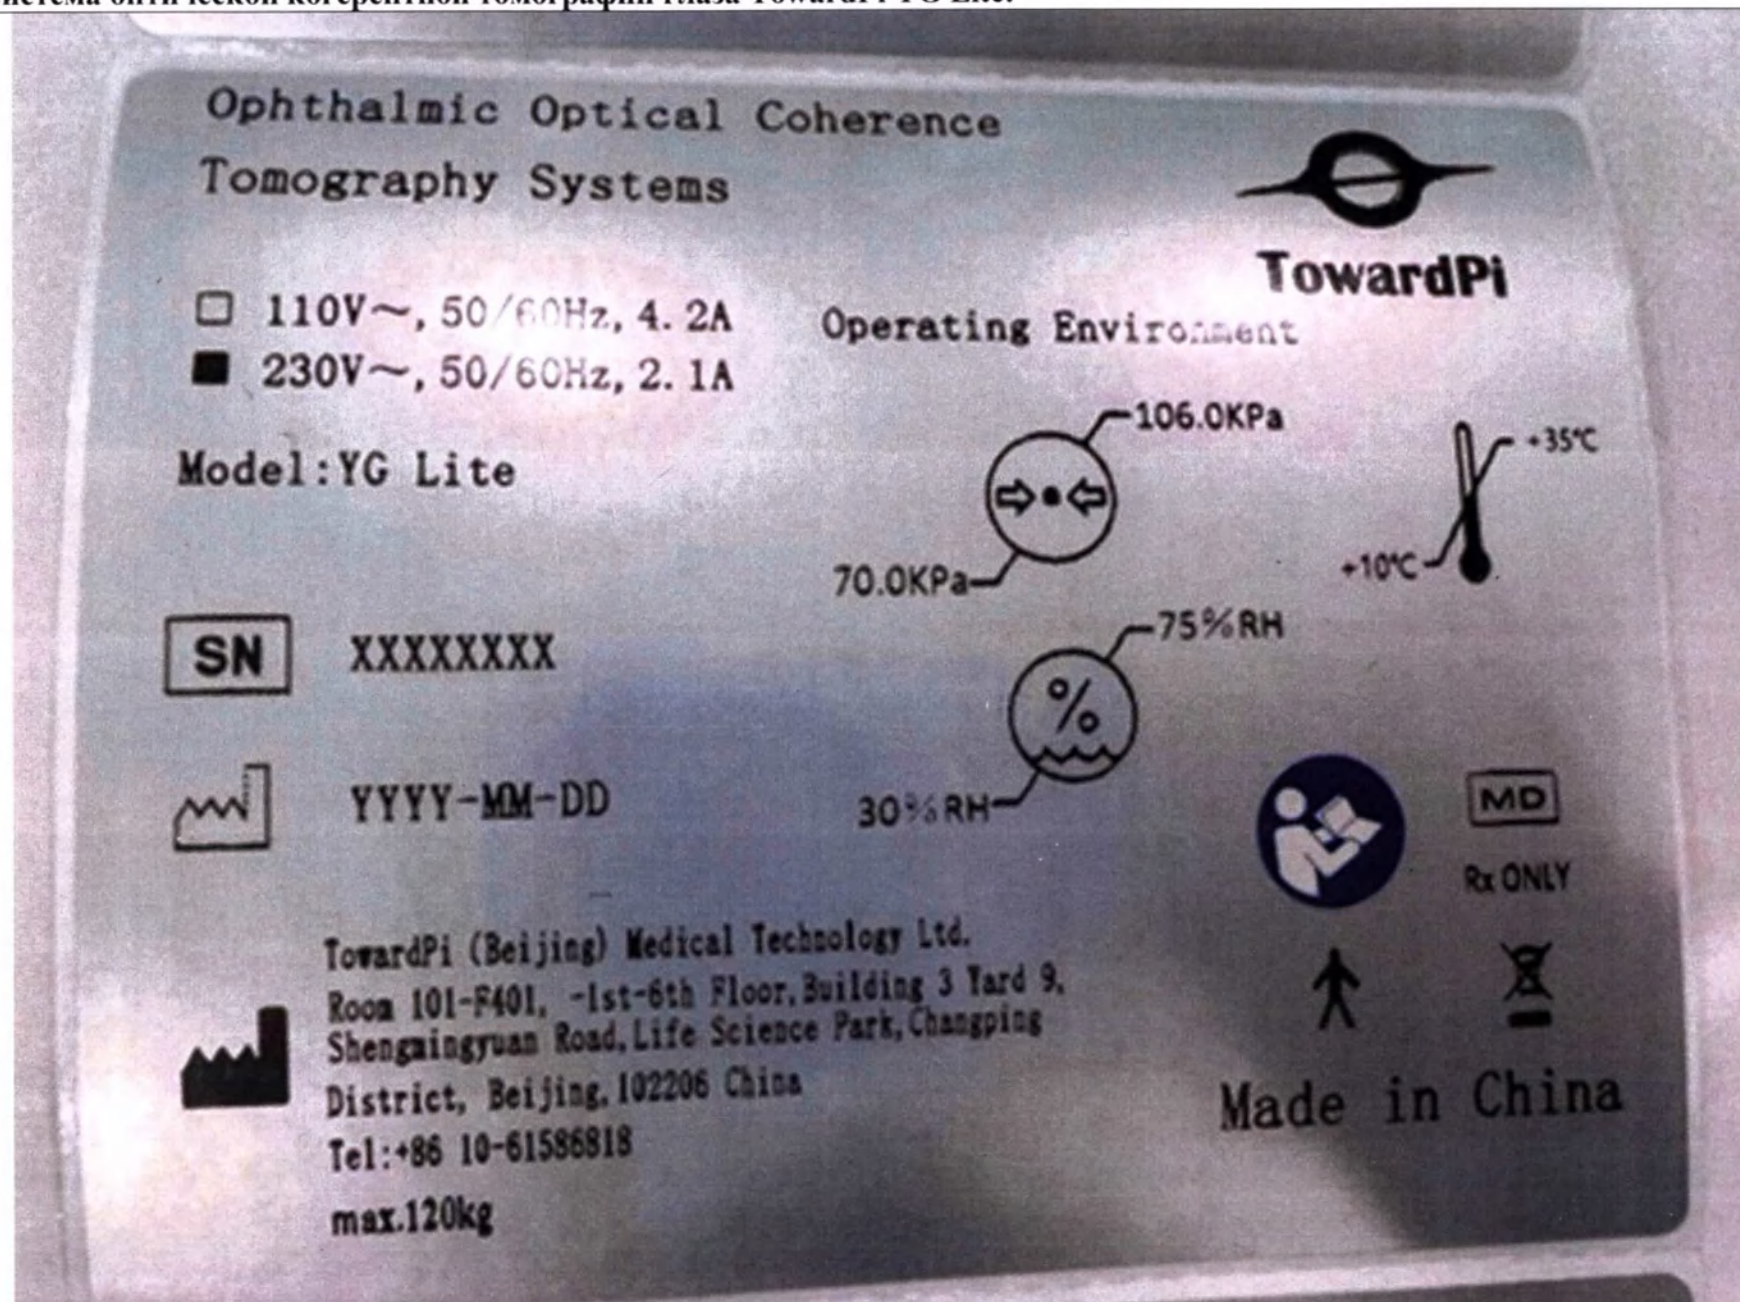

8. Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi YG-100K NF:

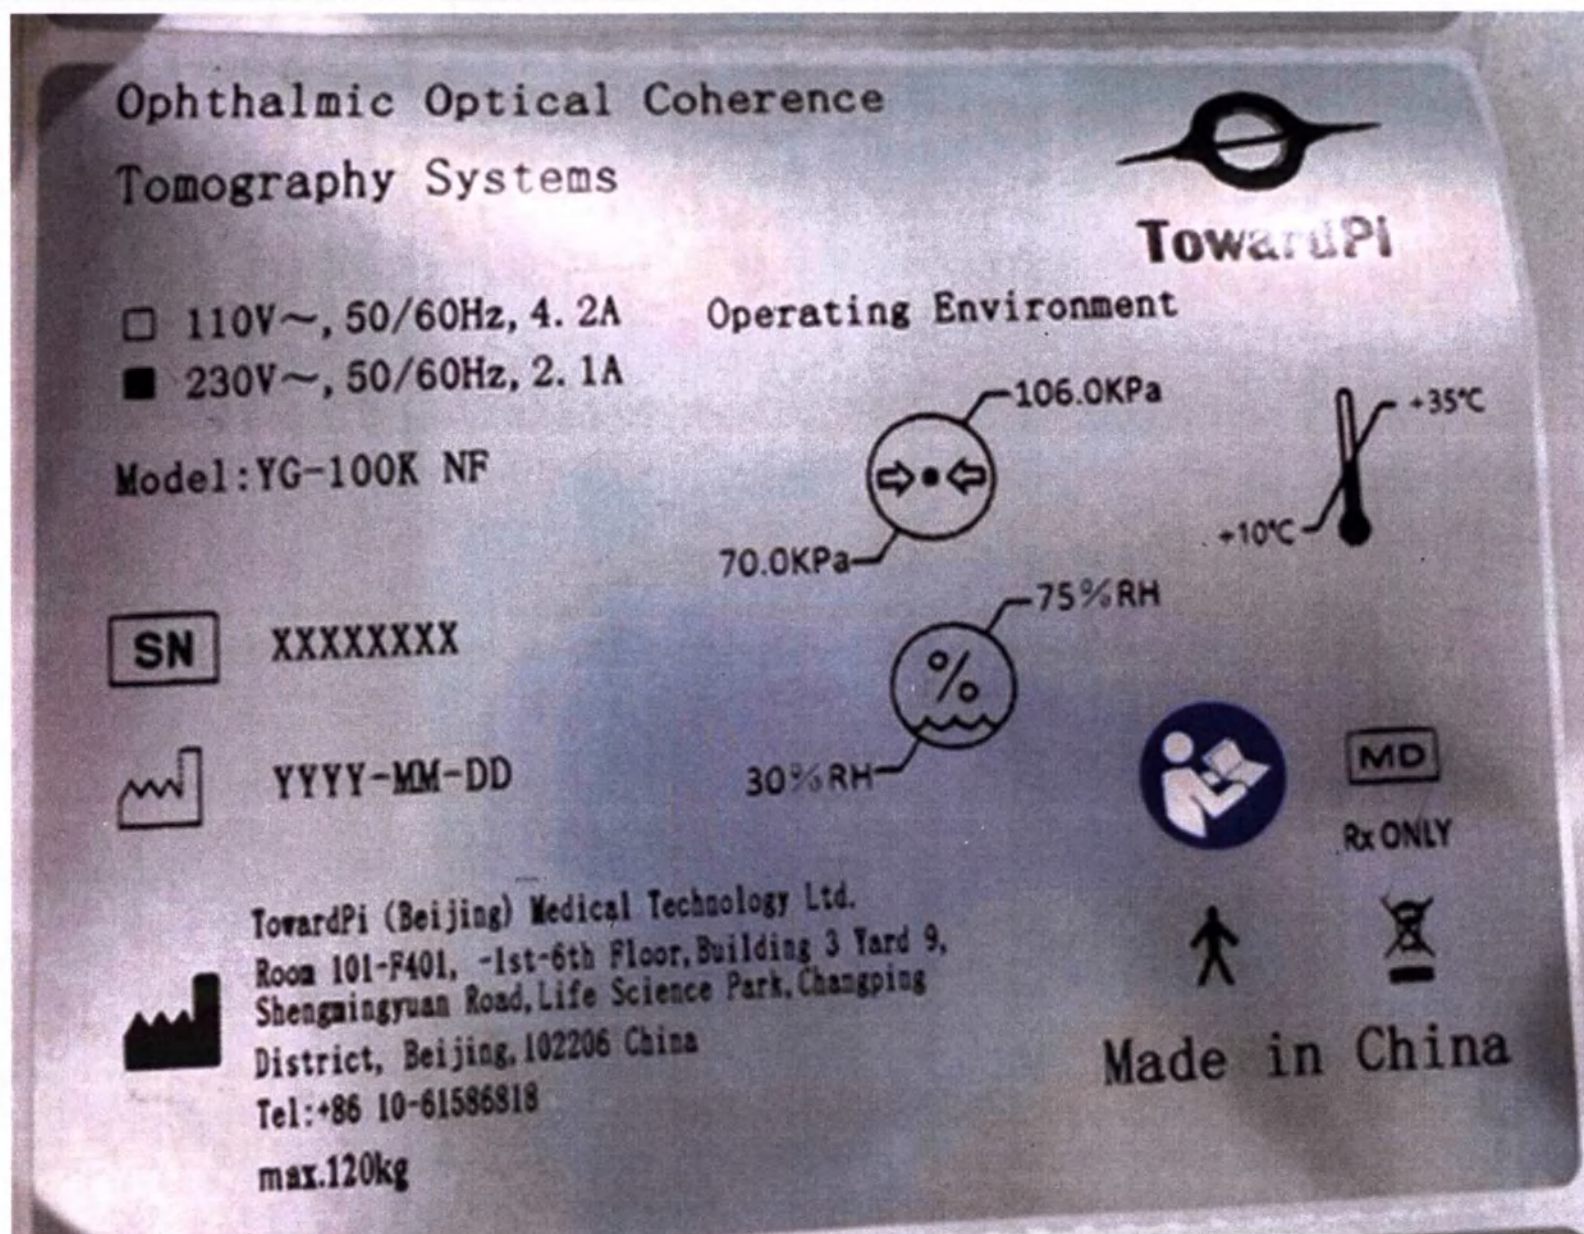

Маркировка будет представлена в форме русскоязычных стикеров, содержащих дополнительную информацию в соответствии с законодательством России.

Маркировка будет нанесена рядом с маркировкой производителя не перекрывая её.

Варианты исполнения:

- а) Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi BM-400K MAX:

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi BM-400K MAX	
Производитель:  TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd. (ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи Лтд.) Room 101-F401, -1st-6st Floor, Building 3, Yard 9, Shengmingyuan Road., Life Science Park, Changping District, Beijing, 102206, China 	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Тринити Медикал Системс» ООО «ТМС» ИНН: 7733856412 109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр. 1, помещ. 1, ком. 8 (этаж 5) Телефон: +7 (495) 182-20-98 info@trinityms.ru
IPX0	Срок службы: 8 лет
Напряжение электропитания	110; 230 В переменного тока
Частота электропитания	50/60 Гц
Потребляемая мощность	4,2 А при 110 В; 2,1 А при 230 В
Режим работы	продолжительный
Максимально допустимое время установления рабочего режима, исчисляемое с момента включения изделия, мин	1
Классификация в зависимости от типа и степени защиты от поражения электрическим током	изделие класса I
Предохранитель	☐ T3.15AL250V P – 2 шт. ☐ T6.3AL250V P – 2 шт. ☐ T1.25AL250V P – 2 шт.
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от +10°C до +35 °C
Относительная влажность воздуха	от 30 до 75%, без конденсации
Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Условия транспортирования и хранения	
Температура окружающей среды от	от –20°C до +55°C
Относительная влажность воздуха	от 10% до 90%, без конденсации

Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Регистрационное удостоверение № _____ от _____	

б) Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi BM-400K:

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi BM-400K	
Производитель:  TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd. (ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи Лтд.) Room 101-F401, -1st-6st Floor, Building 3, Yard 9, Shengmingyuan Road., Life Science Park, Changping District, Beijing, 102206, China 	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Тринити Медикал Системс» ООО «ТМС» ИНН: 7733856412 109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Николаямская, д. 40, стр. 1, помещ. I, ком. 8 (этаж 5) Телефон: +7 (495) 182-20-98 info@trinityms.ru
IPX0	Срок службы: 8 лет
Напряжение электропитания	110; 230 В переменного тока
Частота электропитания	50/60 Гц
Потребляемая мощность	4,2 А при 110 В; 2,1 А при 230 В
Режим работы	продолжительный
Максимально допустимое время установления рабочего режима, исчисляемое с момента включения изделия, мин	1
Классификация в зависимости от типа и степени защиты от поражения электрическим током	изделие класса I
Предохранитель	☐ T3.15AL250V P – 2 шт. ☐ T6.3AL250V P – 2 шт. ☐ T1.25AL250V P – 2 шт.
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от +10°C до +35 °C
Относительная влажность воздуха	от 30 до 75%, без конденсации
Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Условия транспортирования и хранения	
Температура окружающей среды от	от –20°C до +55°C
Относительная влажность воздуха	от 10% до 90%, без конденсации
Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Регистрационное удостоверение № _____ от _____	

с) Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi BM Lite:

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi BM-400K Lite

Производитель:



TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd.
(ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи
Лтд.) Room 101-F401, -1st-6st Floor,
Building 3, Yard 9, Shengmingyuan Road.,
Life Science Park, Changping District,
Beijing, 102206, China



Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью
«Тринити Медикал Системс»

ООО «ТМС»

ИНН: 7733856412

109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Таганский, ул. Николаямская, д. 40, стр.
1, помещ. I, ком. 8 (этаж 5)

Телефон: +7 (495) 182-20-98

info@trinityms.ru

IPX0

Срок службы: 8 лет

Напряжение электропитания

110; 230 В переменного тока

Частота электропитания

50/60 Гц

Потребляемая мощность

4,2 А при 110 В; 2,1 А при 230 В

Режим работы

продолжительный

Максимально допустимое время
установления рабочего режима,
исчисляемое с момента включения
изделия, мин

1

Классификация в зависимости от типа и
степени защиты от поражения
электрическим током

изделие класса I

Предохранитель

☐ T3.15AL250V P – 2 шт.

☐ T6.3AL250V P – 2 шт.

☐ T1.25AL250V P – 2 шт.

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

от +10°C до +35 °C

Относительная влажность воздуха

от 30 до 75%, без конденсации

Давление окружающей среды

700-1060 гПа

Условия транспортирования и хранения

Температура окружающей среды от

от –20°C до +55°C

Относительная влажность воздуха

от 10% до 90%, без конденсации

Давление окружающей среды

700-1060 гПа

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

d) Система оптической когерентной томографии глаза BM-400K NF:

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi BM-400K NF

Производитель:

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью
«Тринити Медикал Системс»

 TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd. (ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи Лтд.) Room 101-F401, -1st-6st Floor, Building 3, Yard 9, Shengmingyuan Road., Life Science Park, Changping District, Beijing, 102206, China 	ООО «ТМС» ИНН: 7733856412 109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр. 1, помещ. I, ком. 8 (этаж 5) Телефон: +7 (495) 182-20-98 info@trinityms.ru
IPX0	Срок службы: 8 лет
Напряжение электропитания	110; 230 В переменного тока
Частота электропитания	50/60 Гц
Потребляемая мощность	4,2 А при 110 В; 2,1 А при 230 В
Режим работы	продолжительный
Максимально допустимое время установления рабочего режима, исчисляемое с момента включения изделия, мин	1
Классификация в зависимости от типа и степени защиты от поражения электрическим током	изделие класса I
Предохранитель	☐ T3.15AL250V P – 2 шт. ☐ T6.3AL250V P – 2 шт. ☐ T1.25AL250V P – 2 шт.
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от +10°C до +35 °C
Относительная влажность воздуха	от 30 до 75%, без конденсации
Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Условия транспортирования и хранения	
Температура окружающей среды от	от –20°C до +55°C
Относительная влажность воздуха	от 10% до 90%, без конденсации
Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Регистрационное удостоверение № _____ от _____	

е) Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi YG-100K MAX:

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi YG-100K MAX	
Производитель:  TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd. (ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Тринити Медикал Системс» ООО «ТМС» ИНН: 7733856412 109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр.

Лтд.) Room 101-F401, -1st-6st Floor, Building 3, Yard 9, Shengmingyuan Road., Life Science Park, Changping District, Beijing, 102206, China		1, помещ. I, ком. 8 (этаж 5) Телефон: +7 (495) 182-20-98 info@trinityms.ru	
			
IPX0		Срок службы: 8 лет	
Напряжение электропитания		110; 230 В переменного тока	
Частота электропитания		50/60 Гц	
Потребляемая мощность		4,2 А при 110 В; 2,1 А при 230 В	
Режим работы		продолжительный	
Максимально допустимое время установления рабочего режима, исчисляемое с момента включения изделия, мин		1	
Классификация в зависимости от типа и степени защиты от поражения электрическим током		изделие класса I	
Предохранитель		☐ T3.15AL250V P – 2 шт. ☐ T6.3AL250V P – 2 шт. ☐ T1.25AL250V P – 2 шт.	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды		от +10°C до +35 °C	
Относительная влажность воздуха		от 30 до 75%, без конденсации	
Давление окружающей среды		700-1060 гПа	
Условия транспортирования и хранения			
Температура окружающей среды от		от –20°C до +55°C	
Относительная влажность воздуха		от 10% до 90%, без конденсации	
Давление окружающей среды		700-1060 гПа	
Регистрационное удостоверение № _____ от _____			

- f) Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi YG-100K PRO:
YG-100K MAX

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi YG-100K PRO	
Производитель:  TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd. (ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи Лтд.) Room 101-F401, -1st-6st Floor, Building 3, Yard 9, Shengmingyuan Road., Life Science Park, Changping District, Beijing, 102206, China	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Тринити Медикал Системс» ООО «ТМС» ИНН: 7733856412 109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр. 1, помещ. I, ком. 8 (этаж 5) Телефон: +7 (495) 182-20-98 info@trinityms.ru

	
IPX0	Срок службы: 8 лет
Напряжение электропитания	110; 230 В переменного тока
Частота электропитания	50/60 Гц
Потребляемая мощность	4,2 А при 110 В; 2,1 А при 230 В
Режим работы	продолжительный
Максимально допустимое время установления рабочего режима, исчисляемое с момента включения изделия, мин	1
Классификация в зависимости от типа и степени защиты от поражения электрическим током	изделие класса I
Предохранитель	☐ T3.15AL250V P – 2 шт. ☐ T6.3AL250V P – 2 шт. ☐ T1.25AL250V P – 2 шт.
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от +10°C до +35 °C
Относительная влажность воздуха	от 30 до 75%, без конденсации
Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Условия транспортирования и хранения	
Температура окружающей среды от	от –20°C до +55°C
Относительная влажность воздуха	от 10% до 90%, без конденсации
Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Регистрационное удостоверение № _____ от _____	

g) Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi YG Lite:

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi YG Lite	
Производитель:  TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd. (ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи Лтд.) Room 101-F401, -1st-6st Floor, Building 3, Yard 9, Shengmingyuan Road., Life Science Park, Changping District, Beijing, 102206, China 	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Тринити Медикал Системс» ООО «ТМС» ИНН: 7733856412 109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Николоямская, д. 40, стр. 1, помещ. I, ком. 8 (этаж 5) Телефон: +7 (495) 182-20-98 info@trinityms.ru
IPX0	Срок службы: 8 лет
Напряжение электропитания	110; 230 В переменного тока

Частота электропитания	50/60 Гц
Потребляемая мощность	4,2 А при 110 В; 2,1 А при 230 В
Режим работы	продолжительный
Максимально допустимое время установления рабочего режима, исчисляемое с момента включения изделия, мин	1
Классификация в зависимости от типа и степени защиты от поражения электрическим током	изделие класса I
Предохранитель	☐ T3.15AL250V P – 2 шт. ☐ T6.3AL250V P – 2 шт. ☐ T1.25AL250V P – 2 шт.
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от +10°C до +35 °C
Относительная влажность воздуха	от 30 до 75%, без конденсации
Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Условия транспортирования и хранения	
Температура окружающей среды от	от –20°C до +55°C
Относительная влажность воздуха	от 10% до 90%, без конденсации
Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Регистрационное удостоверение № _____ от _____	

h) Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi YG-100K NF

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi YG-100K NF	
Производитель:  TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd. (ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи Лтд.) Room 101-F401, -1st-6st Floor, Building 3, Yard 9, Shengmingyuan Road., Life Science Park, Changping District, Beijing, 102206, China 	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Тринити Медикал Системс» ООО «ТМС» ИНН: 7733856412 109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр. 1, помещ. I, ком. 8 (этаж 5) Телефон: +7 (495) 182-20-98 info@trinityms.ru
IPX0	Срок службы: 8 лет
Напряжение электропитания	110; 230 В переменного тока
Частота электропитания	50/60 Гц
Потребляемая мощность	4,2 А при 110 В; 2,1 А при 230 В
Режим работы	продолжительный
Максимально допустимое время установления рабочего режима,	1

исчисляемое с момента включения изделия, мин	
Классификация в зависимости от типа и степени защиты от поражения электрическим током	
Предохранитель	☐ T3.15AL250V P – 2 шт. ☐ T6.3AL250V P – 2 шт. ☐ T1.25AL250V P – 2 шт.
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от +10°C до +35 °C
Относительная влажность воздуха	от 30 до 75%, без конденсации
Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Условия транспортирования и хранения	
Температура окружающей среды от	от –20°C до +55°C
Относительная влажность воздуха	от 10% до 90%, без конденсации
Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Регистрационное удостоверение № _____ от _____	

Маркировка компонентов изделий производителя для РФ (дополнительная), входящих в состав вариантов исполнения медицинского изделия

Блок обработки данных (компьютер PC02) для TowardPi BM-400K MAX, TowardPi BM-400K, TowardPi BM Lite, TowardPi BM-400K NF

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi

Блок обработки данных (компьютер PC02) для TowardPi BM-400K MAX, TowardPi BM-400K, TowardPi BM Lite, TowardPi BM-400K NF



TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd.

(ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи Лтд.) Room 101-F401, -1st-6st Floor, Building 3, Yard 9, Shengmingyuan Road., Life Science Park, Changping District, Beijing, 102206, China

Классификация в зависимости от типа и степени защиты от поражения электрическим током

изделие класса I

Блок обработки данных (компьютер PC01) для TowardPi YG-100K MAX, TowardPi YG-100K PRO, TowardPi YG Lite, TowardPi YG-100K NF

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi

Блок обработки данных (компьютер PC01) для TowardPi YG-100K MAX, TowardPi YG-100K PRO, TowardPi YG Lite, TowardPi YG-100K NF



TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd.

(ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи Лтд.) Room 101-F401, -1st-6st Floor, Building 3, Yard 9, Shengmingyuan Road., Life Science Park, Changping District, Beijing, 102206, China

Классификация в зависимости от типа и степени защиты от поражения электрическим током

изделие класса I

Трансформатор напряжения электросети (IT04) с комплектом крепежных болтов (ØM8x40мм, 6 шт.)

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi

Трансформатор напряжения электросети (IT04) с комплектом крепежных болтов (ØM8x40мм, 6 шт.)



TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd.

(ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи Лтд.) Room 101-F401, -1st-6st Floor, Building 3, Yard 9, Shengmingyuan Road., Life Science Park, Changping District, Beijing, 102206, China

Классификация в зависимости от типа и степени защиты от поражения электрическим током

изделие класса I

Стол электроподъемный (MT01) для размещения основного блока, трансформатора и компьютера

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi

Стол электроподъемный (MT01) для размещения основного блока, трансформатора и компьютера



TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd.

(ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи Лтд.) Room 101-F401, -1st-6st Floor, Building 3, Yard 9, Shengmingyuan Road., Life Science Park, Changping District, Beijing, 102206, China

Классификация в зависимости от типа и степени защиты от поражения электрическим током

изделие класса I

Насадка для сканирования переднего сегмента глаза (AS02) для TowardPi BM-400K MAX, TowardPi BM-400K, TowardPi BM Lite, TowardPi BM-400K NF

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi

Насадка для сканирования переднего сегмента глаза (AS02) для TowardPi BM-400K MAX, TowardPi BM-400K, TowardPi BM Lite, TowardPi BM-400K NF



TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd.

(ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи Лтд.) Room 101-F401, -1st-6st Floor, Building 3, Yard 9, Shengmingyuan Road., Life Science Park, Changping District, Beijing, 102206, China

Классификация в зависимости от типа и степени защиты от поражения электрическим током

изделие класса I

Насадка для сканирования переднего сегмента глаза (AS01) для TowardPi YG-100K MAX, TowardPi YG-100K PRO, TowardPi YG Lite, TowardPi YG-100K NF

Система оптической когерентной томографии глаза TowardPi

Насадка для сканирования переднего сегмента глаза (AS01) для TowardPi YG-100K MAX, TowardPi YG-100K PRO, TowardPi YG Lite, TowardPi YG-100K NF



TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd.

(ТоуардПи (Пекин) Медикал Технолоджи Лтд.) Room 101-F401, -1st-6st Floor, Building 3, Yard 9, Shengmingyuan Road., Life Science Park, Changping District, Beijing, 102206, China

Классификация в зависимости от типа и степени защиты от поражения электрическим током	изделие класса I
---	------------------

Индивидуальная упаковка (картонная коробка) МИ

Коробка для основного блока и основным частей не имеющих индивидуальной упаковки



Ophthalmic Optical Coherence

Tomography Systems



Rx ONLY

TowardPi

Transport And Storage



MD





□ 110V~, 50/60Hz, 4.2A

■ 230V~, 50/60Hz, 2.1A

Model: BM-400K MAX

SN

BM400M23034

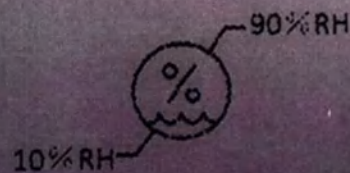

2023-07-15




TowardPi (Beijing) Medical Technology Ltd.
Room 101-F401, -1st-6th Floor, Building 3 Yard 9,
Shengmingyuan Road, Life Science Park, Changping
District, Beijing, 102206 China
Tel: +86 10-6158 6818


Made in China

(01) 16975994660046 (21) BM400M23034 (11) 230716

Коробка для блока обработки данных (компьютер)

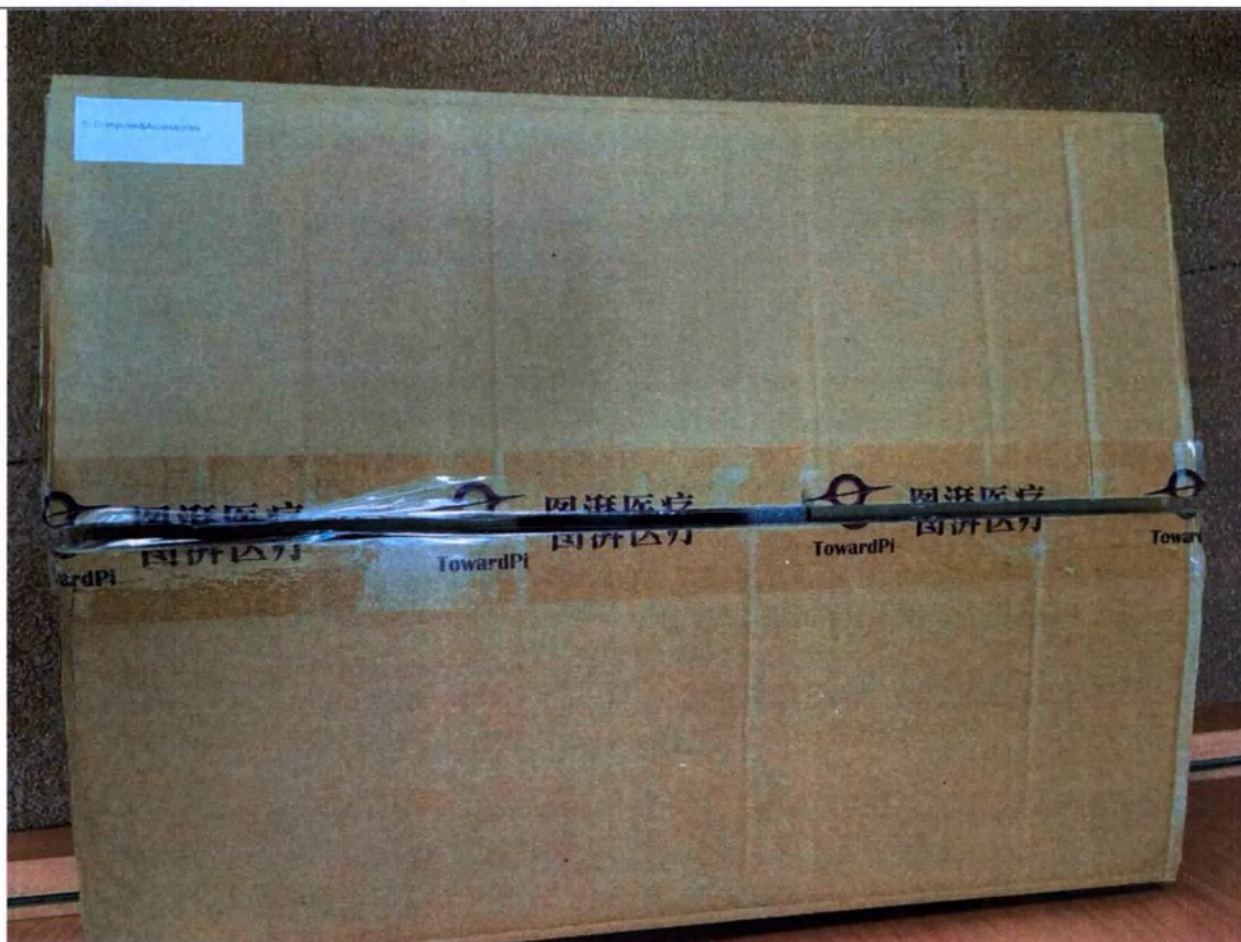


Транспортная индивидуальная маркировка позиции: блок обработки данных (компьютер)

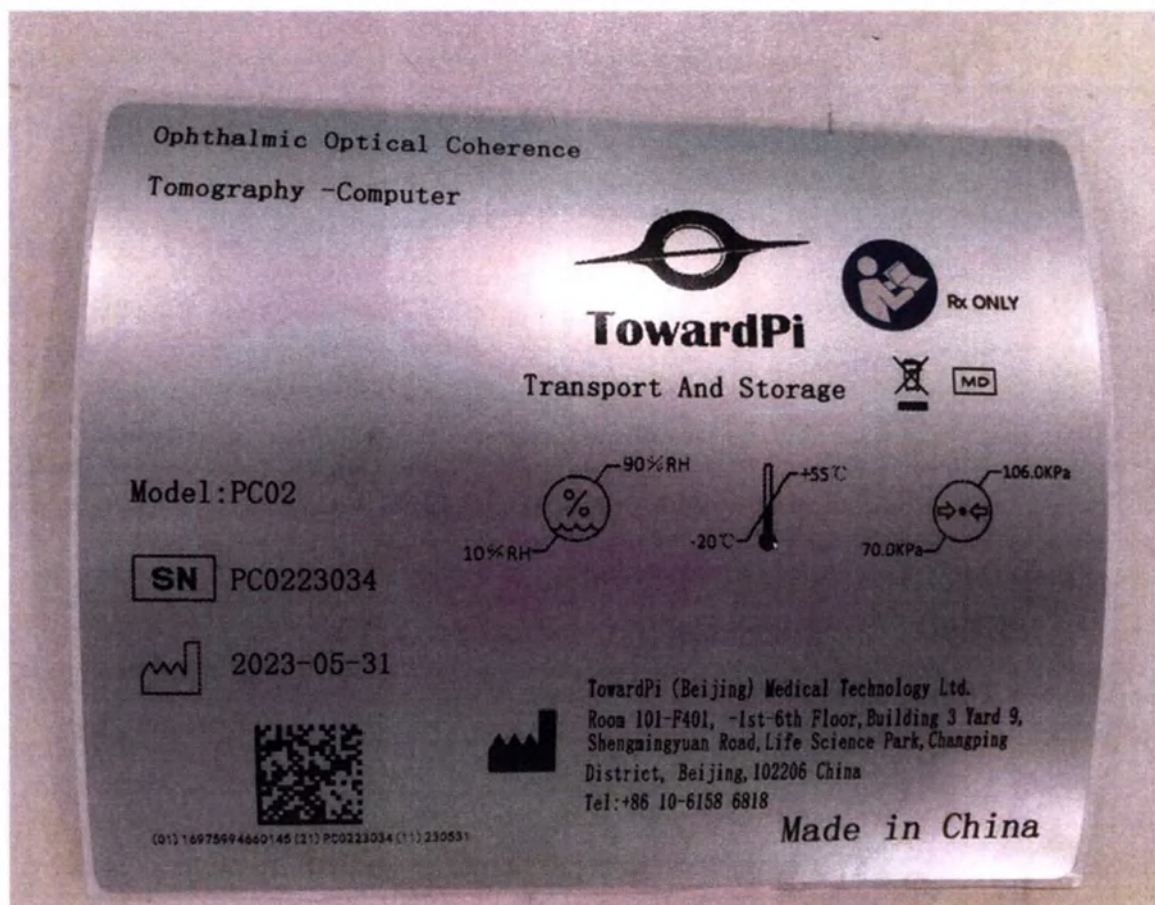

Коробка для позиции: Трансформатор напряжения электросети (IT04) с комплектом крепежных болтов (ØM8x40мм, 6 шт.)




Транспортная индивидуальная маркировка позиции: Трансформатор напряжения электросети (IT04) с комплектом крепежных болтов (ØM8x40мм, 6 шт.)

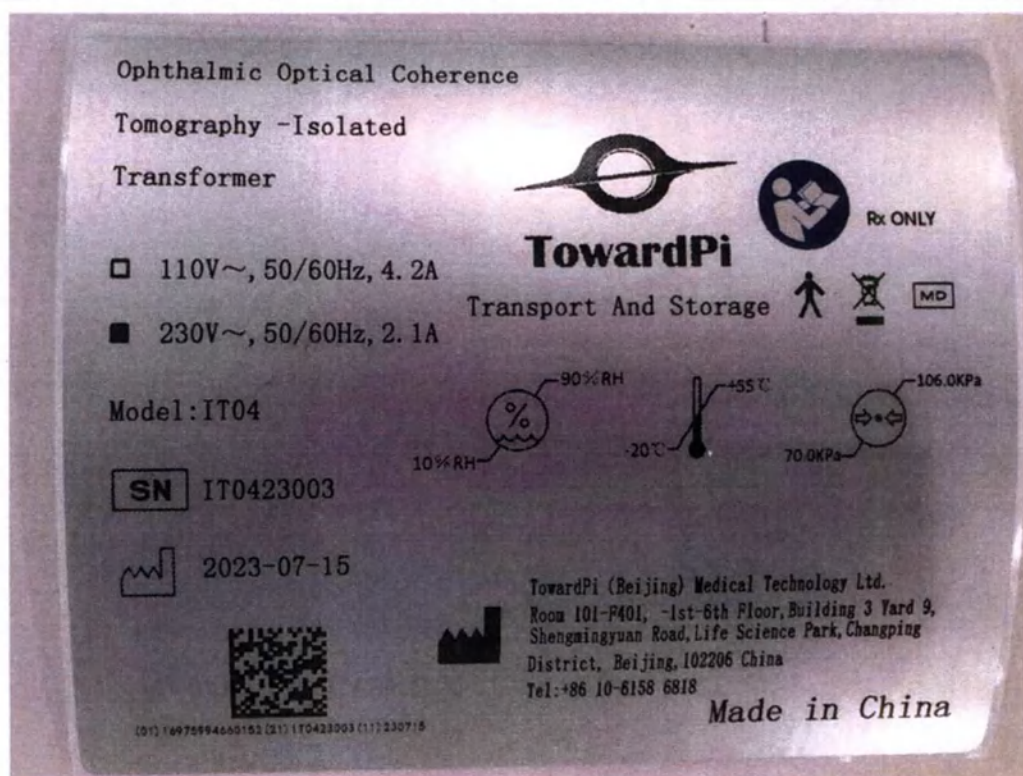

Коробка для позиции: Стол электроподъемный (MT01) для размещения основного блока, трансформатора и компьютера




Транспортная индивидуальная маркировка позиции: Стол электроподъемный (MT01) для размещения основного блока, трансформатора и компьютера

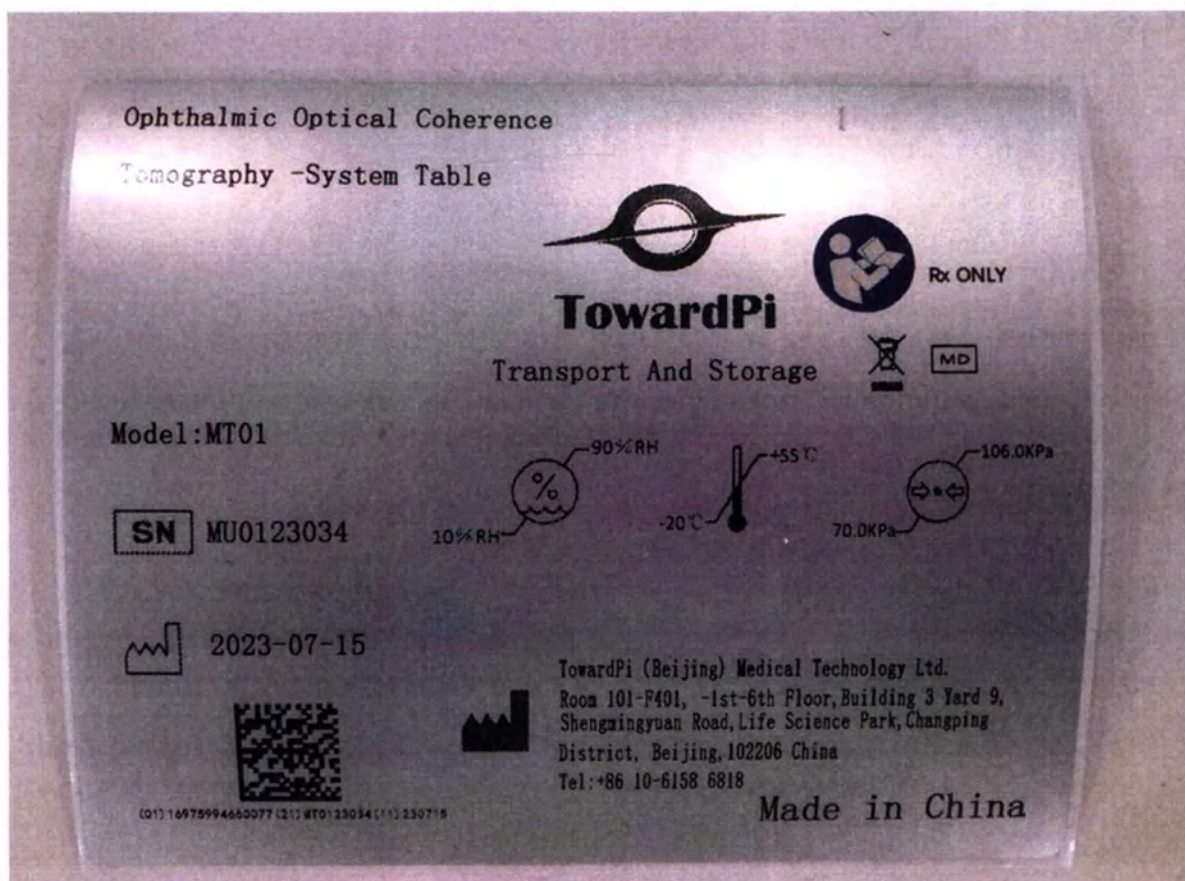


Коробка для позиции: Насадка для сканирования переднего сегмента глаза



Транспортная индивидуальная маркировка позиции: Насадка для сканирования переднего сегмента глаза

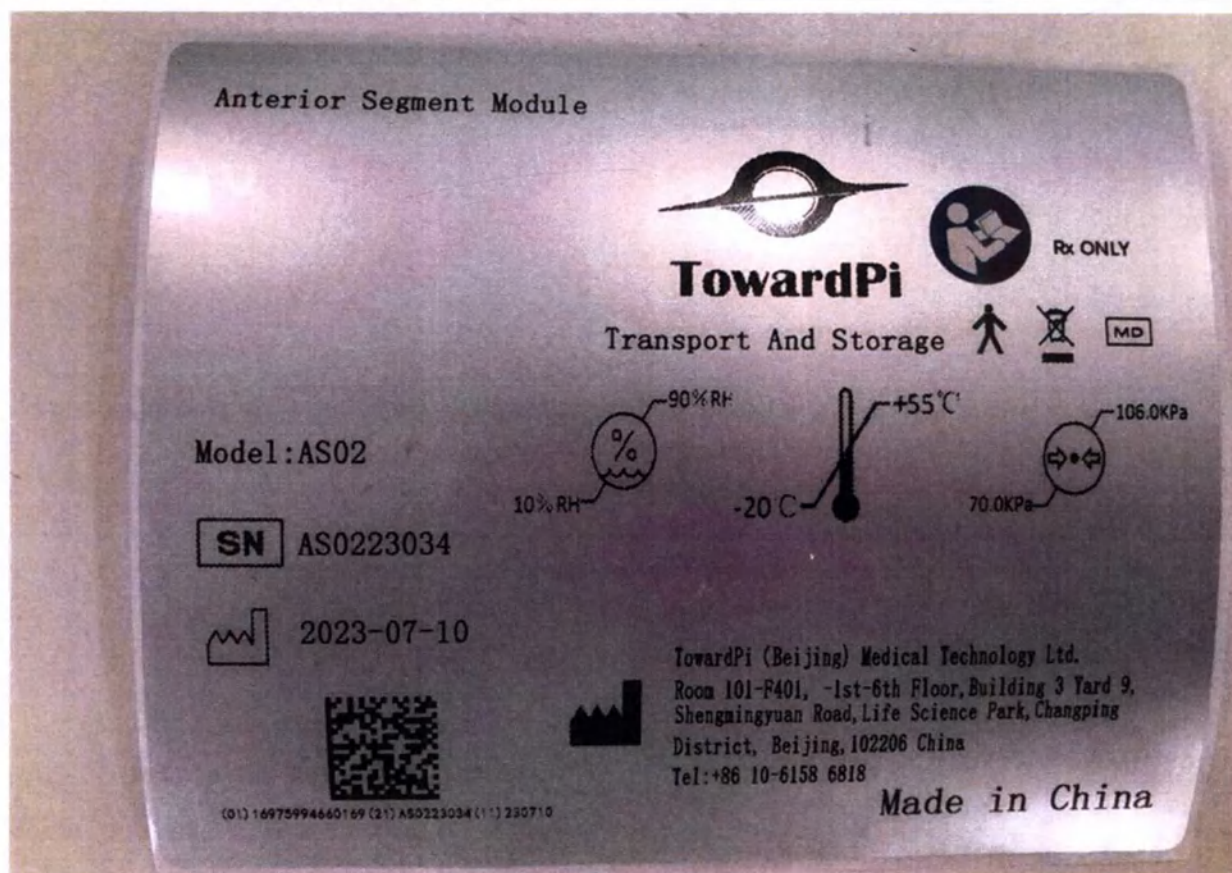

Транспортная коробка (ящик)

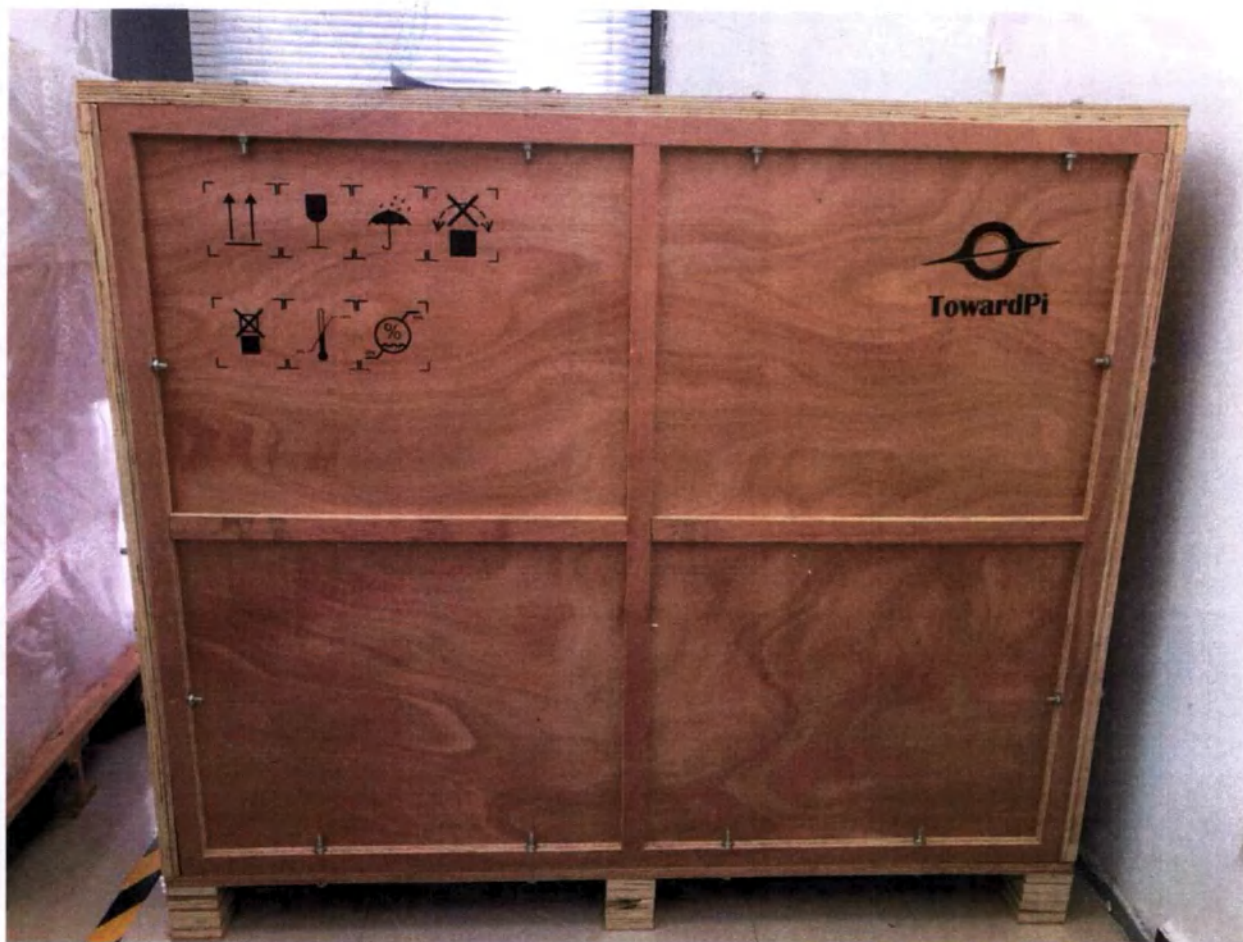

Генеральный директор
ООО «ТМС»

Серегин Р.В.

(подпись)



51 лист