

ООО «Анатомика»
Россия, Казань, ул. Монтажная, 15
+7 (843) 570-05-05
anatomica.ru



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Анатомика»

Д.В. Чигарин

2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Система имплантатов для нейрохирургии
по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017,
в составе (см. Приложение)»

«ООО «Анатомика»
Россия, г. Казань, ул. Монтажная д.15

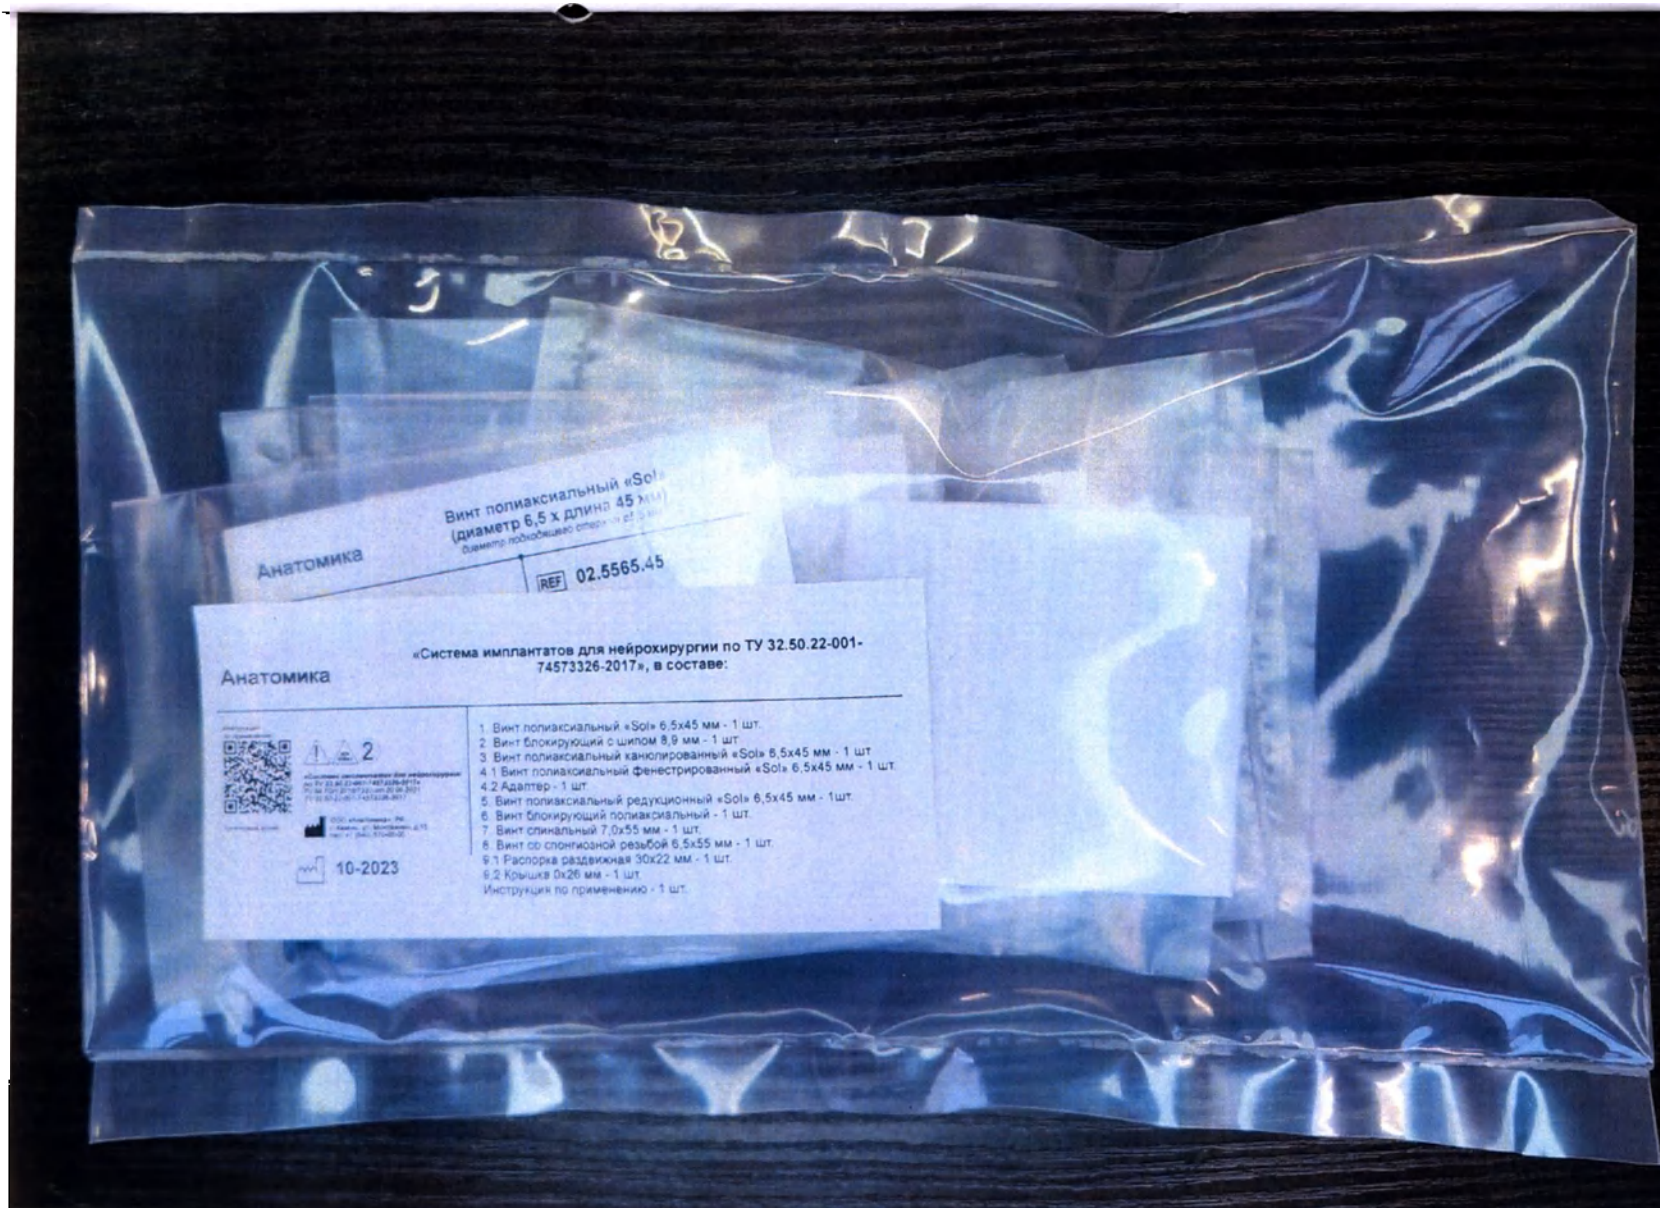


Фото 1. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)» образец изделия в потребительской упаковке, маркировка на сопровождающей этикетке



Фото 2. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)» образец изделия в индивидуальной упаковке, маркировка на сопровождающей этикетке



Фото 3. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»
образец маркировки, нанесенной непосредственно на имплантат



Фото 4. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт транспедикулярный моноосиальный

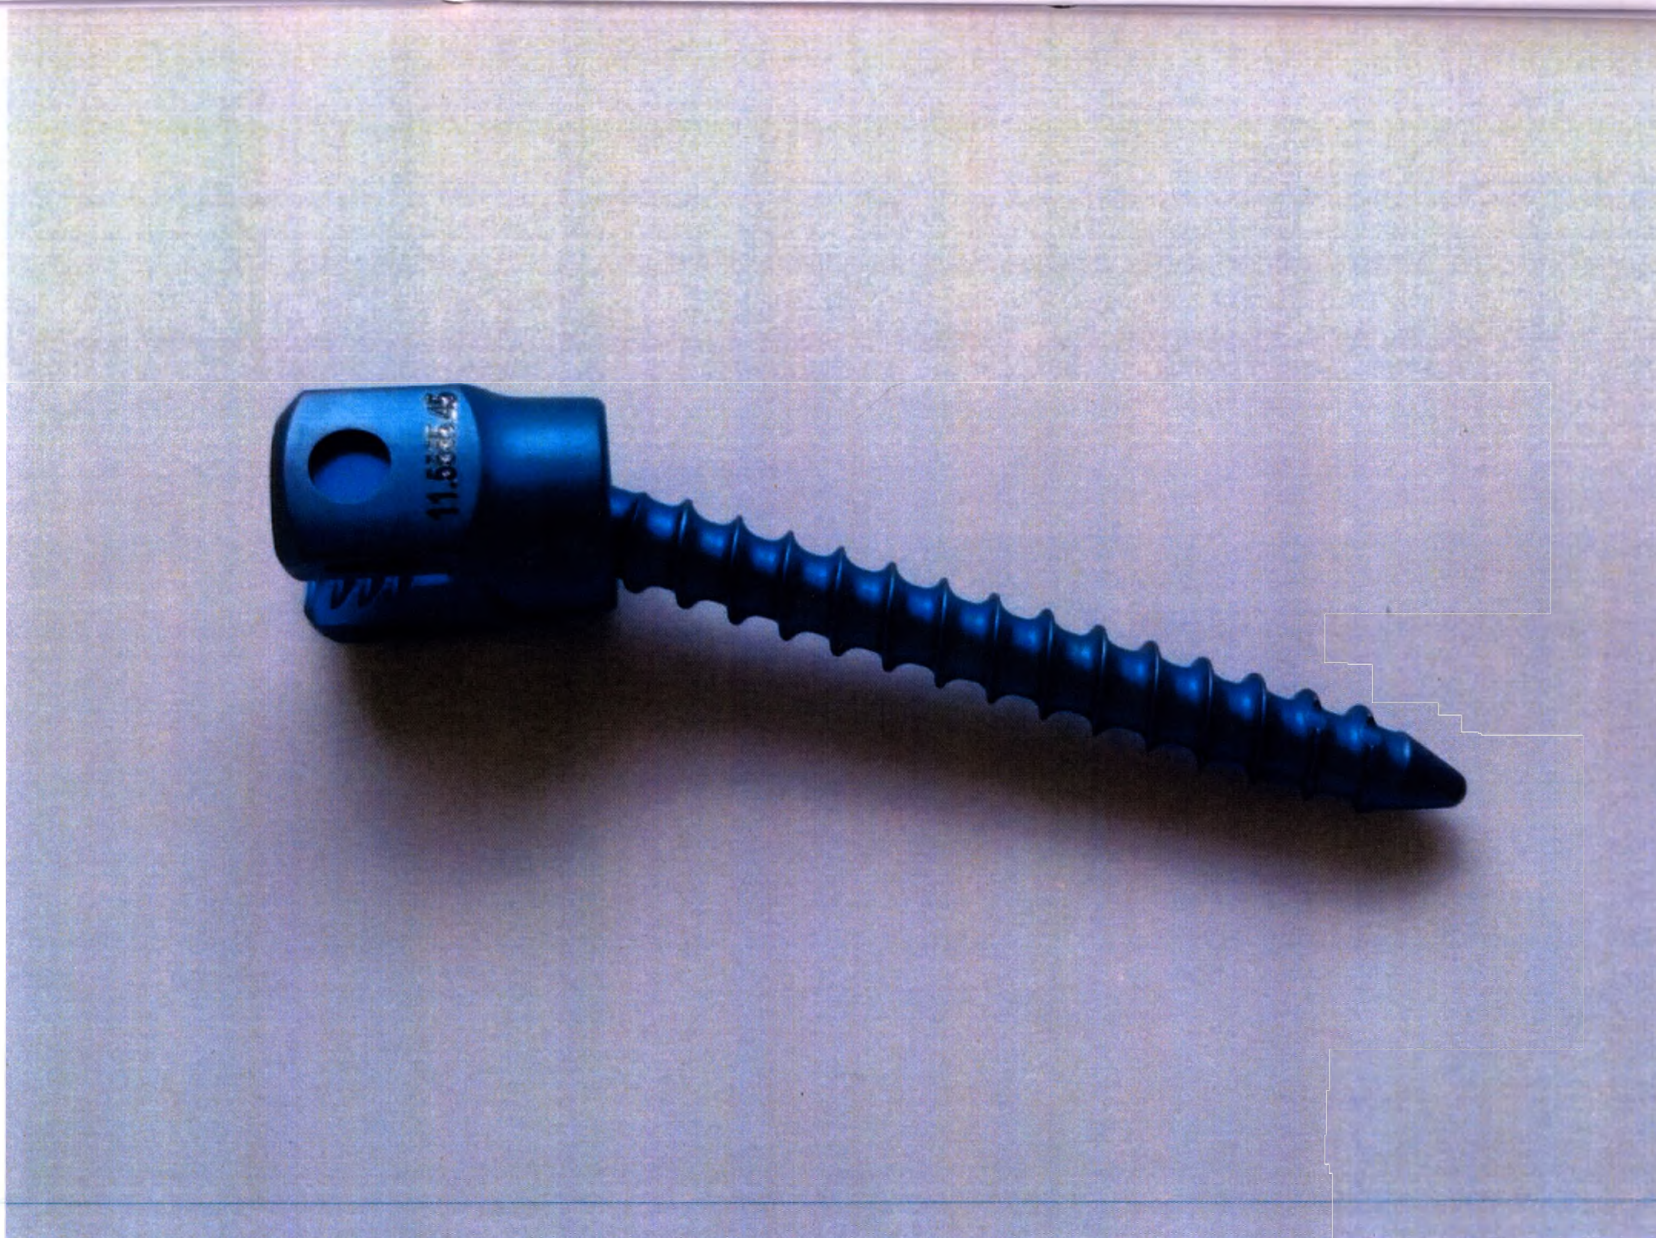


Фото 5. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт транспедикулярный полиаксиальный



Фото 6. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт транспедикулярный полиаксиальный канюлированный



Фото 7. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт транспедикулярный полиаксиальный редуцирующий



Фото 8. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт транспедикулярный униаксиальный



Фото 9. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Крючок педикулярный



Фото 10. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Крючок для поперечного отростка



Фото 11. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Крючок ламинарный



Фото 12. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Крючок ламинарный поясничный смещенный

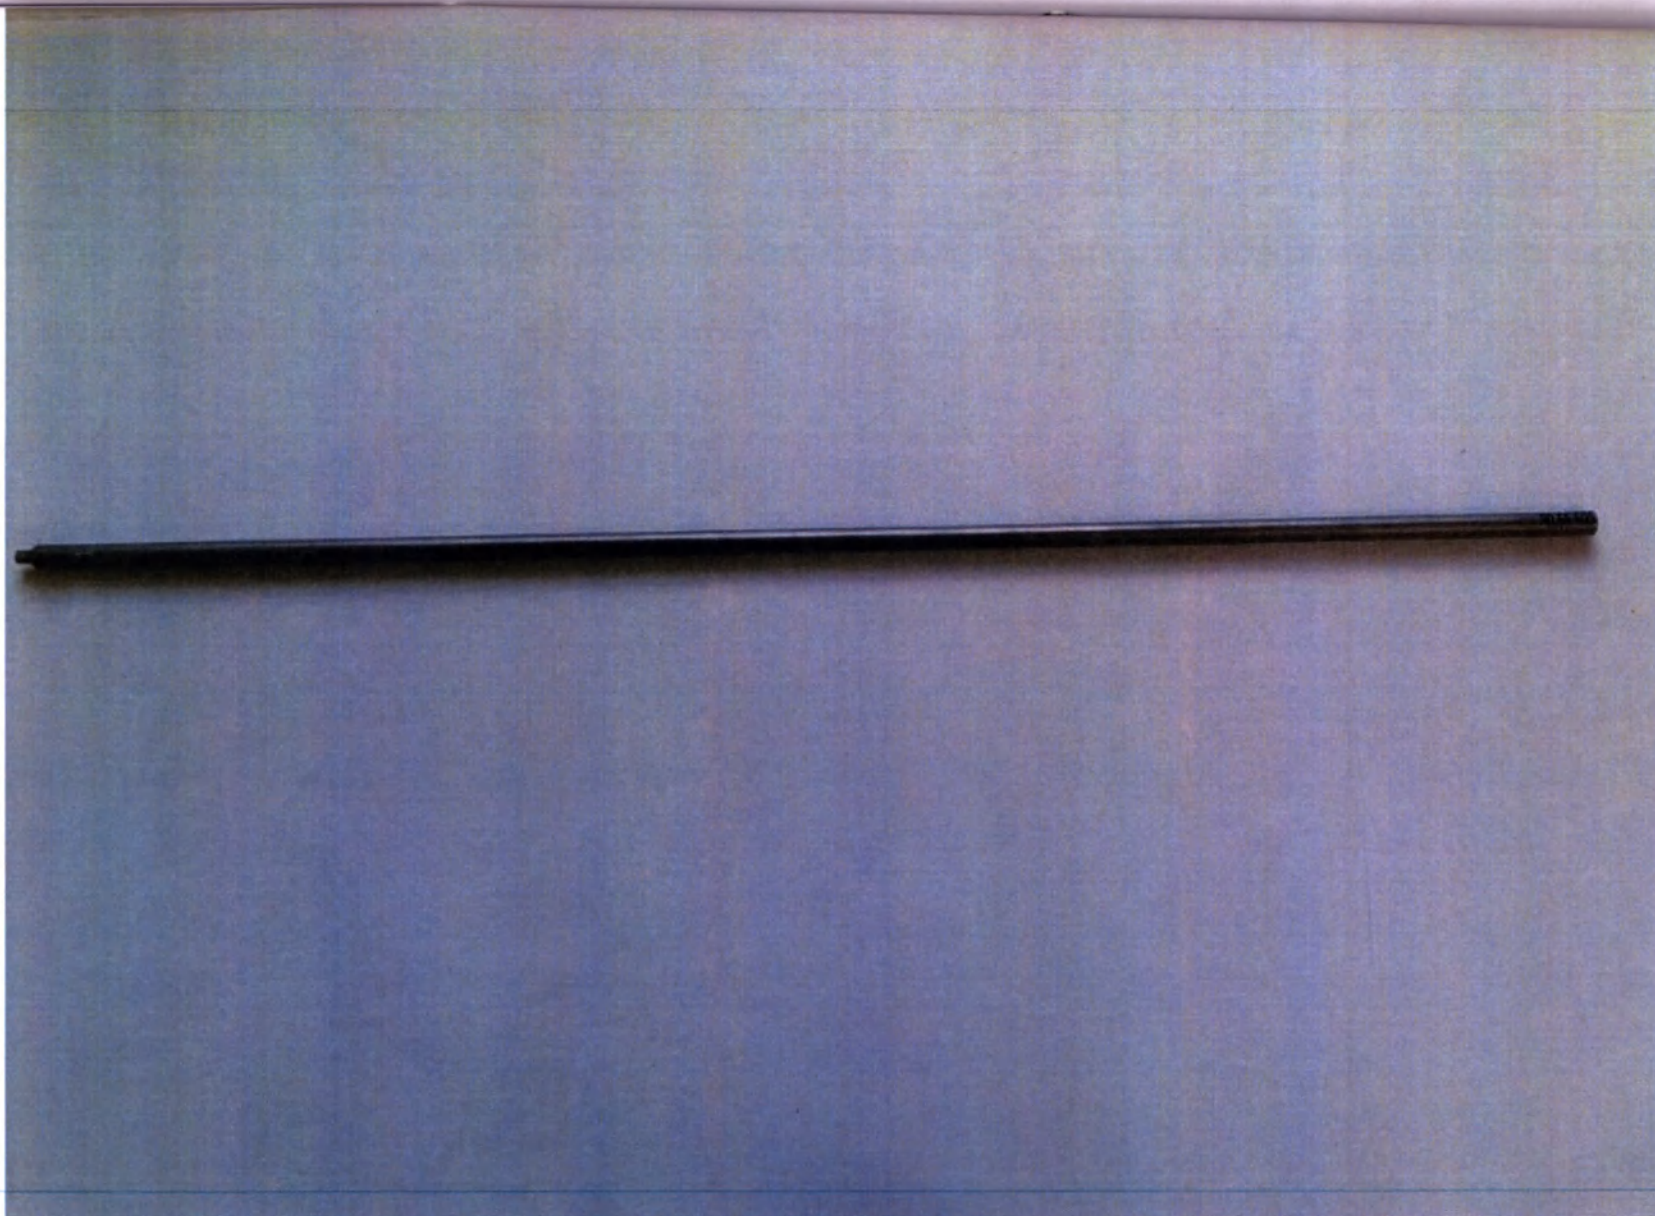


Фото 13. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Стержень прямой



Фото 14. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Стержень изогнутый



Фото 15. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Стяжка поперечная сборная регулируемая универсальная

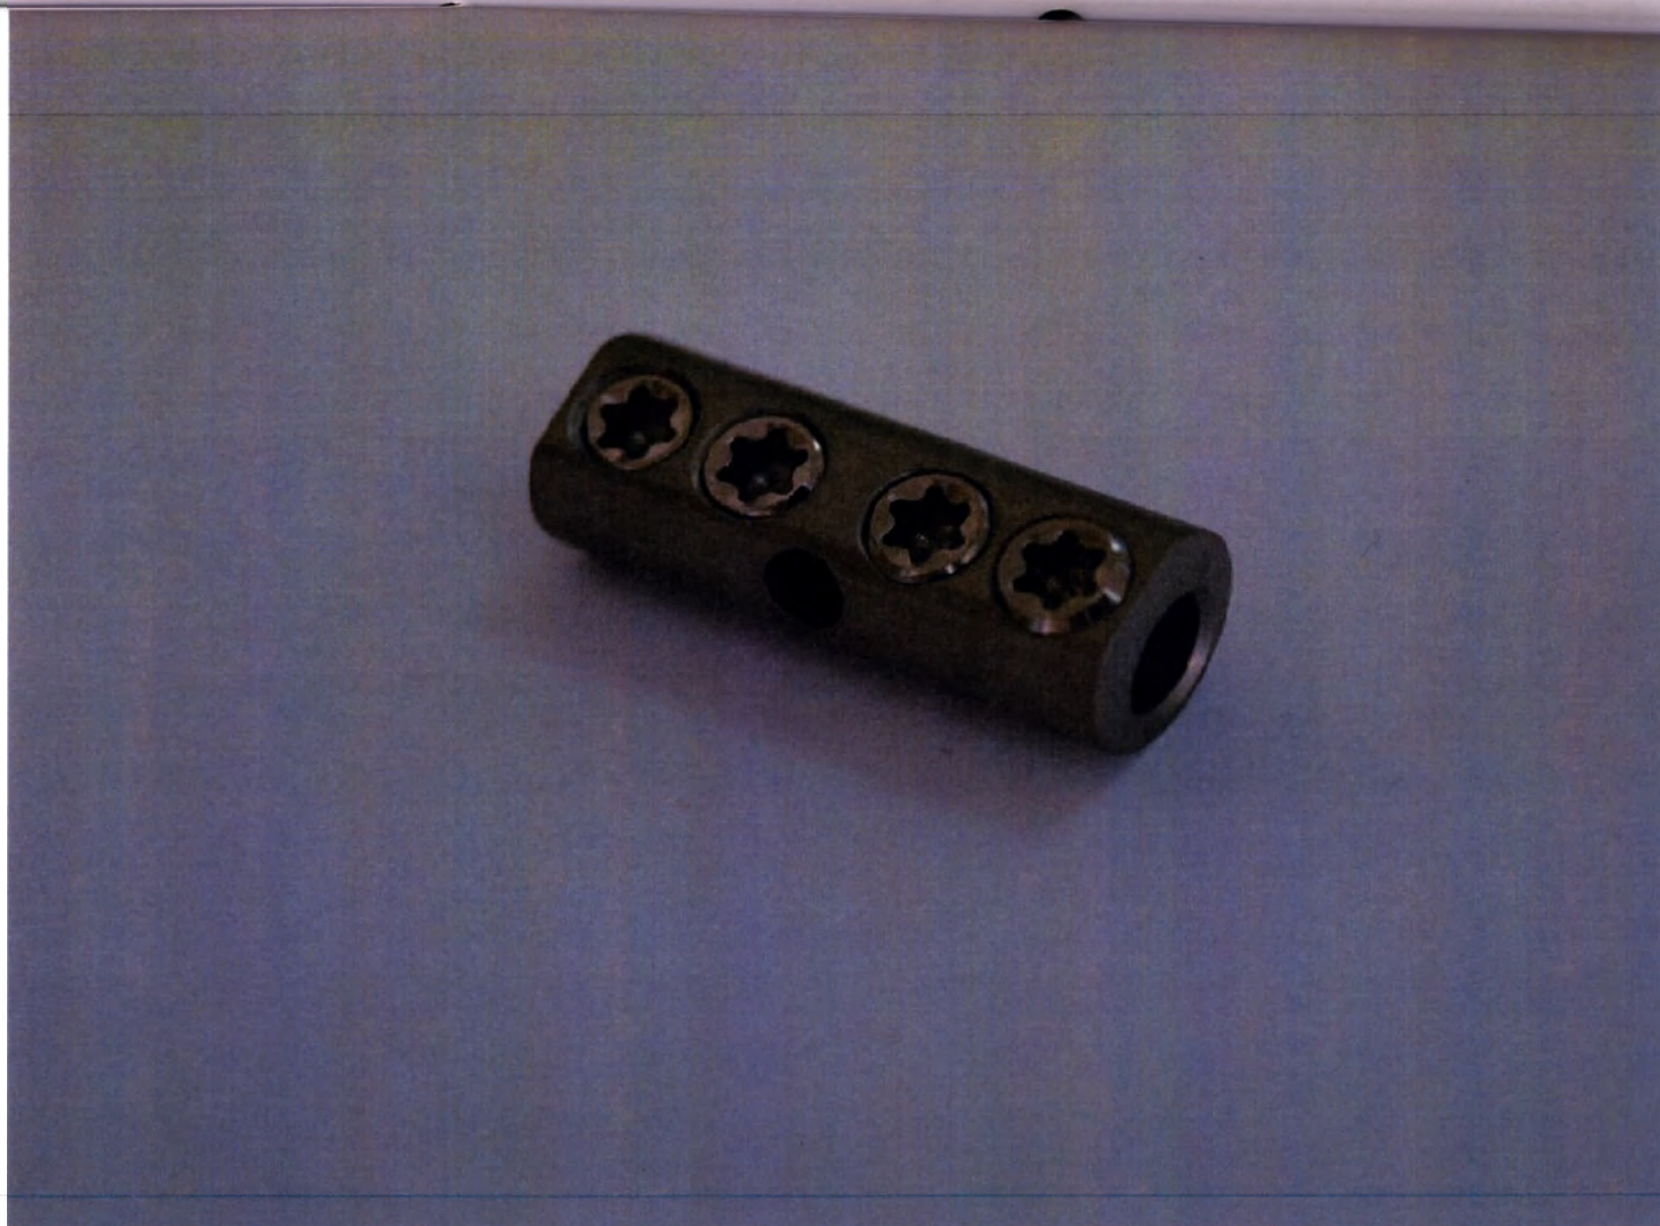


Фото 16. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Коннектор осевой



Фото 17. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт блокирующий



Фото 18. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Пластина передняя шейная

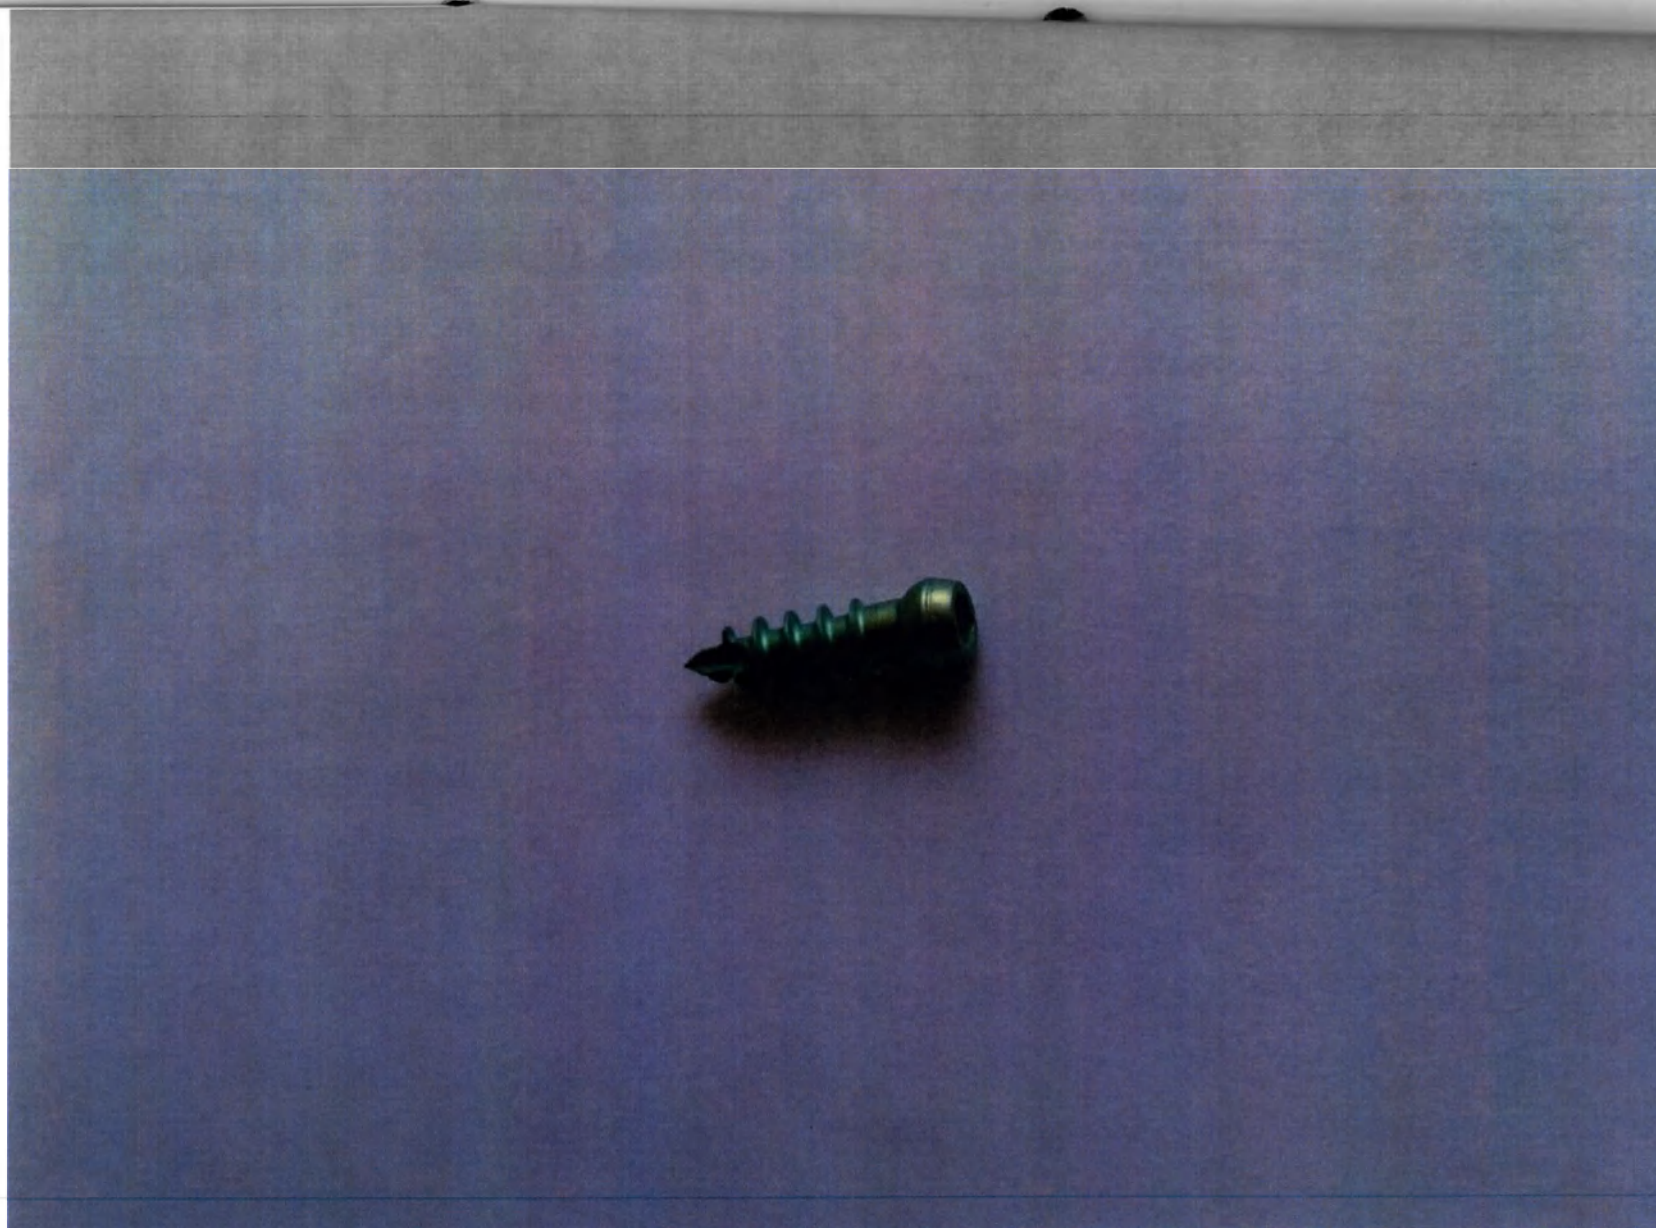


Фото 19. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт костный шейный



Фото 20. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Распорка сетчатая круглая

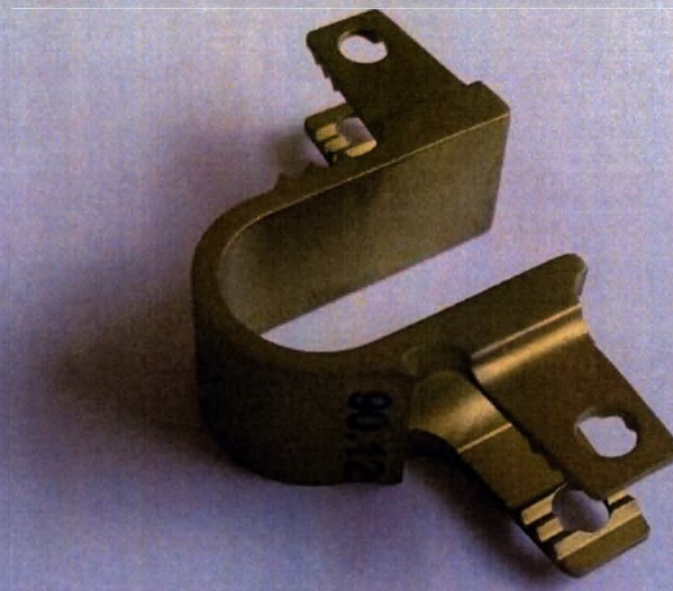


Фото 21. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Фиксатор межостистый

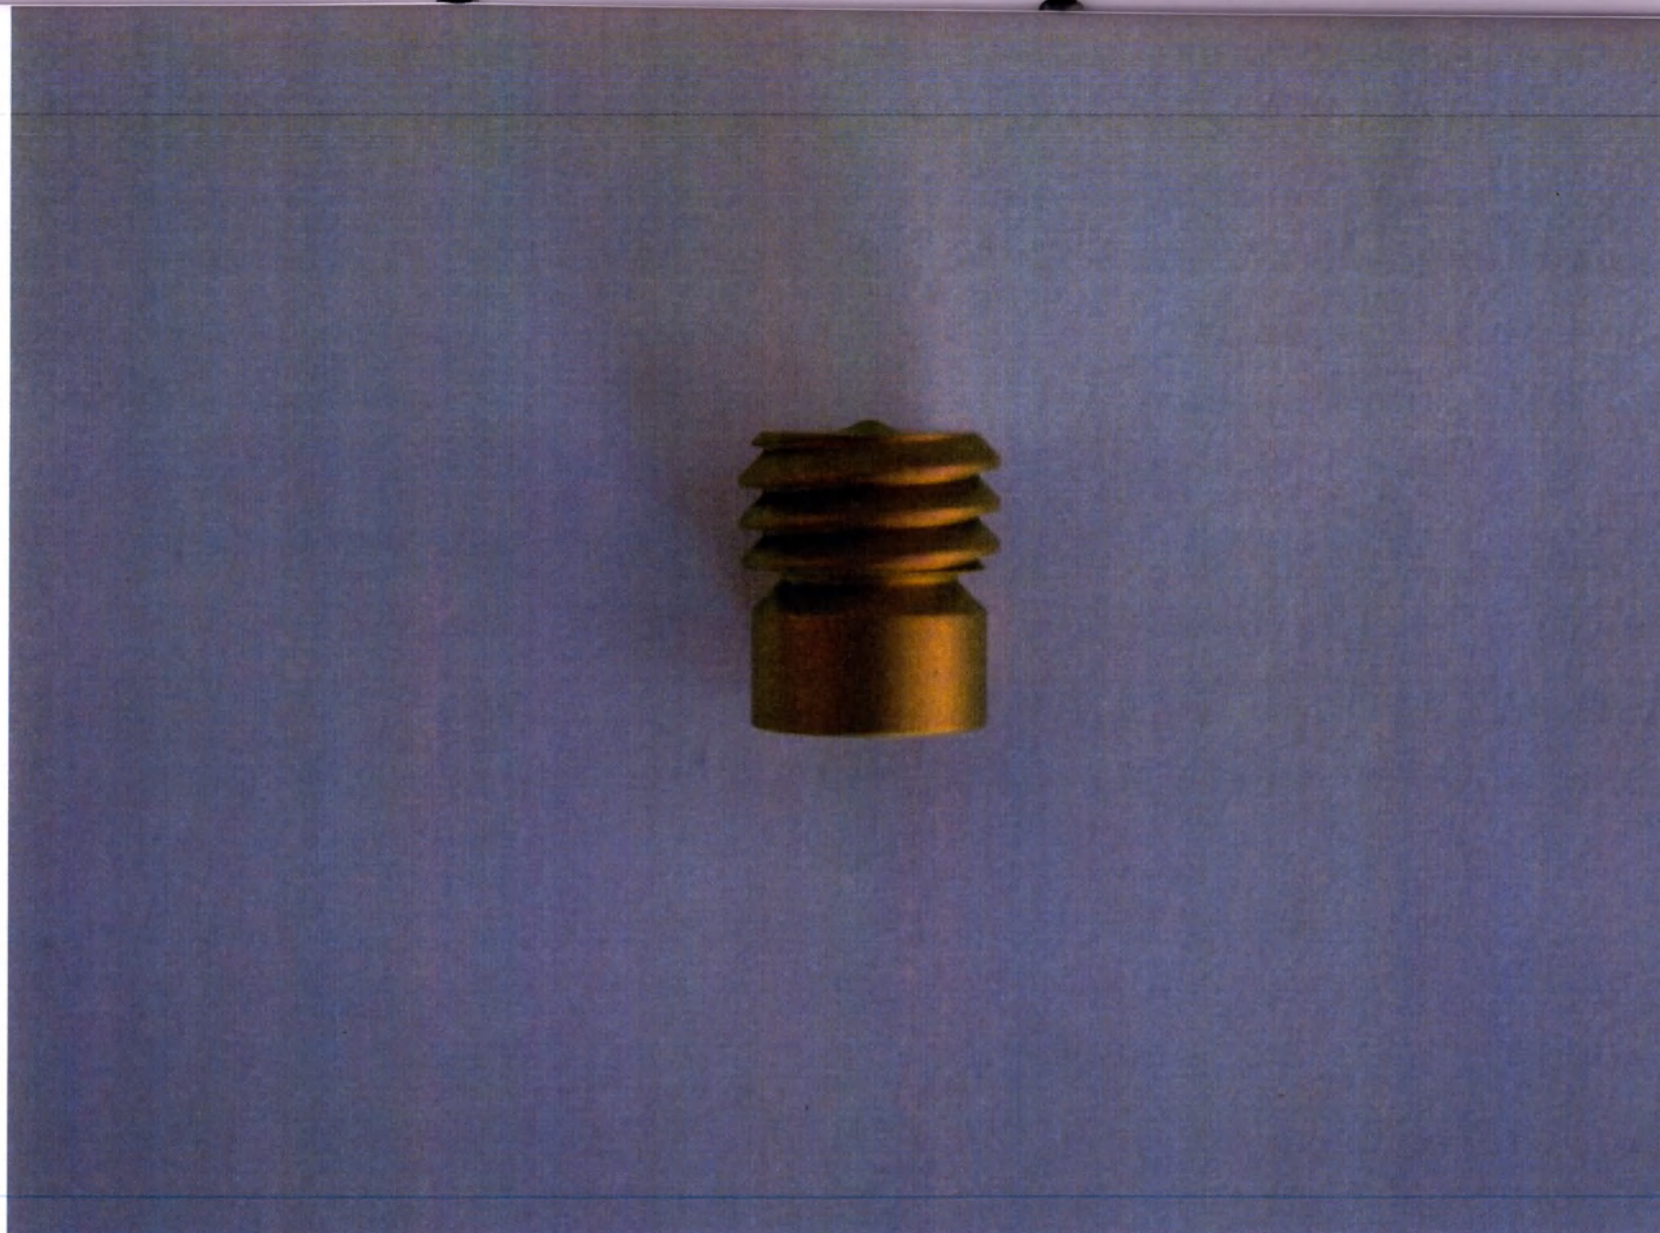


Фото 22. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт блокирующий (для канюлированных винтов)



Фото 23. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт блокирующий (для редуцирующих винтов)

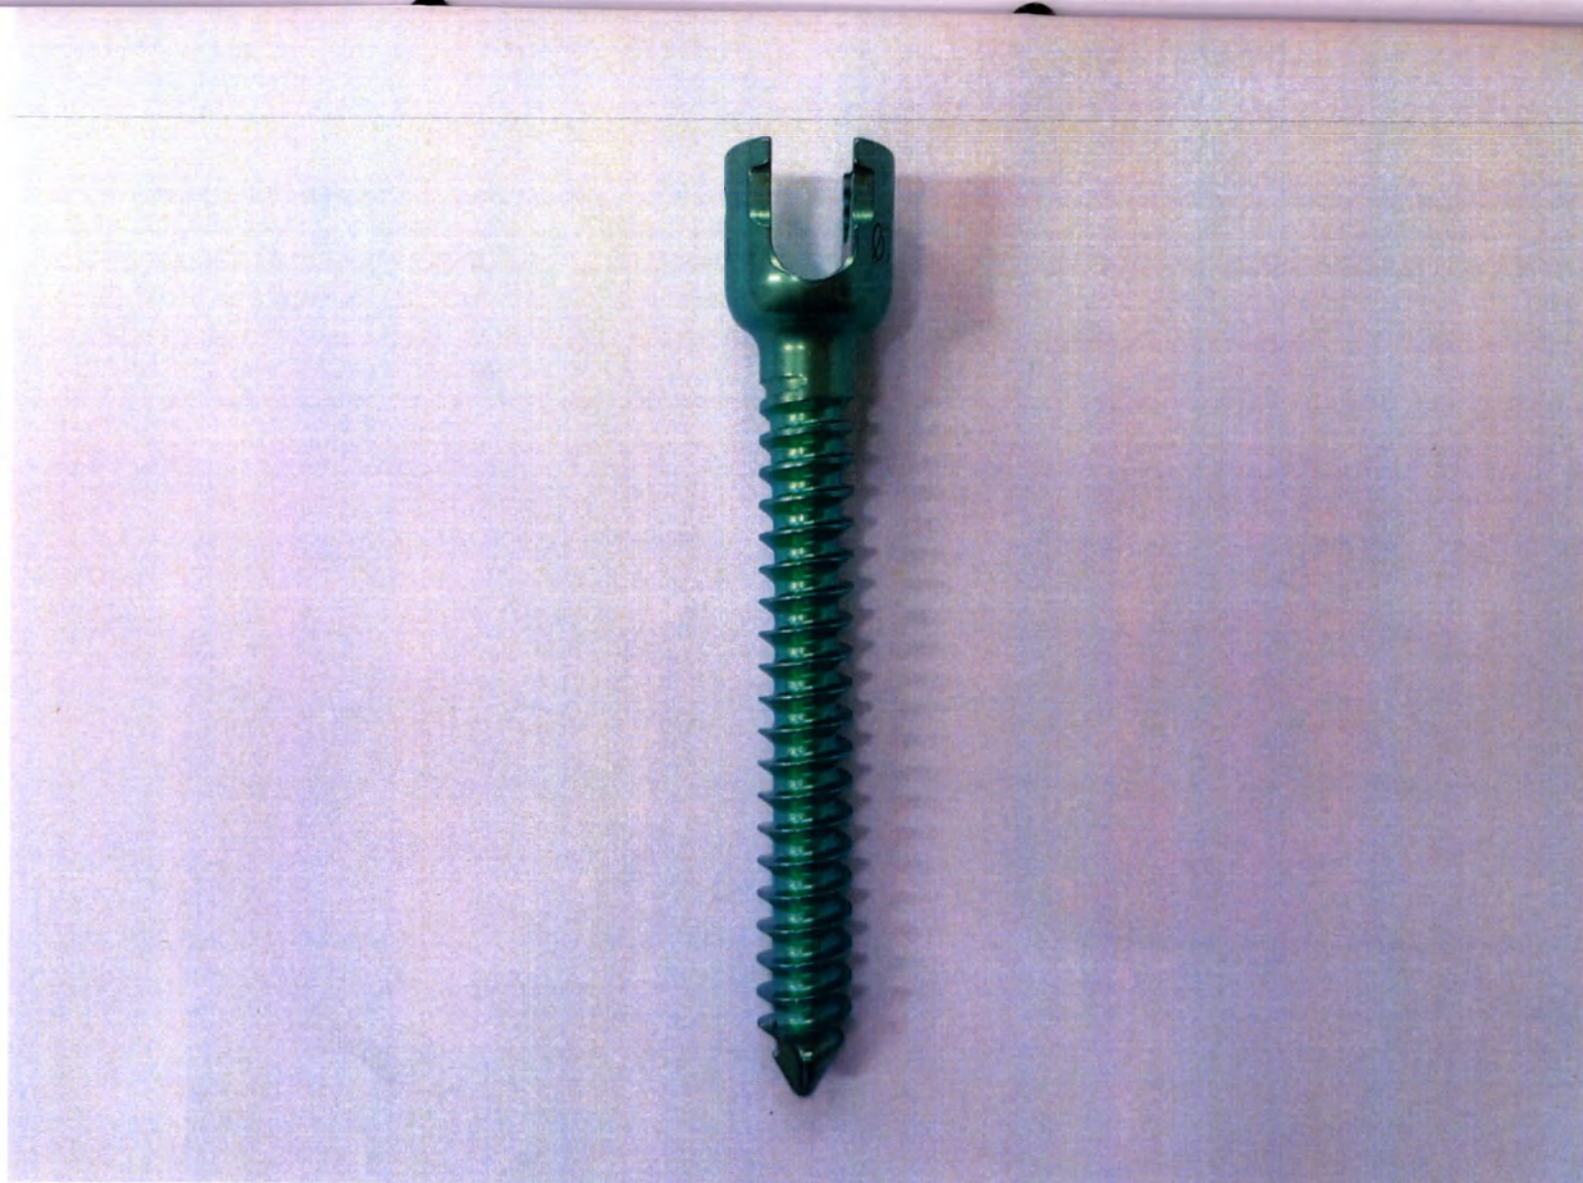


Фото 24. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт моноосиальный

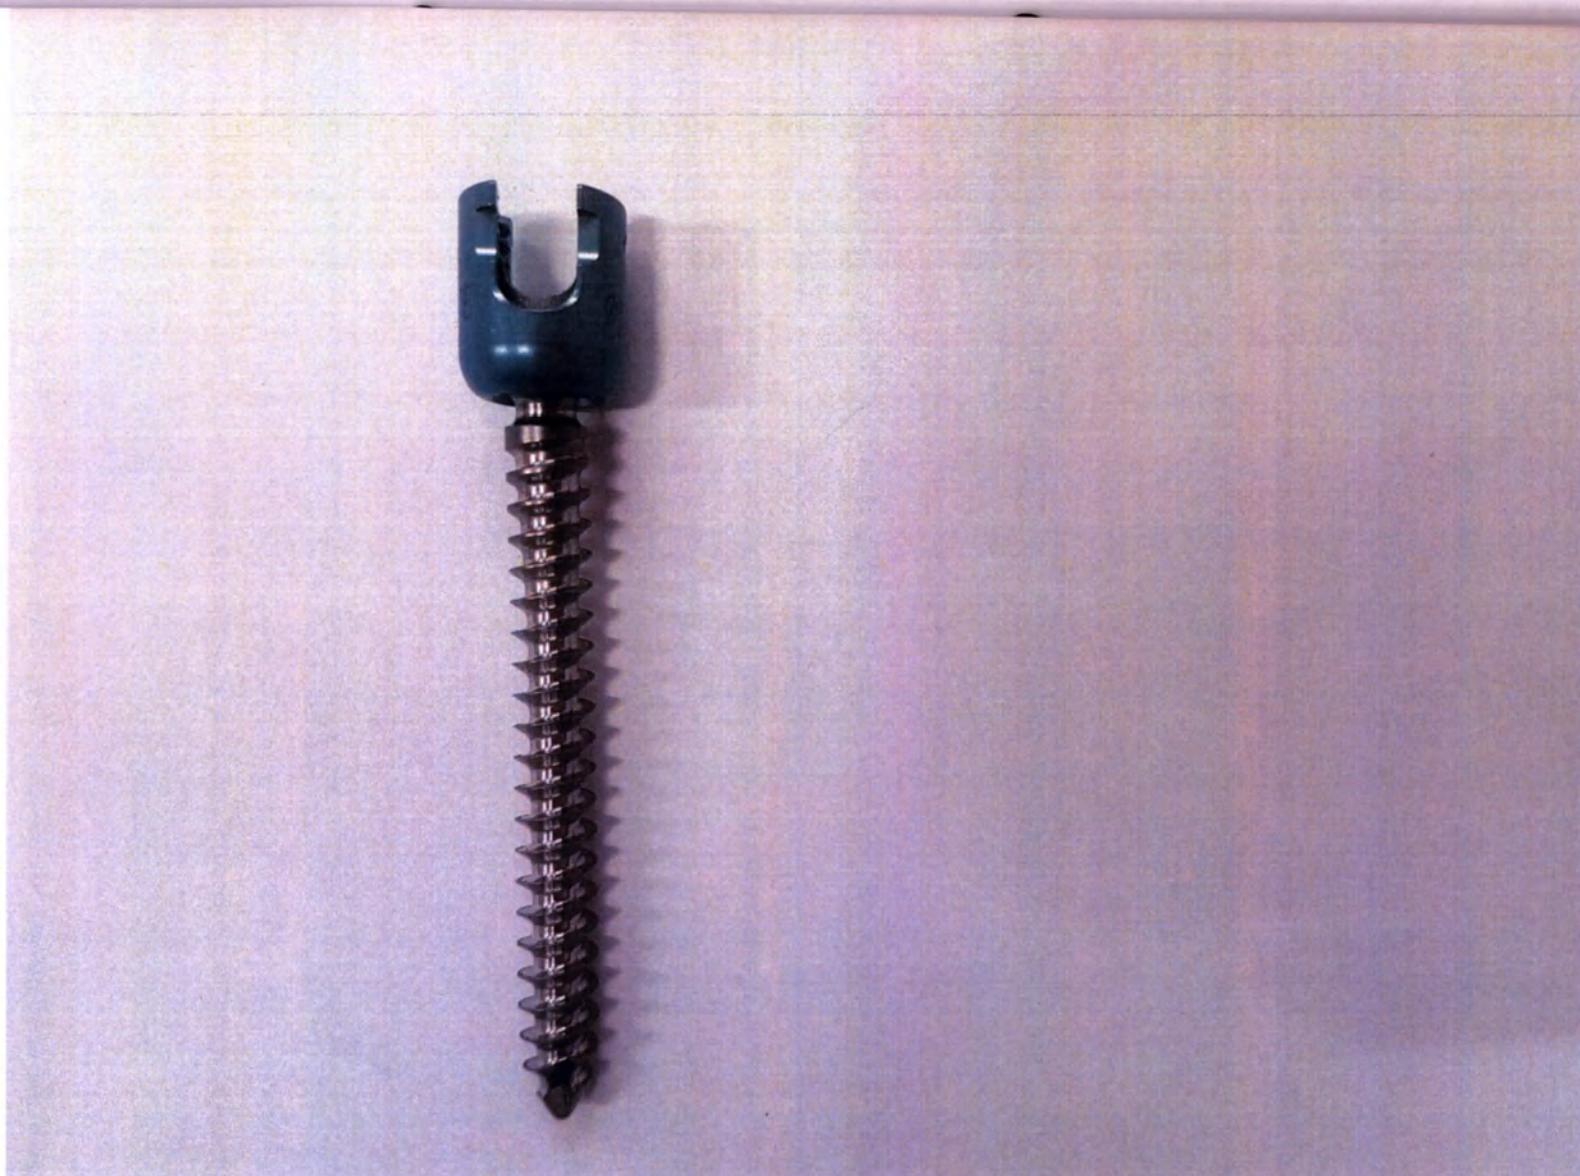


Фото 25. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт полиаксиальный

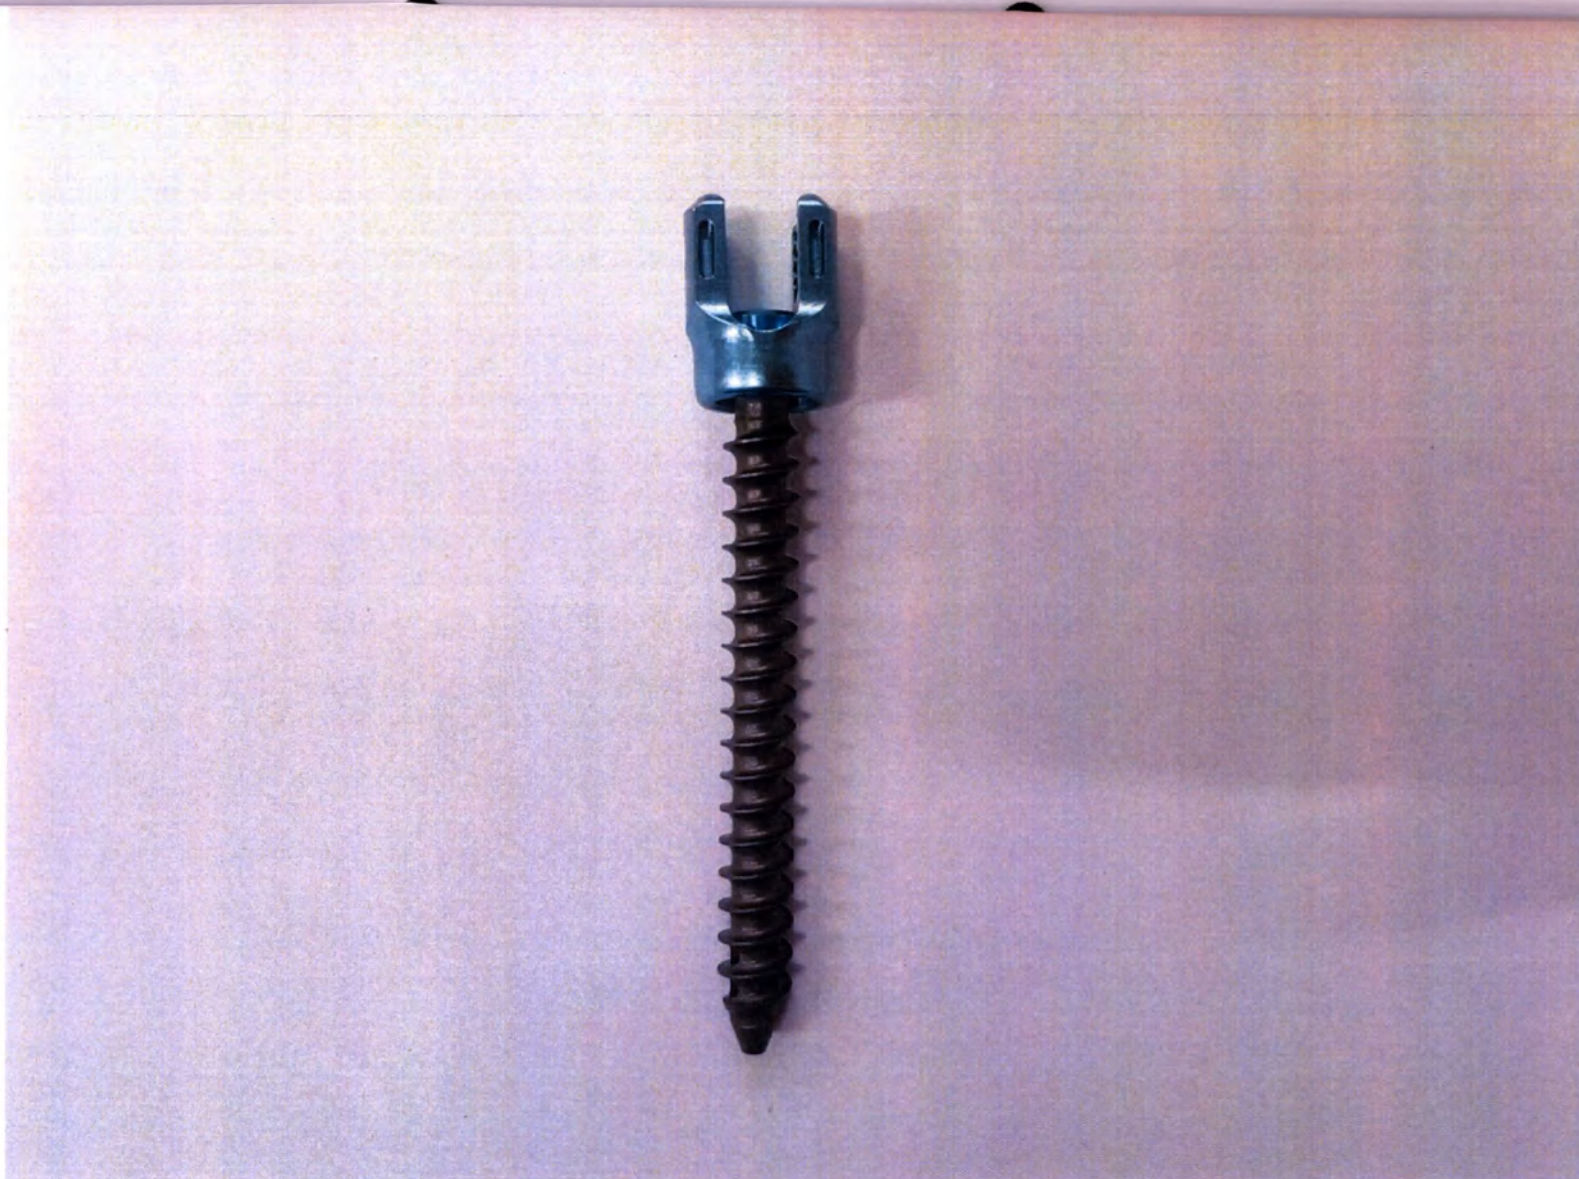


Фото 26. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт полиаксиальный фенестрированный

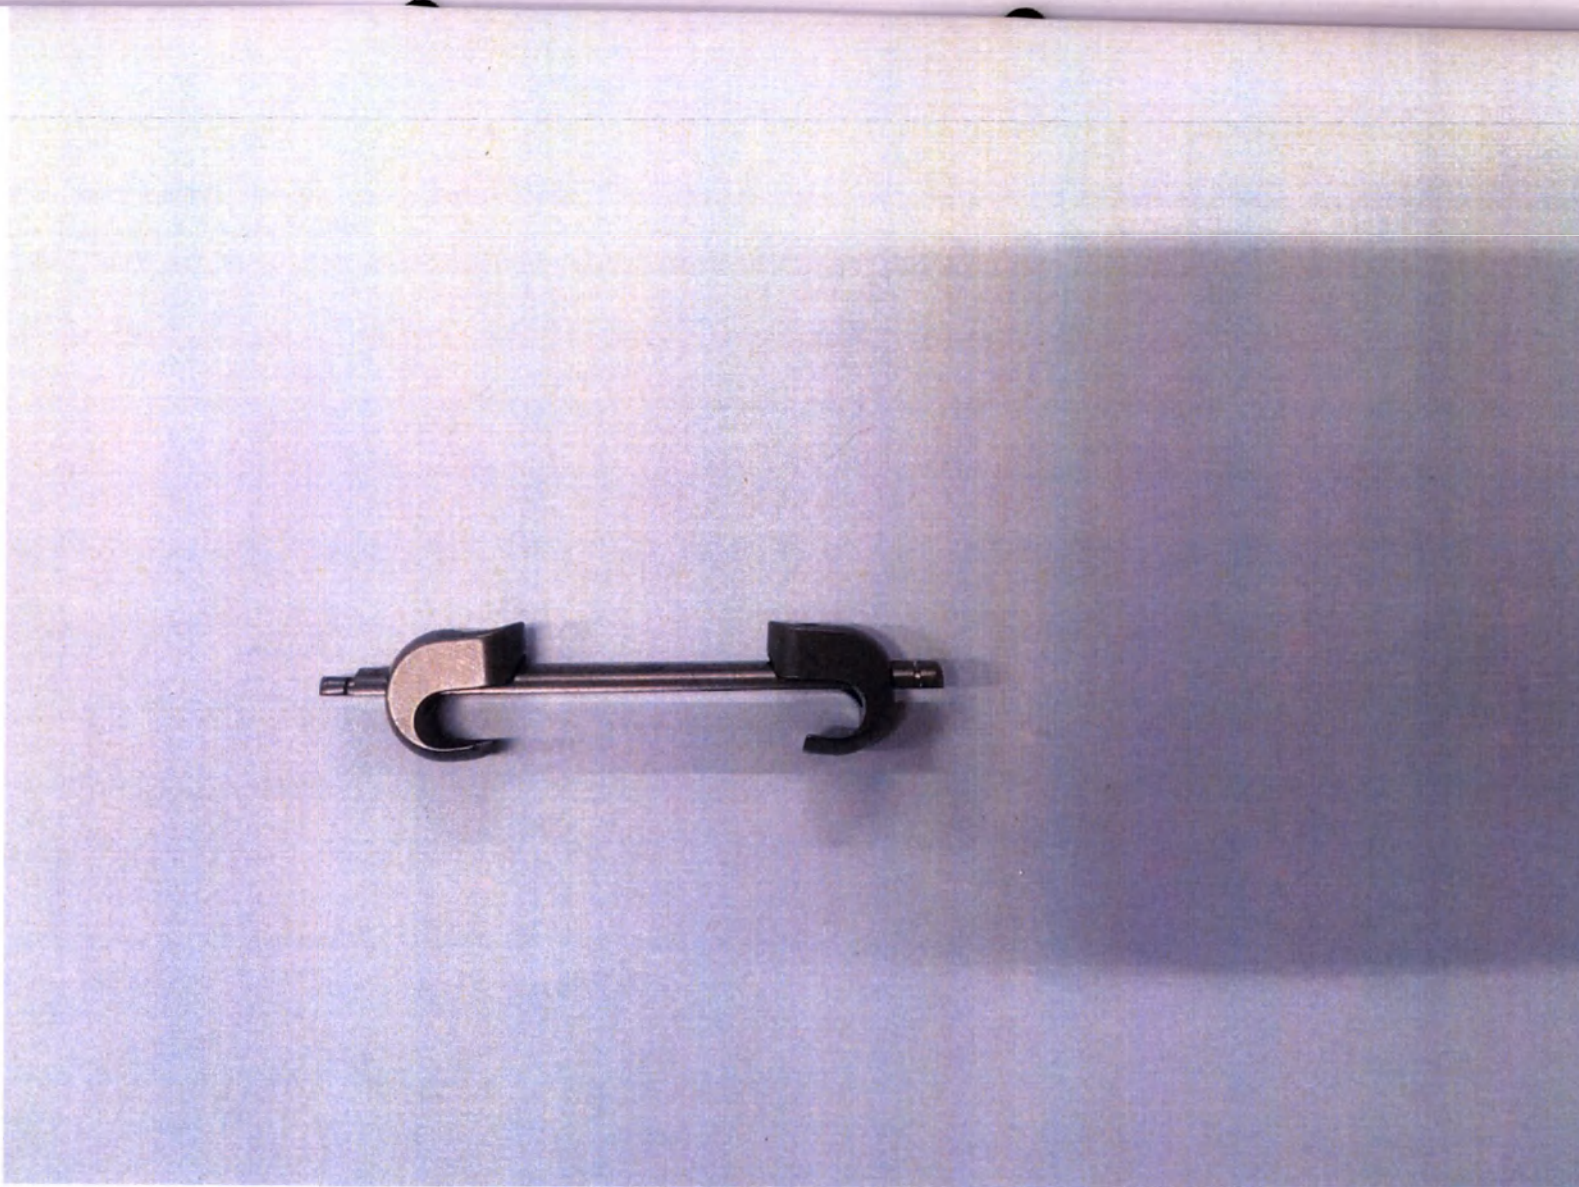


Фото 27. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Стяжка поперечная малая

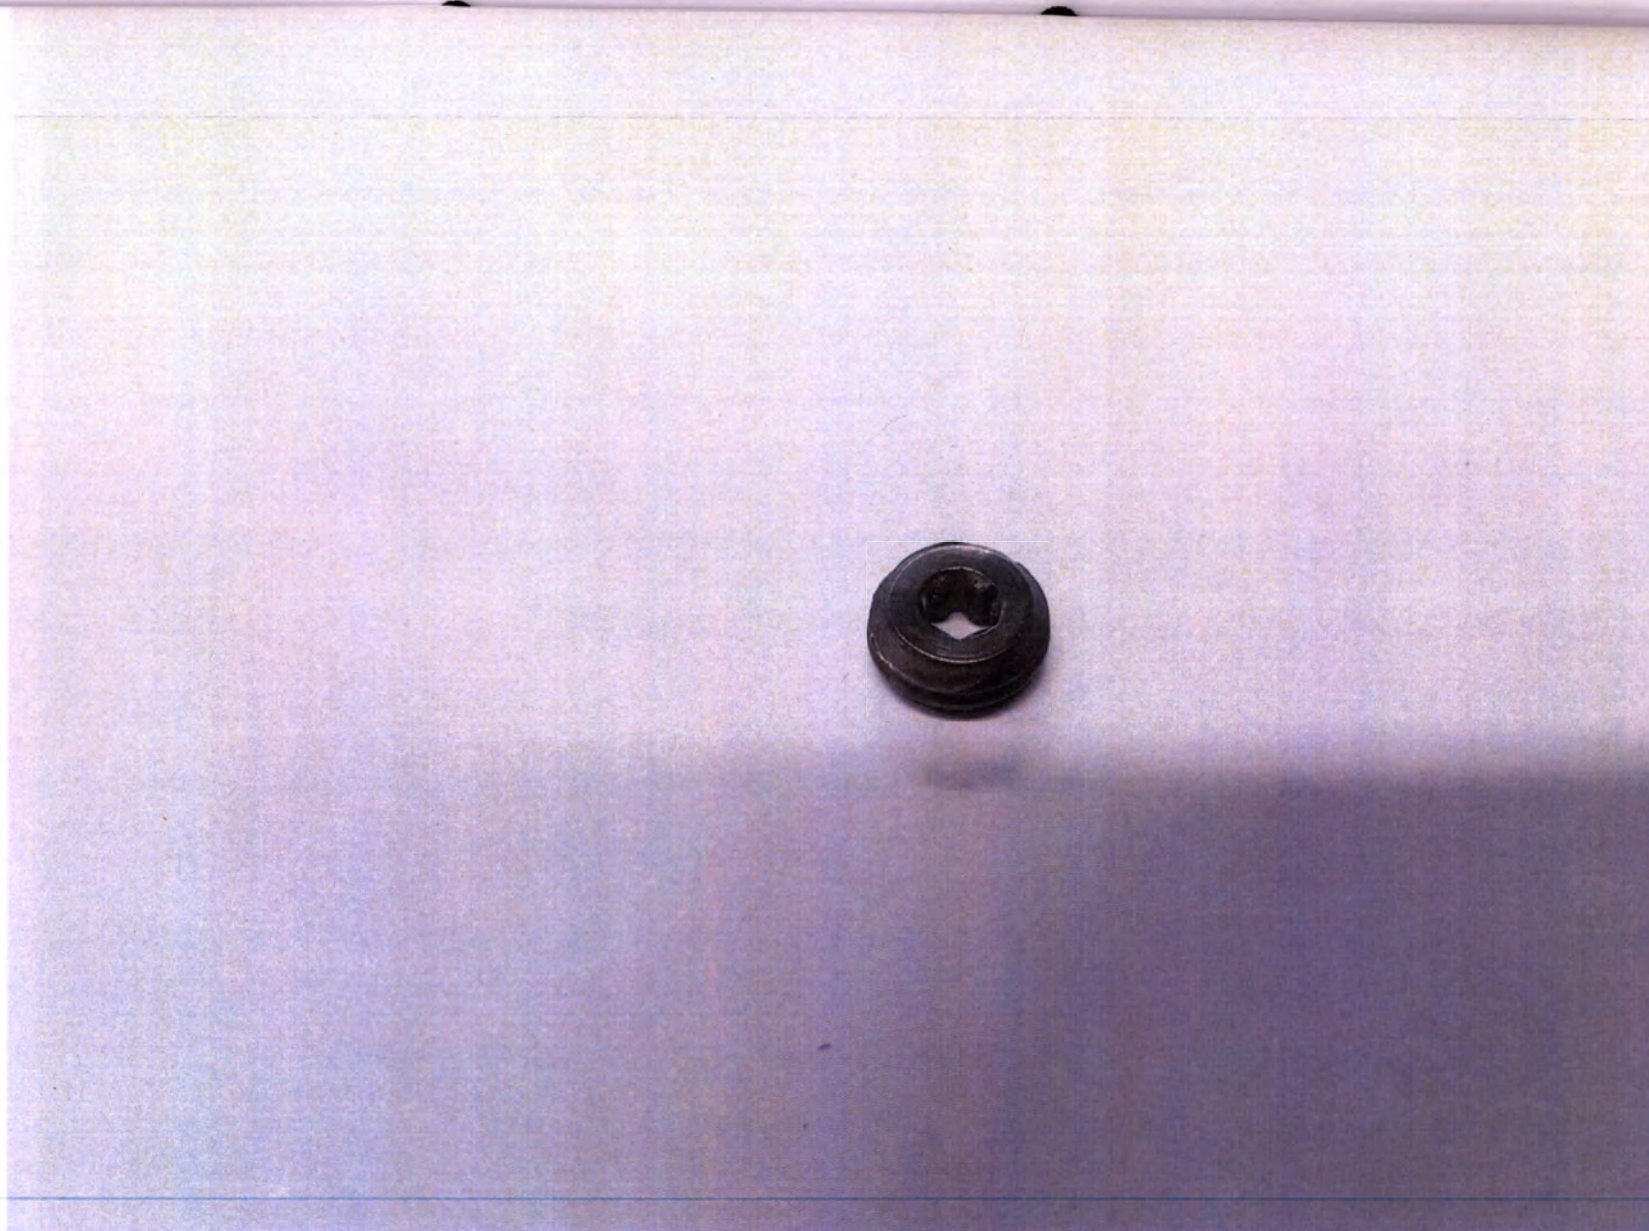


Фото 28. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт блокирующий малый

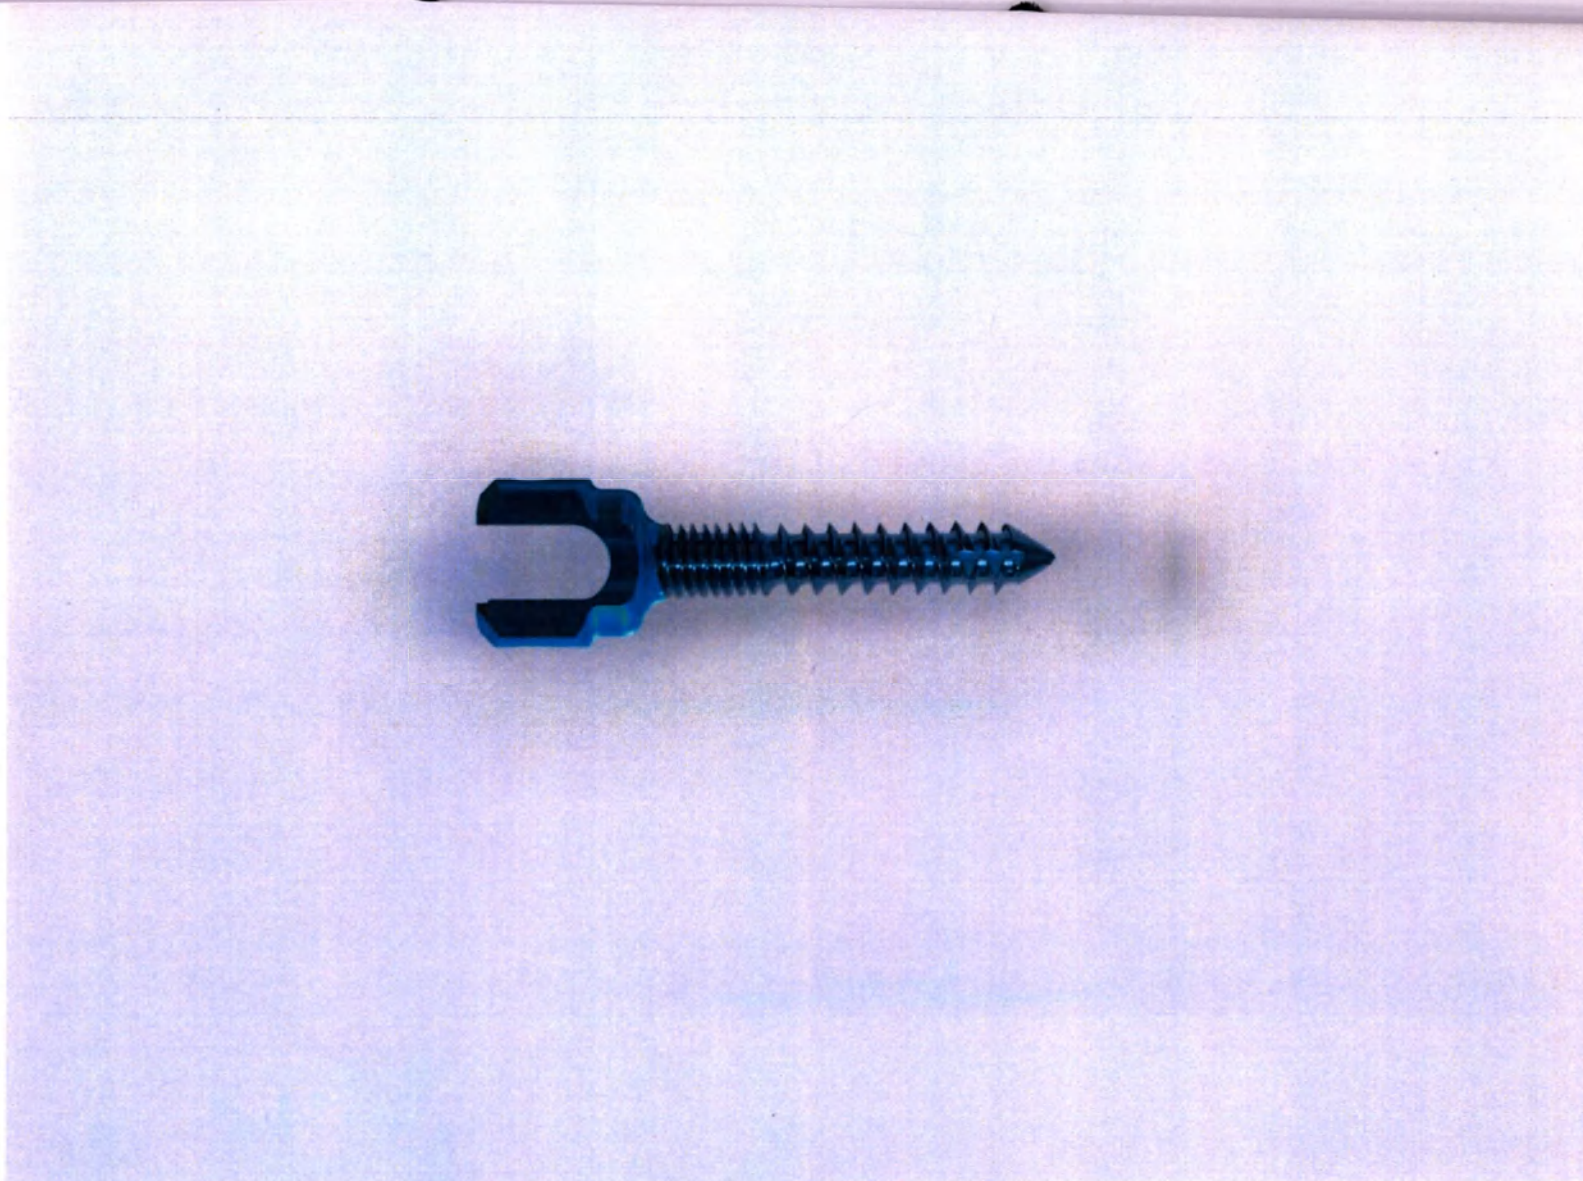


Фото 29. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт моноаксиальный «Sol»



Фото 30. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт полиаксиальный «Sol»

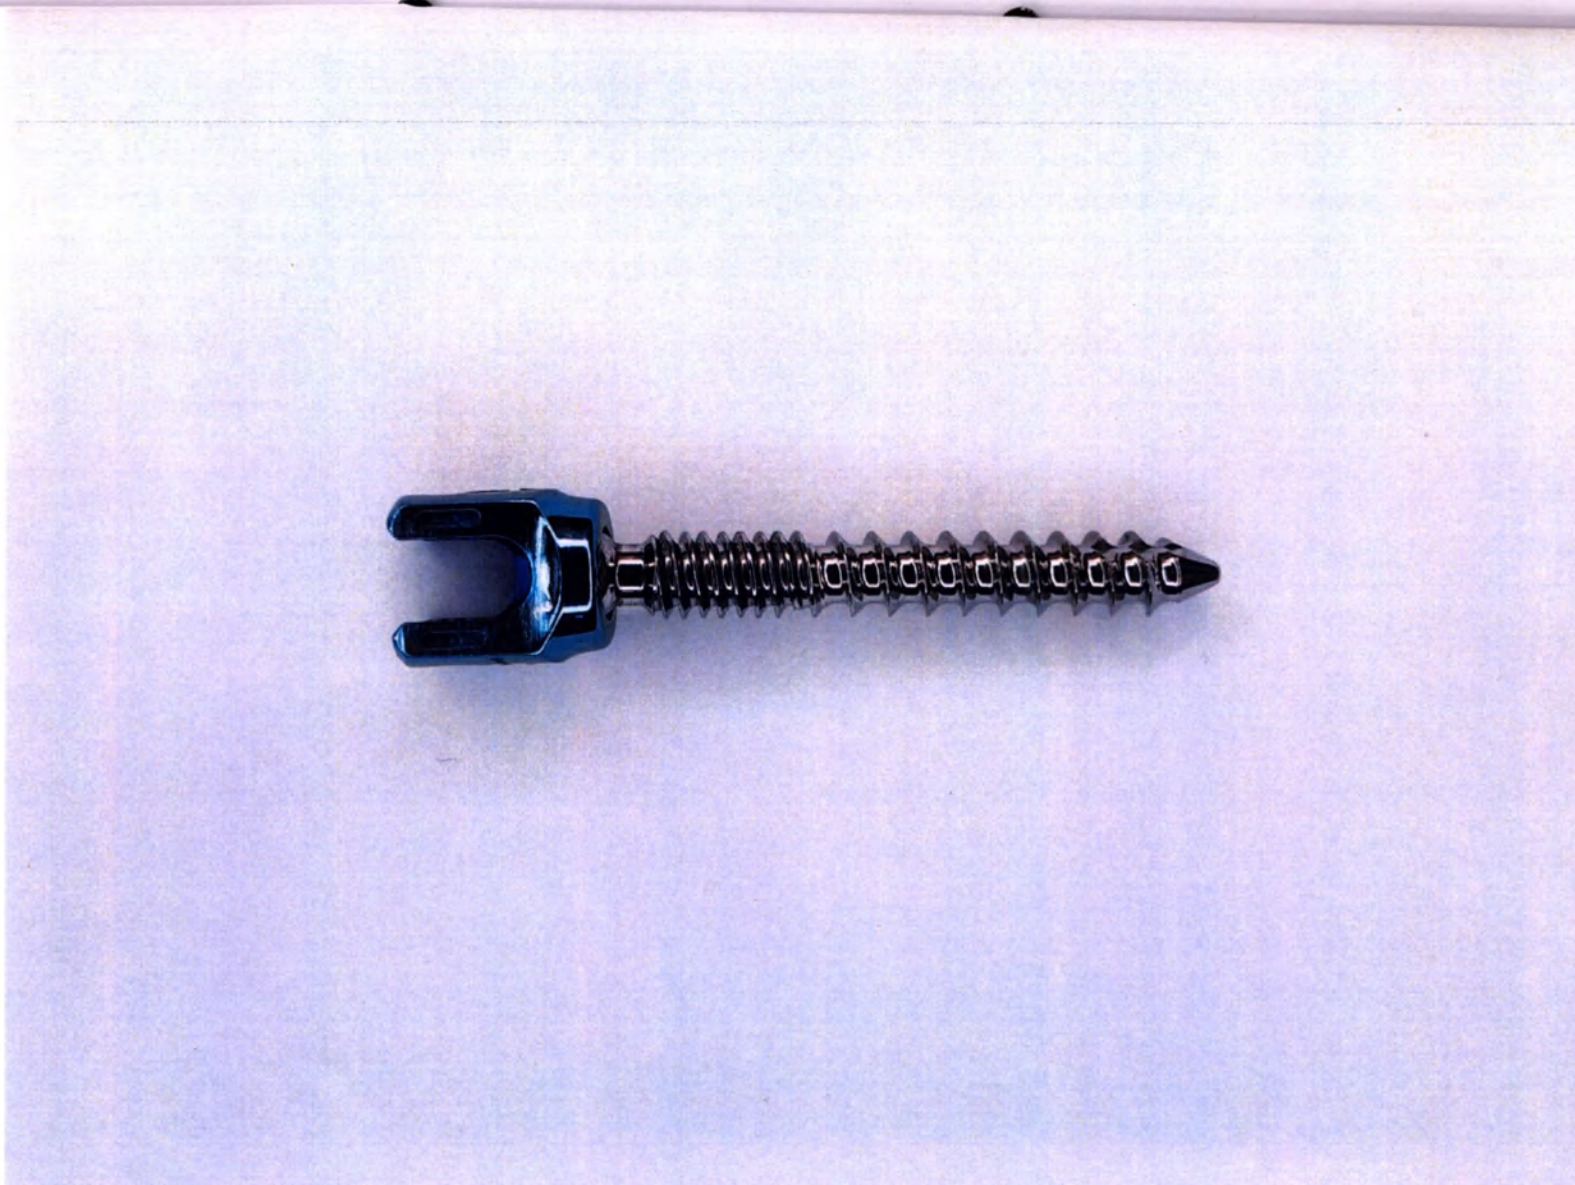


Фото 31. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт униаксиальный «Sol»



Фото 32. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт полиаксиальный канюлированный «Sol»

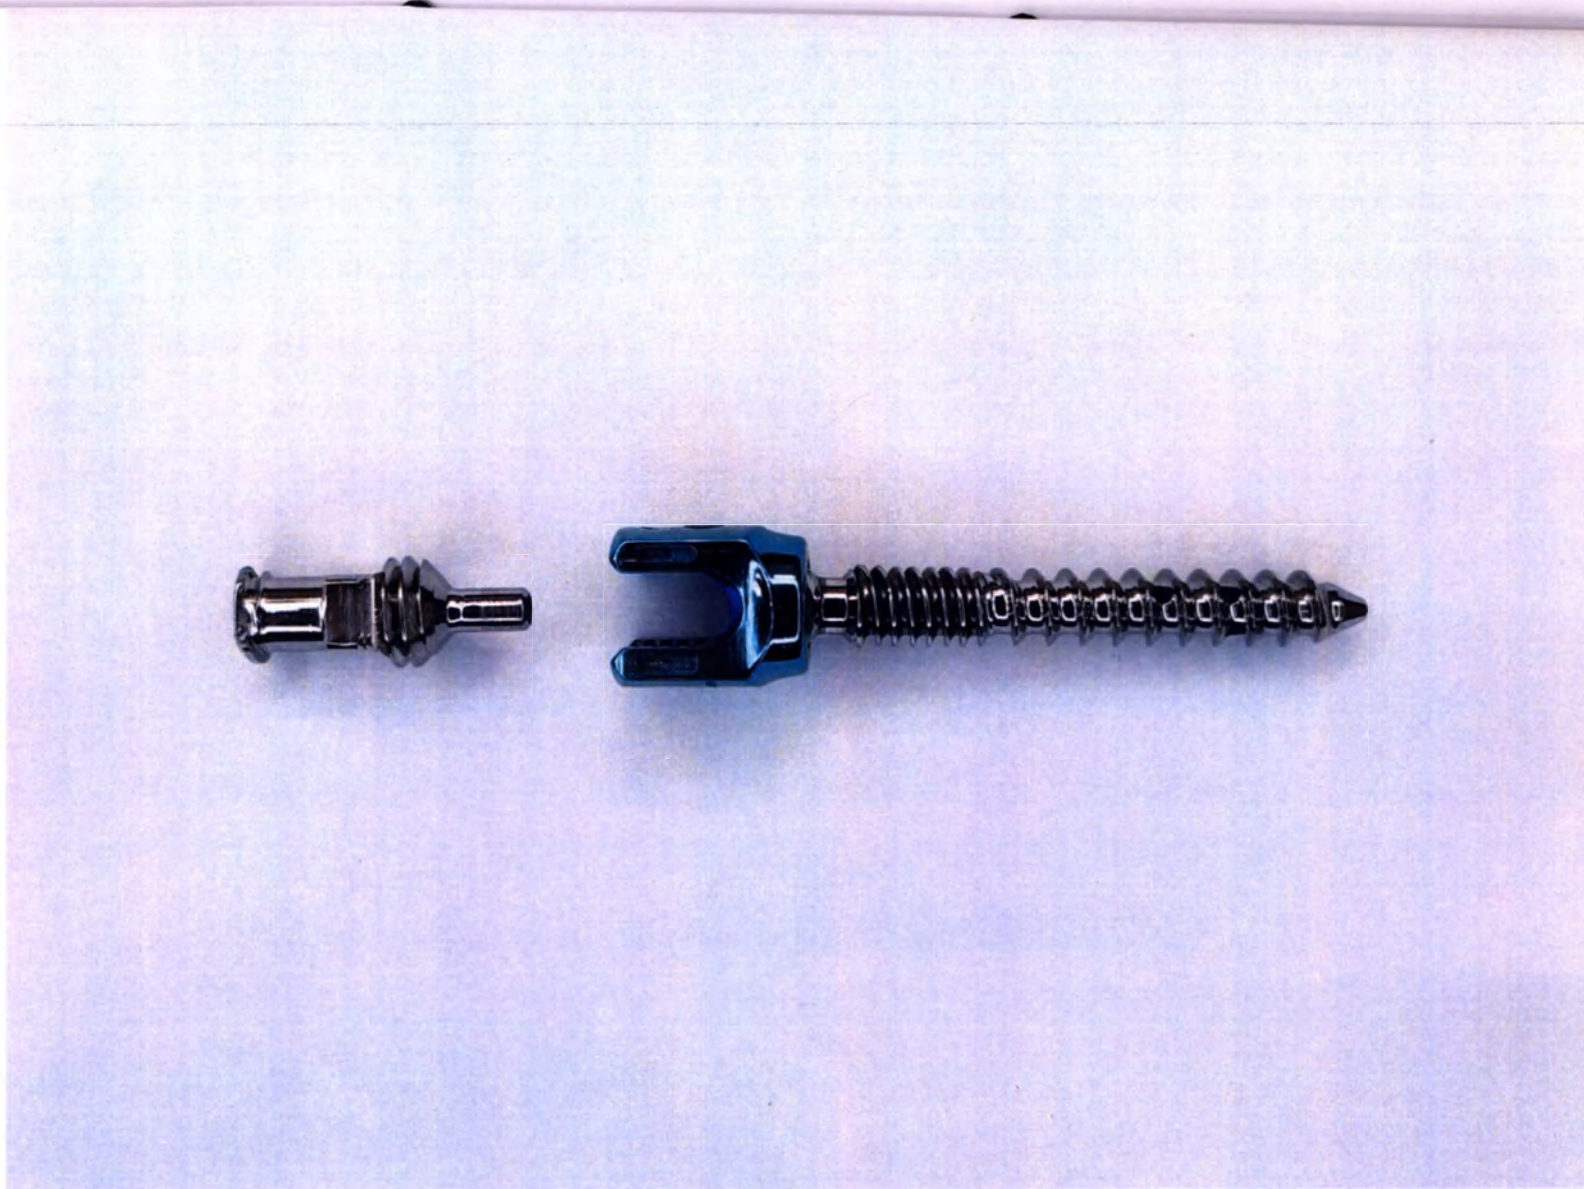


Фото 33. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт полиаксиальный фенестрированный «Sol» + Адаптер

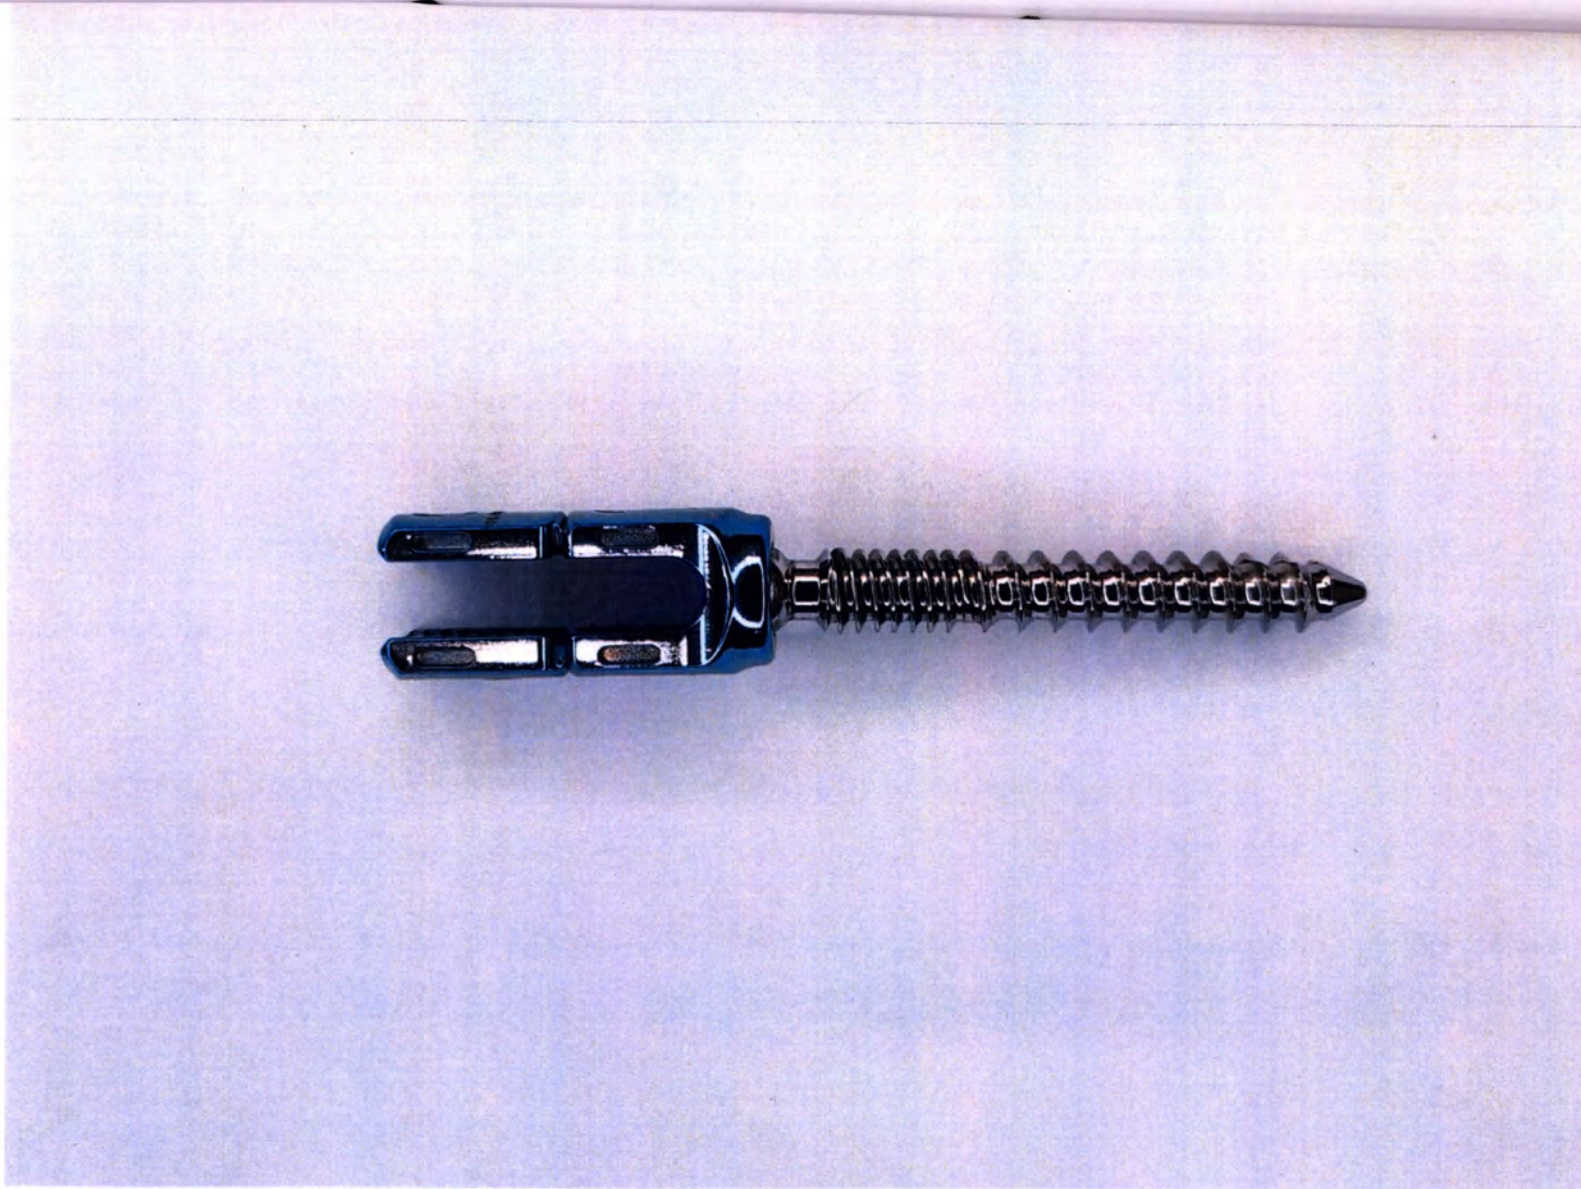


Фото 34. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт полиаксиальный редукционный «Sol»

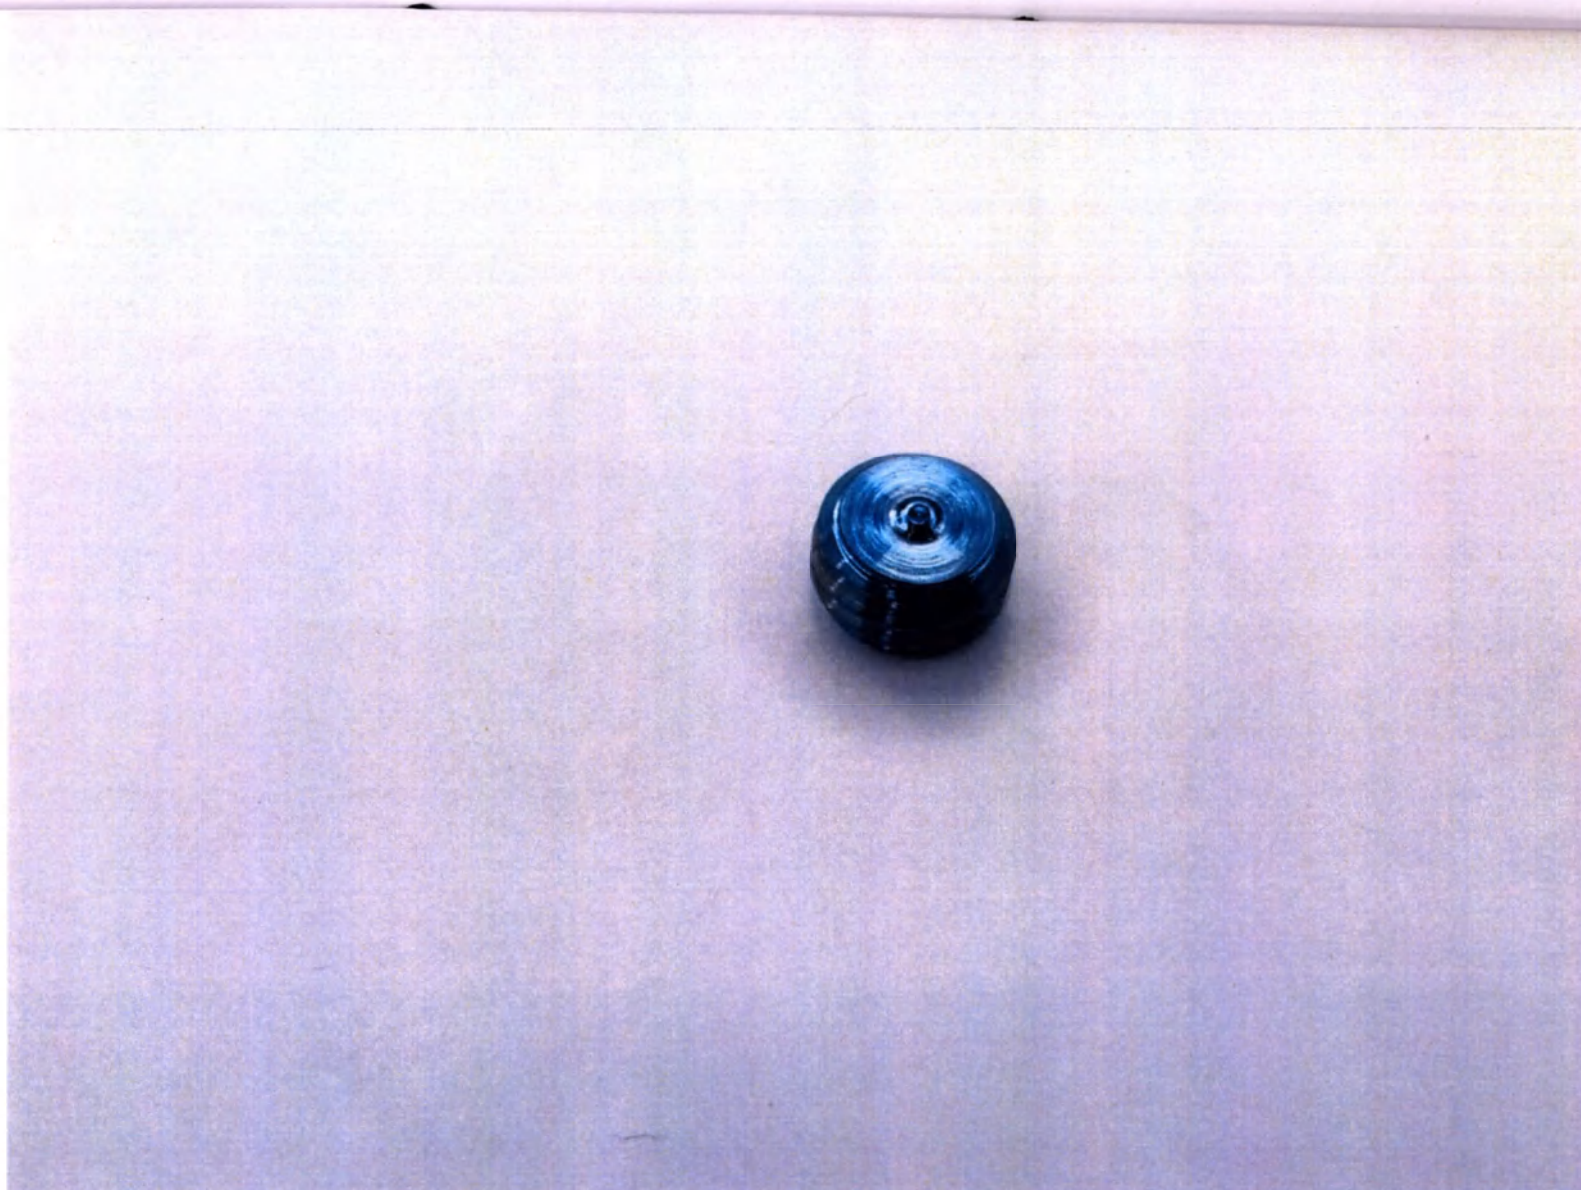


Фото 35. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт блокирующий с шипом



Фото 36. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Распорка раздвижная + Крышка

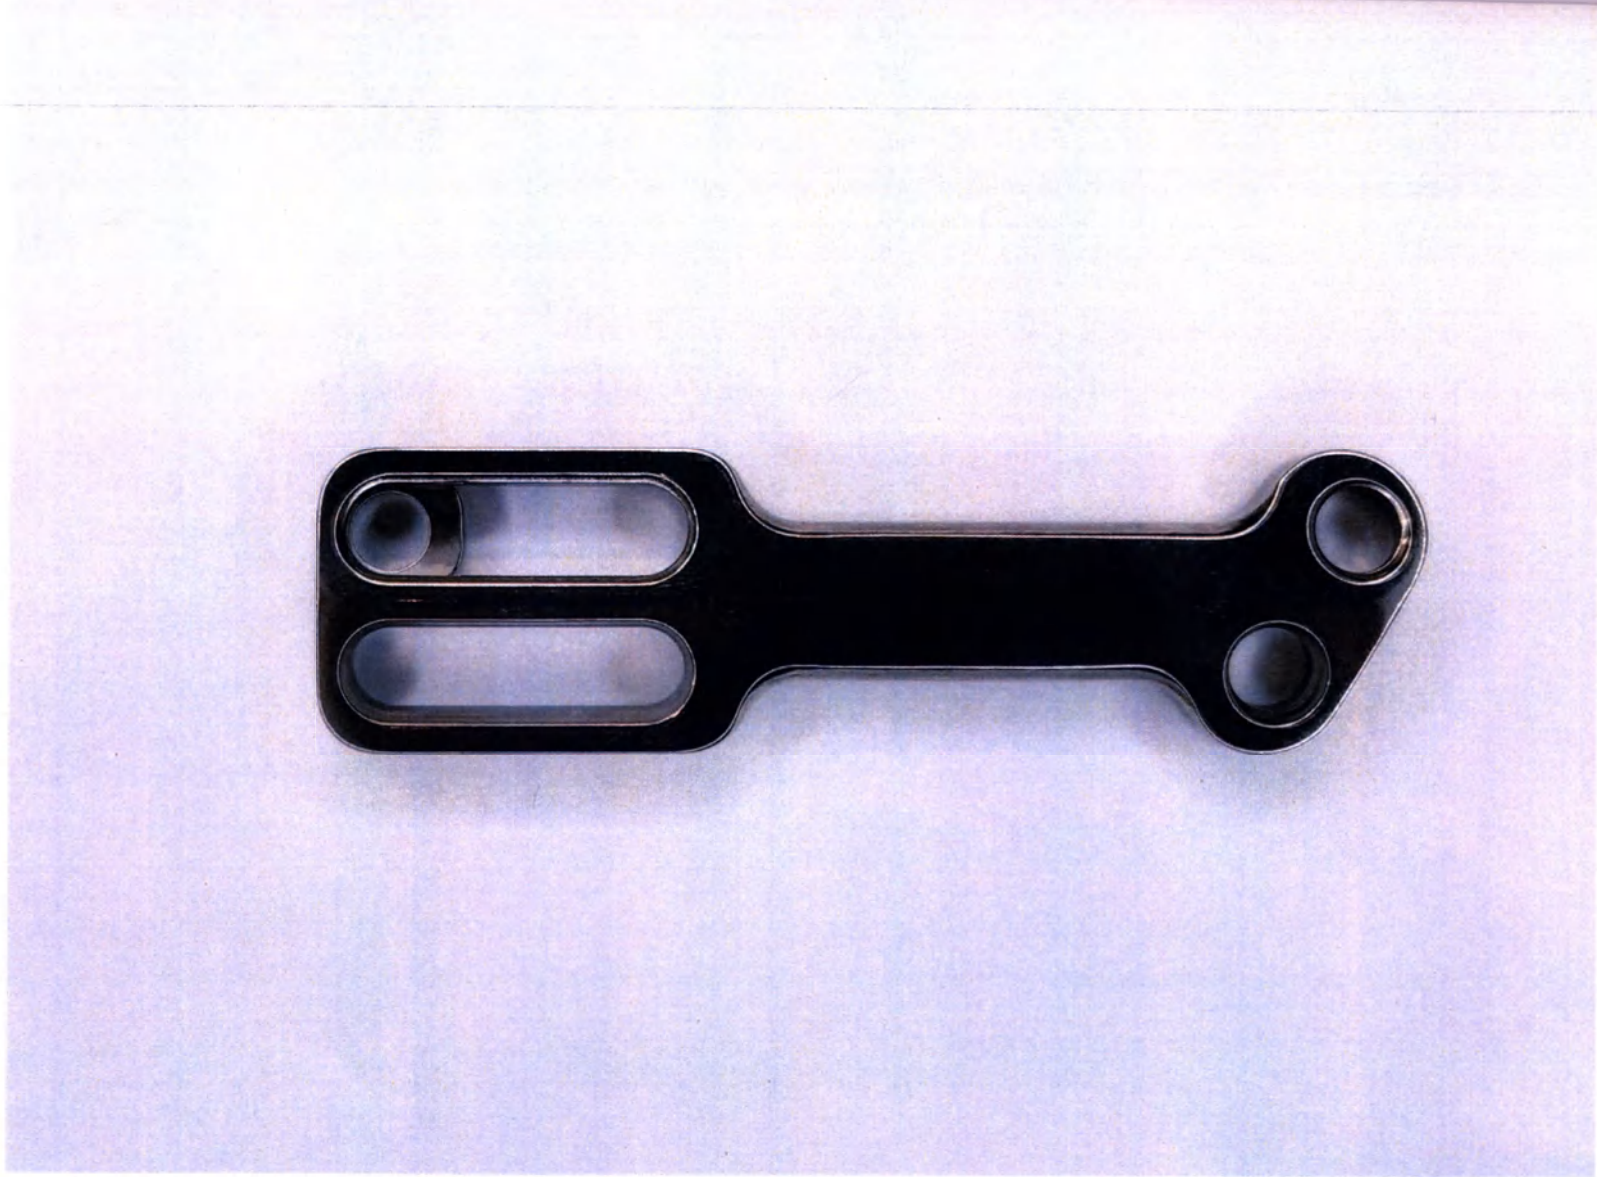


Фото 37. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Пластина стабилизирующая



Фото 38. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт блокирующий полиаксиальный

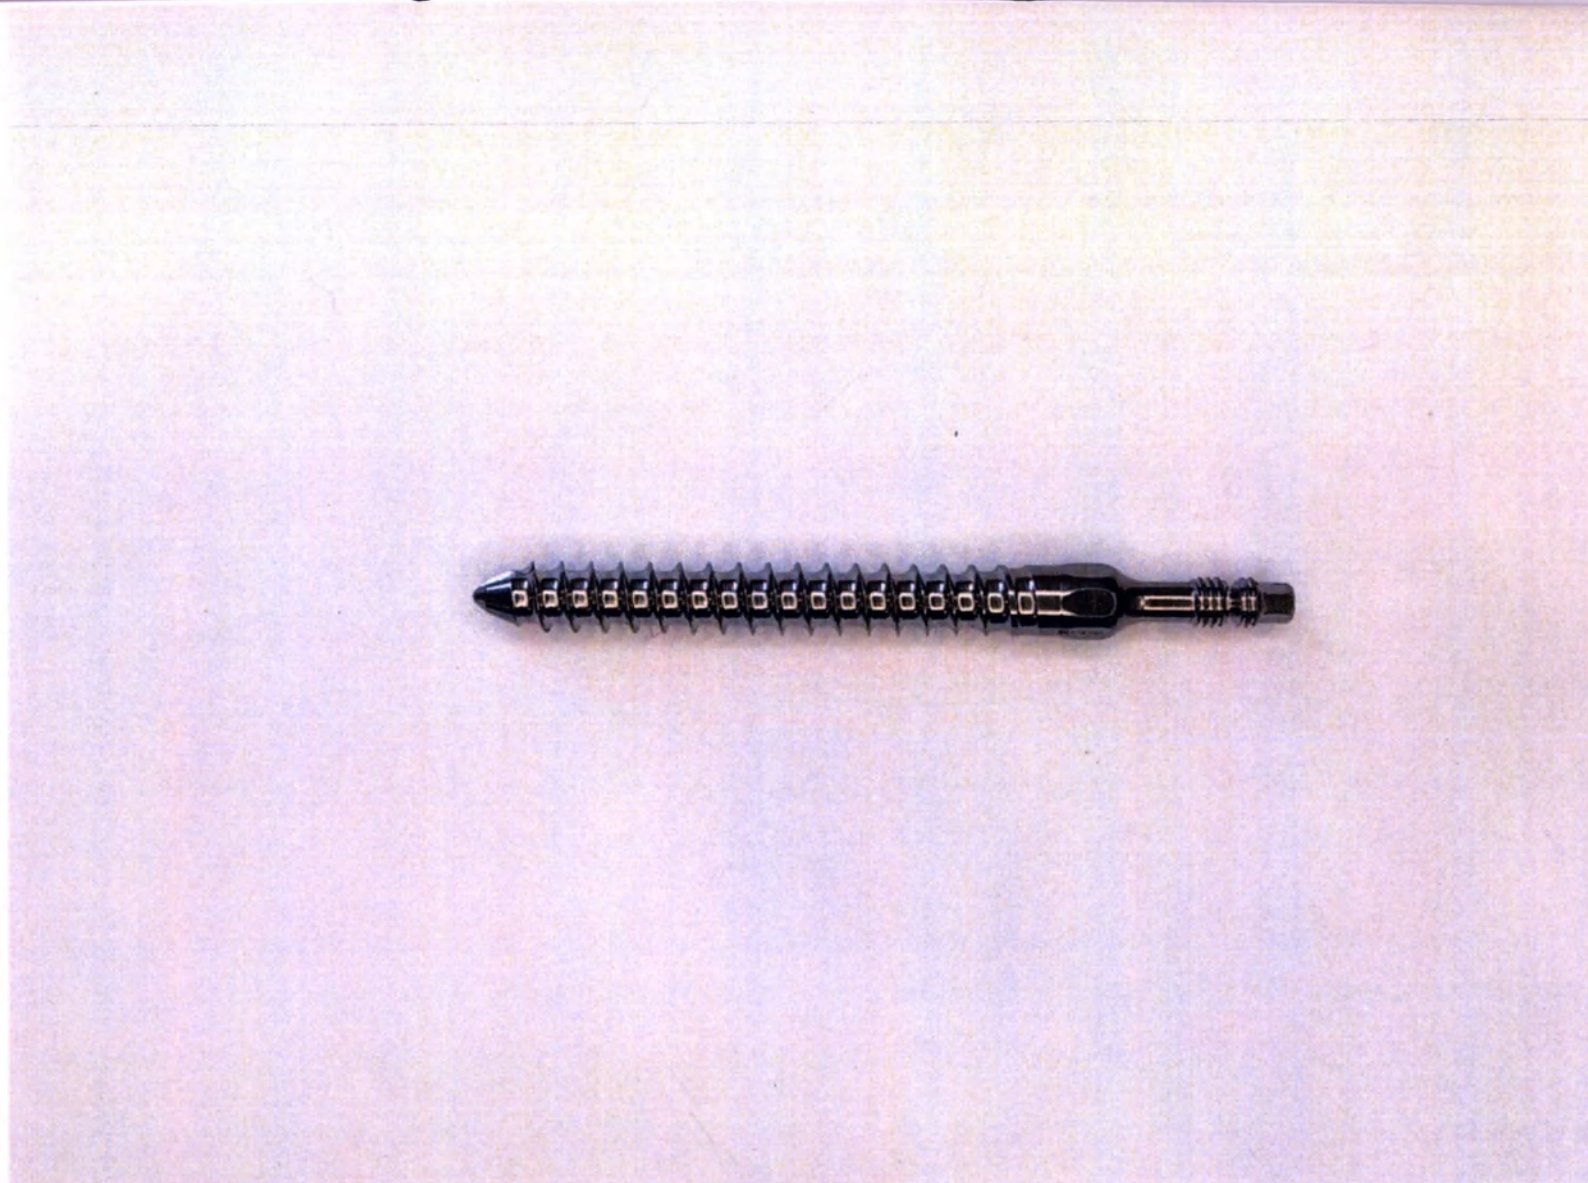


Фото 39. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт спинальный

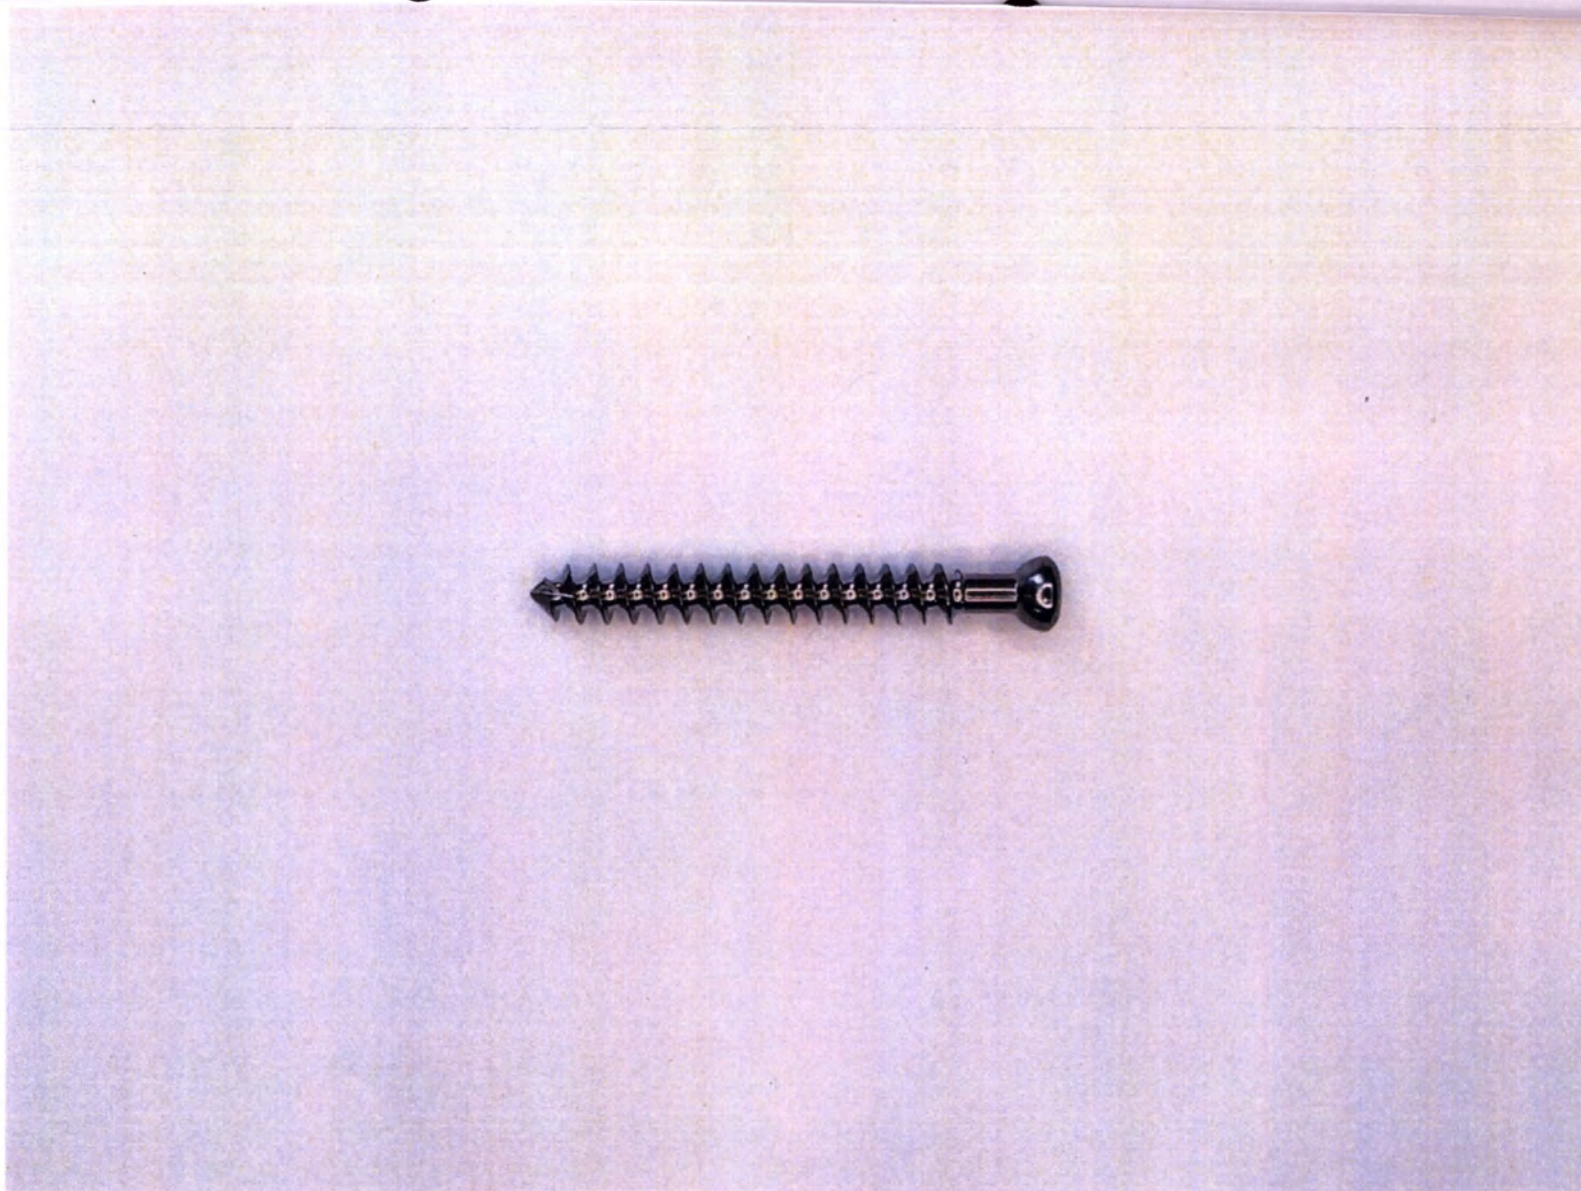


Фото 40. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт со спонгиозной резьбой

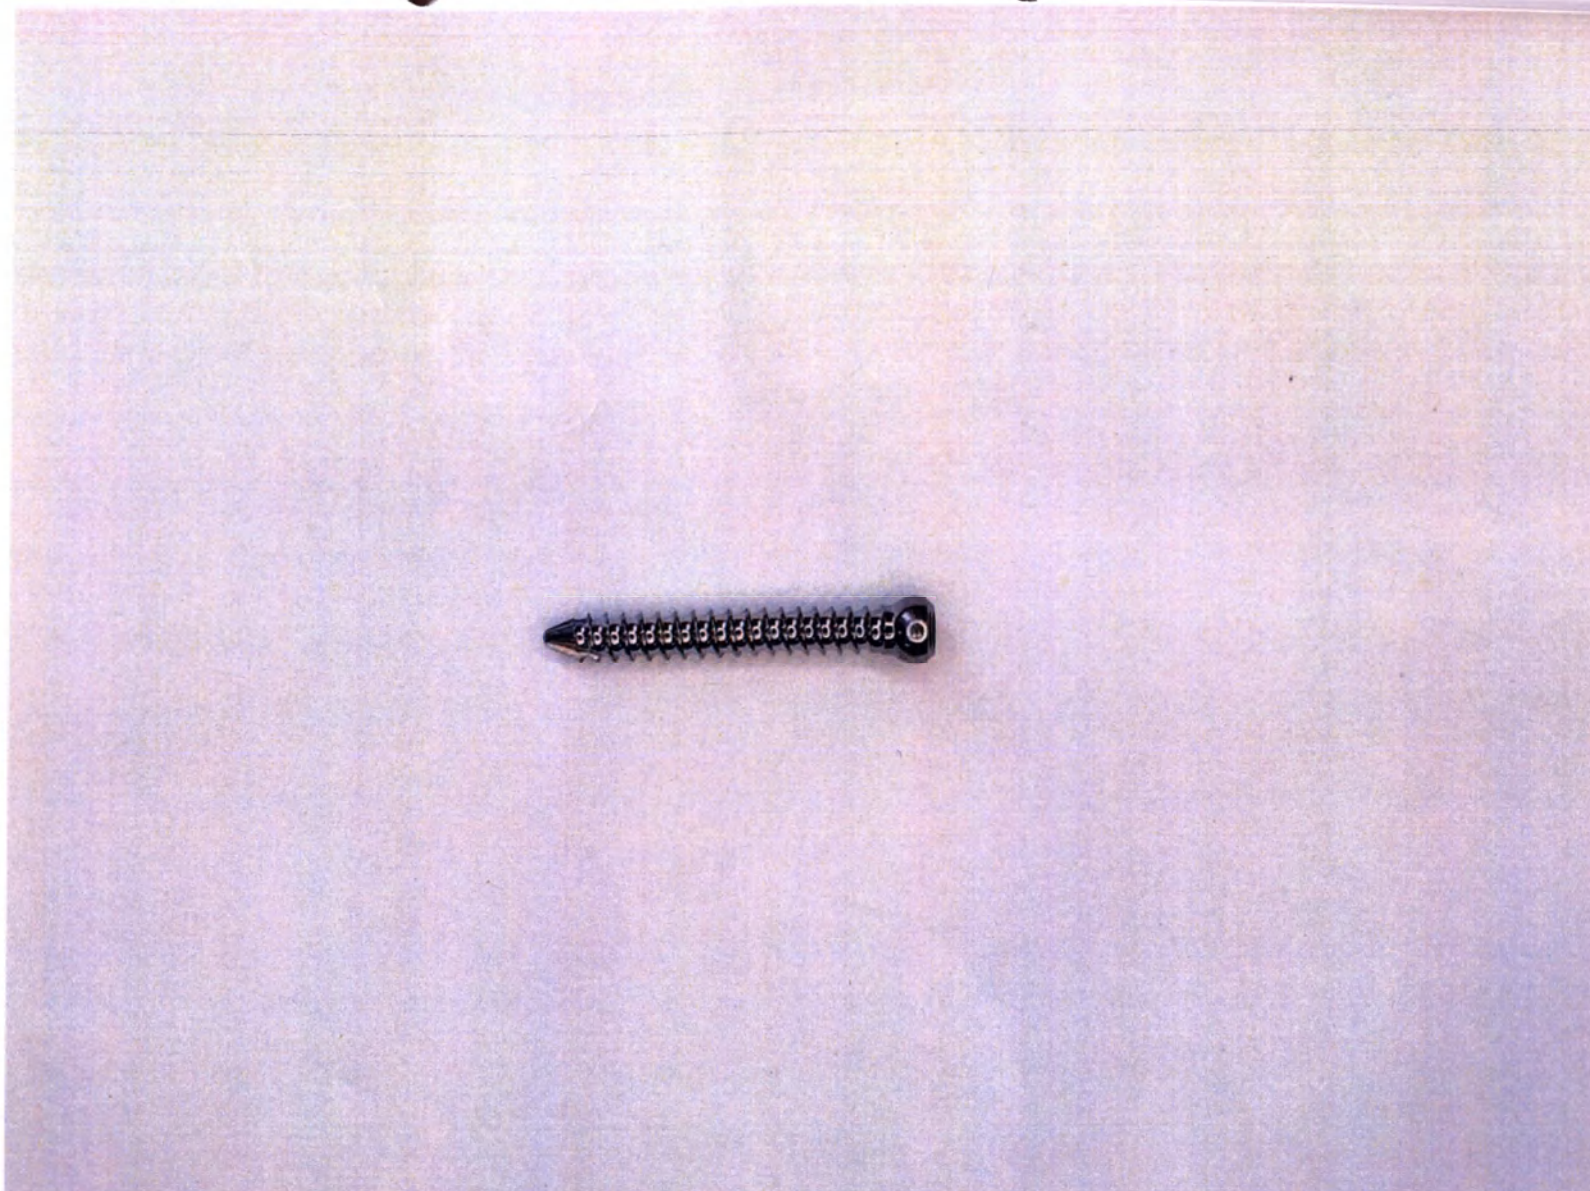


Фото 41. «Система имплантатов для нейрохирургии по ТУ 32.50.22-001-74573326-2017, в составе (см. Приложение)»:
Винт с кортикальной резьбой

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 42 (сорок два)
листов

«28» марта 2024г.
Чигарин Д.В.

