



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

АО «Фрезениус СП»

115054, Россия, Москва
Ул. Валовая, д. 35
т/ф +7 495 789-6454
e-mail: msk.office@fmc-ag.com
web: www.freseniusmedicalcare.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Менеджер по регистрации
медицинских изделий
АО «Фрезениус СП»

Санникова Е.И.


«22» апреля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset
в вариантах исполнения**


1. Фотографическое изображения общего вида медицинского изделия «Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset-R – 26 шт. в групповой упаковке с инструкцией по применению (1 шт.):»:

- Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset-R:

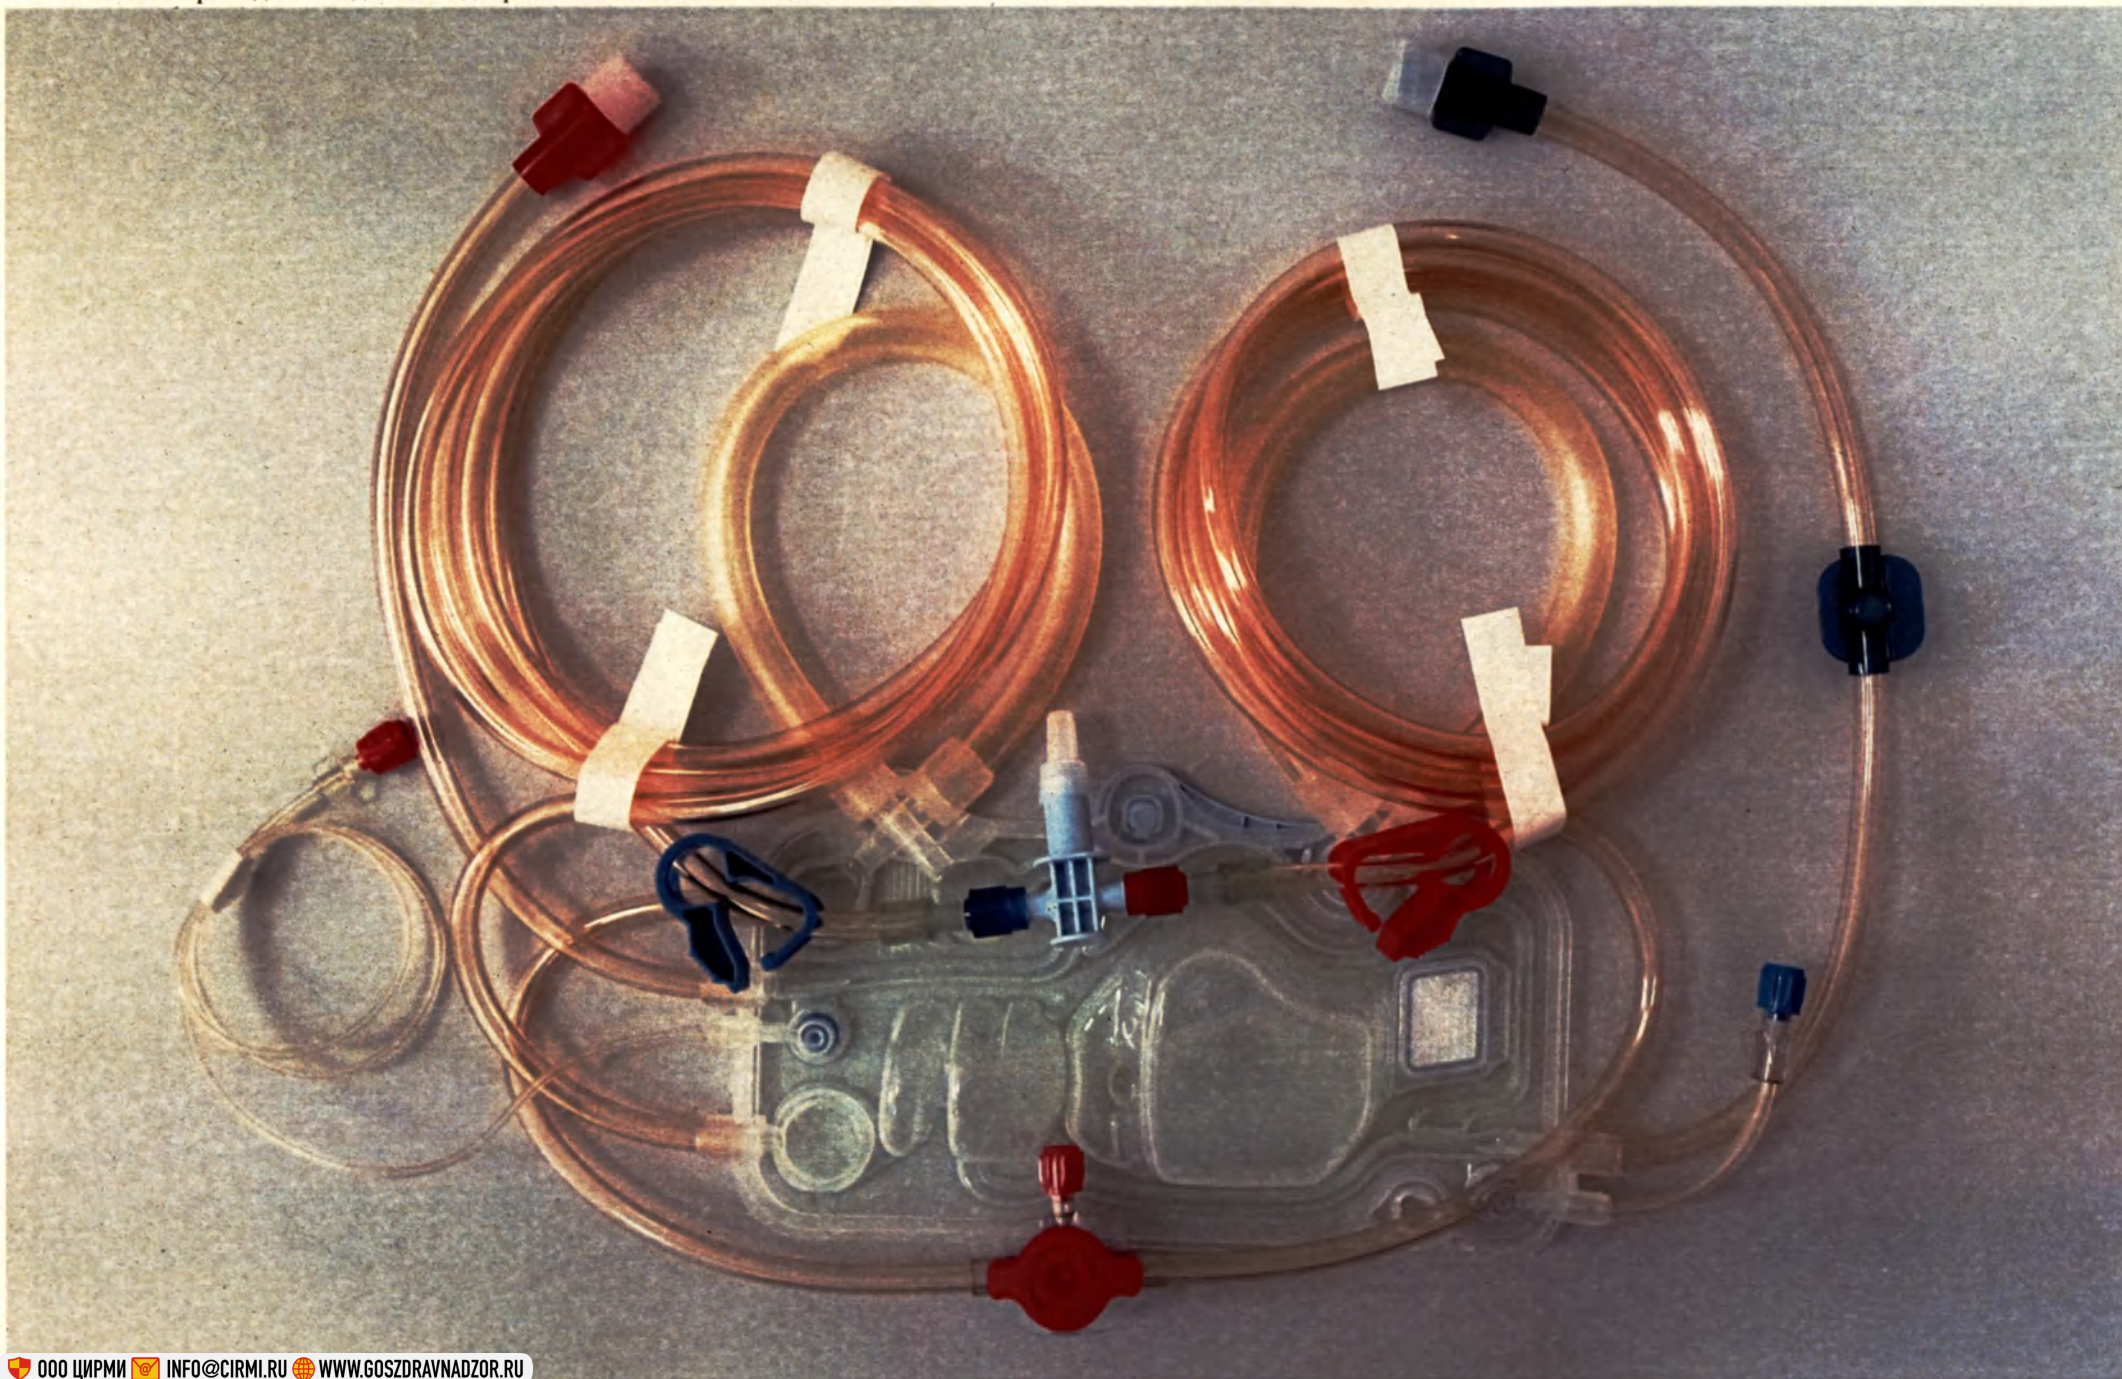


2. Фотографическое изображения общего вида медицинского изделия «Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset BVM-R – 26 шт. в групповой упаковке с инструкцией по применению (1 шт.):»:

- Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset BVM-R:

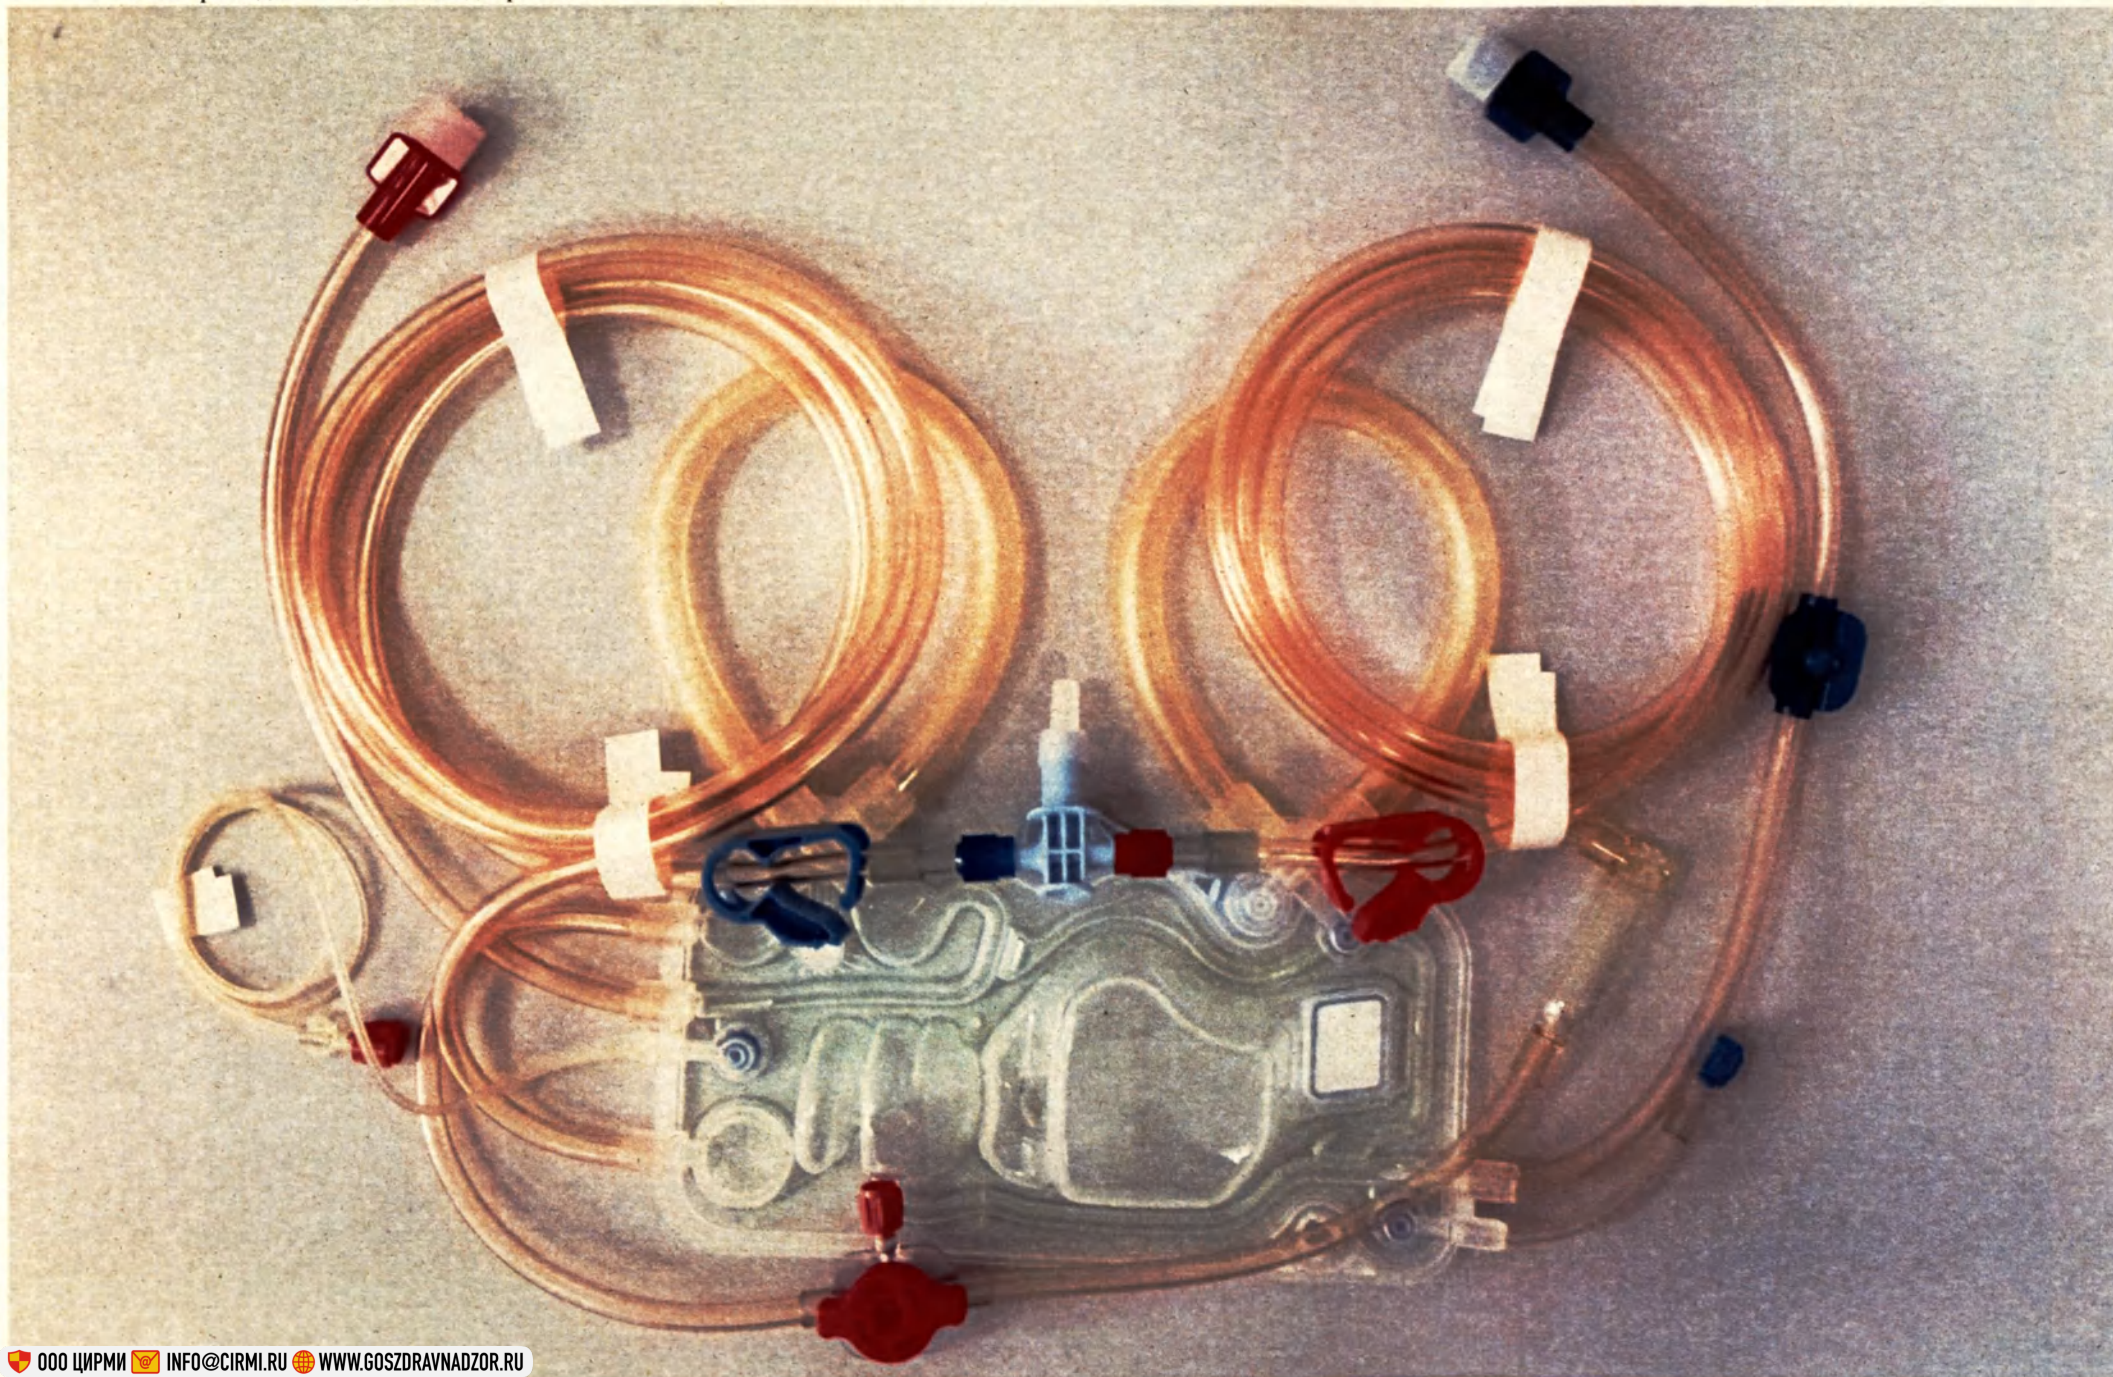


3. Фотографическое изображения общего вида медицинского изделия «Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset L-R – 26 шт. в групповой упаковке инструкции по применению (1 шт.)»:

- Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset L-R:

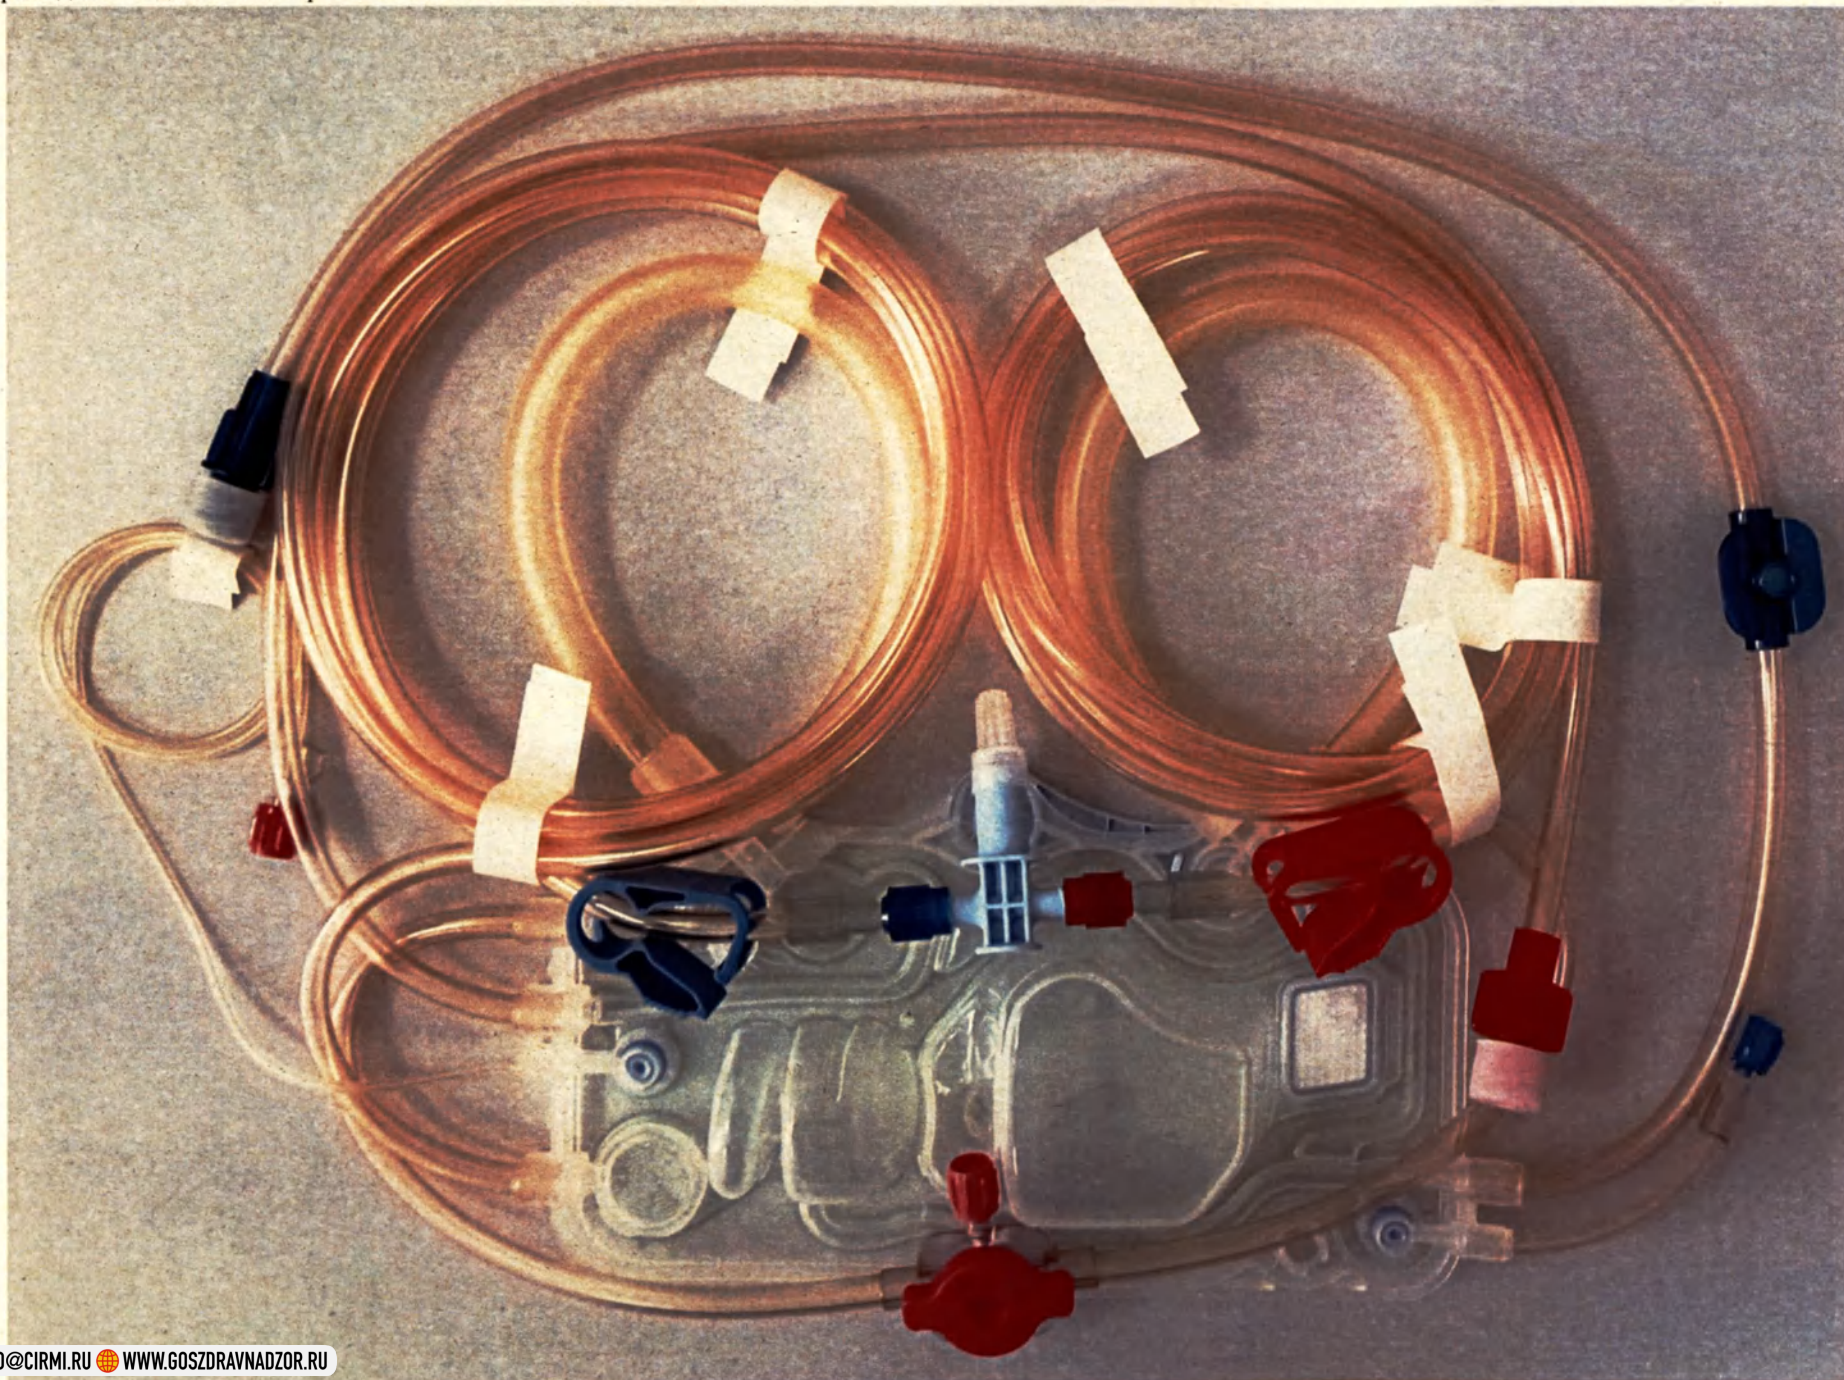


4. Фотографическое изображения общего вида медицинского изделия «Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset BVM L-R – 26 шт. в упаковке с инструкцией по применению (1 шт.):

- Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset BVM L-R:

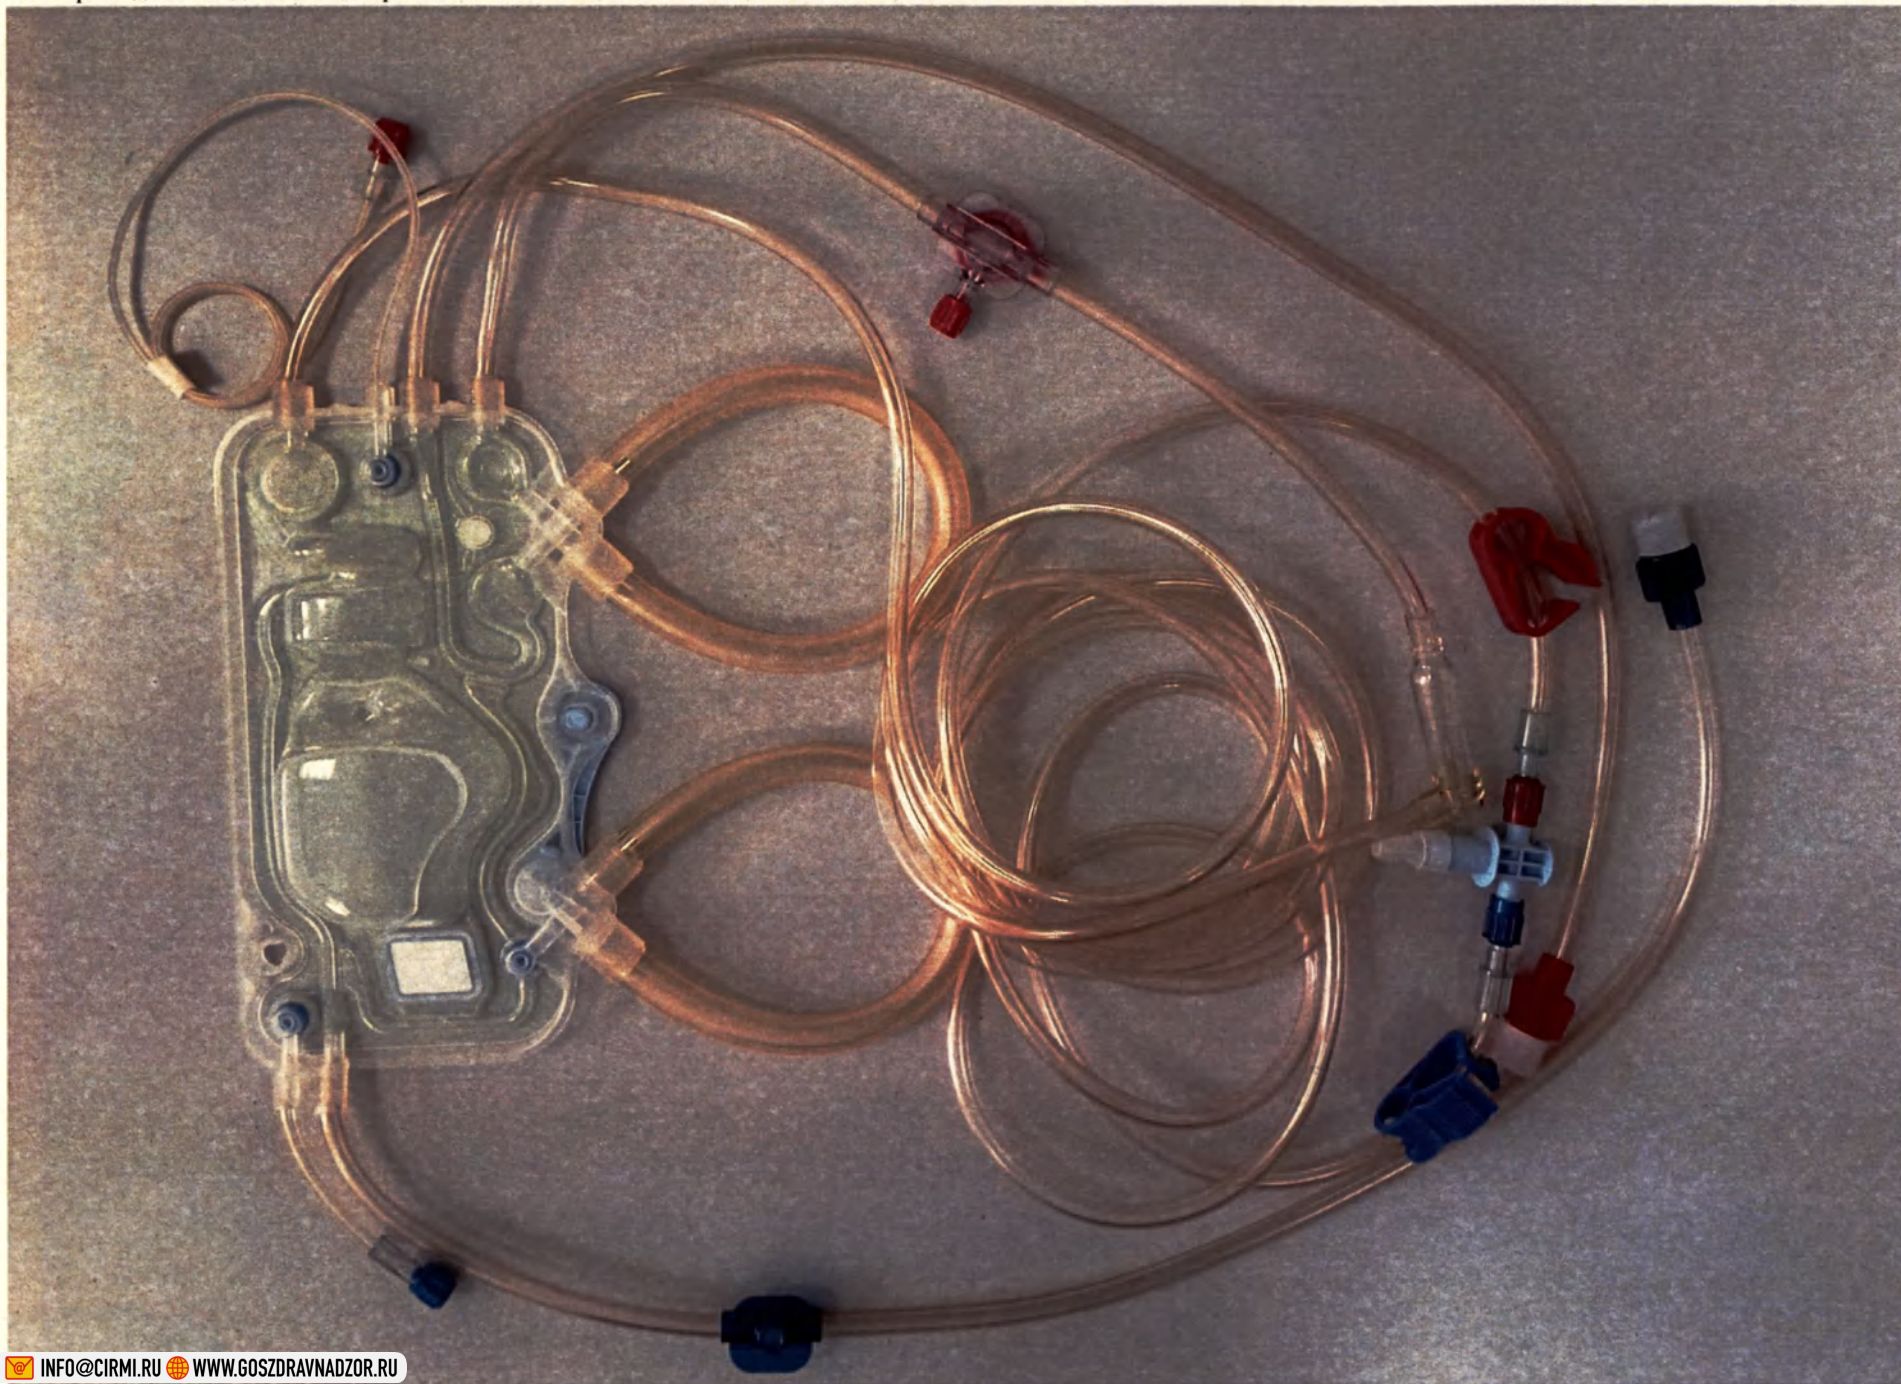


5. Фотографическое изображения общего вида медицинского изделия «Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset Low Volume-R – 24 шт. в упаковке с инструкцией по применению (1 шт.):»:

- Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset Low Volume-R:

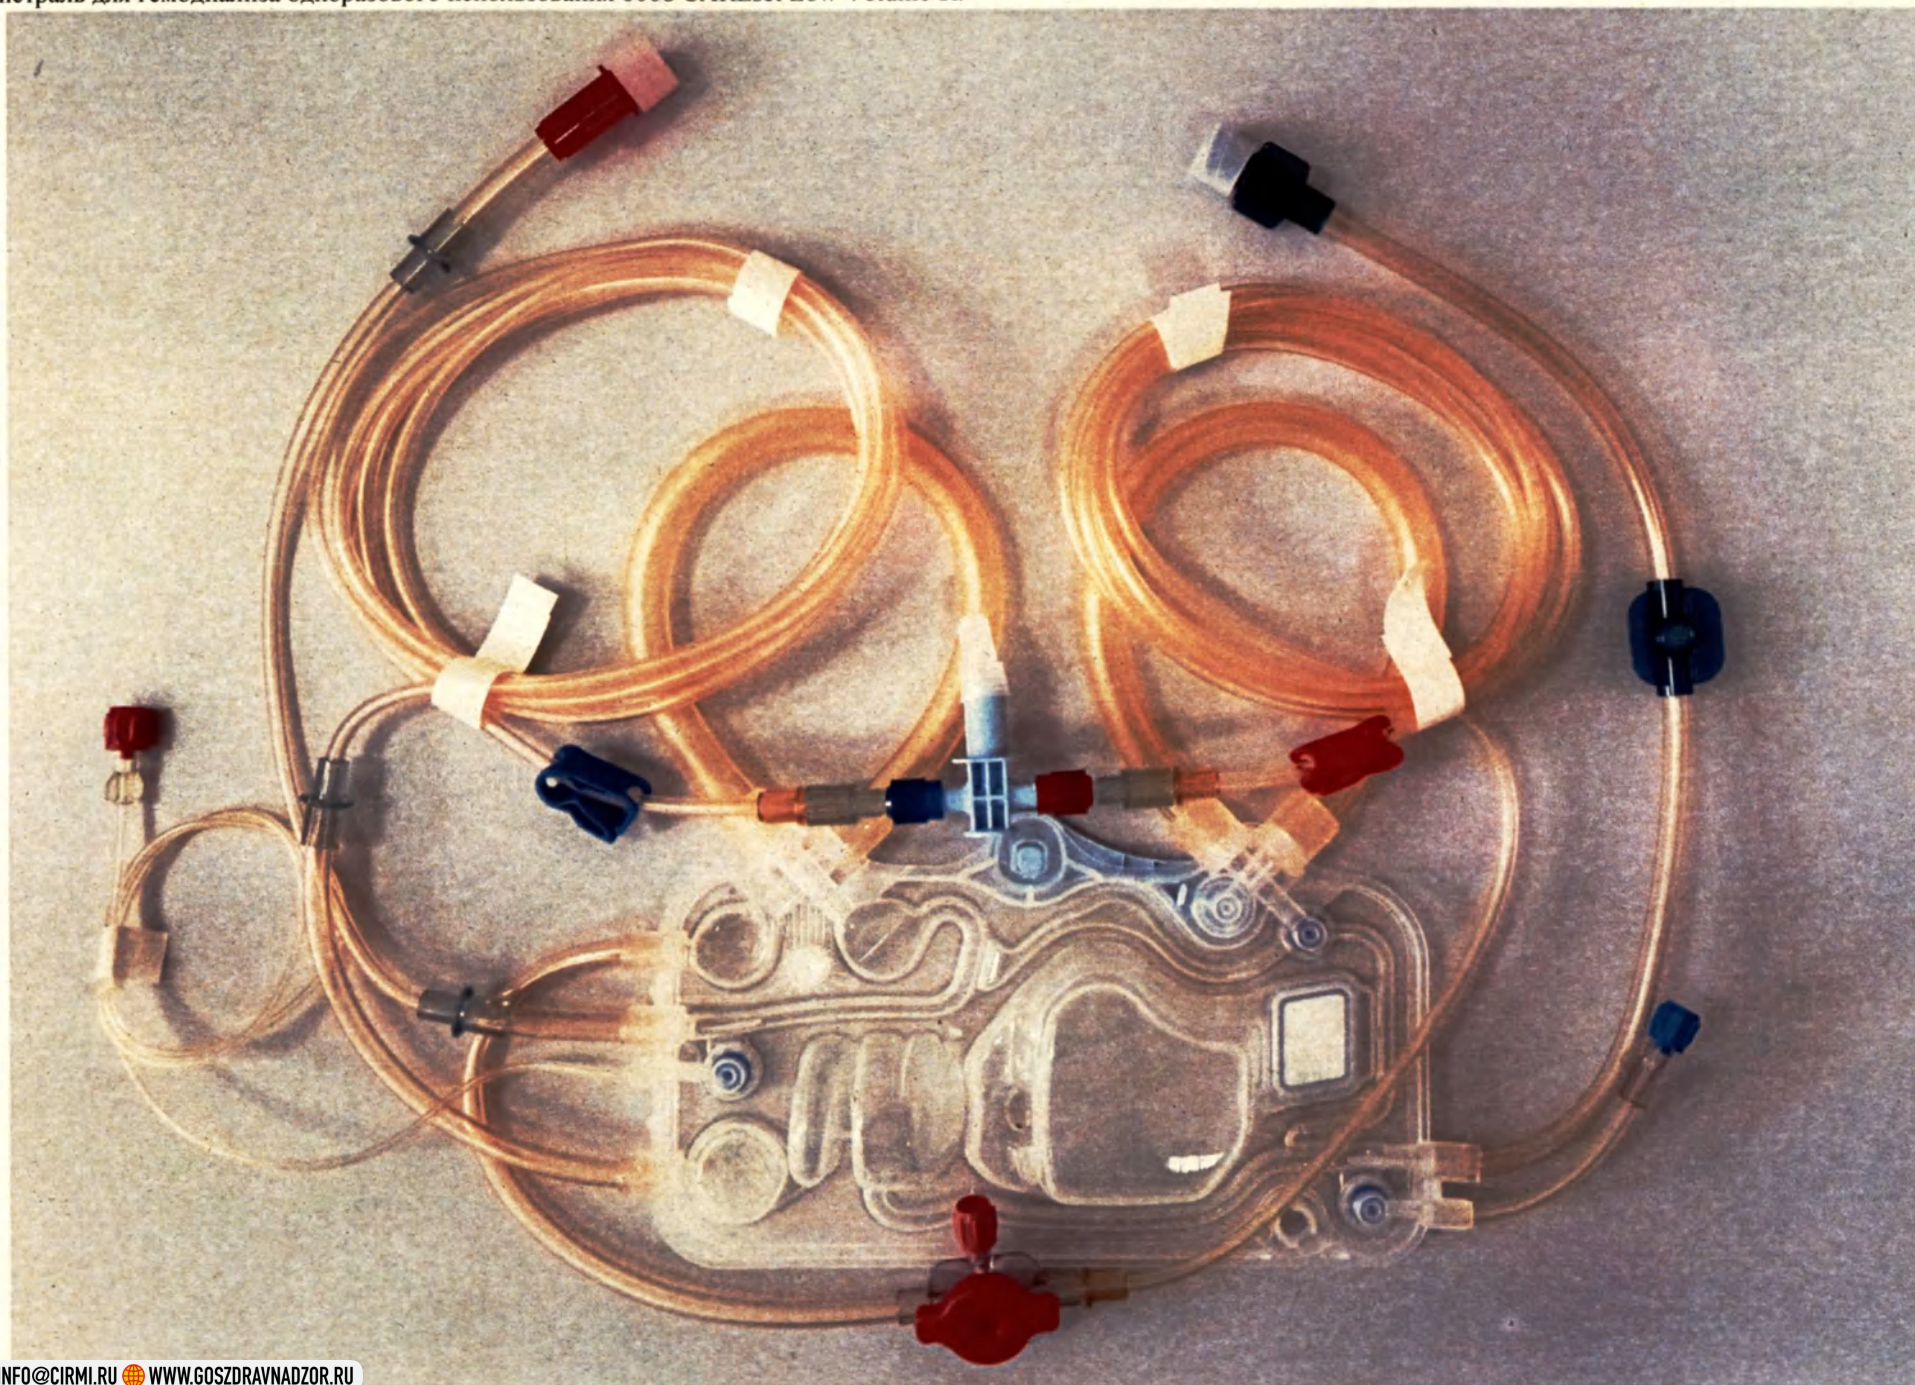


6. Фотографическое изображения общего вида медицинского изделия «Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset Low Volume BVM-R групповой упаковке с инструкцией по применению (1 шт.):


- Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset Low Volume BVM-R:

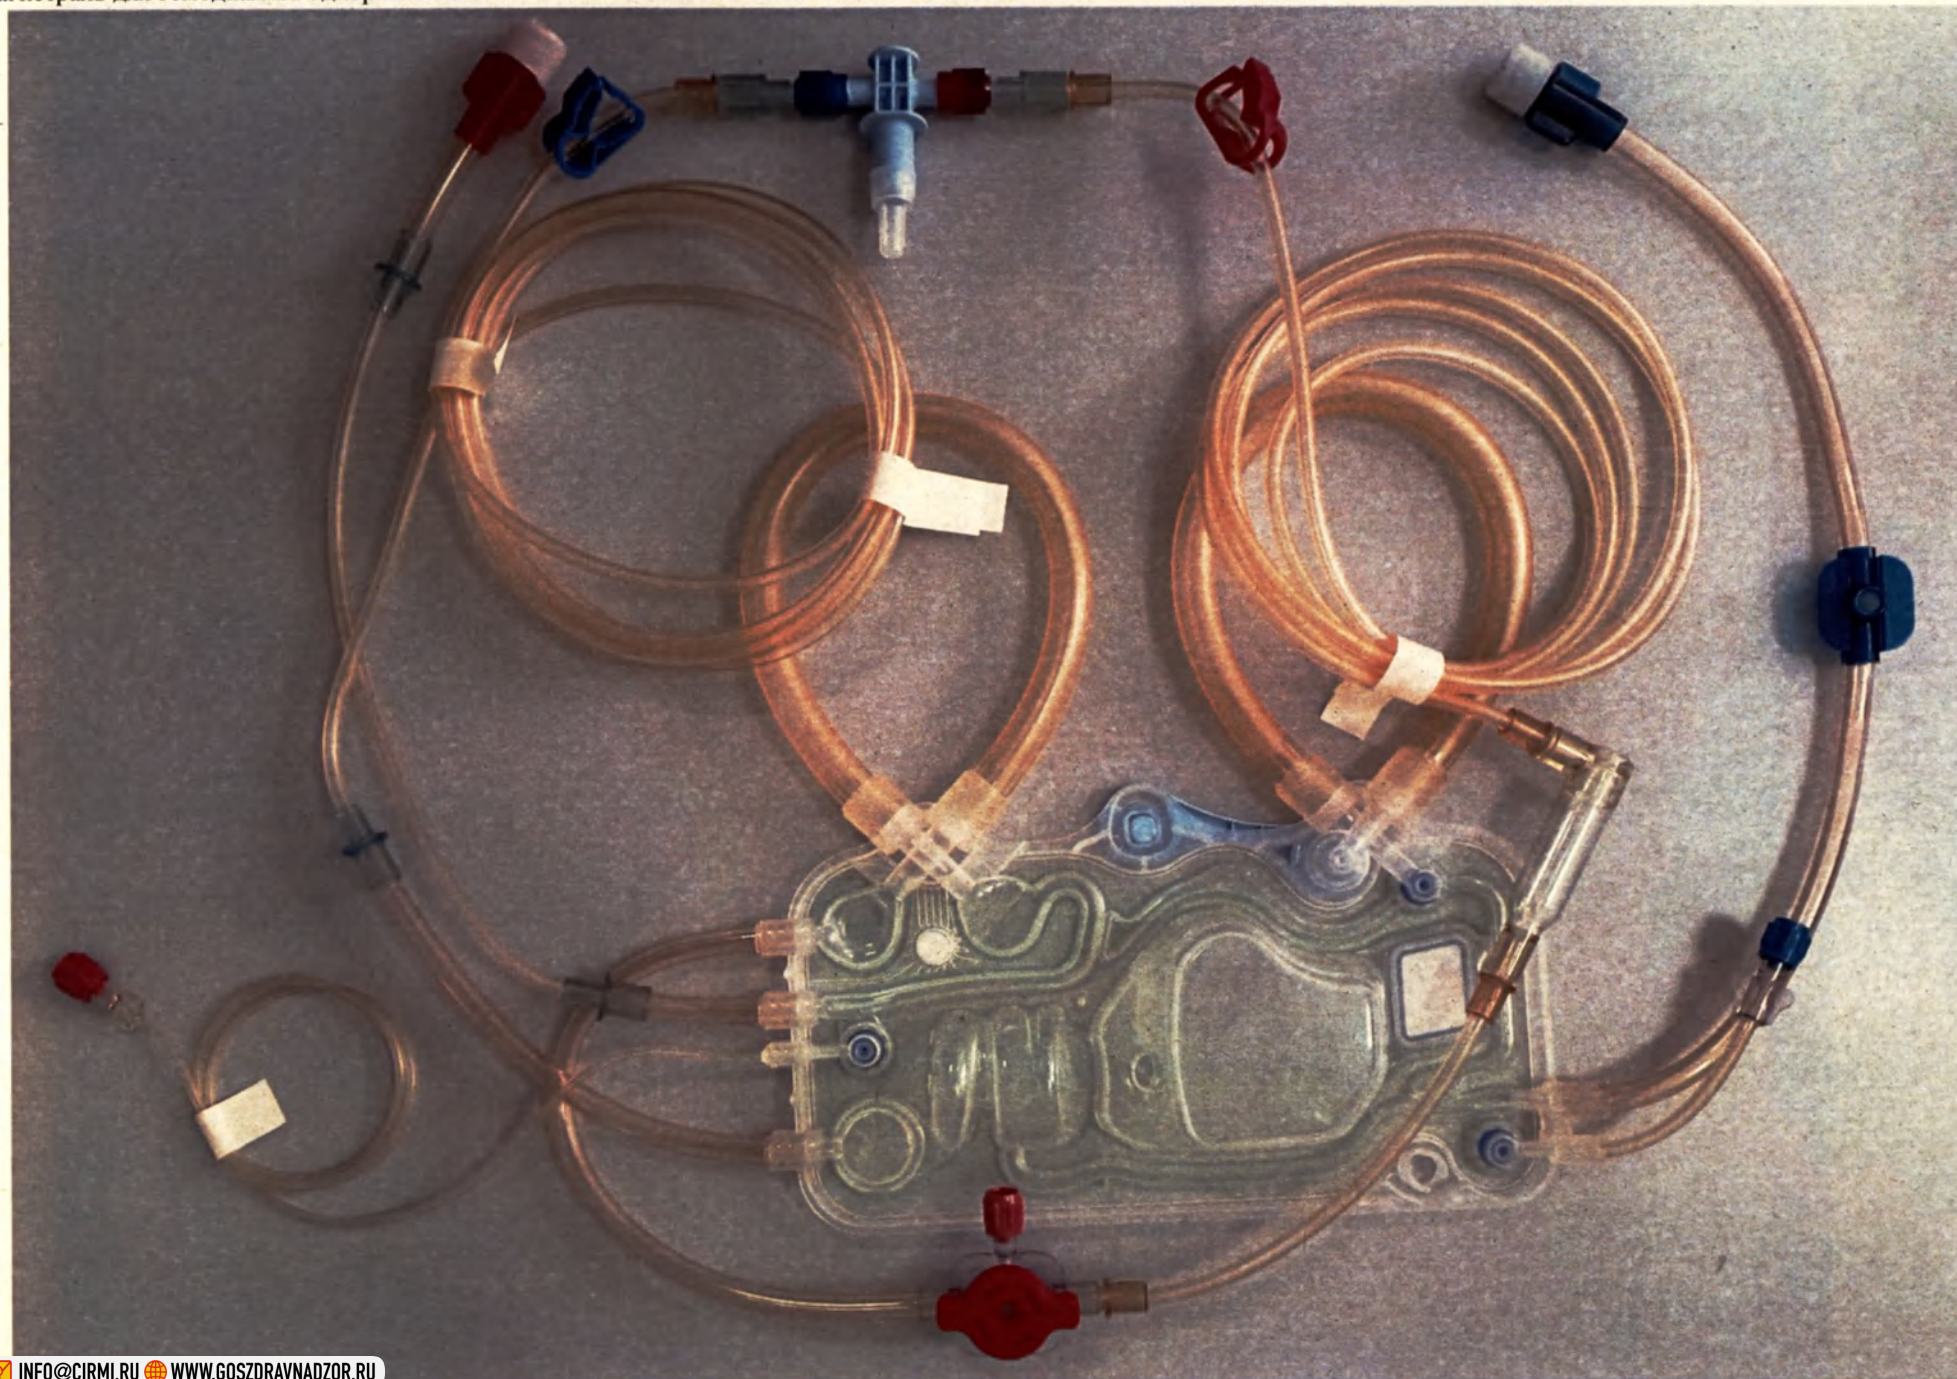

7. Фотографическое изображения общего вида медицинского изделия в индивидуальной первичной упаковке на примере Магистральной для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset-R:

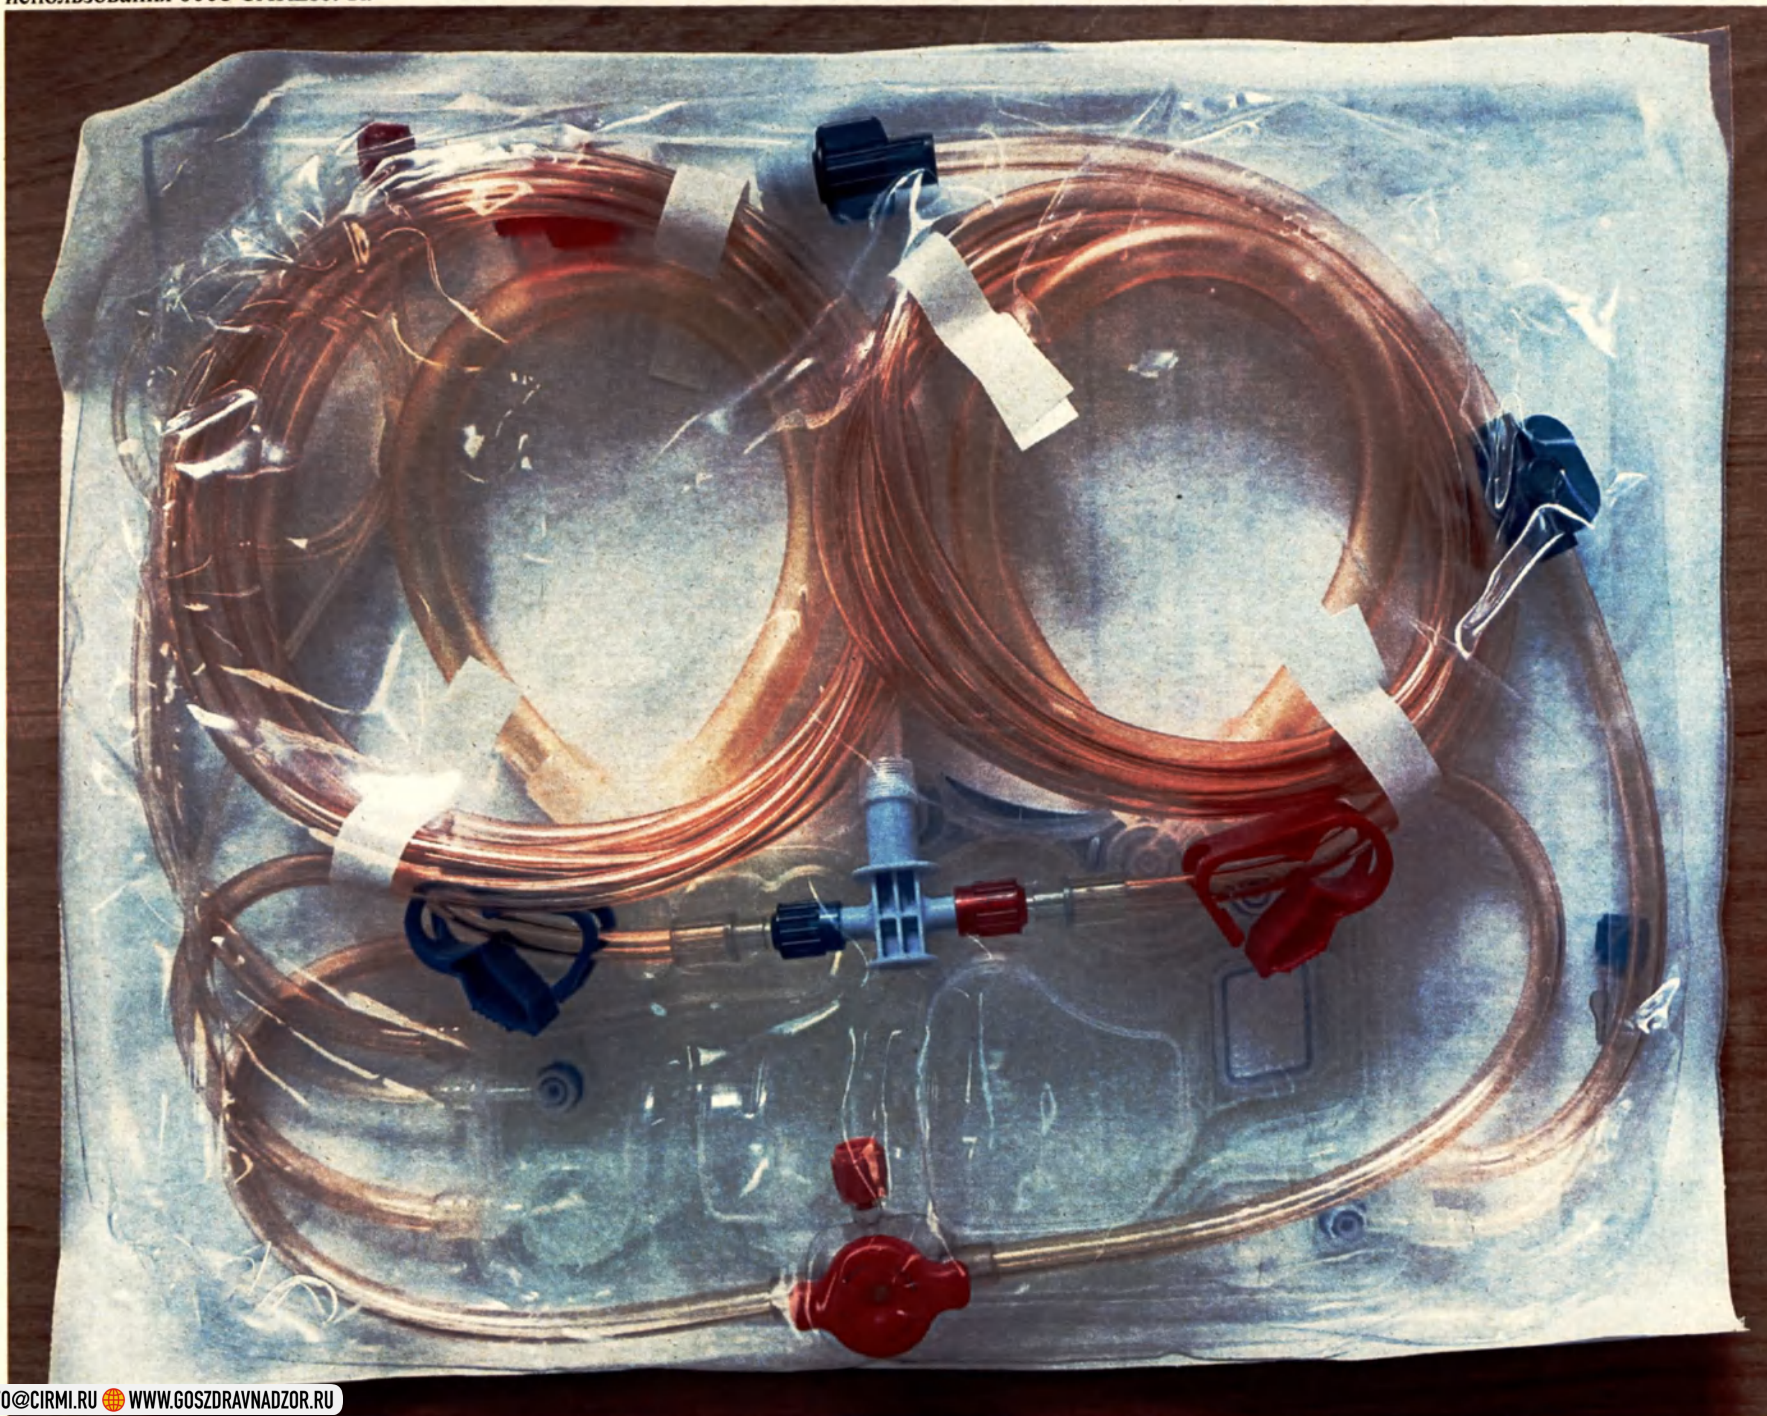

8. Фотографическое изображения общего вида медицинского изделия в групповой упаковке с инструкцией по применению:

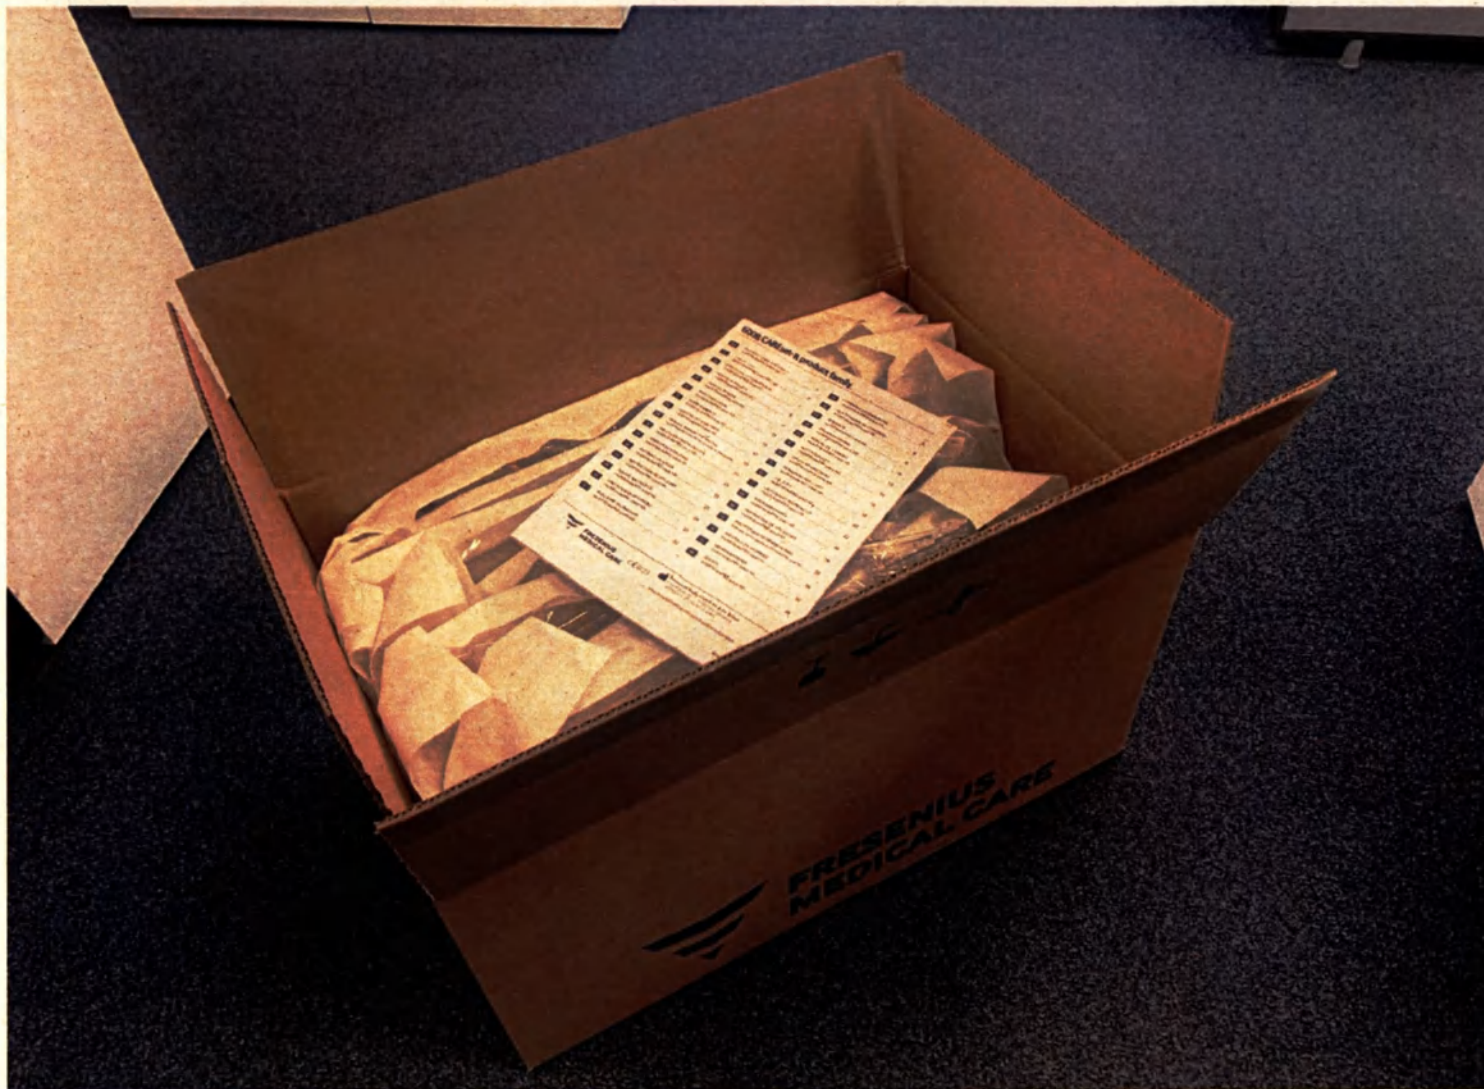

9. Фотографическое изображения общего вида групповой упаковки:



Прошито и пронумеровано
10 страниц

Менеджер по регистрации
медицинских изделий
АО «Фрезениус СП»
Санникова Е.И.





**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

АО «Фрезениус СП»

115054, Россия, Москва
Ул. Валовая, д. 35
т/ф +7 495 789-6454
e-mail: msk.office@fmc-ag.com
web: www.freseniusmedicalcare.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Менеджер по регистрации
медицинских изделий
АО «Фрезениус СП»



Санникова Е.И.

Е.И. Санникова
«22» апреля 2024 г.

ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset
в вариантах исполнения**

1. Данные о маркировке варианта исполнения: Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset-R – 26 шт. в групповой упаковке с инструкцией по применению (1 шт.);

1.1. Макет маркировки индивидуальной первичной упаковки:

Fresenius Medical Care Original Bloodline

6008

CAREset

MD 6008 CAREset-R

MAX
12 h

Ø 7,1 mm /
282 mm

Manufactured in: Variable data

F00006808 **REF**

LOT

30°C

115 ml

DATA
MATRIX

STERILE **R**

UDI BARCODE

DATE (YYYY-MM-DD)
TIME (HH:MM)

BSF00006808/A

FRESENIUS
MEDICAL CARE

Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg
GERMANY ☎ +49 6172 609-0
www.freseniusmedicalcare.com/en/product-information


CE 0123

04039361127367

pool here

pool here

Расшифровка символов маркировки индивидуальной первичной упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Медицинское изделие		Заменить кассету максимум через 12 часов
	Номер по каталогу		Диаметр/длина насосного сегмента
	Запрет на повторное применение		Изготовитель
	Номер партии (код партии)		Знак соответствия стандартам ЕС и номер
	Не содержит латекс		Уникальный идентификатор изделия
	Дата изготовления (месяц, год)		Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Температурный диапазон		Информация для пациентов в Интернете
	Использовать до... (месяц, год) (Срок годности)		Стерильная защитная система
	Осторожно		Апирогенно
	Объем заполнения кровью		Радиационная стерилизация
	Обратитесь к инструкции по применению		

1.2. Макет маркировки групповой (транспортной) упаковки:

6008

CAREset

MD 6008 CAREset-R

Manufactured in: Variable data

REF F00006808

LOT

26

STERILE R

SBS

LATEX

UDI

BAR CODE

**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg
GERMANY ☎ +49 6172 609-0
www.freseniusmedicalcare.com/en/product-information

CE 0123

8258462/A


• Blutschlachsysteme • Bloodlines • Lignes à sang • Linee ematiche • Lineas de Sangre • Linhas de Sangue • Bloedlijensysteem
• Blodslanger • Verletkut • Krvne linije • Γραμμές Αιματος • Kan Setleri • Krevní sety • Linii de sânge • Dreny krwi
• Verellinid • Sely krvné • Vércserelek • Кръвни линии • Kraujo linijos • Asins magistralės • Магистралі
• 血液迴路管 • 血液净化体外循环血路 • 인공신장기용혈액회로 • Магистралдар • خطوط الدم

Рсшифровка символов маркировки групповой (транспортной) упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
MD	Медицинское изделие		Изготовитель
REF	Номер по каталогу	CE 0123	Знак соответствия стандартам ЕС и номер
	Запрет на повторное применение	UDI	Уникальный идентификатор изделия
LOT	Номер партии (код партии)		Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Не содержит латекс		Информация для пациентов в Интернете
	Дата изготовления (месяц, год)	SBS	Стерильная защитная система
	Температурный диапазон		Апирогенно

	Использовать до... (месяц, год) (Срок годности)		Радиационная стерилизация
	Осторожно		Количество
	Обратитесь к инструкции по применению		

1.3. Маркировка, нанесенная непосредственно на групповую (транспортную) упаковку:

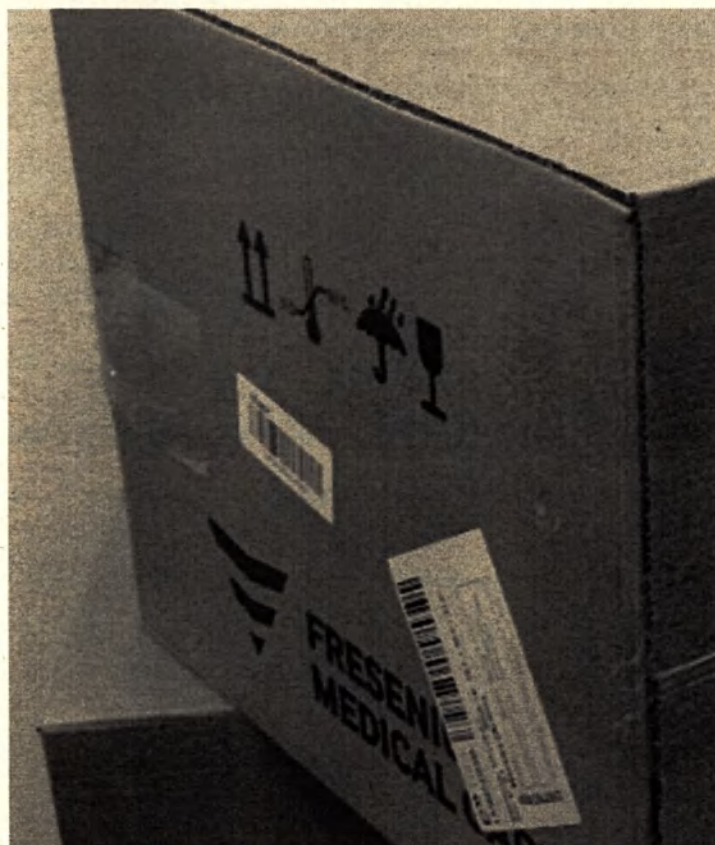

Расшифровка символов маркировки групповой (транспортной) упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Температурный диапазон		Не допускать воздействия влаги
	Вверх		Хрупкое, обращаться осторожно

1.4. Макет маркировки русскоязычного стикера:

Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset-R –
26 шт. в групповой упаковке с инструкцией по применению (1 шт.)

Инструкция по подготовке к использованию: «Перед применением прочтите инструкцию»

Номер партии: см. на упаковке.

Номер по каталогу: см. на упаковке.

Дата стерилизации соответствует дате изготовления. Дата изготовления: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Стерильно, апирогенно, нетоксично

Производитель: Fresenius Medical Care AG

(Фрезениус Медикал Кеа АГ)

Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, Germany

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

АО «Фрезениус СП»

115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09

Тел./факс: +7 (495) 789-64-54

E-mail: msk.office@fmc-ag.com

Дополнительный русскоязычный стикер не перекрывает оригинальную маркировку упаковки.

2. Данные о маркировке варианта исполнения: Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset BVM-R – 26 шт. в групповой инструкции по применению (1 шт.);
- 2.1. Макет маркировки индивидуальной первичной упаковки:

Fresenius Medical Care Original Bloodline

6008

CAREset

MD 6008 CAREset BVM-R

MAX
12 h

Ø 7,1 mm /
282 mm

UDI BARCODE

DATE (YYYY-MM-DD)
TIME (HH:MM)

F00007727 **REF** ②

LOT LATER

122 ml

DATA MATRIX

STERILE R

SBS

Manufactured in: Variable data

• Blutschlauchsysteme • Bloodlines • Lignes à sang • Linee ematiche • Líneas de Sangre
 • Linhas de Sangue • Bloedlijnsysteem • Blodslangar • Blodslanger • Veriletkut • Krvne linije
 • Γραμμές Αίματος • Kan Setleri • Krevní sety • Linii de sânge • Dreny krwi • Vereliinid • Sety krvné
 • Vérszerelékek • Кръвни линии • Kraujo linijos • Asins magistrāles • Магистралы • 血液迴路管
 • 血液净化体外循环血路 • 인공신장기용혈액회로 • Магистралдар • خطوط الدم


FRESENIUS
MEDICAL CARE

Fresenius Medical Care AG
 Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg
 GERMANY ☎ +49 6172 609-0
www.freseniusmedicalcare.com/en/product-information


BSF00007727/A

04039361156046

Расшифровка символов маркировки индивидуальной первичной упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Медицинское изделие		Заменить кассету максимум через 12 часов
	Номер по каталогу		Диаметр/длина насосного сегмента
	Запрет на повторное применение		Изготовитель
	Номер партии (код партии)		Знак соответствия стандартам ЕС и номер
	Не содержит латекс		Уникальный идентификатор изделия
	Дата изготовления (месяц, год)		Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Температурный диапазон		Информация для пациентов в Интернете
	Использовать до... (месяц, год) (Срок годности)		Стерильная защитная система
	Осторожно		Апирогенно
	Объем заполнения кровью		Радиационная стерилизация
	Обратитесь к инструкции по применению		

2.2. Макет маркировки групповой (транспортной) упаковки:

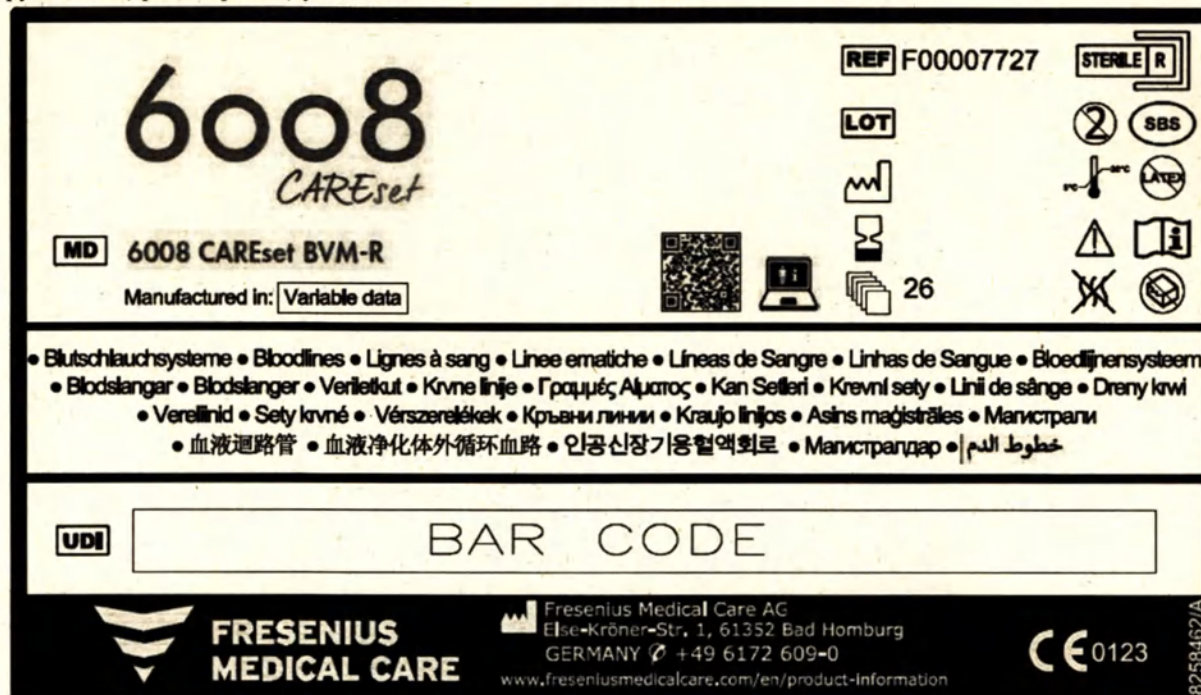

Расшифровка символов маркировки групповой (транспортной) упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
MD	Медицинское изделие		Изготовитель
REF	Номер по каталогу	CE 0123	Знак соответствия стандартам ЕС и номер
	Запрет на повторное применение	UDI	Уникальный идентификатор изделия
LOT	Номер партии (код партии)		Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Не содержит латекс		Информация для пациентов в Интернете
	Дата изготовления (месяц, год)	SBS	Стерильная защитная система
	Температурный диапазон		Апирогенно

	Использовать до... (месяц, год) (Срок годности)		Радиационная стерилизация
	Осторожно		Количество
	Обратитесь к инструкции по применению		

2.3. Маркировка, нанесенная непосредственно на групповую (транспортную) упаковку:



Расшифровка символов маркировки групповой (транспортной) упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Температурный диапазон		Не допускать воздействия влаги
	Вверх		Хрупкое, обращаться осторожно

2.4. Макет маркировки русскоязычного стикера:

Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset
BVM-R – 26 шт. в групповой упаковке с инструкцией по применению (1 шт.)

Инструкция по подготовке к использованию: «Перед применением прочтите инструкцию»

Номер партии: см. на упаковке.

Номер по каталогу: см. на упаковке.

Дата стерилизации соответствует дате изготовления. Дата изготовления: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Стерильно, апирогенно, нетоксично

Производитель: Fresenius Medical Care AG
(Фрезениус Медикал Кеа АГ)
Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, Germany

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
АО «Фрезениус СП»
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09
Тел./факс: +7 (495) 789-64-54
E-mail: msk.office@fmc-ag.com

Дополнительный русскоязычный стикер не перекрывает оригинальную маркировку упаковки.

3. Данные о маркировке варианта исполнения: Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset L-R – 26 шт. в групповой инструкции по применению (1 шт.);

3.1. Макет маркировки индивидуальной первичной упаковки:

Fresenius Medical Care Original Bloodline

6008

CAREset

MD 6008 CAREset L-R

MAX 12 h

Ø 7,1 mm / 282 mm

Manufactured in: Variable data

Blutschlauchsysteme • Bloodlines • Lignes à sang • Linee ematiche • Líneas de Sangre
Linhas de Sangue • Bloedlijnsysteem • Blodslangar • Blodslanger • Veriletkut • Krvne linije
Γραμμές Αίματος • Kan Setleri • Krevní sety • Linii de sânge • Dreny krwi • Vereliinid • Sety krvné
Vérserelékek • Кръвни линии • Kraujo linijos • Asins magistralės • Магистралі • 血液迴路管
血液净化体外循环血路 • 인공신장기용혈액회로 • Магистралдар • خطوط الدم

BSF00007728/A

FRESENIUS MEDICAL CARE

Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg
GERMANY ☎ +49 6172 609-0
www.freseniusmedicalcare.com/en/product-information

CE 0123

04039361156015

F00007728 REF ②

LOT LATEX

8°C 30°C

128 ml

DATA MATRIX

STERILE R

SBS

DATE (YYYY-MM-DD) TIME (HH:MM)

UDI BARCODE


Tubing

USE

peel here

peel here

Расшифровка символов маркировки индивидуальной первичной упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Медицинское изделие		Заменить кассету максимум через 12 часов
	Номер по каталогу		Диаметр/длина насосного сегмента
	Запрет на повторное применение		Изготовитель
	Номер партии (код партии)		Знак соответствия стандартам ЕС и номер
	Не содержит латекс		Уникальный идентификатор изделия
	Дата изготовления (месяц, год)		Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Температурный диапазон		Информация для пациентов в Интернете
	Использовать до... (месяц, год) (Срок годности)		Стерильная защитная система
	Осторожно		Апирогенно
	Объем заполнения кровью		Радиационная стерилизация
	Обратитесь к инструкции по применению		

6008

CAREset

MD 6008 CAREset L-R

Manufactured in: Variable data

26

REF F00007728

LOT

STERILE R

UDI BAR CODE

FRESENIUS MEDICAL CARE

Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg
GERMANY ☎ +49 6172 609-0
www.freseniusmedicalcare.com/en/product-information

CE 0123

8258462/A

Рсшифровка символов маркировки групповой (транспортной) упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
MD	Медицинское изделие		Изготовитель
REF	Номер по каталогу	CE 0123	Знак соответствия стандартам ЕС и номер
	Запрет на повторное применение	UDI	Уникальный идентификатор изделия
LOT	Номер партии (код партии)		Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Не содержит латекс		Информация для пациентов в Интернете
	Дата изготовления (месяц, год)	SBS	Стерильная защитная система

	Температурный диапазон		Апирогенно
	Использовать до... (месяц, год) (Срок годности)		Радиационная стерилизация
	Осторожно		Количество
	Обратитесь к инструкции по применению		

3.3. Маркировка, нанесенная непосредственно на групповую (транспортную) упаковку:



Расшифровка символов маркировки групповой (транспортной) упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Температурный диапазон		Не допускать воздействия влаги
	Вверх		Хрупкое, обращаться осторожно

3.4. Макет маркировки русскоязычного стикера:

Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset
L-R – 26 шт. в групповой упаковке с инструкцией по применению (1 шт.)

Инструкция по подготовке к использованию: «Перед применением прочтите инструкцию»

Номер партии: см. на упаковке.

Номер по каталогу: см. на упаковке.

Дата стерилизации соответствует дате изготовления. Дата изготовления:
см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Стерильно, апирогенно, нетоксично

Производитель: Fresenius Medical Care AG
(Фрезениус Медикал Кеа АГ)
Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, Germany

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
АО «Фрезениус СП»
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09
Тел./факс: +7 (495) 789-64-54
E-mail: msk.office@fmc-ag.com

Дополнительный русскоязычный стикер не перекрывает оригинальную маркировку упаковки.

4. Данные о маркировке варианта исполнения: Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset BVM L-R – 26 шт. в группе, инструкция по применению (1 шт.);
- 4.1. Макет маркировки индивидуальной первичной упаковки:

Fresenius Medical Care Original Bloodline

6008

CAREset

F00007729 **REF** 

LOT 

135 ml  

DATA MATRIX 

 **STERILE R** 





MAX
12 h



Ø 7,1 mm /
282 mm

Manufactured in: Variable data

• Blutschlauchsysteme • Bloodlines • Lignes à sang • Linee ematiche • Líneas de Sangre
 • Linhas de Sangue • Bloedlijnsysteem • Blodslangar • Blodslanger • Veriletkut • Krvne linije
 • Γραμμές Αίματος • Kan Setleri • Krevní sety • Linii de sânge • Dreny krwi • Vereliinid • Sety krvné
 • Vércserelékek • Кръвни линии • Kraujo linijos • Asins magistralės • Магистралі • 血液迴路管
 • 血液净化体外循环血路 • 인공신장기용혈액회로 • Магистралдар • خطوط الدم



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care AG
 Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg
 GERMANY ☎ +49 6172 609-0
www.freseniusmedicalcare.com/en/product-information


CE 0123



04039361155988

BSF00007723/A

Расшифровка символов маркировки индивидуальной первичной упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Медицинское изделие		Заменить кассету максимум через 12 часов
	Номер по каталогу		Диаметр/длина насосного сегмента
	Запрет на повторное применение		Изготовитель
	Номер партии (код партии)		Знак соответствия стандартам ЕС и номер
	Не содержит латекс		Уникальный идентификатор изделия
	Дата изготовления (месяц, год)		Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Температурный диапазон		Информация для пациентов в Интернете
	Использовать до... (месяц, год) (Срок годности)		Стерильная защитная система
	Осторожно		Апирогенно
	Объем заполнения кровью		Радиационная стерилизация
	Обратитесь к инструкции по применению		

6008

CAREset

MD 6008 CAREset BVM L-R

Manufactured in: Variable data

REF F00007729

LOT

26

• Blutschlachsysteme • Bloodlines • Lignes à sang • Linee ematice • Lineas de Sangre • Linhas de Sangue • Bloedlijnsysteem
 • Blodslangar • Blodslanger • Verletkut • Krvne linije • Γραμμές Αιματος • Kan Setleri • Krevní sety • Linii de sânge • Dreny krwi
 • Verellind • Sety krvné • Vényszerelékek • Кръвни линии • Kraujo linijos • Asins magistrāles • Магистрални
 • 血液迴路管 • 血液净化体外循环回路 • 인공신장기용혈액회로 • Магистралдар • خطوط الدم

STERILE R

2 **SBS**

LATEX

UDI BAR CODE

**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care AG
 Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg
 GERMANY ☎ +49 6172 609-0
www.freseniusmedicalcare.com/en/product-information

CE 0123

8258462/A

Рсшифровка символов маркировки групповой (транспортной) упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
MD	Медицинское изделие		Изготовитель
REF	Номер по каталогу	CE 0123	Знак соответствия стандартам ЕС и номер
	Запрет на повторное применение	UDI	Уникальный идентификатор изделия
LOT	Номер партии (код партии)		Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Не содержит латекс		Информация для пациентов в Интернете
	Дата изготовления (месяц, год)	SBS	Стерильная защитная система
	Температурный диапазон		Апирогенно

	Использовать до... (месяц, год) (Срок годности)		Радиационная стерилизация
	Осторожно		Количество
	Обратитесь к инструкции по применению		

4.3. Маркировка, нанесенная непосредственно на групповую (транспортную) упаковку:



Расшифровка символов маркировки групповой (транспортной) упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Температурный диапазон		Не допускать воздействия влаги
	Вверх		Хрупкое, обращаться осторожно

4.4. Макет маркировки русскоязычного стикера:

Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset BVM
L-R – 26 шт. в групповой упаковке с инструкцией по применению (1 шт.)

Инструкция по подготовке к использованию: «Перед применением прочтите инструкцию»

Номер партии: см. на упаковке.

Номер по каталогу: см. на упаковке.

Дата стерилизации соответствует дате изготовления. Дата изготовления: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Стерильно, апирогенно, нетоксично

Производитель: Fresenius Medical Care AG

(Фрезениус Медикал Кеа АГ)

Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, Germany

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

АО «Фрезениус СП»

115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09

Тел./факс: +7 (495) 789-64-54

E-mail: msk.office@fmc-ag.com

Дополнительный русскоязычный стикер не перекрывает оригинальную маркировку упаковки.

5. Данные о маркировке варианта исполнения: Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset Low Volume групповой упаковке с инструкцией по применению (1 шт.);

5.1. Макет маркировки индивидуальной первичной упаковки:

Fresenius Medical Care Original Bloodline

6008

CAREset

F00007578 REF 2

MD **6008 CAREset Low Volume - R**

UDI BARCODE

LOT LATEX

39°C

78 ml

DATA MATRIX STERILE R

SBS

Ø 7,1 mm / 282 mm

Manufactured in: Variable data

• Blutschlauchsysteme • Bloodlines • Lignes à sang • Linee ematiche • Líneas de Sangre
 • Linhas de Sangue • Bloedlijnsysteem • Blodslangar • Blodslanger • Veriletkut • Krvne linije
 • Γραμμές Αίματος • Kan Setleri • Krevnl sety • Linii de sânge • Dreny krwi • Vereliinid • Sety krvné
 • Vérszerelések • Кръвни линии • Kraujo linijos • Asins maģistrāles • Магистралы • 血液迴路管
 • 血液净化体外循环血路 • 인공신장기용혈액회로 • Магистралдар • خطوط الدم

**FRESENIUS
MEDICAL CARE**


Fresenius Medical Care AG
 Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg
 GERMANY ☎ +49 6172 609-0
www.freseniusmedicalcare.com/en/product-information


CE 0123

04039361154790

BSF00007578/A

Расшифровка символов маркировки индивидуальной первичной упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Медицинское изделие		Заменить кассету максимум через 12 часов
	Номер по каталогу		Диаметр/длина насосного сегмента
	Запрет на повторное применение		Изготовитель
	Номер партии (код партии)		Знак соответствия стандартам ЕС и номер
	Не содержит латекс		Уникальный идентификатор изделия
	Дата изготовления (месяц, год)		Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Температурный диапазон		Информация для пациентов в Интернете
	Использовать до... (месяц, год) (Срок годности)		Стерильная защитная система
	Осторожно		Апирогенно
	Объем заполнения кровью		Радиационная стерилизация
	Обратитесь к инструкции по применению		

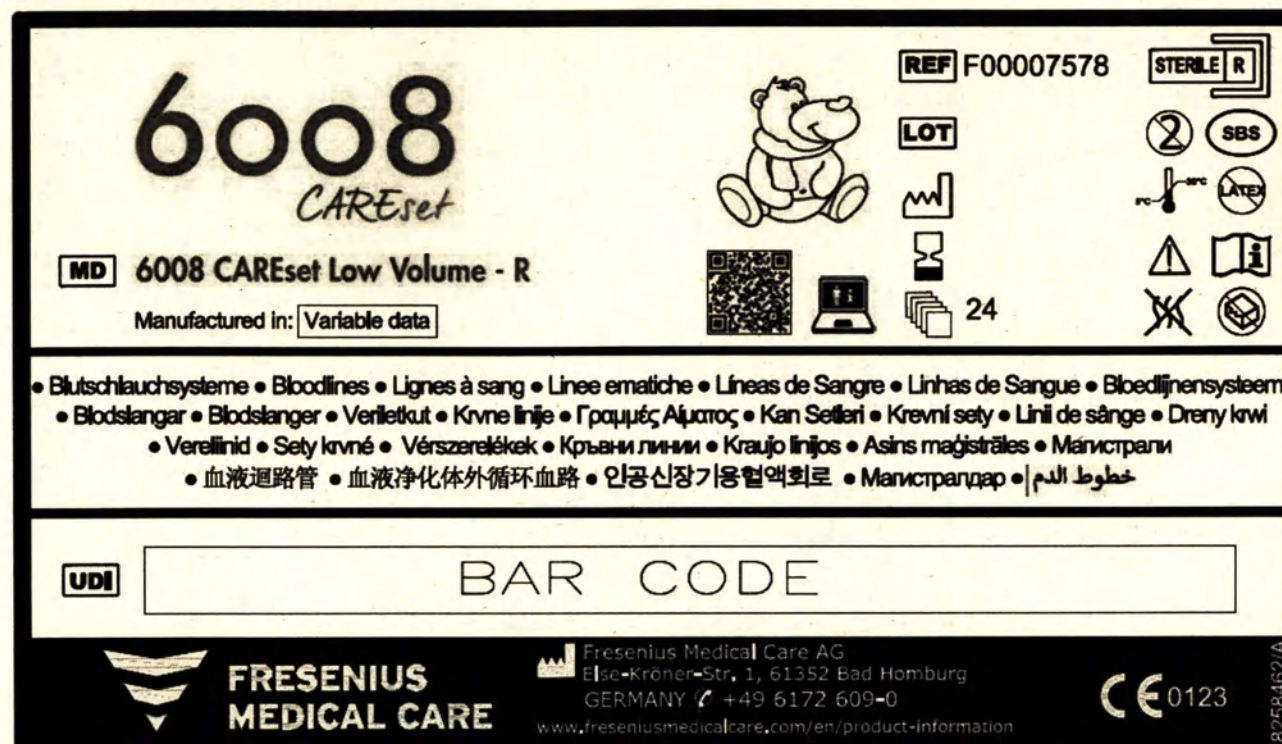

Расшифровка символов маркировки групповой (транспортной) упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
MD	Медицинское изделие		Изготовитель
REF	Номер по каталогу	CE 0123	Знак соответствия стандартам ЕС и номер
	Запрет на повторное применение	UDI	Уникальный идентификатор изделия
LOT	Номер партии (код партии)		Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Не содержит латекс		Информация для пациентов в Интернете
	Дата изготовления (месяц, год)	SBS	Стерильная защитная система
	Температурный диапазон		Апирогенно

	Использовать до... (месяц, год) (Срок годности)		Радиационная стерилизация
	Осторожно		Количество
	Обратитесь к инструкции по применению		

5.3. Маркировка, нанесенная непосредственно на групповую (транспортную) упаковку:



Расшифровка символов маркировки групповой (транспортной) упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Температурный диапазон		Не допускать воздействия влаги
	Вверх		Хрупкое, обращаться осторожно

5.4. Макет маркировки русскоязычного стикера:

Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset Low Volume - R – 24 шт. в групповой упаковке с инструкцией по применению (1 шт.)

Инструкция по подготовке к использованию: «Перед применением прочтите инструкцию»

Номер партии: см. на упаковке.

Номер по каталогу: см. на упаковке.

Дата стерилизации соответствует дате изготовления. Дата изготовления: см. на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Стерильно, апиrogenно, нетоксично

Производитель: Fresenius Medical Care AG

(Фрезениус Медикал Кеа АГ)

Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, Germany

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

АО «Фрезениус СП»

115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09

Тел./факс: +7 (495) 789-64-54

E-mail: msk.office@fmc-ag.com

Дополнительный русскоязычный стикер не перекрывает оригинальную маркировку упаковки.

6. Данные о маркировке варианта исполнения: Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset Low Volume BVM в групповой упаковке с инструкцией по применению (1 шт.);
- 6.1. Макет маркировки индивидуальной первичной упаковки:


Fresenius Medical Care Original Bloodline

6008

CAREset




MD 6008 CAREset Low Volume BVM - R



UDI BARCODE

F00007579 **REF** 

LOT 

 30°C

83 ml  

DATA MATRIX 

STERILE 

 **SBS** 





MAX
12 h



Ø 7,1 mm /
282 mm

Manufactured in: Variable data

• Blutschlachsysteme • Bloodlines • Lignes à sang • Linee ematiche • Líneas de Sangre
 • Linhas de Sangue • Bloedlijnsysteem • Blodslangar • Blodslanger • Veriletkut • Krvne linije
 • Γραμμές Αίματος • Kan Setleri • Krevní sety • Linii de sânge • Dreny krwi • Vereliinid • Sety krvné
 • Vércserelekek • Кръвни линии • Kraujo linijos • Asins maģistrāles • Магистралы • 血液迴路管
 • 血液净化体外循环血路 • 인공신장기용혈액회로 • Магистралдар • خطوط الدم



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care AG
 Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg
 GERMANY ☎ +49 6172 609-0
www.freseniusmedicalcare.com/en/product-information

BSF00007573/A




04039361153533

peel here

peel here

Расшифровка символов маркировки индивидуальной первичной упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Медицинское изделие		Заменить кассету максимум через 12 часов
	Номер по каталогу		Диаметр/длина насосного сегмента
	Запрет на повторное применение		Изготовитель
	Номер партии (код партии)		Знак соответствия стандартам ЕС и номер
	Не содержит латекс		Уникальный идентификатор изделия
	Дата изготовления (месяц, год)		Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Температурный диапазон		Информация для пациентов в Интернете
	Использовать до... (месяц, год) (Срок годности)		Стерильная защитная система
	Осторожно		Апирогенно
	Объем заполнения кровью		Радиационная стерилизация
	Обратитесь к инструкции по применению		

6008

CAREset

MD 6008 CAREset Low Volume BVM - R

Manufactured in: Variable data




REF F00007579

LOT

 24

STERILE R

 **SBS**

 **LATEX**

UDI BAR CODE



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg
GERMANY ☎ +49 6172 609-0
www.freseniusmedicalcare.com/en/product-information

CE 0123

8258462/A

• Blutschlachsysteme • Bloodlines • Lignes à sang • Linee ematiche • Líneas de Sangre • Linhas de Sangue • Bloedlijensysteem
• Blodslanger • Blodslanger • Verletkut • Krvne linije • Γραμμές Αιματος • Kan Seteri • Krevní sety • Linii de sânge • Dreny krwi
• Vereliniid • Sety krvné • Vényszerelék • Кръвни линии • Kraujo linijos • Asins magistrāles • Магистралы
• 血液迴路管 • 血液净化体外循环血路 • 인공신장기용혈액회로 • Магистрандар • خطوط الدم

Рсшифровка символов маркировки групповой (транспортной) упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
MD	Медицинское изделие		Изготовитель
REF	Номер по каталогу	CE 0123	Знак соответствия стандартам ЕС и номер
	Запрет на повторное применение	UDI	Уникальный идентификатор изделия
LOT	Номер партии (код партии)		Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Не содержит латекс		Информация для пациентов в Интернете
	Дата изготовления (месяц, год)		Стерильная защитная система
	Температурный диапазон		Апирогенно

	Использовать до... (месяц, год) (Срок годности)		Радиационная стерилизация
	Осторожно		Количество
	Обратитесь к инструкции по применению		

6.3. Маркировка, нанесенная непосредственно на групповую (транспортную) упаковку:



Расшифровка символов маркировки групповой (транспортной) упаковки:

Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Температурный диапазон		Не допускать воздействия влаги
	Вверх		Хрупкое, обращаться осторожно

6.4. Макет маркировки русскоязычного стикера:

Магистраль для гемодиализа одноразового использования 6008 CAREset
Low Volume BVM - R – 24 шт. в групповой упаковке с инструкцией по
применению (1 шт.)

Инструкция по подготовке к использованию: «Перед применением прочтите
инструкцию»

Номер партии: см. на упаковке.

Номер по каталогу: см. на упаковке.

Дата стерилизации соответствует дате изготовления. Дата изготовления: см.
на упаковке.

Срок годности: см. на упаковке.

Стерильно, апирогенно, нетоксично

Производитель: Fresenius Medical Care AG

(Фрезениус Медикал Кеа АГ)

Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, Germany

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

АО «Фрезениус СП»

115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09

Тел./факс: +7 (495) 789-64-54

E-mail: msk.office@fmc-ag.com

Дополнительный русскоязычный стикер не перекрывает оригинальную маркировку упаковки.

Менеджер по регистрации
медицинских изделий
АО «Фрезениус СП»
Санникова Е.И.

