

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ОЛИМПИК»

Самошин Игорь Алексеевич

«30 » Ноября 2023 г.



**ФОТОГРАФИИ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Клинок для ларингоскопа KAWE одноразовый, в вариантах
исполнения.»**

производства

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
(КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ)



2.


Клинок ларингоскопа стандартного освещения Макинтош стальной одноразовый, размер 1, артикул 03.14010.612







1.

Клинок ларингоскопа стандартного освещения Макинтош стальной одноразовый, размер 3, артикул 03.14010.632

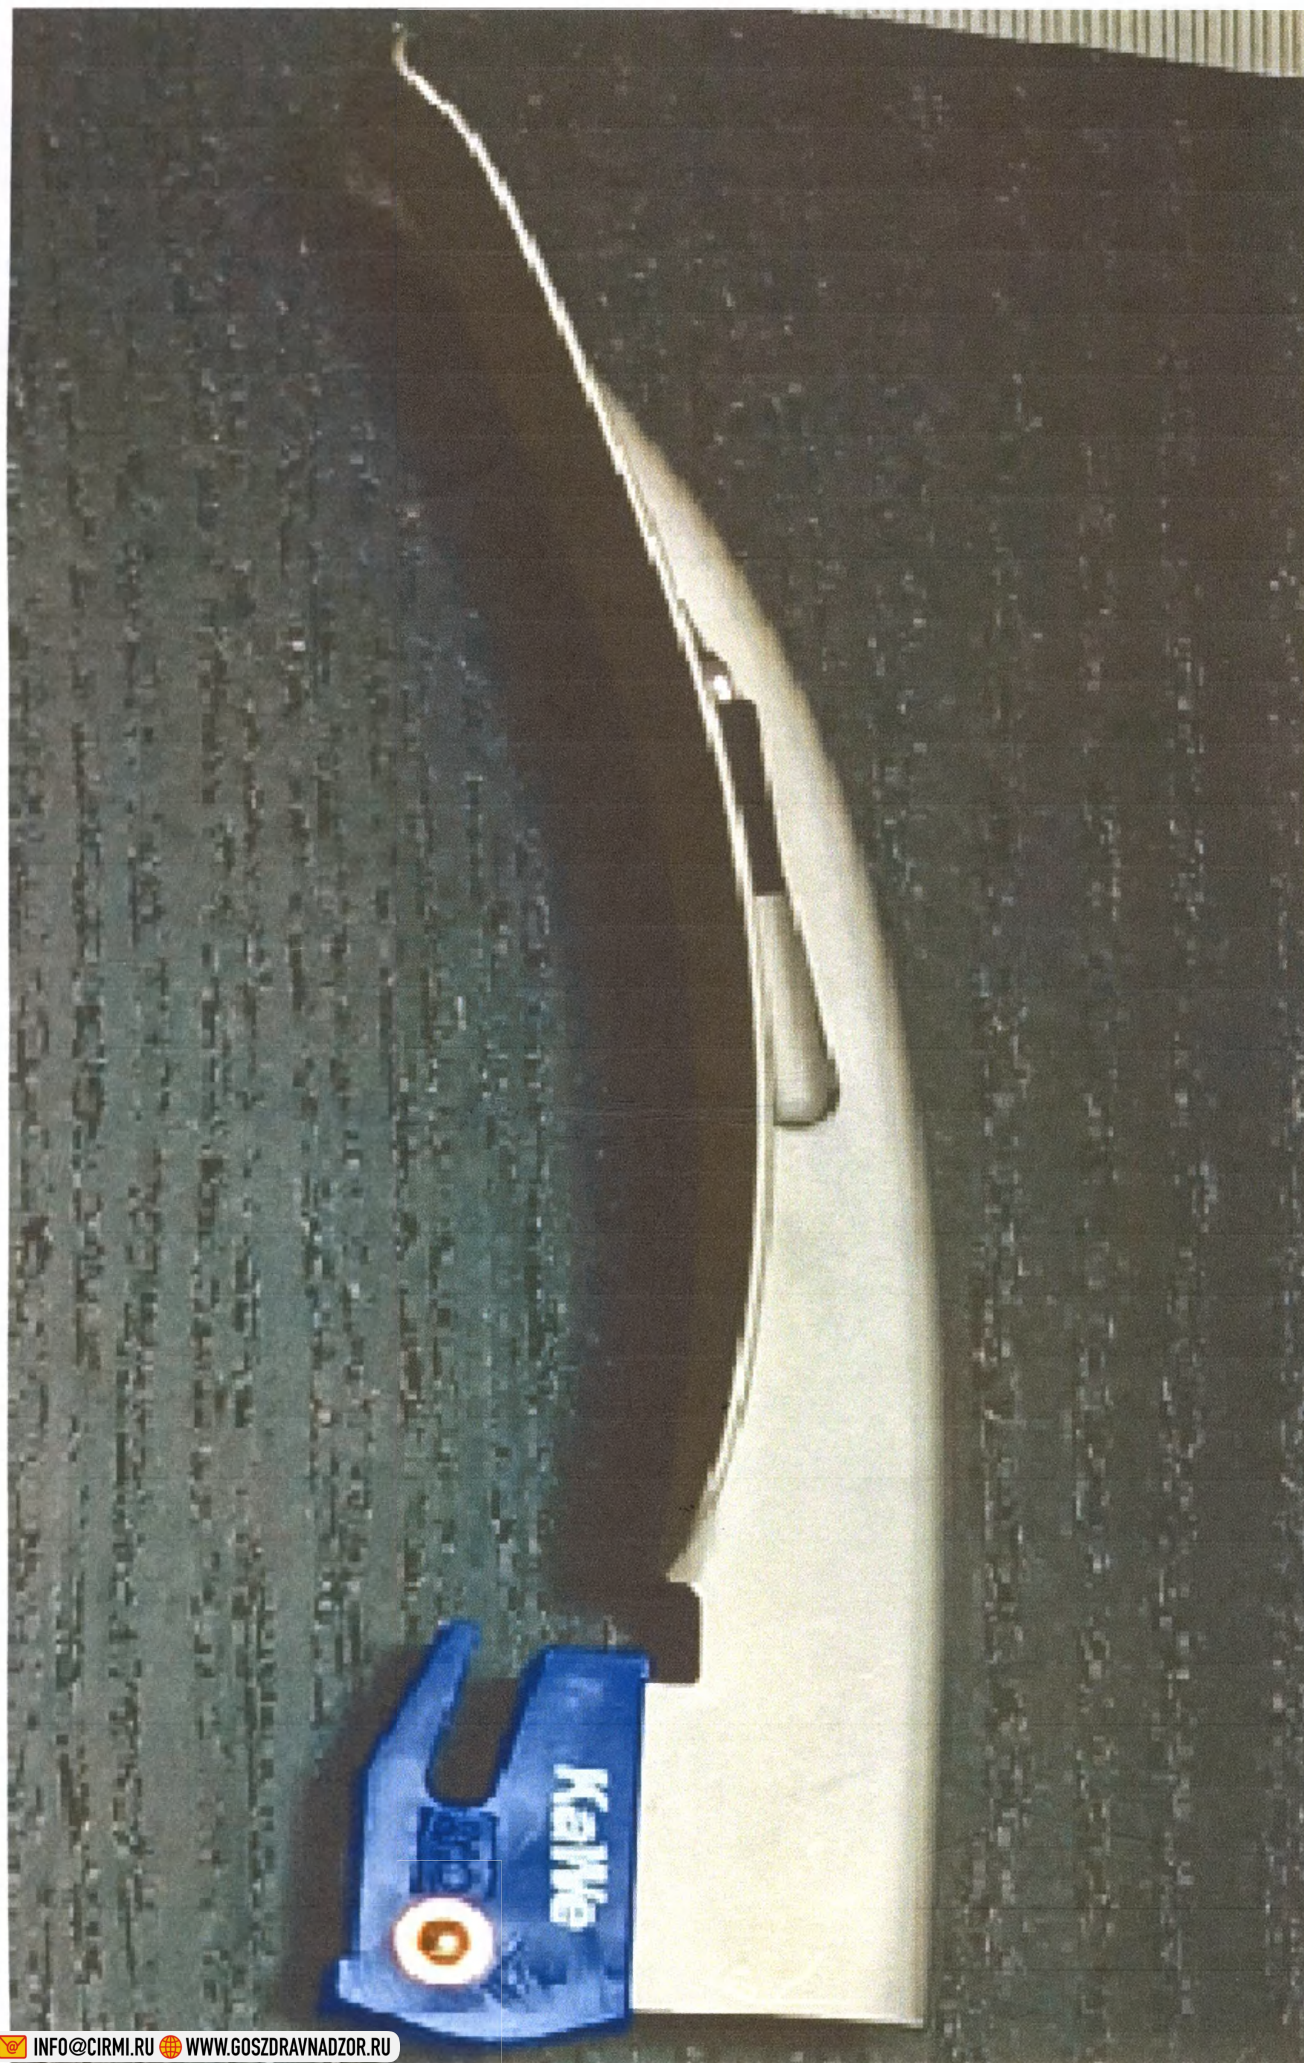


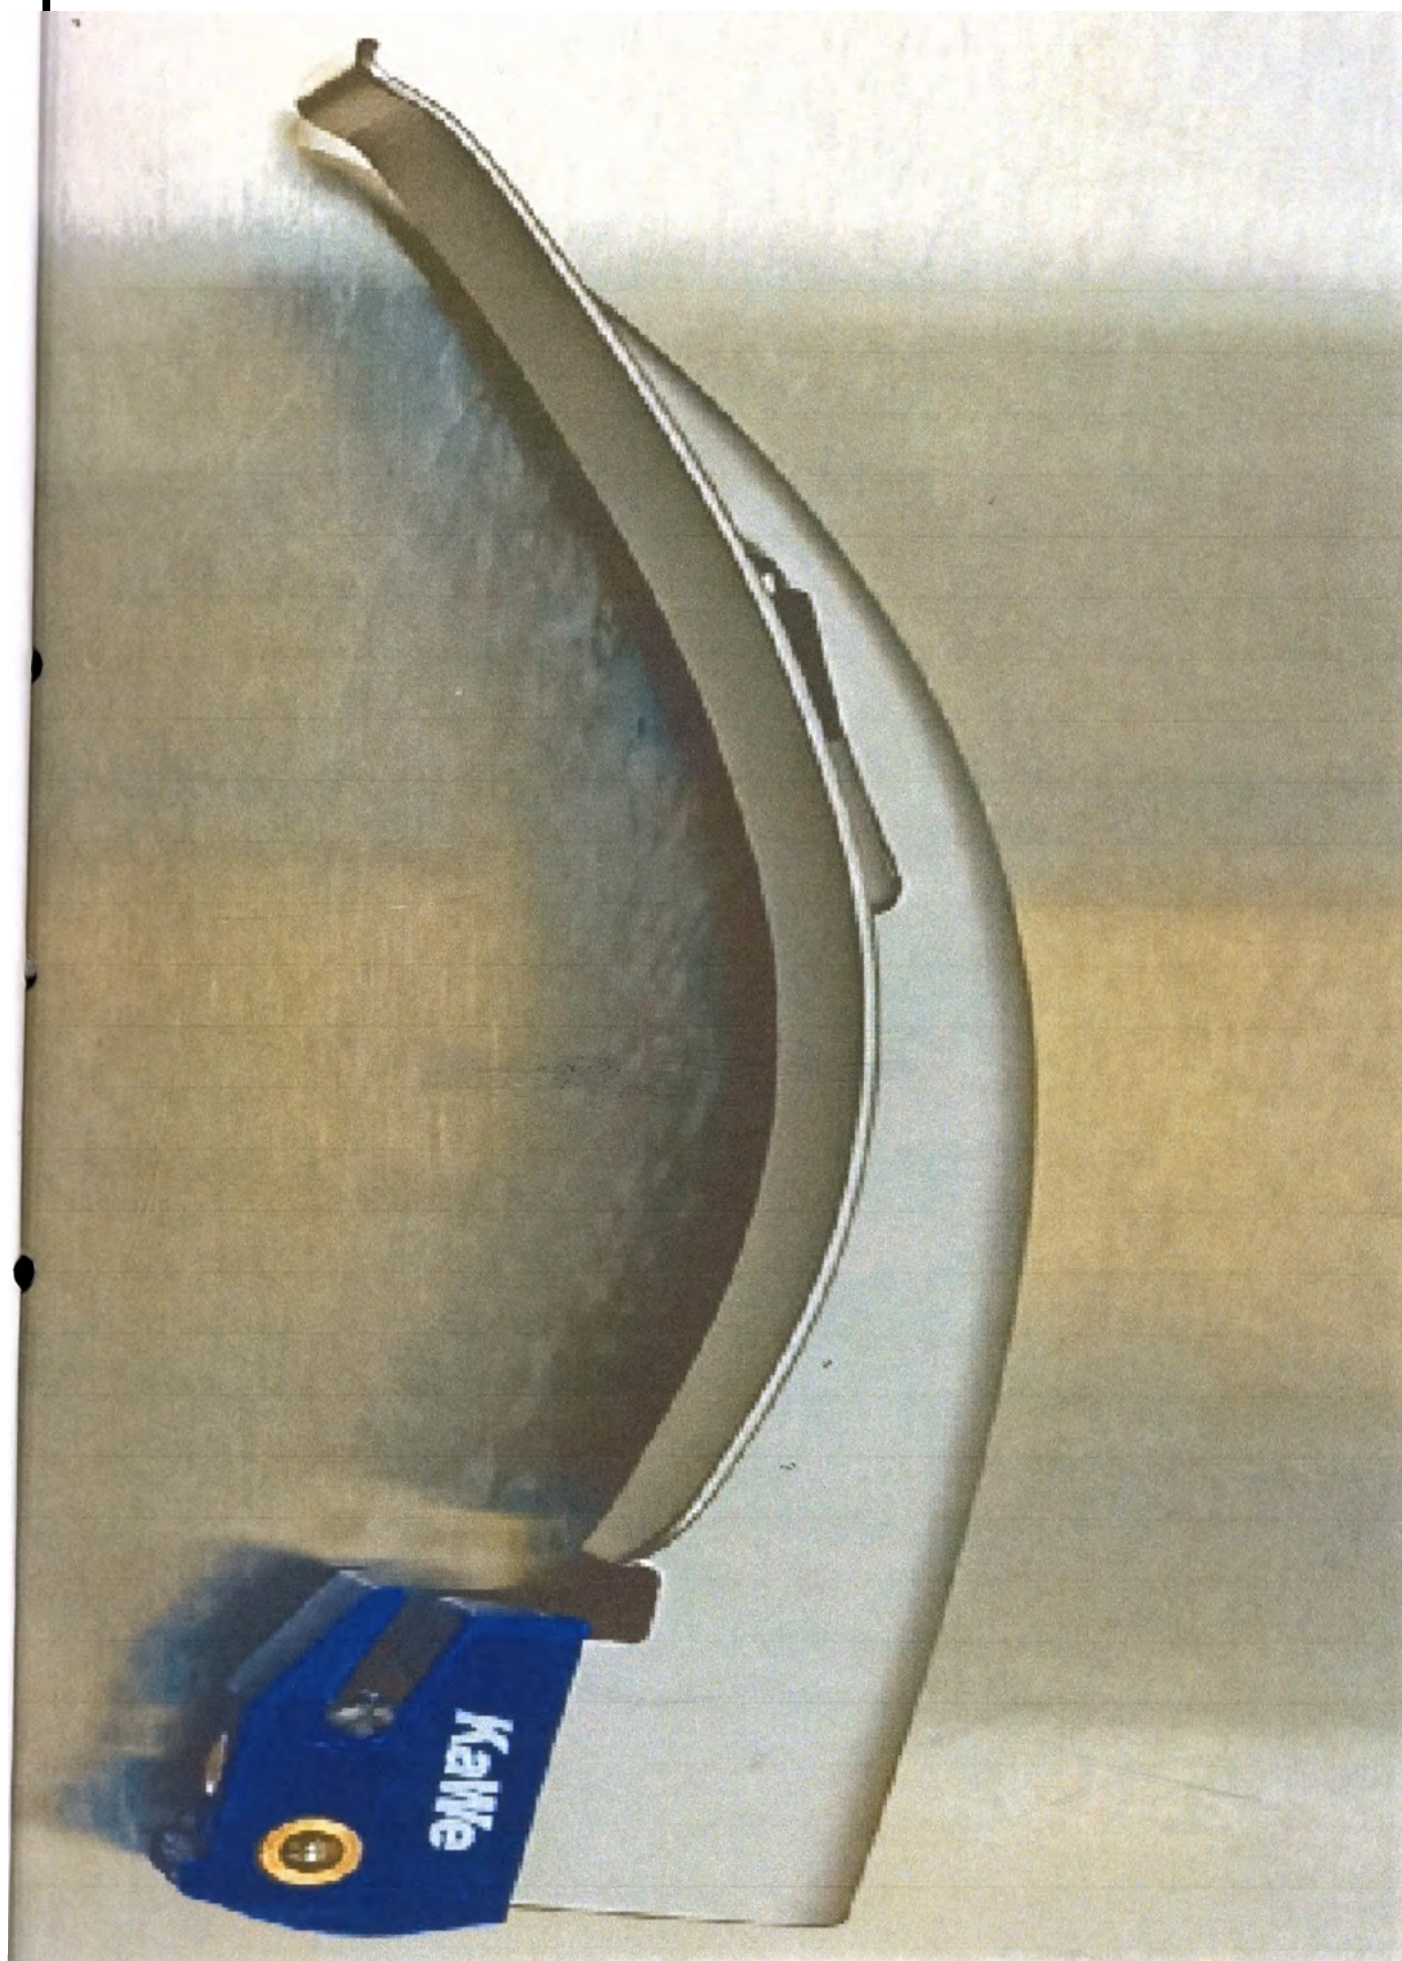




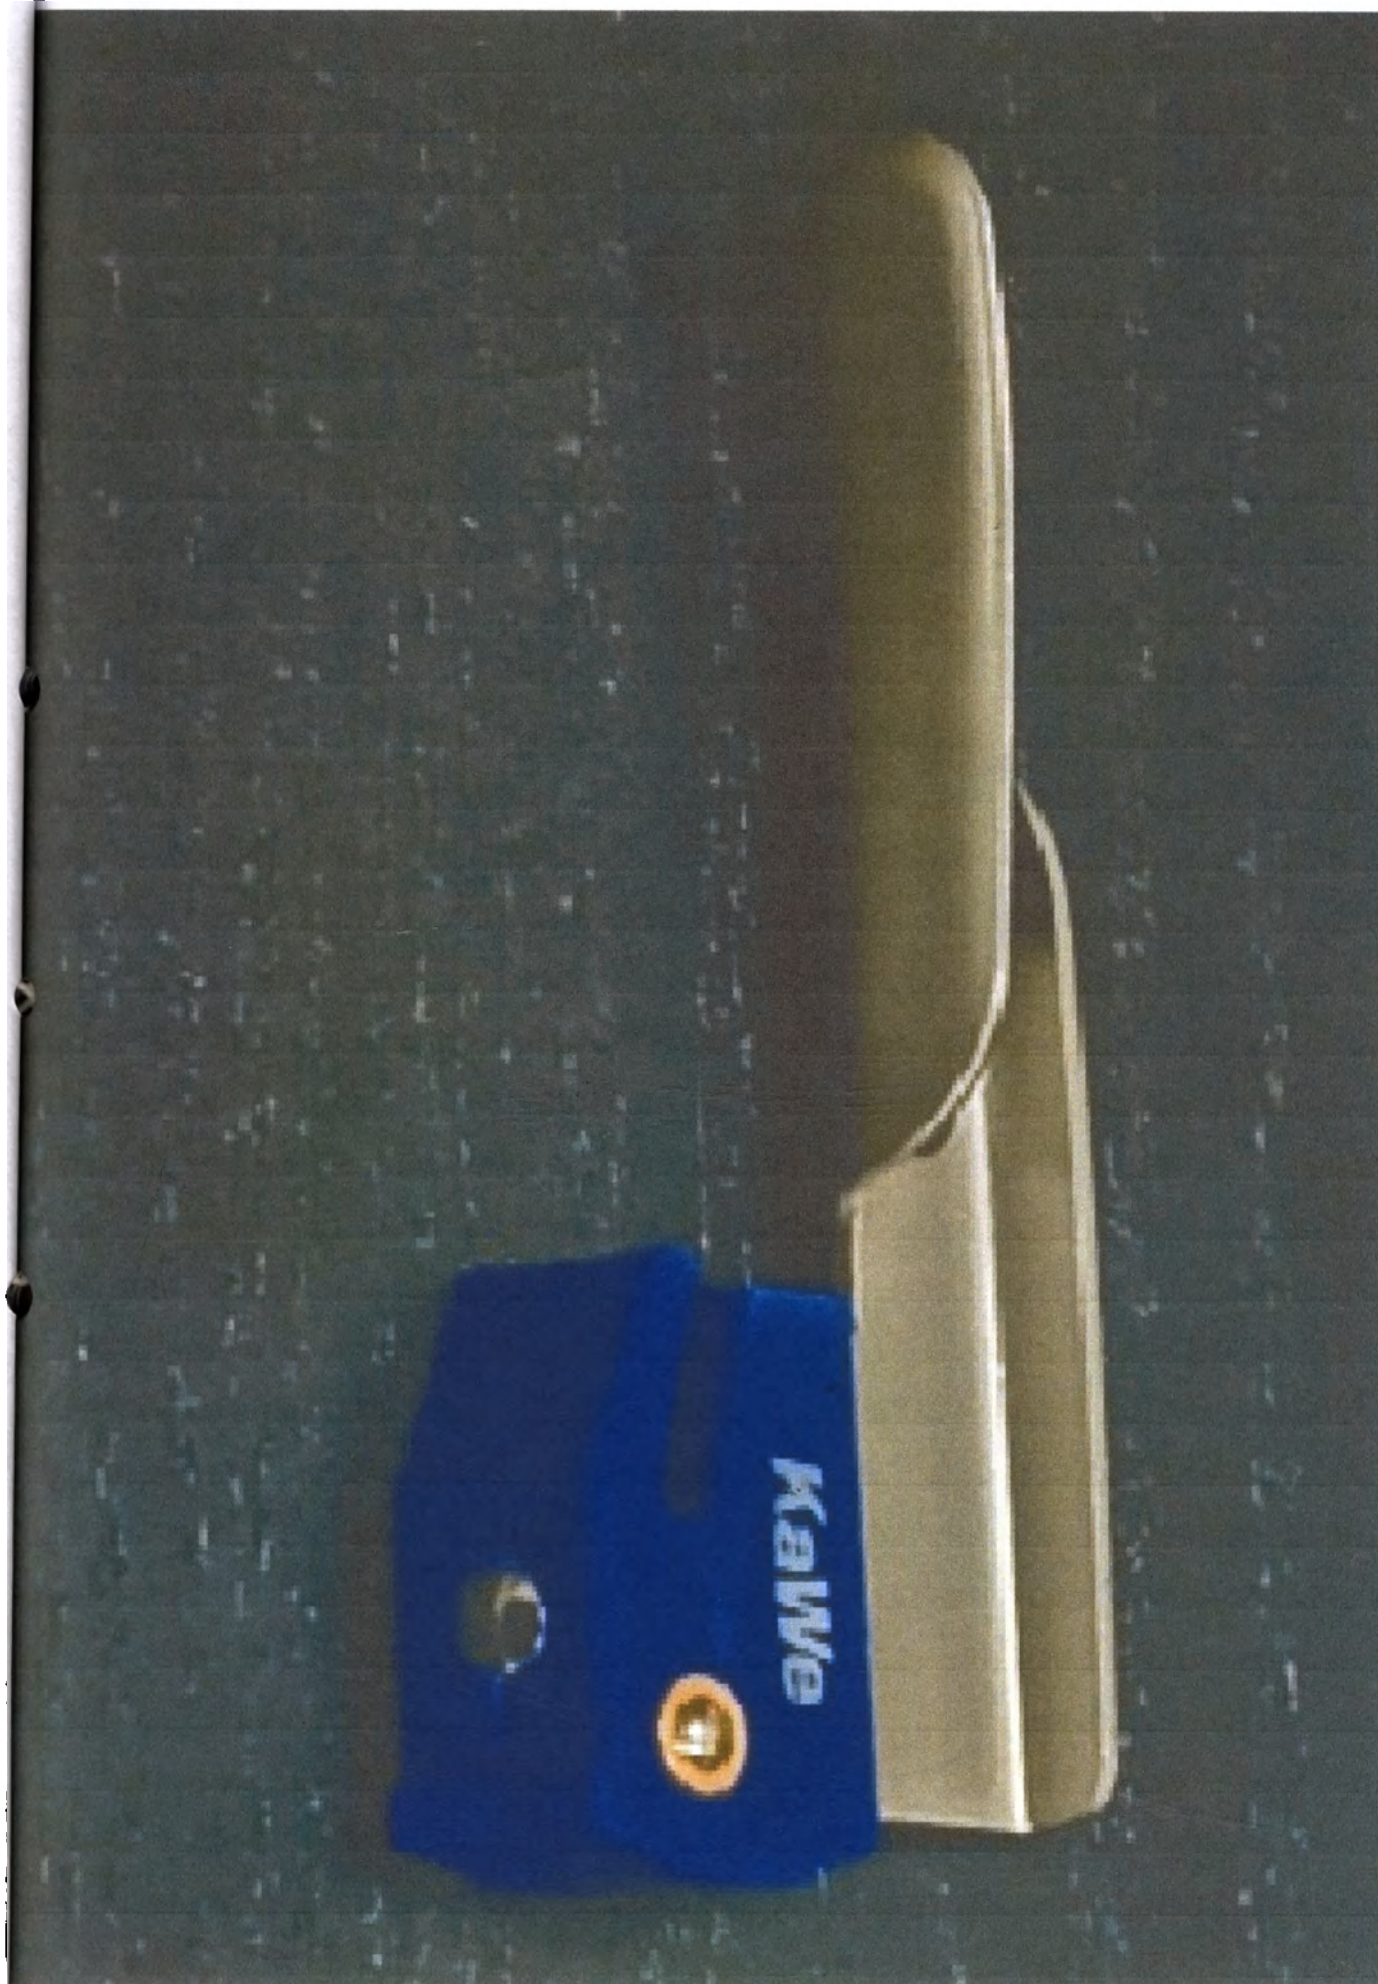




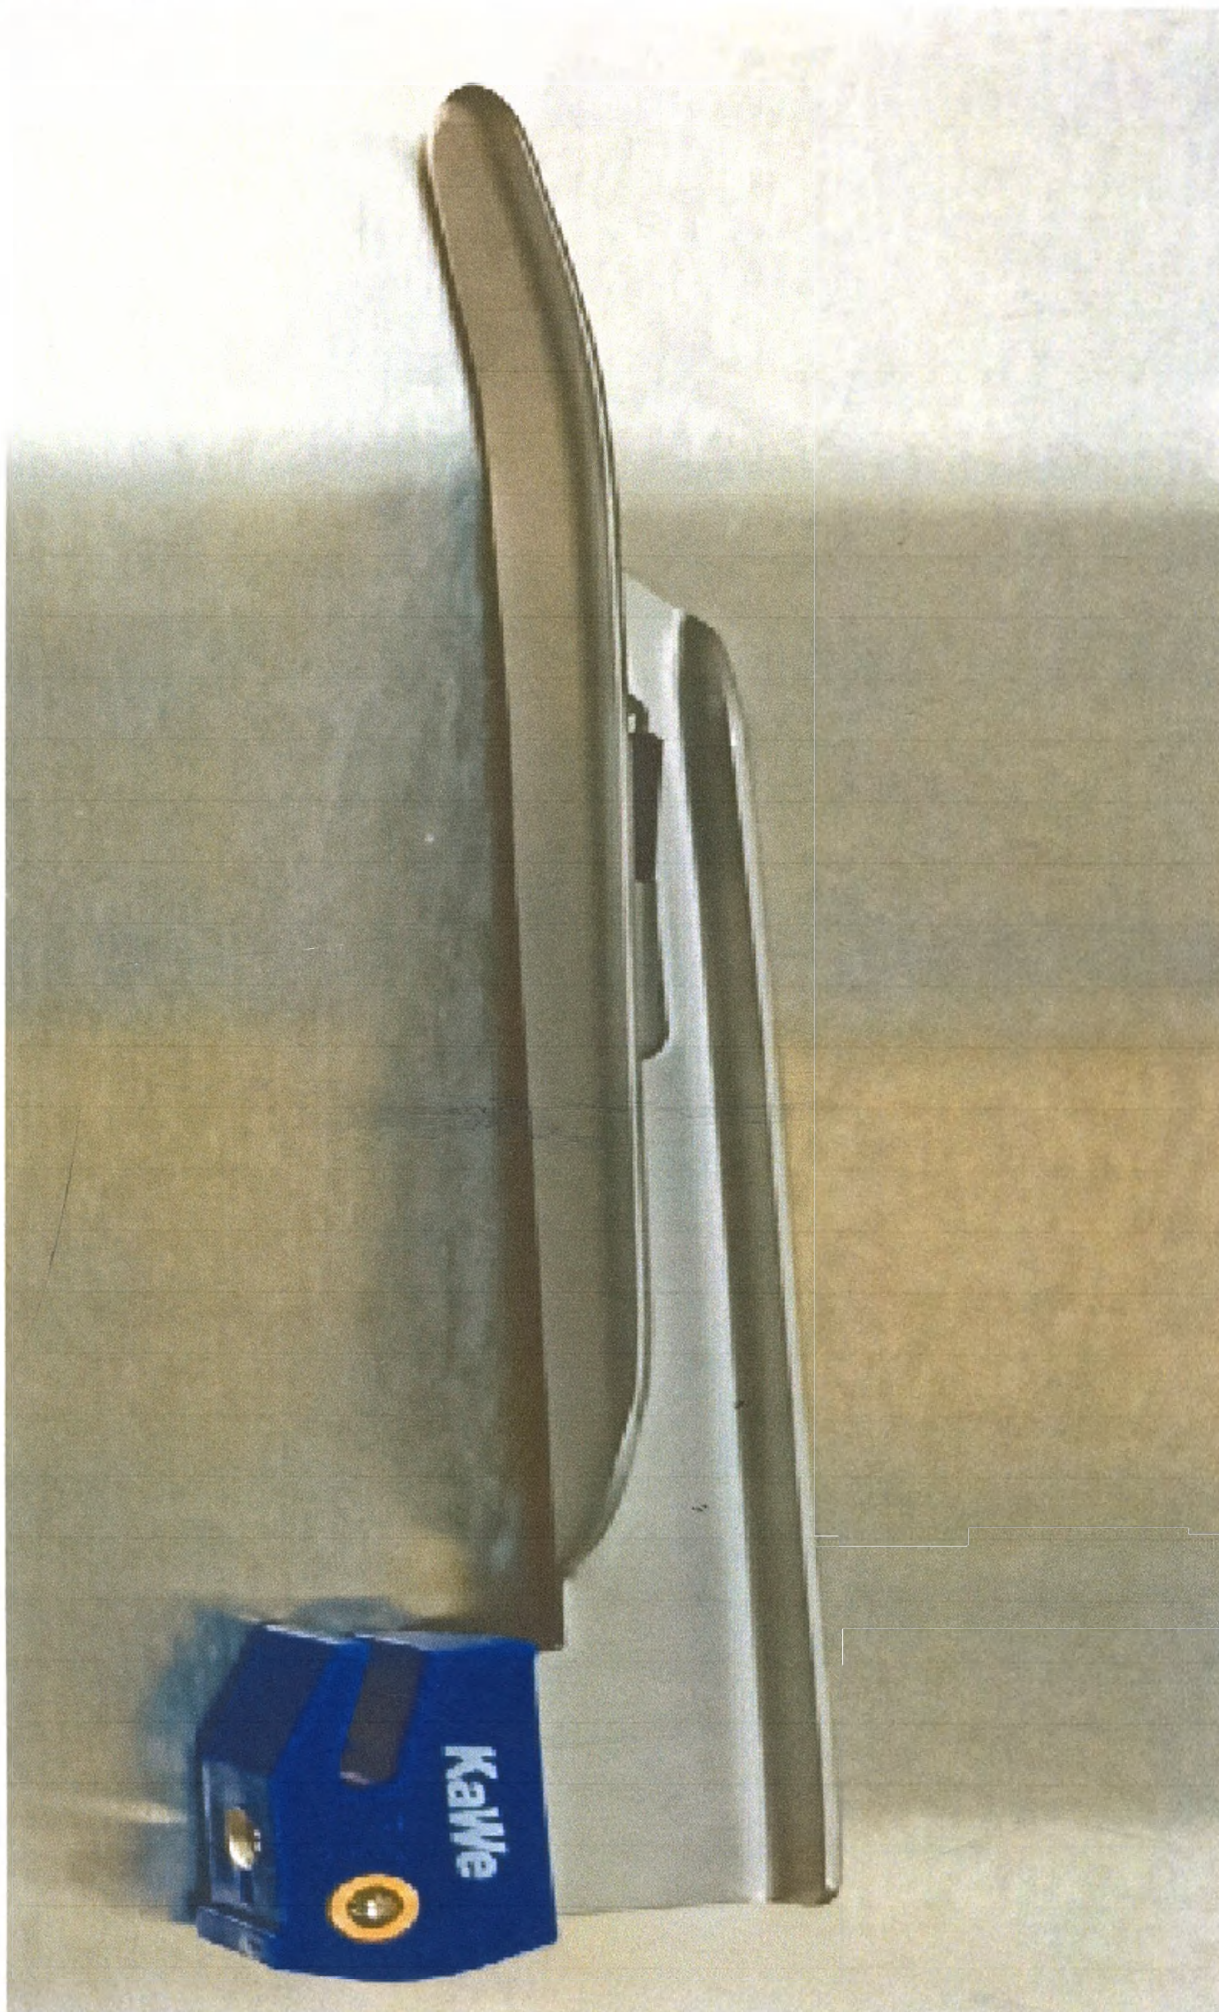


10. Клинок ларингоскопа стандартного освещения Миллер стальной одноразовый, размер 3, артикул 03.14020.632

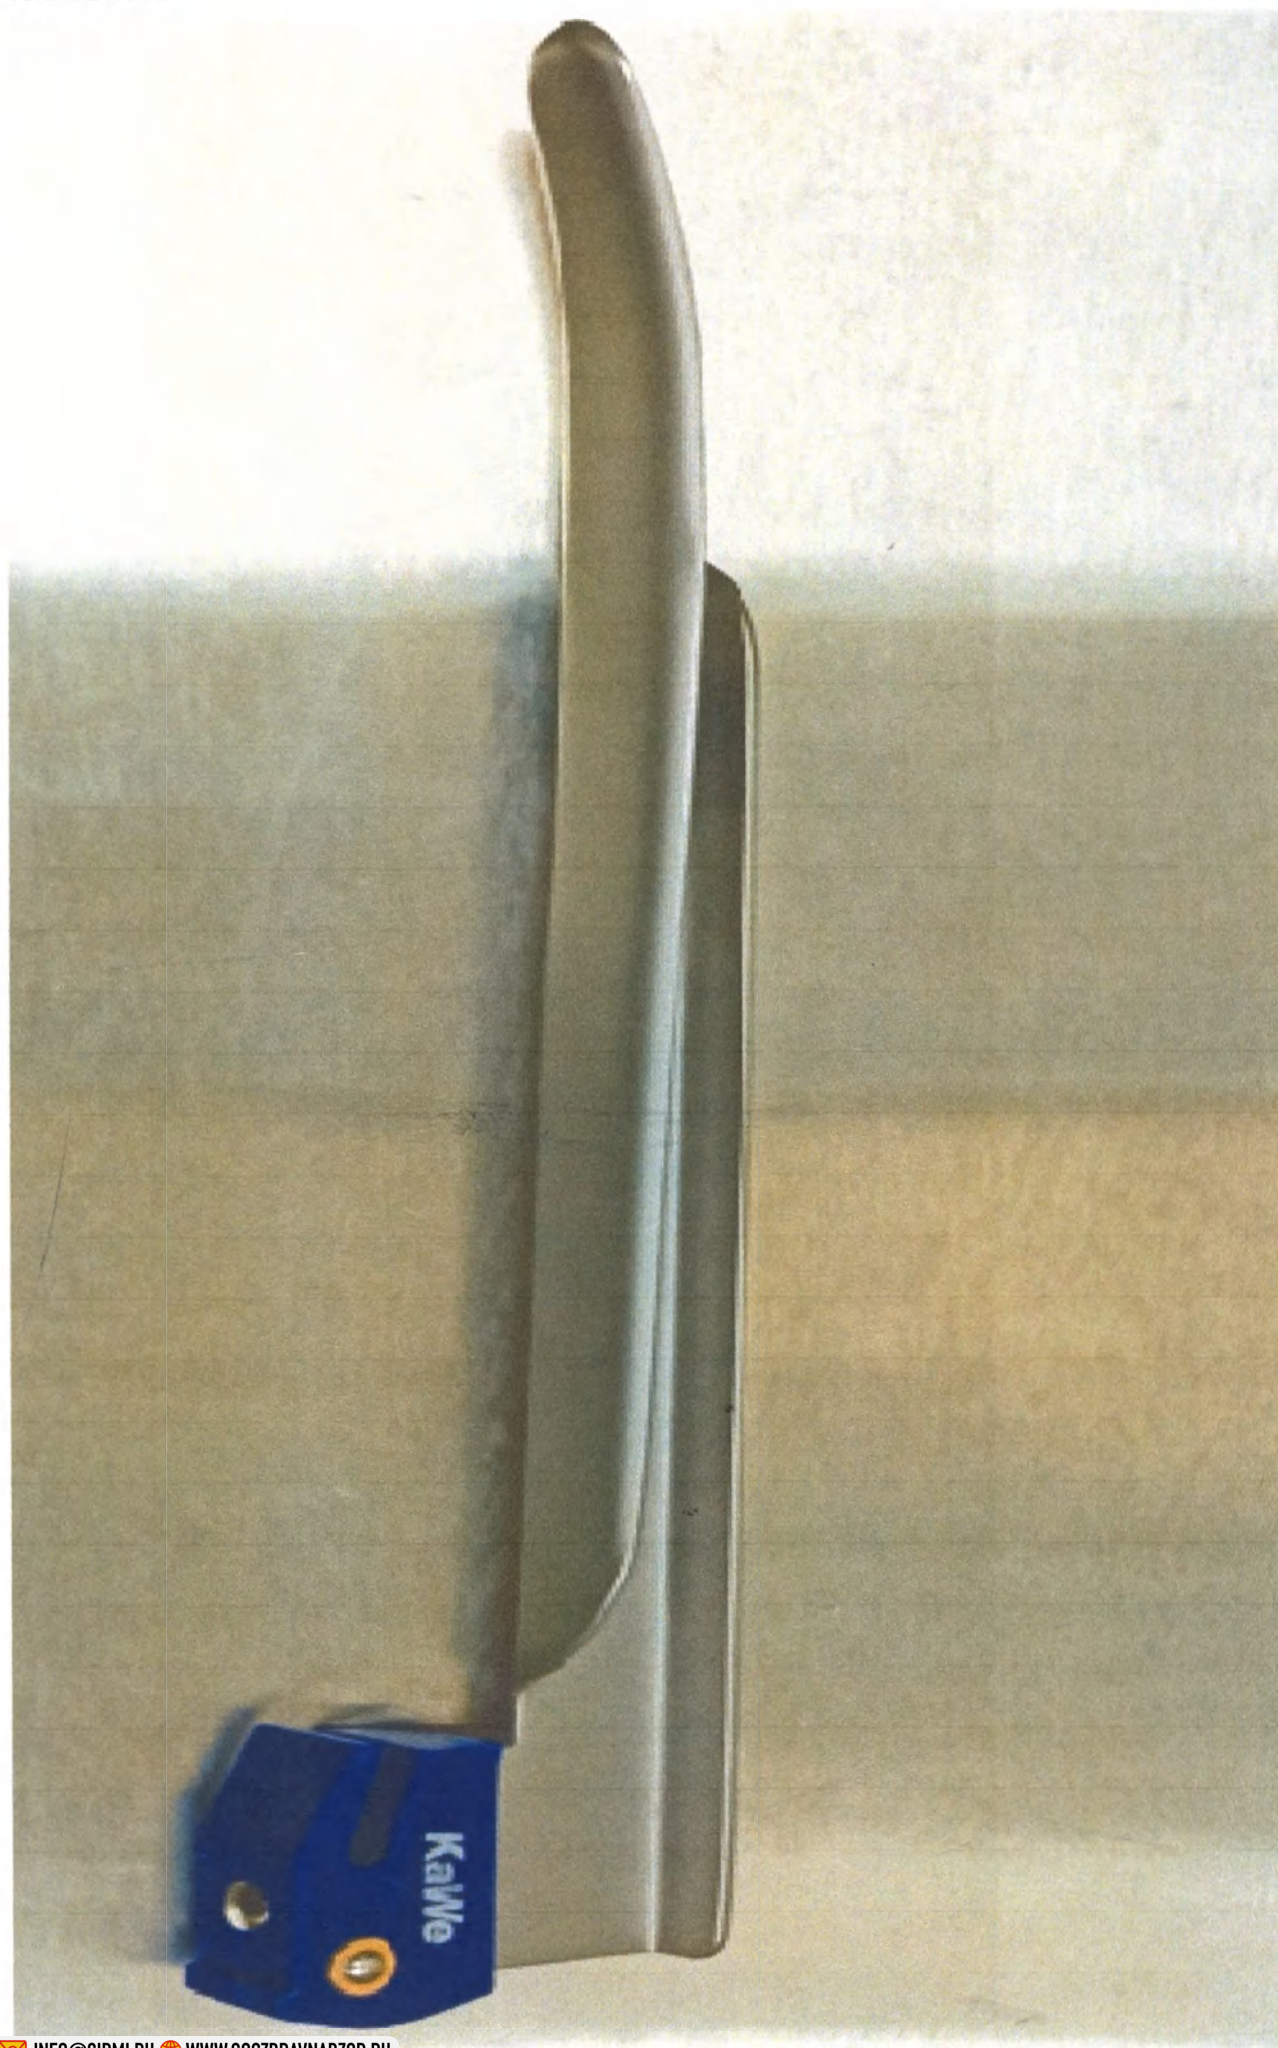

11. Клинок ларингоскопа стандартного освещения Миллер стальной одноразовый, размер 4, артикул 03.14020.642

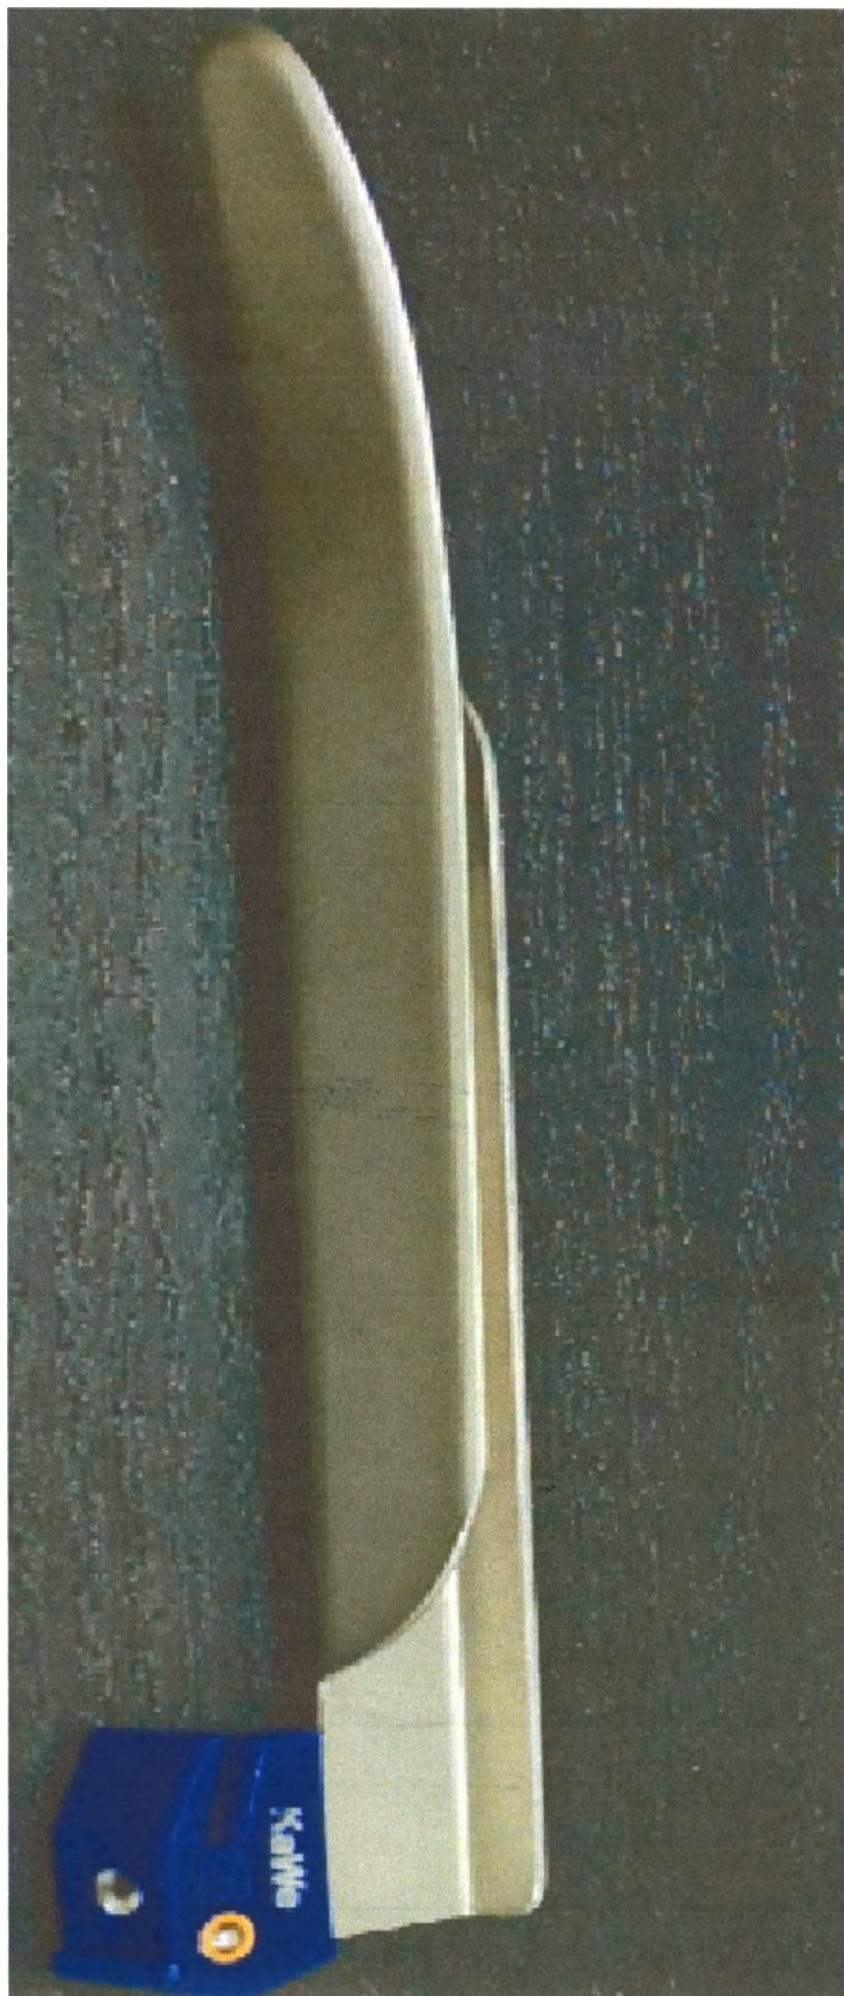

12. Клинок ларингоскопа фиброоптического освещения Макинтош стальной од-норазовый, размер 0, артикул 03.44014.602

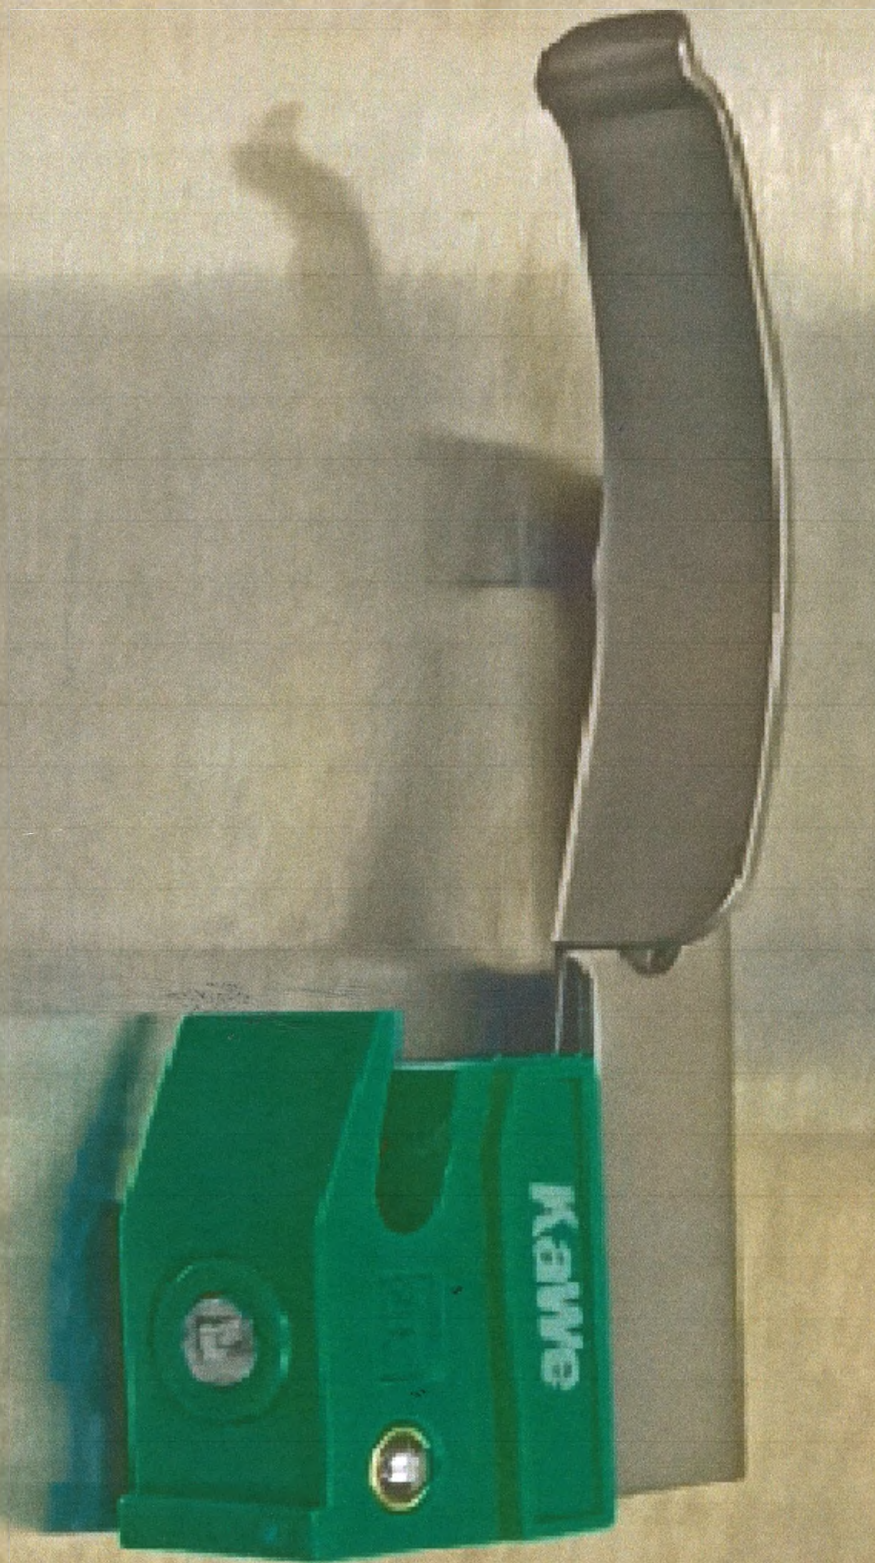

3. Клинок ларингоскопа фиброоптического освещения Макинтош стальной одноразовый, размер 1, артикул 03.44014.612






5. Клинок ларингоскопа фиброоптического освещения Макинтош стальной одноразовый, размер 3, артикул 03.44014.632



16. Клинок ларингоскопа фиброоптического освещения Макинтош стальной од-норазовый, размер 4, артикул 03.44014.642

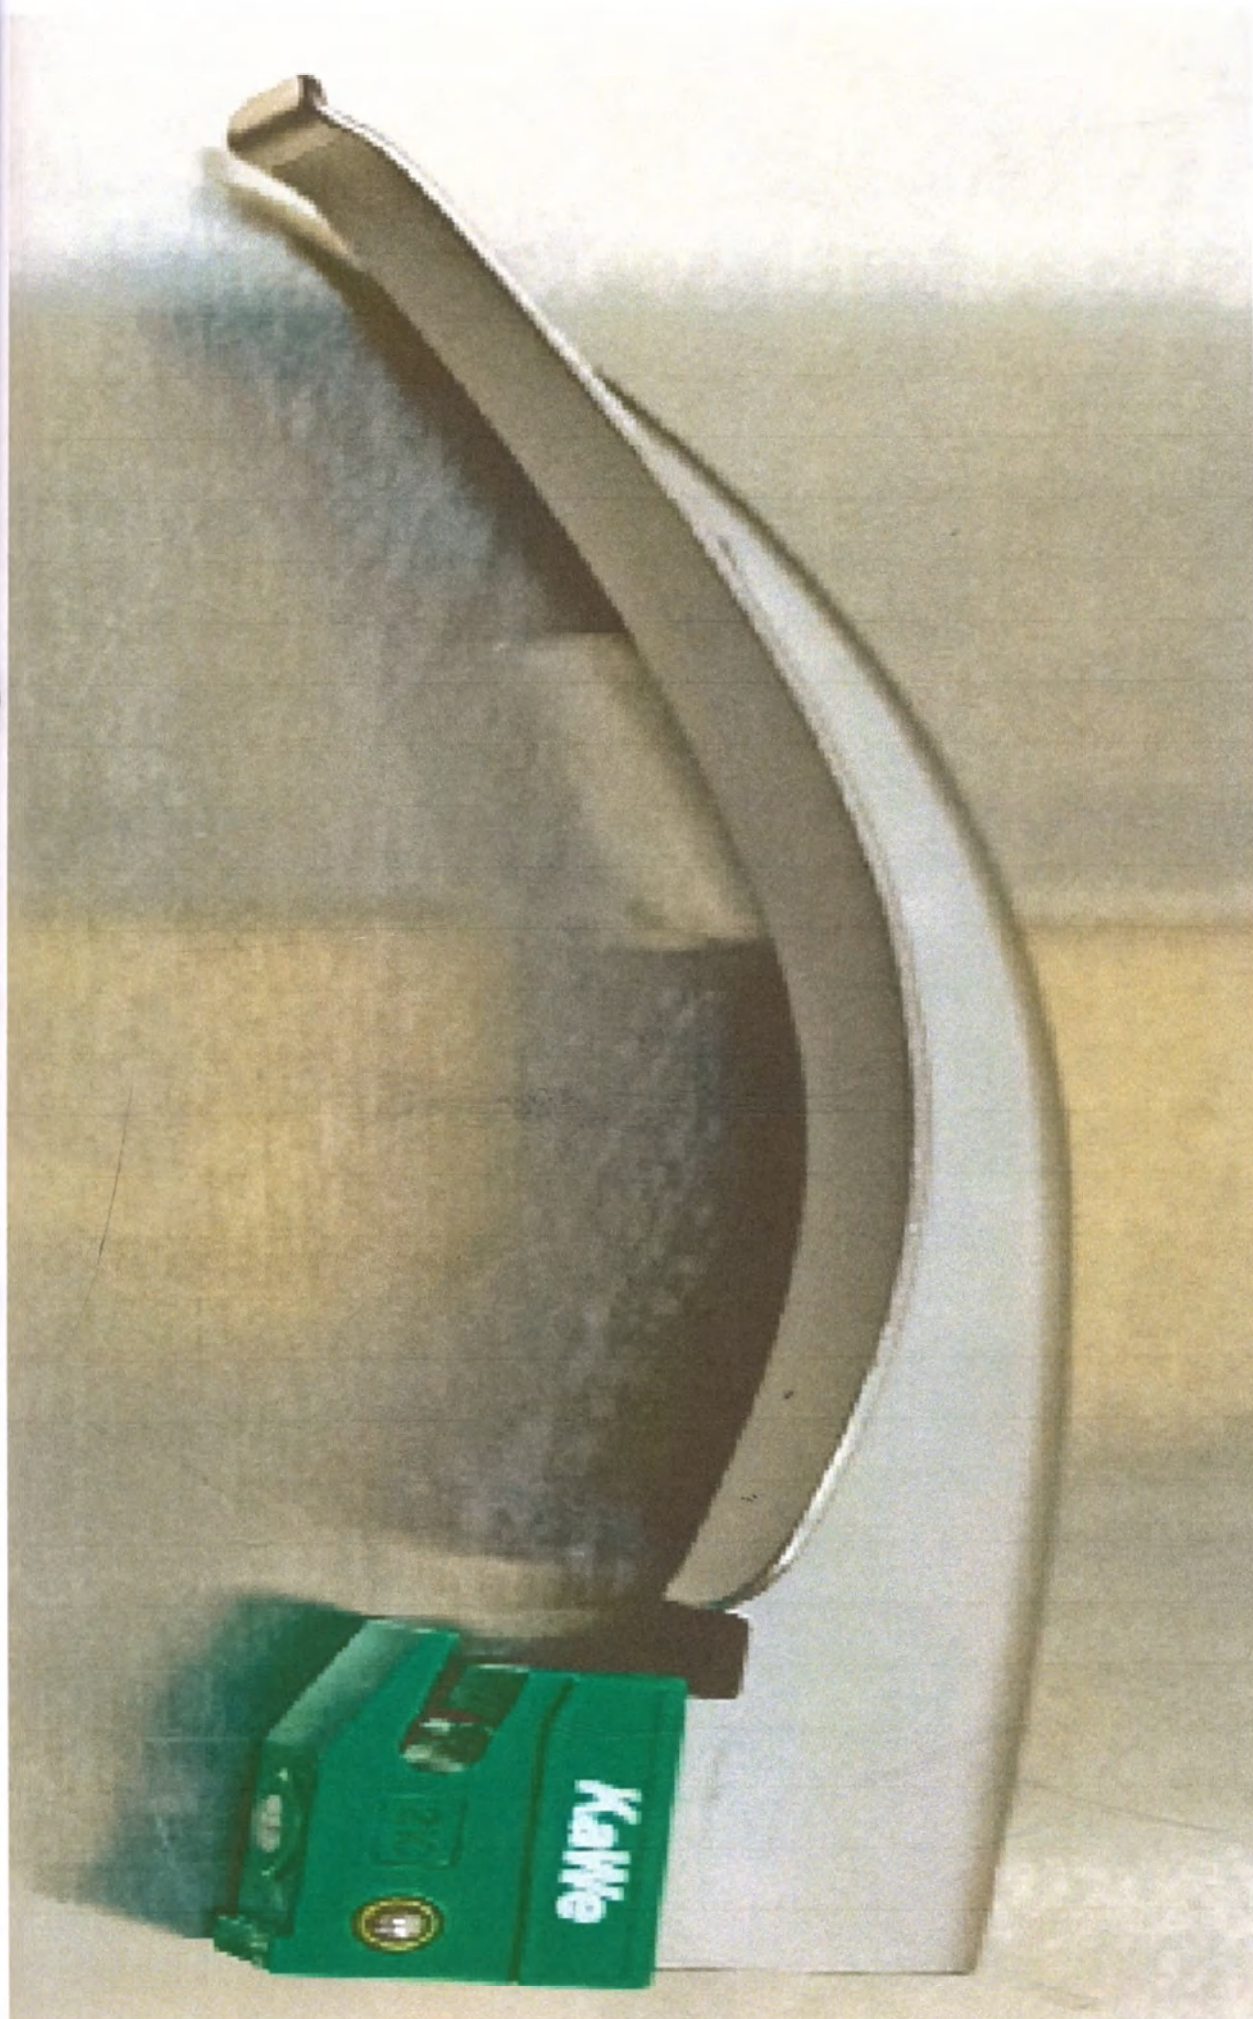


17. Клинок ларингоскопа фиброоптического освещения Миллер стальной одноразовый, размер 00, артикул 03.44024.592







Клинок ларингоскопа фиброоптического освещения Миллер стальной одноразовый, размер 1,
артикул 03.44024.612



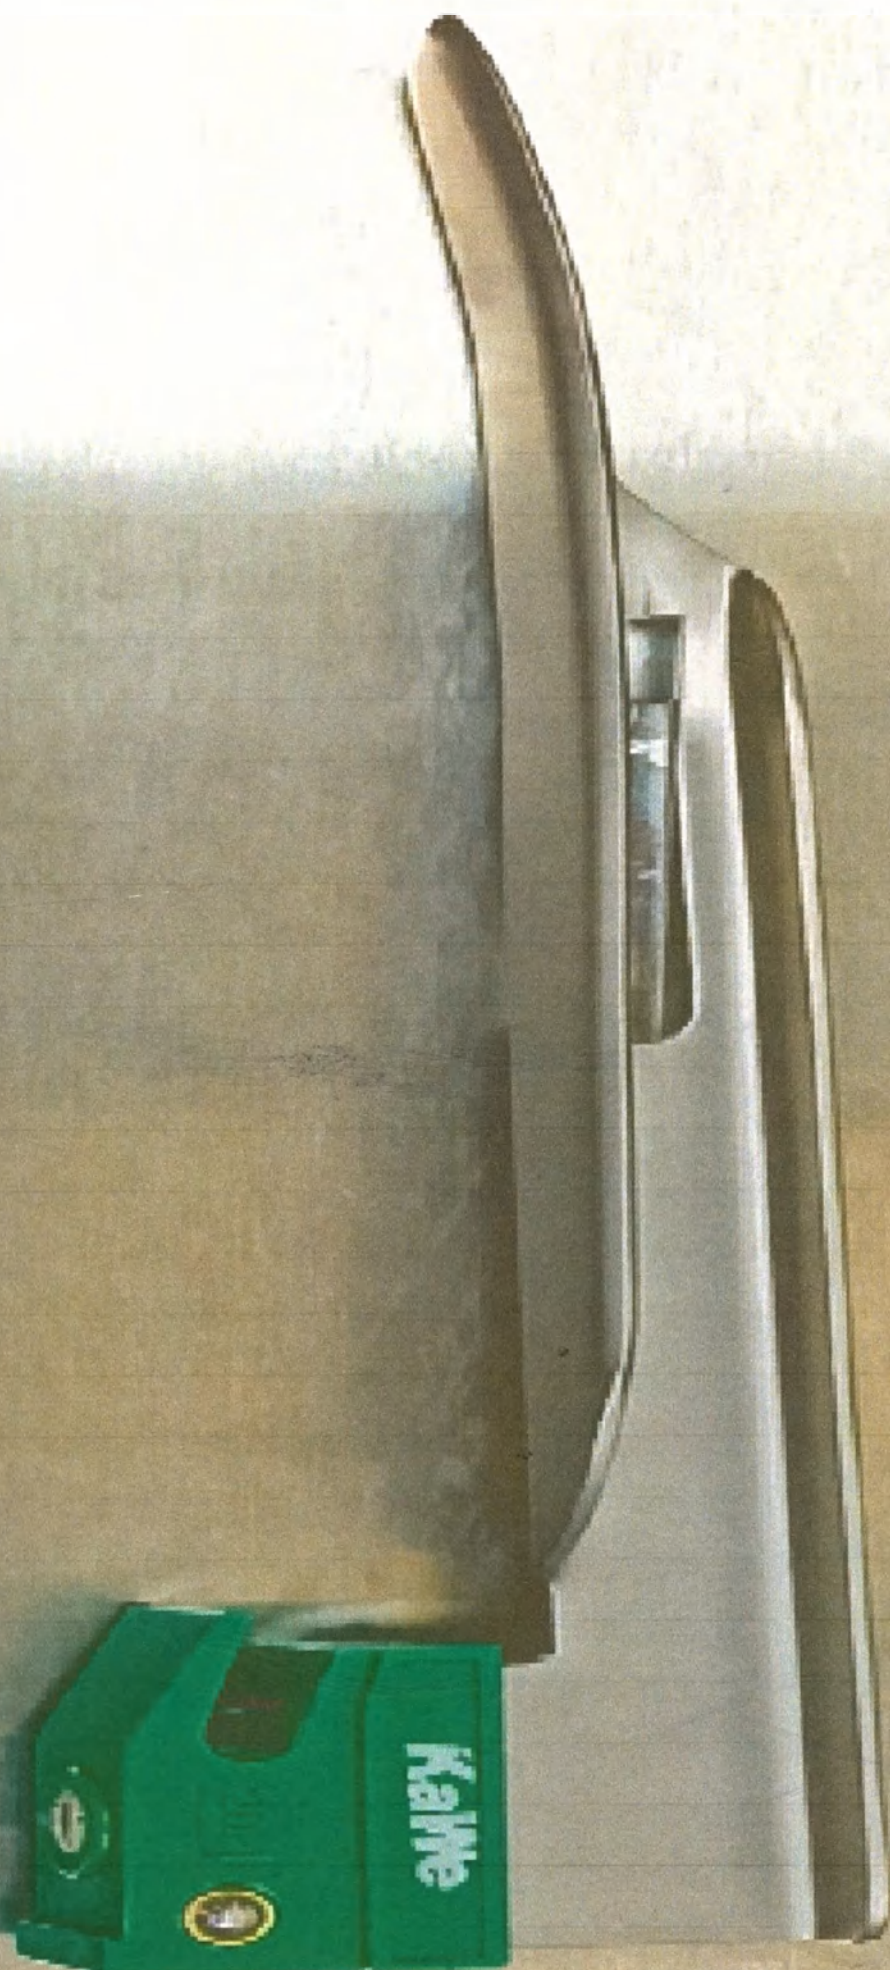

11. Клинок ларингоскопа фиброоптического освещения Миллер стальной одноразовый, размер 3, артикул 03.44024.632

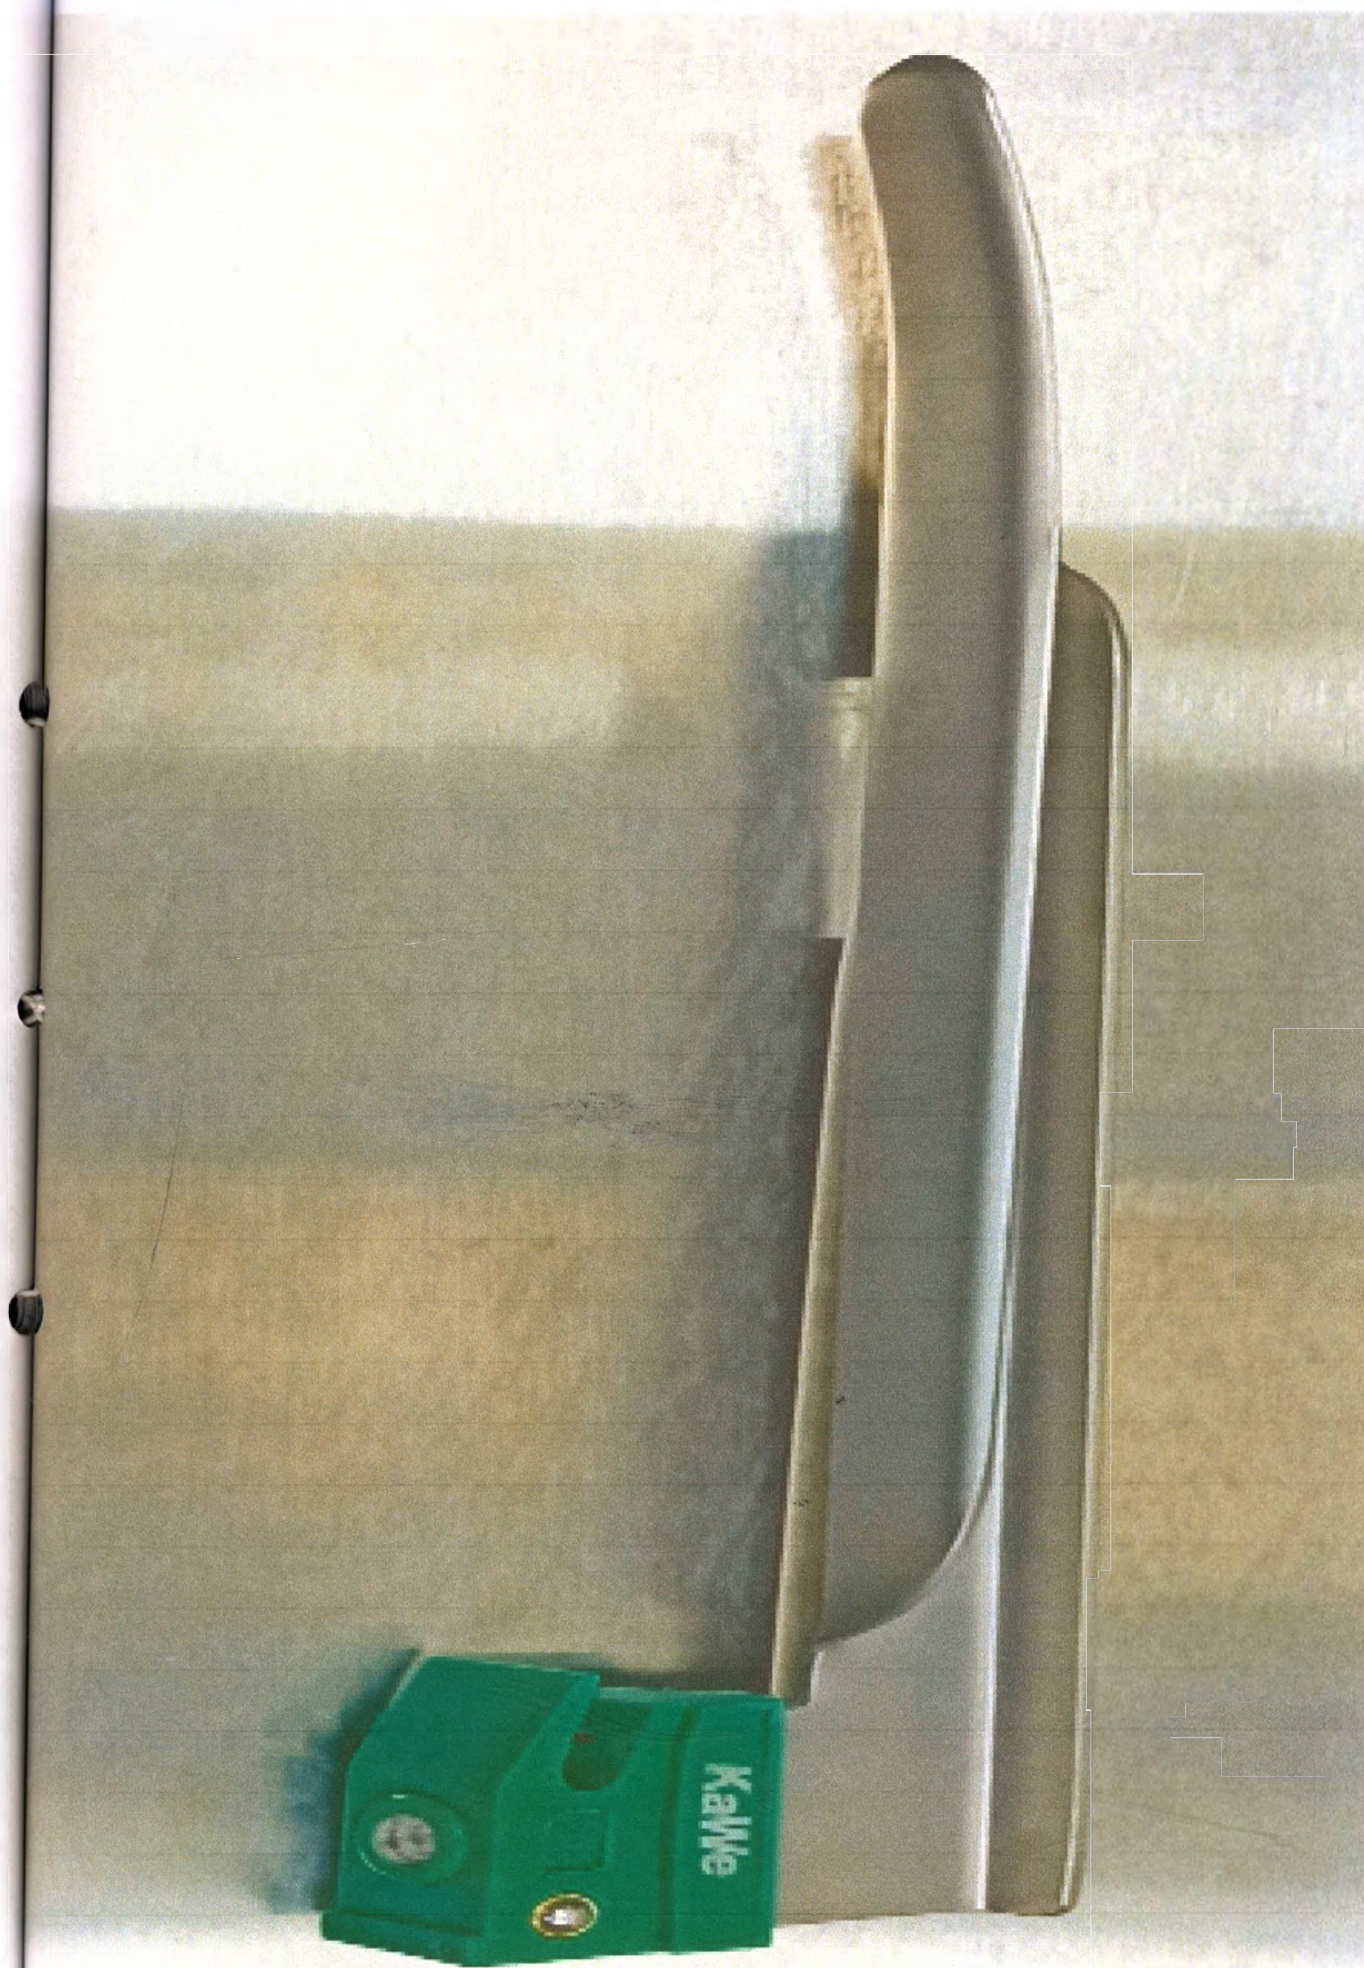

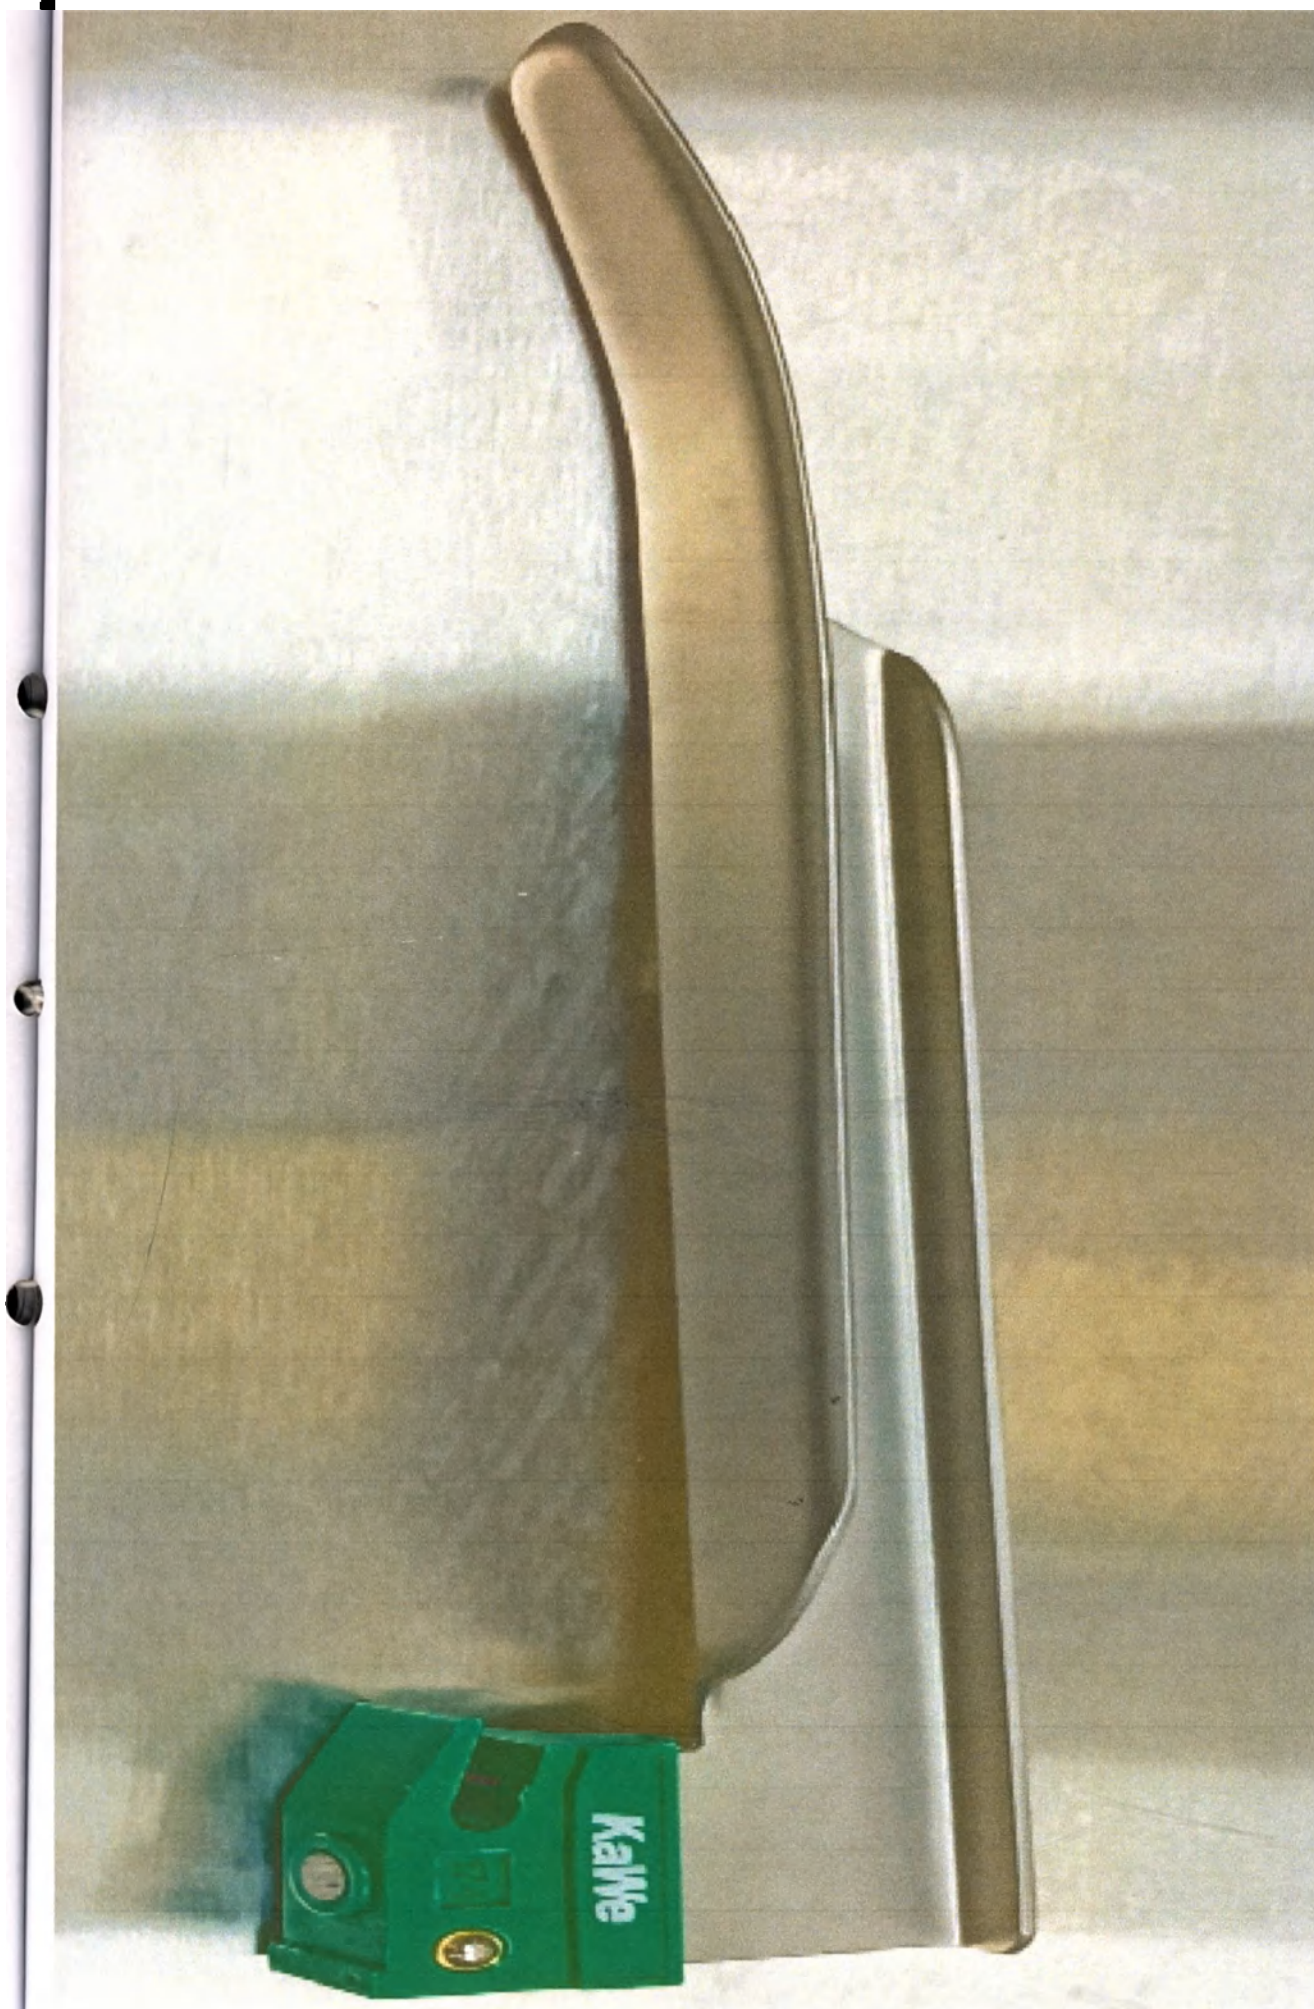


Клинок ларингоскопа фиброоптического освещения Макинтош пластиковый одноразовый, размер 2, артикул 03.43014.622







Клинок ларингоскопа фиброоптического освещения Макинтош пластиковый одноразовый, размер 4, артикул 03.43014.642



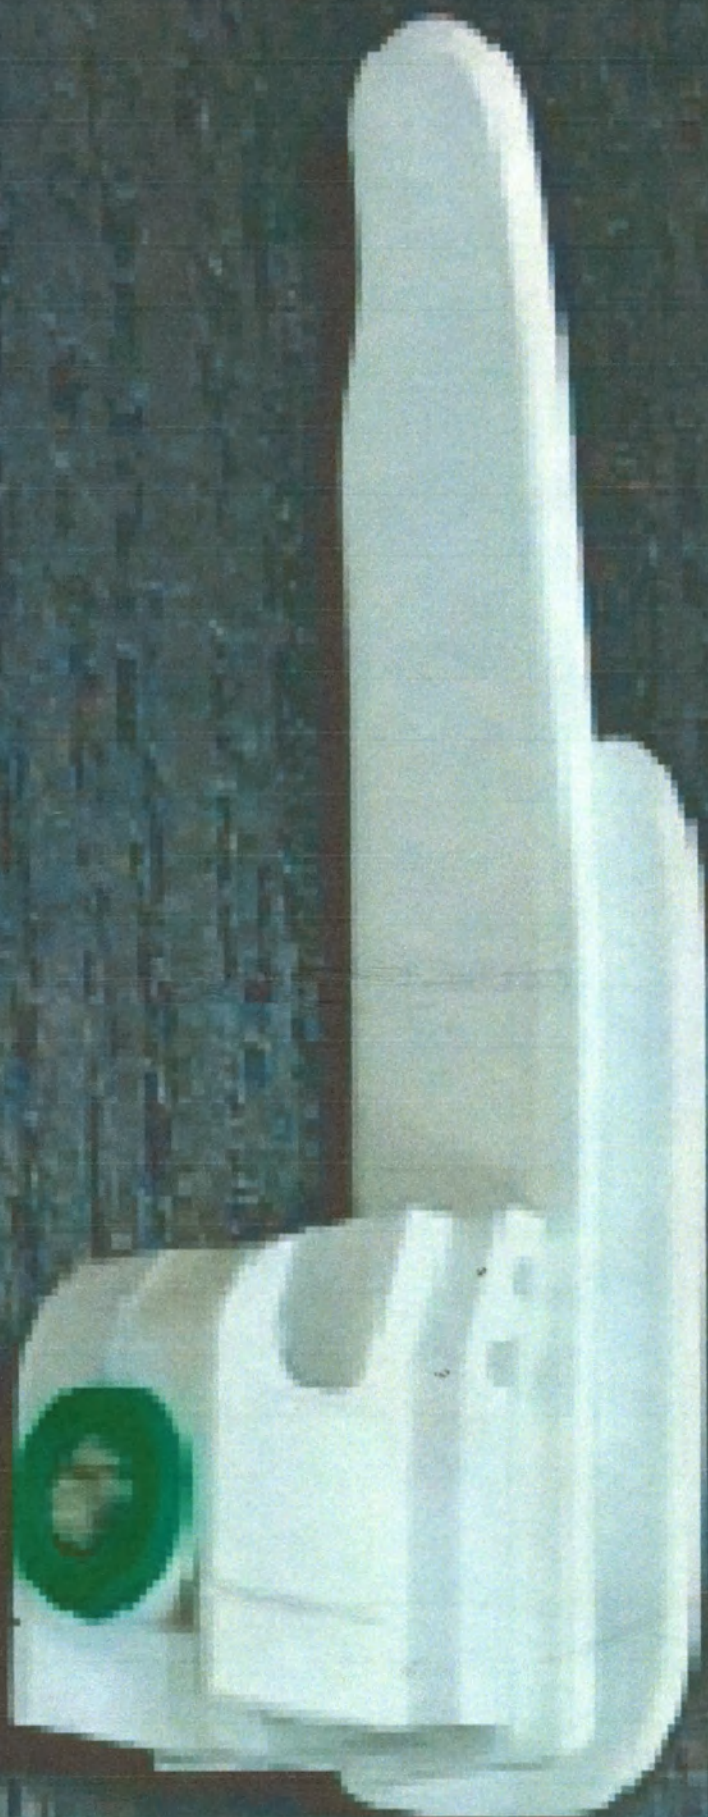

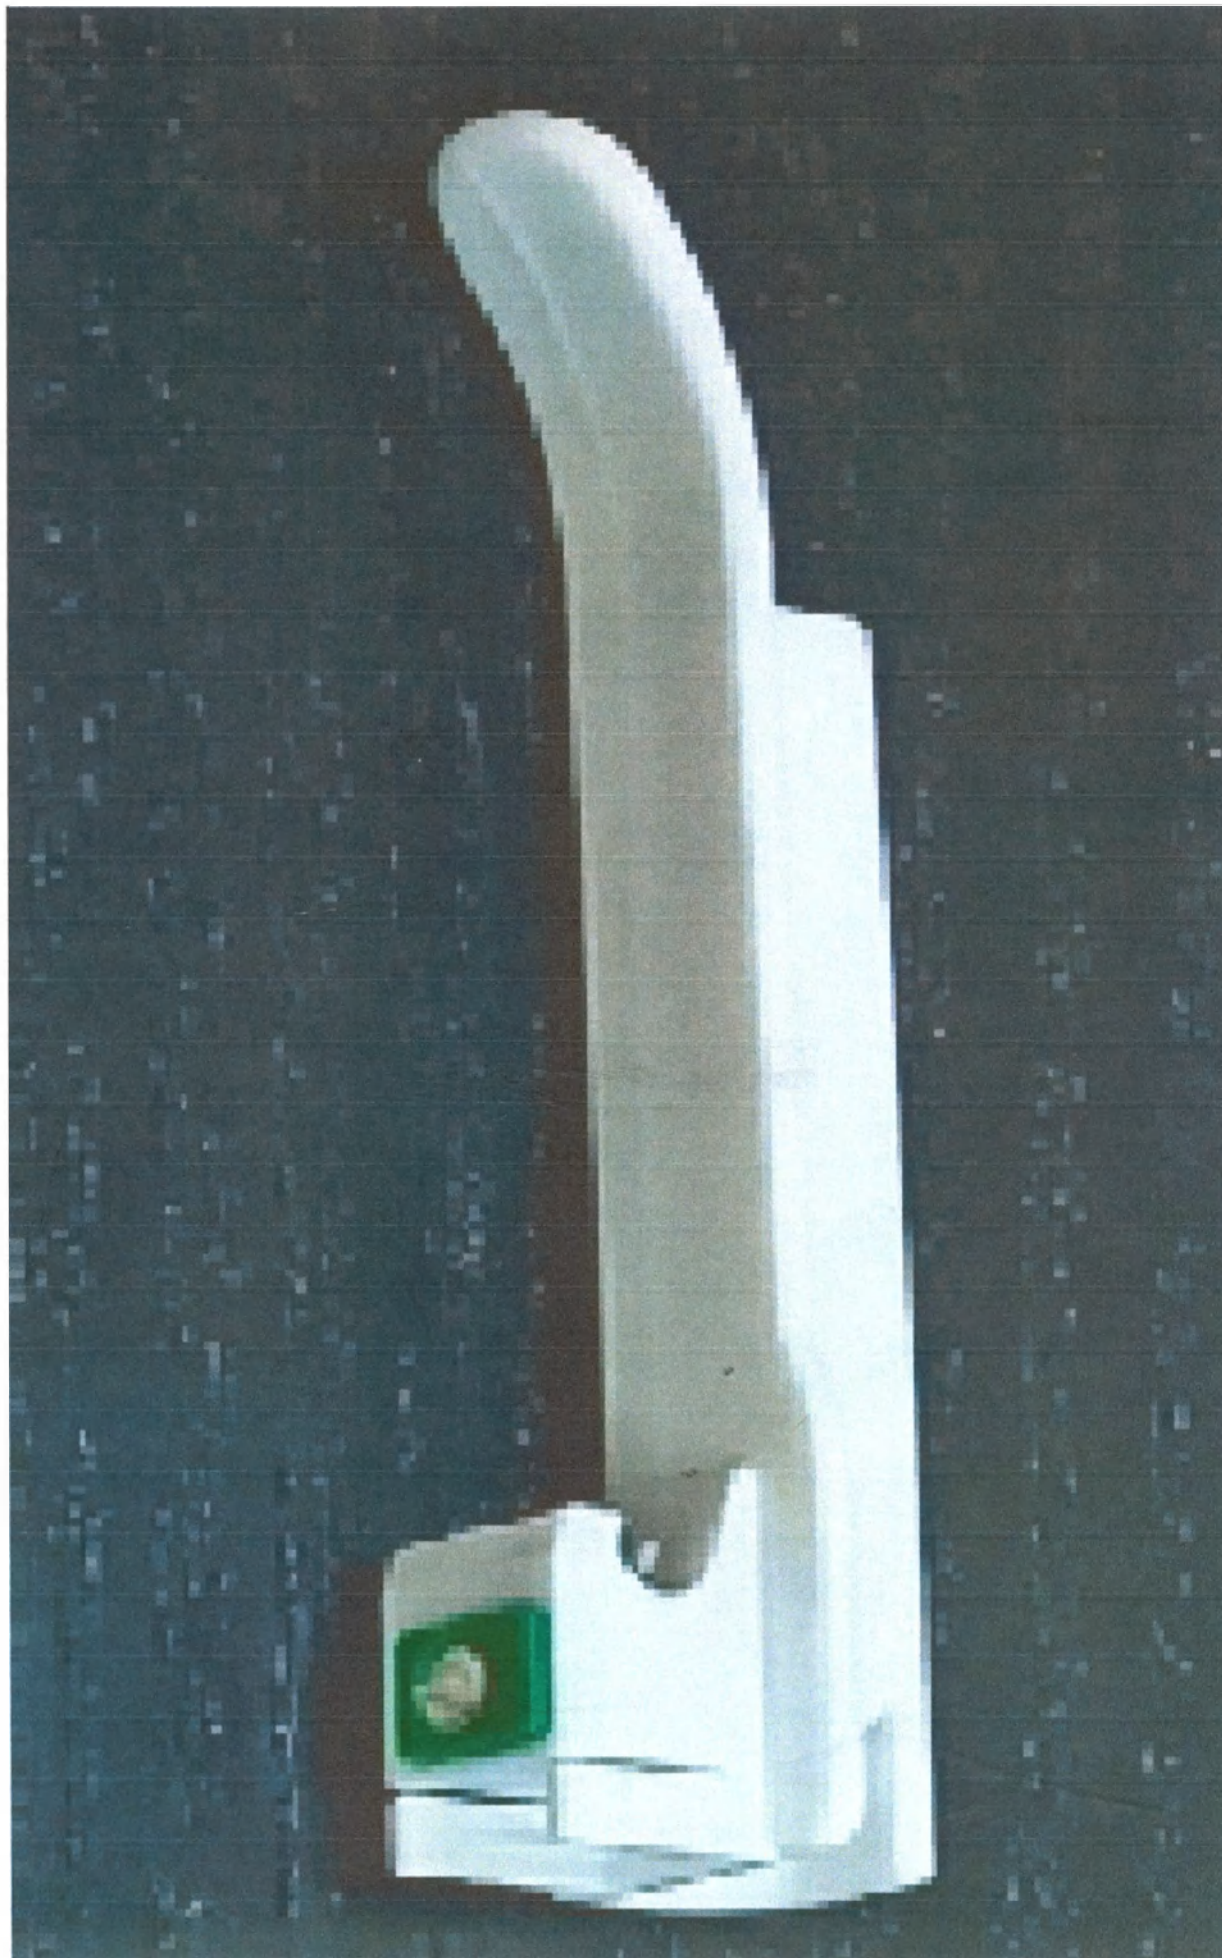



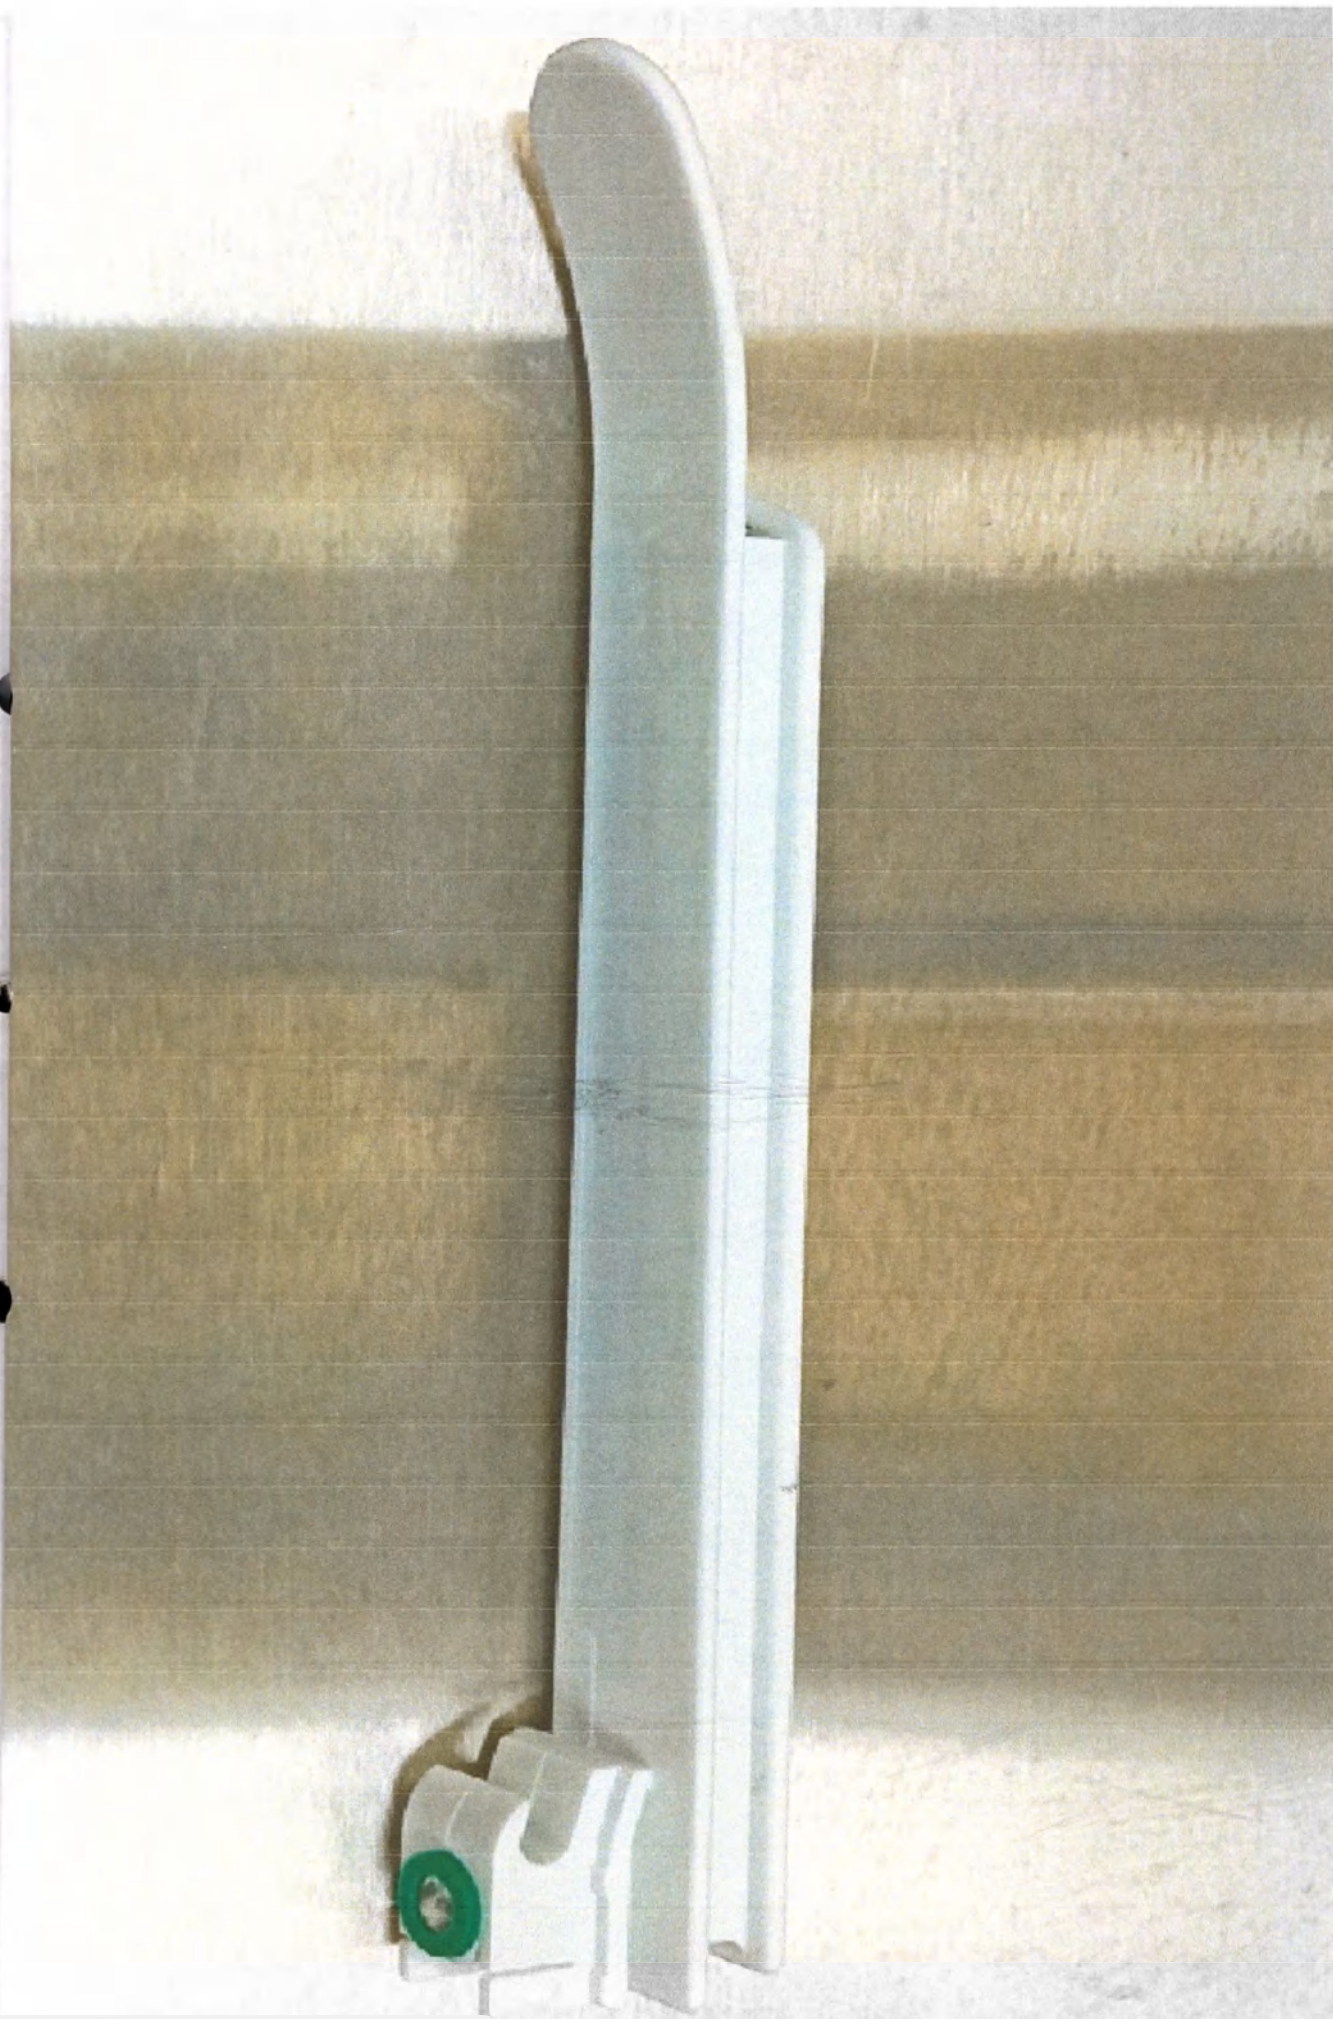



REF 03.14010.632

LOT 207



FA: 103318

13-6 mm
Einmal-Spatel Macintosh, Größe 3, unsteril, 10 Stk.
Disposable blades Macintosh, size 3, non sterile, 10 pcs
Laryngoskop Macintosh, Größe 3, non sterile, 10 pcs
Laryngoscope blades Macintosh, size 3, non sterile, 10 pcs
Laryngoscope Macintosh, Größe 3, non sterile, 10 pcs
Laryngoscope Macintosh, size 3, non sterile, 10 pcs

KaWe GmbH & Co. KG
Königsplatz 10, D-71634 Ludwigsburg
Tel. 0394 7797-140-140
www.ka-we.com



101304030156014214

INHALT
Konventioneller Einmal-Spatel kompatibel
ISO 7376

CONTENTS
One Single Use Standard Laryngoscope
Compatible with ISO 7376

СОДЕРЖАНИЕ
Одноразовый ларингоскопический
клинок, стандарт, совместим по
ISO 7376

Macintosh

- | | |
|---|---|
| ☐ 03.14010.602 Sz.0 | ☐ 03.14020.592 Sz.00 |
| ☐ 03.14010.612 Sz.1 | ☐ 03.14020.602 Sz.0 |
| ☐ 03.14010.622 Sz.2 | ☐ 03.14020.612 Sz.1 |
| ☒ 03.14010.632 Sz.3 | ☐ 03.14020.622 Sz.2 |
| ☐ 03.14010.642 Sz.4 | ☐ 03.14020.632 Sz.3 |
| | ☐ 03.14020.642 Sz.4 |

Miller

CLINICALLY CLEAN




LOT

207/807



57

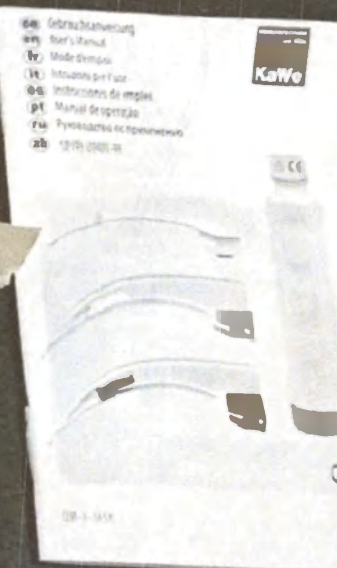



33 (медицинский)