

Фотографические изображения
медицинского изделия

**Набор реагентов in vitro для качественного определения
антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2
(MAGLUMI[®] HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюми-
несцентного анализа на автоматических анализаторах
MAGLUMI[®], в вариантах исполнения**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КПС»

Смирнов Э.А.


«24» октября

2023 г.


Вариант исполнения 1

**Набор реагентов in vitro для качественного определения
антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2
(MAGLUMI[®] HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминес-
центного анализа на автоматических анализаторах
MAGLUMI[®], 30 тестов**


Картридж с реагентами

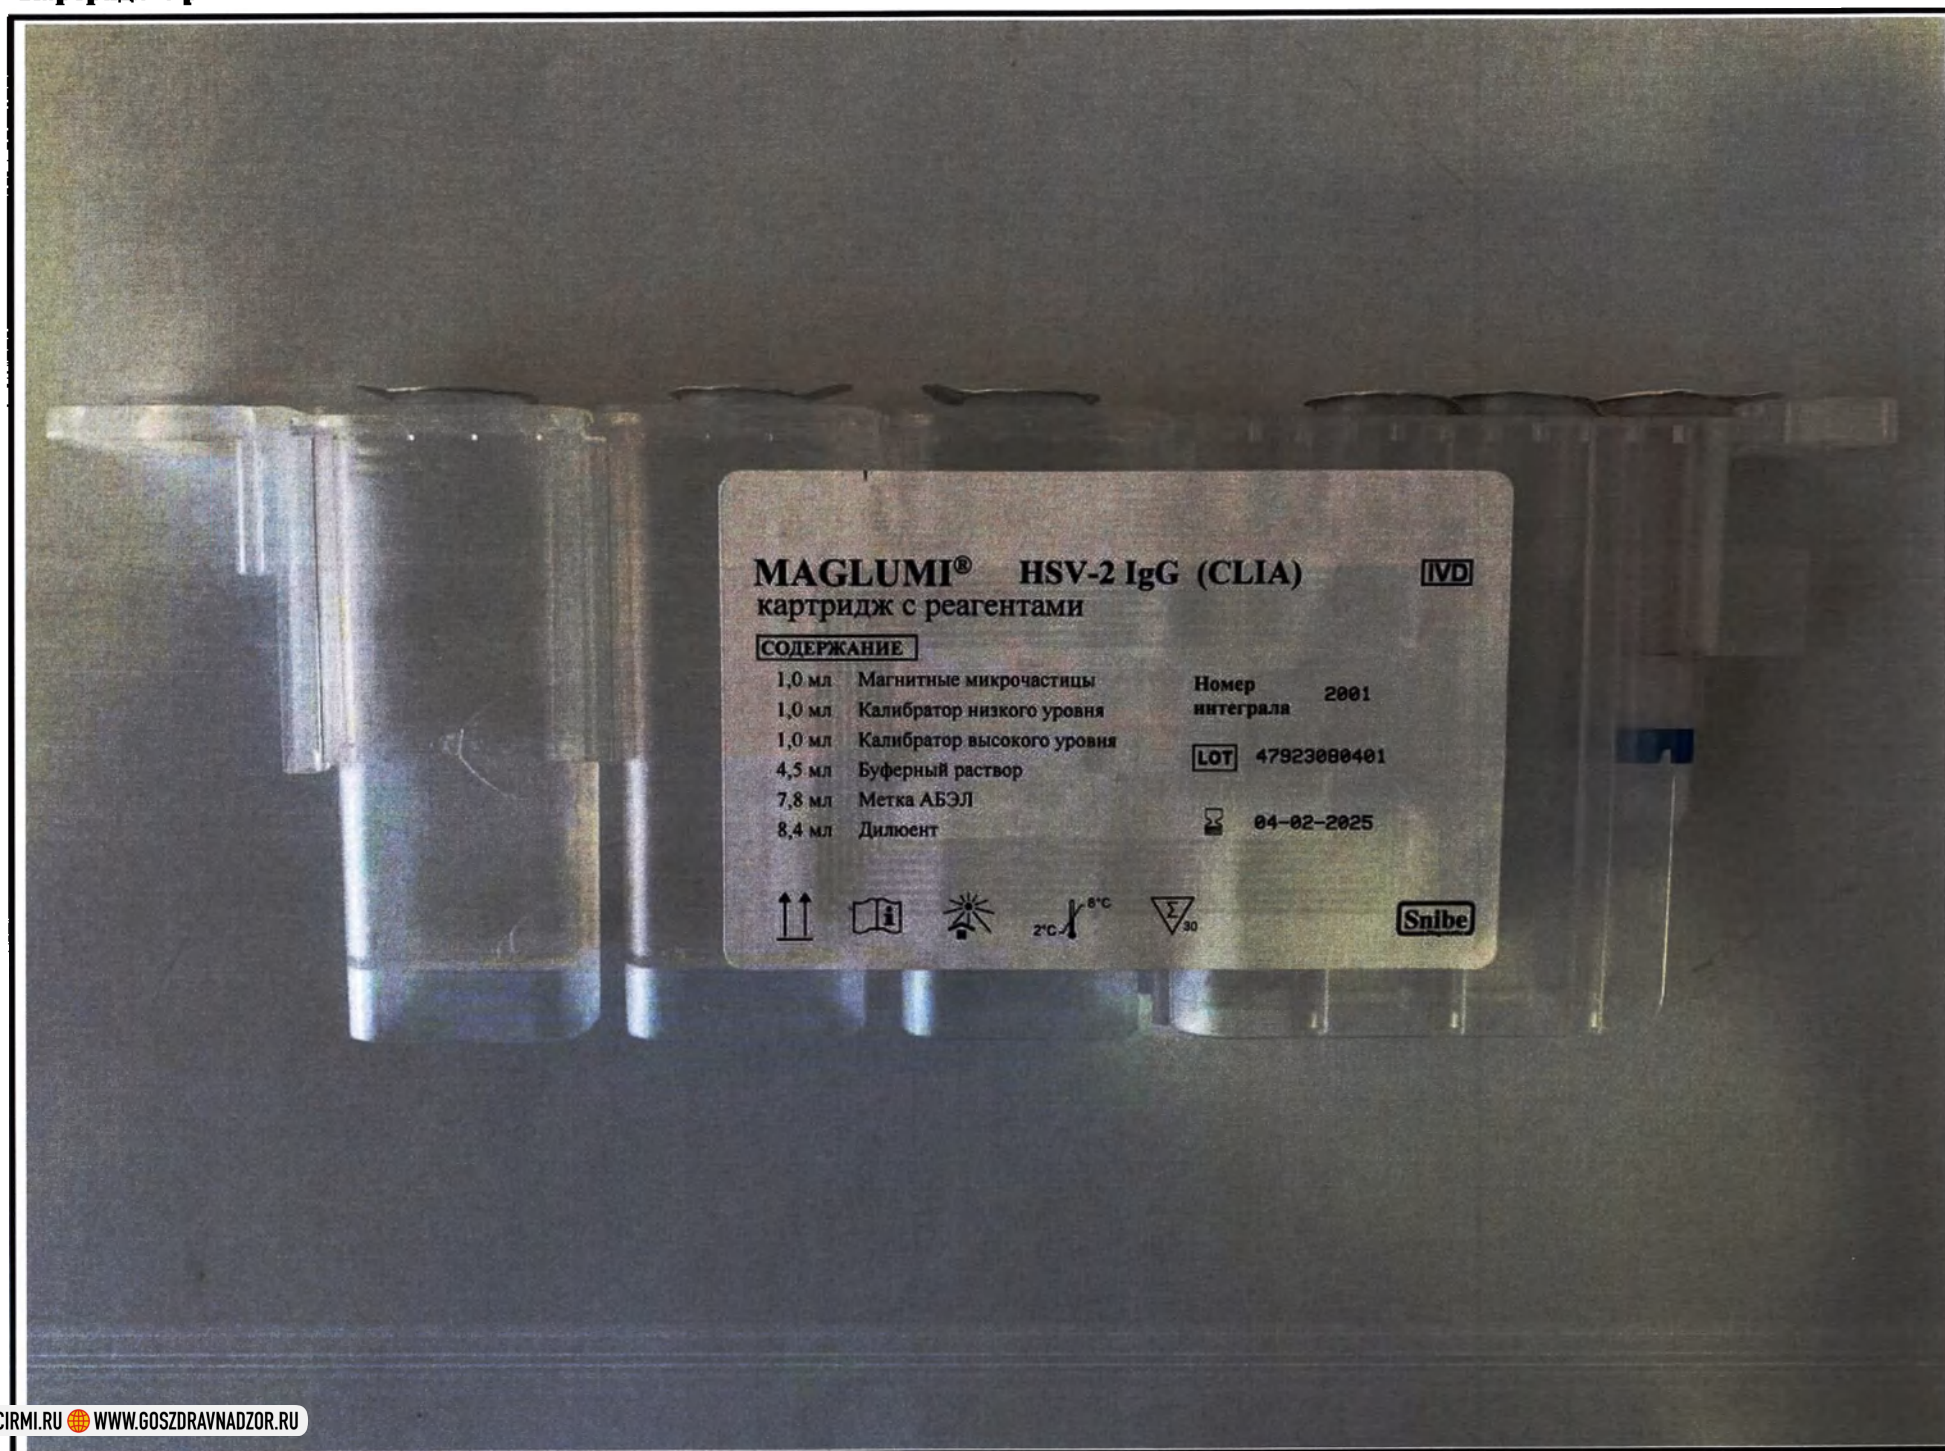


Отрицательный контроль

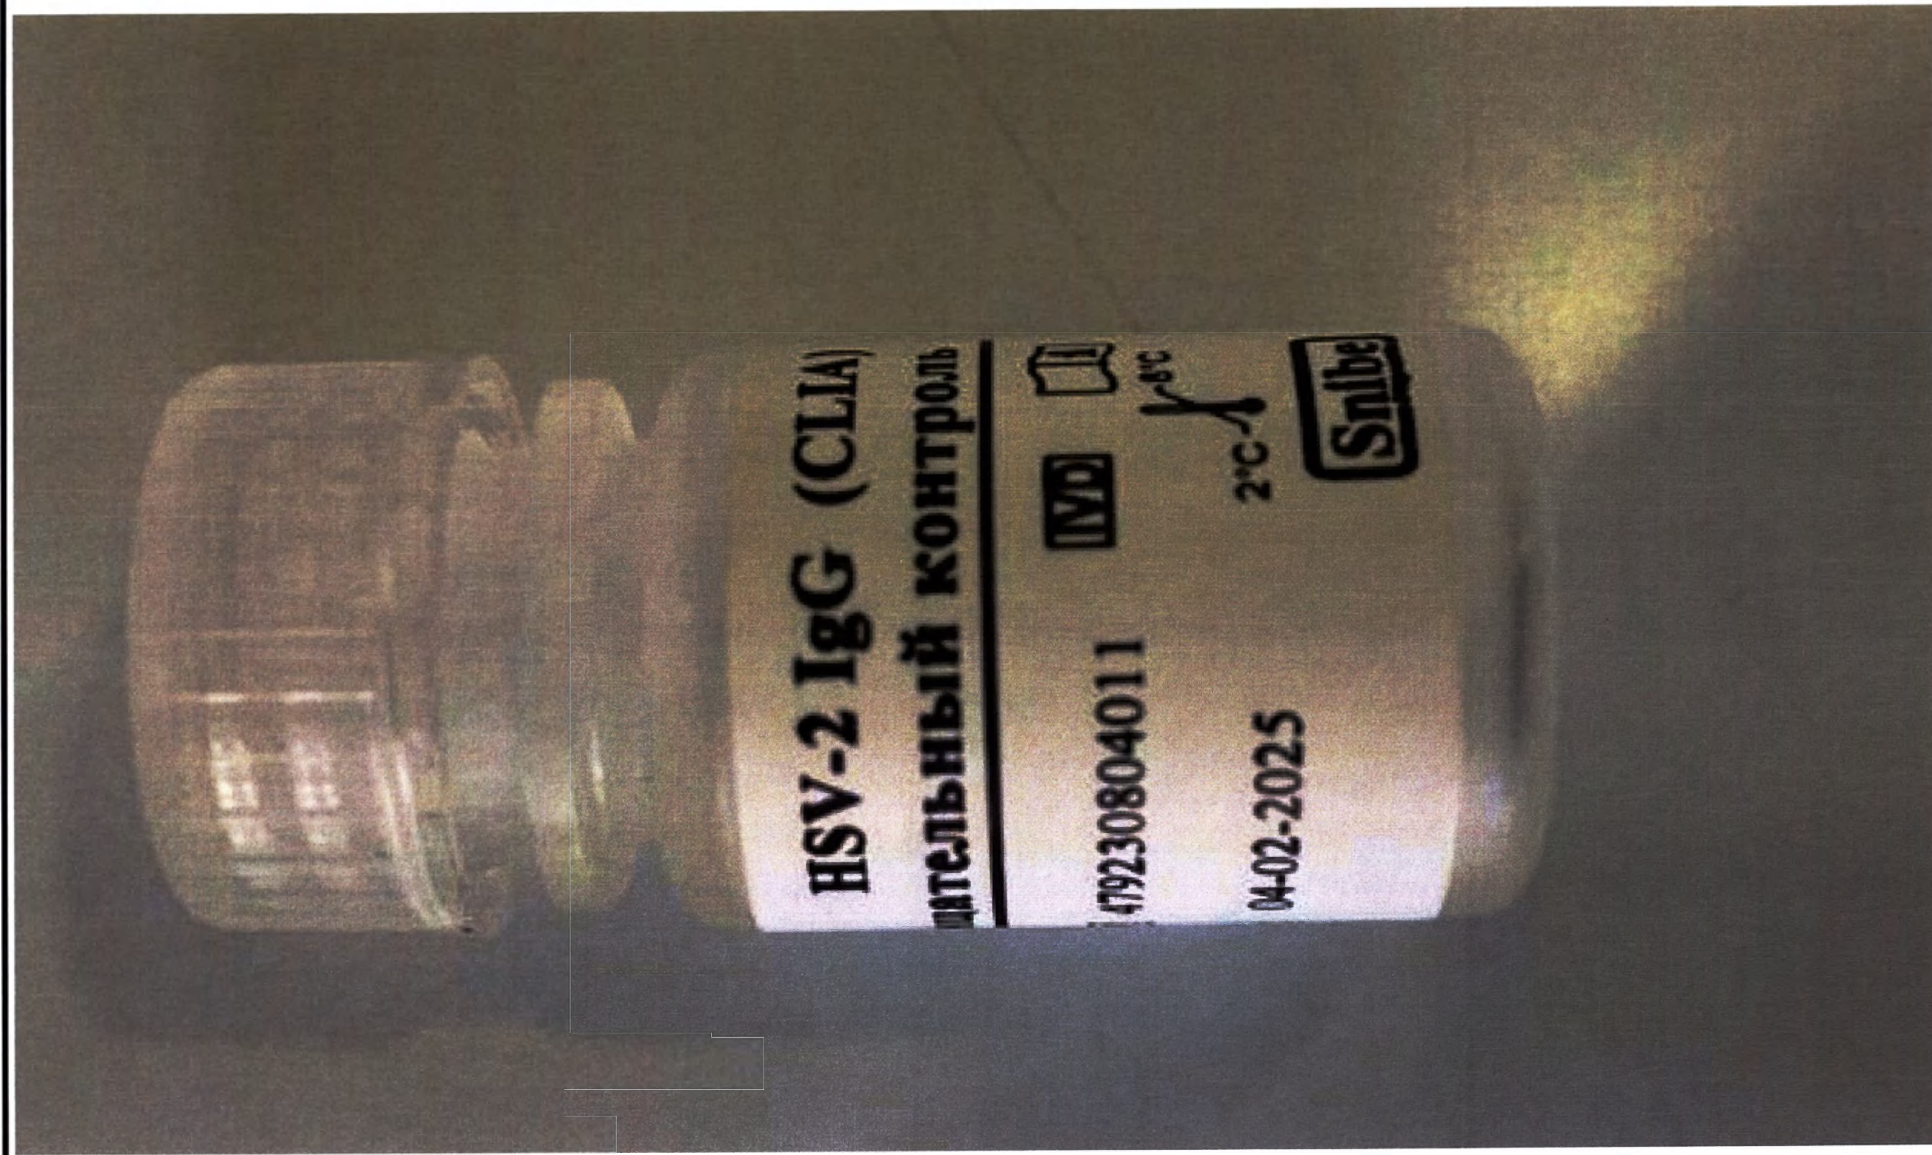

Положительный контроль

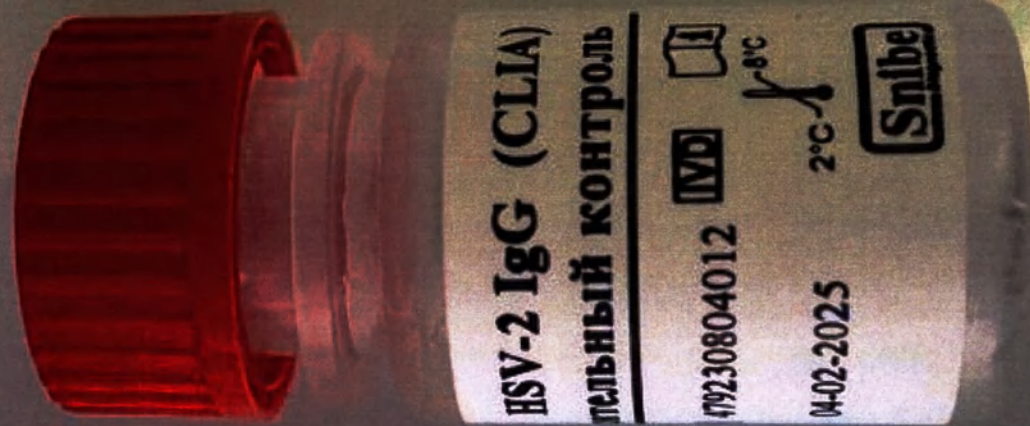

Лента для запечатывания картриджа с реагентами

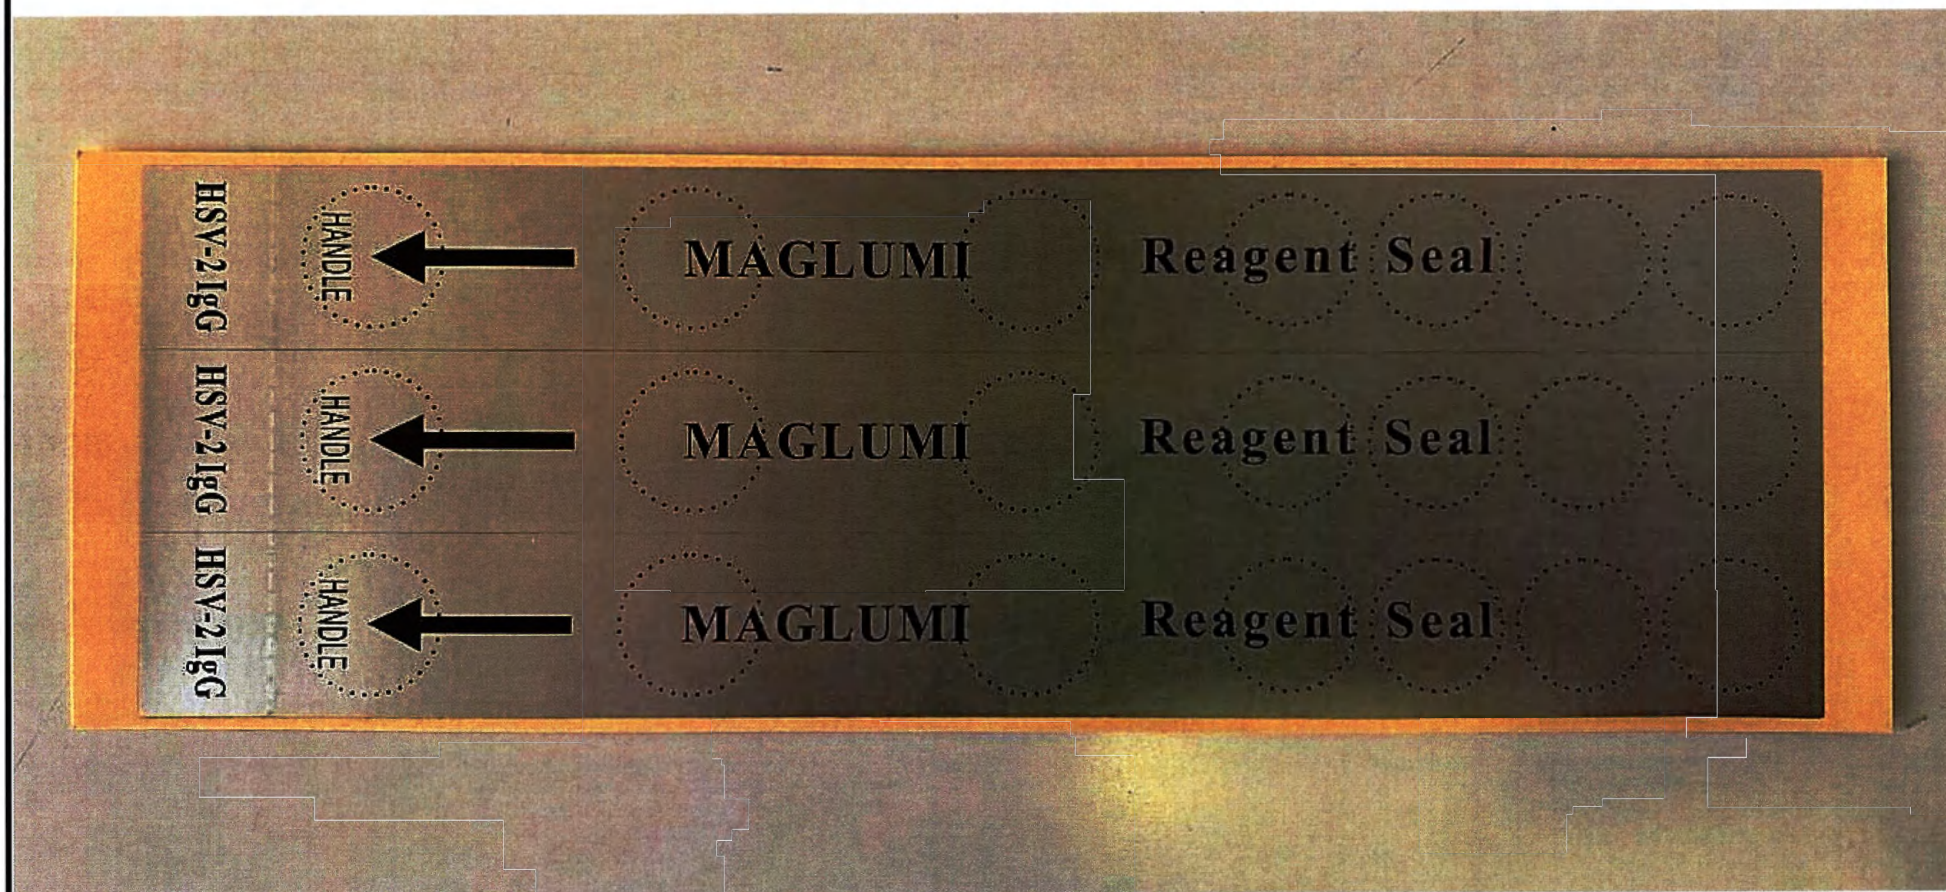

Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля



Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля



CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**



130262008M: 100 тестов
130662008M: 50 тестов
130762008M: 30 тестов

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 (MAGLUMI® HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики вируса простого герпеса 2, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АНАЛИЗА

Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), является одним из наиболее распространенных вирусных заболеваний, передающихся половым путем, во всем мире¹. ВПГ представляет собой вирус с двуспиральной ДНК и относится к семейству вирусов герпеса человека, официально известному как *Herpesviridae*². Вирус существует в 2 формах: ВПГ-1 и ВПГ-2. Два типа ВПГ отличаются антигенными различиями в белках их оболочек^{2,3}. Большинство инфекций полости рта, лица и глаз являются результатом ВПГ-1, в то время как на ВПГ-2 приходится большинство герпетических поражений гениталий и кожи нижней части тела².

Первичный герпетический гингивостоматит (ПГГ) - это инфекция полости рта, вызываемая вирусом простого герпеса⁴. Первичный герпетический гингивостоматит может включать как оральные, так и экстраоральные поражения, опухшие и кровоточащие десны, а также такие симптомы, как боль, лихорадка, раздражительность, недомогание, головная боль и инфекция верхних дыхательных путей⁴. ВПГ-1 может вызывать губной герпес. Заражение ВПГ-2 также может привести к первичному лабиальному герпесу, но этот тип редко вызывает рецидив недуга⁵. Первичная инфекция вирусом простого герпеса может привести к тяжелому заболеванию во время беременности⁶. Поскольку инфекция часто встречается у женщин репродуктивного возраста, ею можно заразиться и передать плоду во время беременности и новорожденному⁷. Последствиями могут быть прерванная беременность, преждевременные роды, плод с задержкой внутриутробного развития, врожденные пороки развития или мертворождение^{6,8}.

Генитальный герпес (ГГ), вызываемый ВПГ-1 или ВПГ-2, является одним из наиболее распространенных заболеваний, передающихся половым путем во всем мире, ВПГ-2 стал наиболее распространенной причиной язвенной болезни гениталий⁹. Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), может проявляться различными путями¹⁰. У женщин это вызывает образование пузырей и язв на наружных половых органах и шейке матки, что приводит к боли в области вульвы, дизурии, выделениям из влагалища и местной лимфаденопатии. Также наблюдаются везикулярные и язвенные поражения внутренней поверхности бедра, ягодиц, промежности или перианальной области. Как у мужчин, так и у женщин первичная инфекция может осложняться системными симптомами, такими как лихорадка, головная боль, миалгия (38% у мужчин, 68% у женщин) и иногда менингитом, а также вегетативной невропатией, приводящей к задержке мочи, главным образом у женщин⁷. Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса (ВПГ), являются распространенной причиной паховой лимфаденопатии. Кроме того, предыдущие исследования показали корреляцию между паховой лимфаденопатией, вызванной ВПГ, и последующим развитием поражений гениталий, связанных с ВПГ. Хотя ВПГ встречается редко, первоначально он может проявляться в виде паховой лимфаденопатии без других сопутствующих симптомов¹¹. Серологическое тестирование, специфичное для типов IgG и IgM, вскоре после появления первых симптомов, указывающих на генитальный герпес, может помочь определить, является ли инфекция новой или ранее существовавшей¹².

ПРИНЦИП АНАЛИЗА

Сэндвич-метод иммунохемилюминесцентного анализа

Образец, дилуент, буфер, магнитные микрочастицы, покрытые антигеном ВПГ-2, тщательно перемешивают и инкубируют, выполняя цикл промывки после осаждения в магнитном поле. Затем добавляют метку АБЭЛ с антителом IgG человека и инкубируют, реагируя с образованием иммунокомплексов. После осаждения в магнитном поле надосадочную жидкость сливают, а затем проводят цикл промывки. Впоследствии добавляют стартер 1+2 для инициирования хемилюминесцентной реакции. Световой сигнал измеряется фотоумножителем в относительных световых единицах (RLU), которые пропорциональны концентрации IgG к ВПГ-2, присутствующего в образце.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 (MAGLUMI® HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения:

479 HSV-2 IgG-IFU-ru-RU, V0.1, 2023-09

1/10

Потребительская упаковка Вариант исполнения 1 (30 тестов)

MAGLUMI®

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 (MAGLUMI® HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилуминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®

IVD**СОСТАВ**

Картридж с реагентами	1 шт.
Отрицательный контроль	1,0 мл
Положительный контроль	1,0 мл
Лента для запечатывания картриджа с реагентами	3 шт.
Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля	4 шт.
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля	4 шт.
Сертификат отдела контроля производителя	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

REF 130762008M**LOT** 47923080401
 04-02-2025
P3H P3H XXXXX/XXXXXX

Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.
№ 23, Цзиньсю восточное шоссе, район Пиншань,
518122 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
Тел.: +86-755-21536601 Факс: +86-755-28292740



Уполномоченный представитель по РФ ООО «КЛС» (LLC CLS),
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корпус 216.1, комната 58
Тел.: +7-495-9469597

Для профессионального применения

Snibe
Diagnostic

Маркировка на потребительской упаковке Вариант исполнения 1 (30 тестов)

MAGLUMI

HSV-2 IgG

REF 130762008M

LOT 47923080401

04-02-2025

01

MAGLUMI®

СОСТАВ

Картридж с реагентами	1 шт.
Отрицательный контроль	1,0 мл
Положительный контроль	1,0 мл
Лента для запечатывания картриджа с реагентами	3 шт.
Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля	4 шт.
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля	4 шт.
Сертификат отдела контроля производителя	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

 Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.
№ 23, Цзиньсю восточное шоссе, район Пиншань,
518122 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
Тел.: +86-755-21536601 Факс: +86-755-28292740

Уполномоченный представитель по РФ ООО «КЛС» (LLC CLS),
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корпус 216.1, комната 58
Тел.: +7-495-9469597

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 (MAGLUMI® HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилуминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®

REF 130762008M

LOT 47923080401

04-02-2025

РЗН РЗН XXXX/XXXXXX

   2°C 8°C  30 


Для профессионального применения

IVD


Вариант исполнения 2

**Набор реагентов in vitro для качественного определения
антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2
(MAGLUMI® HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминес-
центного анализа на автоматических анализаторах
MAGLUMI®, 50 тестов**


Картридж с реагентами

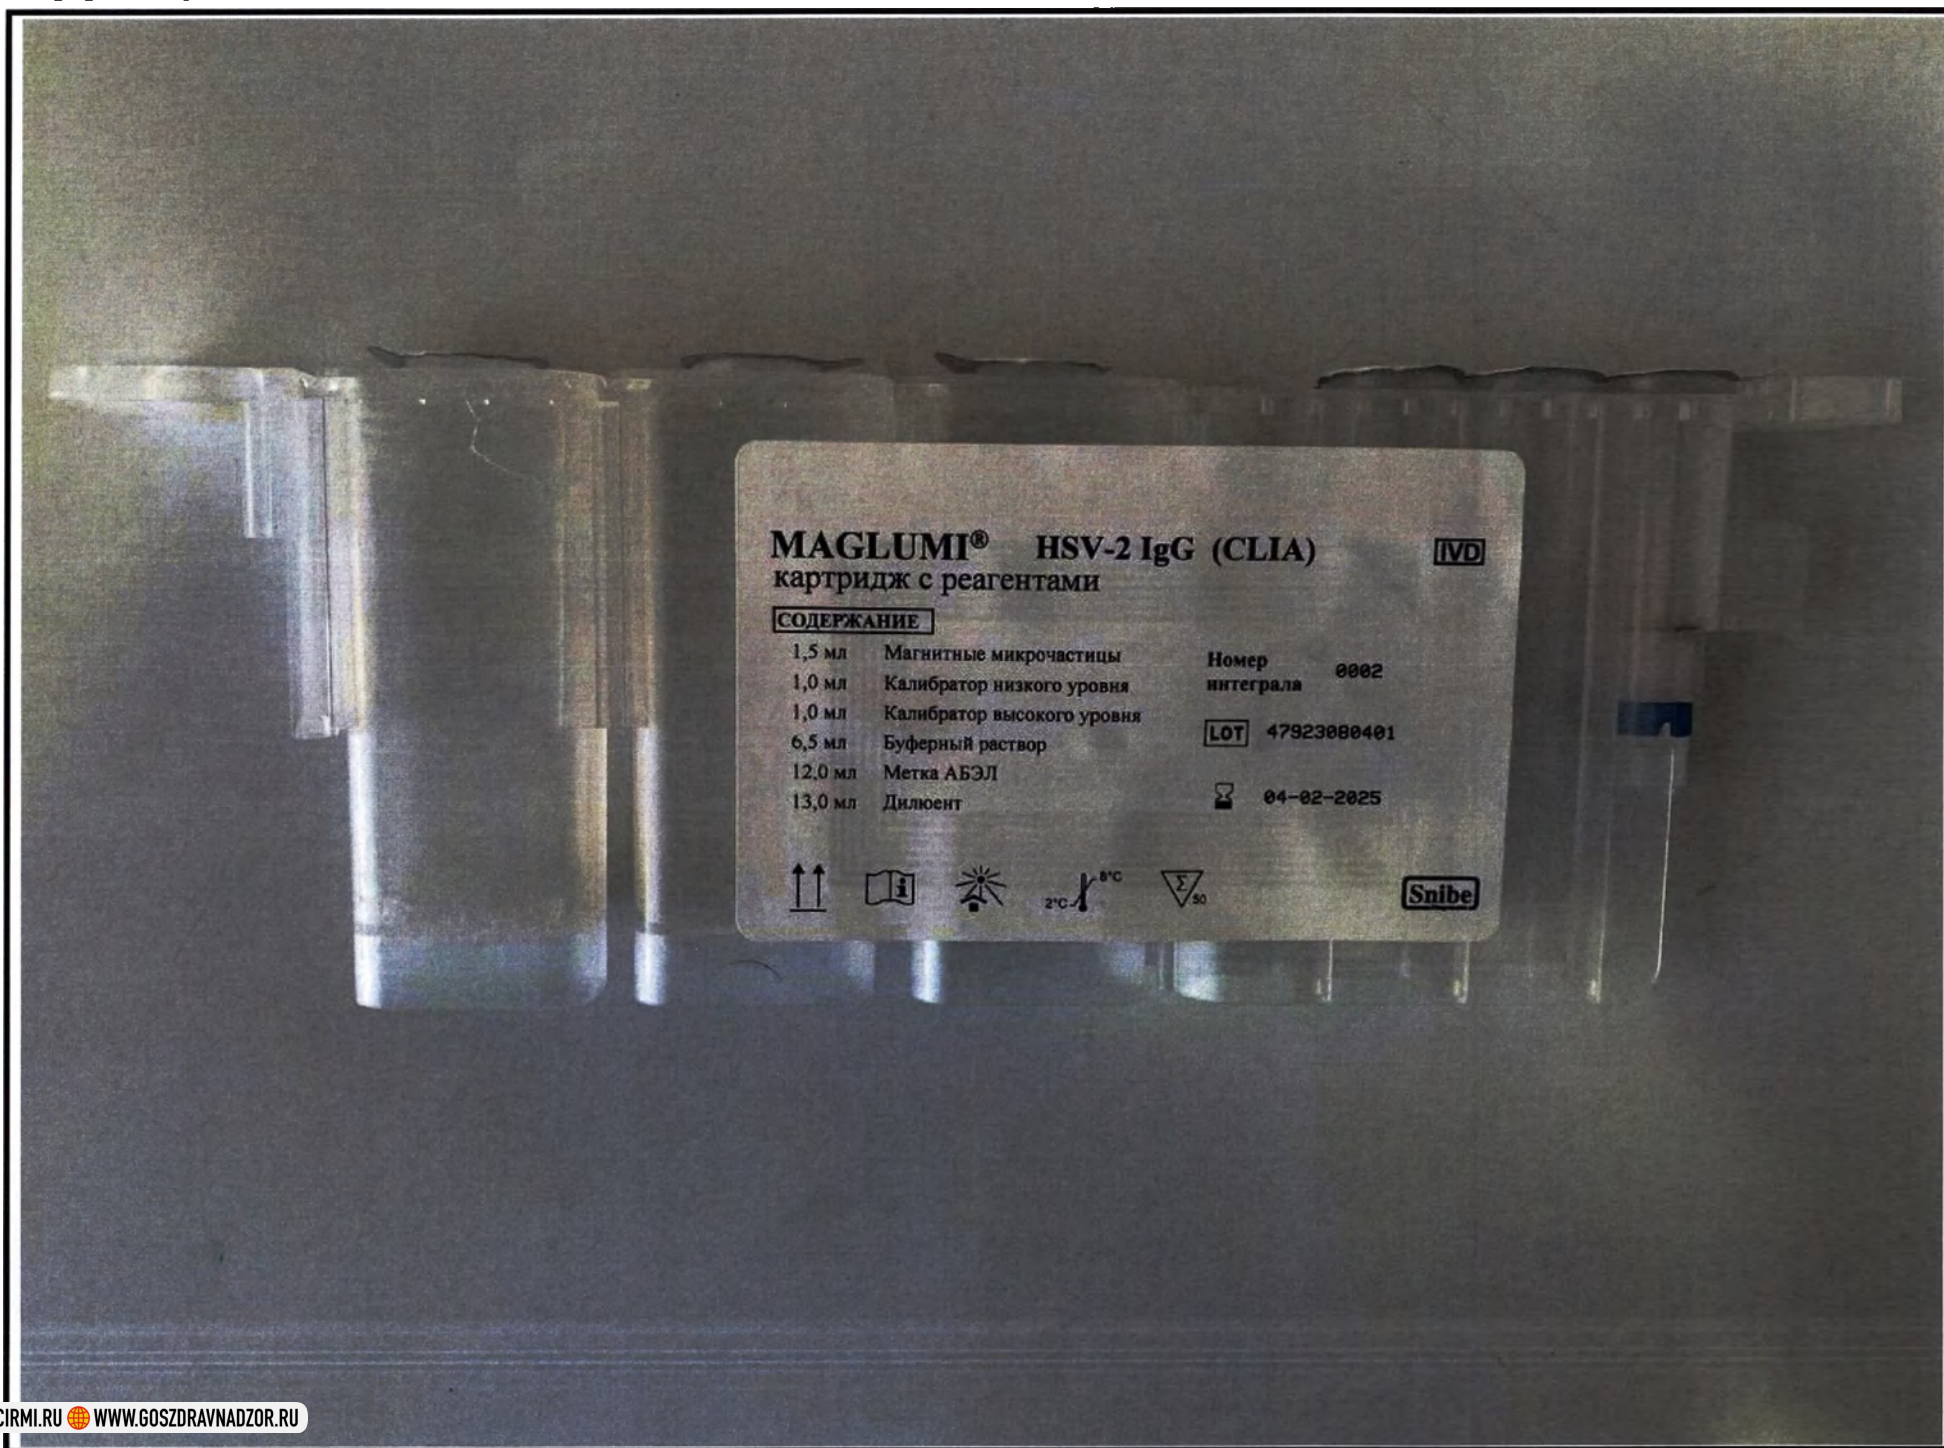


Отрицательный контроль

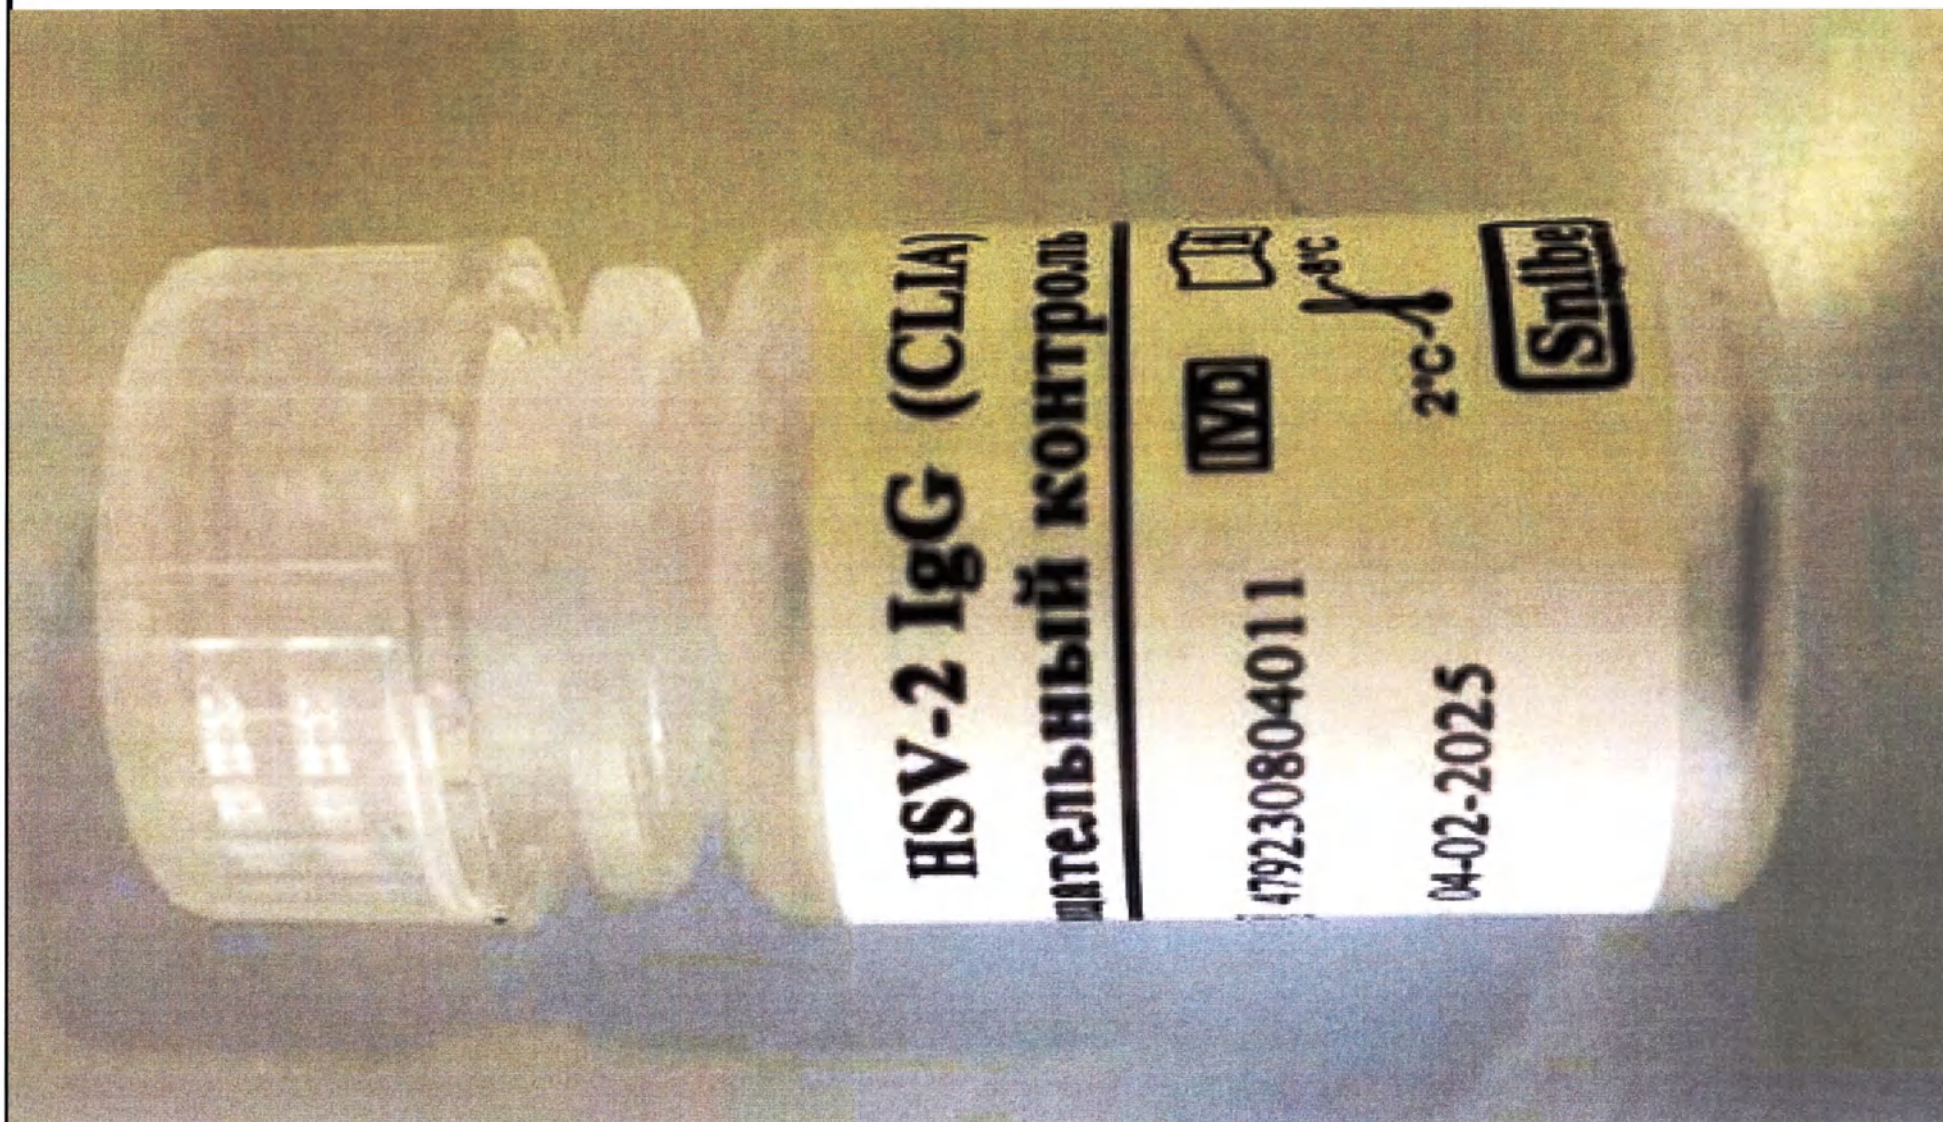

Положительный контроль

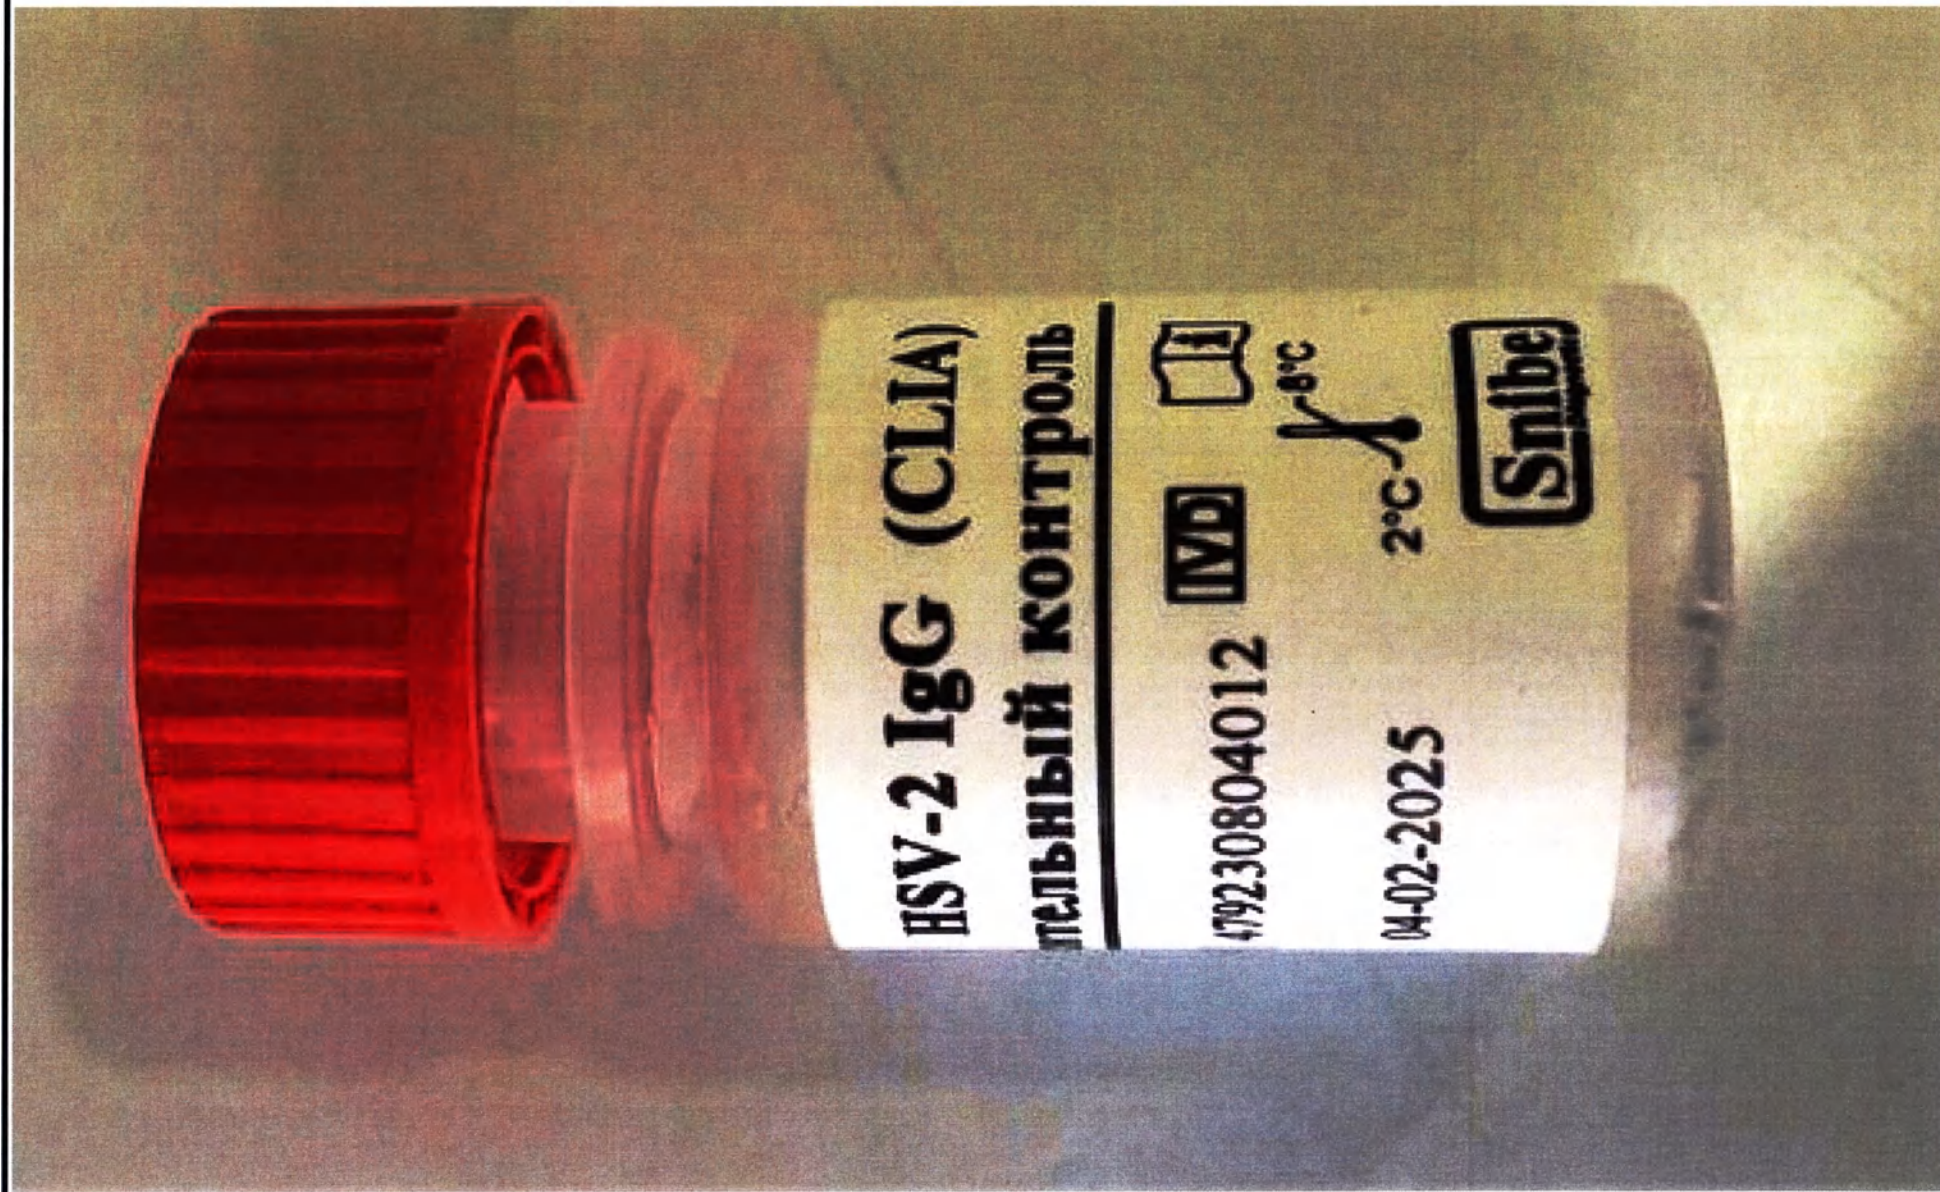

Лента для запечатывания картриджа с реагентами

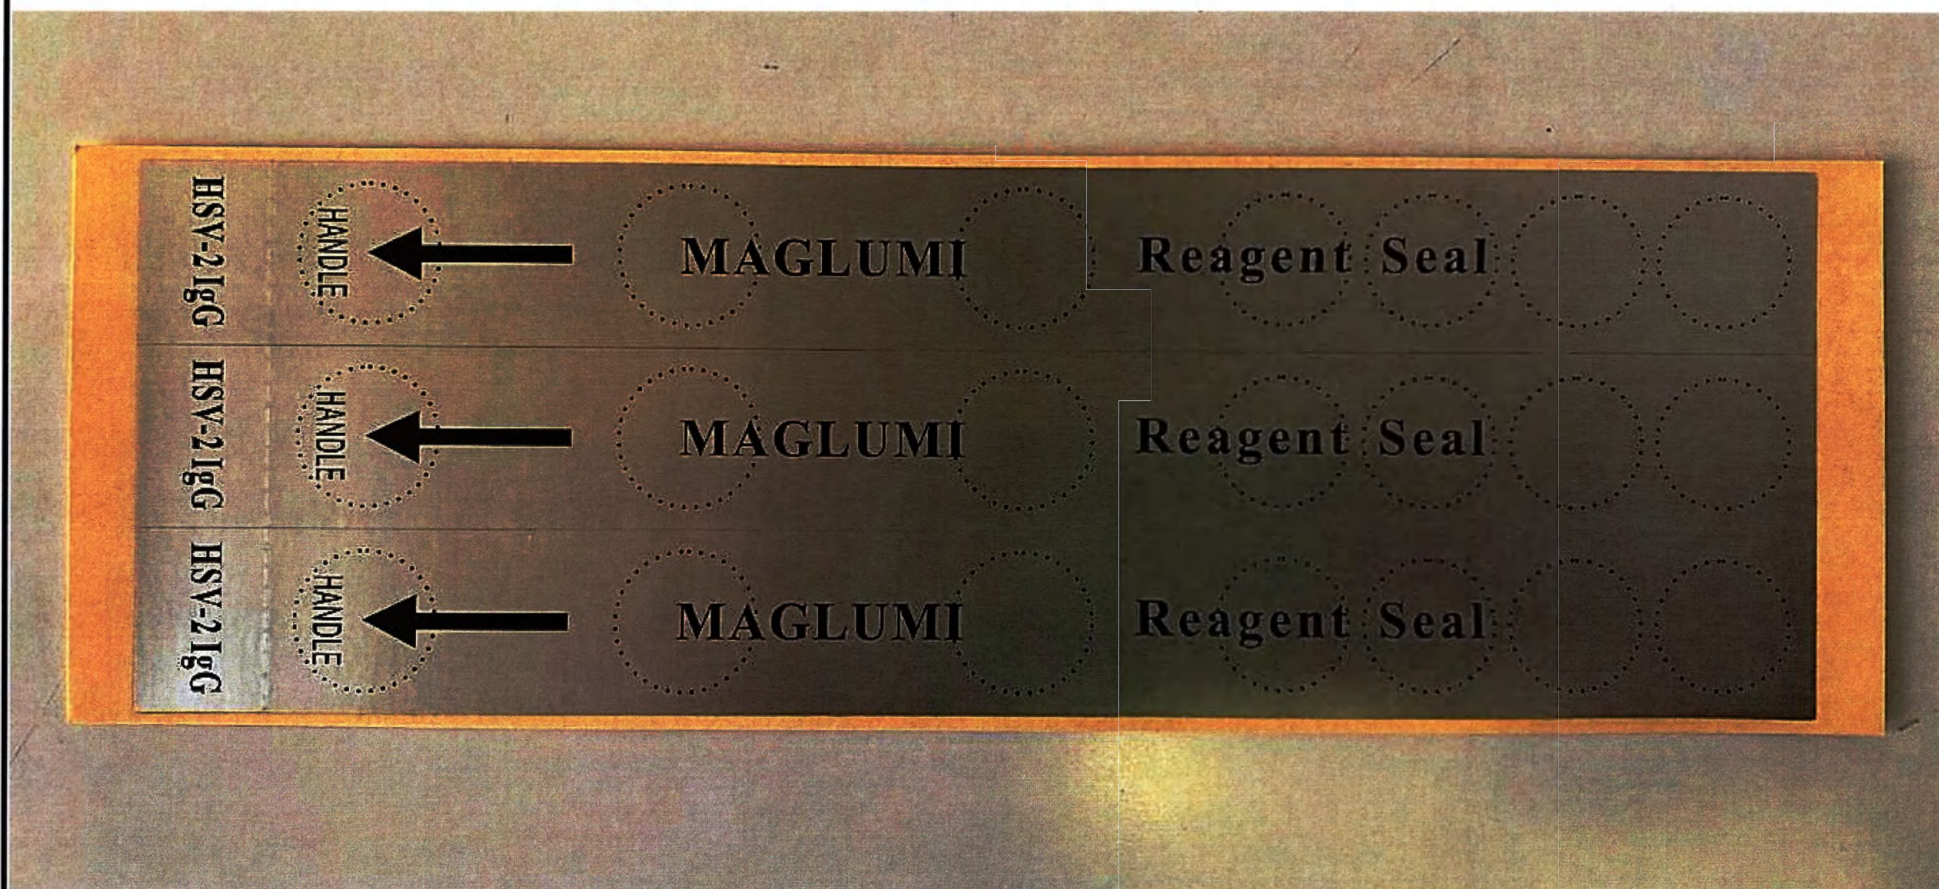

Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля



Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля



CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**



130262008M: 100 тестов
130662008M: 50 тестов
130762008M: 30 тестов

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 (MAGLUMI® HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики вируса простого герпеса 2, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АНАЛИЗА

Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), является одним из наиболее распространенных вирусных заболеваний, передающихся половым путем, во всем мире¹. ВПГ представляет собой вирус с двуспиральной ДНК и относится к семейству вирусов герпеса человека, официально известному как *Herpesviridae*². Вирус существует в 2 формах: ВПГ-1 и ВПГ-2. Два типа ВПГ отличаются антигенными различиями в белках их оболочки^{2,3}. Большинство инфекций полости рта, лица и глаз являются результатом ВПГ-1, в то время как на ВПГ-2 приходится большинство герпетических поражений гениталий и кожи нижней части тела².

Первичный герпетический гингивостоматит (ПГГ) - это инфекция полости рта, вызываемая вирусом простого герпеса⁴. Первичный герпетический гингивостоматит может включать как оральные, так и экстраоральные поражения, опухшие и кровоточащие десны, а также такие симптомы, как боль, лихорадка, раздражительность, недомогание, головная боль и инфекция верхних дыхательных путей⁴. ВПГ-1 может вызывать губной герпес. Заражение ВПГ-2 также может привести к первичному лабиальному герпесу, но этот тип редко вызывает рецидив недуга⁵. Первичная инфекция вирусом простого герпеса может привести к тяжелому заболеванию во время беременности⁶. Поскольку инфекция часто встречается у женщин репродуктивного возраста, ею можно заразиться и передать плоду во время беременности и новорожденному⁷. Последствиями могут быть прерванная беременность, преждевременные роды, плод с задержкой внутриутробного развития, врожденные пороки развития или мертворождение^{6,8}.

Генитальный герпес (ГГ), вызываемый ВПГ-1 или ВПГ-2, является одним из наиболее распространенных заболеваний, передающихся половым путем во всем мире, ВПГ-2 стал наиболее распространенной причиной язвенной болезни гениталий⁹. Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), может проявляться различными путями¹⁰. У женщин это вызывает образование пузырей и изъязвлений на наружных половых органах и шейке матки, что приводит к боли в области вульвы, дизурии, выделениям из влагалища и местной лимфаденопатии. Также наблюдаются везикулярные и язвенные поражения внутренней поверхности бедра, ягодиц, промежности или периаанальной области. Как у мужчин, так и у женщин первичная инфекция может осложняться системными симптомами, такими как лихорадка, головная боль, миалгия (38% у мужчин, 68% у женщин) и иногда менингитом, а также вегетативной невропатией, приводящей к задержке мочи, главным образом у женщин⁷. Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса (ВПГ), являются распространенной причиной паховой лимфаденопатии. Кроме того, предыдущие исследования показали корреляцию между паховой лимфаденопатией, вызванной ВПГ, и последующим развитием поражений гениталий, связанных с ВПГ. Хотя ВПГ встречается редко, первоначально он может проявляться в виде паховой лимфаденопатии без других сопутствующих симптомов¹¹. Серологическое тестирование, специфичное для типов IgG и IgM, вскоре после появления первых симптомов, указывающих на генитальный герпес, может помочь определить, является ли инфекция новой или ранее существовавшей¹².

ПРИНЦИП АНАЛИЗА

Сэндвич-метод иммунохемилюминесцентного анализа


Образец, дилуент, буфер, магнитные микрочастицы, покрытые антигеном ВПГ-2, тщательно перемешивают и инкубируют, выполняя цикл промывки после осаждения в магнитном поле. Затем добавляют метку АБЭЛ с антителом IgG человека и инкубируют, реагируя с образованием иммунокомплексов. После осаждения в магнитном поле надосадочную жидкость сливают, а затем проводят цикл промывки. Впоследствии добавляют стартер 1+2 для инициирования хемилюминесцентной реакции. Световой сигнал измеряется фотоумножителем в относительных световых единицах (RLU), которые пропорциональны концентрации IgG к ВПГ-2, присутствующего в образце.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 (MAGLUMI® HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения:

479 HSV-2 IgG- IFU-ru-RU, V0.1, 2023-09

1/10

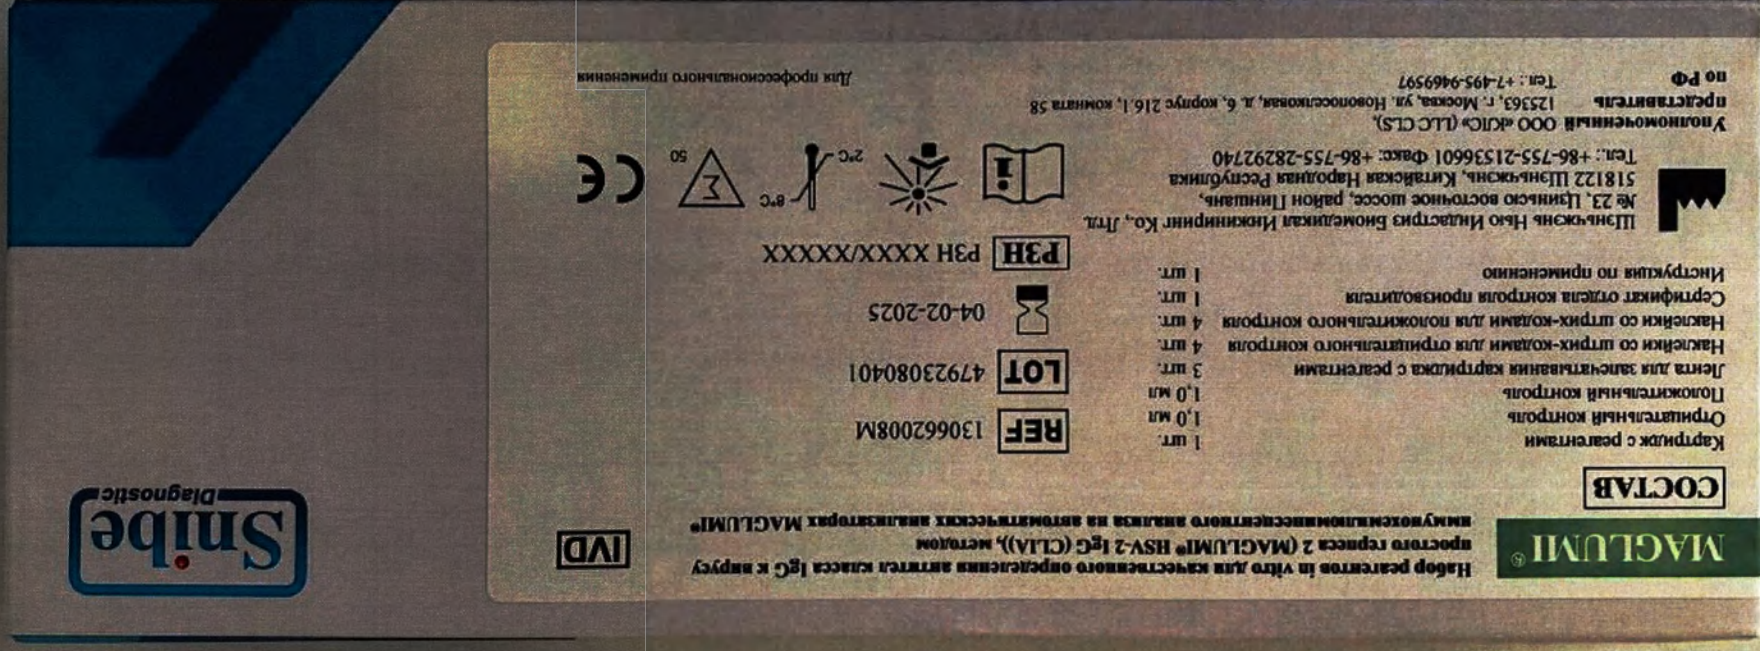

MAGLUMI®

HSV-2 IgG

REF

130662008M

LOT

47923080401



04-02-2025



01

MAGLUMI®

СОСТАВ

Картридж с реагентами	1 шт.
Отрицательный контроль	1,0 мл
Положительный контроль	1,0 мл
Лента для запечатывания картриджа с реагентами	3 шт.
Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля	4 шт.
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля	4 шт.
Сертификат отдела контроля производителя	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

 Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.
 № 23, Цзиньсю восточное шоссе, район Пиншань,
 518122 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
 Тел.: +86-755-21536601 Факс: +86-755-28292740

Уполномоченный представитель по РФ ООО «КЛС» (LLC CLS),
 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корпус 216.1, комната 58
 Тел.: +7-495-9469597

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 (MAGLUMI® HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®

IVD

REF 130662008M

LOT 47923080401

 04-02-2025

РЗН РЗН XXXX/XXXXX


   8°C  50 

Для профессионального применения


Вариант исполнения 3

**Набор реагентов in vitro для качественного определения
антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2
(MAGLUMI® HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминес-
центного анализа на автоматических анализаторах
MAGLUMI®, 100 тестов**


Картридж с реагентами

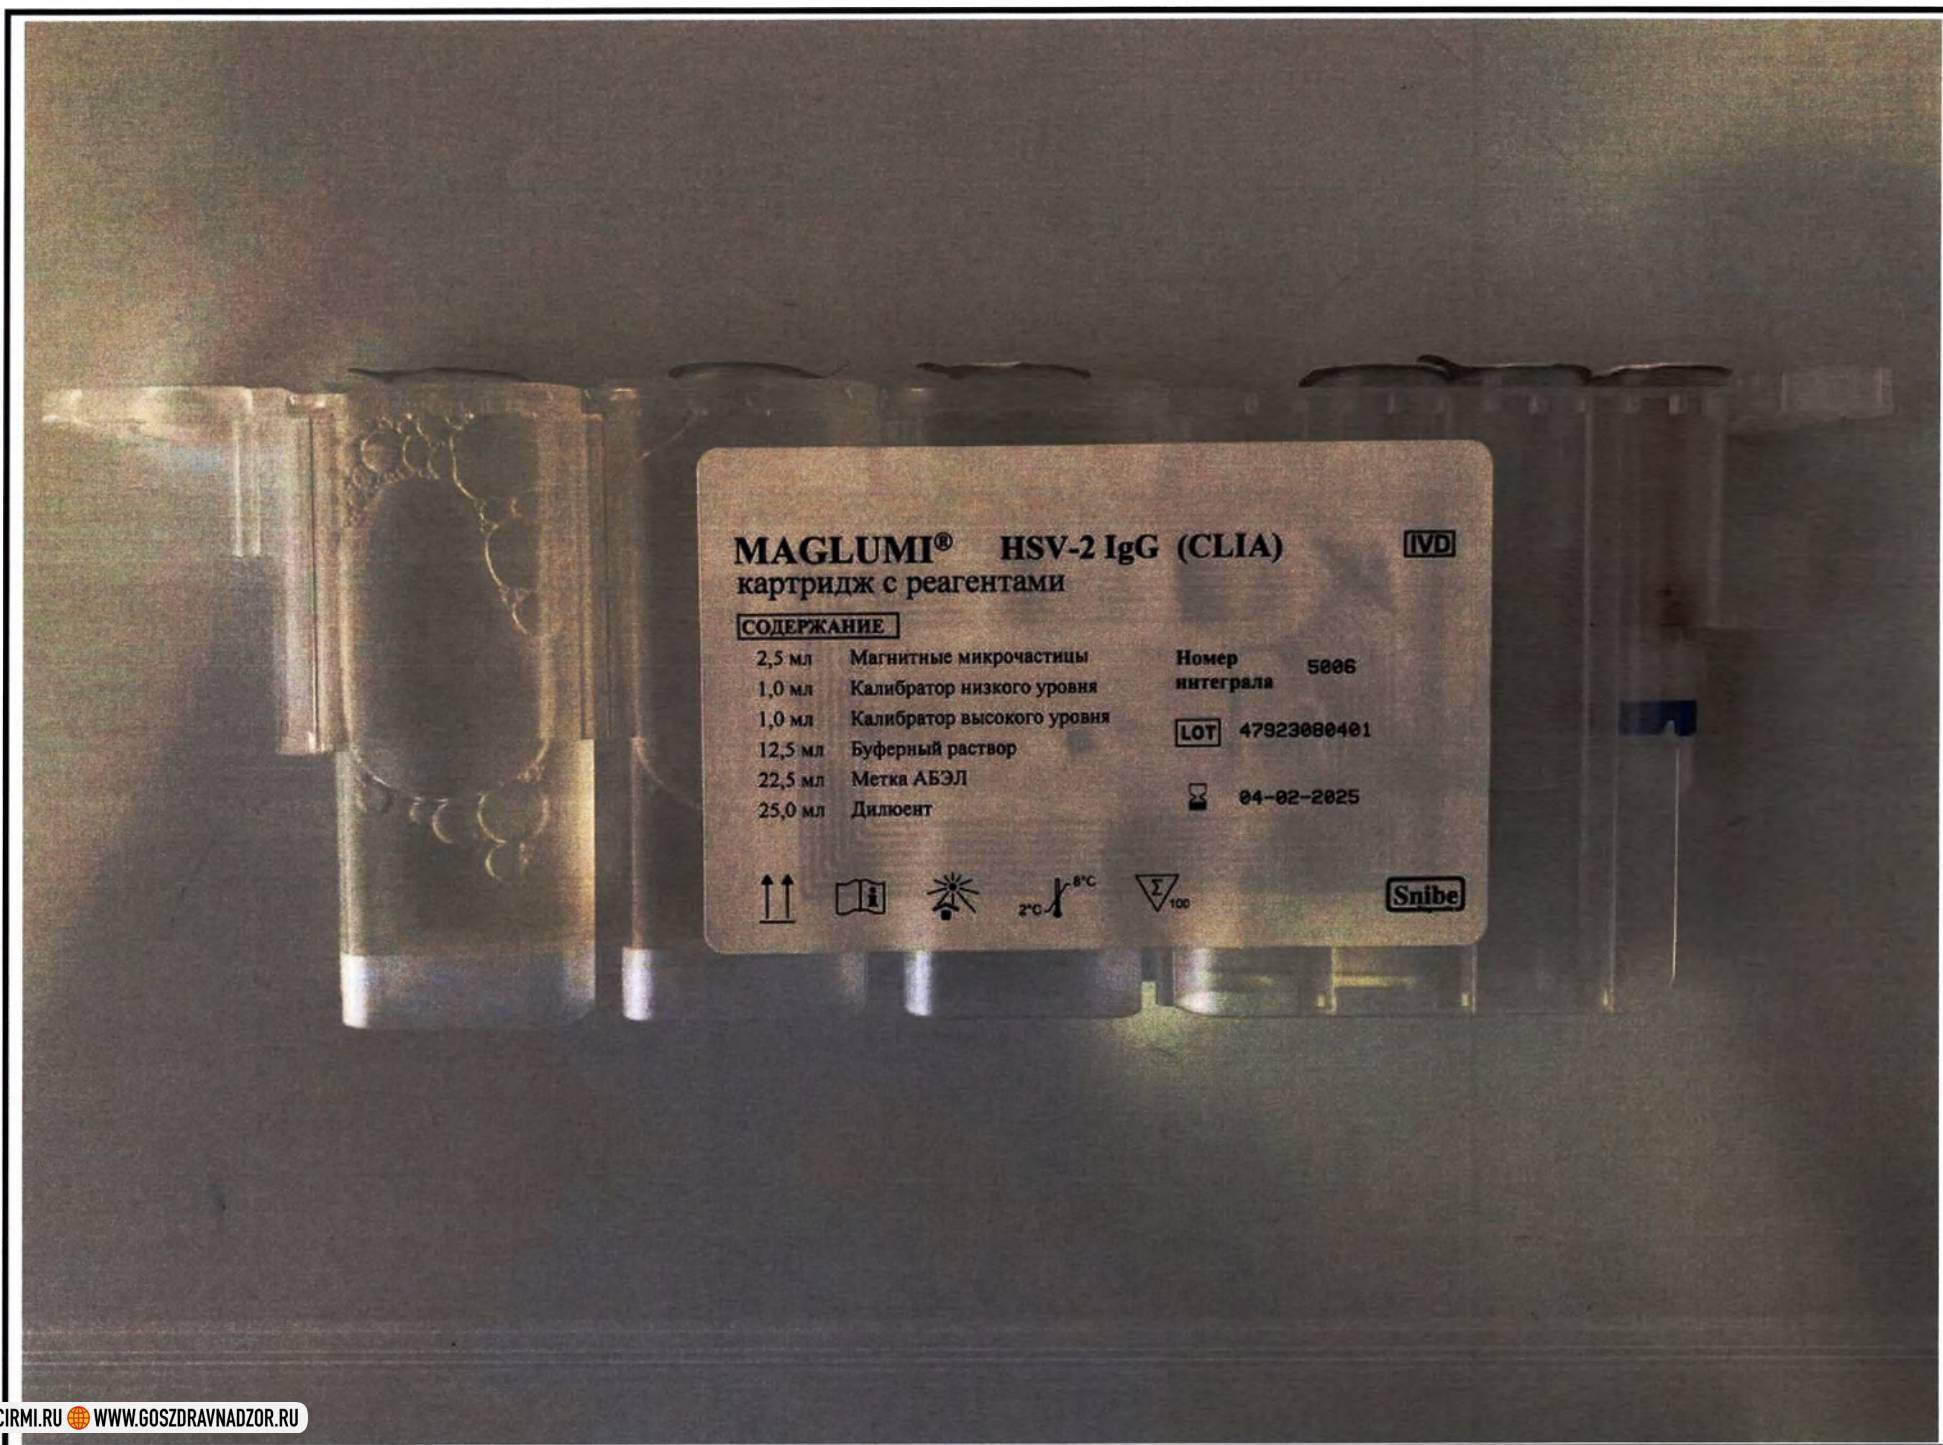


Отрицательный контроль

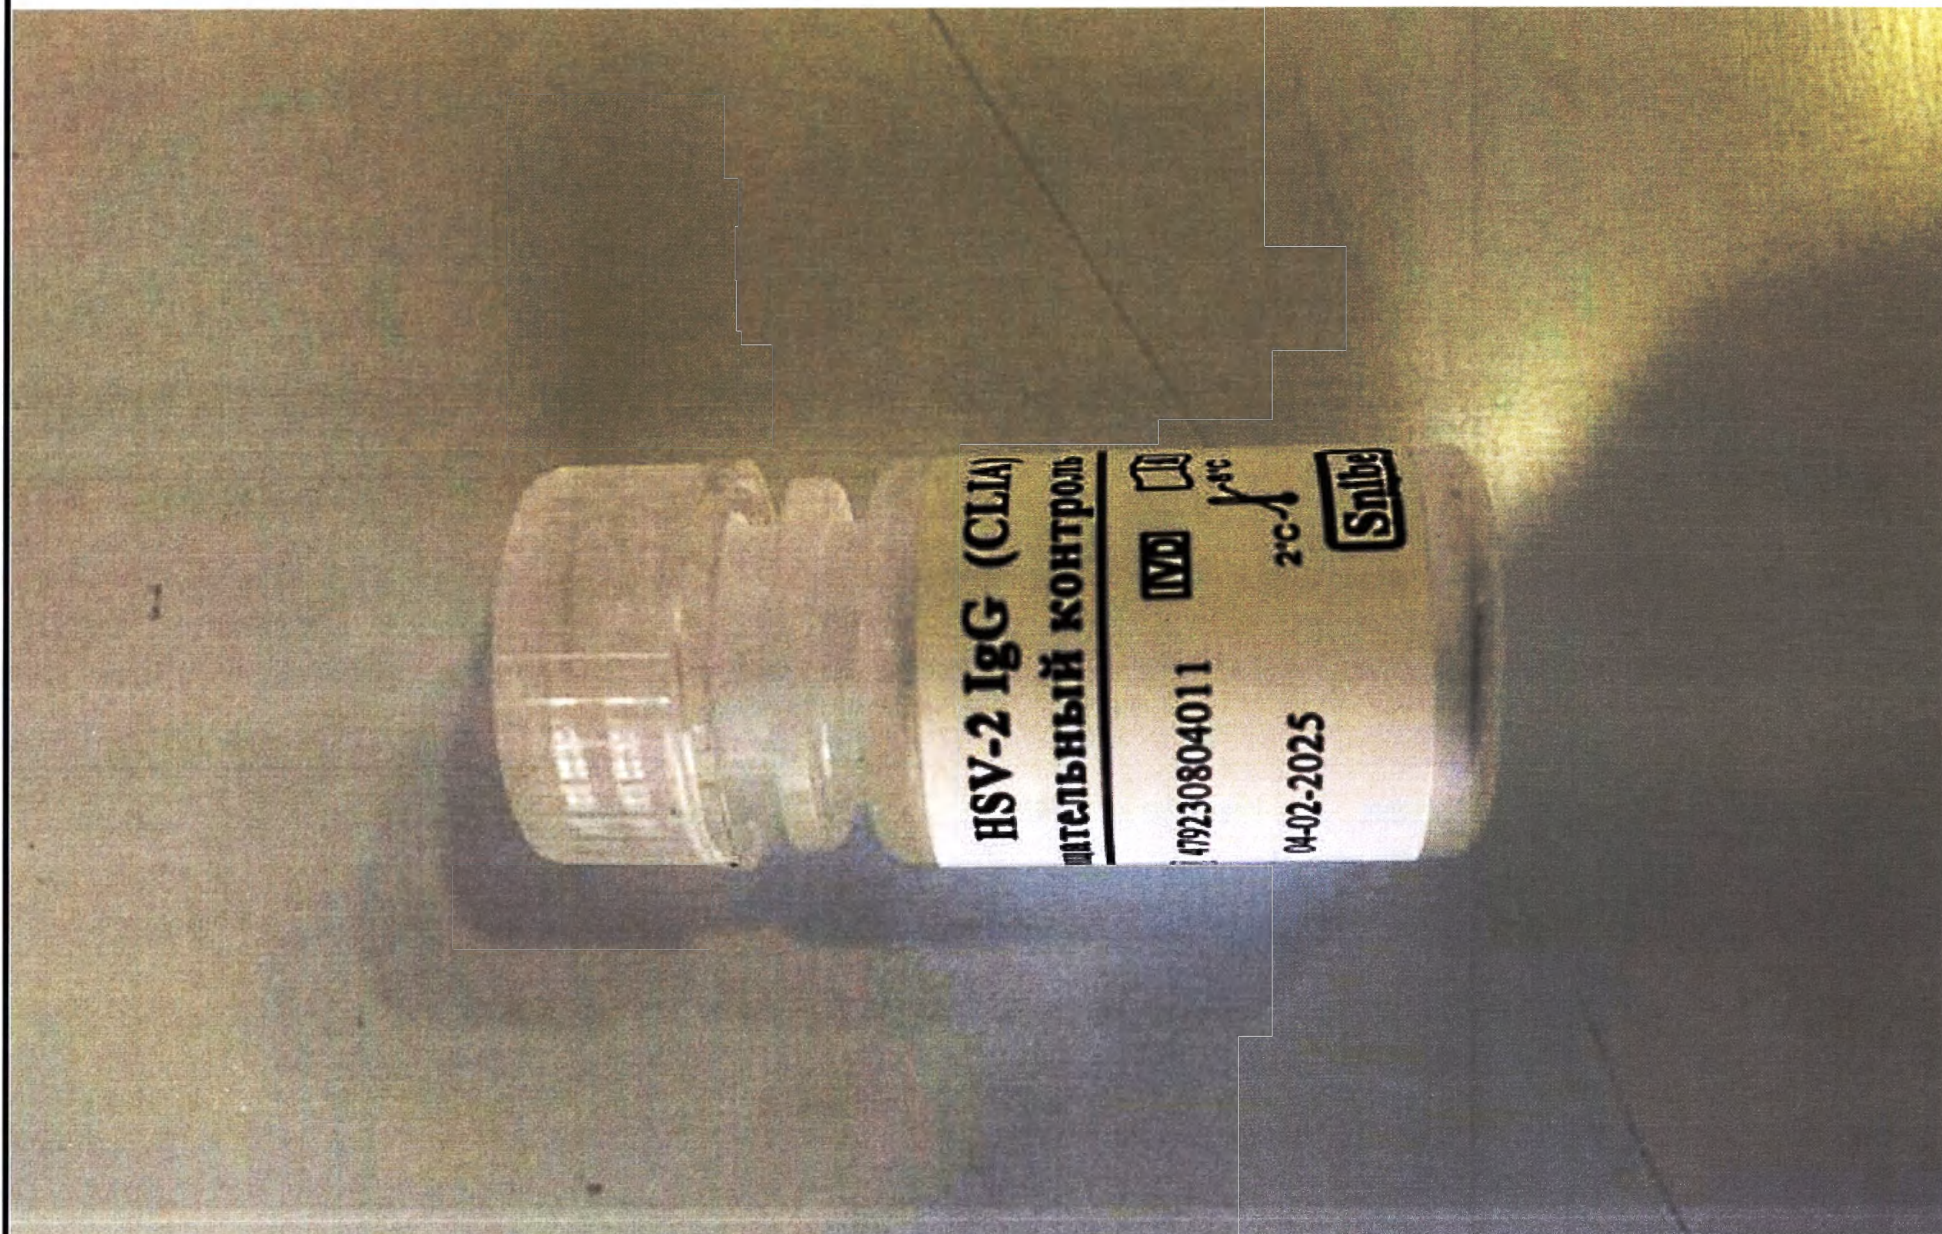

Положительный контроль

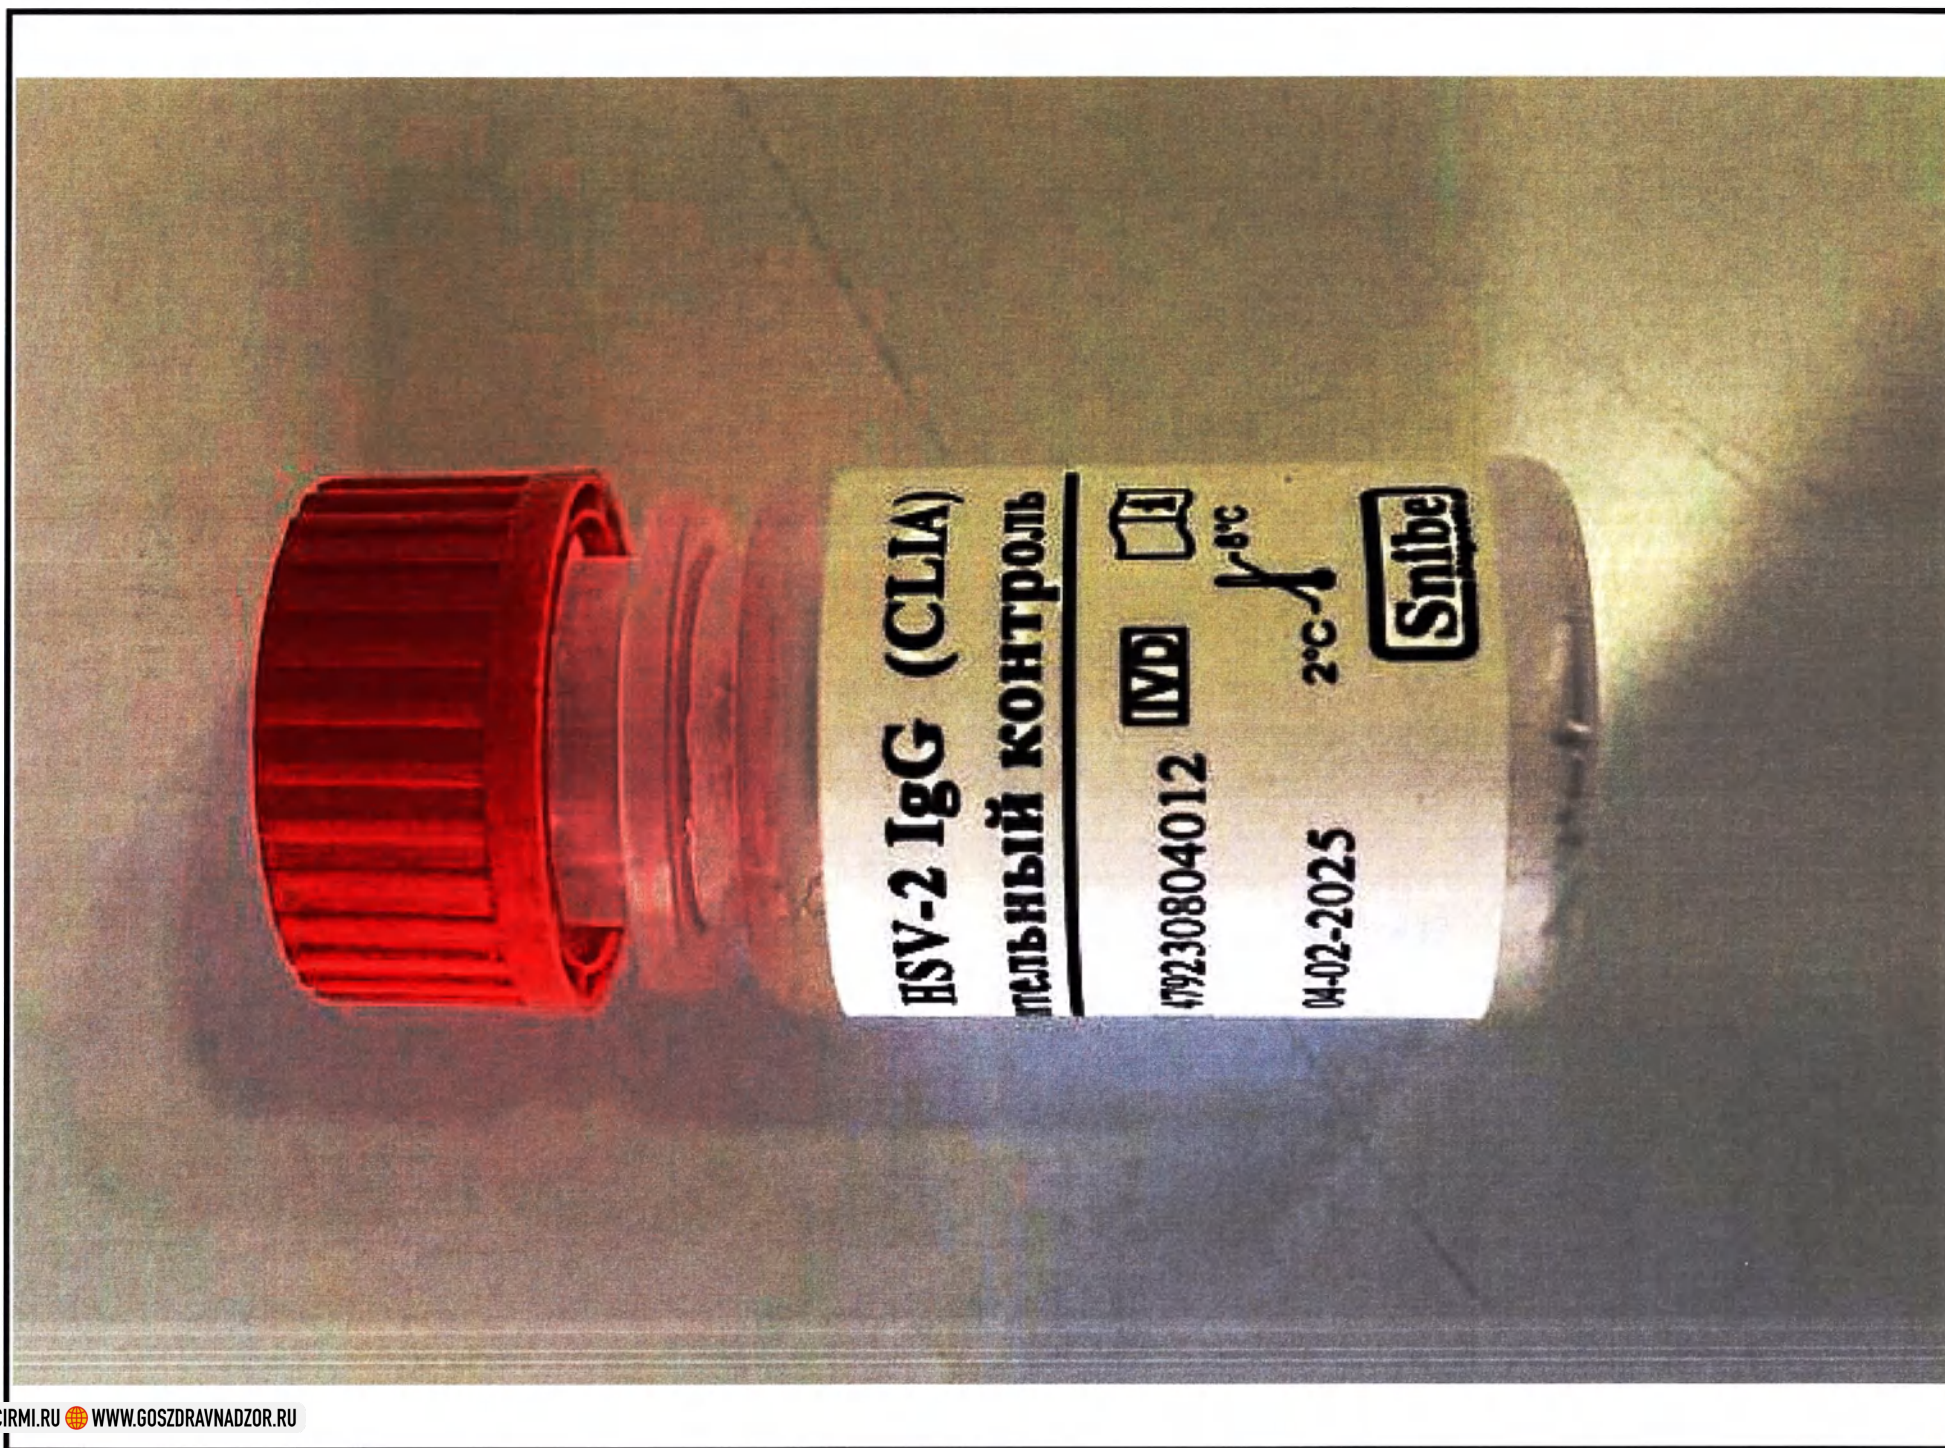

Лента для запечатывания картриджа с реагентами

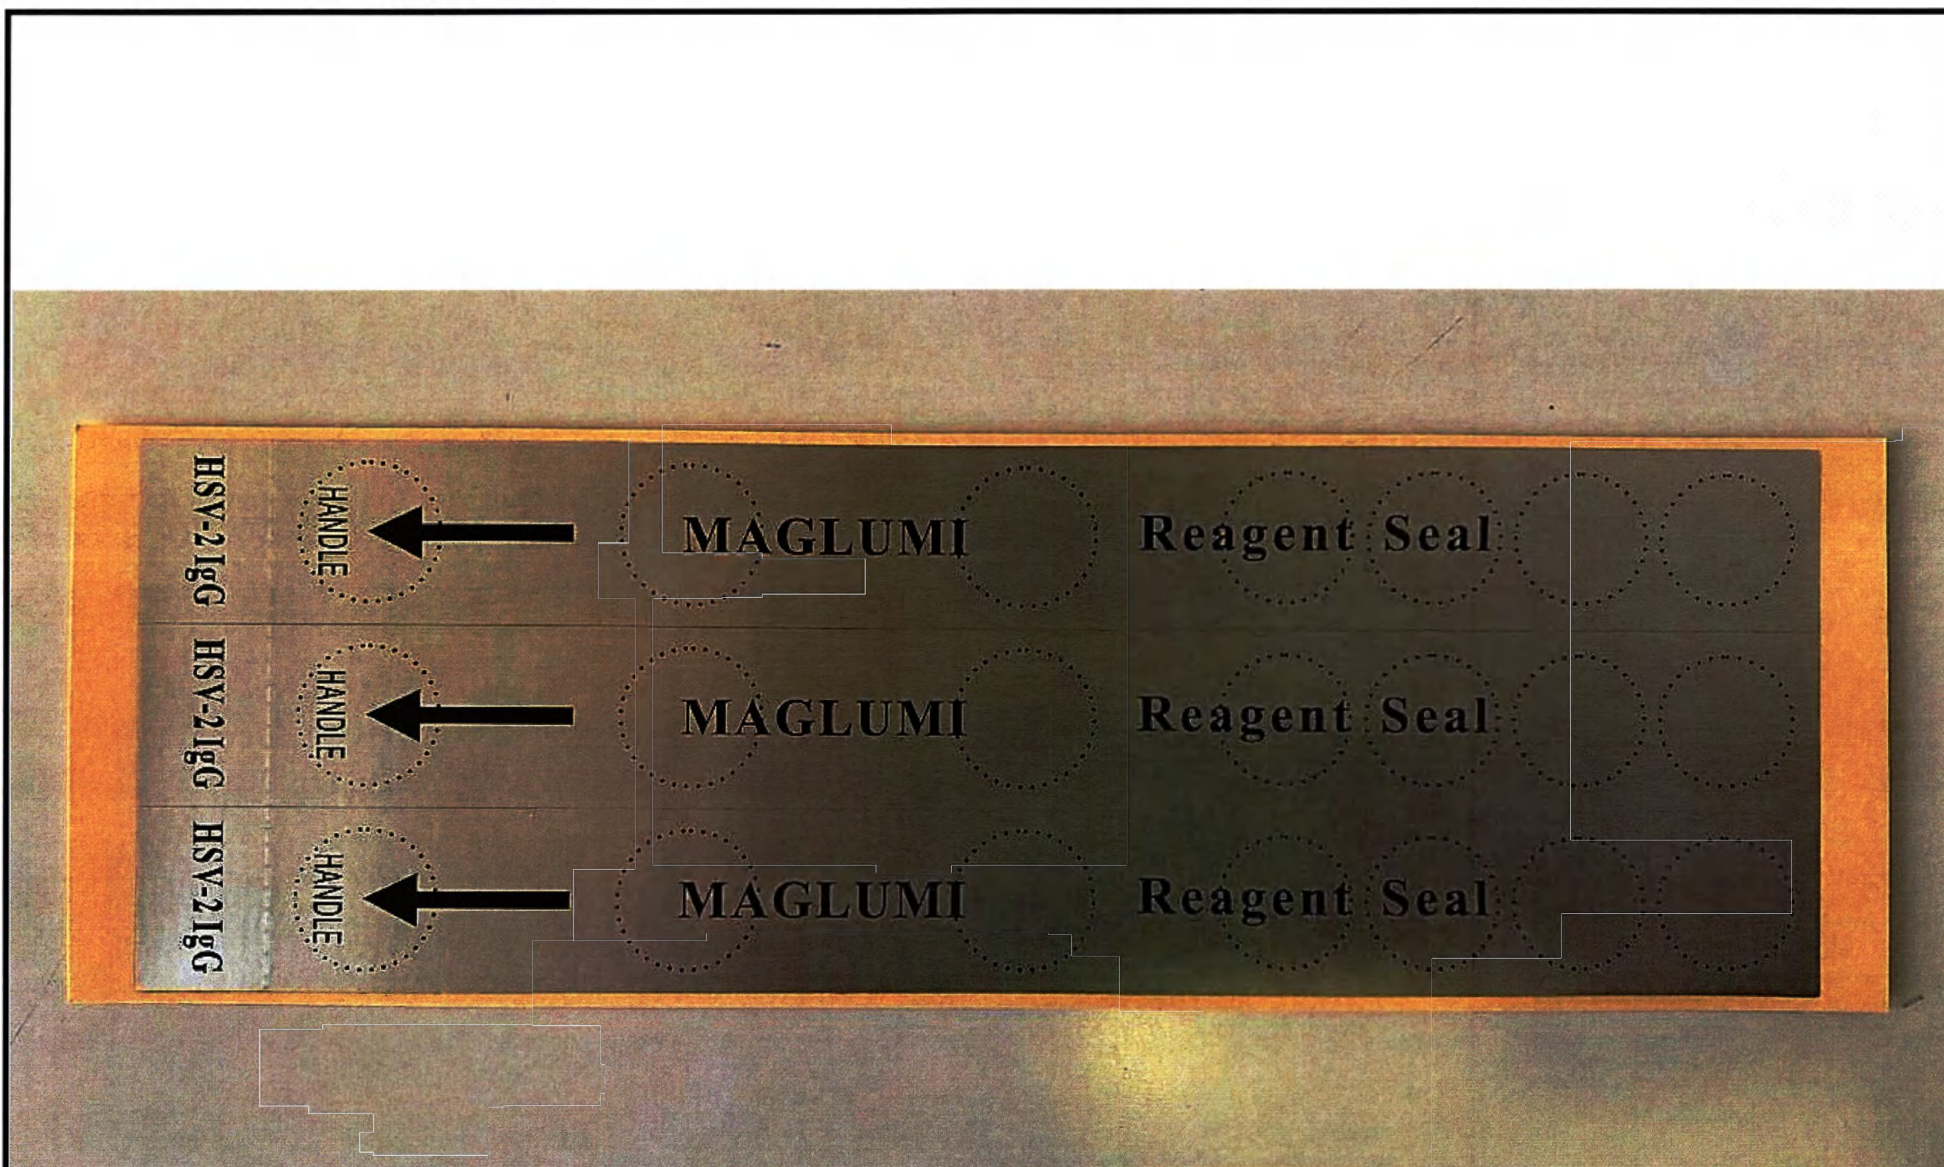

Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля



Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля



CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**



130262008M: 100 тестов
130662008M: 50 тестов
130762008M: 30 тестов

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 (MAGLUMI® HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики вируса простого герпеса 2, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АНАЛИЗА

Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), является одним из наиболее распространенных вирусных заболеваний, передающихся половым путем, во всем мире¹. ВПГ представляет собой вирус с двуспиральной ДНК и относится к семейству вирусов герпеса человека, официально известному как *Herpesviridae*². Вирус существует в 2 формах: ВПГ-1 и ВПГ-2. Два типа ВПГ отличаются антигенными различиями в белках их оболочек^{2,3}. Большинство инфекций полости рта, лица и глаз являются результатом ВПГ-1, в то время как на ВПГ-2 приходится большинство герпетических поражений гениталий и кожи нижней части тела².

Первичный герпетический гингивостоматит (ПГГ) - это инфекция полости рта, вызываемая вирусом простого герпеса⁴. Первичный герпетический гингивостоматит может включать как оральные, так и экстраоральные поражения, опухшие и кровоточащие десны, а также такие симптомы, как боль, лихорадка, раздражительность, недомогание, головная боль и инфекция верхних дыхательных путей⁴. ВПГ-1 может вызывать губной герпес. Заражение ВПГ-2 также может привести к первичному лабиальному герпесу, но этот тип редко вызывает рецидив недуга⁵. Первичная инфекция вирусом простого герпеса может привести к тяжелому заболеванию во время беременности⁶. Поскольку инфекция часто встречается у женщин репродуктивного возраста, ею можно заразиться и передать плоду во время беременности и новорожденному⁷. Последствиями могут быть прерванная беременность, преждевременные роды, плод с задержкой внутриутробного развития, врожденные пороки развития или мертворождение^{6,8}.

Генитальный герпес (ГГ), вызываемый ВПГ-1 или ВПГ-2, является одним из наиболее распространенных заболеваний, передающихся половым путем во всем мире, ВПГ-2 стал наиболее распространенной причиной язвенной болезни гениталий⁹. Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), может проявляться различными путями¹⁰. У женщин это вызывает образование пузырей и язв на наружных половых органах и шейке матки, что приводит к боли в области вульвы, дизурии, выделениям из влагалища и местной лимфаденопатии. Также наблюдаются везикулярные и язвенные поражения внутренней поверхности бедра, ягодиц, промежности или перианальной области. Как у мужчин, так и у женщин первичная инфекция может осложняться системными симптомами, такими как лихорадка, головная боль, миалгия (38% у мужчин, 68% у женщин) и иногда менингитом, а также вегетативной невропатией, приводящей к задержке мочи, главным образом у женщин⁷. Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса (ВПГ), являются распространенной причиной паховой лимфаденопатии. Кроме того, предыдущие исследования показали корреляцию между паховой лимфаденопатией, вызванной ВПГ, и последующим развитием поражений гениталий, связанных с ВПГ. Хотя ВПГ встречается редко, первоначально он может проявляться в виде паховой лимфаденопатии без других сопутствующих симптомов¹¹. Серологическое тестирование, специфичное для типов IgG и IgM, вскоре после появления первых симптомов, указывающих на генитальный герпес, может помочь определить, является ли инфекция новой или ранее существовавшей¹².

ПРИНЦИП АНАЛИЗА

Сэндвич-метод иммунохемилюминесцентного анализа

Образец, дилуент, буфер, магнитные микрочастицы, покрытые антигеном ВПГ-2, тщательно перемешивают и инкубируют, выполняя цикл промывки после осаждения в магнитном поле. Затем добавляют метку АБЭЛ с антителом IgG человека и инкубируют, реагируя с образованием иммунокомплексов. После осаждения в магнитном поле надосадочную жидкость сливают, а затем проводят цикл промывки. Впоследствии добавляют стартер 1+2 для инициирования хемилюминесцентной реакции. Световой сигнал измеряется фотоумножителем в относительных световых единицах (RLU), которые пропорциональны концентрации IgG к ВПГ-2, присутствующего в образце.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 (MAGLUMI® HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения:

479 HSV-2 IgG- IFU-ru-RU, V0.1, 2023-09

1/10



Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 (MAGLUMI® HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®





СОСТАВ

Картридж с реагентами	1 шт.
Отрицательный контроль	1,0 мл
Положительный контроль	1,0 мл
Лента для запечатывания картриджа с реагентами	3 шт.
Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля	4 шт.
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля	4 шт.
Сертификат отдела контроля производителя	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

REF 130262008M

LOT 47923080401

 04-02-2025

P3H P3H XXXX/XXXXXX



Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.
№ 23, Цзиньсю восточное шоссе, район Пиншань,
518122 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
Тел.: +86-755-21536601 Факс: +86-755-28292740






8°C
2°C




Уполномоченный представитель по РФ ООО «КЛС» (LLC CLS),
125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корпус 216.1, комната 58
Тел.: +7-495-9469597

Для профессионального применения

MAGLUMI®

HSV-2 IgG

REF 130262008M

LOT 47923080401

04-02-2025

01

MAGLUMI®

СОСТАВ

Картридж с реагентами	1 шт.
Отрицательный контроль	1,0 мл
Положительный контроль	1,0 мл
Лента для запечатывания картриджа с реагентами	3 шт.
Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля	4 шт.
Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля	4 шт.
Сертификат отдела контроля производителя	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

 Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.
 № 23, Цзиньсю восточное шоссе, район Пиншань,
 518122 Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика
 Тел.: +86-755-21536601 Факс: +86-755-28292740

Уполномоченный представитель по РФ ООО «КЛС» (LLC CLS),
 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корпус 216.1, комната 58
 Тел.: +7-495-9469597

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 (MAGLUMI® HSV-2 IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®

IVD

REF 130262008M

LOT 47923080401

04-02-2025

P3H P3H XXXX/XXXXXX

   8°C  100 

Для профессионального применения

Всего прошнуровано и
скреплено 34 лист«ов»

Генеральный директор
Смирнов Э.А.

