

ООО «Анатомика»
Россия, Казань, ул. Монтажная, 15
+7 (843) 570-05-05
anatomica.ru



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Анатомика»

Д.В. Чигарин

«19» марта 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»

«ООО «Анатомика»

Россия, г. Казань, ул. Монтажная д.15

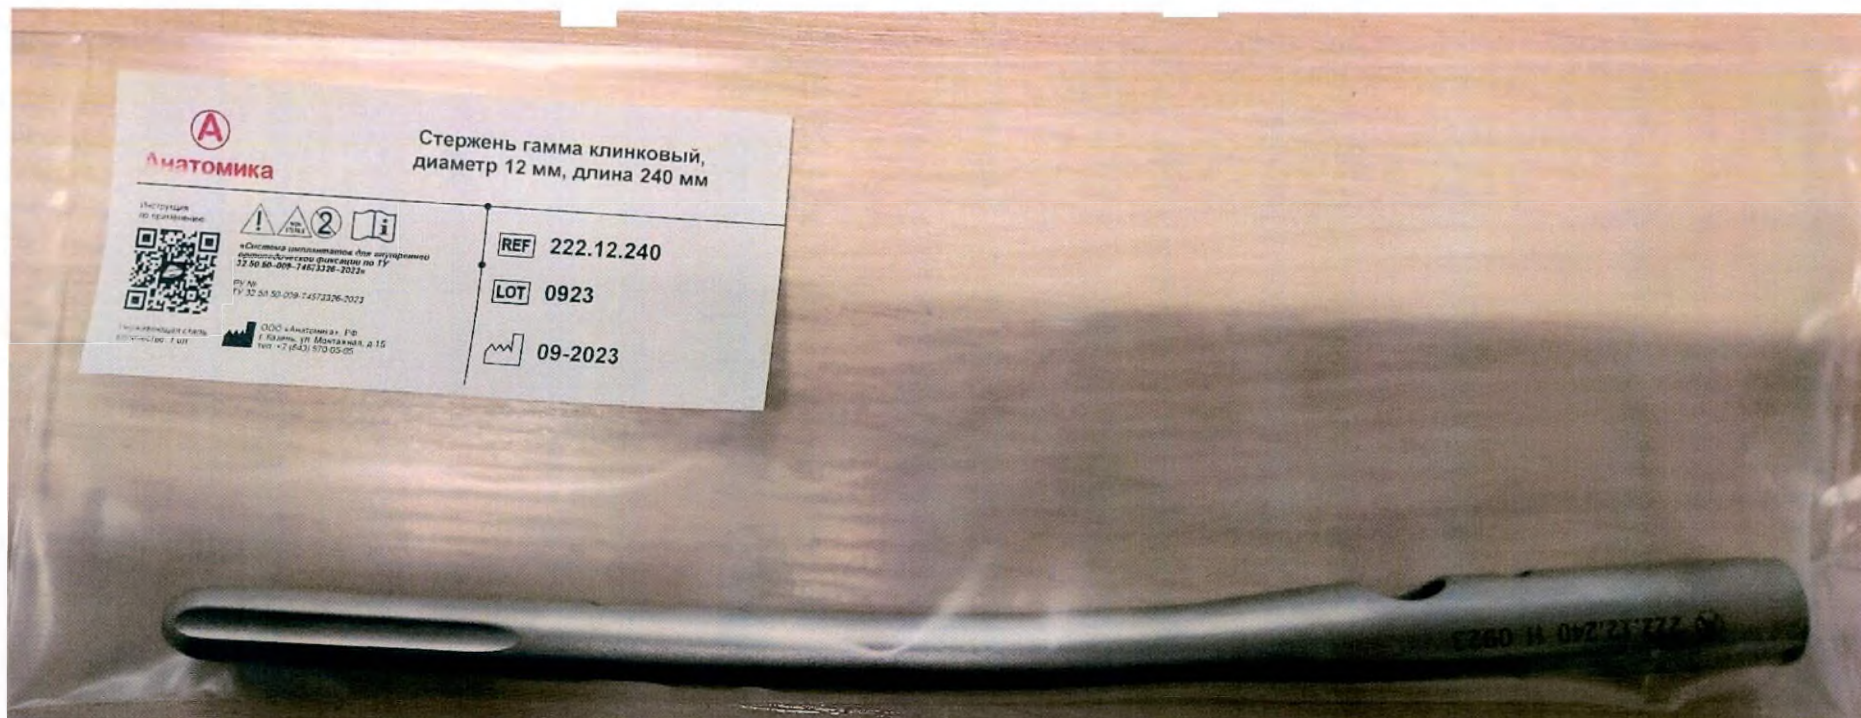


Фото 1. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023», образец изделия в индивидуальной упаковке, с маркировкой на этикетке



Фото 2. «Система имплантов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023», образец изделия в групповой (потребительской) упаковке, с маркировкой на этикетке



Фото 3. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023», образец маркировки изделия



Фото 4. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина дистальная лучевая широкая с угловой стабильностью



Фото 5. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина для головки лучевой кости с угловой стабильностью



Фото 6. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина дистальная лучевая с угловой стабильностью



Фото 7. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина дистальная лучевая Т-образная с угловой стабильностью



Фото 8. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина медиальная для плечевой кости с угловой стабильностью



Фото 9. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина для локтевого отростка с угловой стабильностью



Фото 10. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина дорсальная Y-образная для лучевой кости с угловой стабильностью



Фото 11. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина дистальная латеральная для плечевой кости с угловой стабильностью



Фото 12. «Система имплантов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина "лист клевера" для плечевой кости с угловой стабильностью



Фото 13. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина дистальная внесуставная для плечевой кости с угловой стабильностью



Фото 14. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина для проксимального отдела плеча с угловой стабильностью с ограниченным контактом



Фото 15. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина для большеберцово-таранного артродеза с угловой стабильностью



Фото 16. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина симфизная

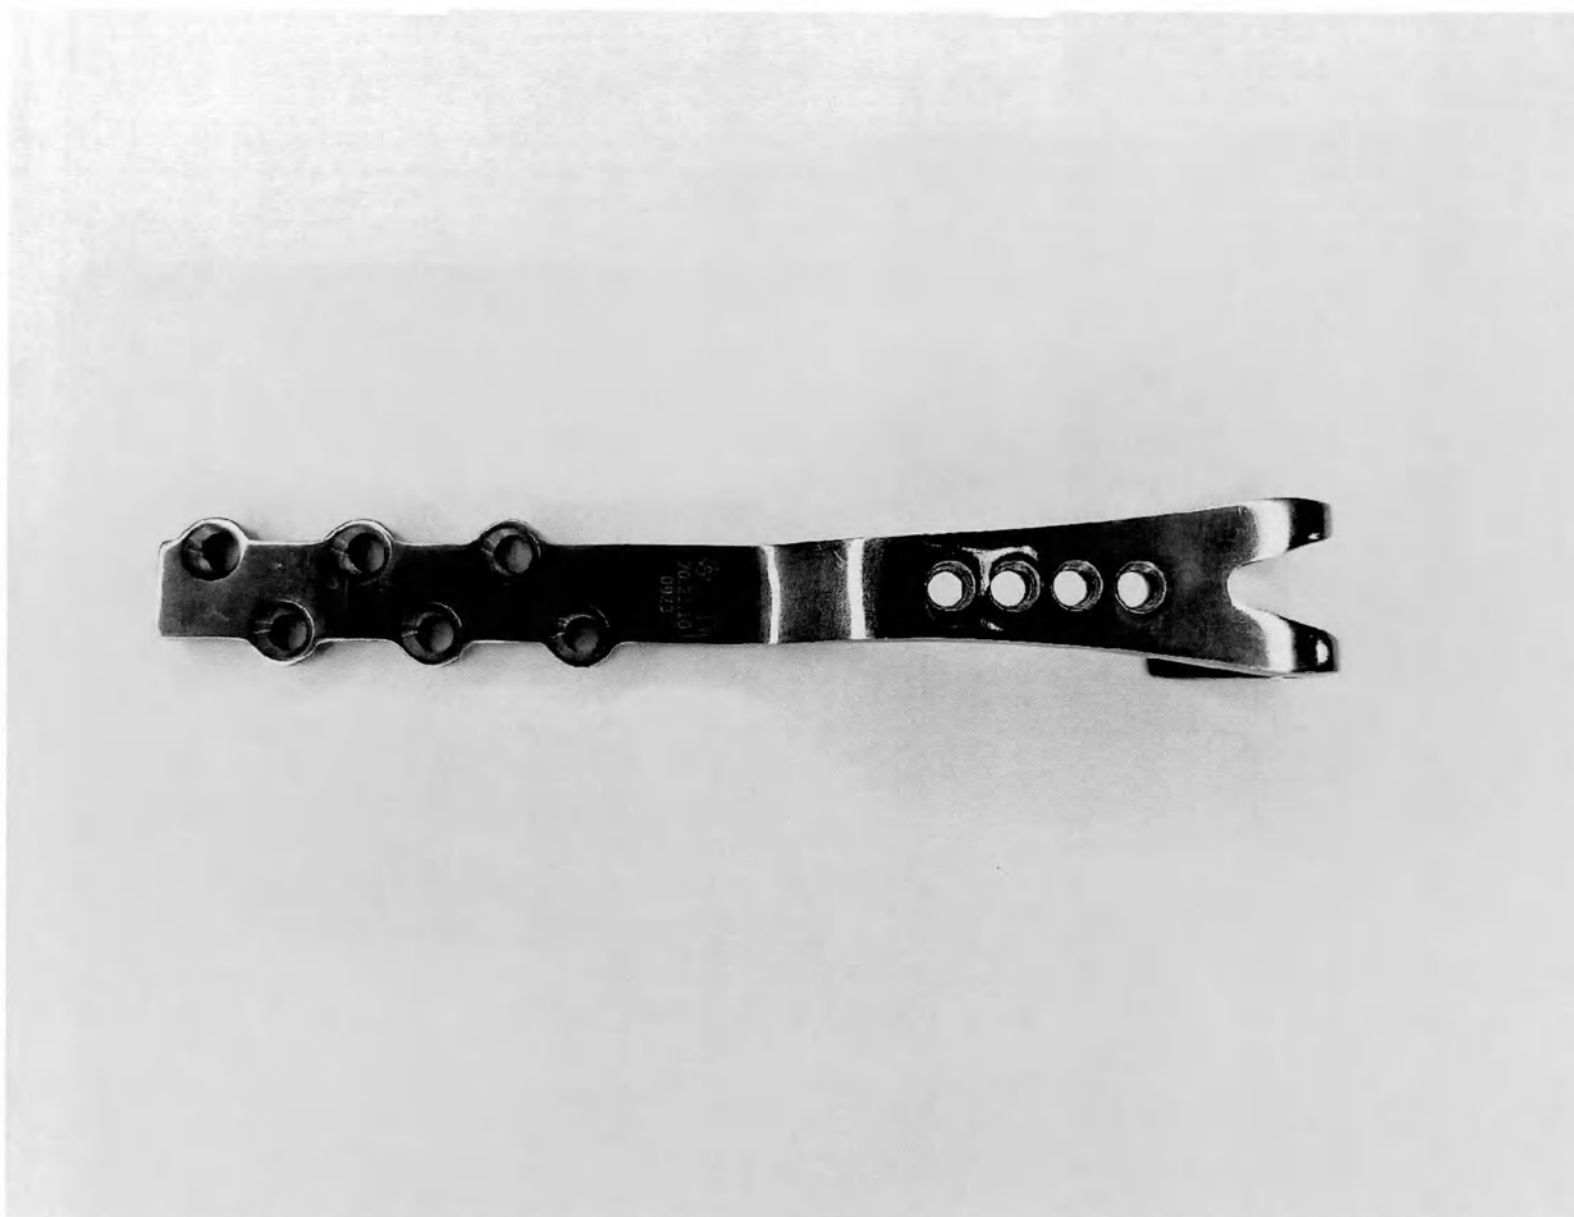


Фото 17. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина вертельная



Фото 18. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина для кубовидной кости с угловой стабильностью



Фото 19. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина для ладьевидной кости с угловой стабильностью



Фото 20. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина медиальная проксимальная для большеберцовой кости с угловой стабильностью



Фото 21. «Система имплантов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина дистальная медиальная маллеолярная для большеберцовой кости с угловой стабильностью



Фото 22. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина дистальная передняя маллеолярная для большеберцовой кости с угловой стабильностью

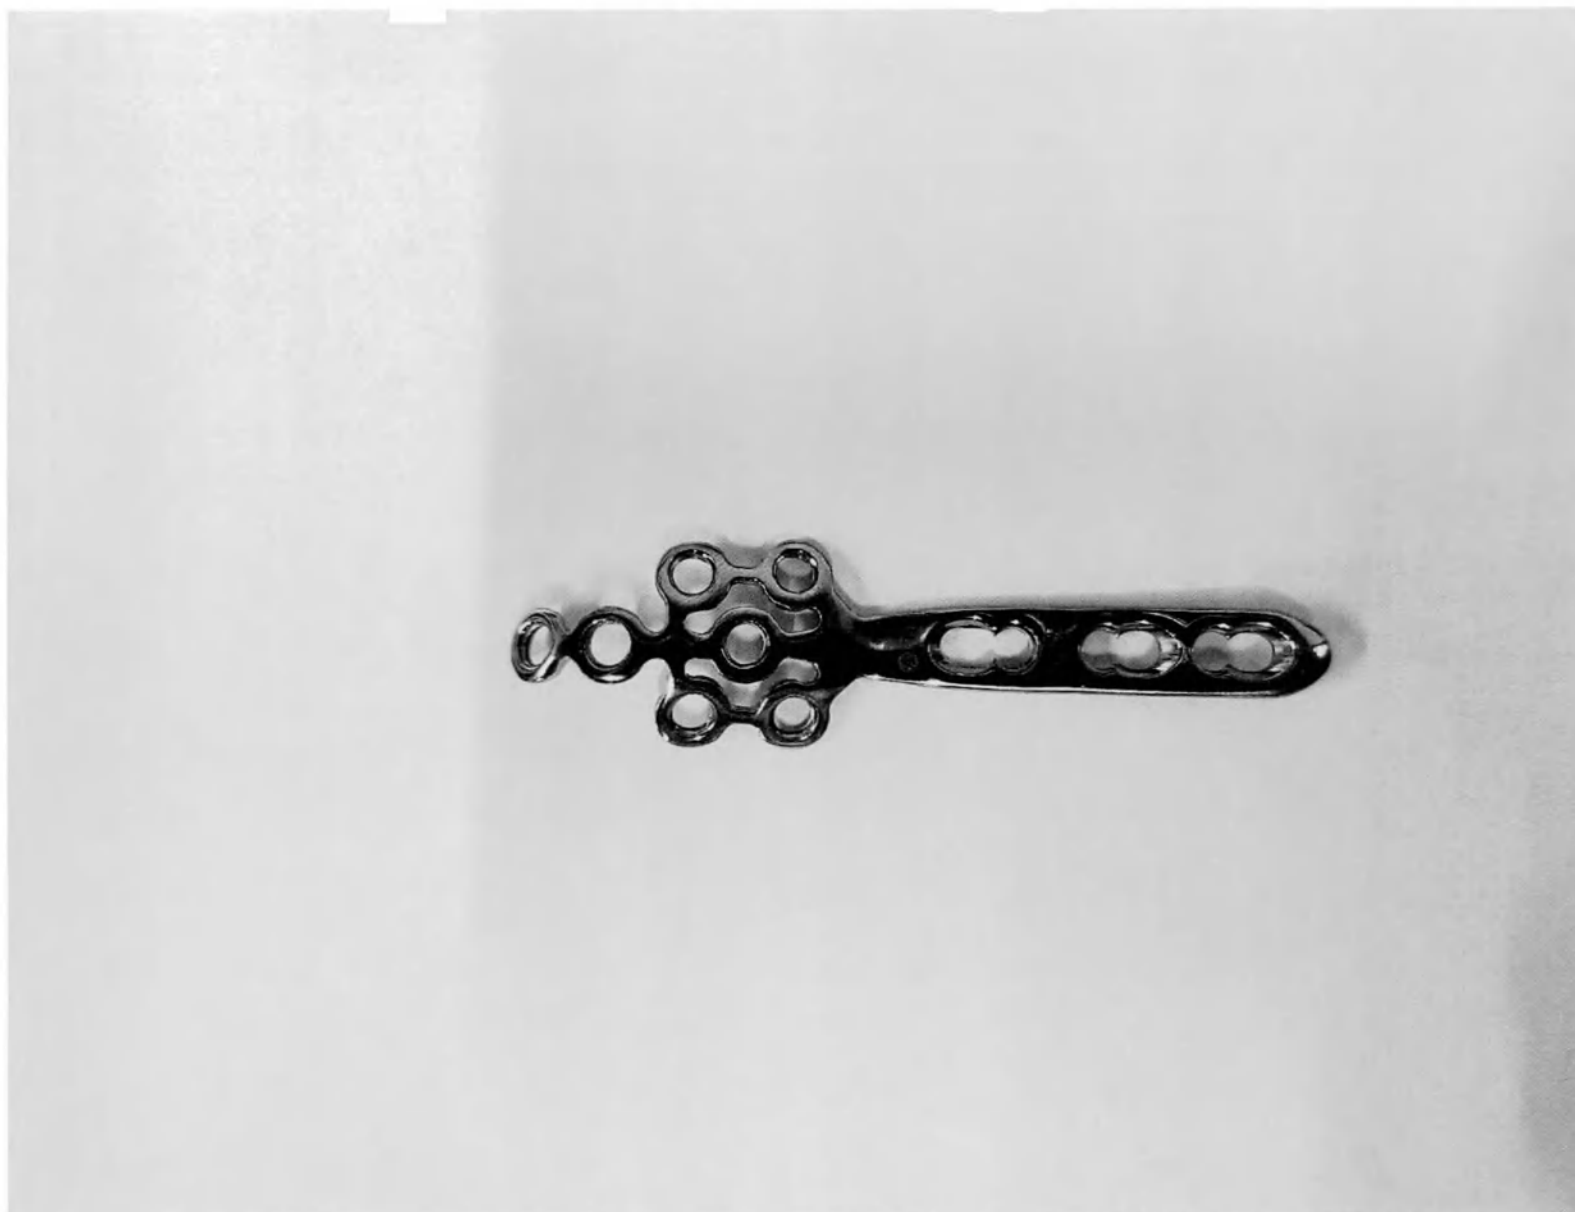


Фото 23. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина дистальная для большеберцовой кости с угловой стабильностью

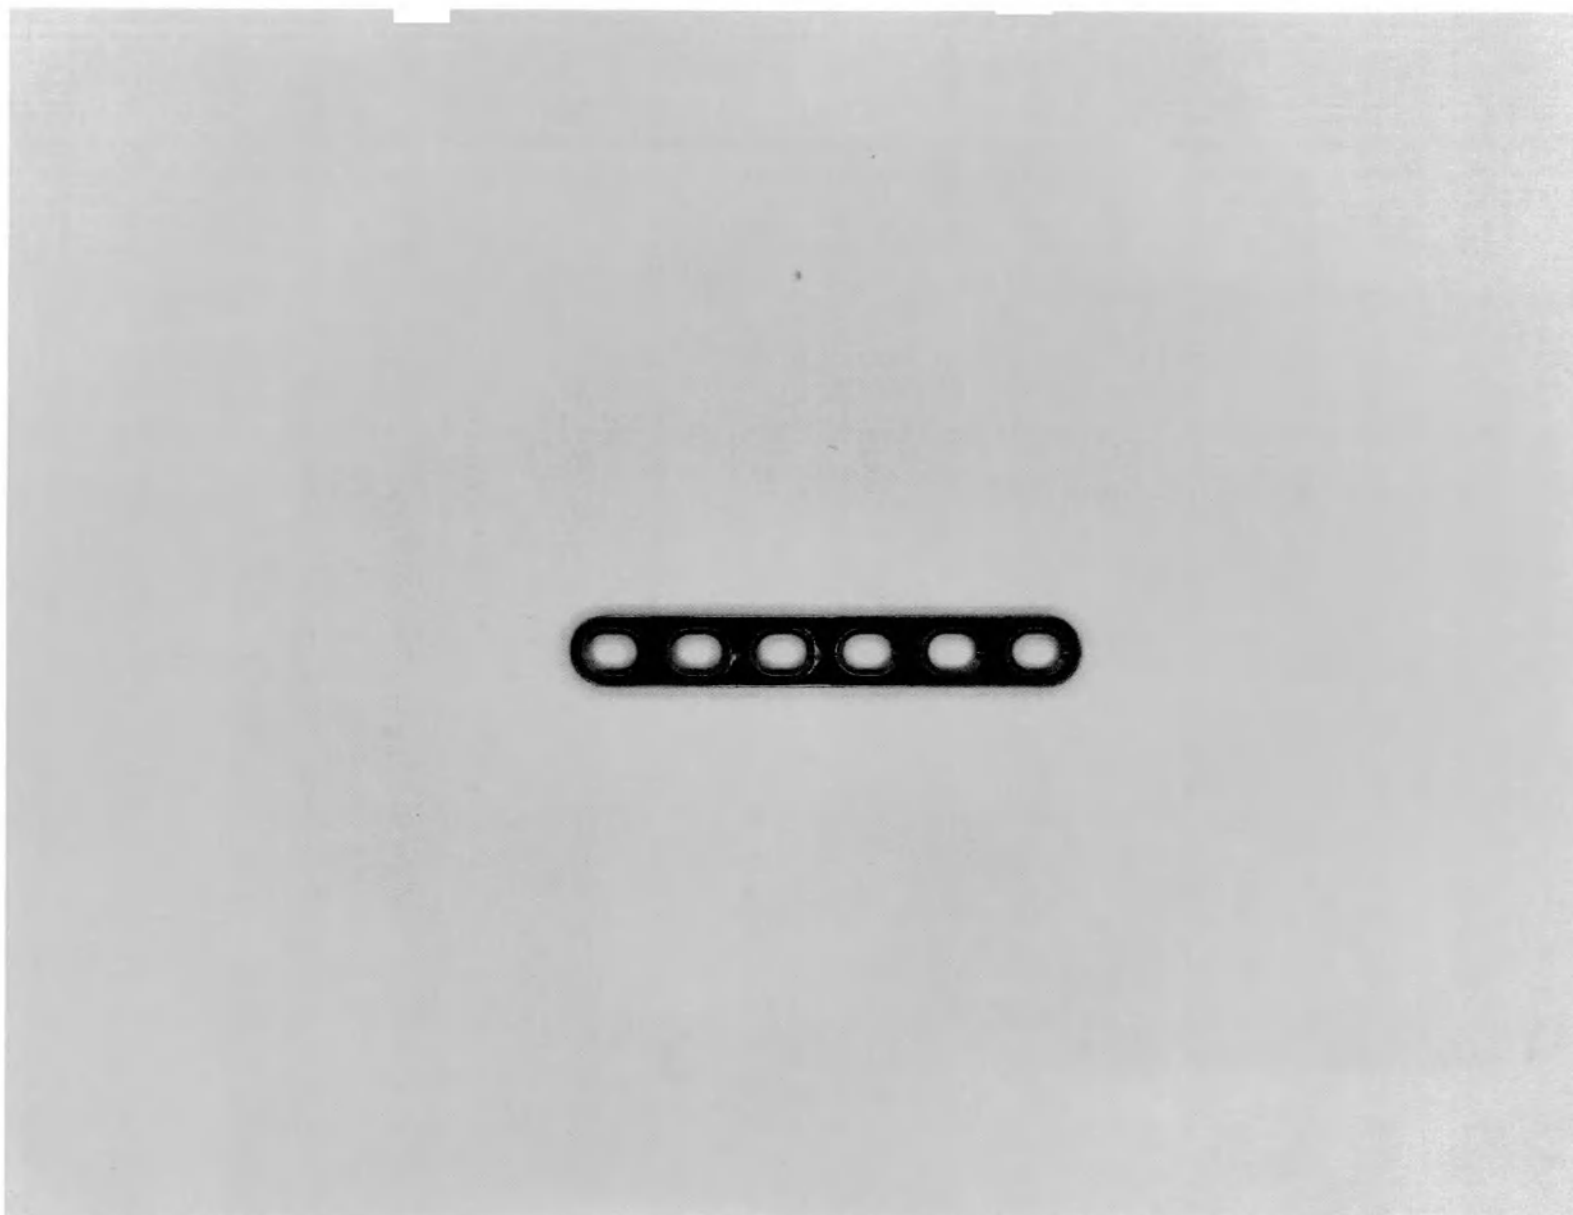


Фото 24. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина прямая малая

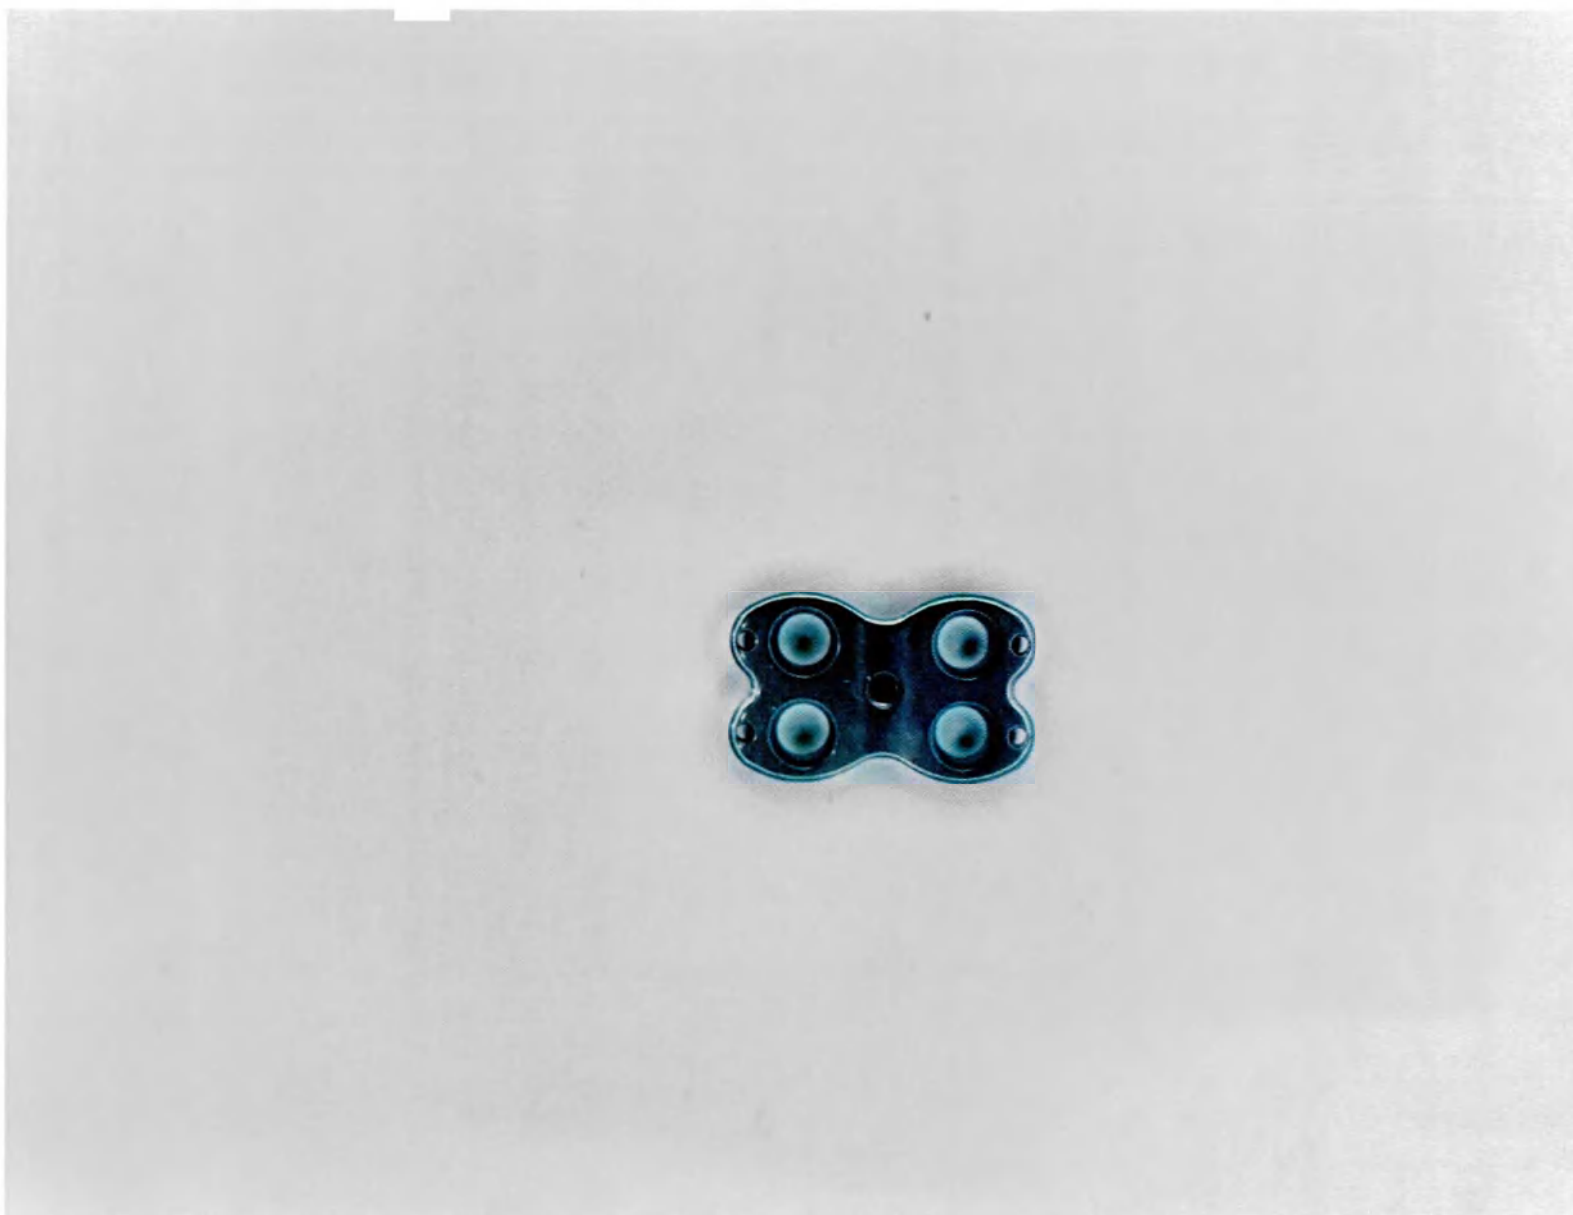


Фото 25. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина Н-образная



Фото 26. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина DHS с комбинированными отверстиями с угловой стабильностью с ограниченным контактом

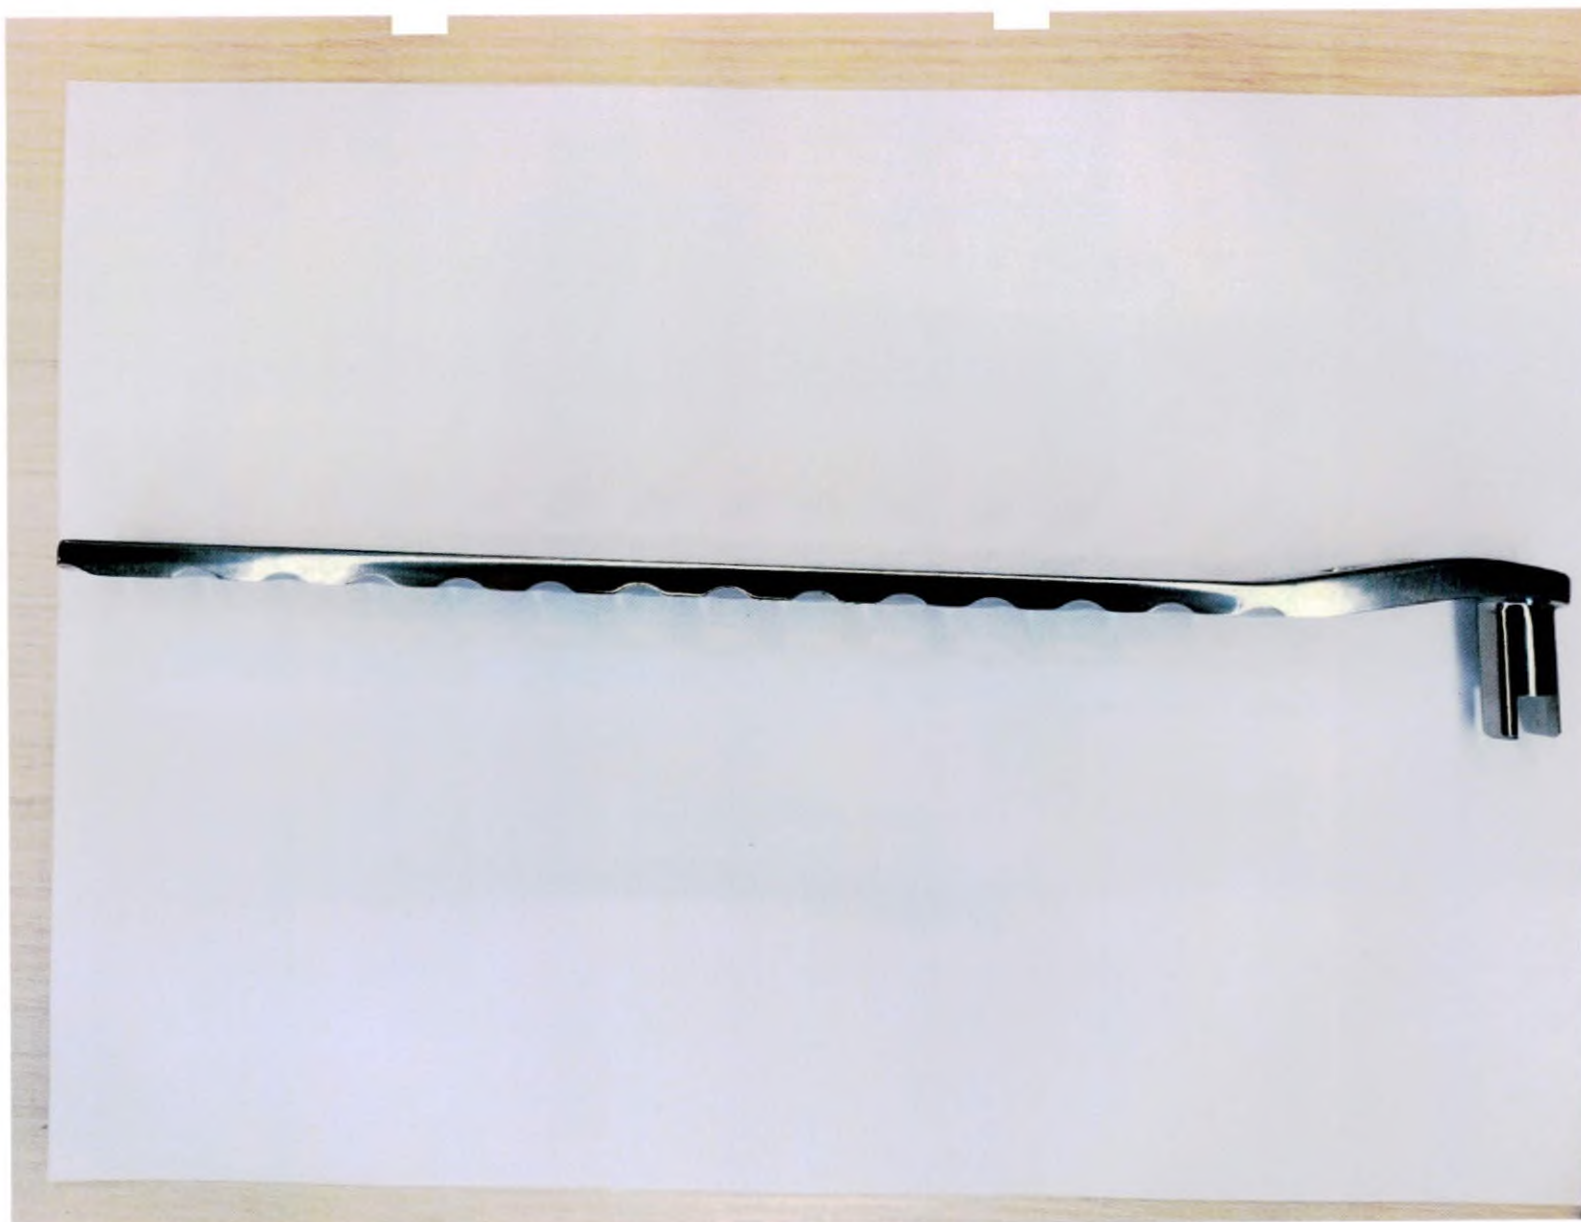


Фото 27. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина DCS с комбинированными отверстиями с угловой стабильностью с ограниченным контактом


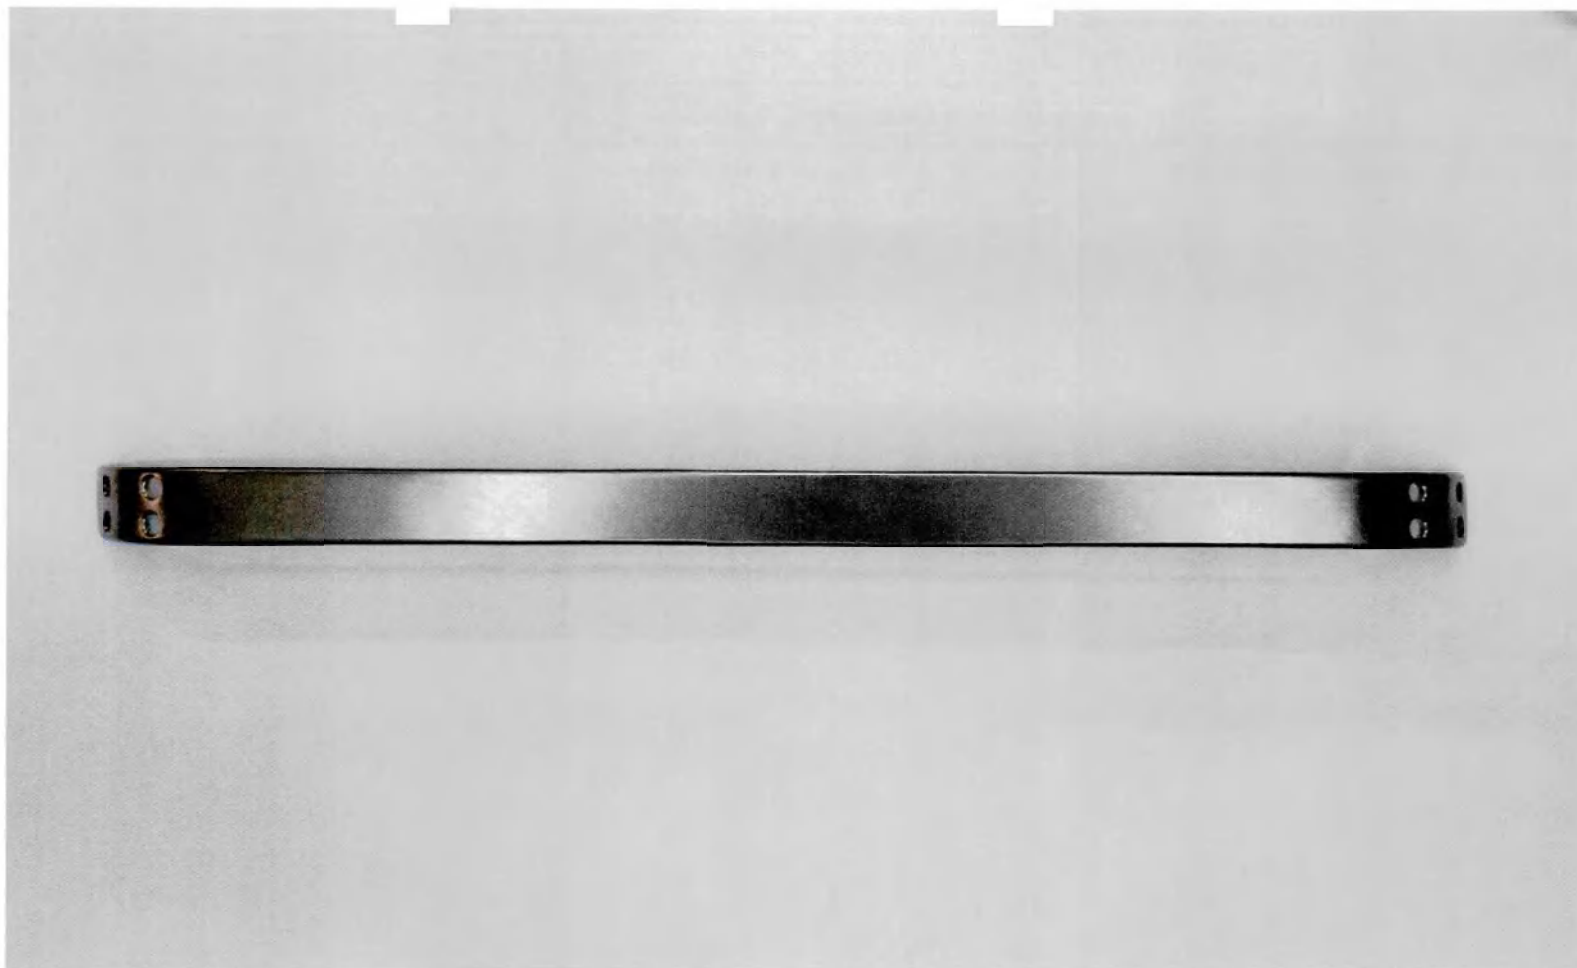


Фото 28. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина для коррекции деформации грудной клетки

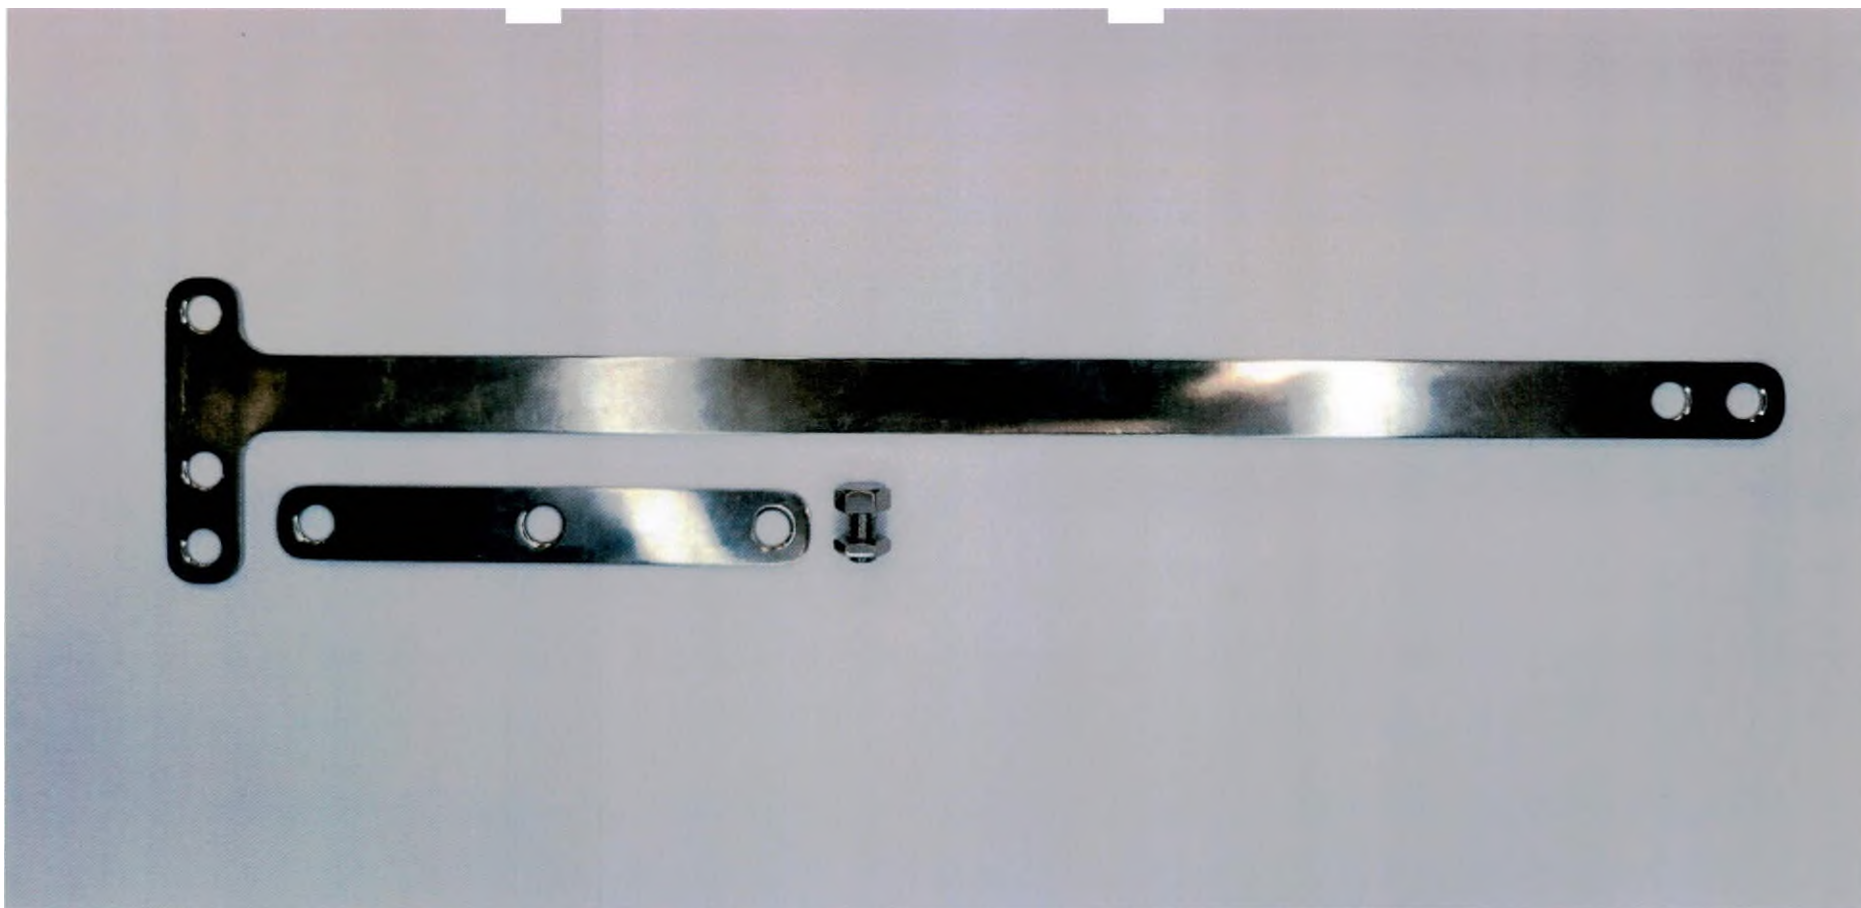

**Фото 29. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина Т-образная для коррекции деформации грудной клетки**

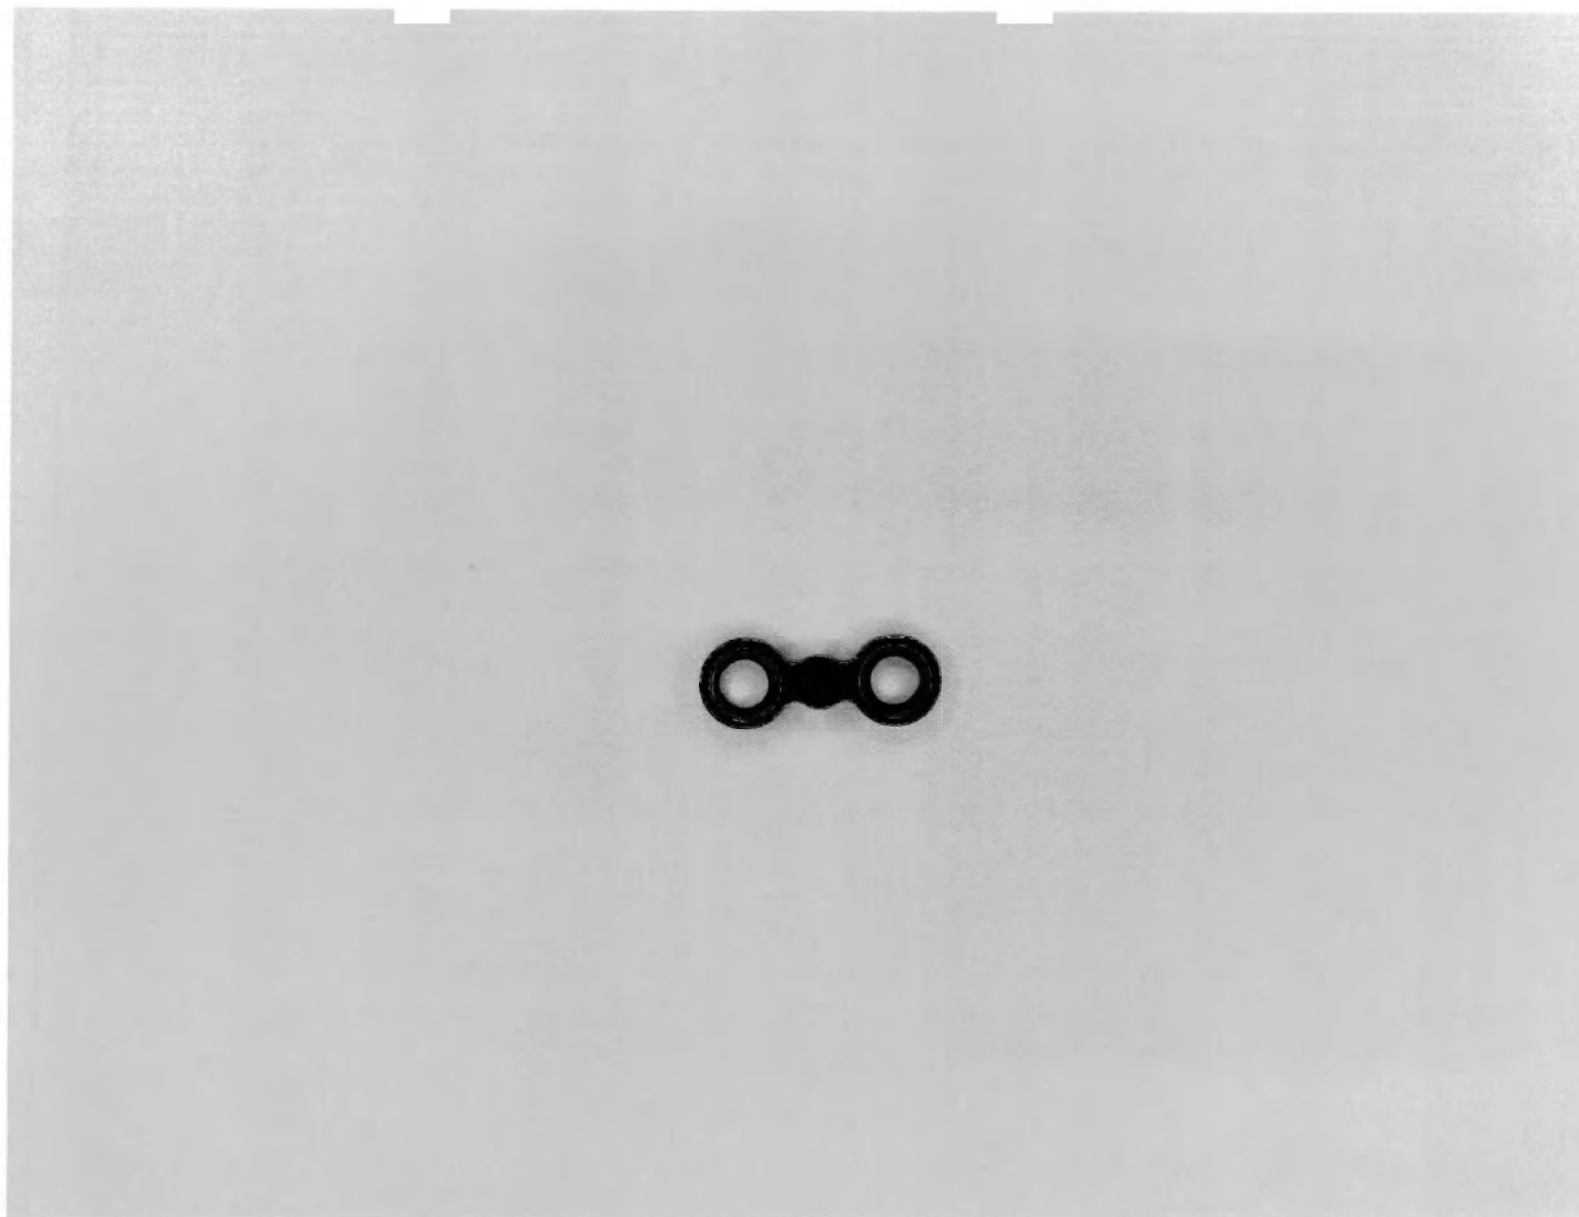


Фото 30. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина восьмиобразная прямая

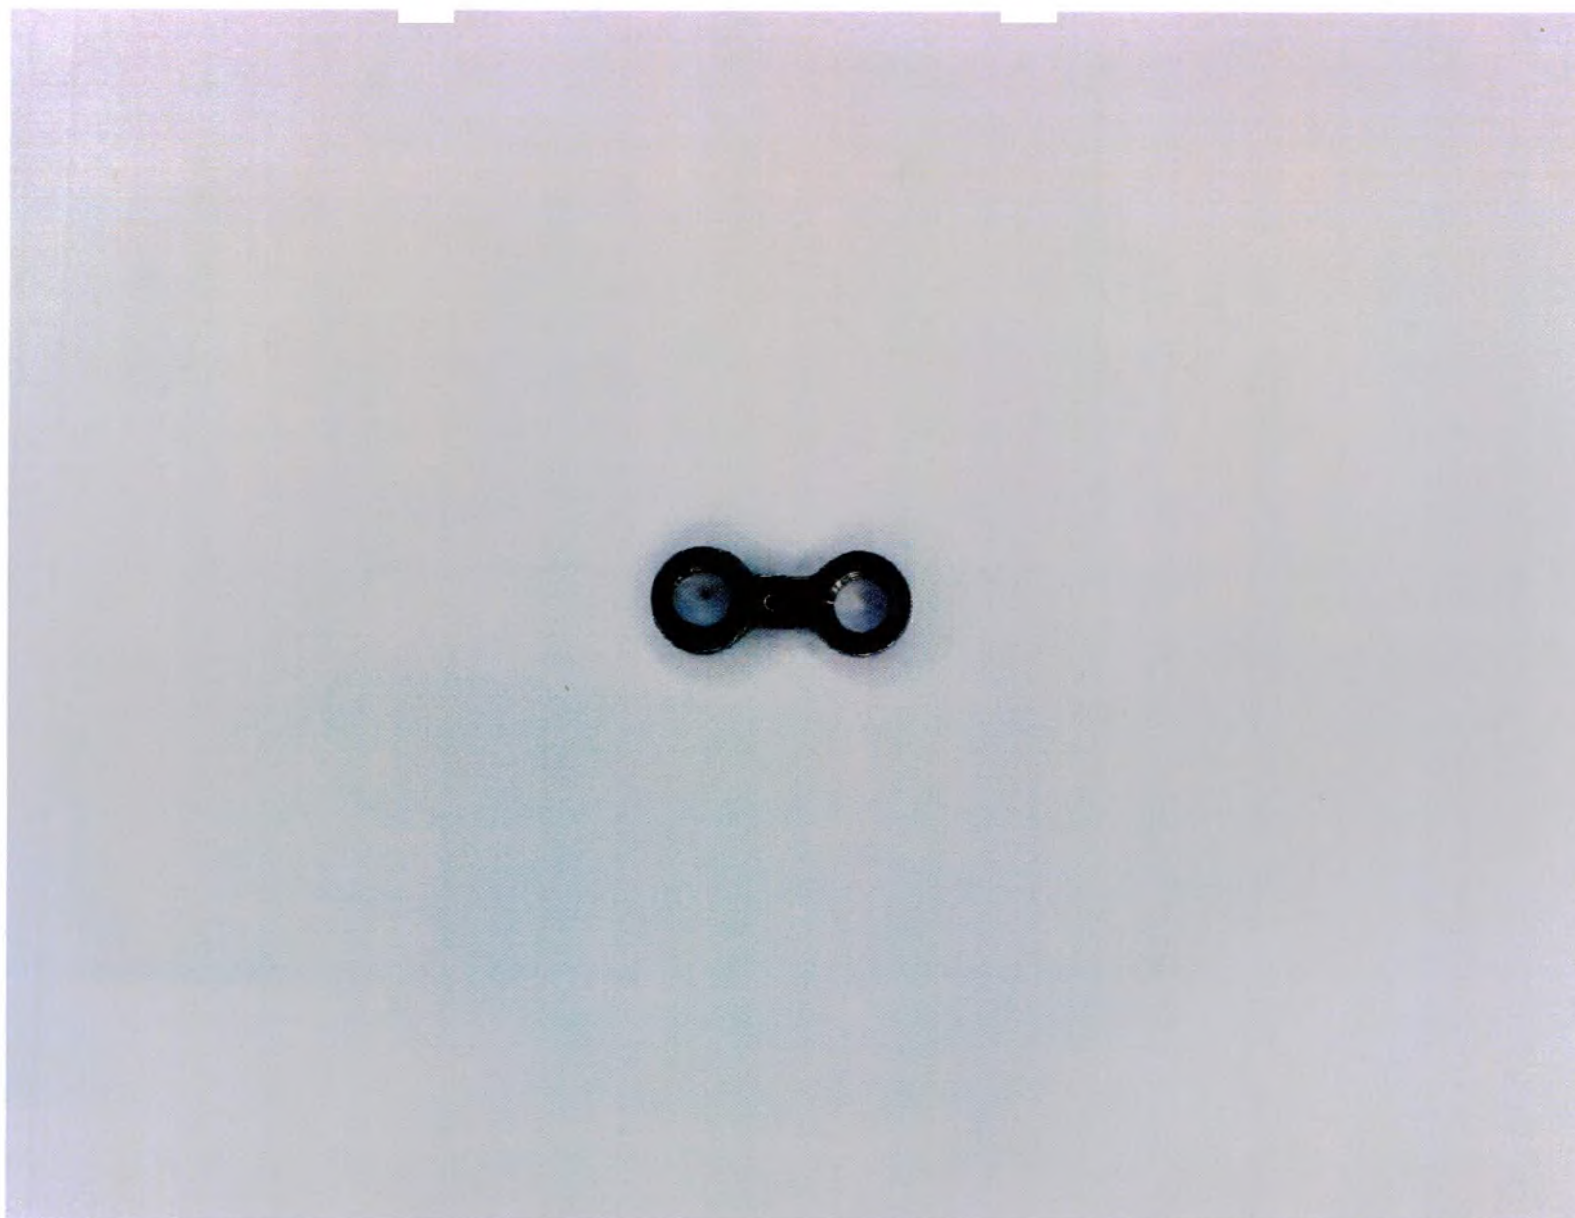


Фото 31. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина восьмиобразная профилированная

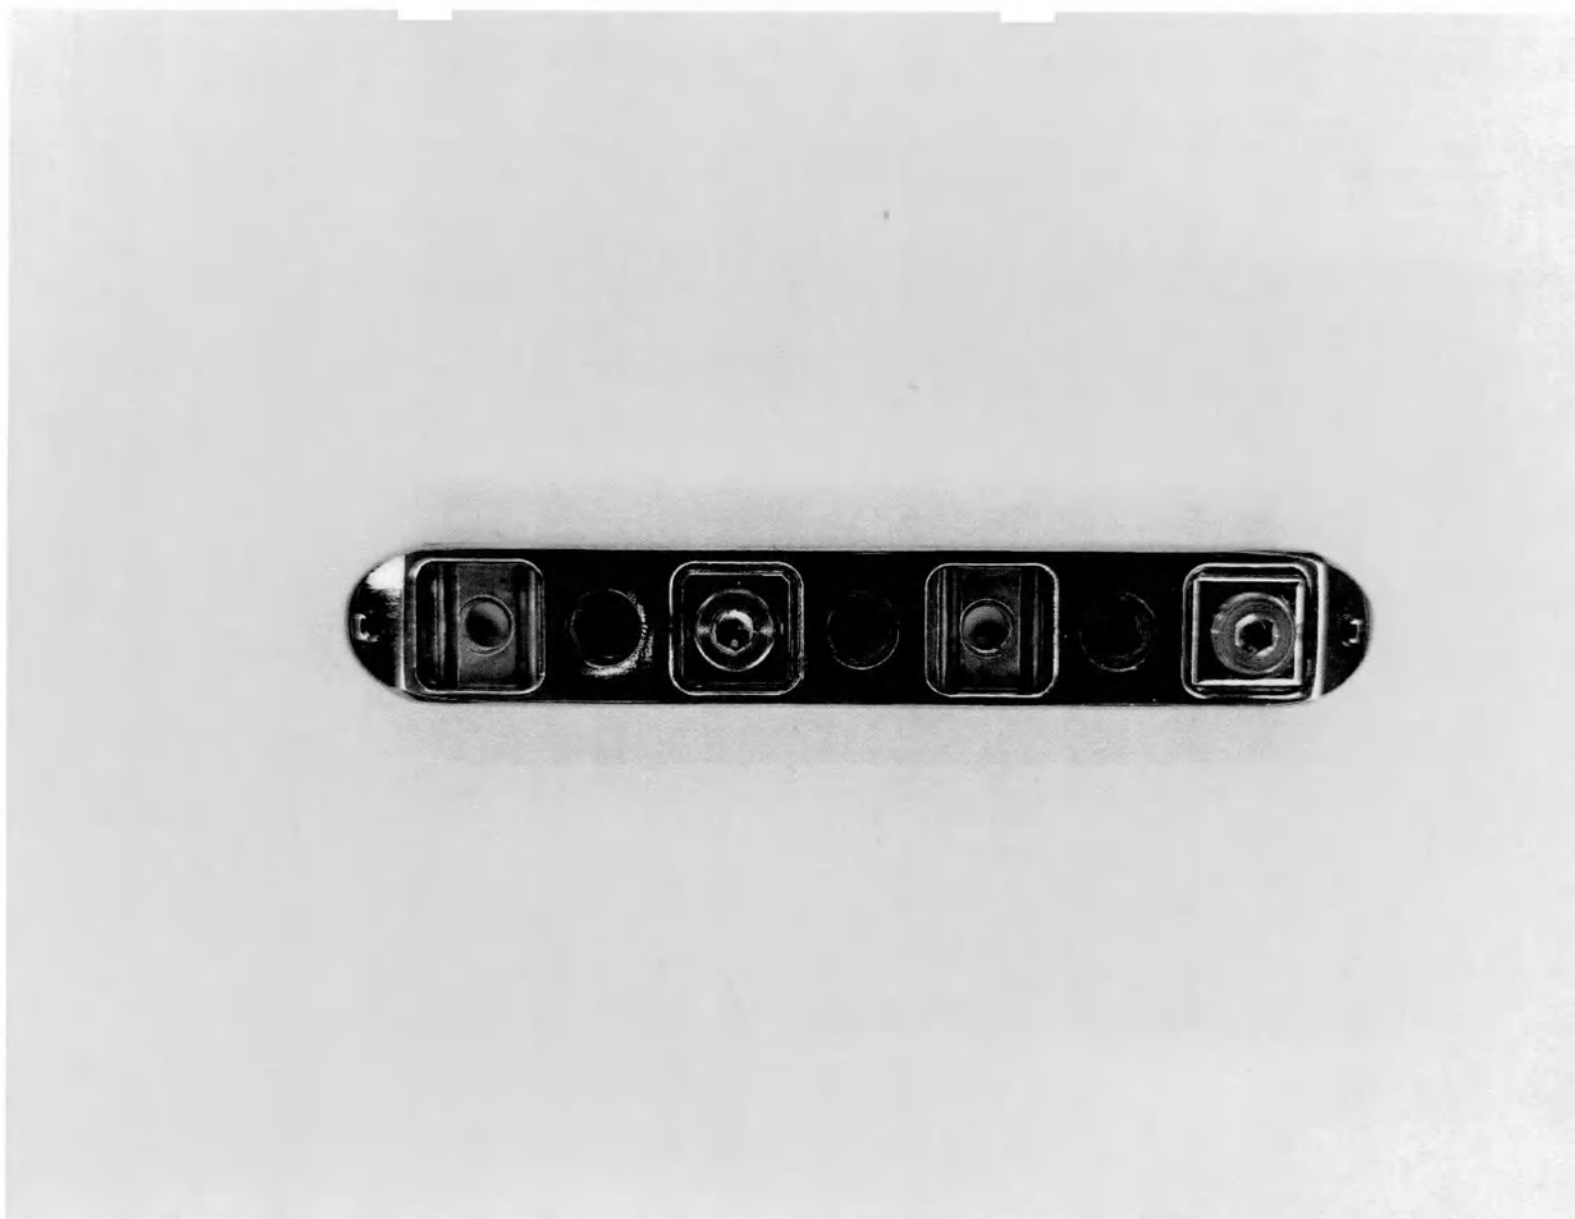


Фото 32. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина перипротезная прямая с угловой стабильностью

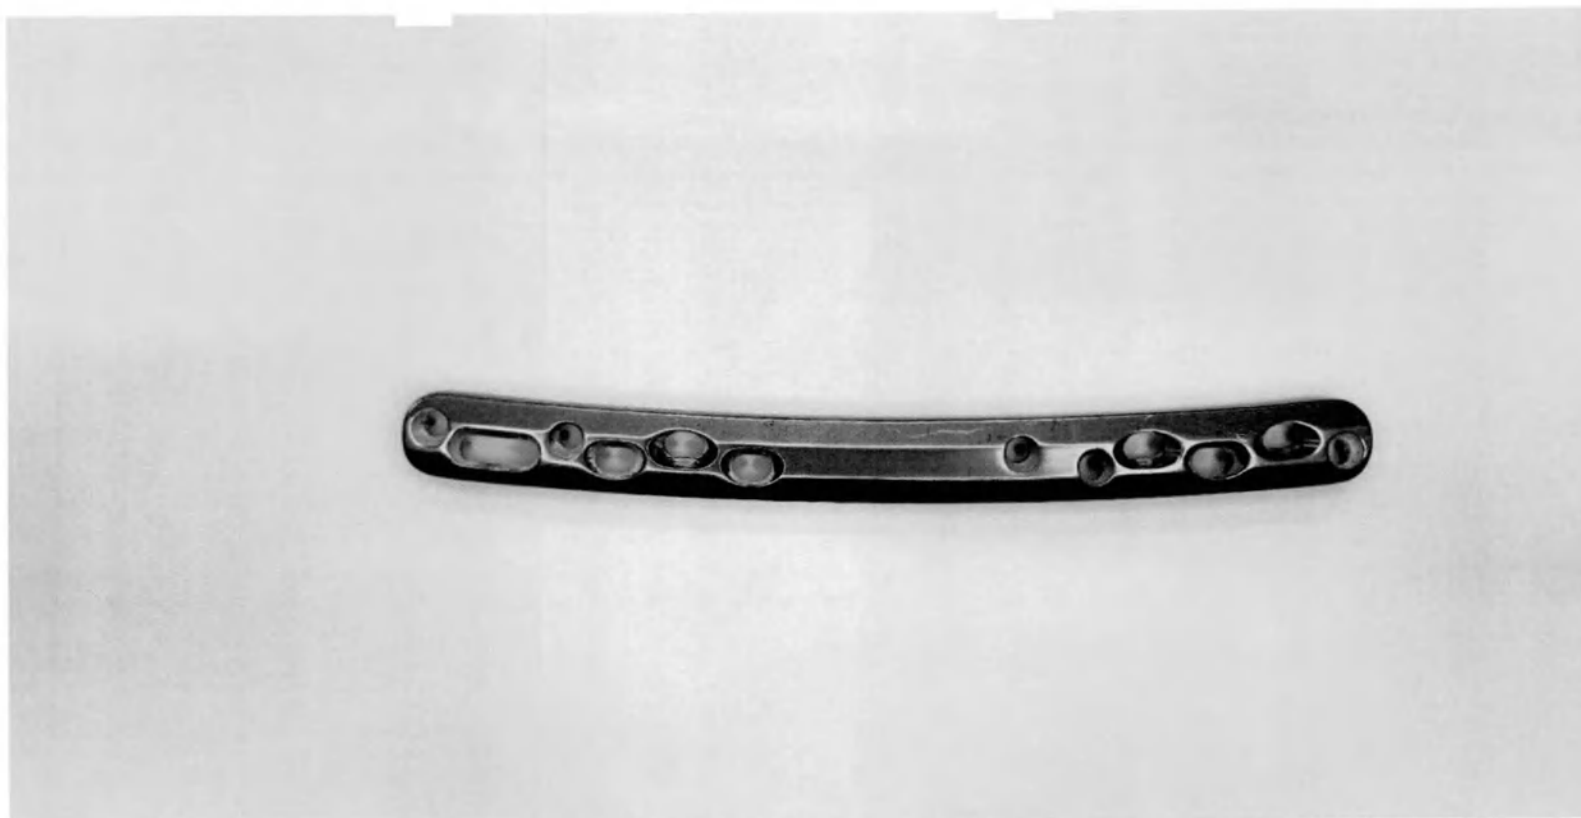


Фото 33. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина перипротезная

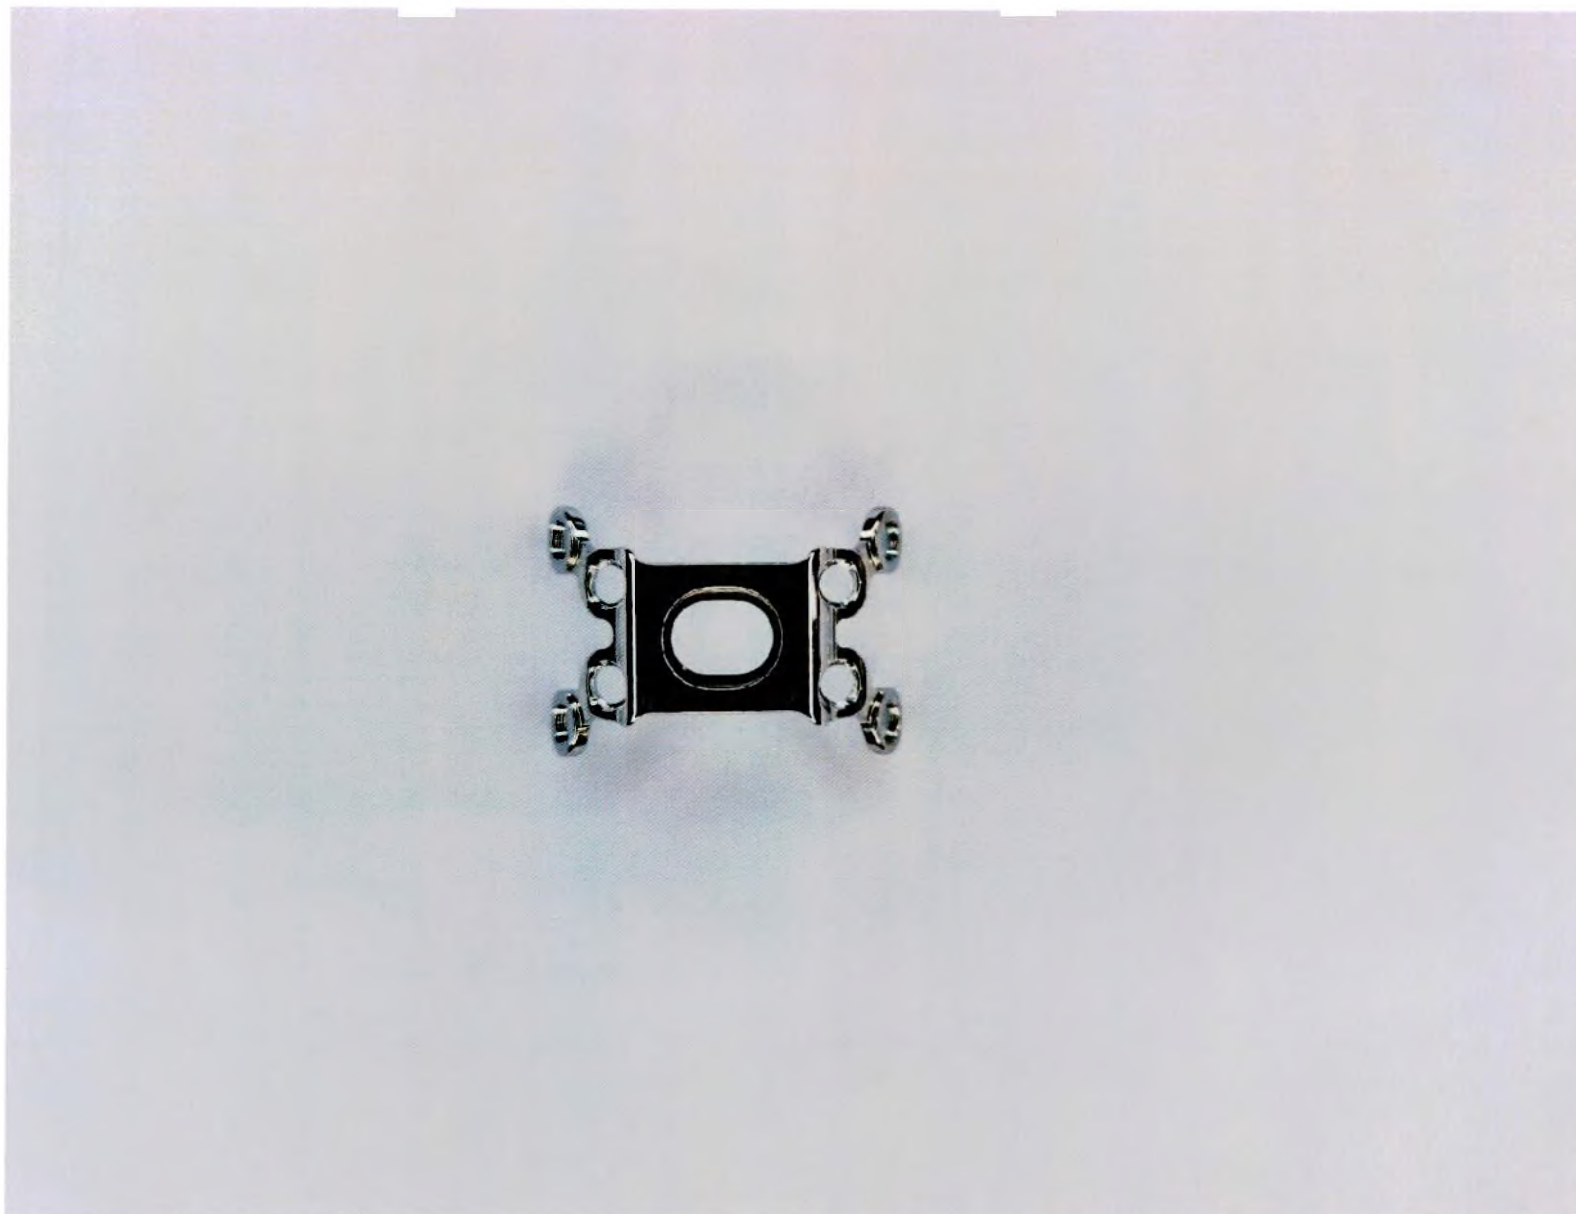


Фото 34. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина перипротезная фиксирующая с угловой стабильностью

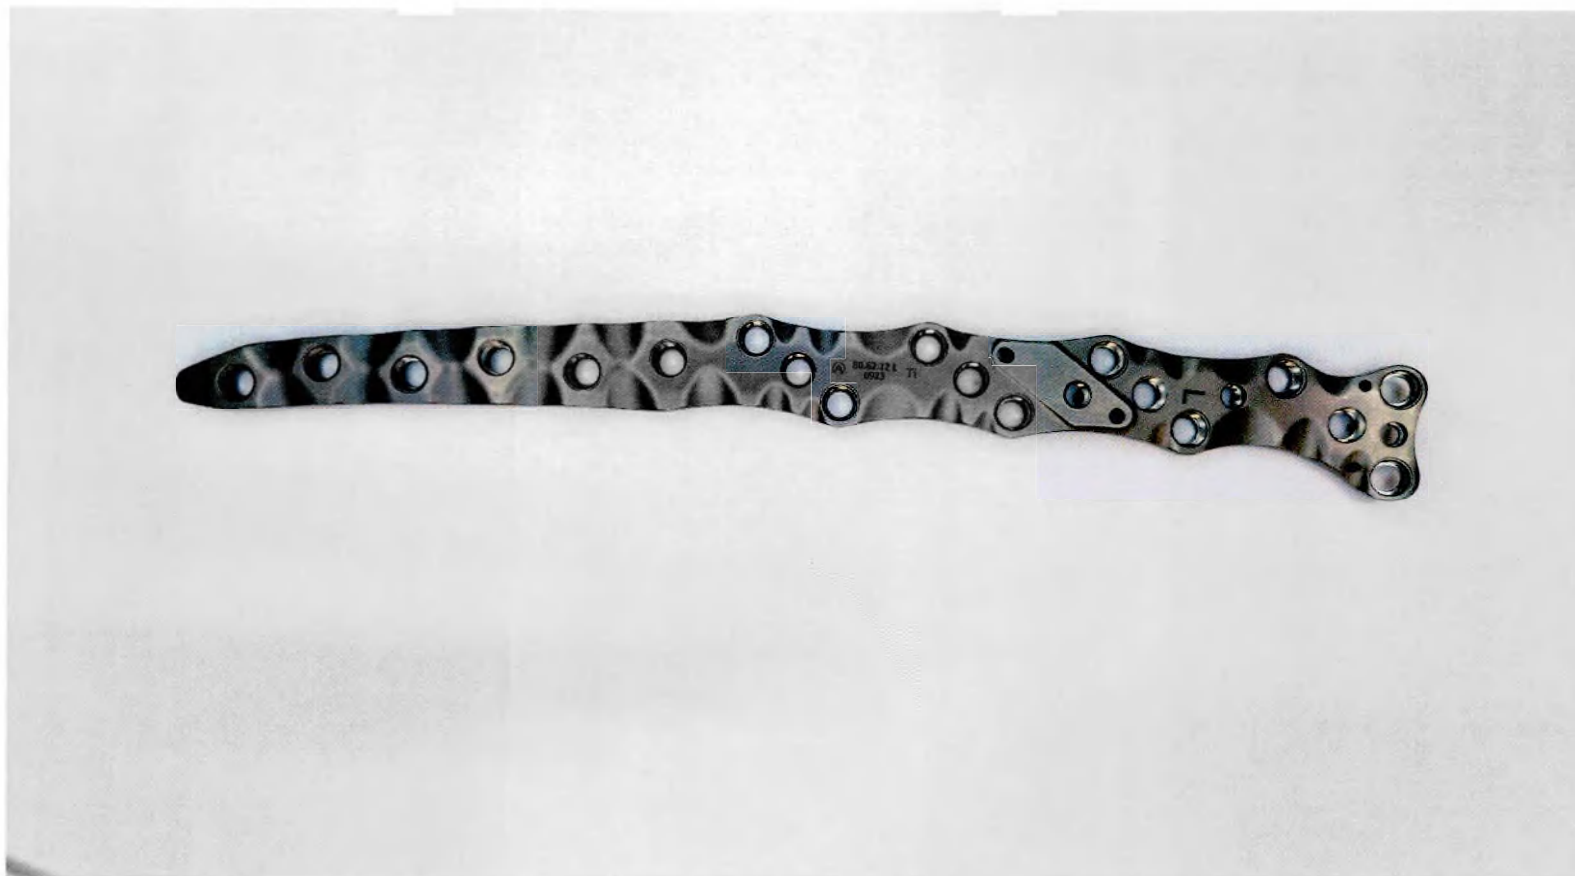


Фото 35. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина перипротезная проксимальная бедренная с угловой стабильностью



Фото 36. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина перипротезная дистальная бедренная с угловой стабильностью

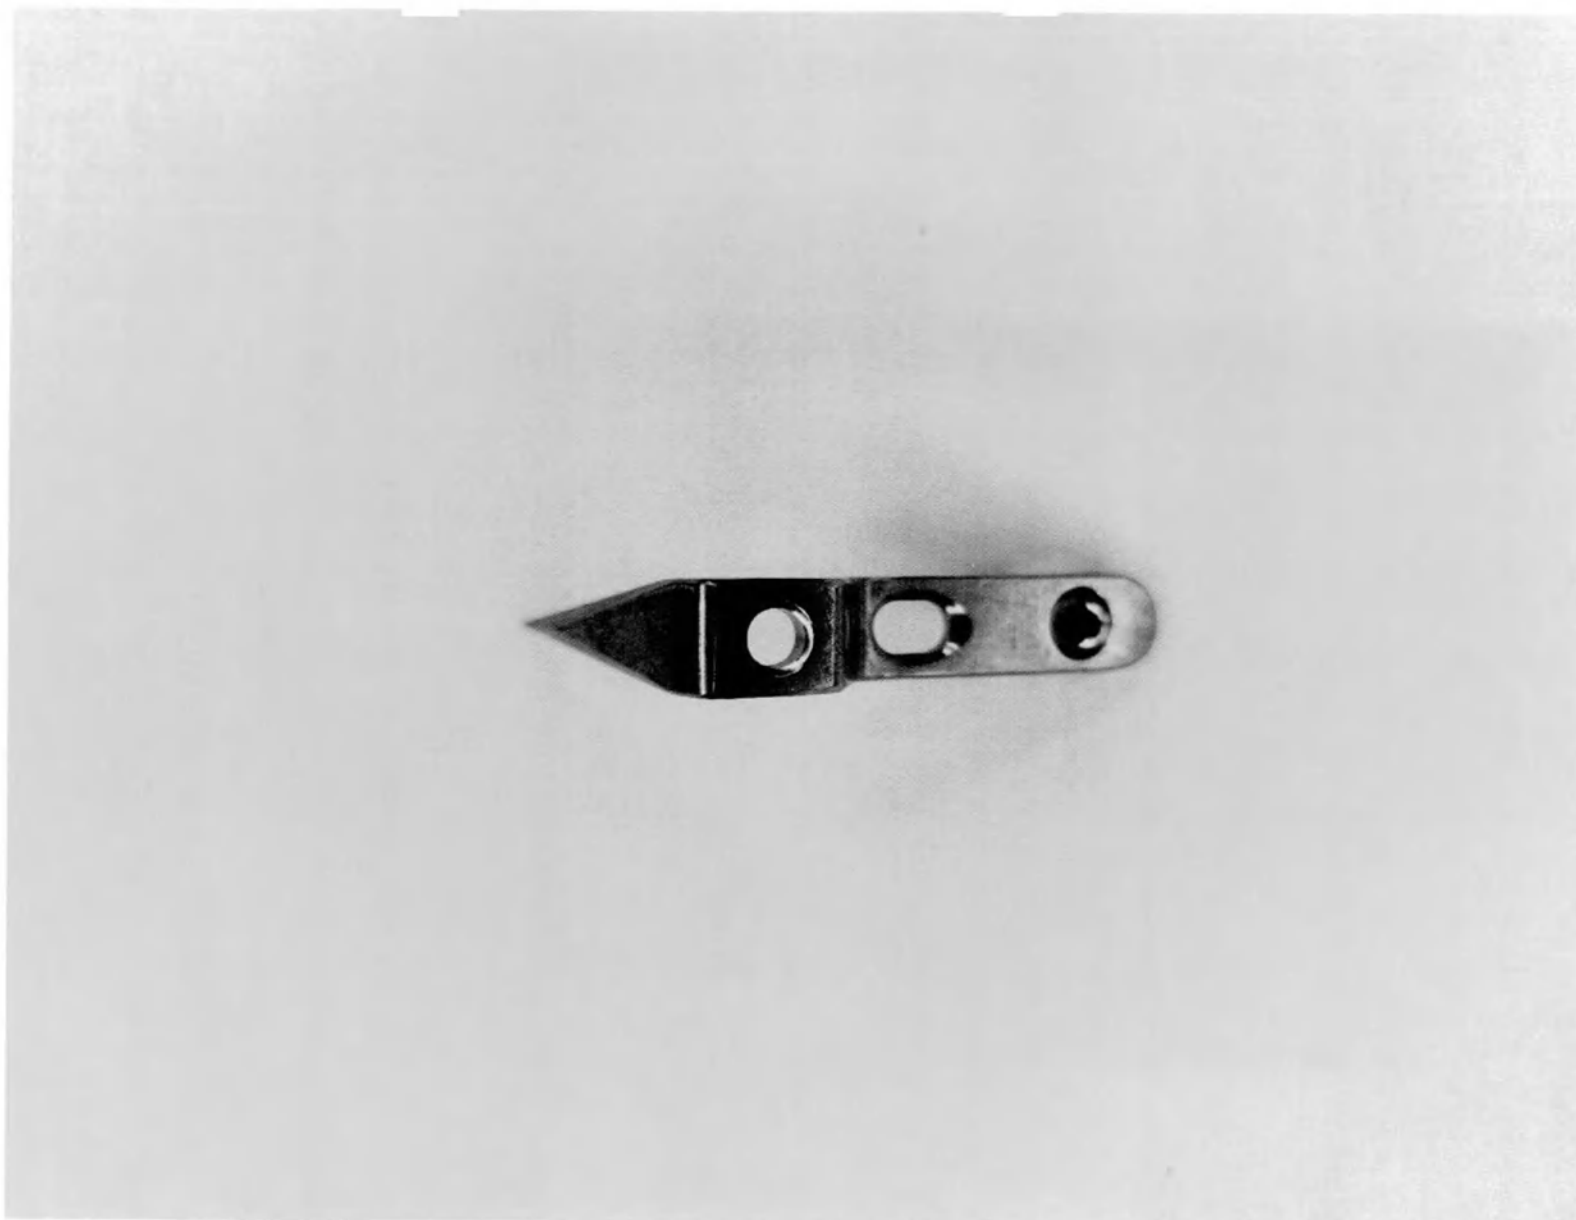


Фото 37. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина угловая малая варизирующая

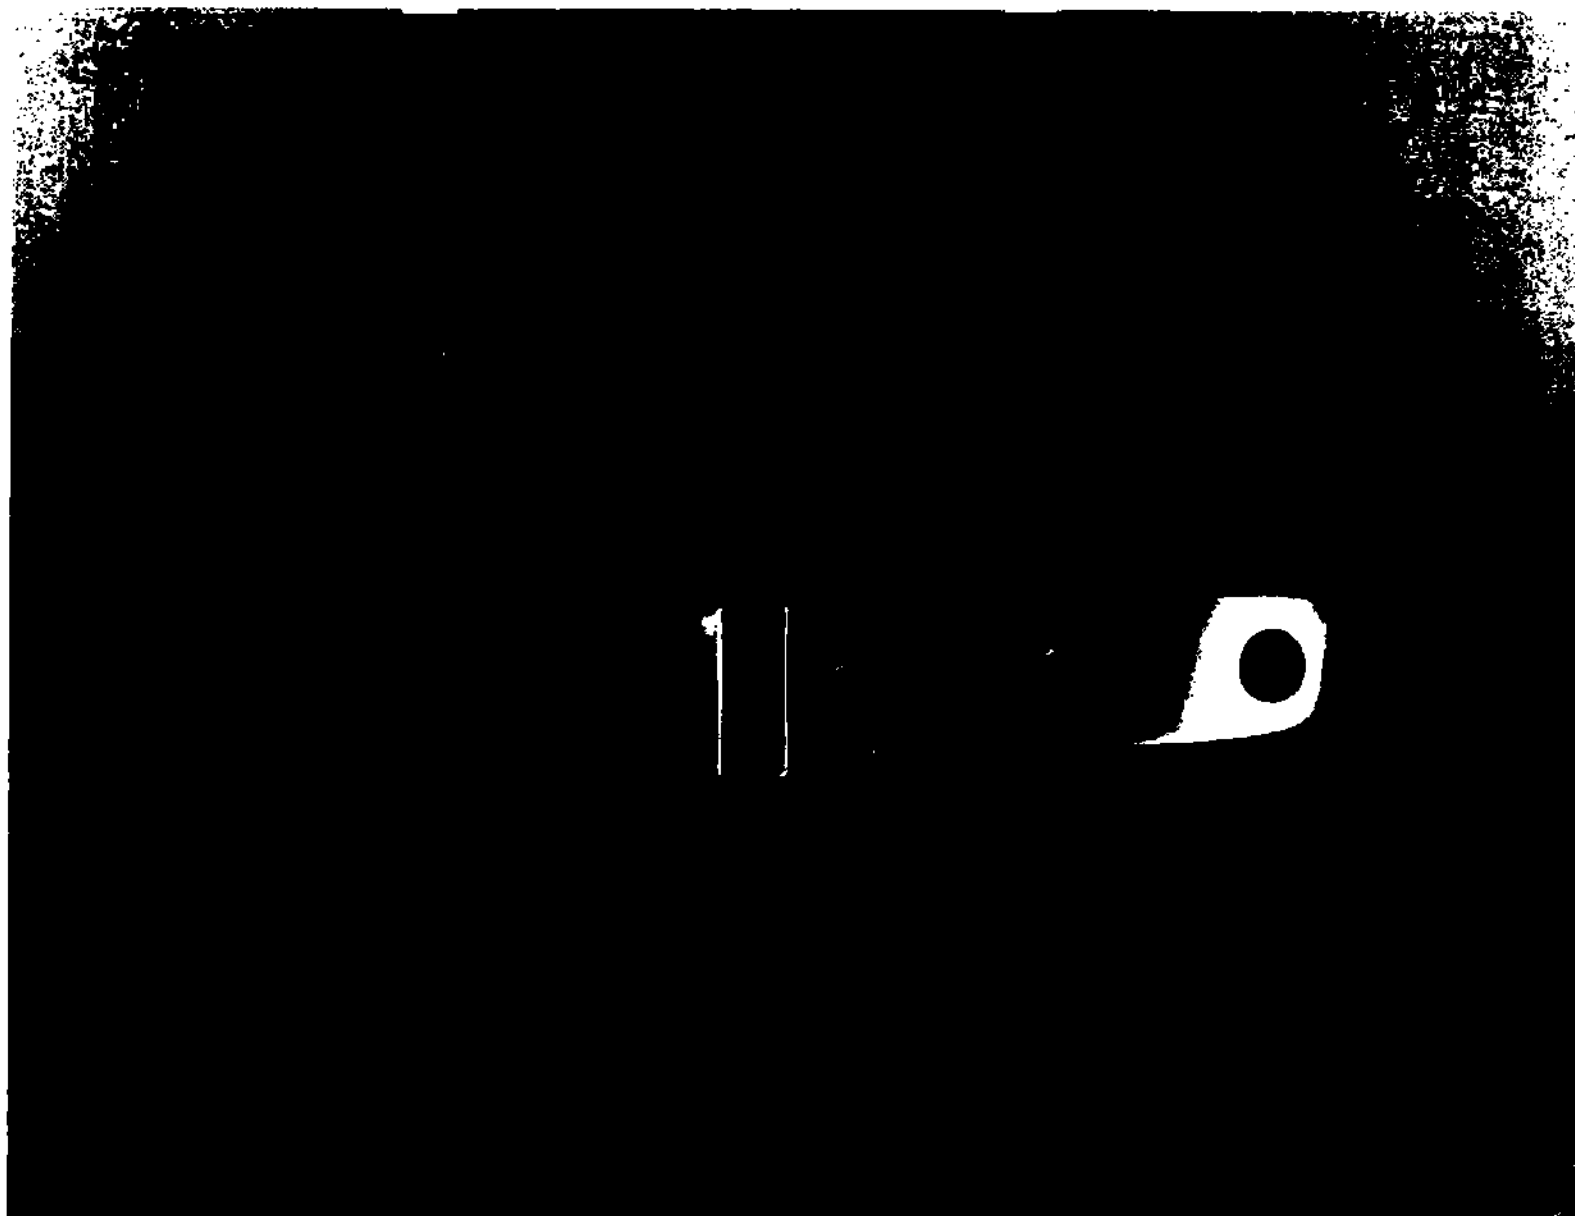


Фото 38. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина угловая малая вальгизирующая

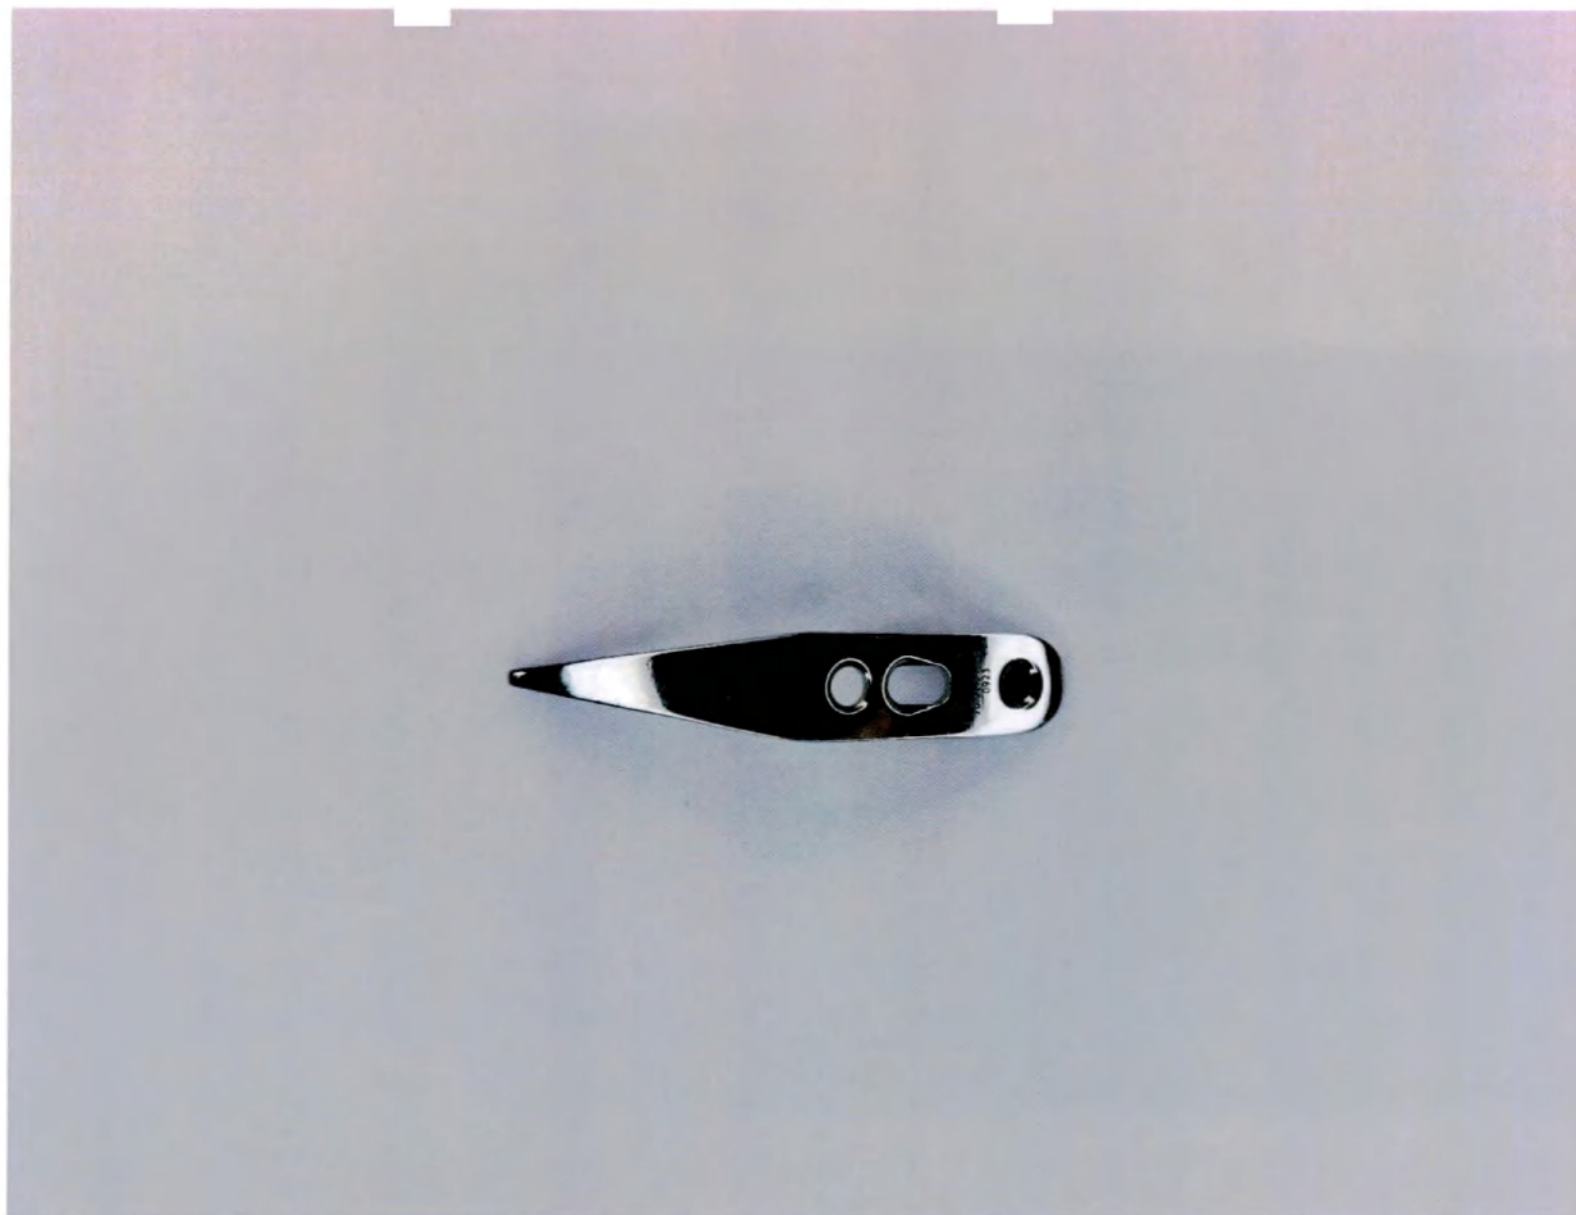


Фото 39. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина угловая малая



Фото 40. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина для остеотомии большеберцовой кости с угловой стабильностью



Фото 41. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина медиальная для остеотомии большеберцовой кости с угловой стабильностью



Фото 42. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии с угловой стабильностью с ограниченным контактом

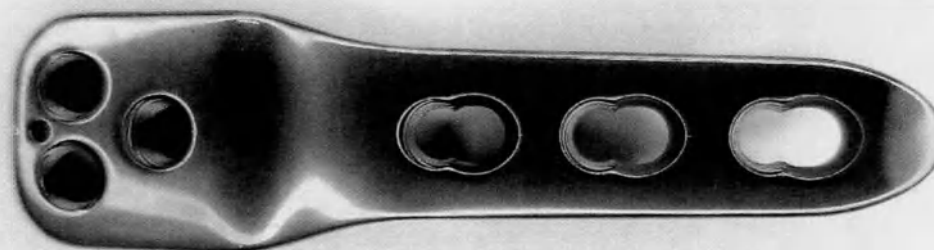


Фото 43. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина педиатрическая бедренная для варусной остеотомии с угловой стабильностью



Фото 44. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина педиатрическая бедренная для вальгусной остеотомии с угловой стабильностью с ограниченным контактом



Фото 45. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина Т-образная для остеотомии большеберцовой кости с угловой стабильностью



Фото 46. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина латеральная для остеотомии большеберцовой кости с угловой стабильностью

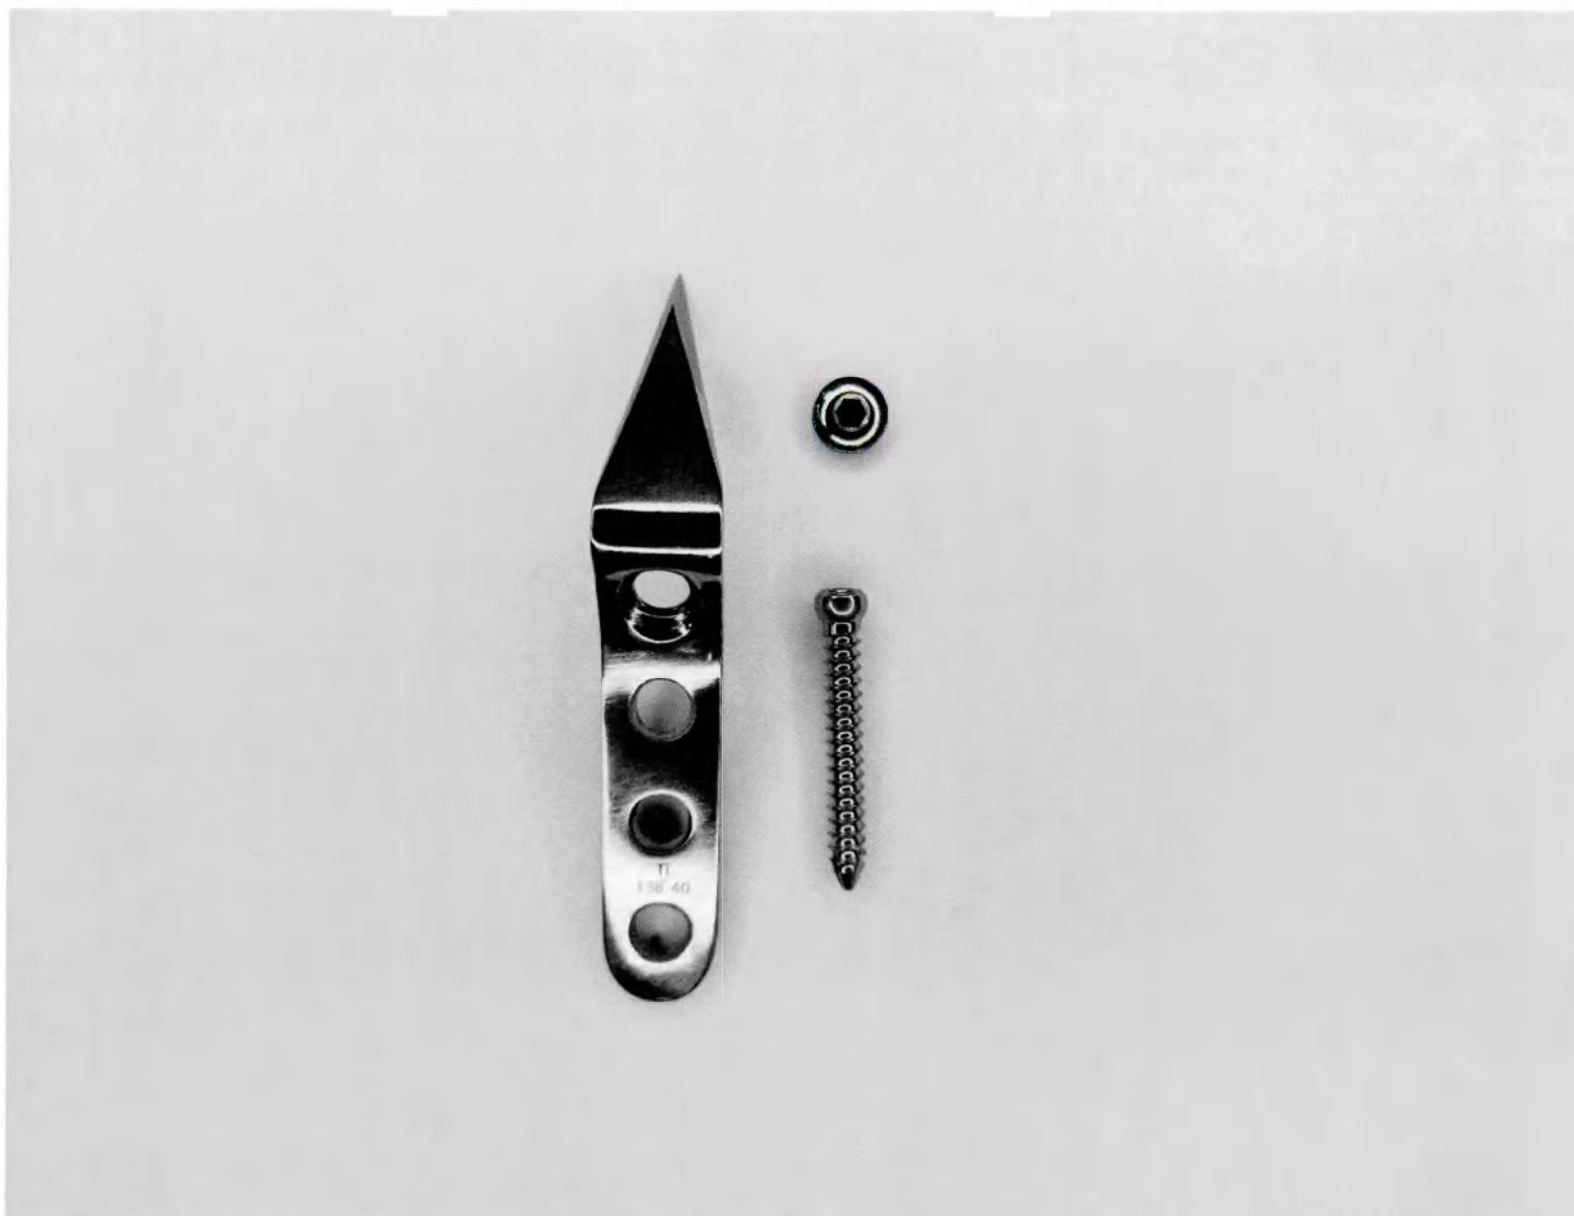


Фото 47. «Система имплантов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Пластина угловая малая вальгизирующая полиаксиальная

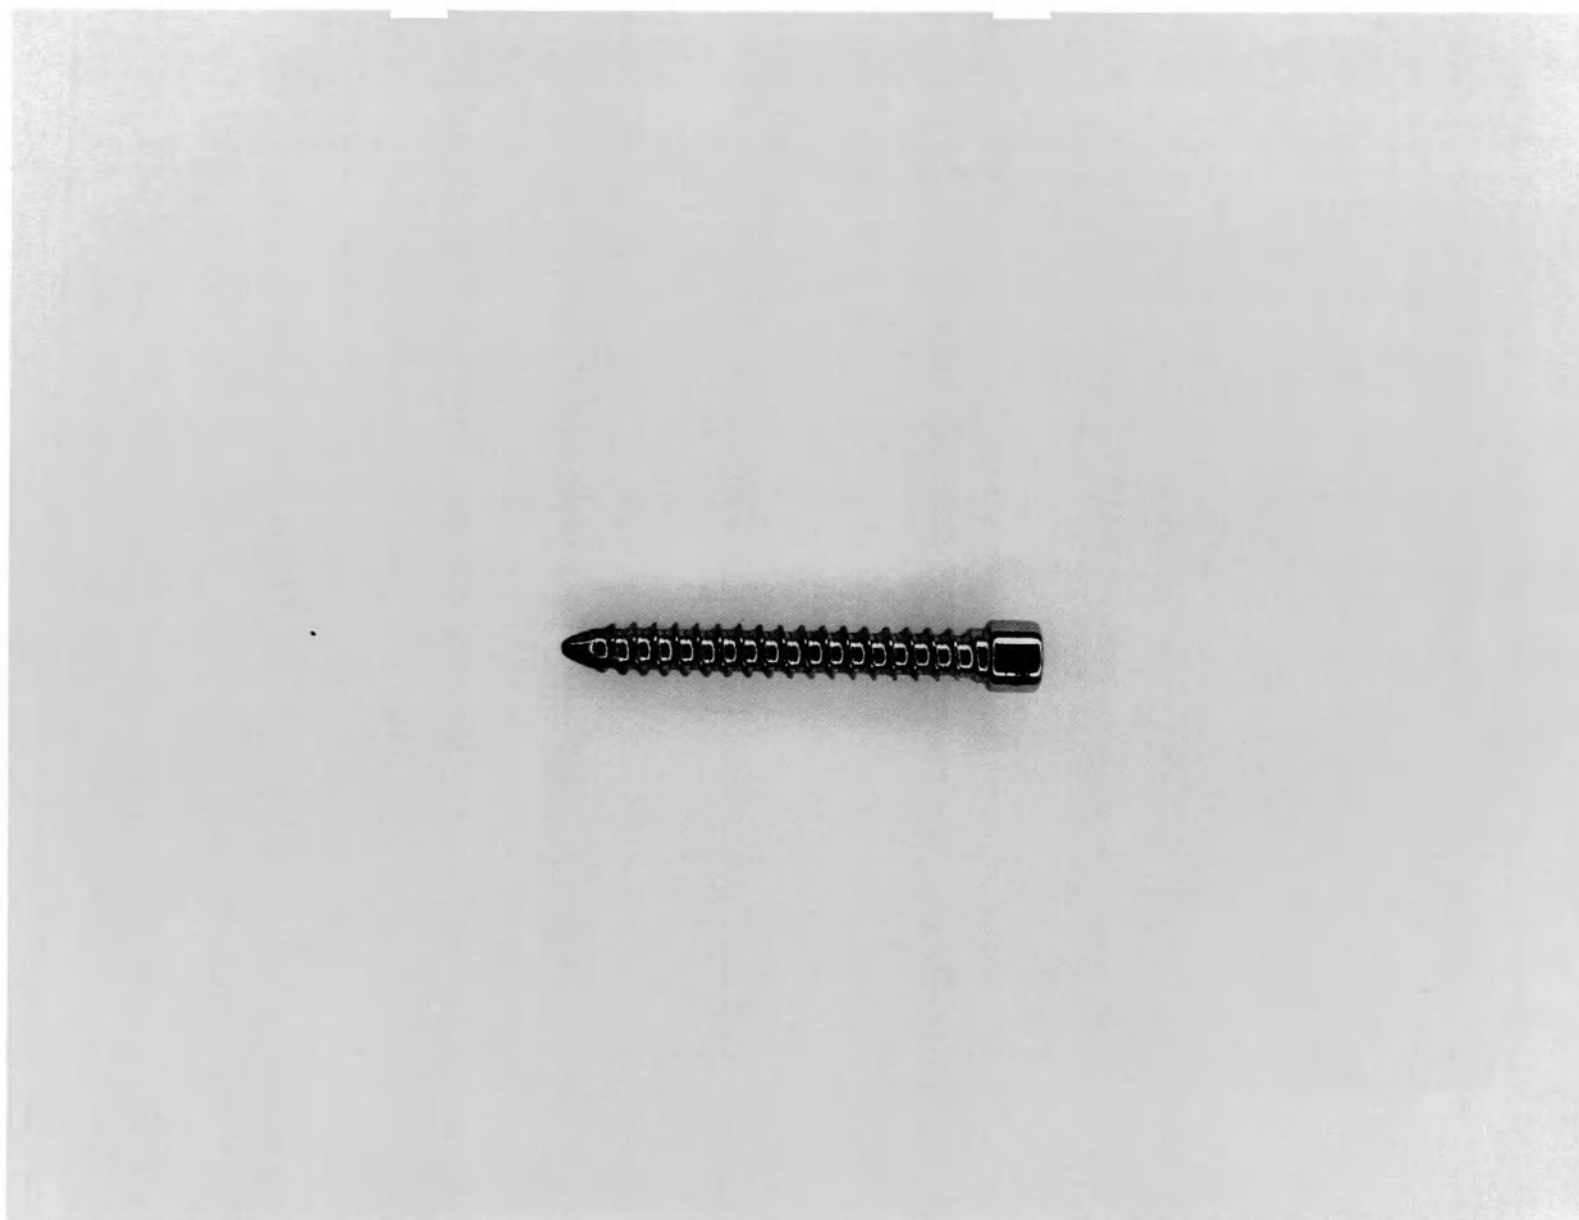


Фото 48. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт блокирующий дистальный

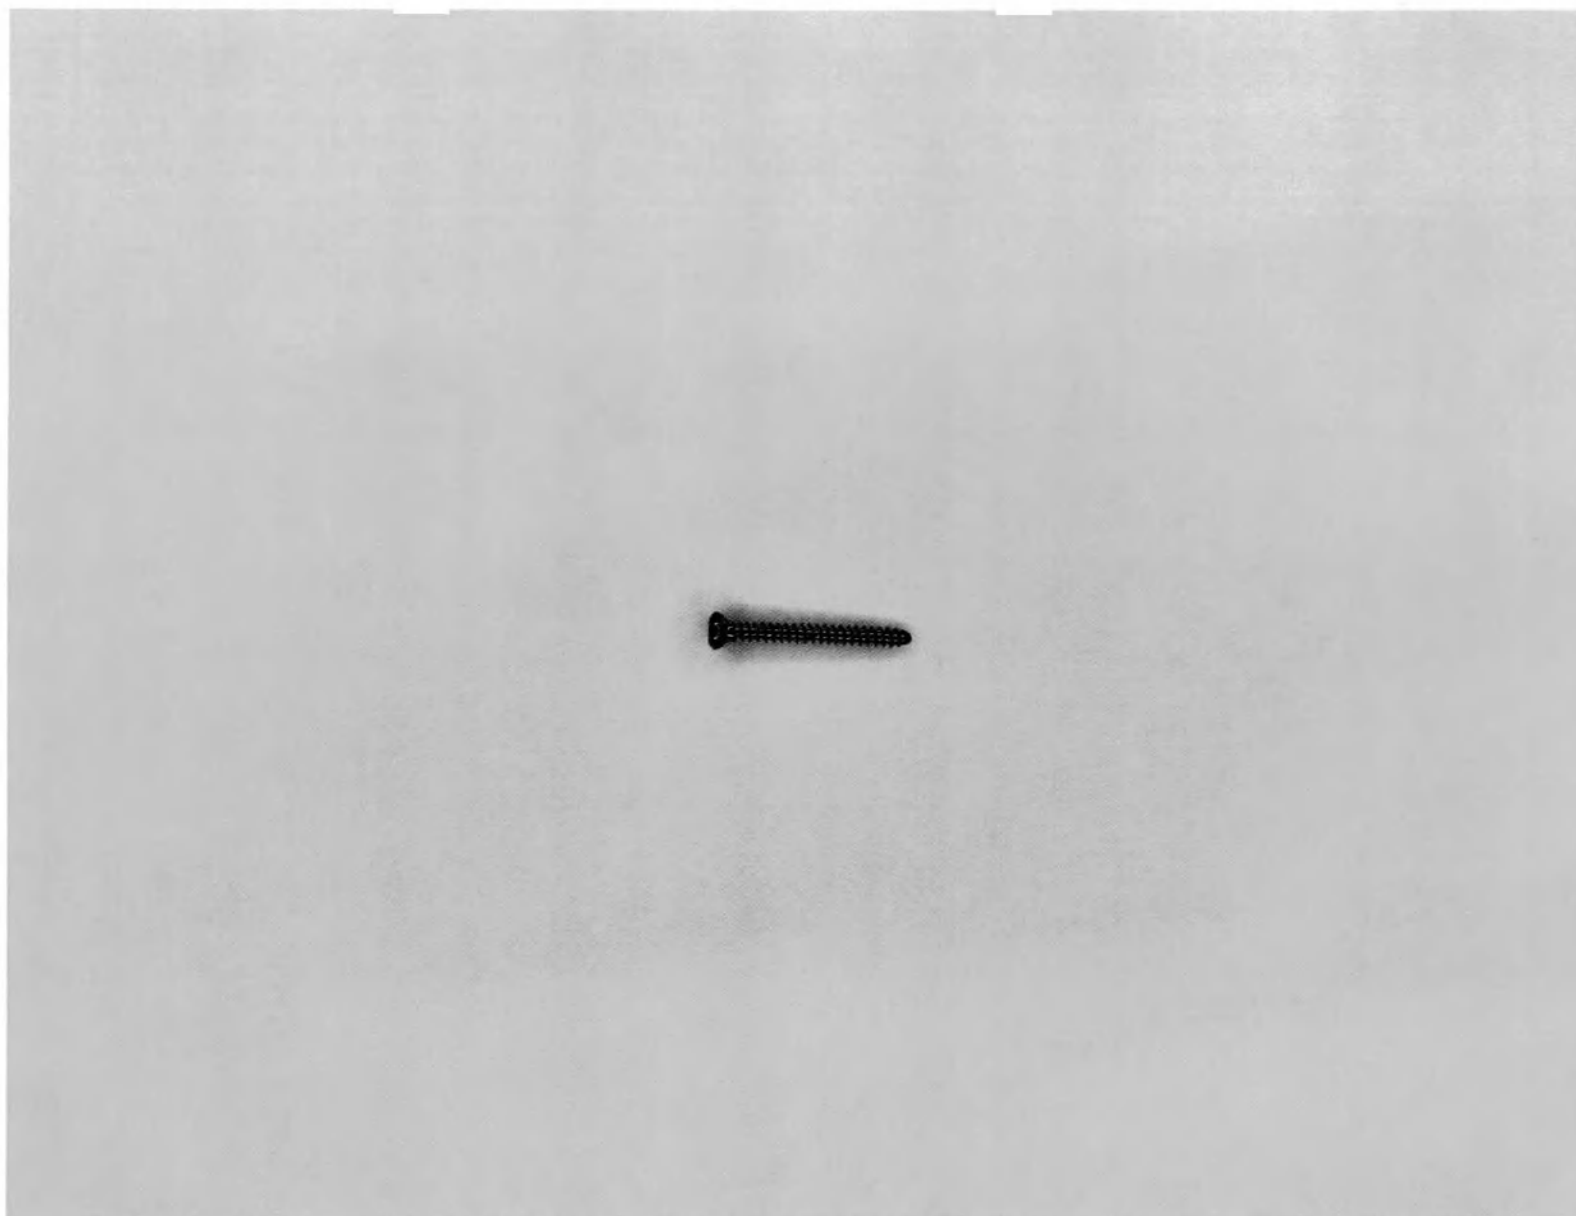


Фото 49. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт дистальный



Фото 50. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт шеечный клинковый



Фото 51. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт блокирующий проксимальный канюлированный модульный



Фото 52. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт блокирующий деротационный канюлированный модульный



Фото 53. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт шеечный канюлированный

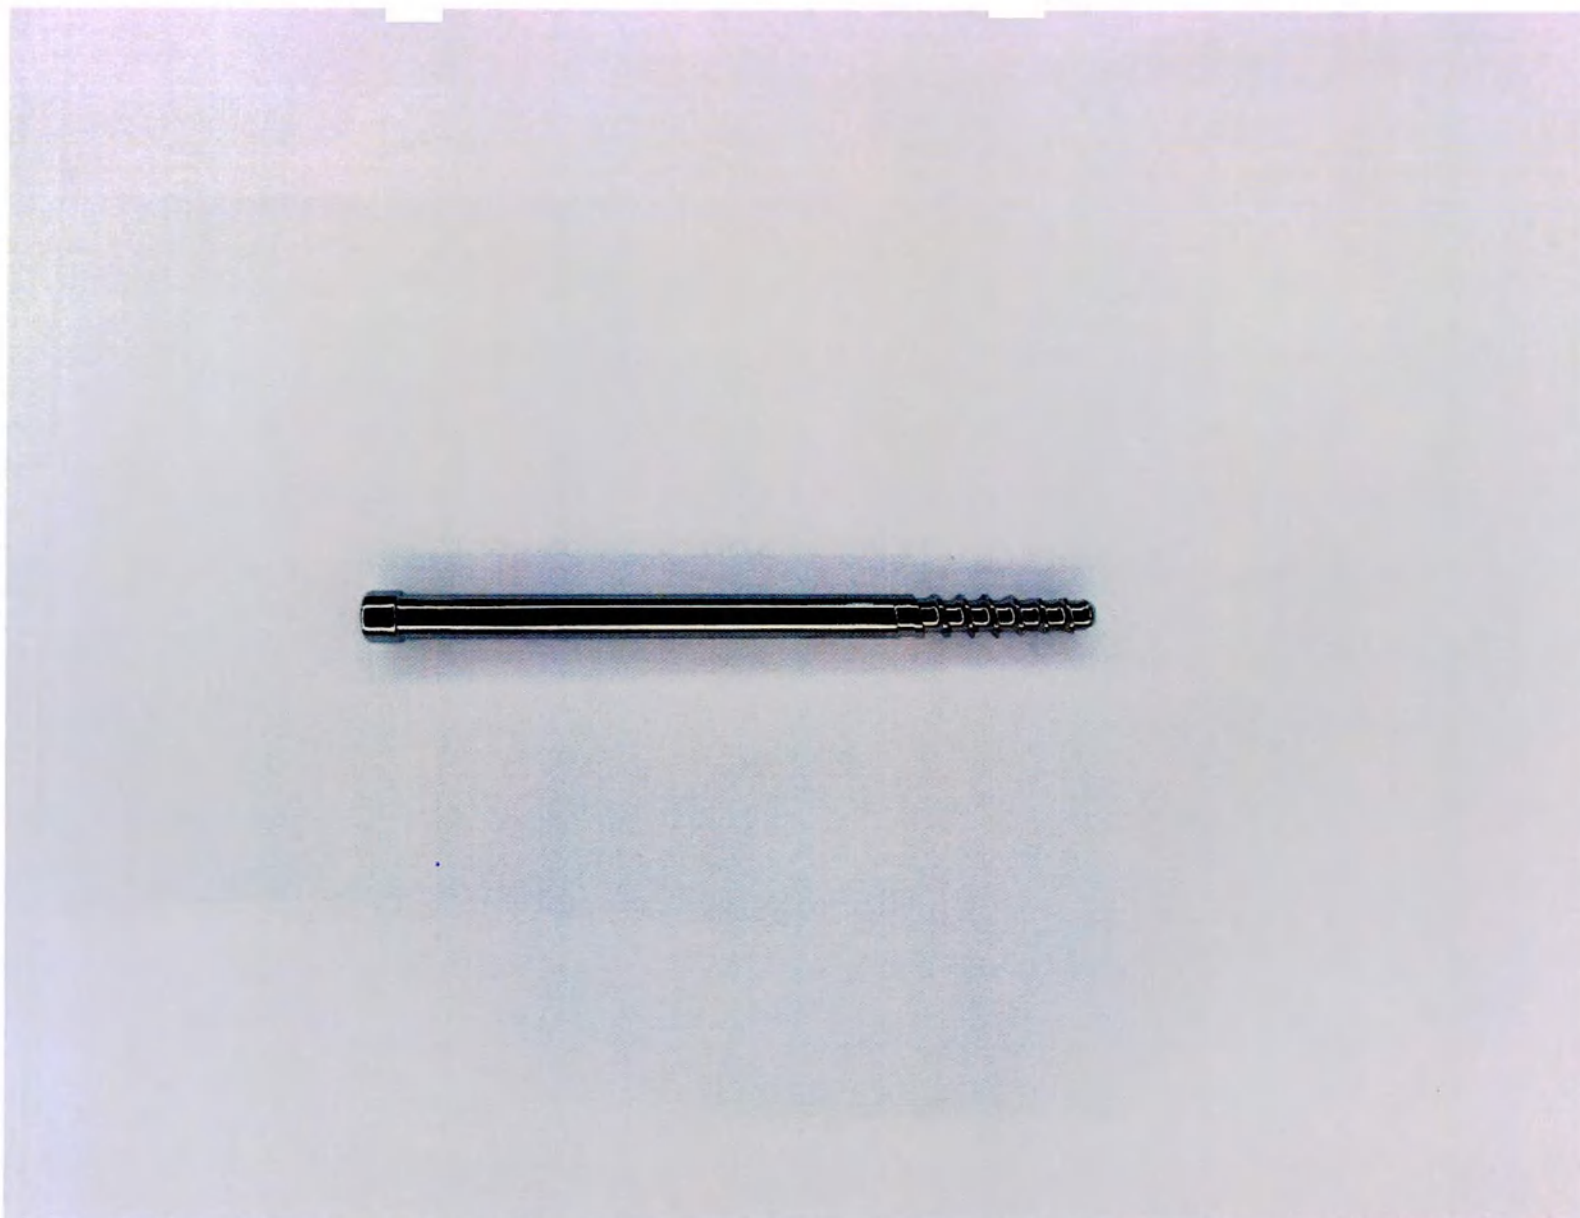


Фото 54. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт блокирующий деротационный

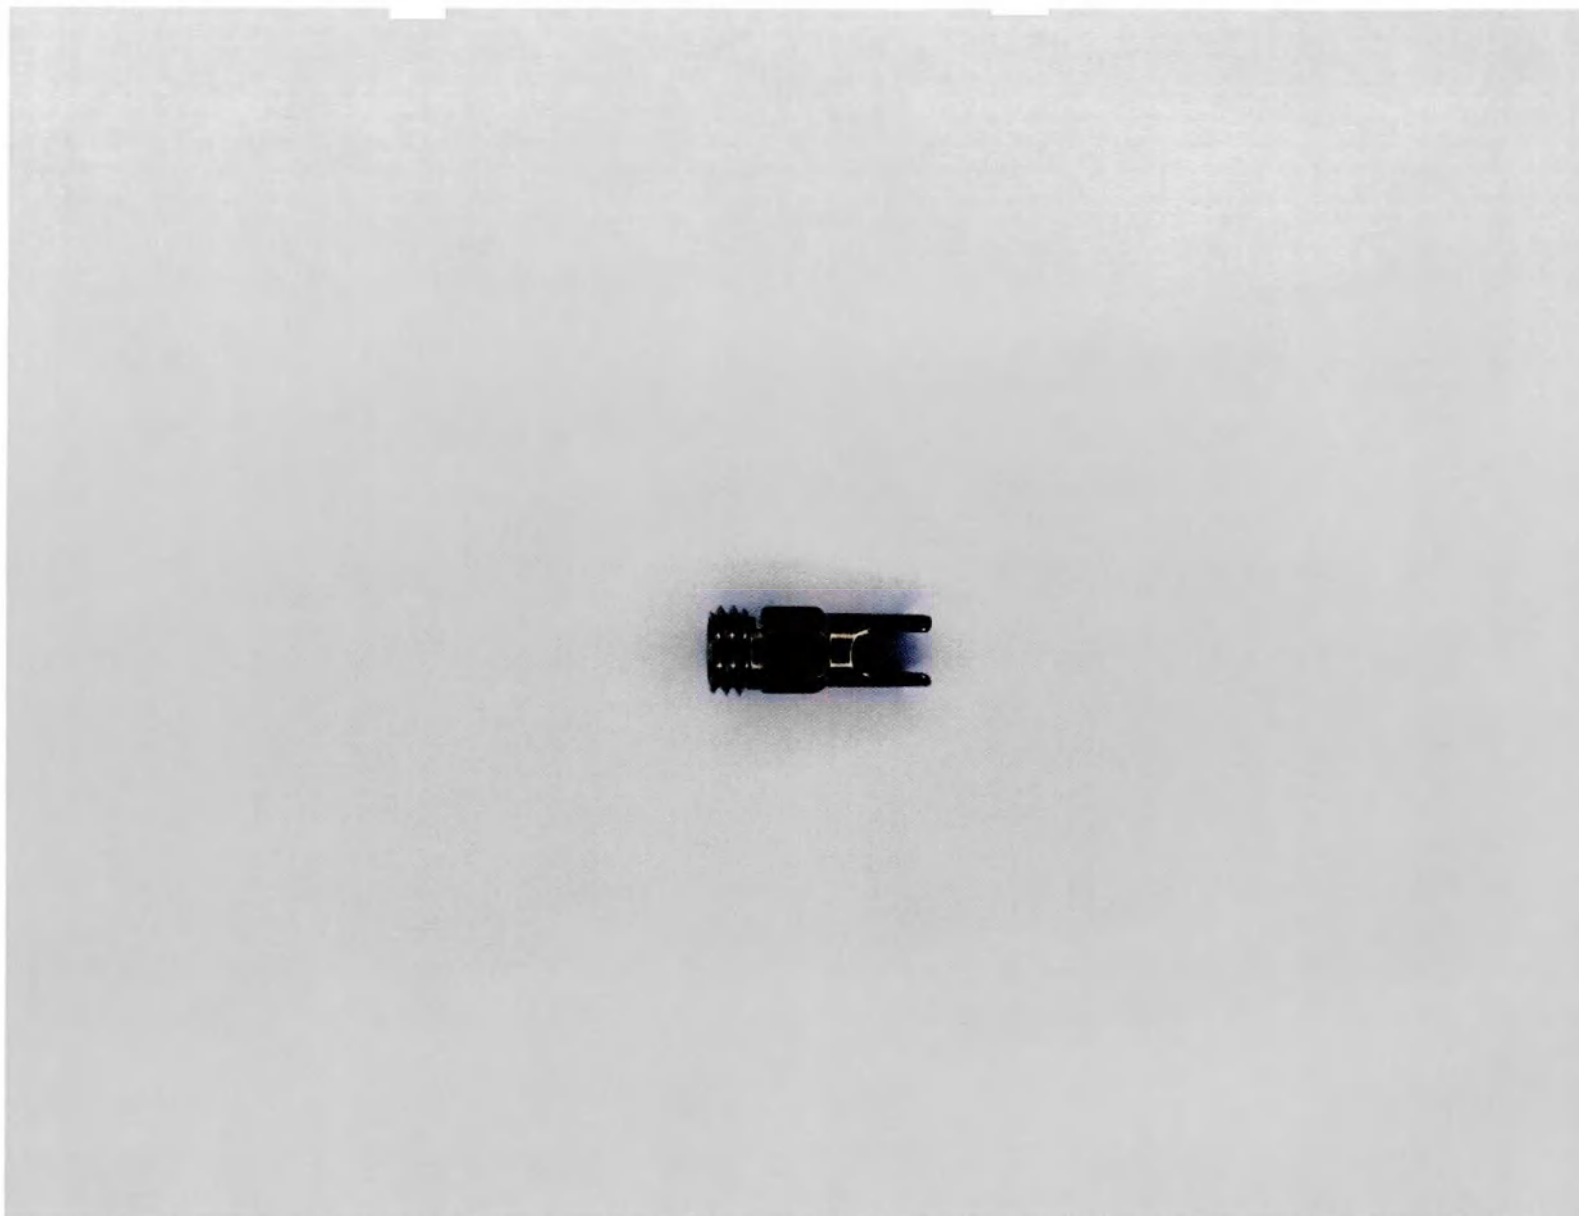


Фото 55. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт компрессионный стержневой

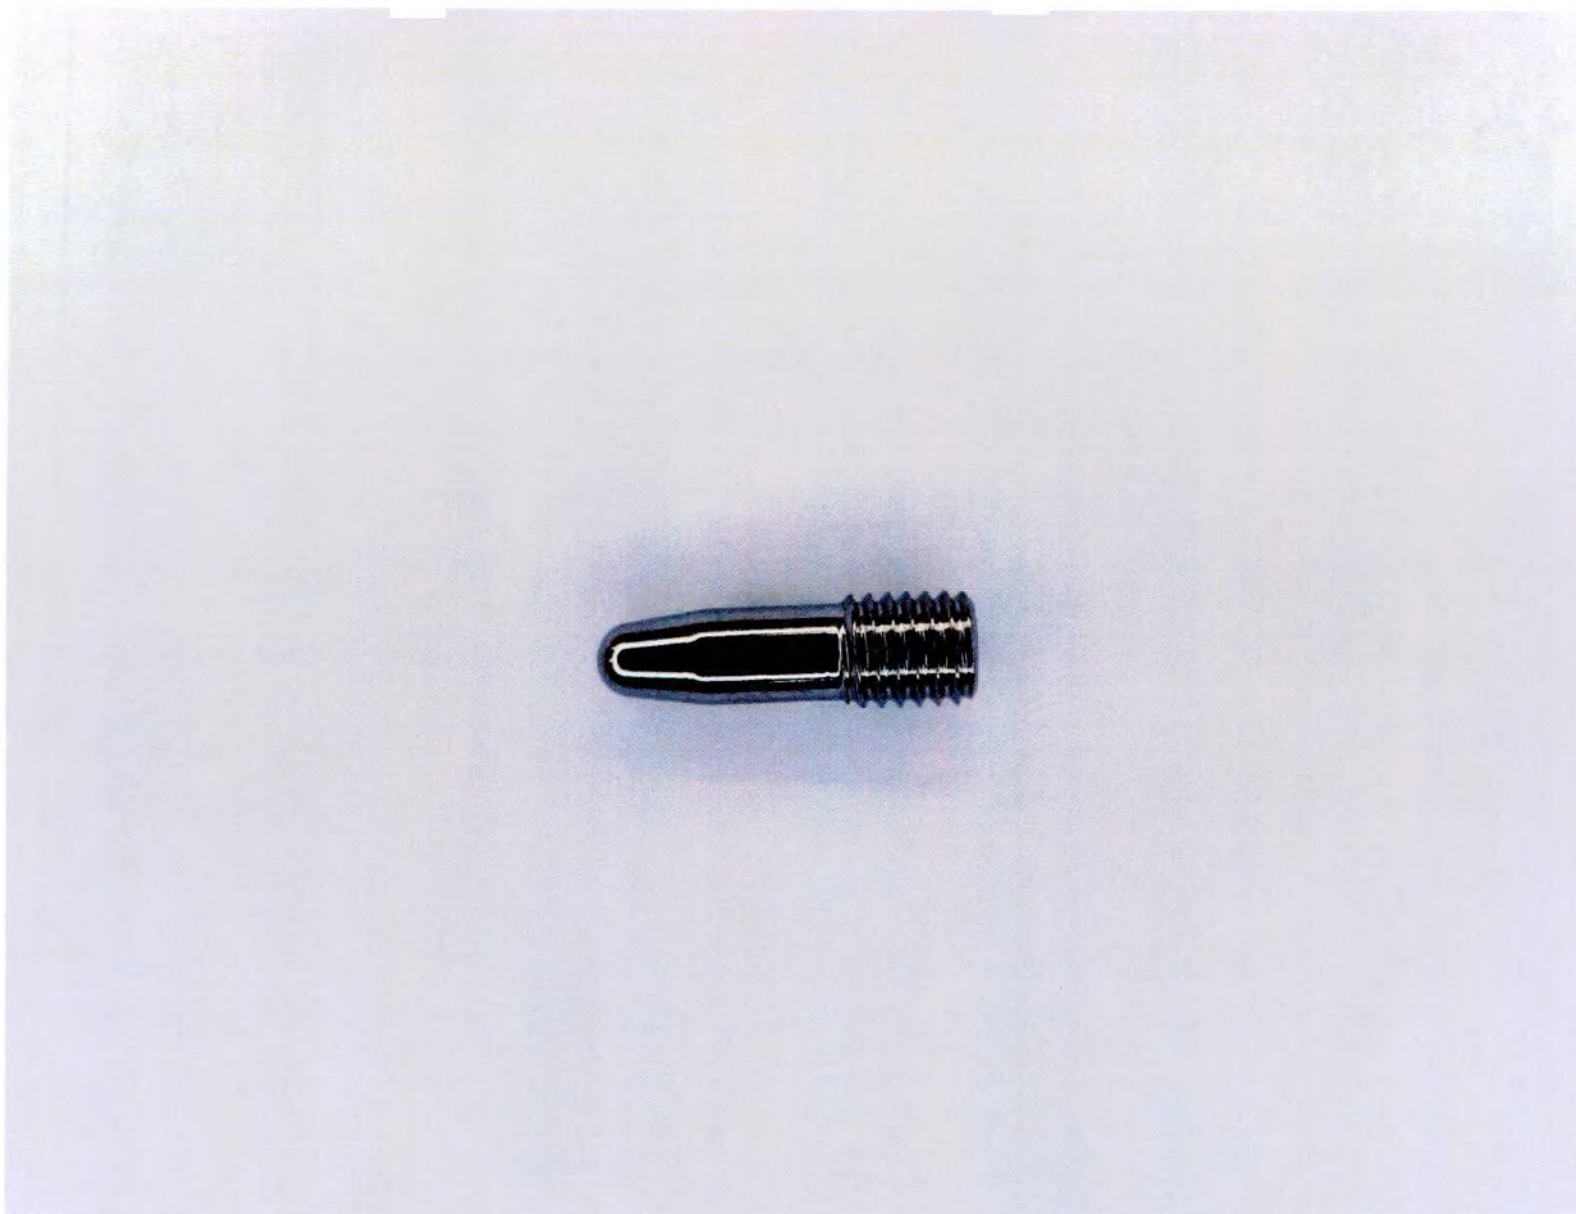


Фото 56. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт компрессионный стопорный

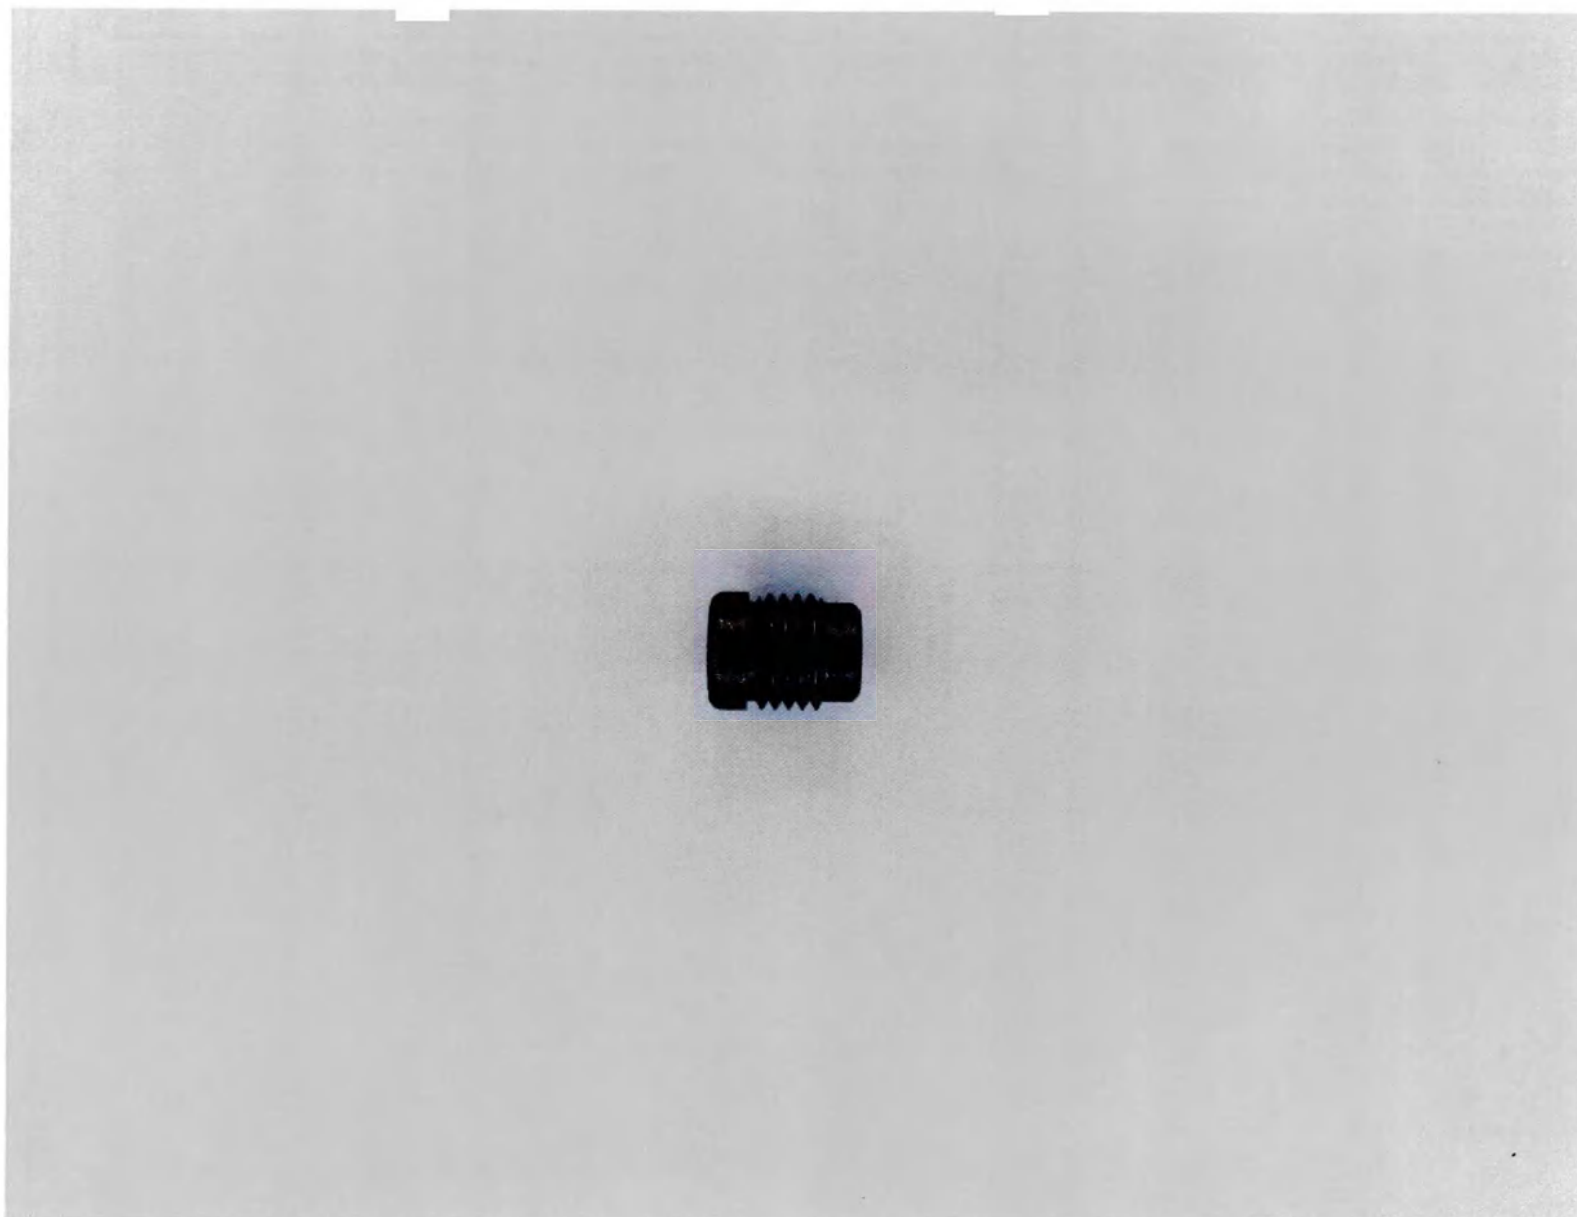


Фото 57. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт стопорный модульный

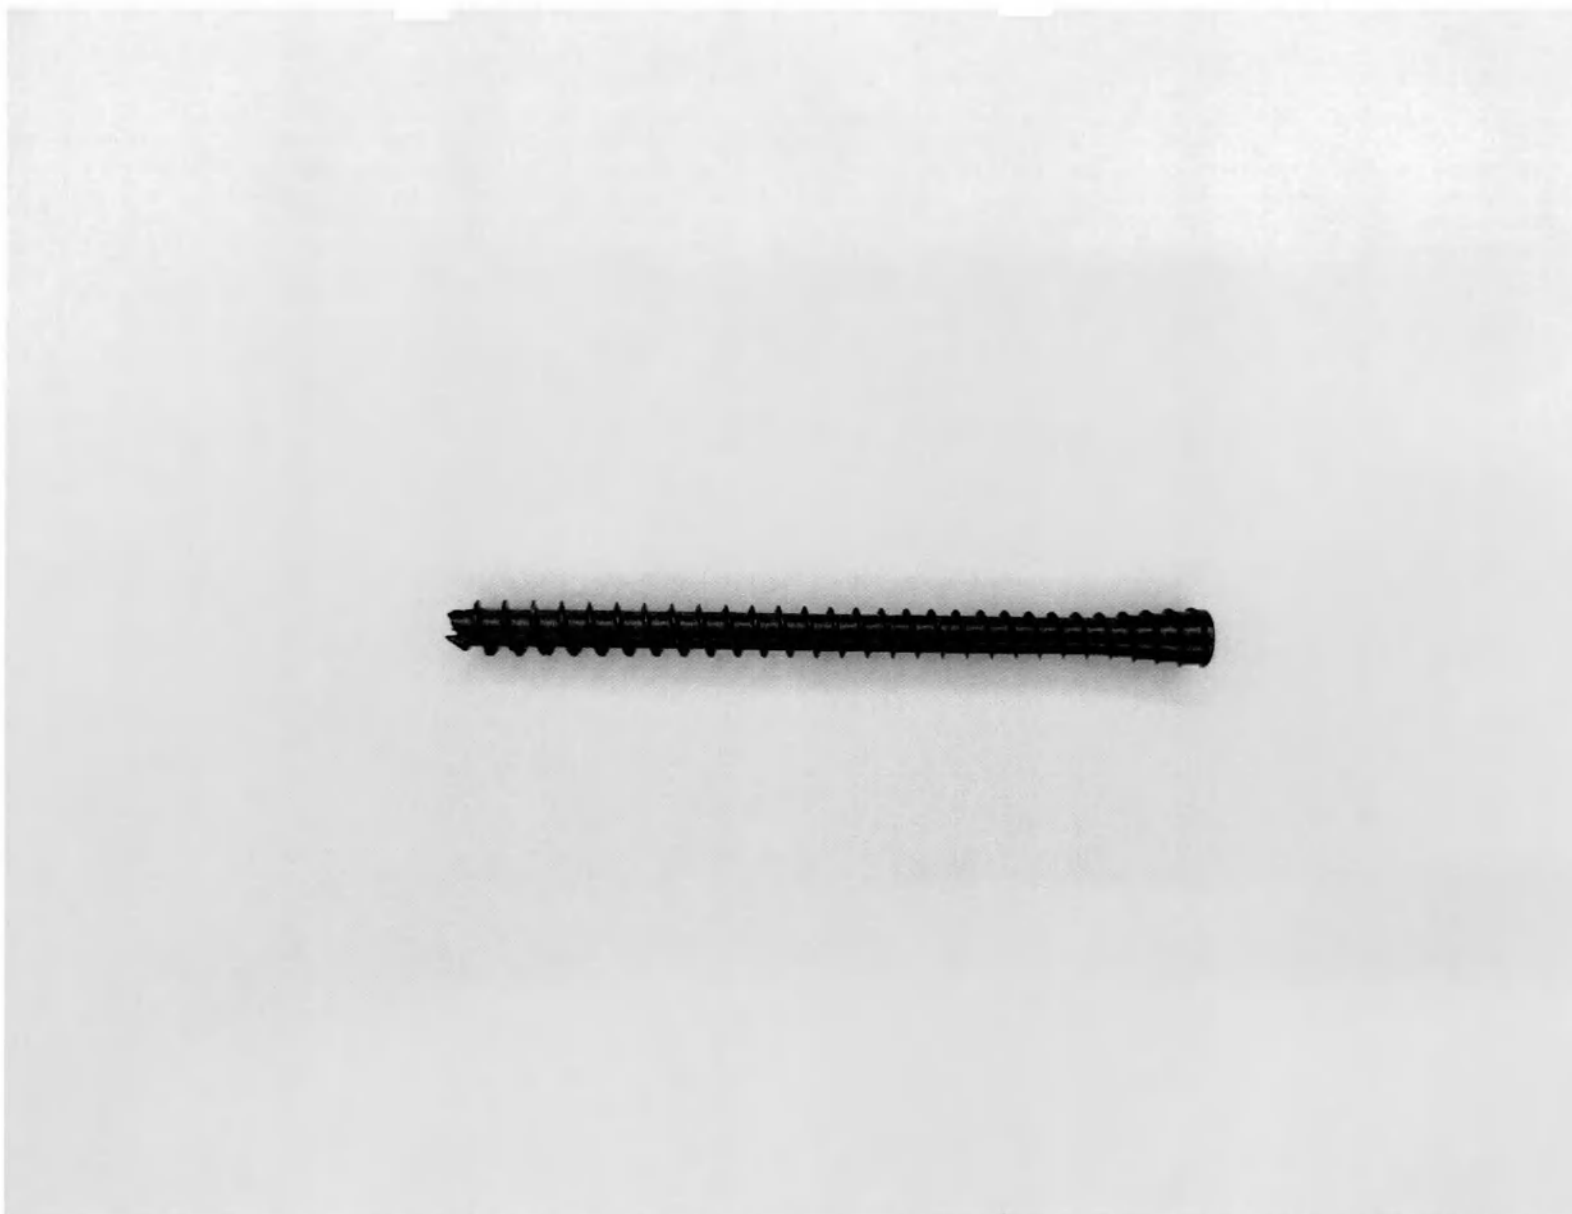


Фото 58. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт канюлированный компрессирующий безголовчатый

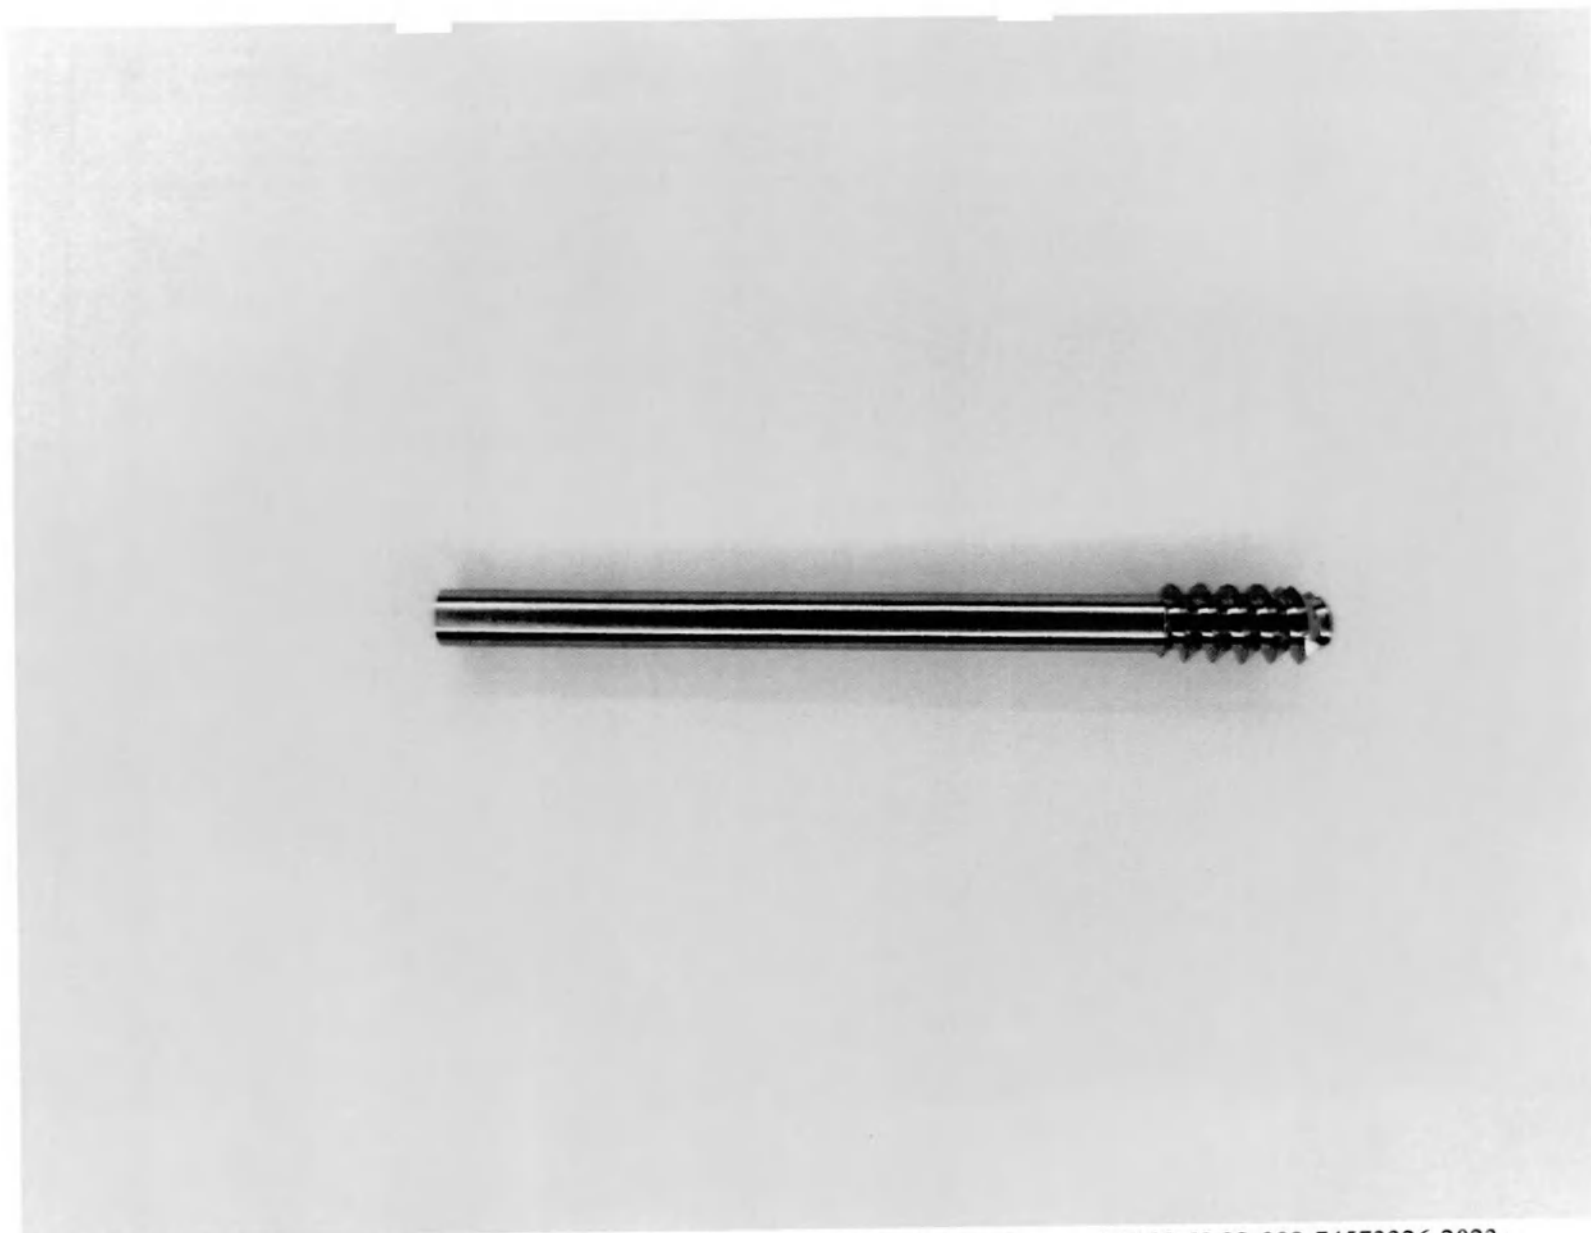


Фото 59. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт канюлированный бесшляпочный



Фото 60. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт блокируемый

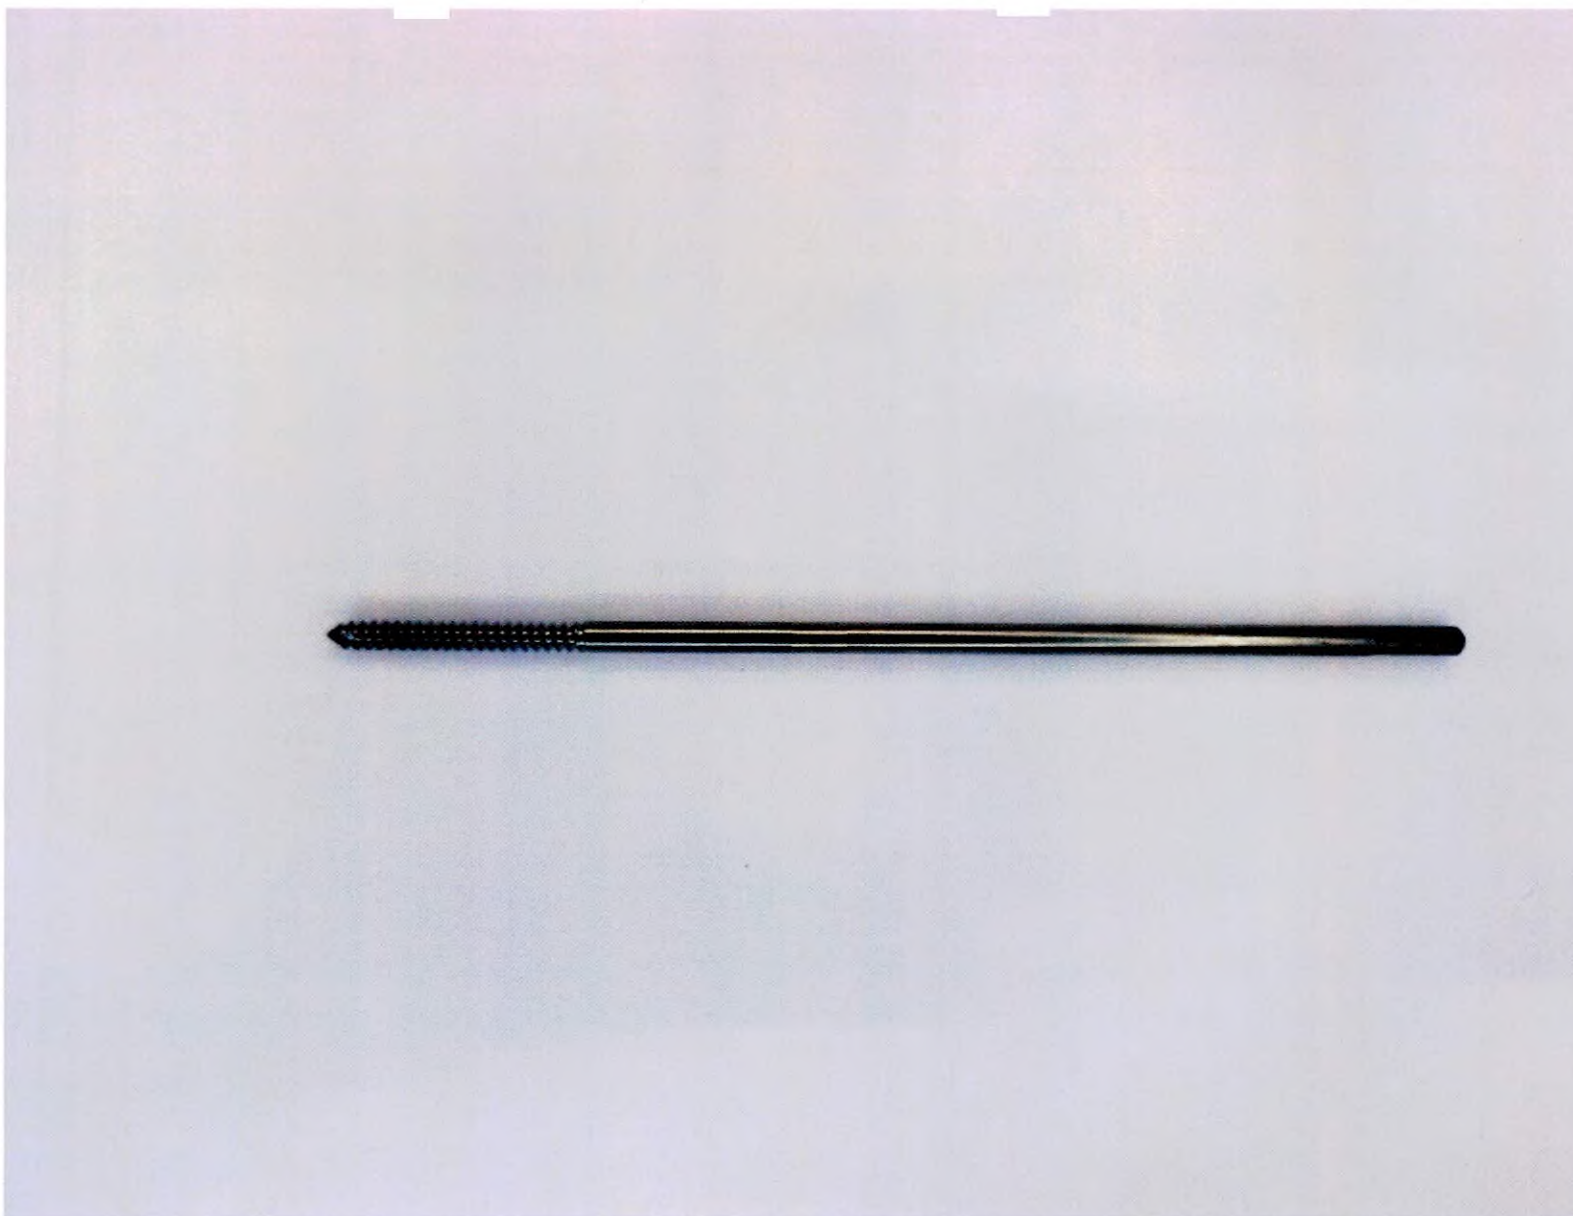


Фото 61. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт Шанца

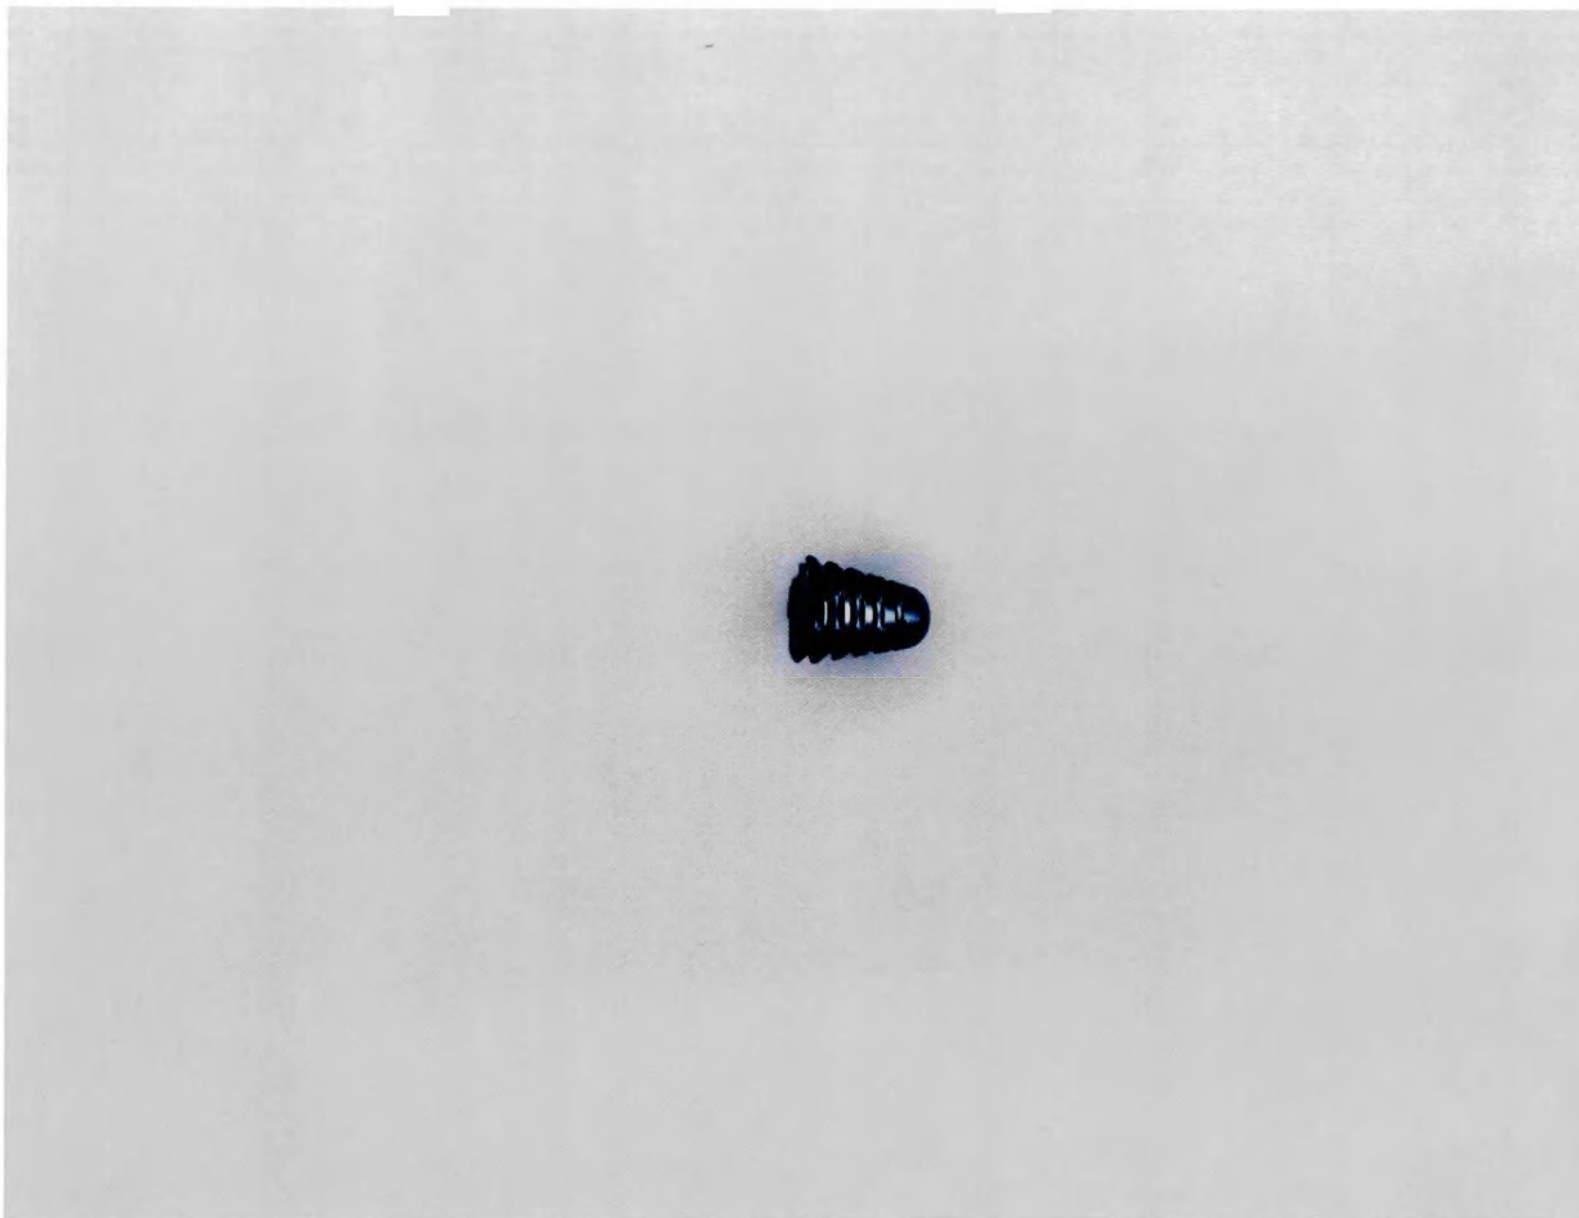


Фото 62. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт для подтаранного артродеза

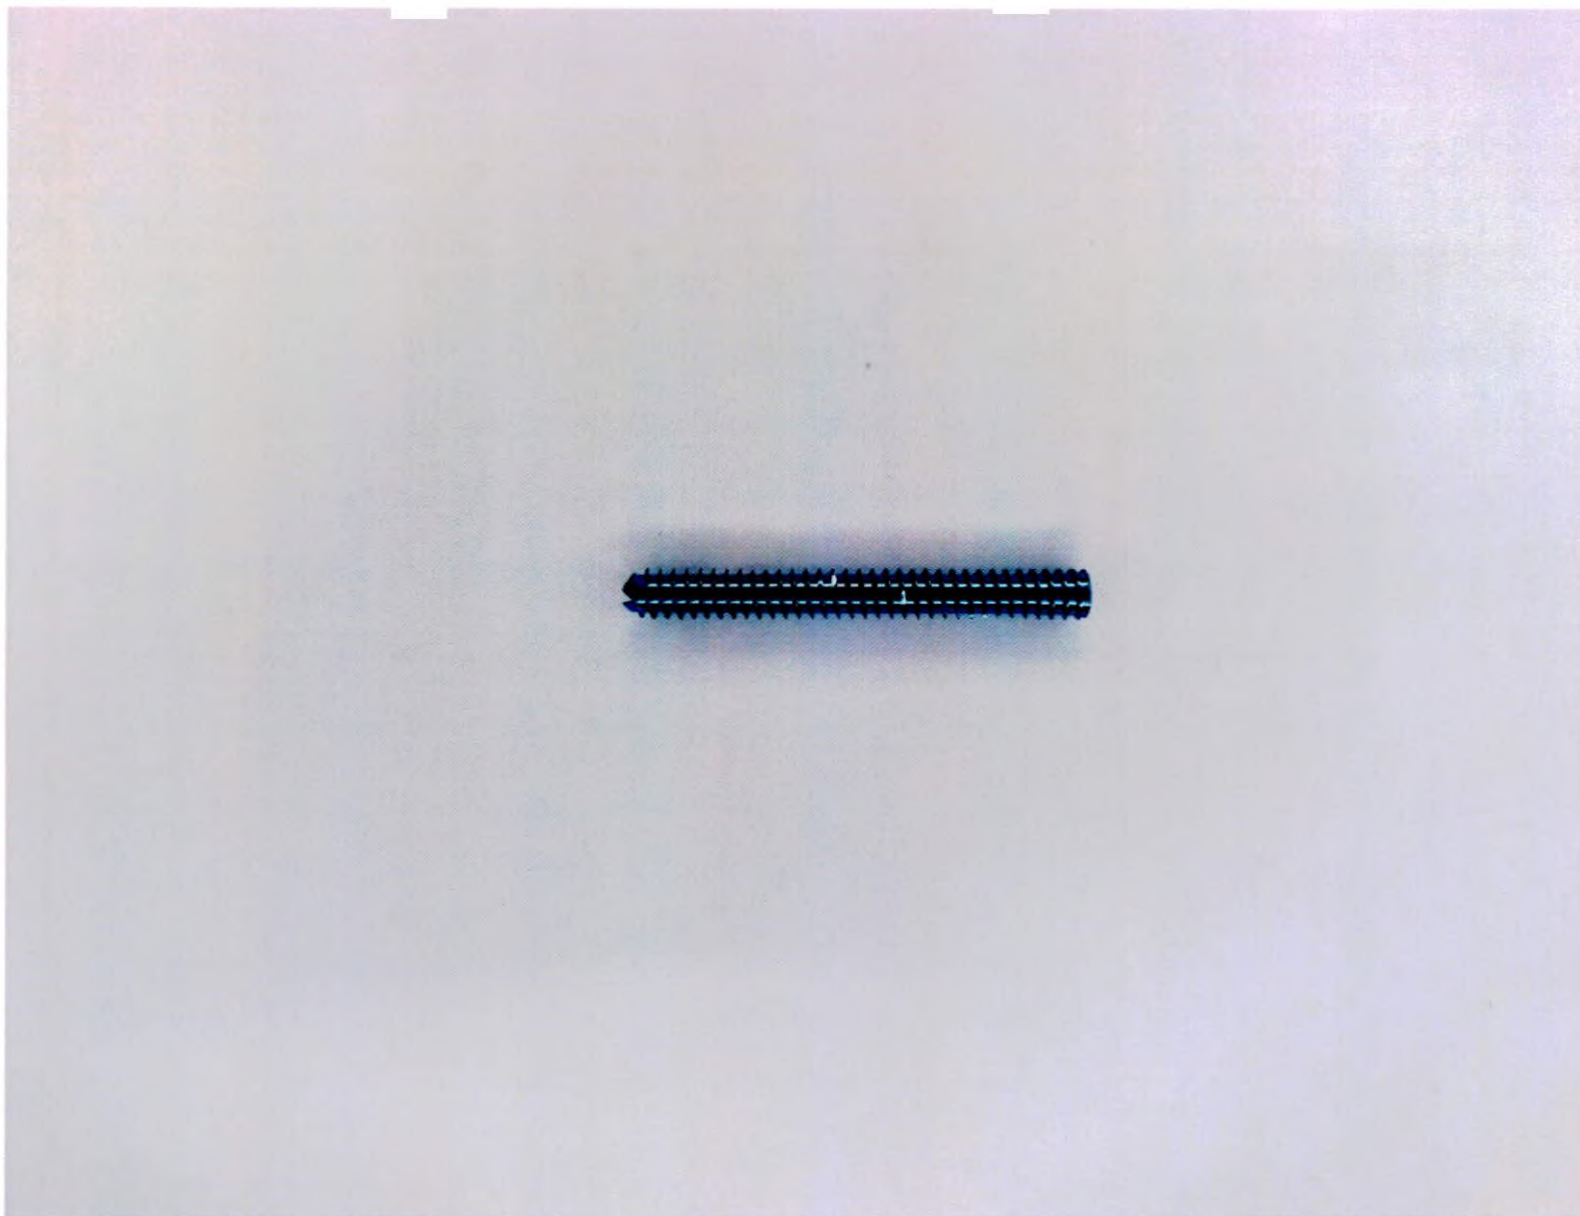


Фото 63. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт трансферный

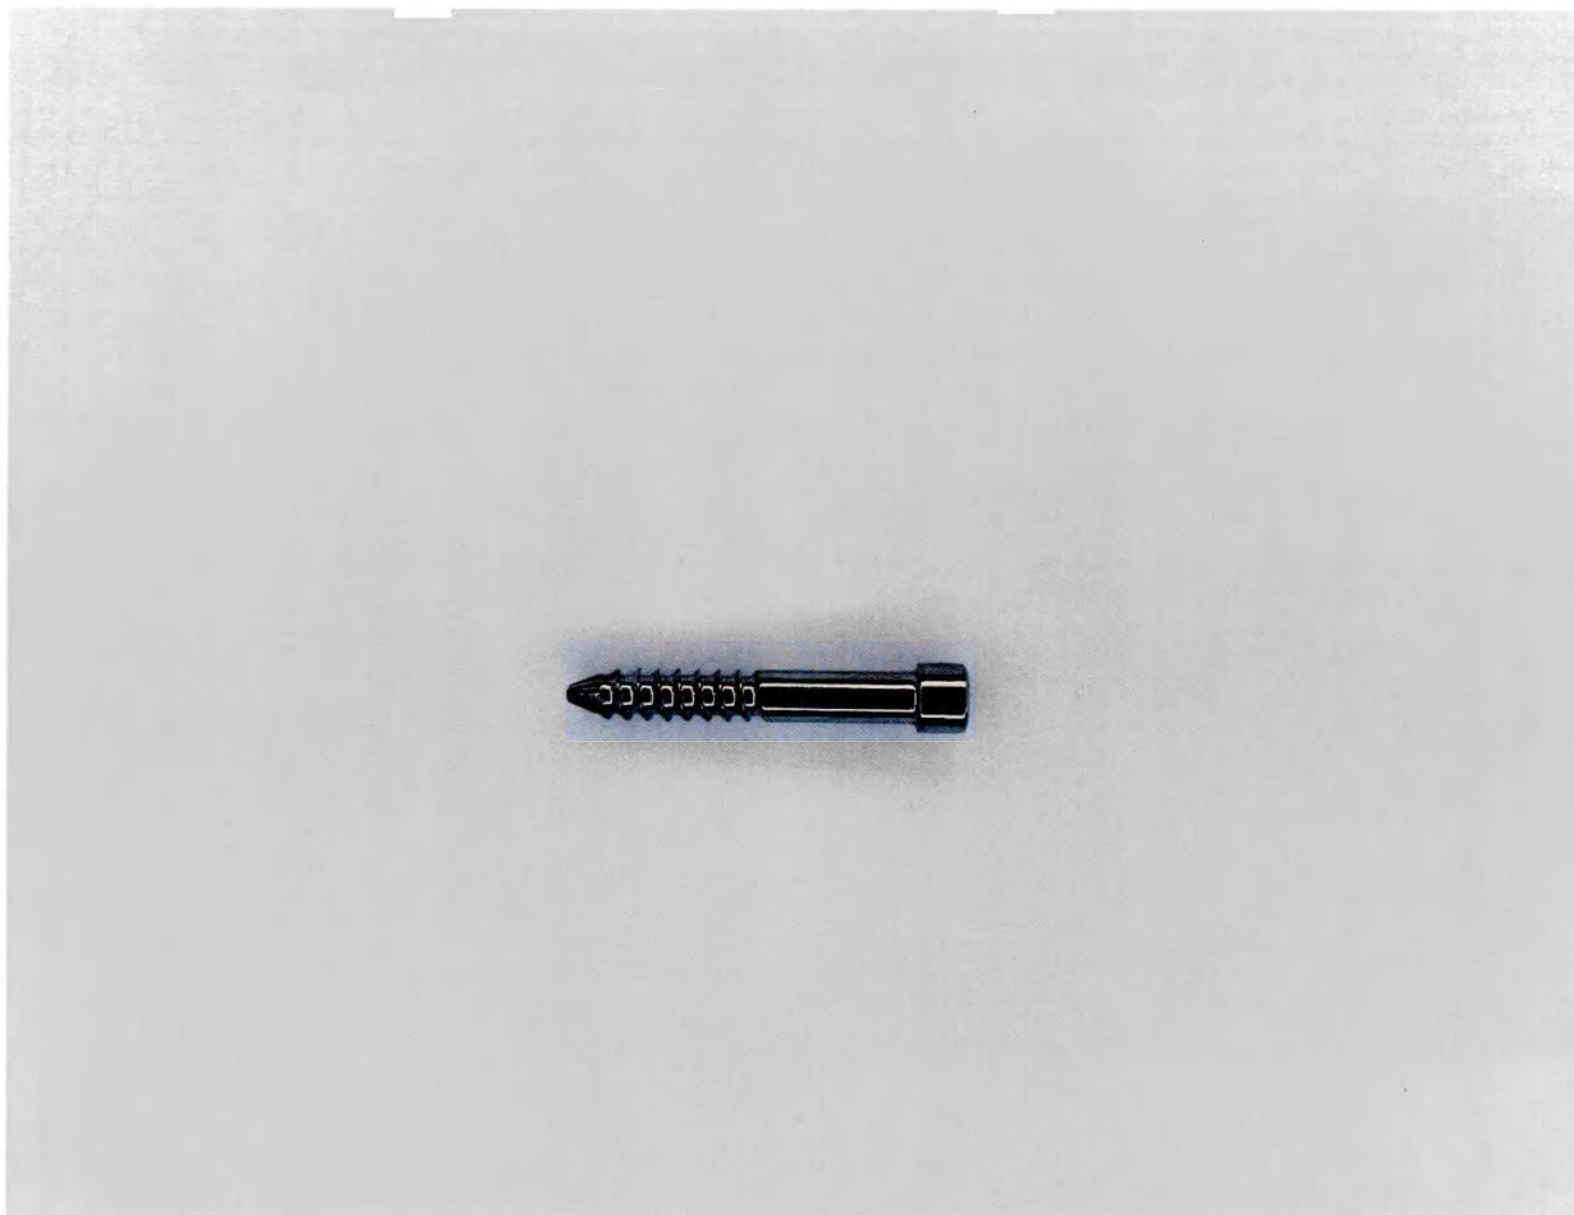


Фото 64. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Винт блокирующий проксимальный

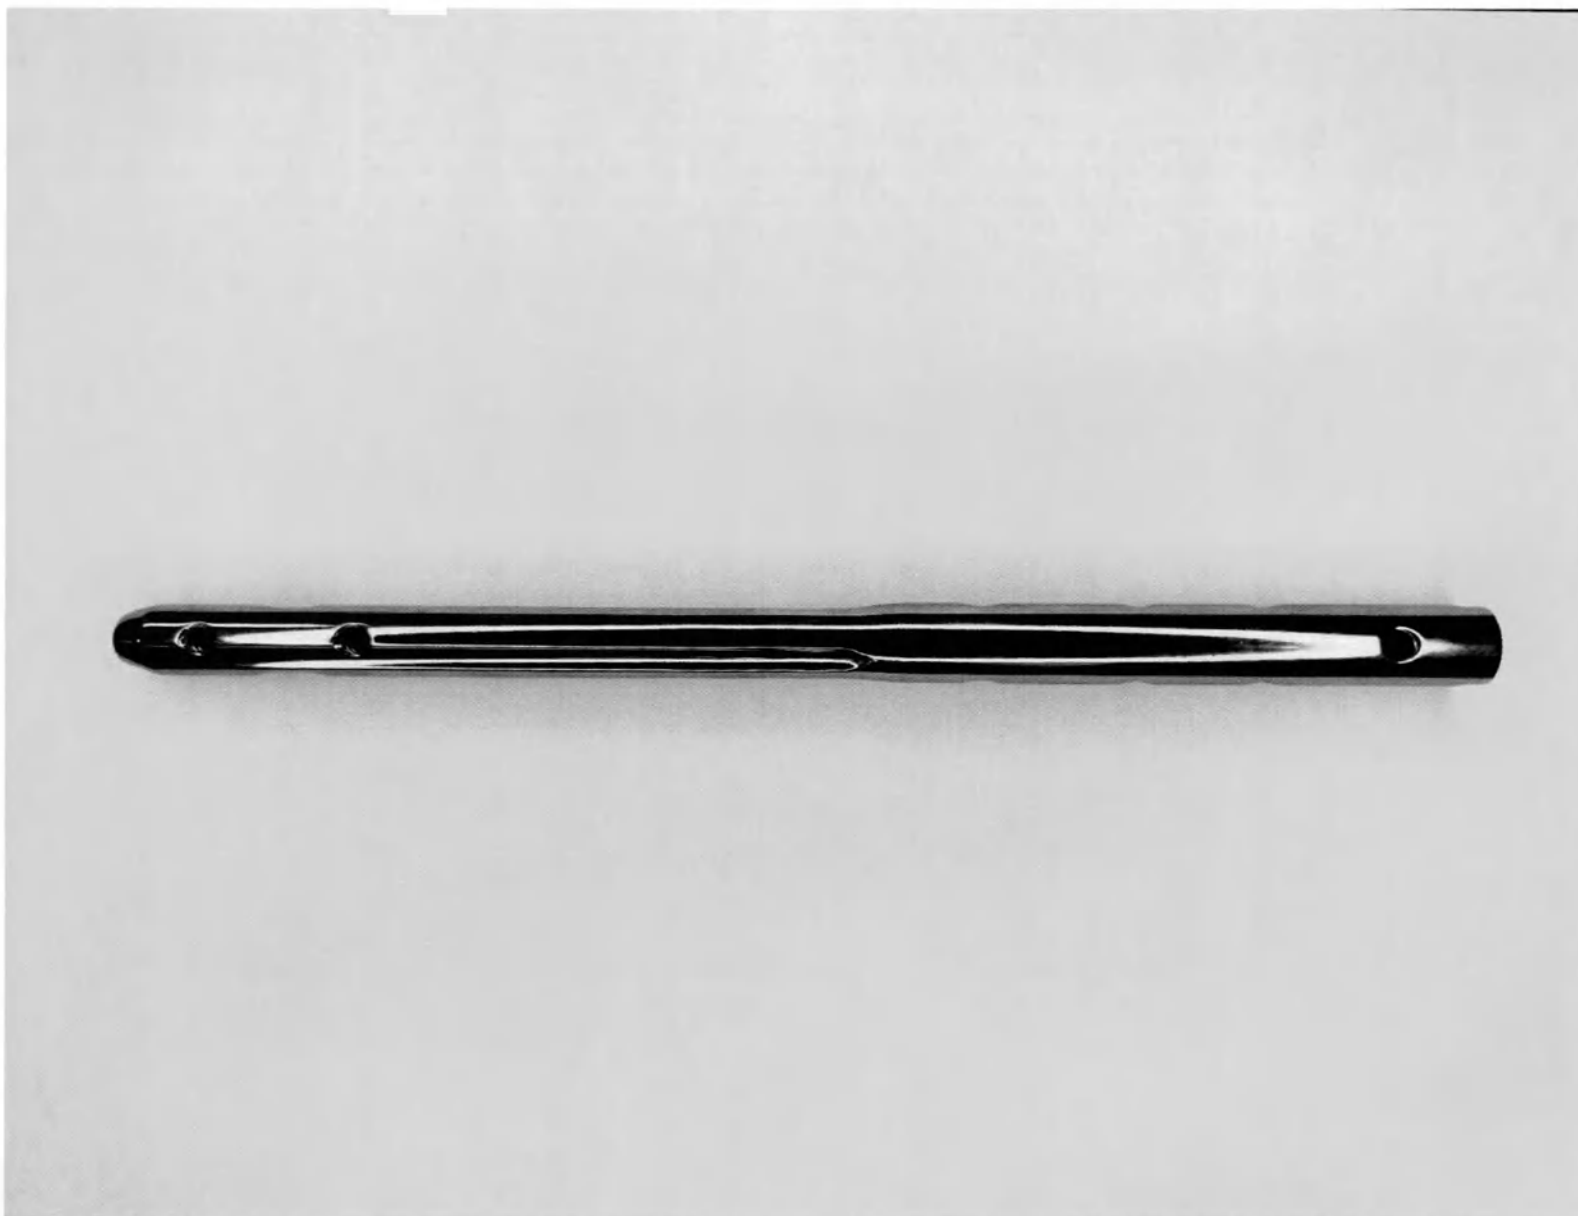


Фото 65. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Стержень ретроградный для большеберцовой кости



Фото 66. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Стержень телескопический

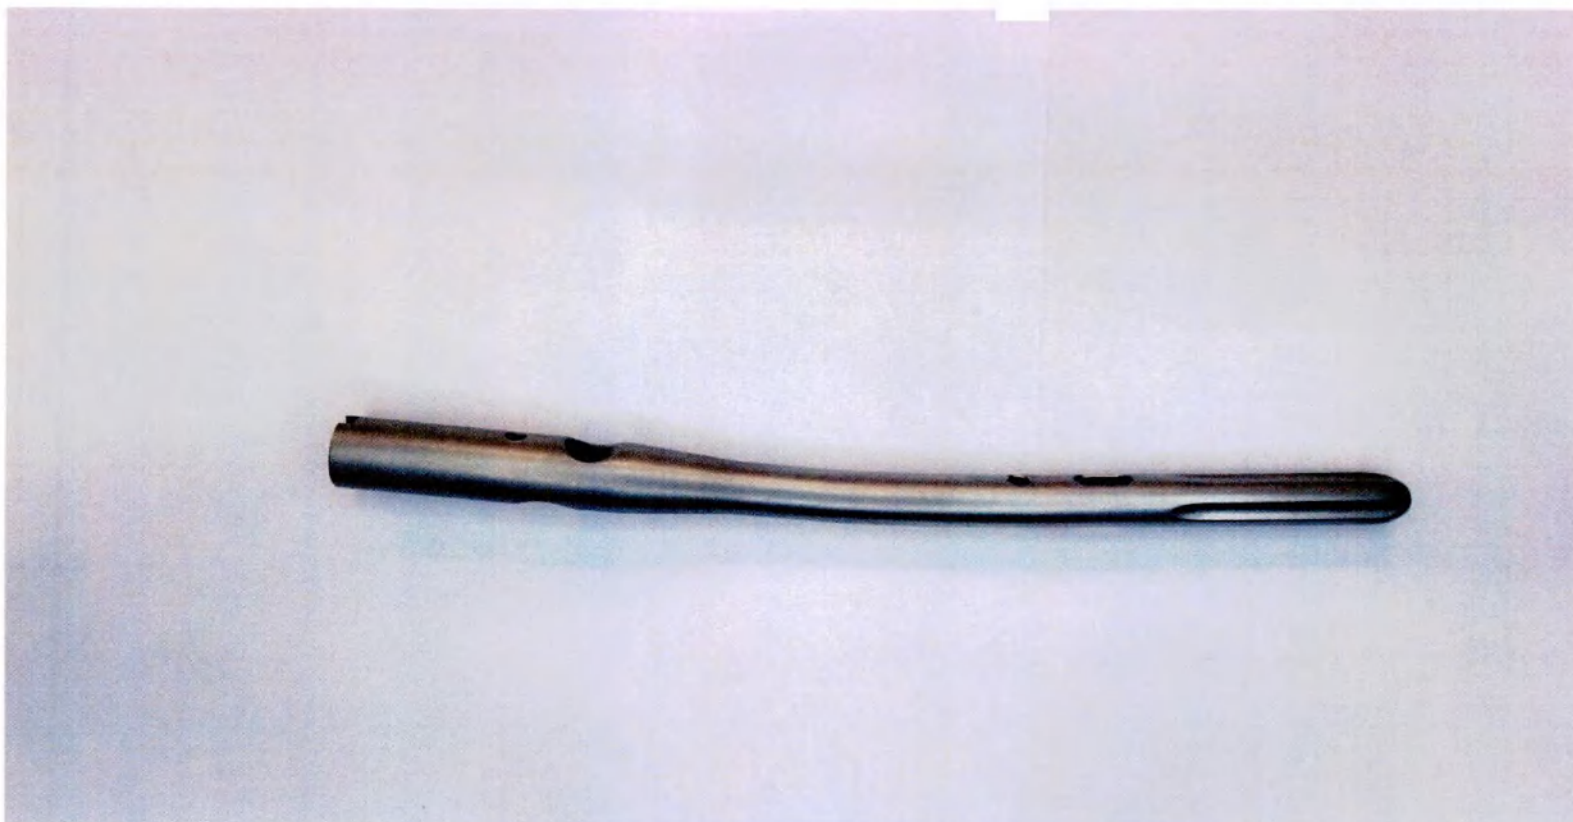


Фото 67. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Стержень гамма клинковый

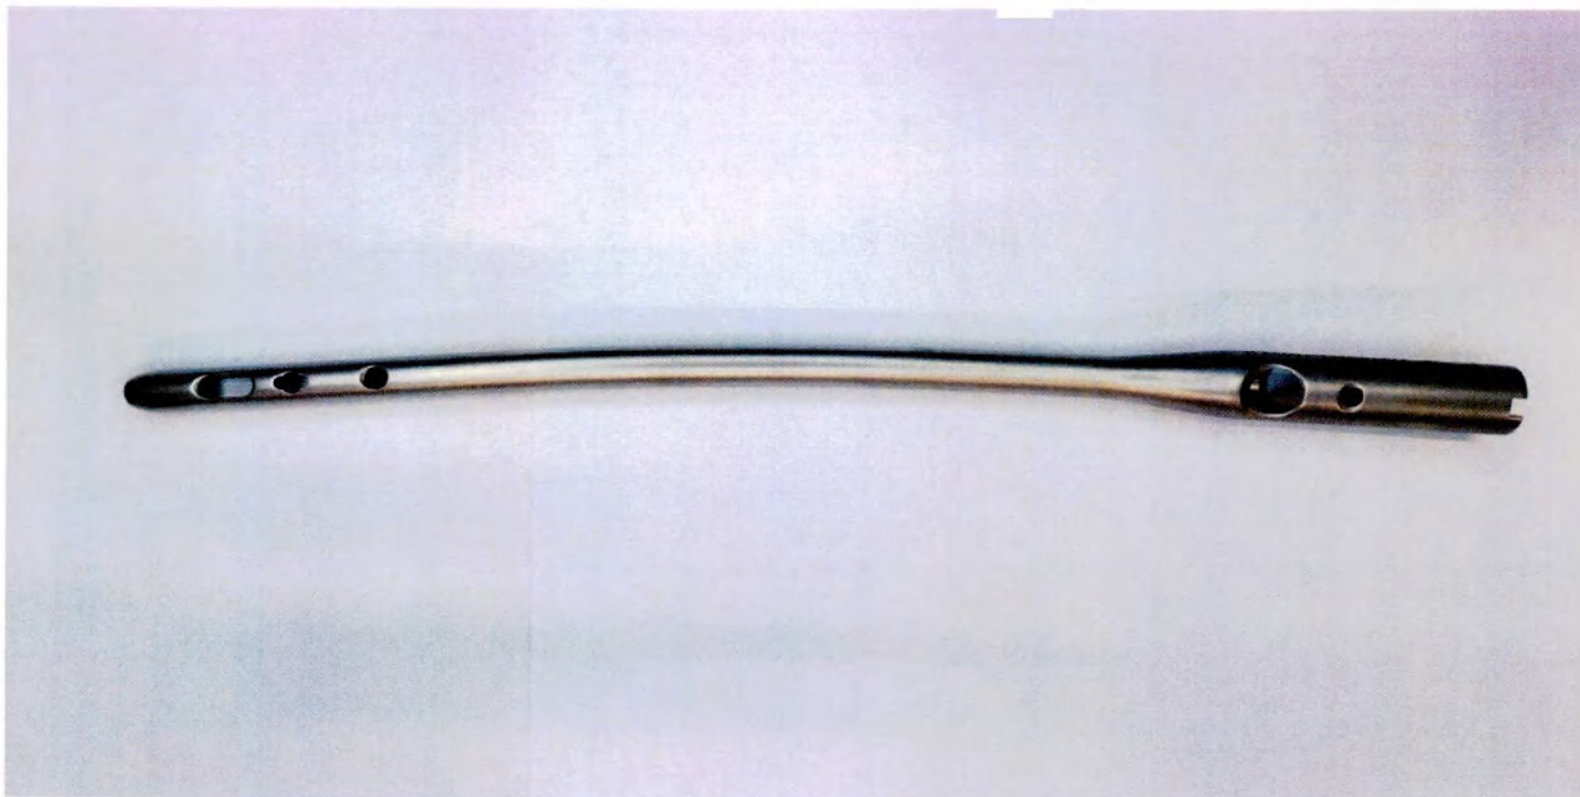


Фото 68. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Стержень гамма клинковый длинный

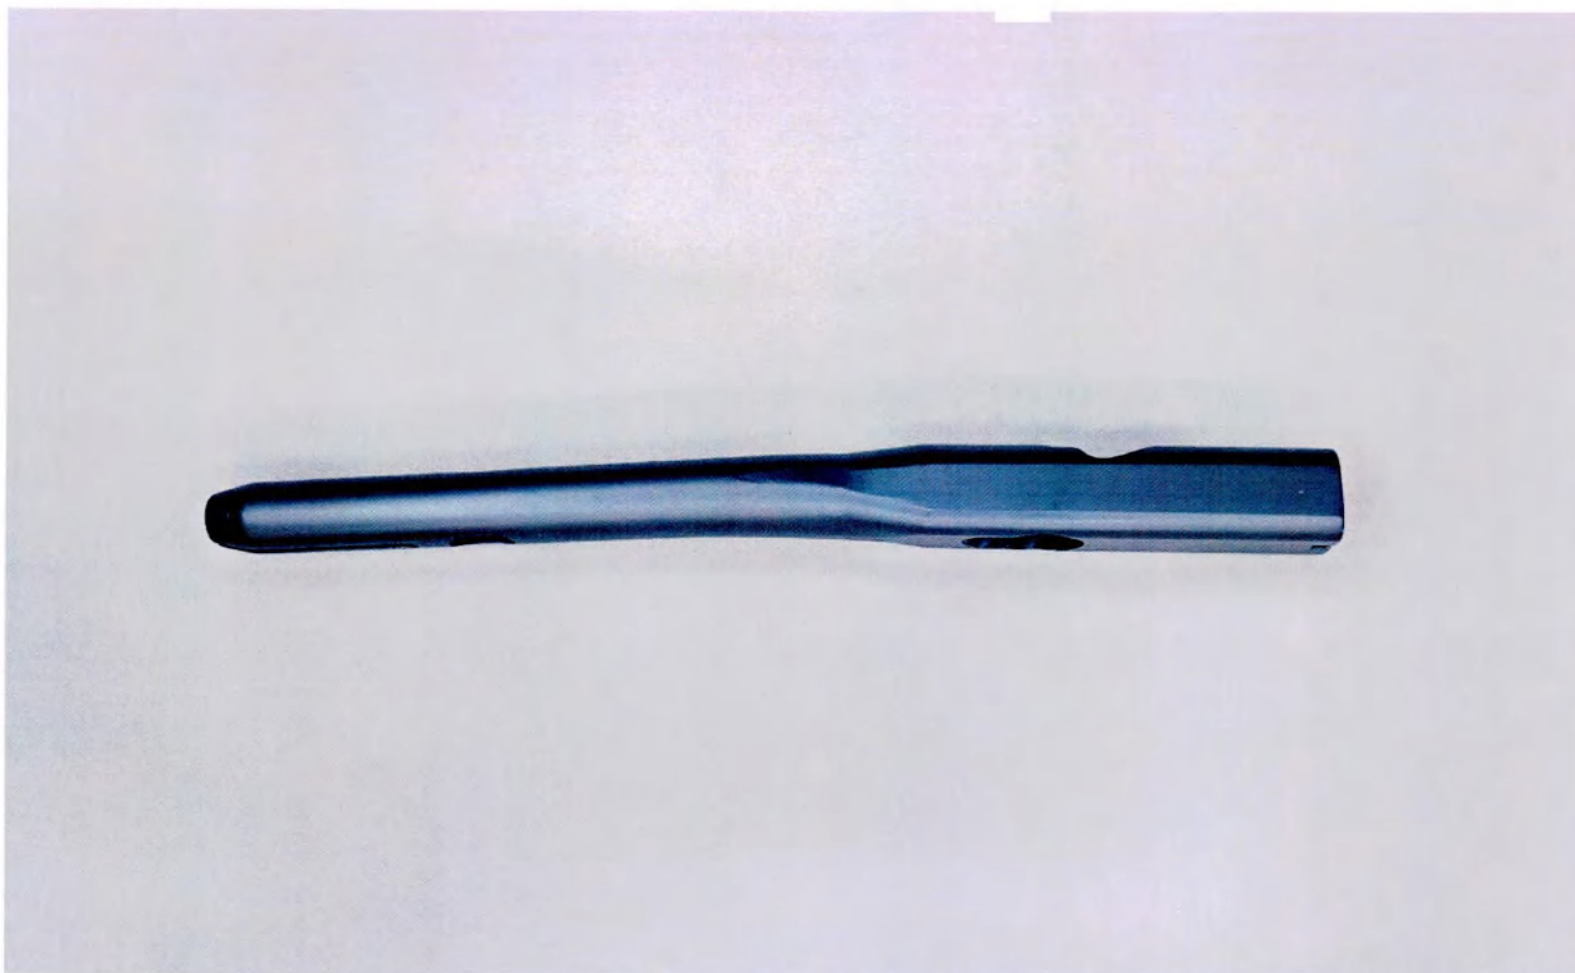


Фото 69. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Стержень гамма модульный

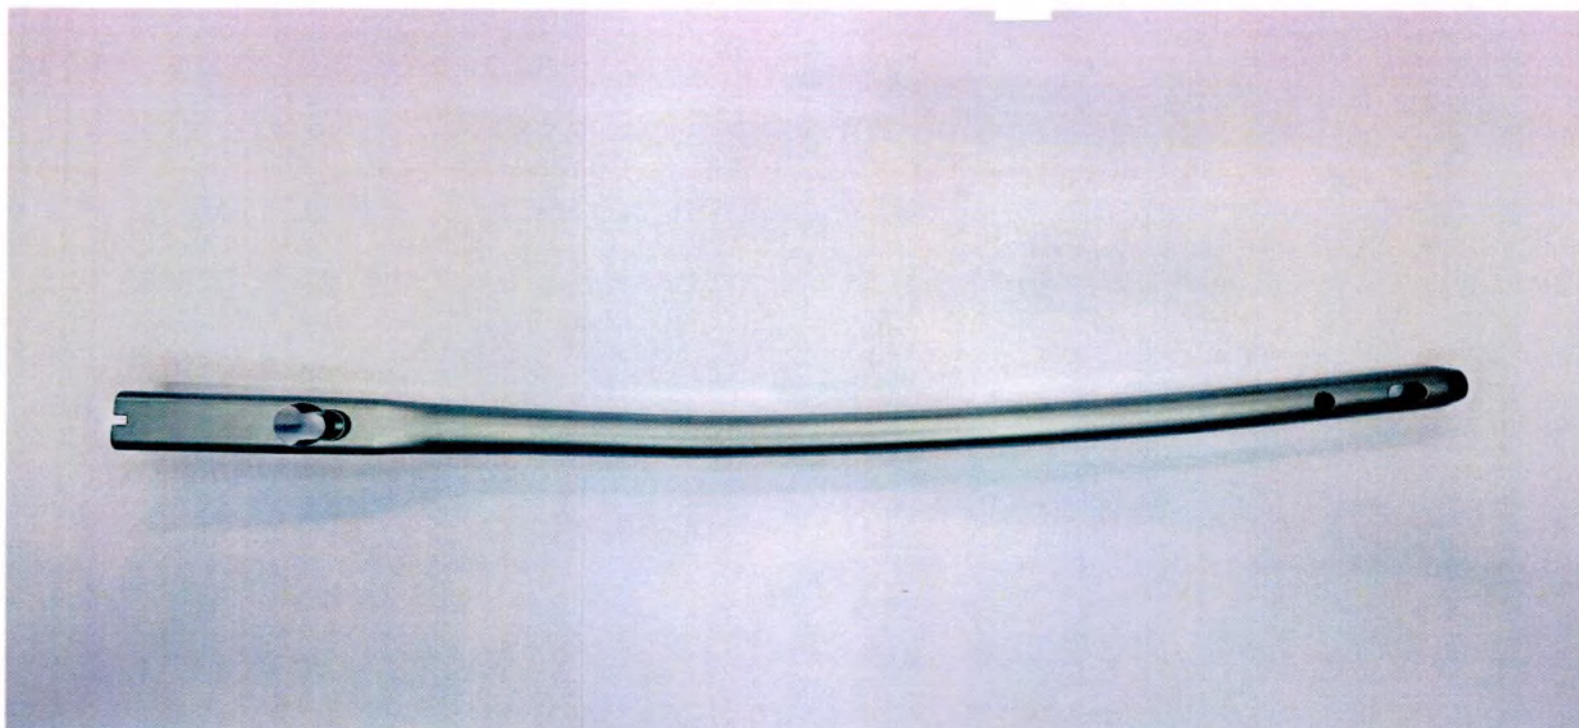


Фото 70. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Стержень гамма модульный длинный



Фото 71. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Стержень гамма короткий блокируемый

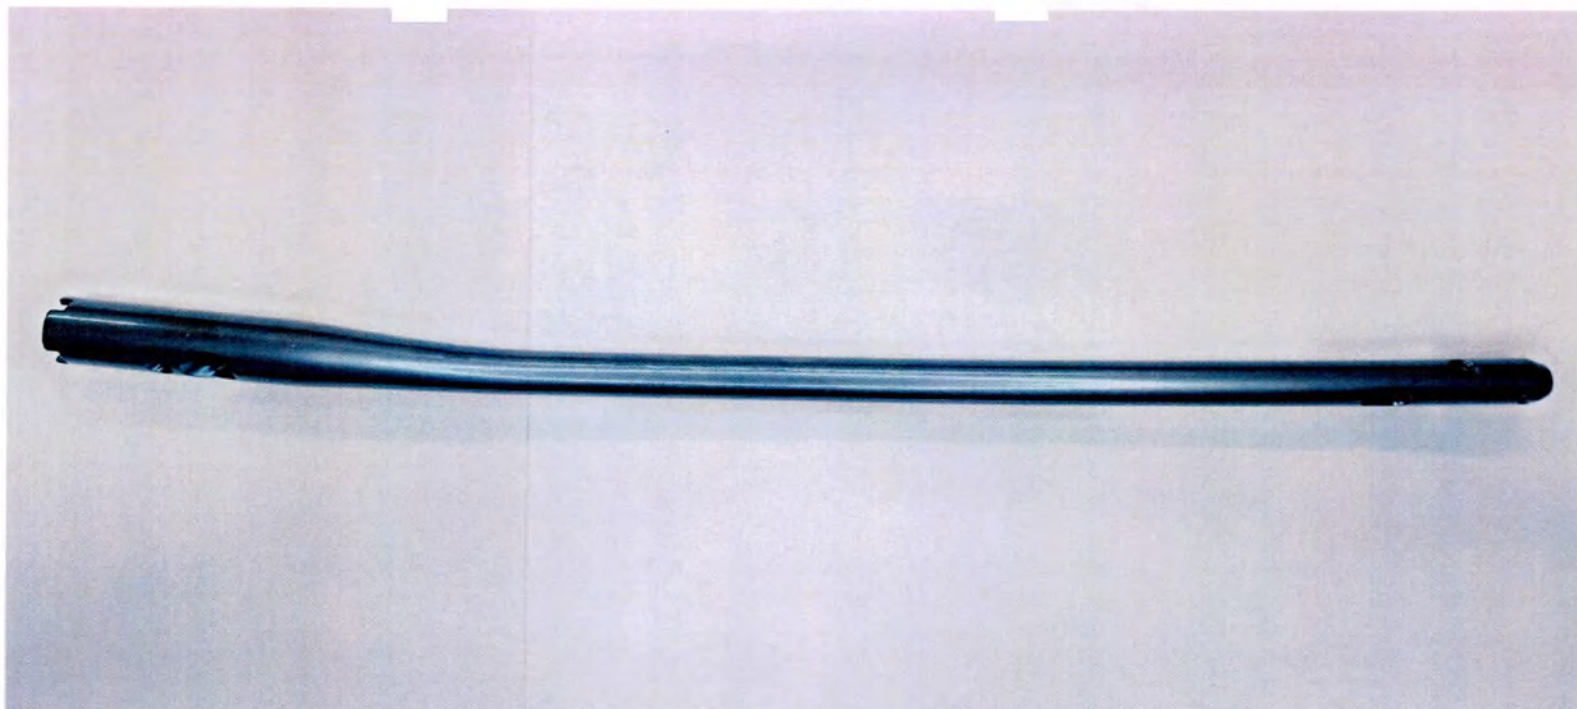


Фото 72. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Стержень гамма длинный блокируемый

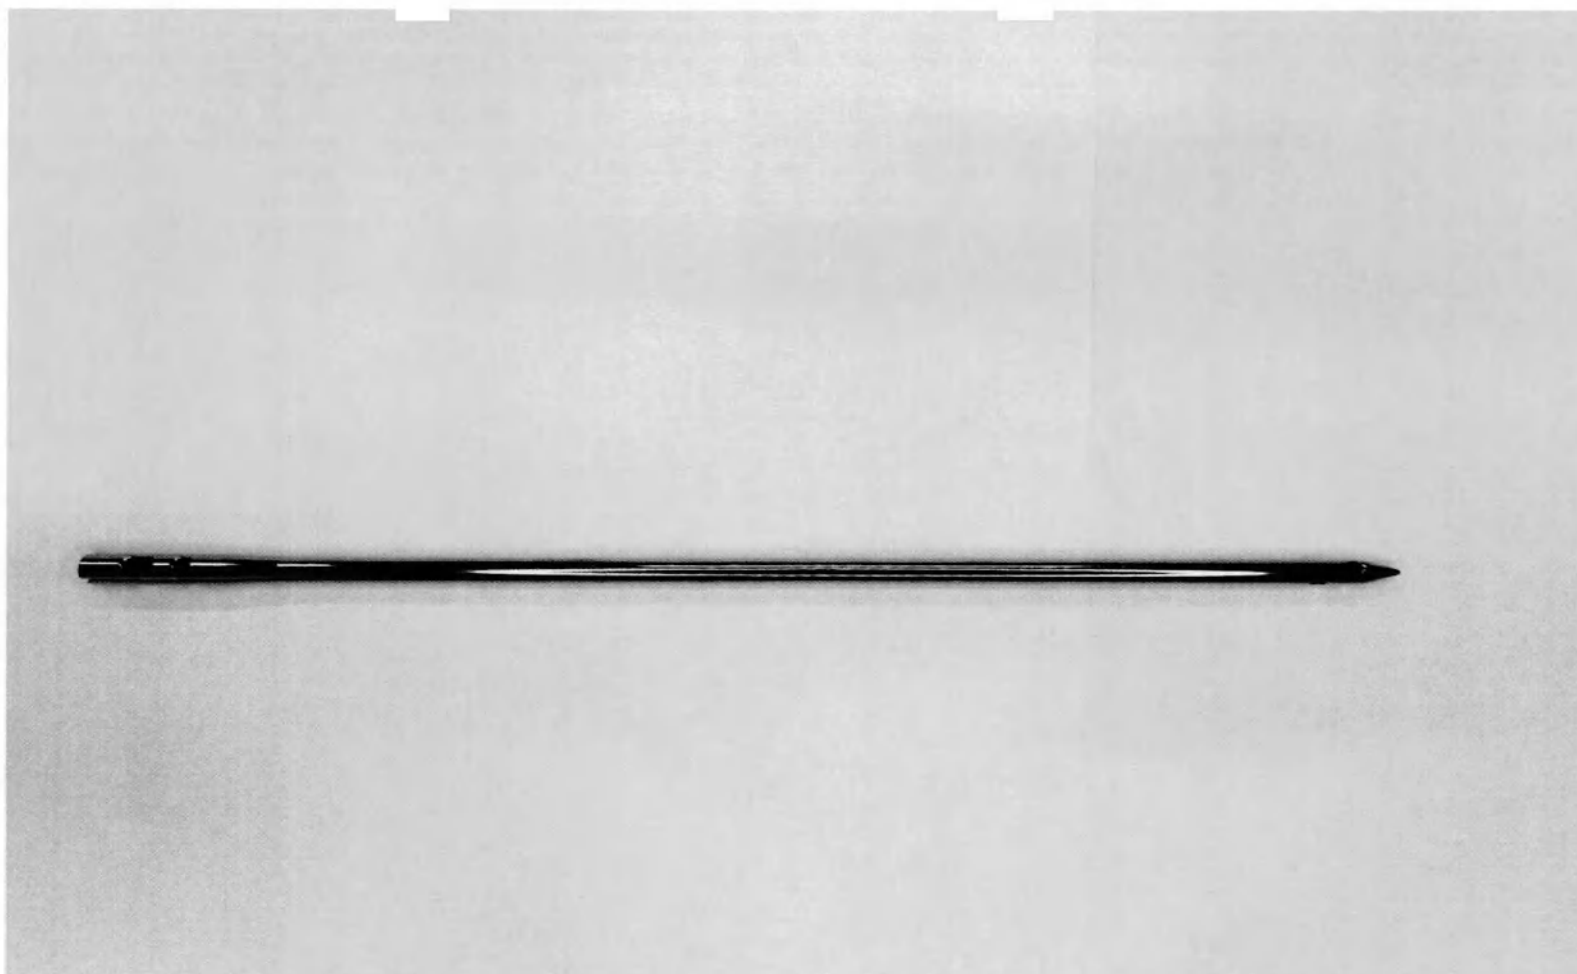


Фото 73. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Стержень для костей предплечья



Фото 74. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Стержень реконструктивный для плеча прямой

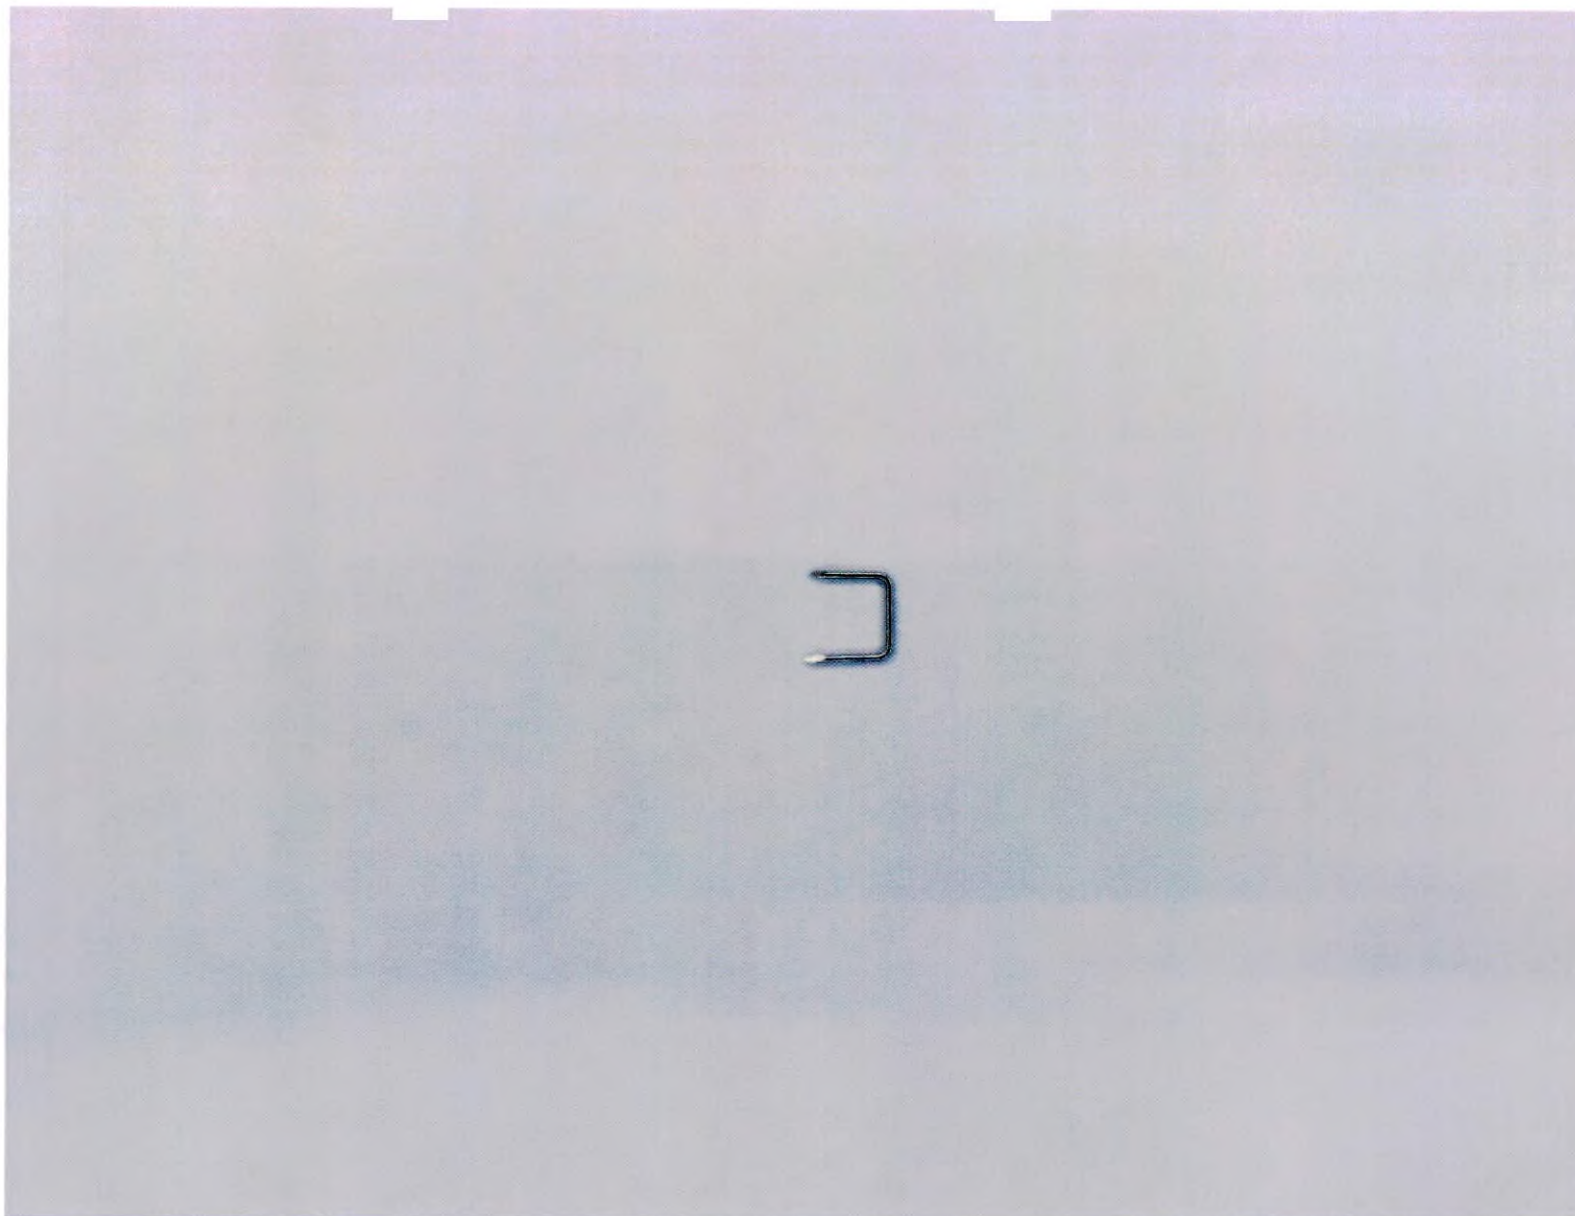



Фото 75. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Скоба



**Фото 76. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Проволока**



Фото 77. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Трос

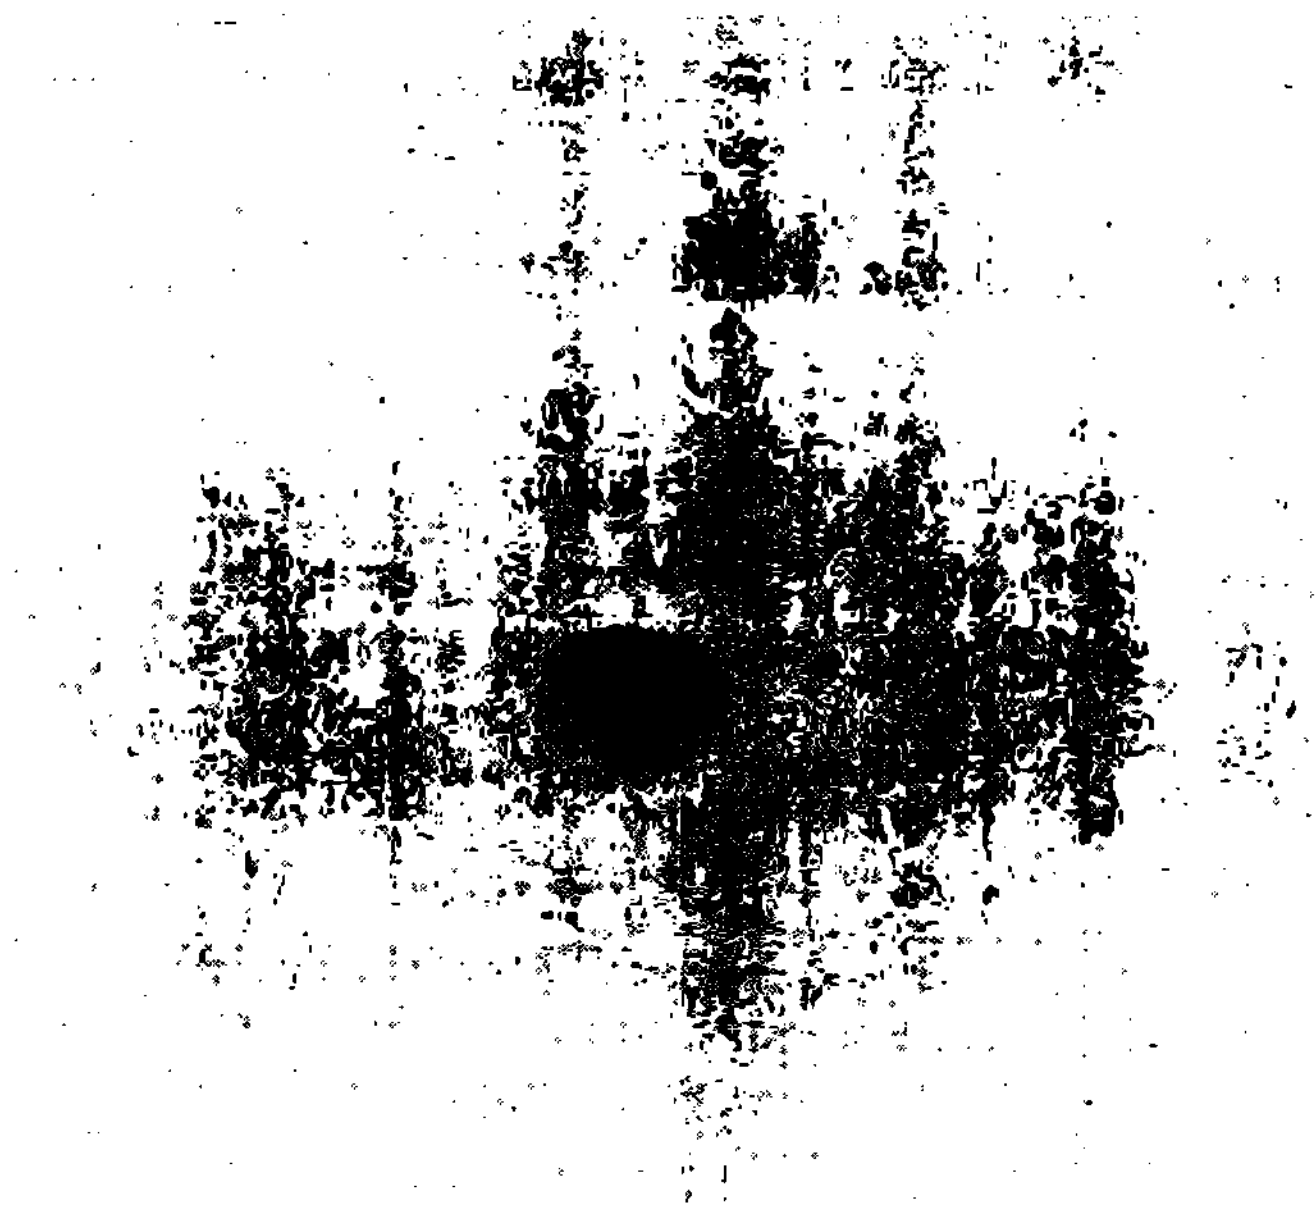

**Фото 78. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023»,
Направитель резьбовых отверстий**



Фото 79. «Система имплантатов для внутренней ортопедической фиксации по ТУ 32.50.22-009-74573326-2023», образец транспортной упаковки с манипуляционными знаками, расположенными в соответствии с ГОСТ 14192.

Примечание: текстовая часть маркировки не приводится, поскольку она оформляется транспортной компанией в соответствии с внутренними требованиями к маркировке грузов (автоматически генерируемые ярлыки со штрих-кодом, фирменные пакеты, в которые упаковываются малогабаритные грузы и т.п.).

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью И. Вешнякова
листов

«28 марта 2017г.»
Чигарин Д.В.

