

ООО «Парамед Дистрибьюшн»
ИНН 6671213167 ОГРН 1226600030601
Фактический и юридический адрес:
620144, Россия, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Московская 249
Тел. +7 (343) 226-1404, info@parmd.ru



Paramed Distribution LLC
INN 6671213167, PSRN 1226600030601
Legal and postal address:
Moskovskaya Street 249, Yekaterinburg,
620144 Russian Federation
Tel. +7 (343) 226-1404, info@parmd.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Парамед Дистрибьюшн»



Гимадитдинов Ф.Р.
«12» декабря 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Маска кислородная стерильная

Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китайская Народная Республика



Рисунок 1 - Маска кислородная стерильная стандартная, общий вид




Рисунок 2 - Маска кислородная стерильная стандартная, общий вид в индивидуальной упаковке

Маска кислородная стерильная стандартная

Размер: S

ВНИМАНИЕ!

- Изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом. Спецификация кислородных масок должна быть выбрана в соответствии с возрастом и телосложением пациентов;
- Не применять при наличии аллергии на материалы, из которых изготовлено изделие;
- Избегайте замерзания и чрезмерного нагрева;
- Перед применением убедитесь, что все соединения надёжно закреплены.



Условия эксплуатации: темп. от +14°C до +35°C, влажность не более 80%

Условия хранения: темп. от 0°C до +35°C, влажность не более 80%

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

LOT: 20220910

 : 20220910

 : 20270909

Штрих-код



STERILE EO

LATEX

2
STERILIZED

 **Производитель:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»). Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1, No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Парамед Дистрибьюшн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Рисунок 3 - Маска кислородная стерильная стандартная, маркировка индивидуальной упаковки



Рисунок 4 - Маска кислородная стерильная Вентури с регулируемым потоком, общий вид



Рисунок 5 - Маска кислородная стерильная Вентури с регулируемым потоком, общий вид в индивидуальной упаковке

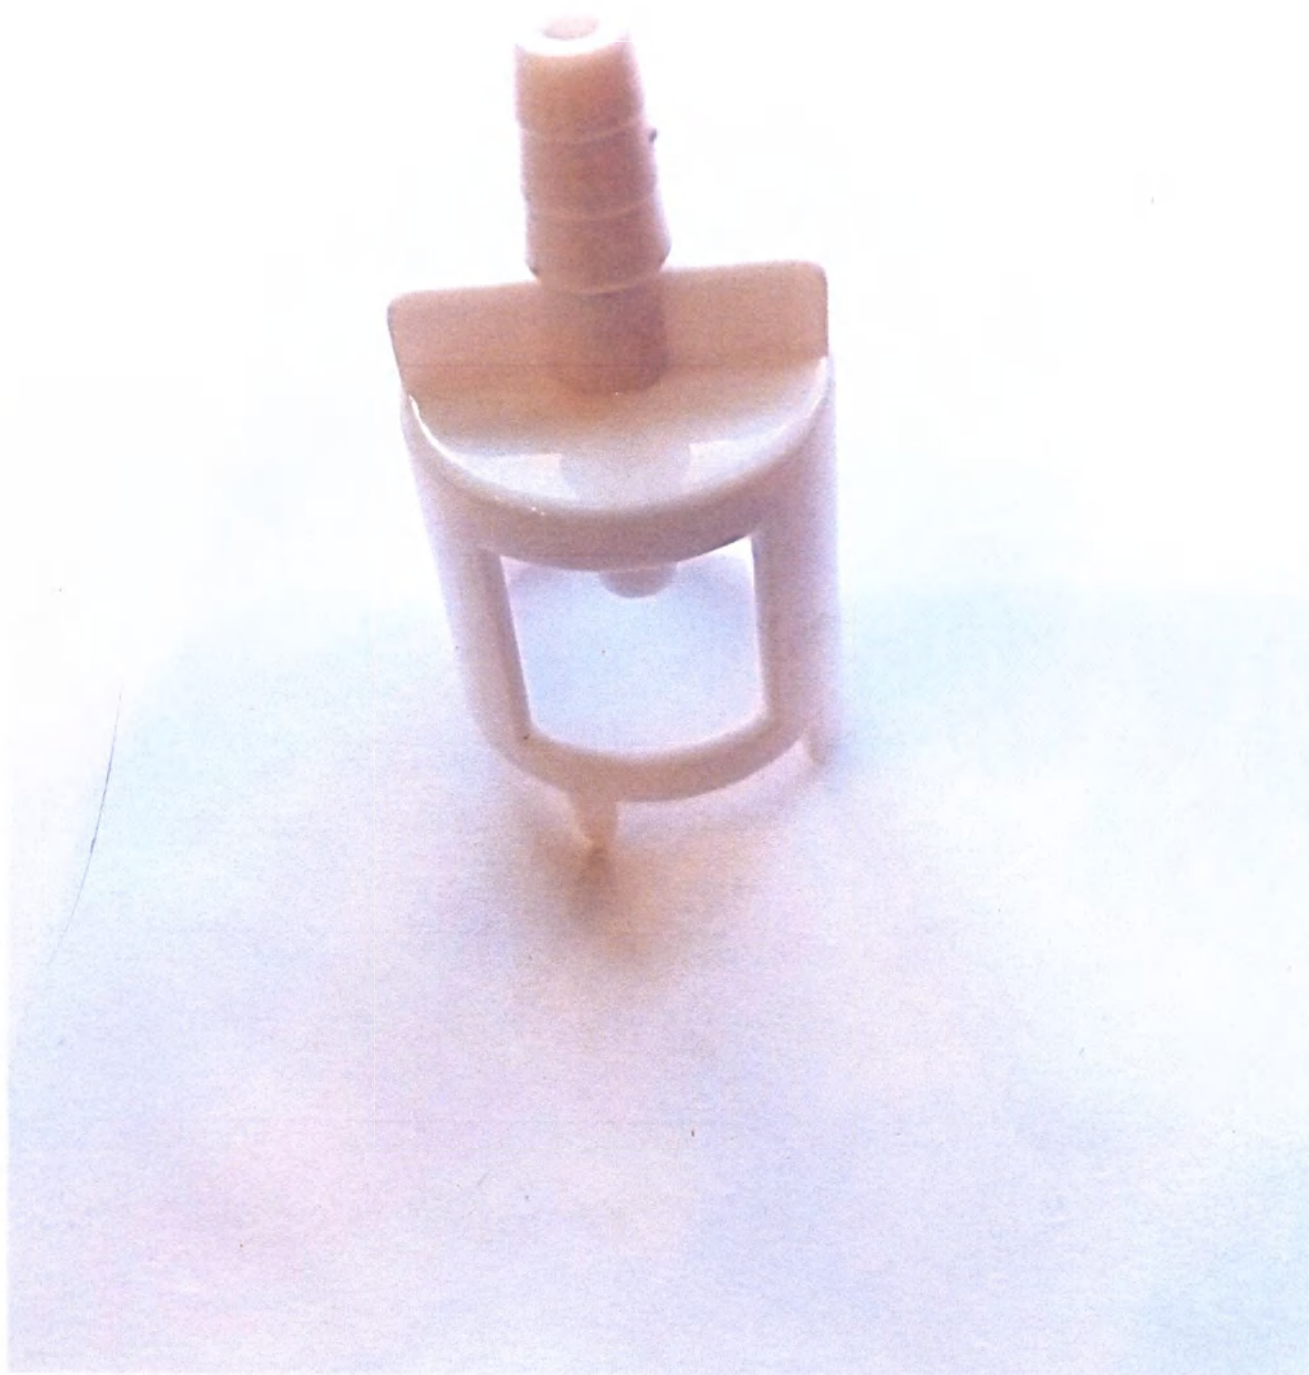


Рисунок 6 - Маска кислородная стерильная Вентури с регулируемым потоком: клапан Вентури белый (35%, 40%, 50%)



Рисунок 7 - Маска кислородная стерильная Вентури с регулируемым потоком: клапан Вентури зелёный (24%, 26%, 28%, 30%)

Маска кислородная стерильная Вентури с регулируемым потоком

ВНИМАНИЕ!

- Изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом. Спецификация кислородных масок должна быть выбрана в соответствии с возрастом и телосложением пациентов;
- Не применять при наличии аллергии на материалы, из которых изготовлено изделие;
- Избегайте замерзания и чрезмерного нагрева;
- Перед применением убедитесь, что все соединения надёжно закреплены.

Размер: L



Условия эксплуатации: темп. от +14°C до +35°C, влажность не более 80%

Условия хранения: темп. от 0°C до +35°C, влажность не более 80%

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

LOT: 20220910

 : 20220910

 : 20270909

Штрих-код



STERILE EO

LATEX



 **Производитель:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»). Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1 No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Парамед Дистрибьюшн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Рисунок 8 - Маска кислородная стерильная Вентури с регулируемым потоком, маркировка индивидуальной упаковки



Рисунок 9 - Маска кислородная стерильная Вентури, общий вид



Рисунок 10 - Маска кислородная стерильная Вентури, общий вид в индивидуальной упаковке

Маска кислородная стерильная Вентури

ВНИМАНИЕ!

- Изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом. Спецификация кислородных масок должна быть выбрана в соответствии с возрастом и телосложением пациентов;
- Не применять при наличии аллергии на материалы, из которых изготовлено изделие;
- Избегайте замерзания и чрезмерного нагрева;
- Перед применением убедитесь, что все соединения надёжно закреплены.

Условия эксплуатации: темп. от +14°C до +35°C, влажность не более 80%

Условия хранения: темп. от 0°C до +35°C, влажность не более 80%

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Размер: XL



LOT: 20220910

 : 20220910

 : 20270909

Штрих-код



STERILE

LATEX

2
STERILIZED

Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»). Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1 No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Парамед Дистрибьюшн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Рисунок 11 - Маска кислородная стерильная Вентури, маркировка индивидуальной упаковки



Рисунок 12 - Маска кислородная стерильная Вентури: клапан Вентури синий (24%)



Рисунок 13 - Маска кислородная стерильная Вентури: клапан Вентури жёлтый (28%)



Рисунок 14 - Маска кислородная стерильная Вентури: клапан Вентури белый (31%)



Рисунок 15 - Маска кислородная стерильная Вентури: клапан Вентури зелёный (35%)



Рисунок 16 - Маска кислородная стерильная Вентури: клапан Вентури розовый (40%)



Рисунок 17 - Маска кислородная стерильная Вентури: клапан Вентури оранжевый (50%)



Рисунок 18 - Маска кислородная стерильная с мешком, общий вид




Рисунок 19 - Маска кислородная стерильная с мешком, общий вид в индивидуальной упаковке

Маска кислородная стерильная с мешком

Размер: XS

ВНИМАНИЕ!

- Изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом. Спецификация кислородных масок должна быть выбрана в соответствии с возрастом и телосложением пациентов;
- Не применять при наличии аллергии на материалы, из которых изготовлено изделие;
- Избегайте замерзания и чрезмерного нагрева;
- Перед применением убедитесь, что все соединения надёжно закреплены.



Условия эксплуатации: темп. от +14°C до +35°C, влажность не более 80%

Условия хранения: темп. от 0°C до +35°C, влажность не более 80%

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

LOT : 20220910

 : 20220910

 : 20270909

Штрих-код



STERILE

LATEX



 **Производитель:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»). Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1 No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, Zhejiang Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Парамед Дистрибьюшн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Рисунок 20 - Маска кислородная стерильная с мешком, маркировка индивидуальной упаковки

Маска кислородная стерильная с мешком

Размер: XS

КОЛ-ВО: 50 ШТ.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Штрих-код

Рисунок 21 - Транспортная (групповая) упаковка – сторона 1



Рисунок 22 - Транспортная (групповая) упаковка – стороны 1 и 2



Рисунок 23 - Транспортная (групповая) упаковка – стороны 3 и 4

Маска кислородная стерильная стандартная

Размер: S

КОЛ-ВО: 50 ШТ.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Штрих-код

Маска кислородная стерильная стандартная

Размер: S


КОЛ-ВО: 50 ШТ.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

LOT: 20220910

: 20220910

: 20270909



Производитель: Ningbo Sincere Medical Instruments Co., Ltd. (Нинбо Синчери Медицинские Инструменты Ко., Лтд.) Адрес: Китайская Народная Республика, 167-1, Building 1, No. 88 Changyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.
Уполномоченный представитель: ООО «Гарант-Дистрибуция» Адрес: Россия, 420104, Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московский, д. 240, тел.: +7 (343) 238-14-04.



Маска кислородная стерильная стандартная

Размер: S

КОЛ-ВО: 50 ШТ.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Штрих-код

Условия транспортирования: темп. от -10°C до +35°C, влажность не более 80%

Условия хранения: темп. от 0°C до +35°C, влажность не более 80%



Рисунок 24 – Макет маркировки транспортной (групповой) упаковки

Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

25 (двадцать пять) листа(-ов)

ООО «Парамед Дистрибьюшн»

Директор Гимадигдинов Ф.Р.

Подпись _____

