

ОКПД2 32.50.13.190

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РиГ Групп Ко»

Л.С. Ахлахвердиев/

«3» июня 2024 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Стилет для интубации STATIM,
одноразовый, стерильный,
в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13-002-38044224-2023**

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «РиГ Групп Ко»
199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Санкт-Петербург,
2024

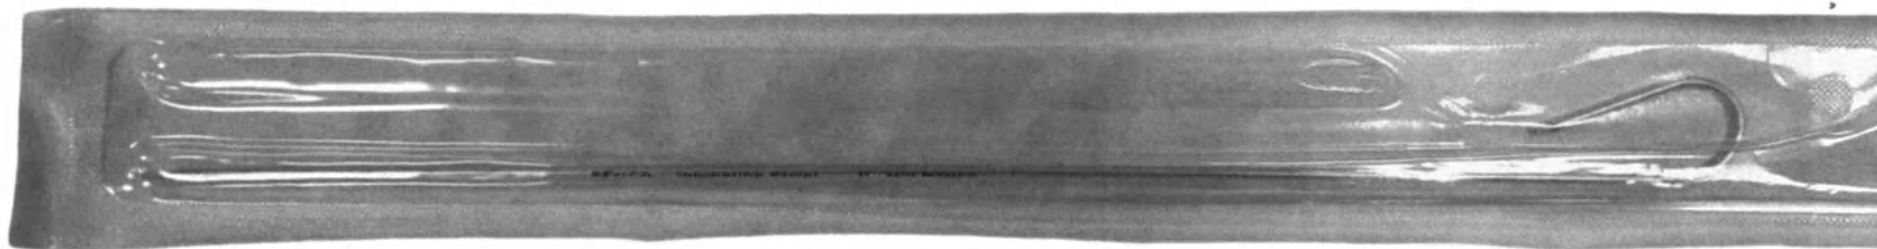

Стилет для интубации STATIM Ch/Fr 6

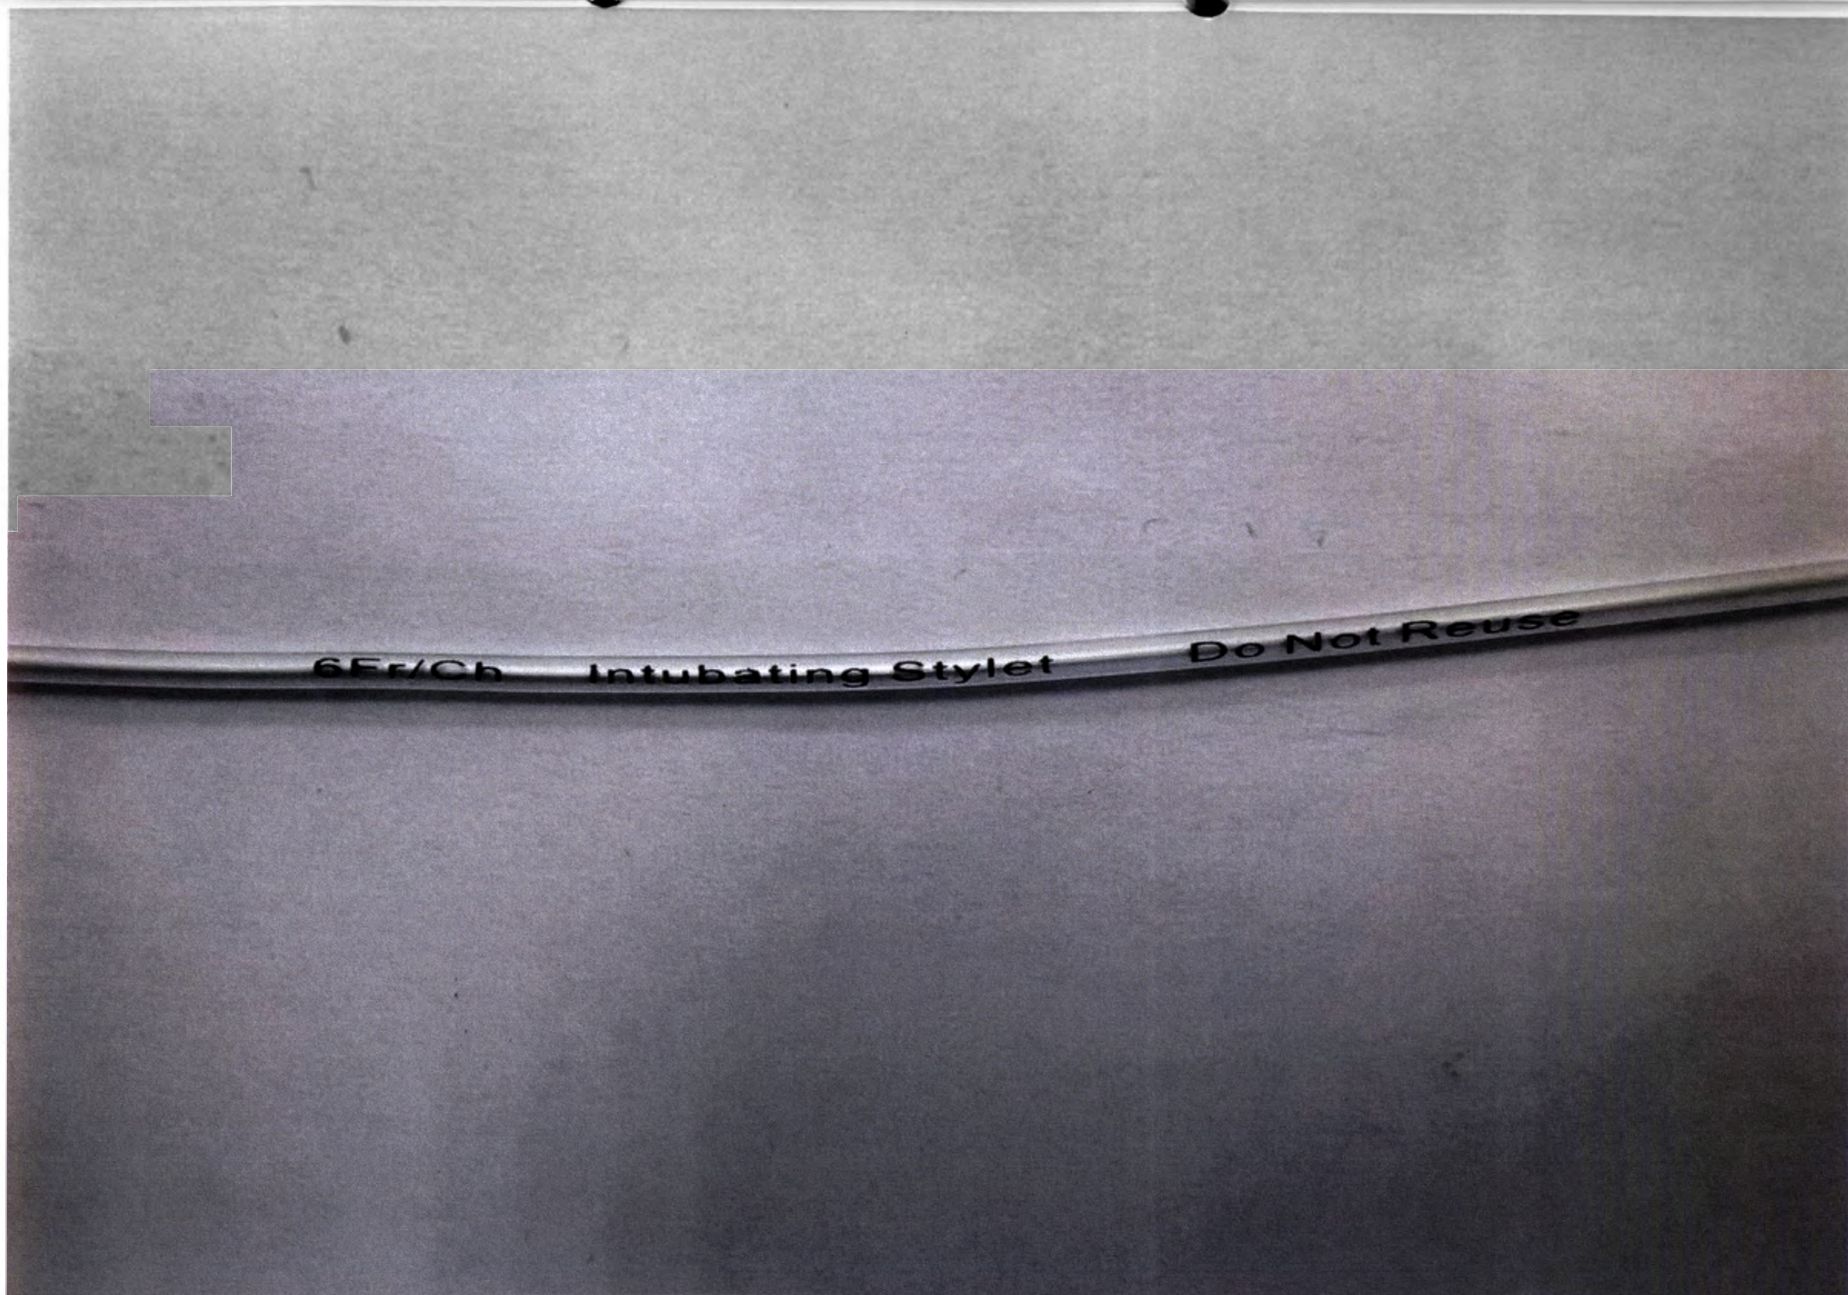

Маркировка изделия Стиллет для интубации STATIM Ch/Fr 6



Стиллет для интубации STATIM Ch/Fr 10

10Fr/Ch Intubating Stylet Do Not Reuse

Маркировка изделия Стиллет для интубации STATIM Ch/Fr 10




Стилет для интубации STATIM Ch/Fr 12

12Fr/Ch Intubating Stylet Do Not Reuse

Маркировка изделия Стиллет для интубации STATIM Ch/Fr 12




Стилет для интубации STATIM Ch/Fr 14

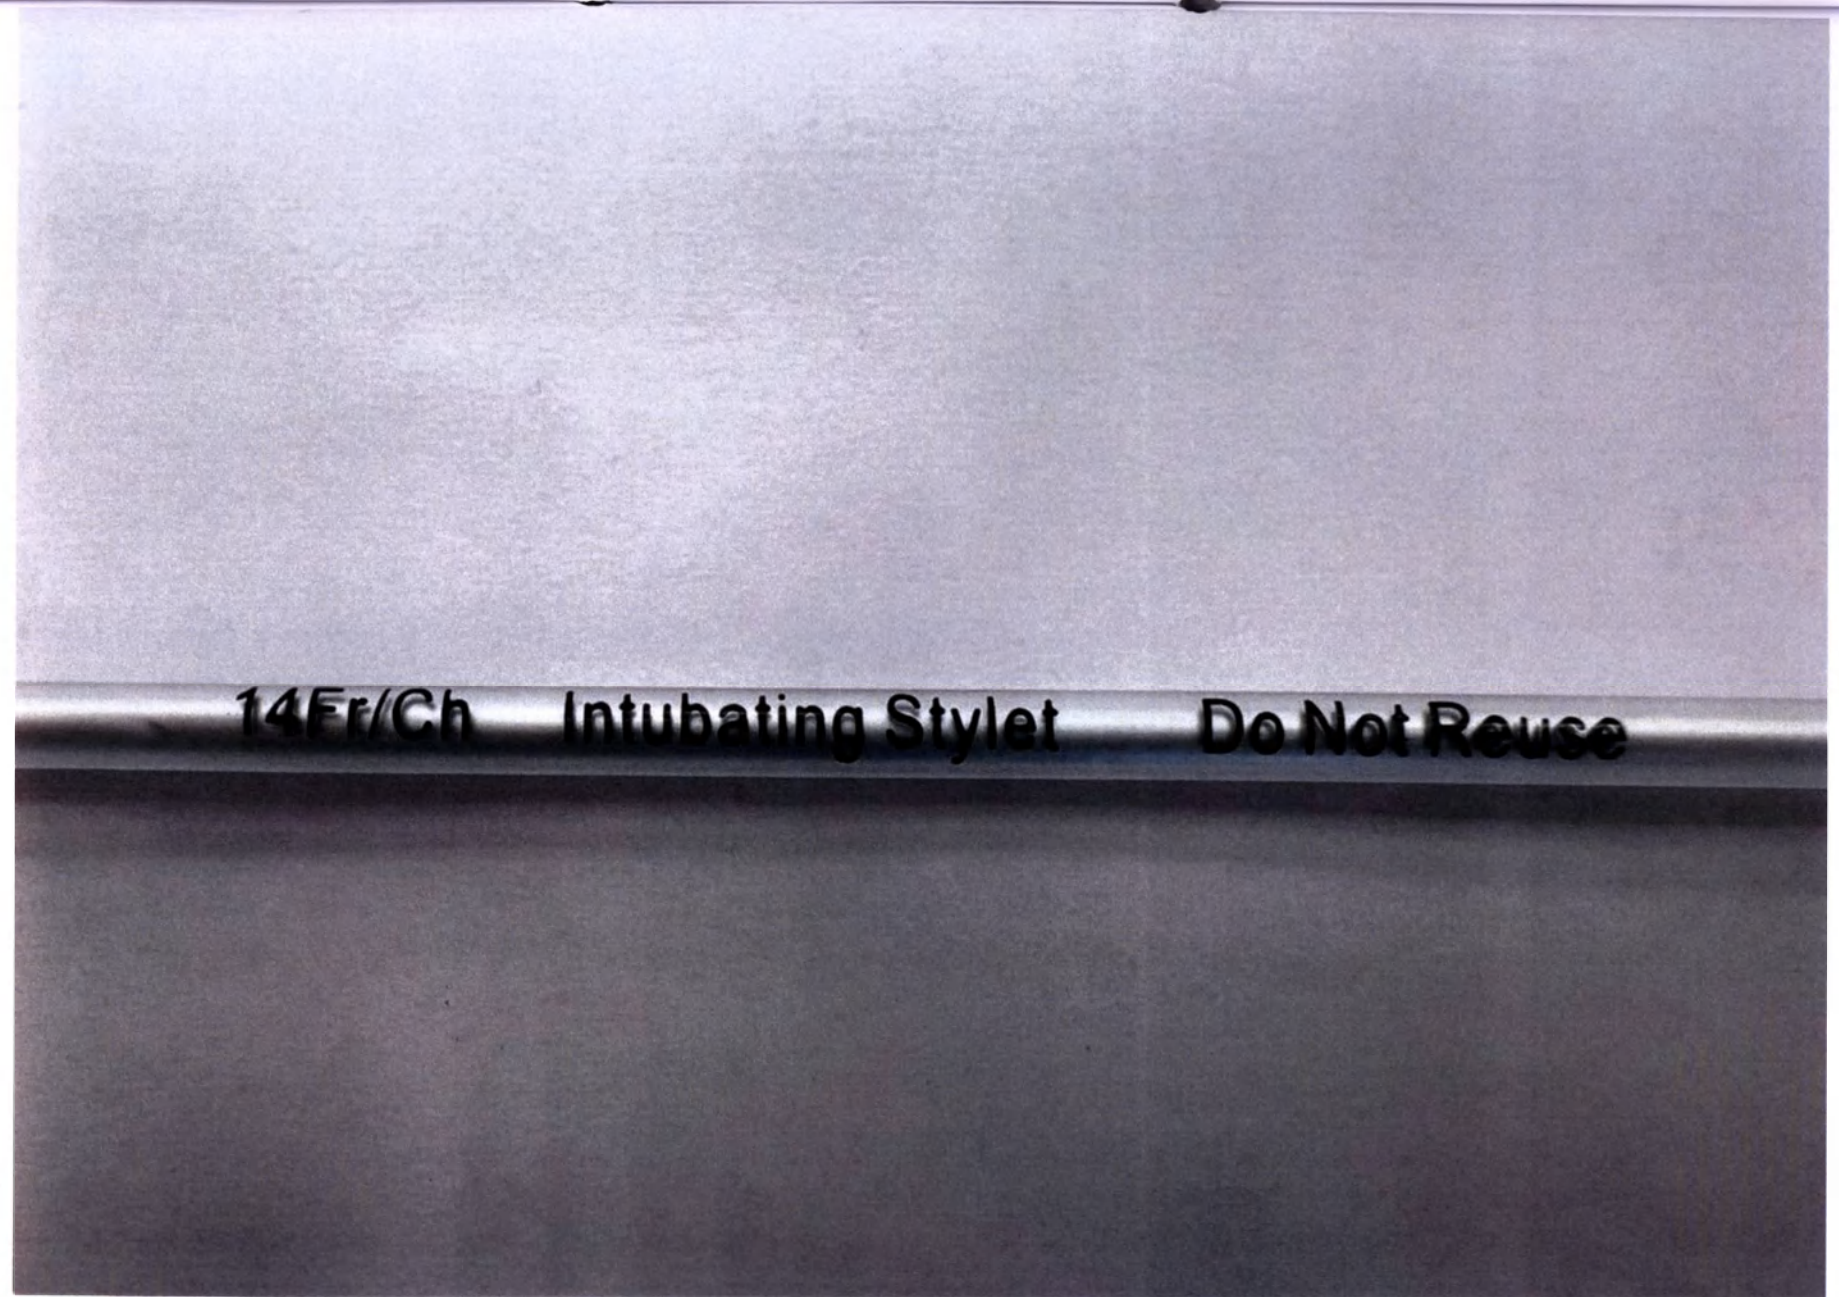


Маркировка изделия Стиллет для интубации STATIM Ch/Fr 14




Маркировка изделия Проводник для интубации STATIM Ch/Fr 6

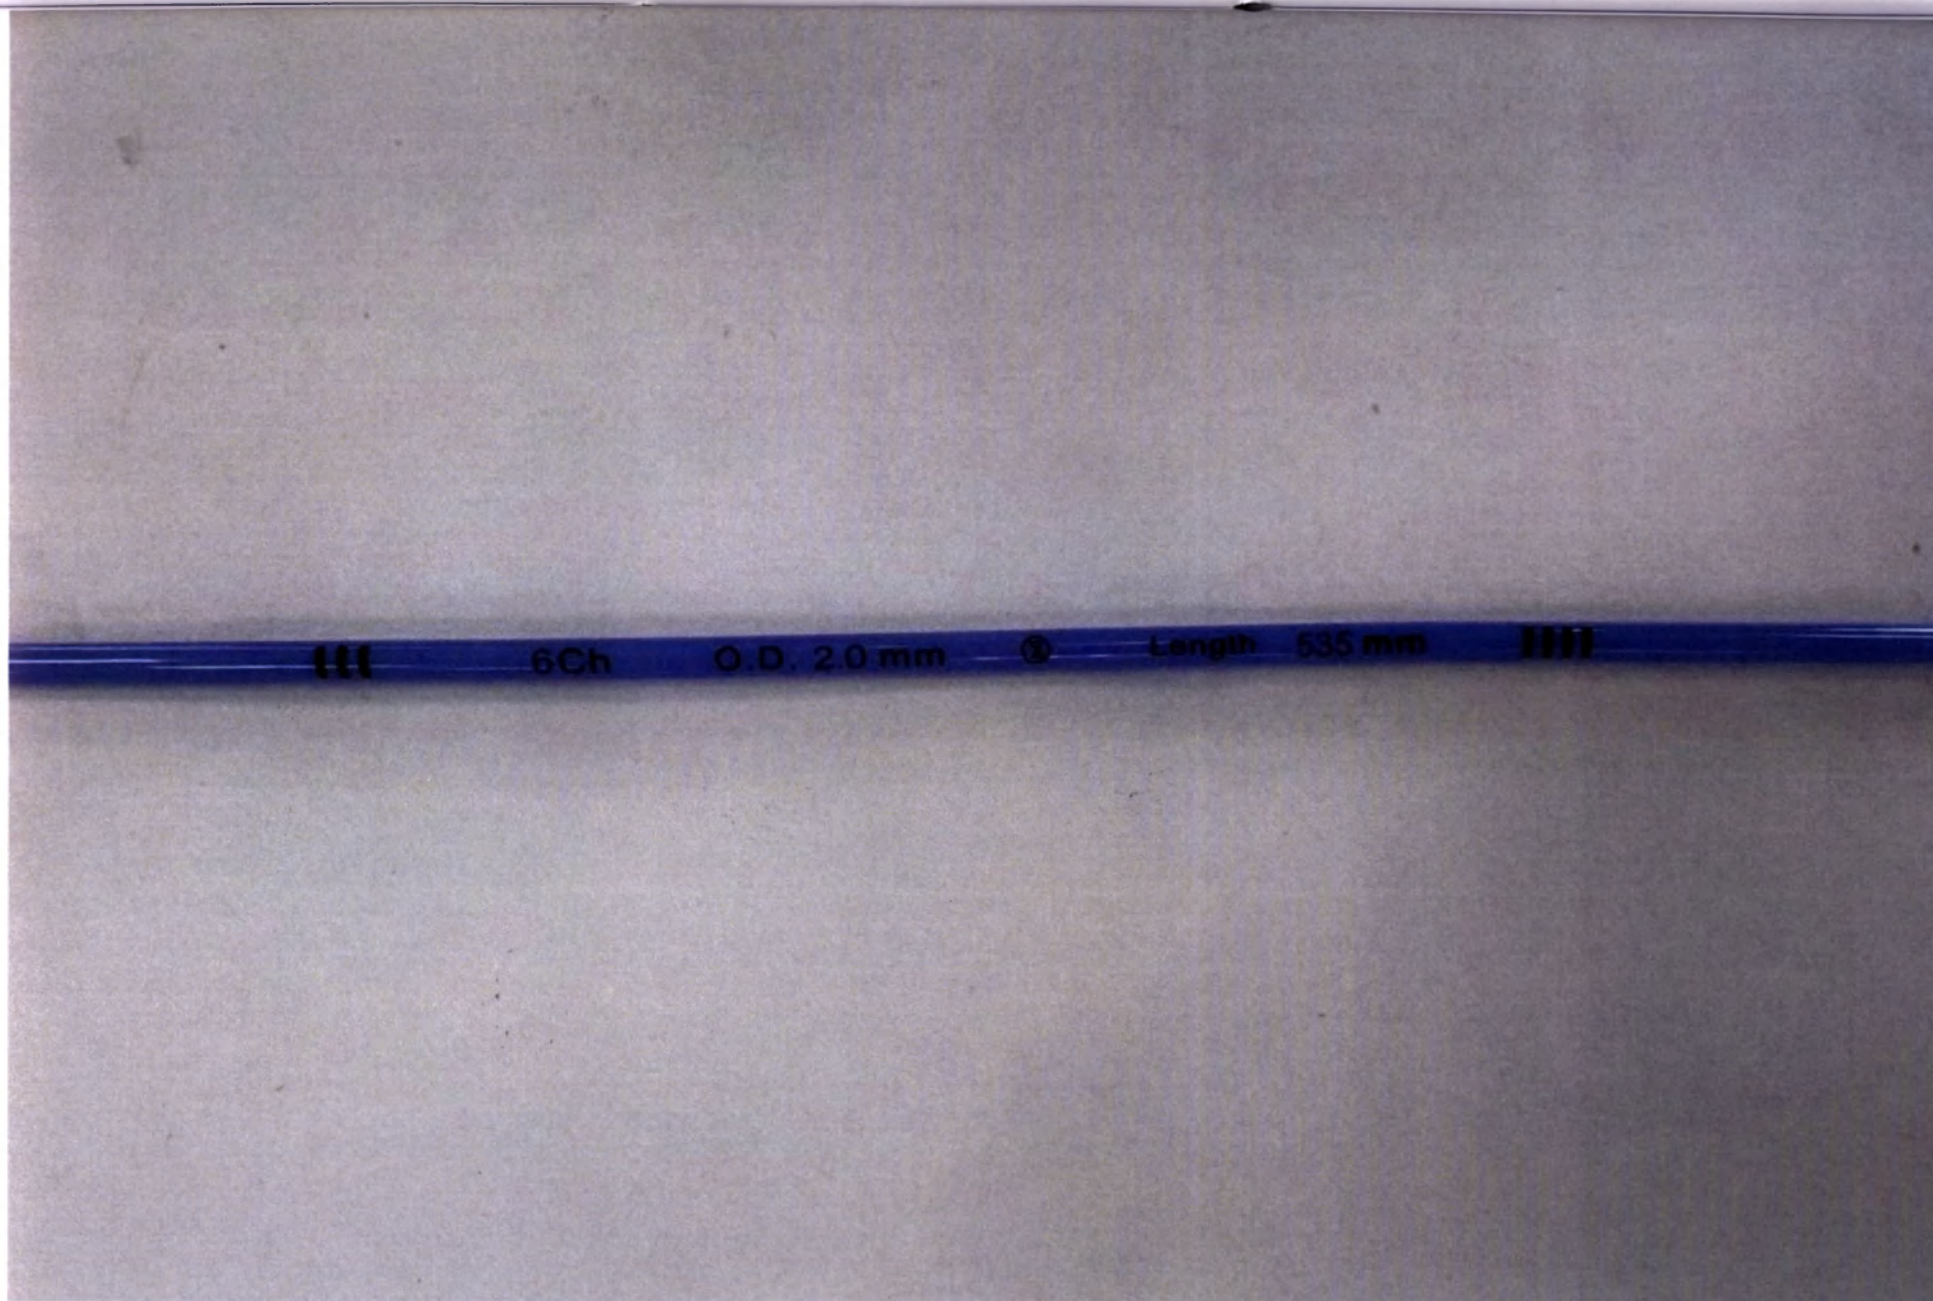


Маркировка изделия Проводник для интубации STATIM Ch/Fr 6

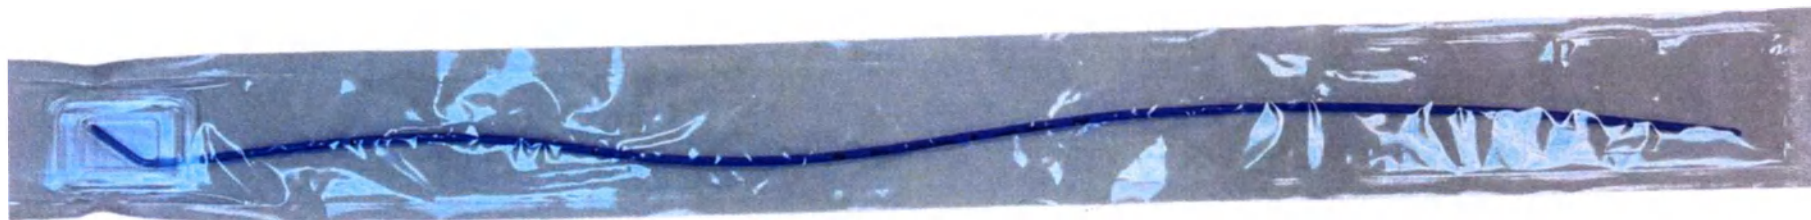


Проводник для интубации STATIM Ch/Fr 10

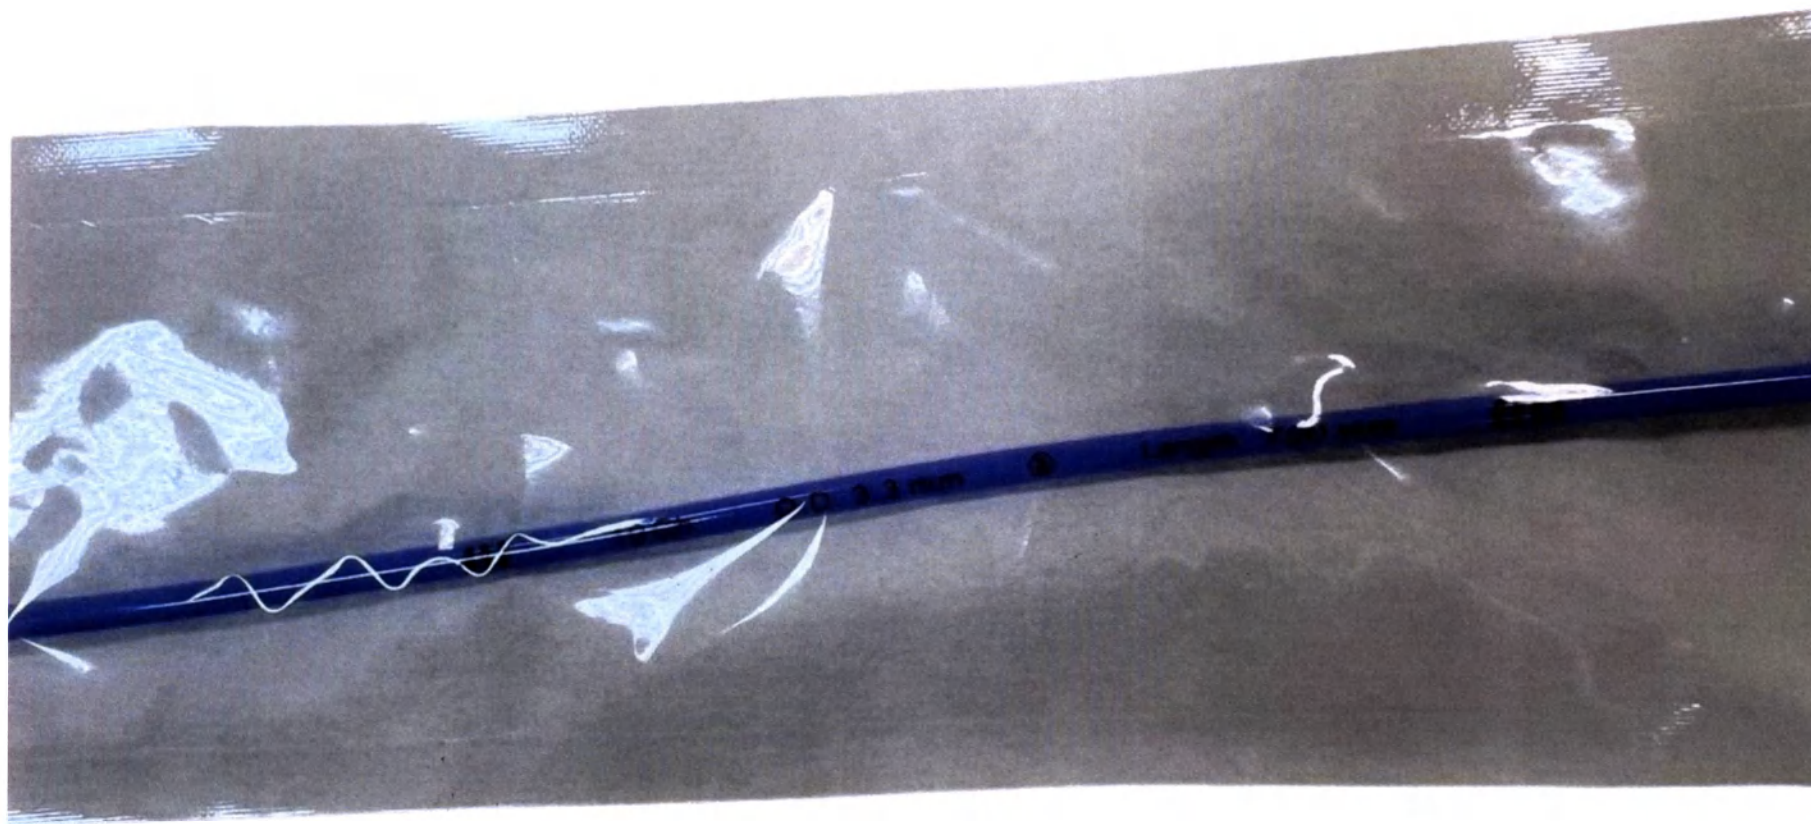

Проводник для интубации STATIM Ch/Fr 10

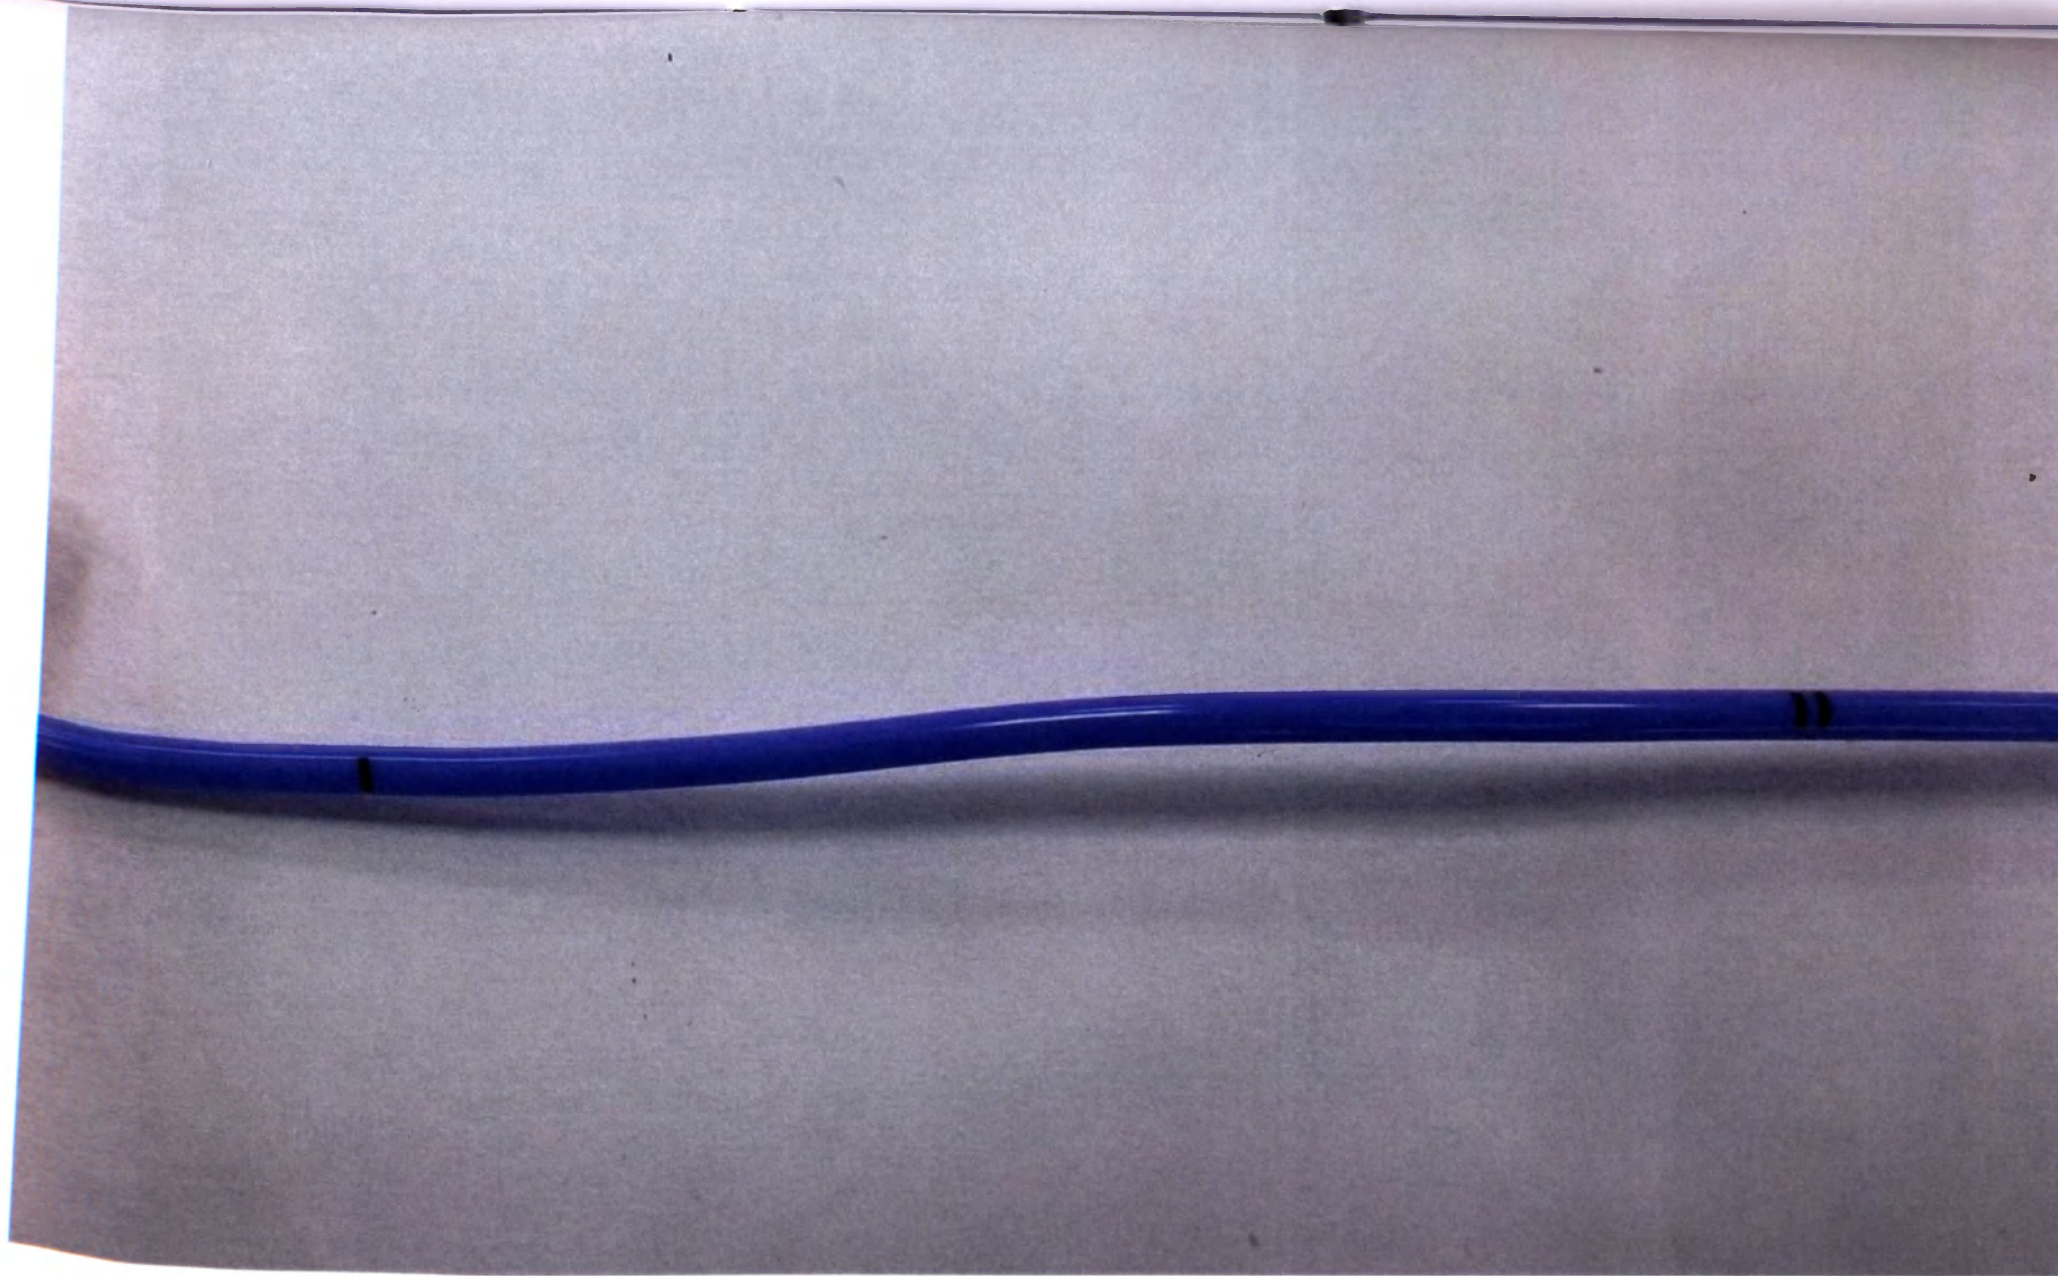

Маркировка изделия Проводник для интубации STATIM Ch/Fr 10

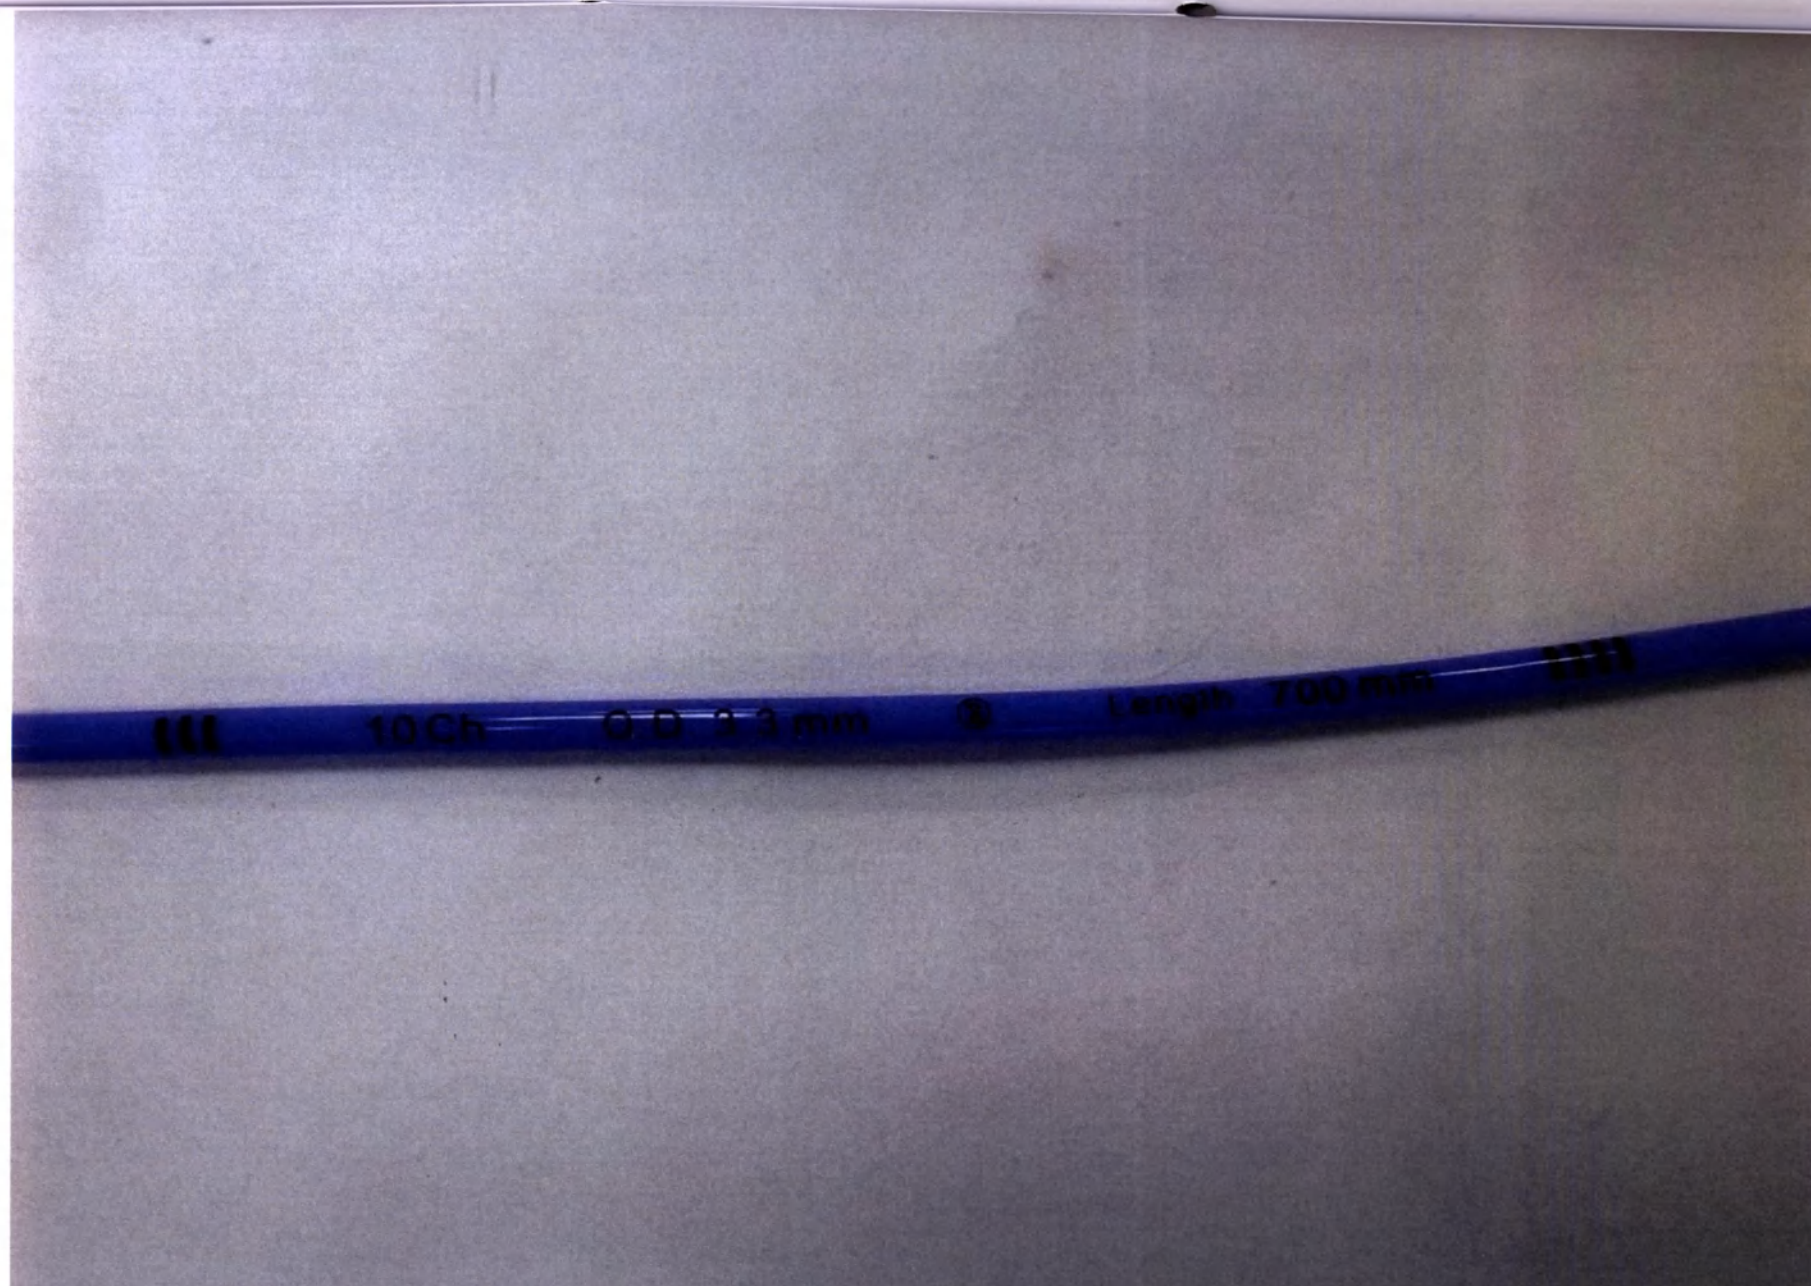

Маркировка изделия Проводник для интубации STATIM Ch/Fr 10



Проводник для интубации STATIM Ch/Fr 15




Проводник для интубации STATIM Ch/Fr 15



Проводник для интубации STATIM Ch/Fr 15



Маркировка изделия Проводник для интубации STATIM Ch/Fr 15

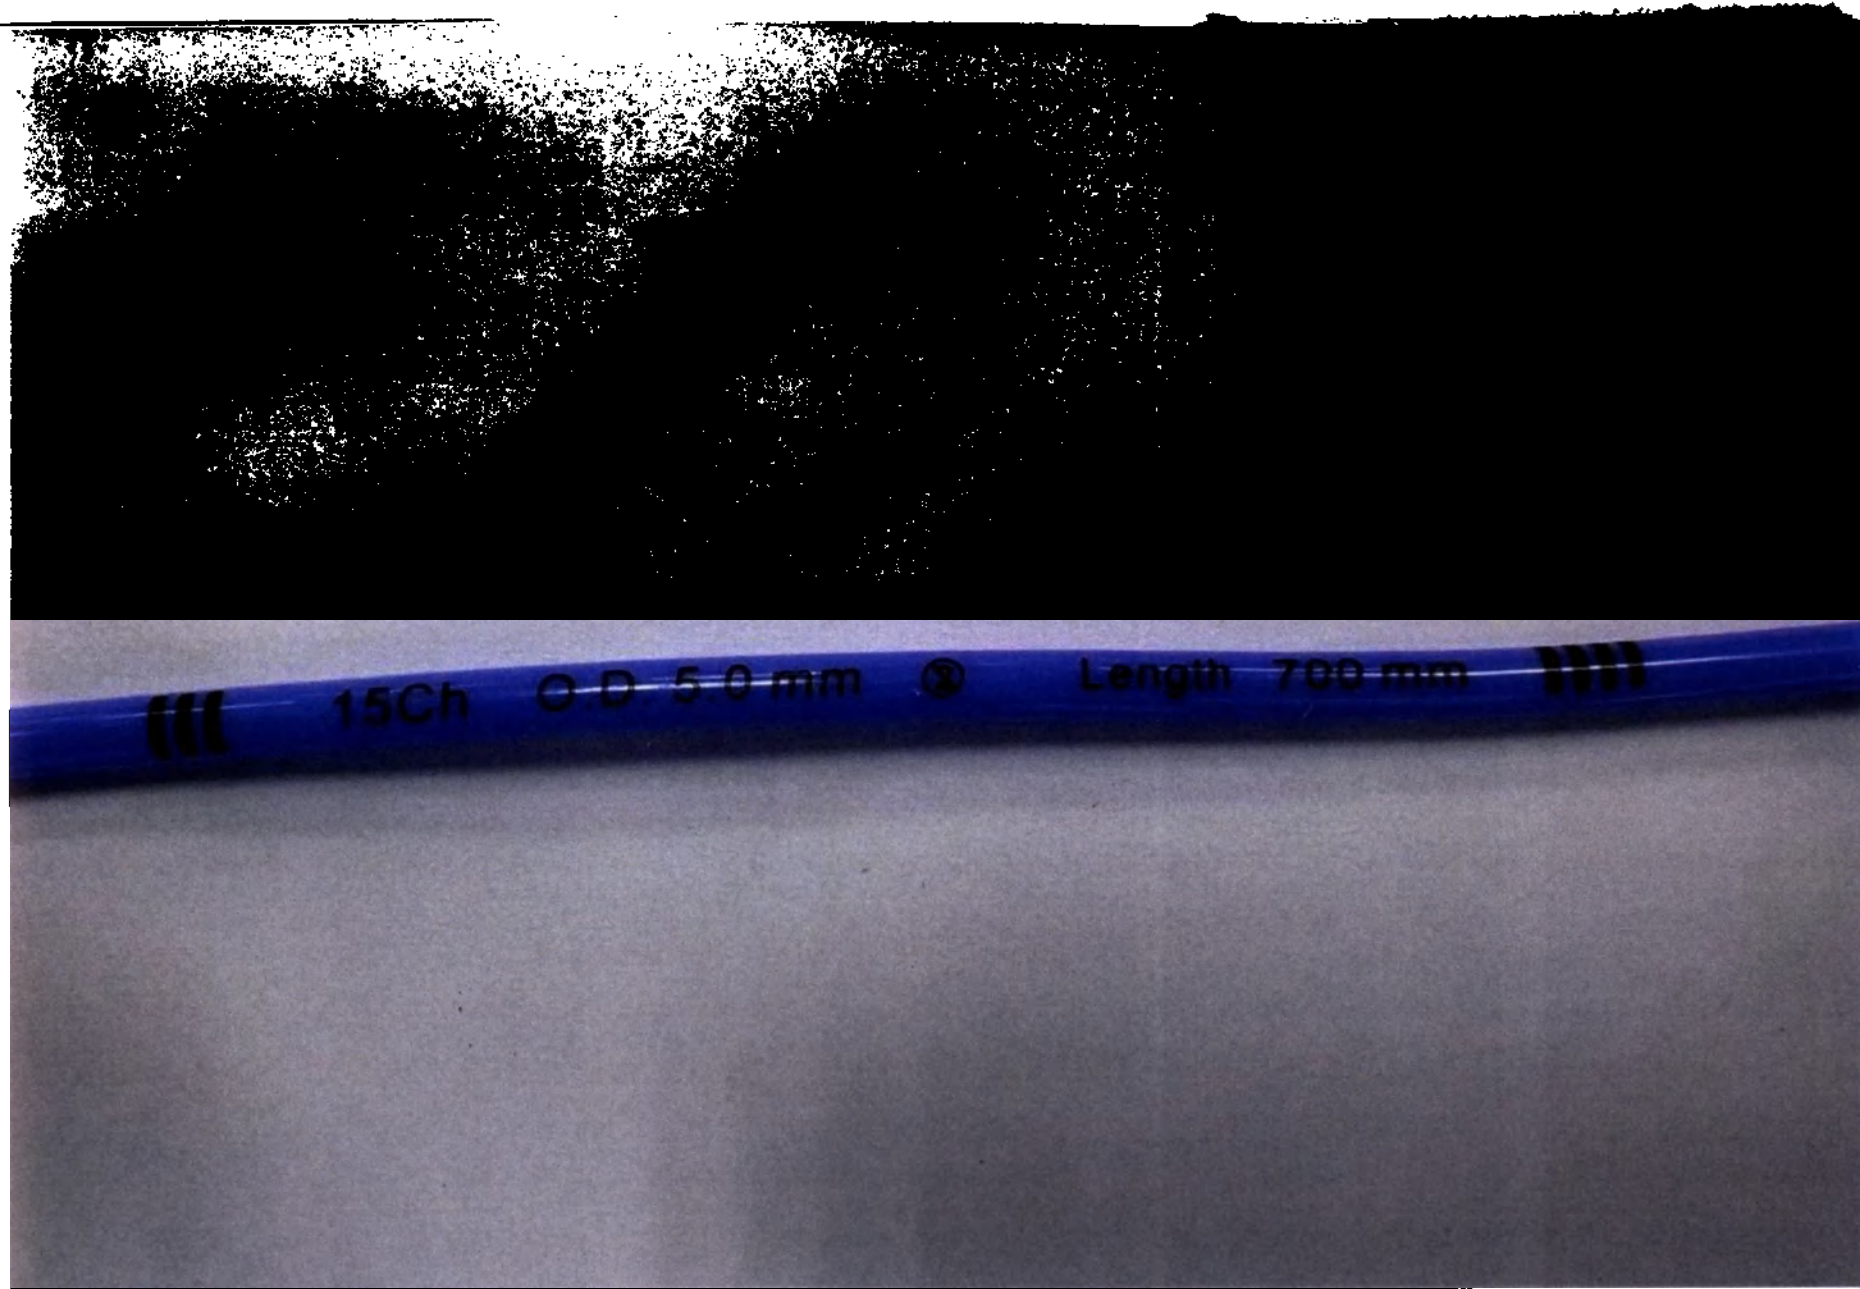


Маркировка изделия Проводник для интубации STATIM Ch/Fr 15



Проводник полый для интубации STATIM Ch/Fr 10




Проводник полый для интубации STATIM Ch/Fr 10

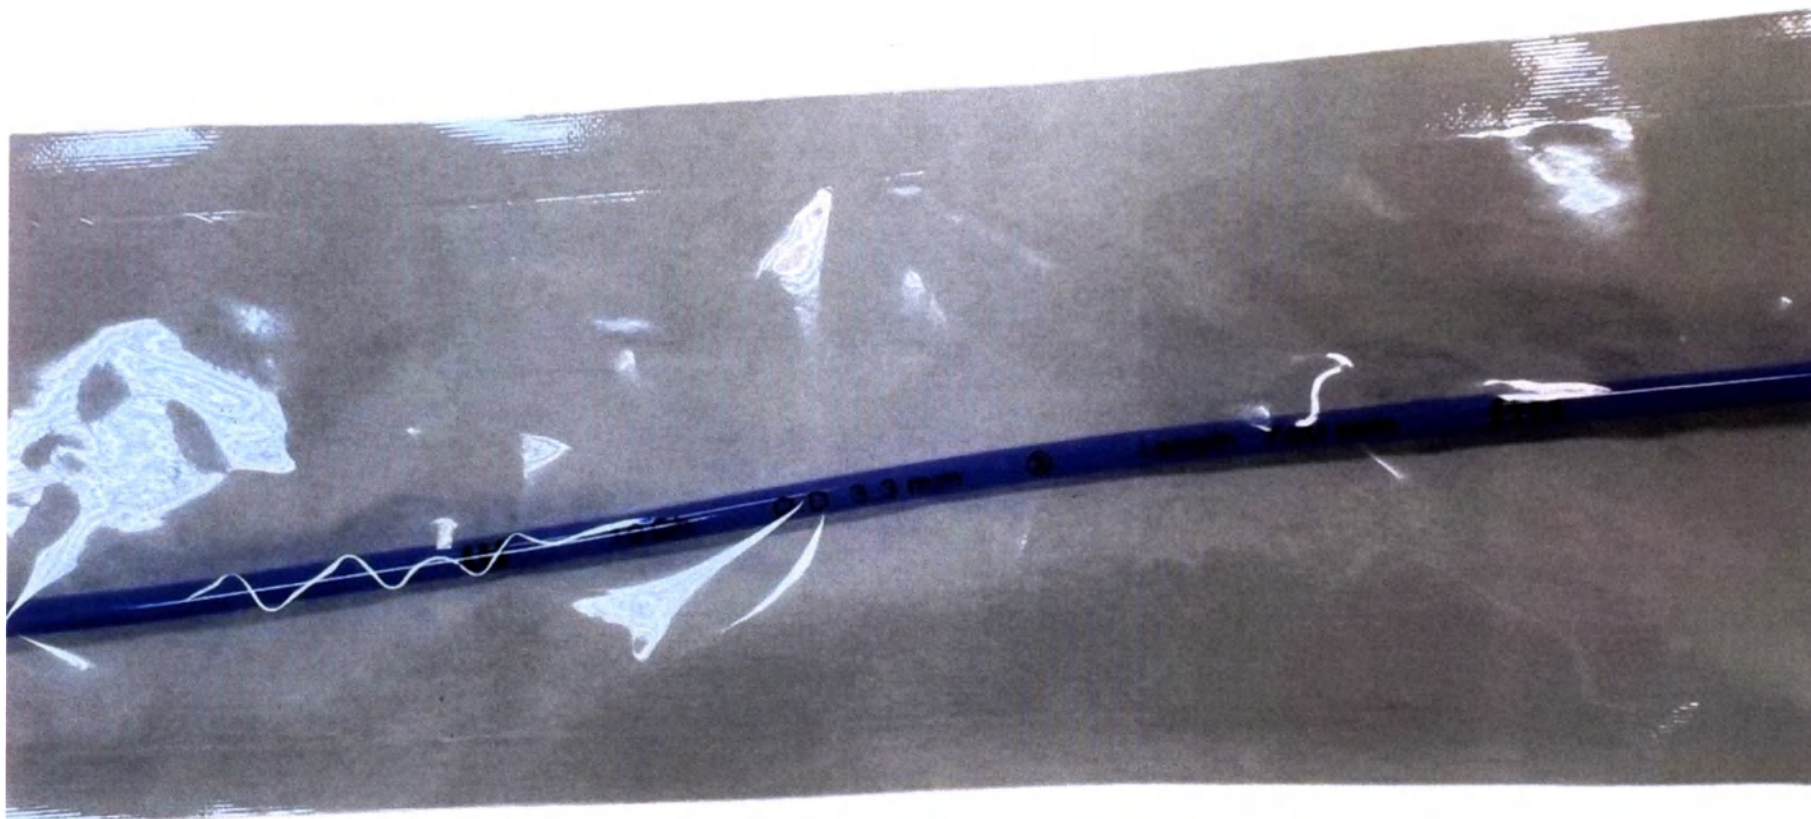


Проводник полый для интубации STATIM Ch/Fr 10



Маркировка изделия Проводник полый для интубации STATIM Ch/Fr 10

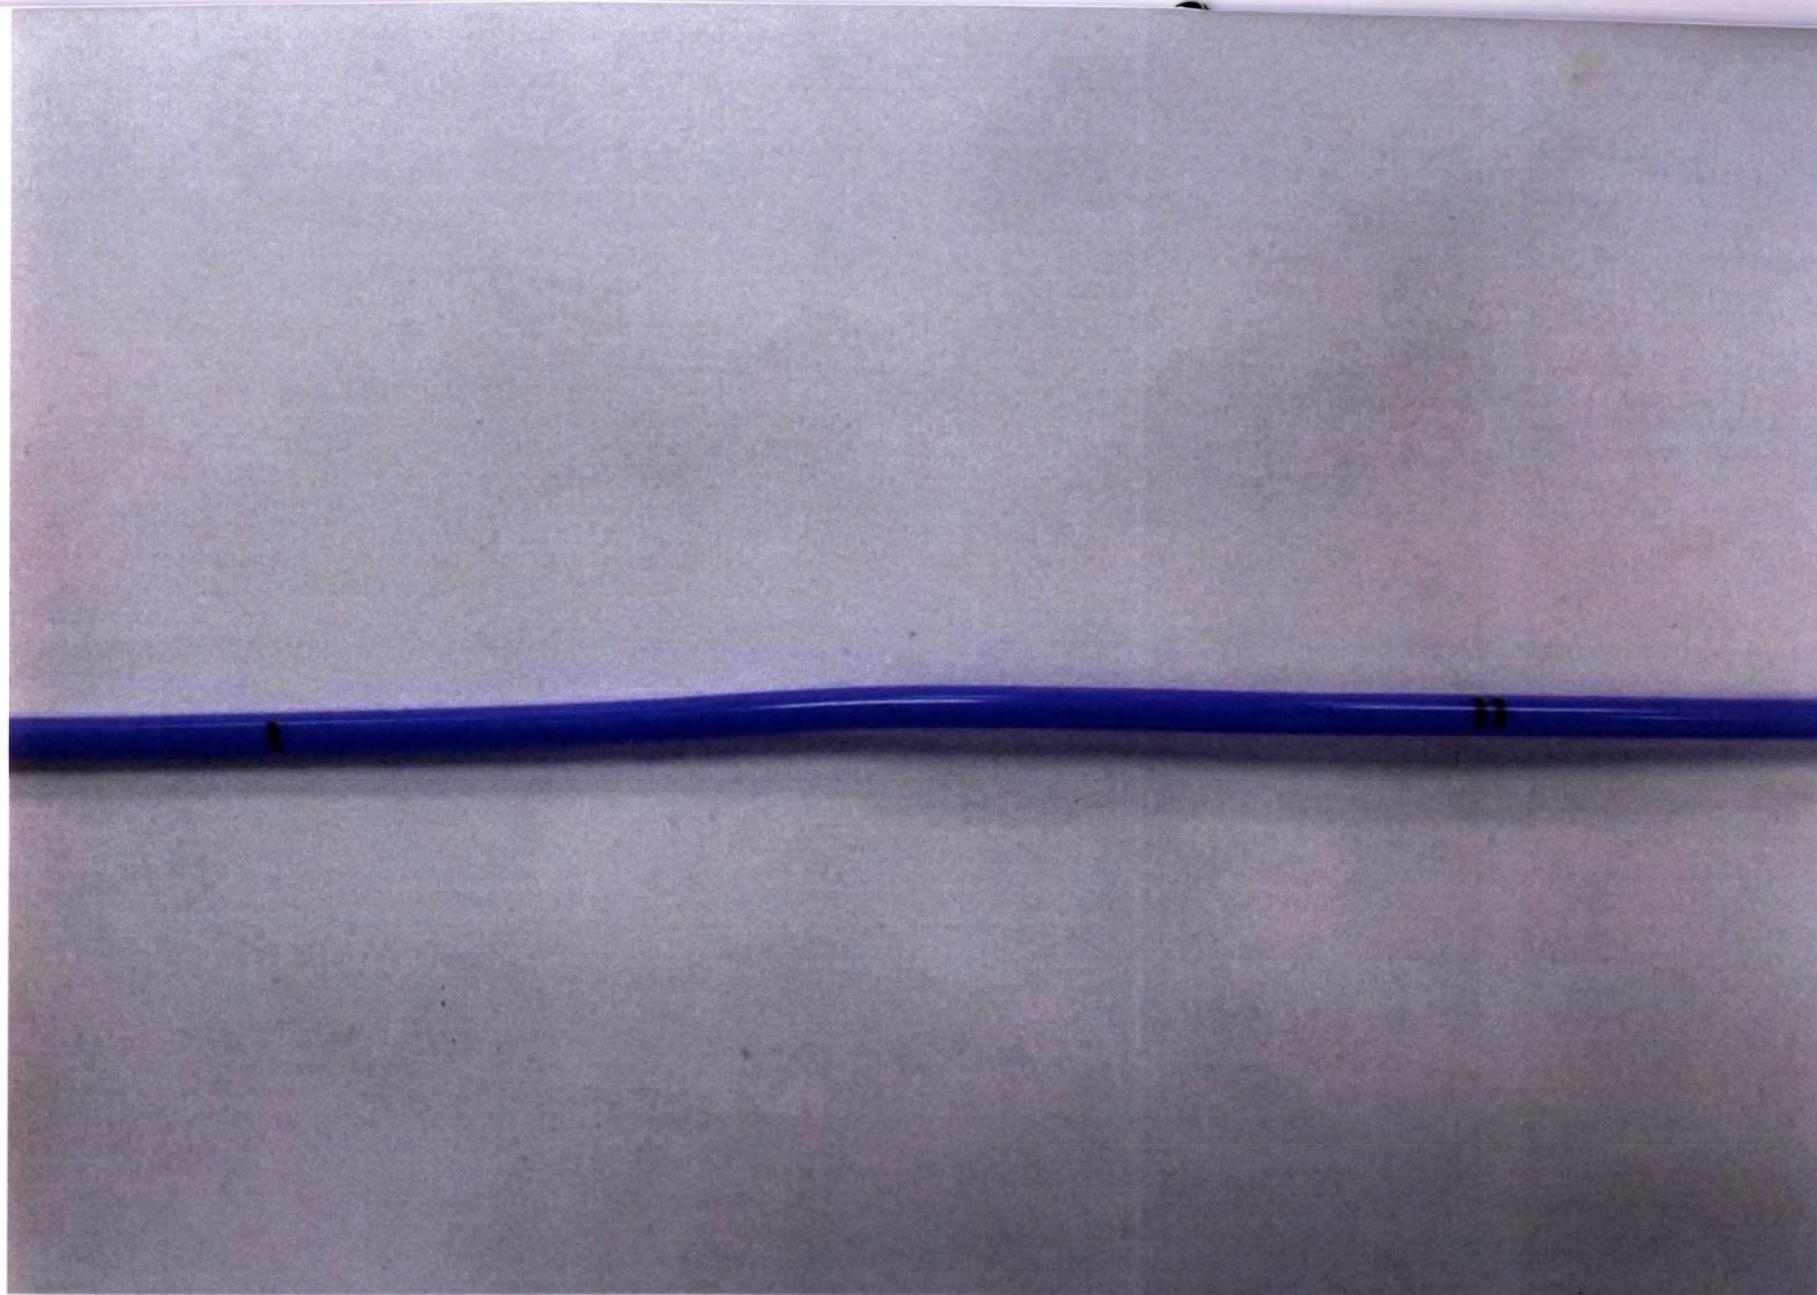

Маркировка изделия Проводник полый для интубации STATIM Ch/Fr 10

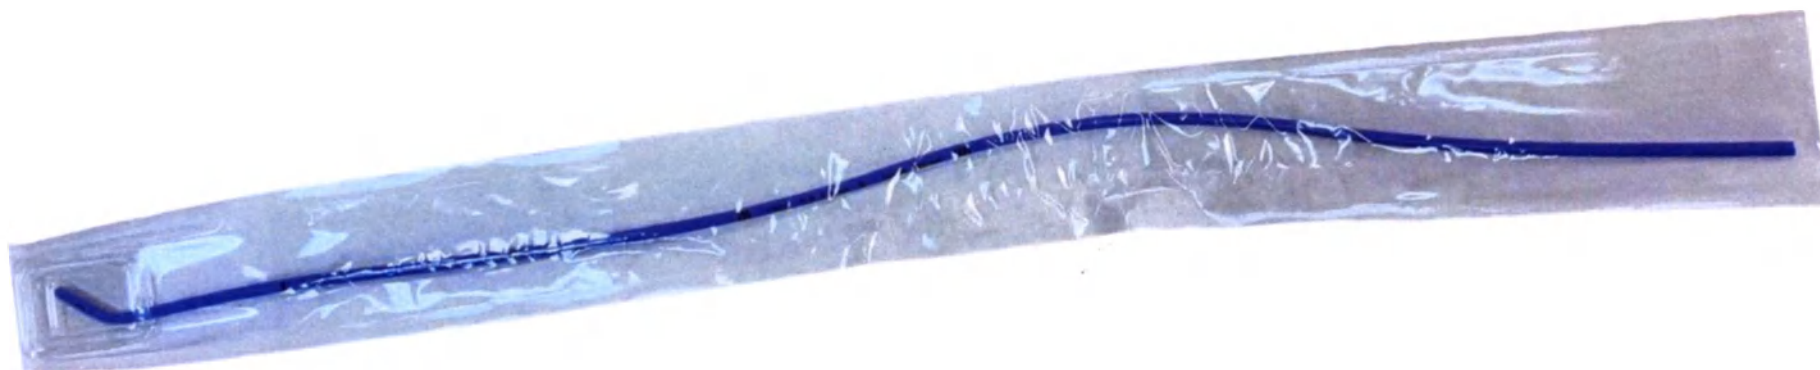


Проводник полый для интубации STATIM Ch/Fr 15




Проводник полый для интубации STATIM Ch/Fr 15



Проводник полый для интубации STATIM Ch/Fr 15

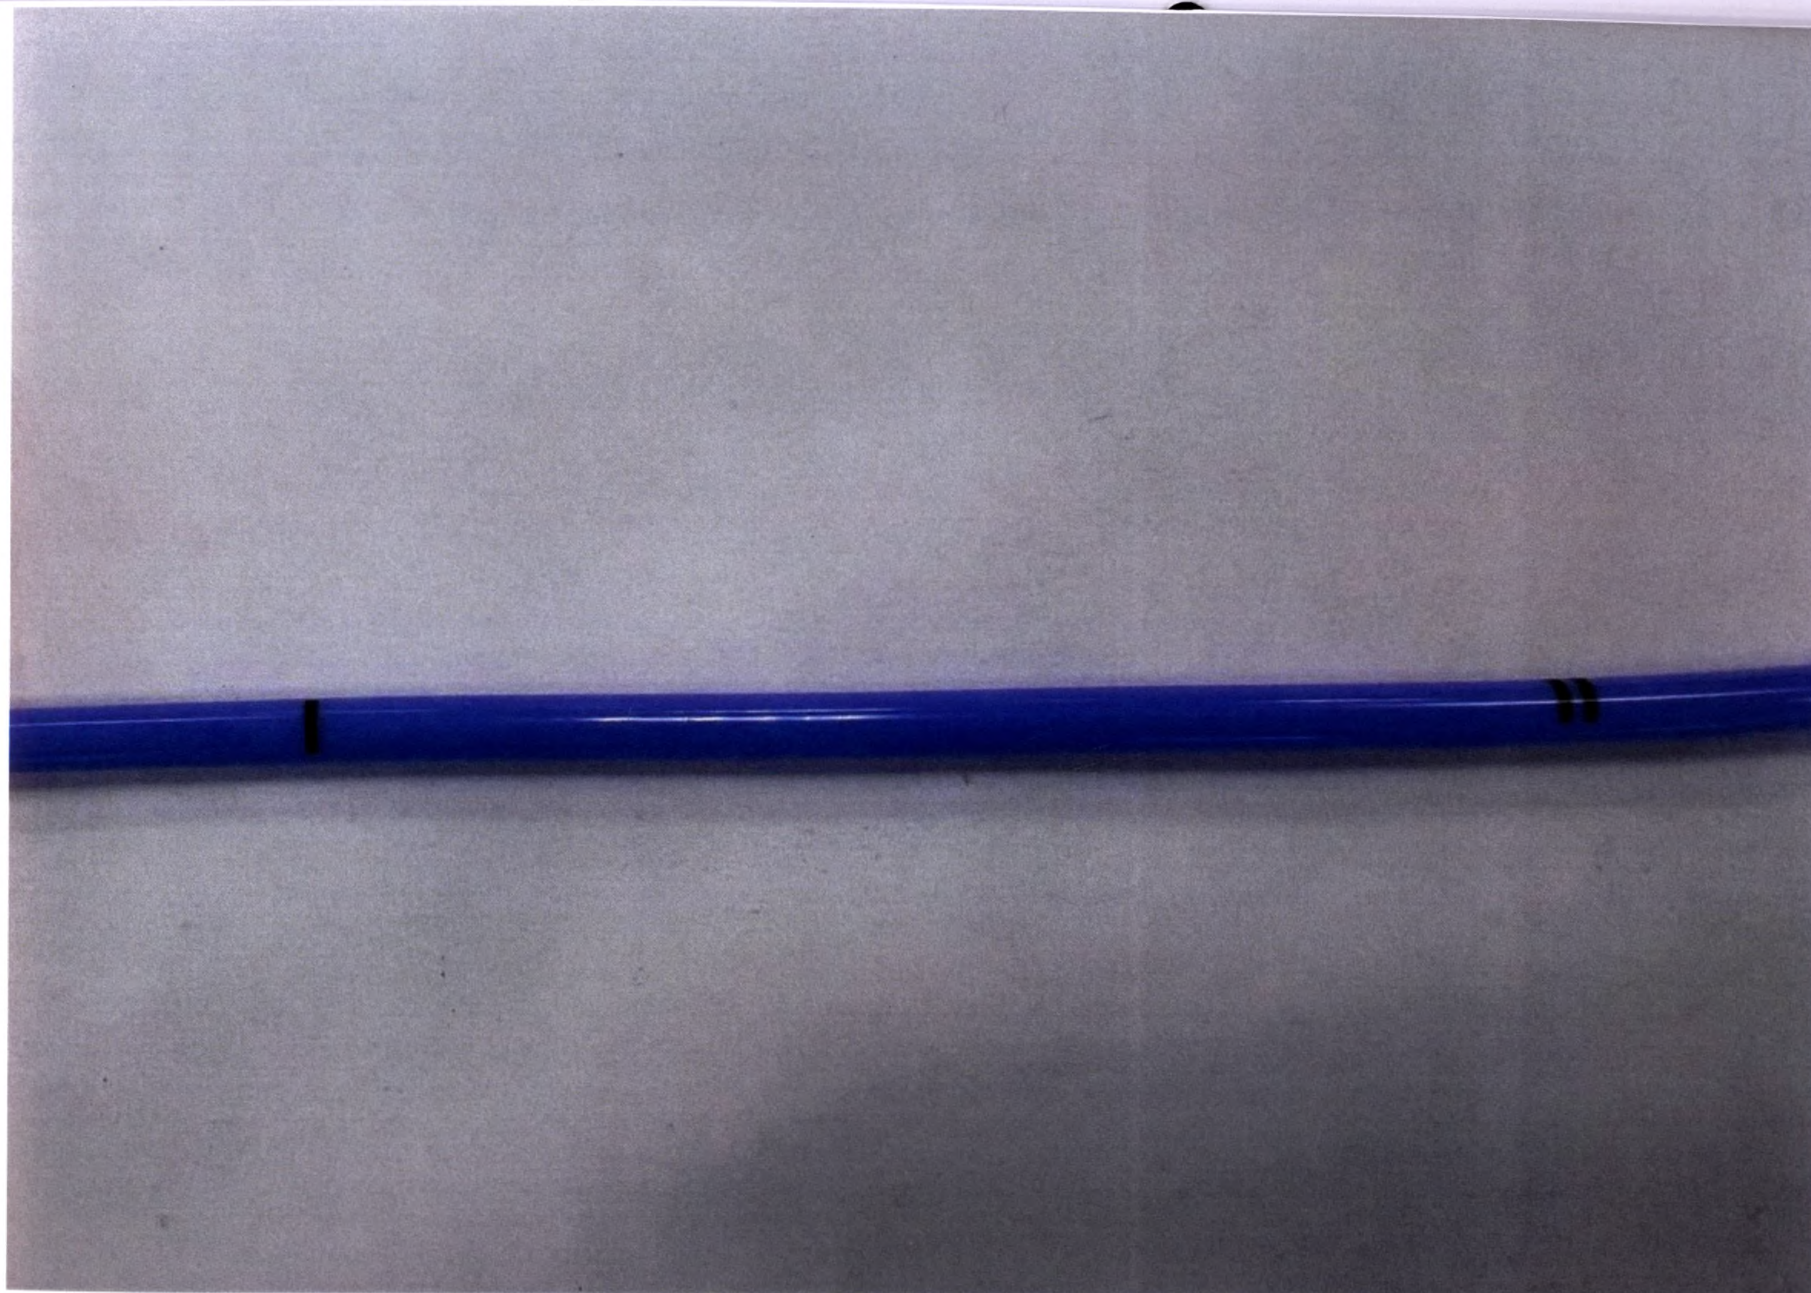

Маркировка изделия Проводник полый для интубации STATIM Ch/Fr 15

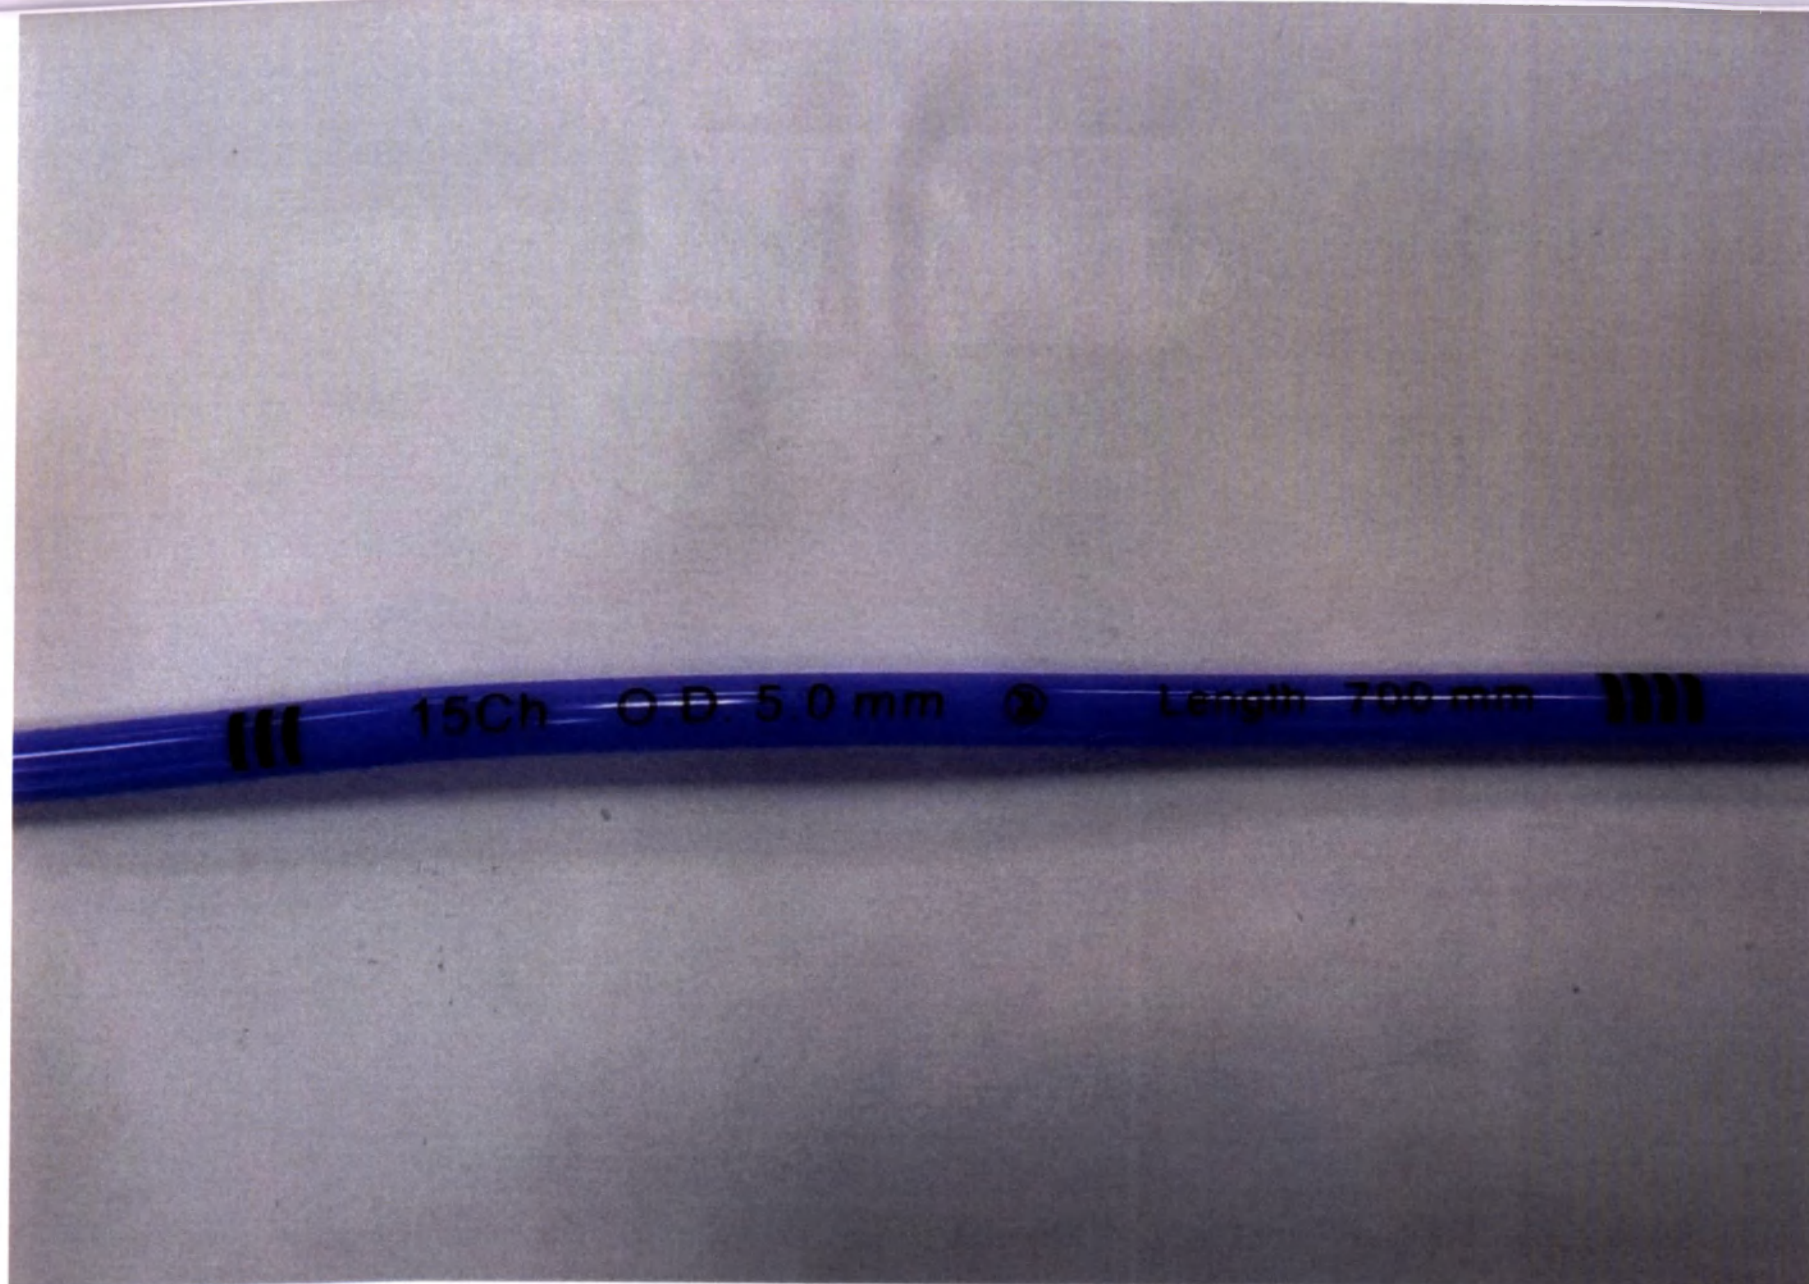


Маркировка изделия Проводник полый для интубации STATIM Ch/Fr 15

Прошито, пронумеровано и
скреплено 30 листов

ООО «РиГ Групп Ко»

Генеральный директор

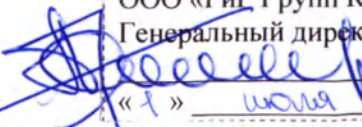 / Г.С.Аллахвердиев

«1» июня 2024 г.

