

ОКПД2 26.60.12.126

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РиГ Групп Ко»

 Г.С. Аллахвердиев/

«5» июня 2024

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Видеоуретерореноскоп гибкий STATIM,
одноразовый, стерильный
по ТУ 26.60.12-010-38044224-2023**

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «РиГ Групп Ко»
199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Санкт-Петербург,
2024

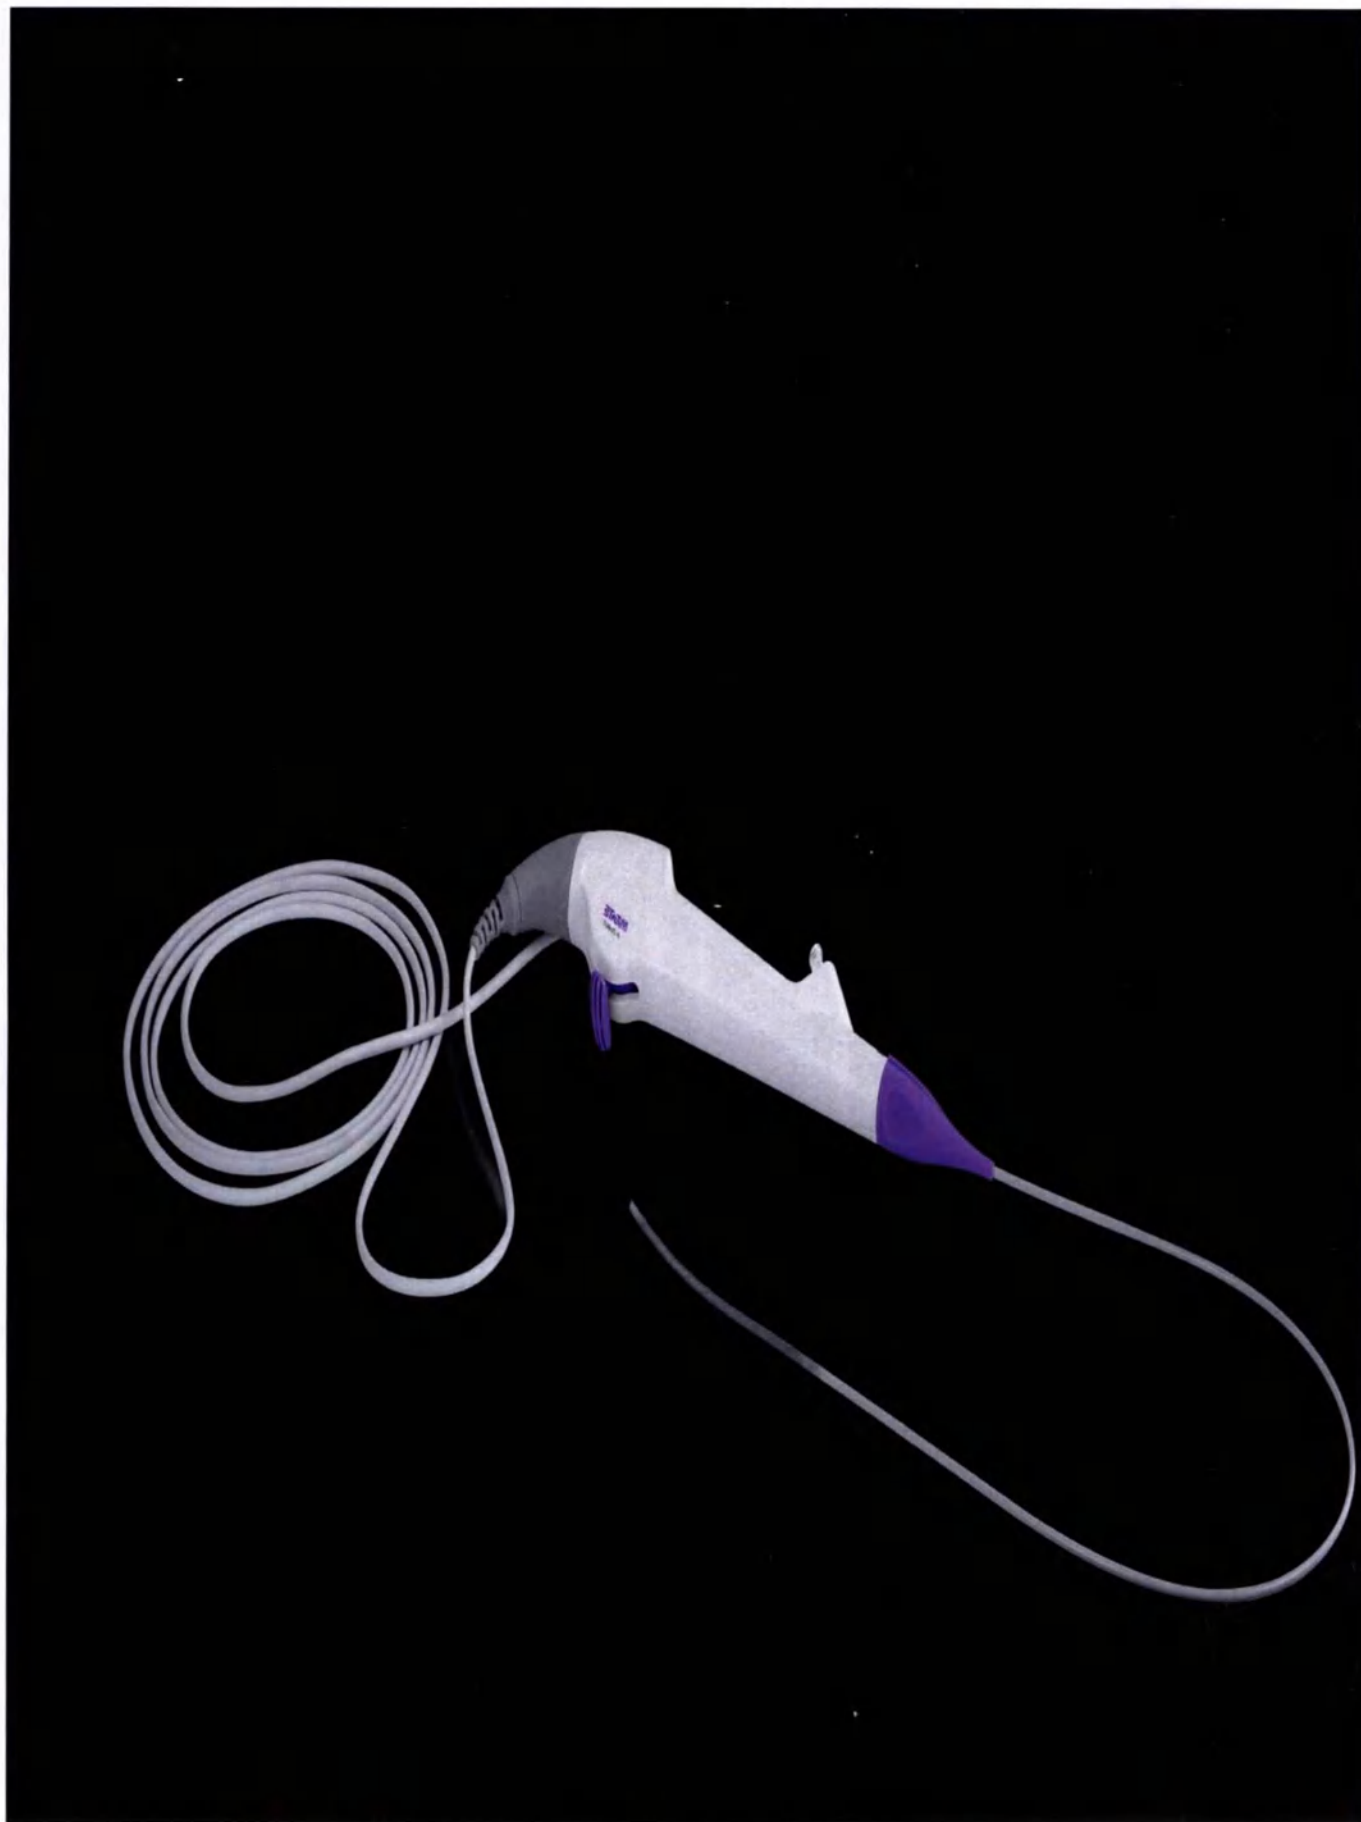


Рисунок 1 – Видеоуретерореноскоп гибкий STATIM, модели SUV-2C-B



Рисунок 2 – Видеоуретерореноскоп гибкий STATIM, модели SUV-2C-B в индивидуальной упаковке



Рисунок 3 – Видеоуретерореноскоп гибкий STATIM, модели SUV-2C-B в индивидуальной упаковке с маркировкой

Видеоретерореноскоп гибкий STATIM, одноразовый, стерильный
по ТУ 26.60.12-010-38044224-2023

Видеоретерореноскоп STATIM, модель SUV-2C-B – 1 штука



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50.

Адрес места

Scivita Medical Technology Co., Ltd.,

производства:

No.2, Qingqiu Street, Suzhou Industrial Park, 215000 Suzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.



03.04.2024



2024021301



02.04.2027

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °C до +35 °C, относительная влажность 80% при температуре плюс 25 °C и атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не более 80% при 25 °C, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: видеоретерореноскопы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а видеоретерореноскопы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

РУ №от.....

IPX8



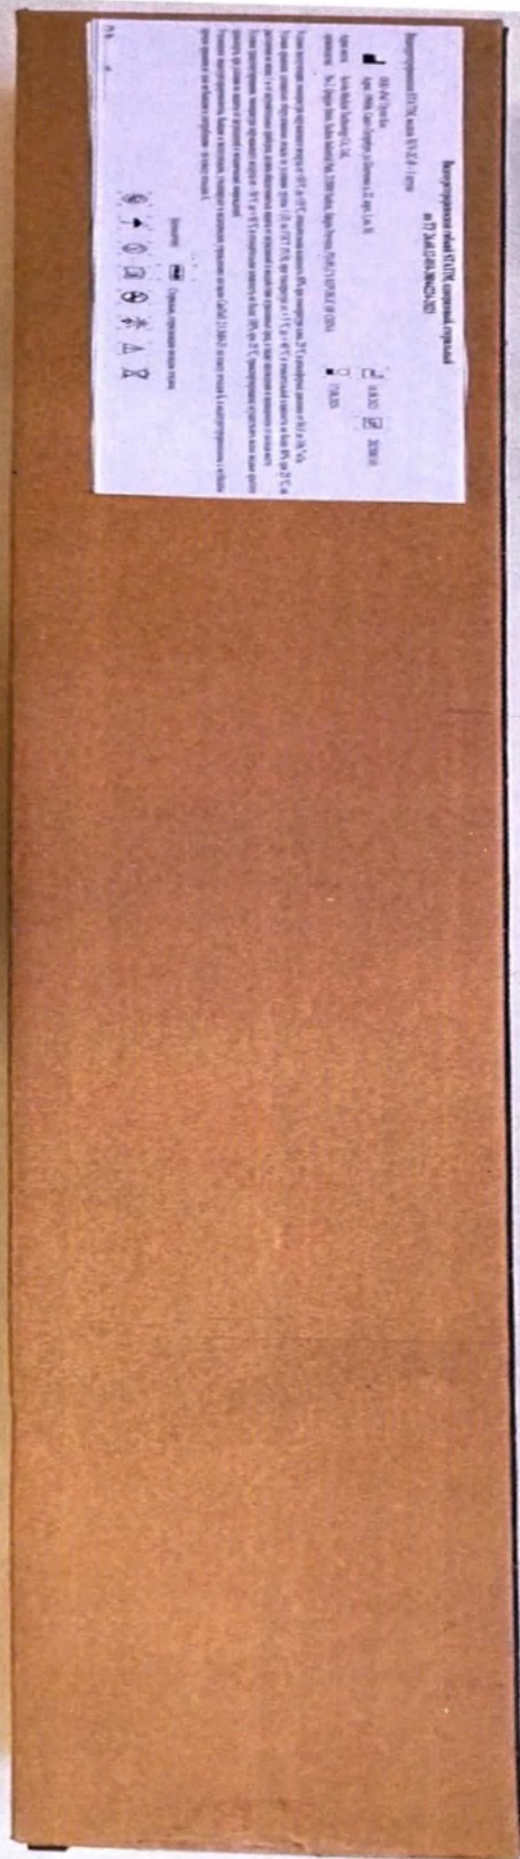


Рисунок 5 – Видеоуретерореноскоп гибкий STATIM, модели SUV-2C-B в потребительской упаковке с маркировкой

Видеоретерореноскоп гибкий STATIM, одноразовый, стерильный
по ТУ 26.60.12-010-38044224-2023

Видеоретерореноскоп STATIM, модель SUV-2C-B – 1 штука



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50.

Адрес места
производства:

Scivita Medical Technology Co., Ltd.,
No.2, Qingqiu Street, Suzhou Industrial Park, 215000 Suzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.



03.04.2024



2024021301



02.04.2027

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С, относительная влажность 80% при температуре плюс 25 °С и атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: видеоретерореноскопы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а видеоретерореноскопы с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена



РУ №от.....



Рисунок 7 – Транспортная упаковка Видеоуретерореноскопа гибкого STATIM, модели SUV-2C-B



Рисунок 8 - Маркировка транспортной упаковки Видеоуретероскопа гибкого STATIM, модели SUV-2C-B

Прошито, пронумеровано и
скреплено 9 листов

ООО «РиГ Групп Ко»

Генеральный директор

Г.С.Аллахвердиев

2024. г



ОКПД2 26.60.12.126

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РиГ Групп Ко»

 Г.С. Аллахвердиев /

«5» июня 2024 г.



**МАКЕТ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Видеоуретерореноскоп гибкий STATIM,
одноразовый, стерильный
по ТУ 26.60.12-010-38044224-2023**

Производства: ООО «РиГ Групп Ко», Россия
199406, Санкт-Петербург, ул Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50.

г. Санкт-Петербург,
2024 г.

Макет маркировки индивидуальной упаковки видеоуретерореноскопа

Видеоуретерореноскоп гибкий STATIM, одноразовый, стерильный
по ТУ 26.60.12-010-38044224-2023

Видеоуретерореноскоп STATIM, модель SUV-2C-B – 1 штука

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50.
Адрес места
производ-
ства: **ООО «РиГ Групп Ко», 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п.,**
тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1
Scivita Medical Technology Co., Ltd.,
No.2, Qingqiu Street, Suzhou Industrial Park, 215000 Suzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA.

 03.04.2024  2024021301
 02.04.2027

Нетоксично

 Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С, относительная влажность 80% при температуре плюс 25 °С и атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: видеоуретерореноскопы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а видеоуретерореноскопы с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

IPX8 

РУ №от.....



Макет маркировки потребительской упаковки видеоуретерореноскопа

Видеоуретерореноскоп гибкий STATIM, одноразовый, стерильный
по ТУ 26.60.12-010-38044224-2023

Видеоуретерореноскоп STATIM, модель SUV-2C-B – 1 штука


Адрес места
производ-
ства:

ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул Шевченко д. 22, корп. 1, кв. 50.

ООО «РиГ Групп Ко», 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Вылюзское г. п.,
тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1

Scivita Medical Technology Co., Ltd.,

No.2, Qingqiu Street, Suzhou Industrial Park, 215000 Suzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF
CHINA.



03.04.2024

LOT

2024021301



02.04.2027

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С, относительная влажность 80% при температуре плюс 25 °С и атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: видеоуретерореноскопы, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а видеоуретерореноскопы с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена



РУ №от.....

Макет маркировки транспортной упаковки видеоуретерореноскопа

Видеоуретерореноскоп гибкий STATIM, одноразовый, стерильный по ТУ 26.60.12-010-38044224-2023

Видеоуретерореноскоп STATIM, модель SUV-2C-B – 22 штуки.



ООО «РнГ Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% при 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от – 50 °С до + 50 °С и относительная влажность не более 100% при 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



03.04.2024



02.04.2027




2024021301



Прошито, пронумеровано и
скреплено 4 листов

ООО «РиГ Групп Ко»

Генеральный директор

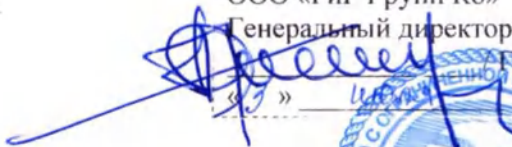 С.Аллахвердиев
«12» Июня 2022 г.

