


ОКПД2 32.50.21.129

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «РиГ Групп Ко»**


И.С. Аллахвердиев/
«3» июня 2024

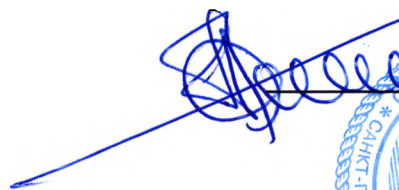


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «РиГ Групп Ко»
199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50


Санкт-Петербург,
2024

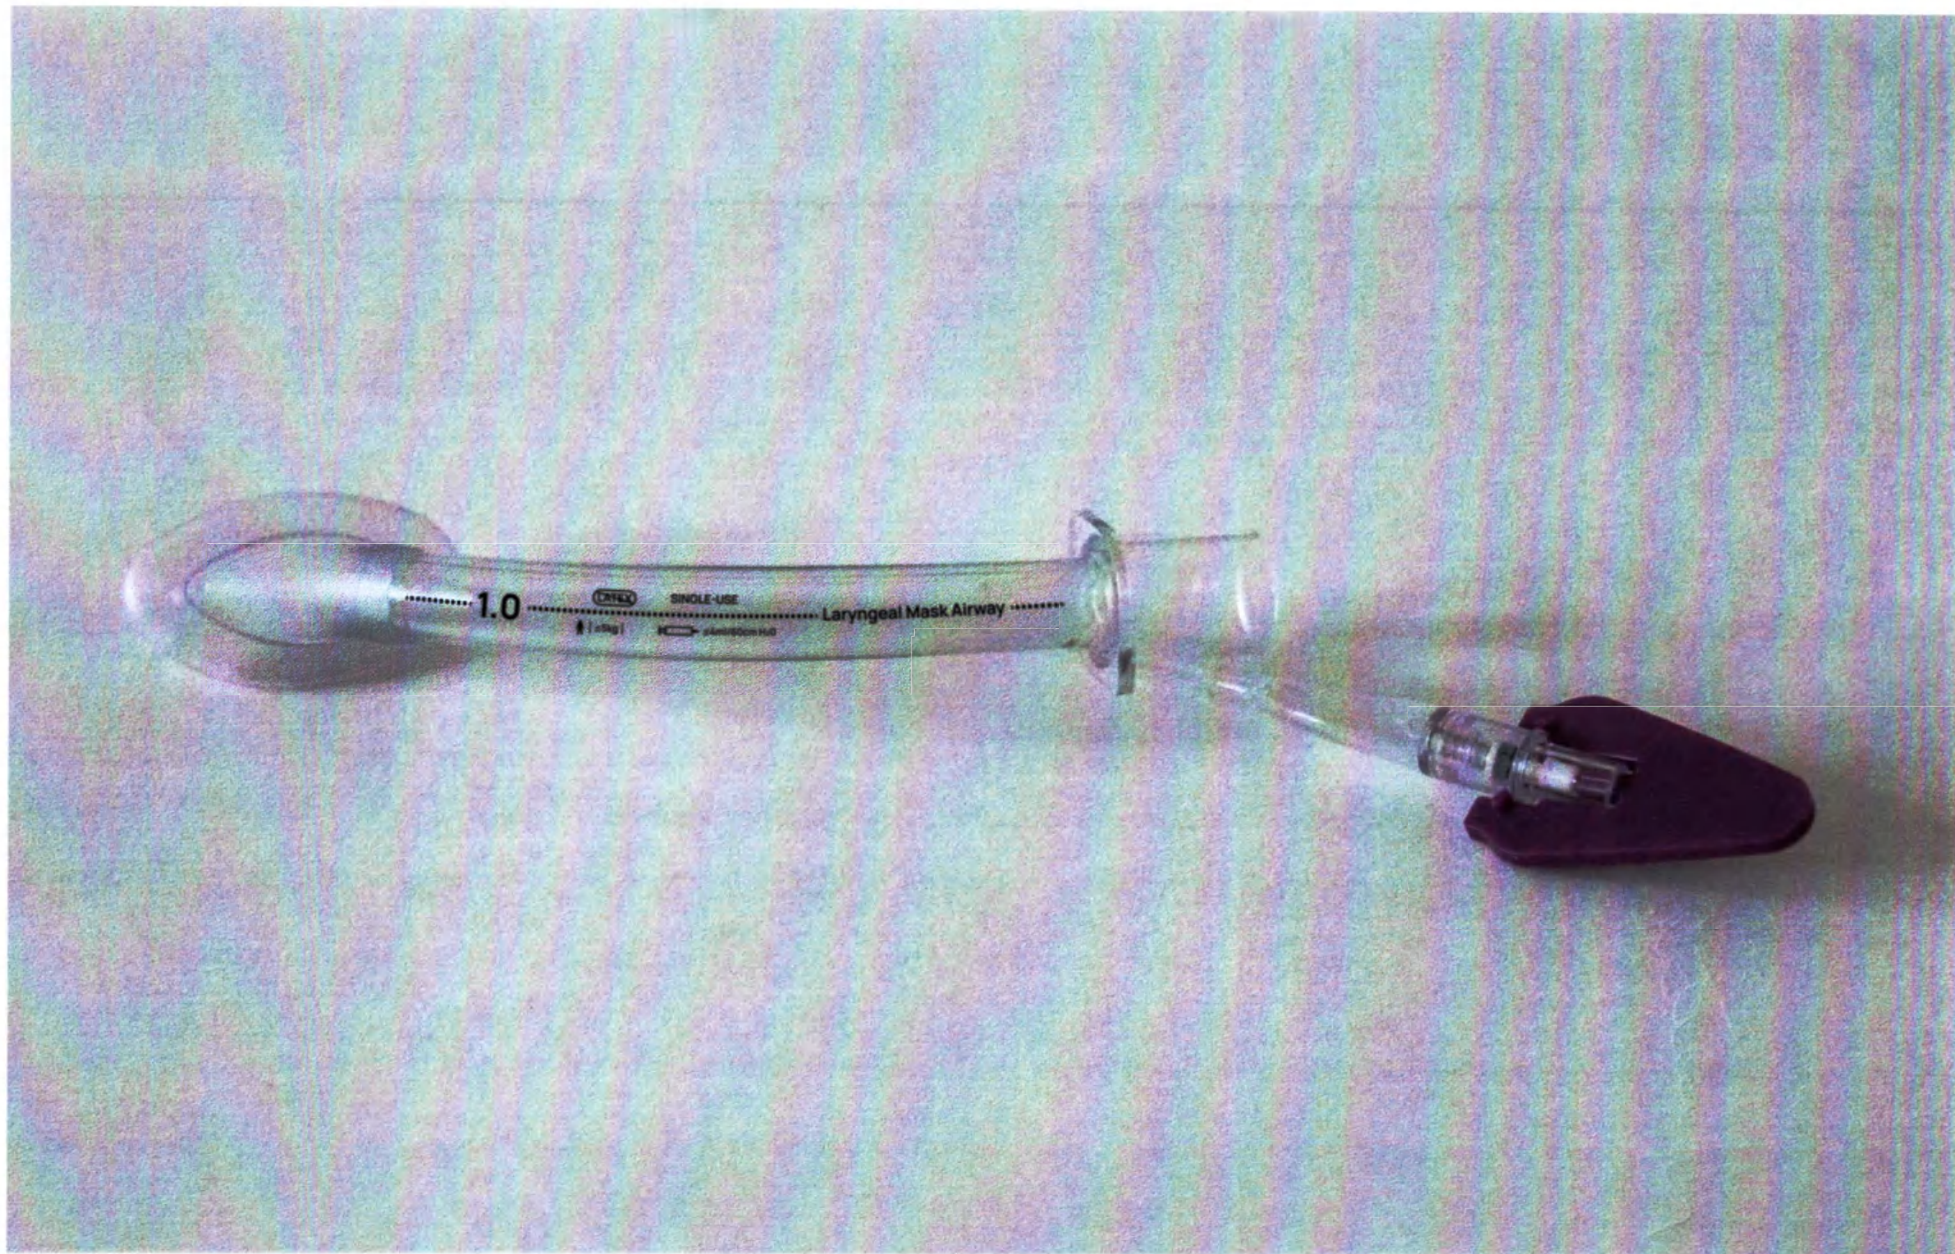


Маска ларингеальная STATIM, размер 1,0

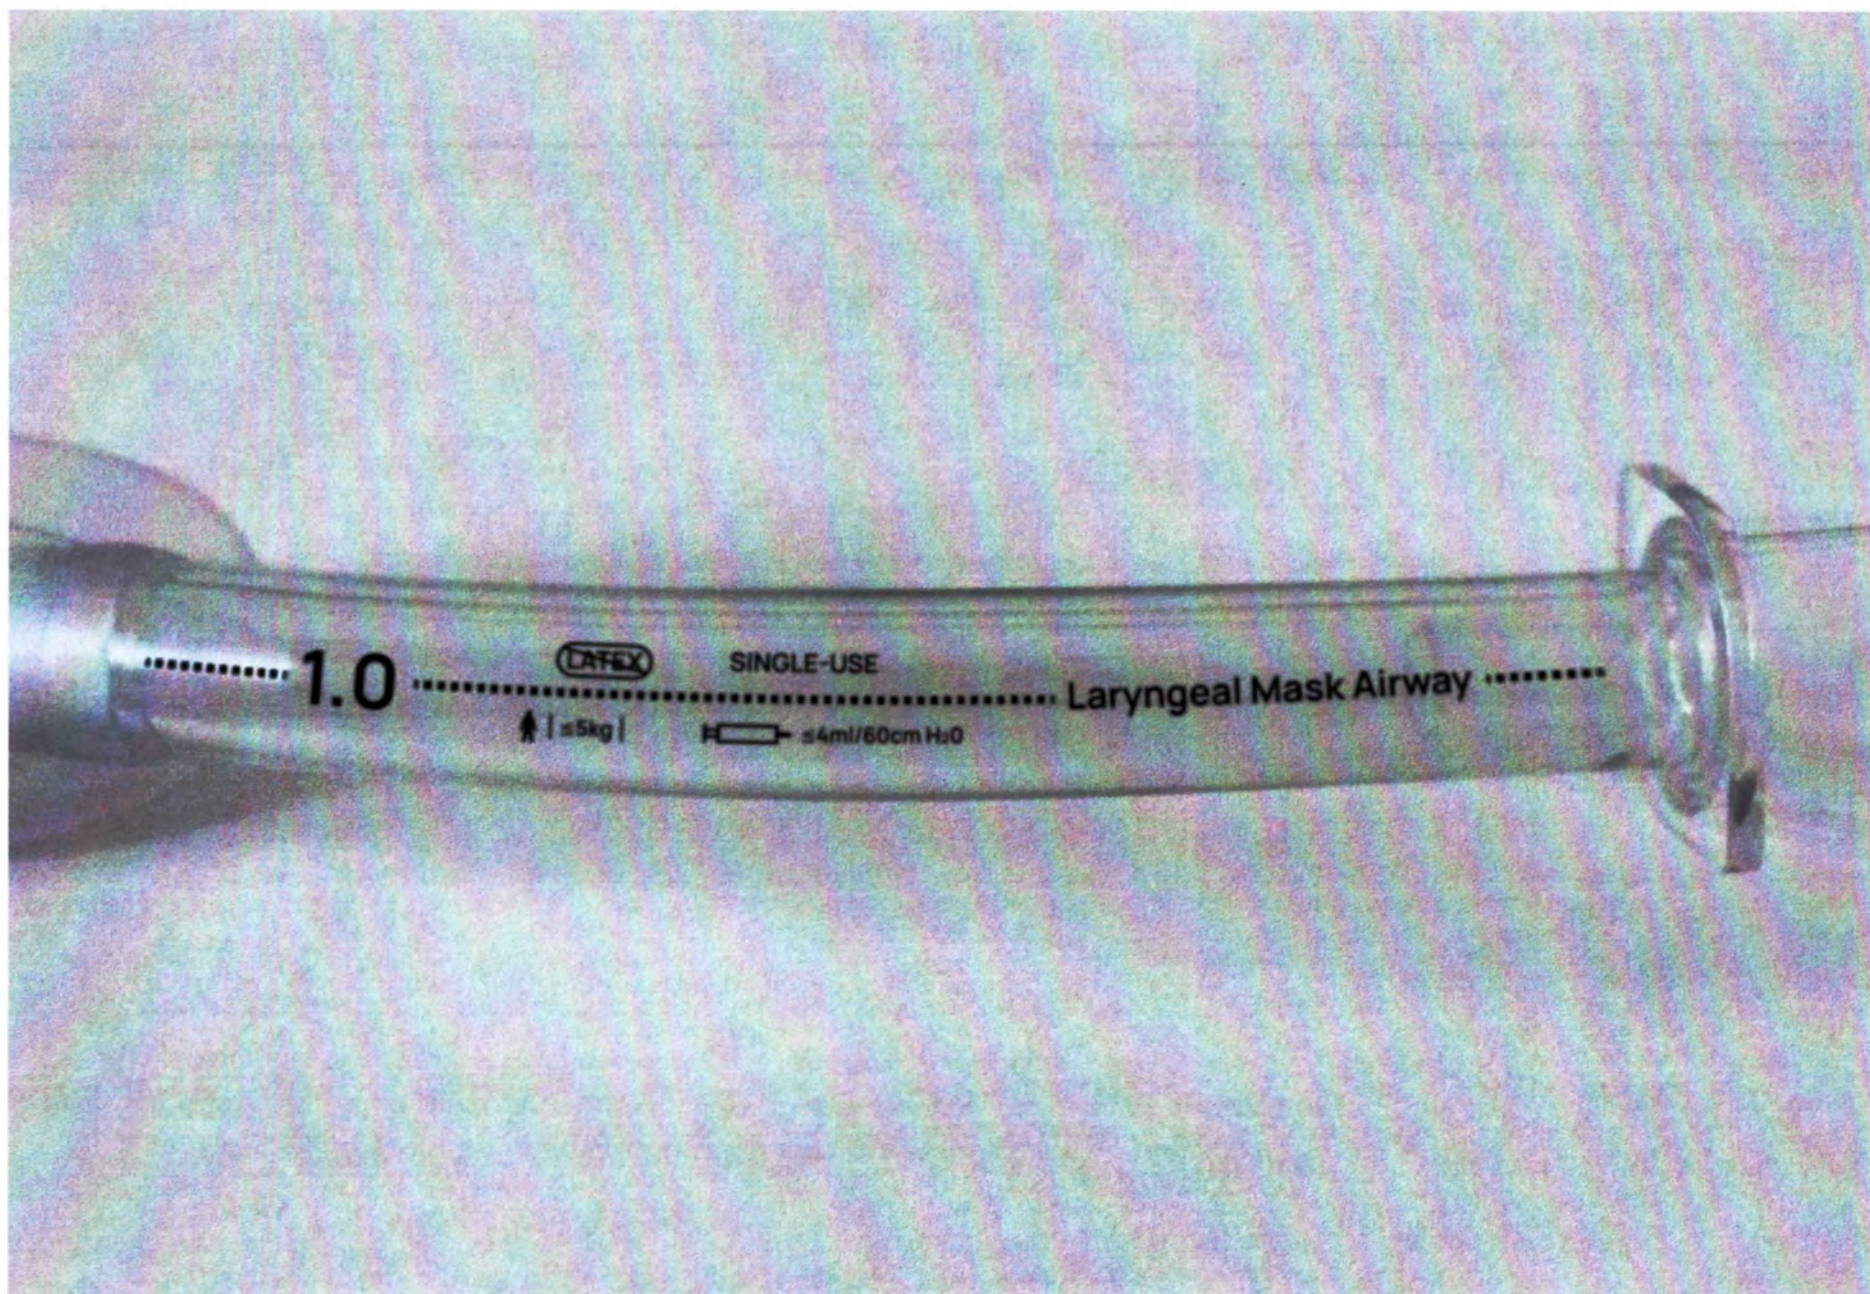


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM, размер 1,0

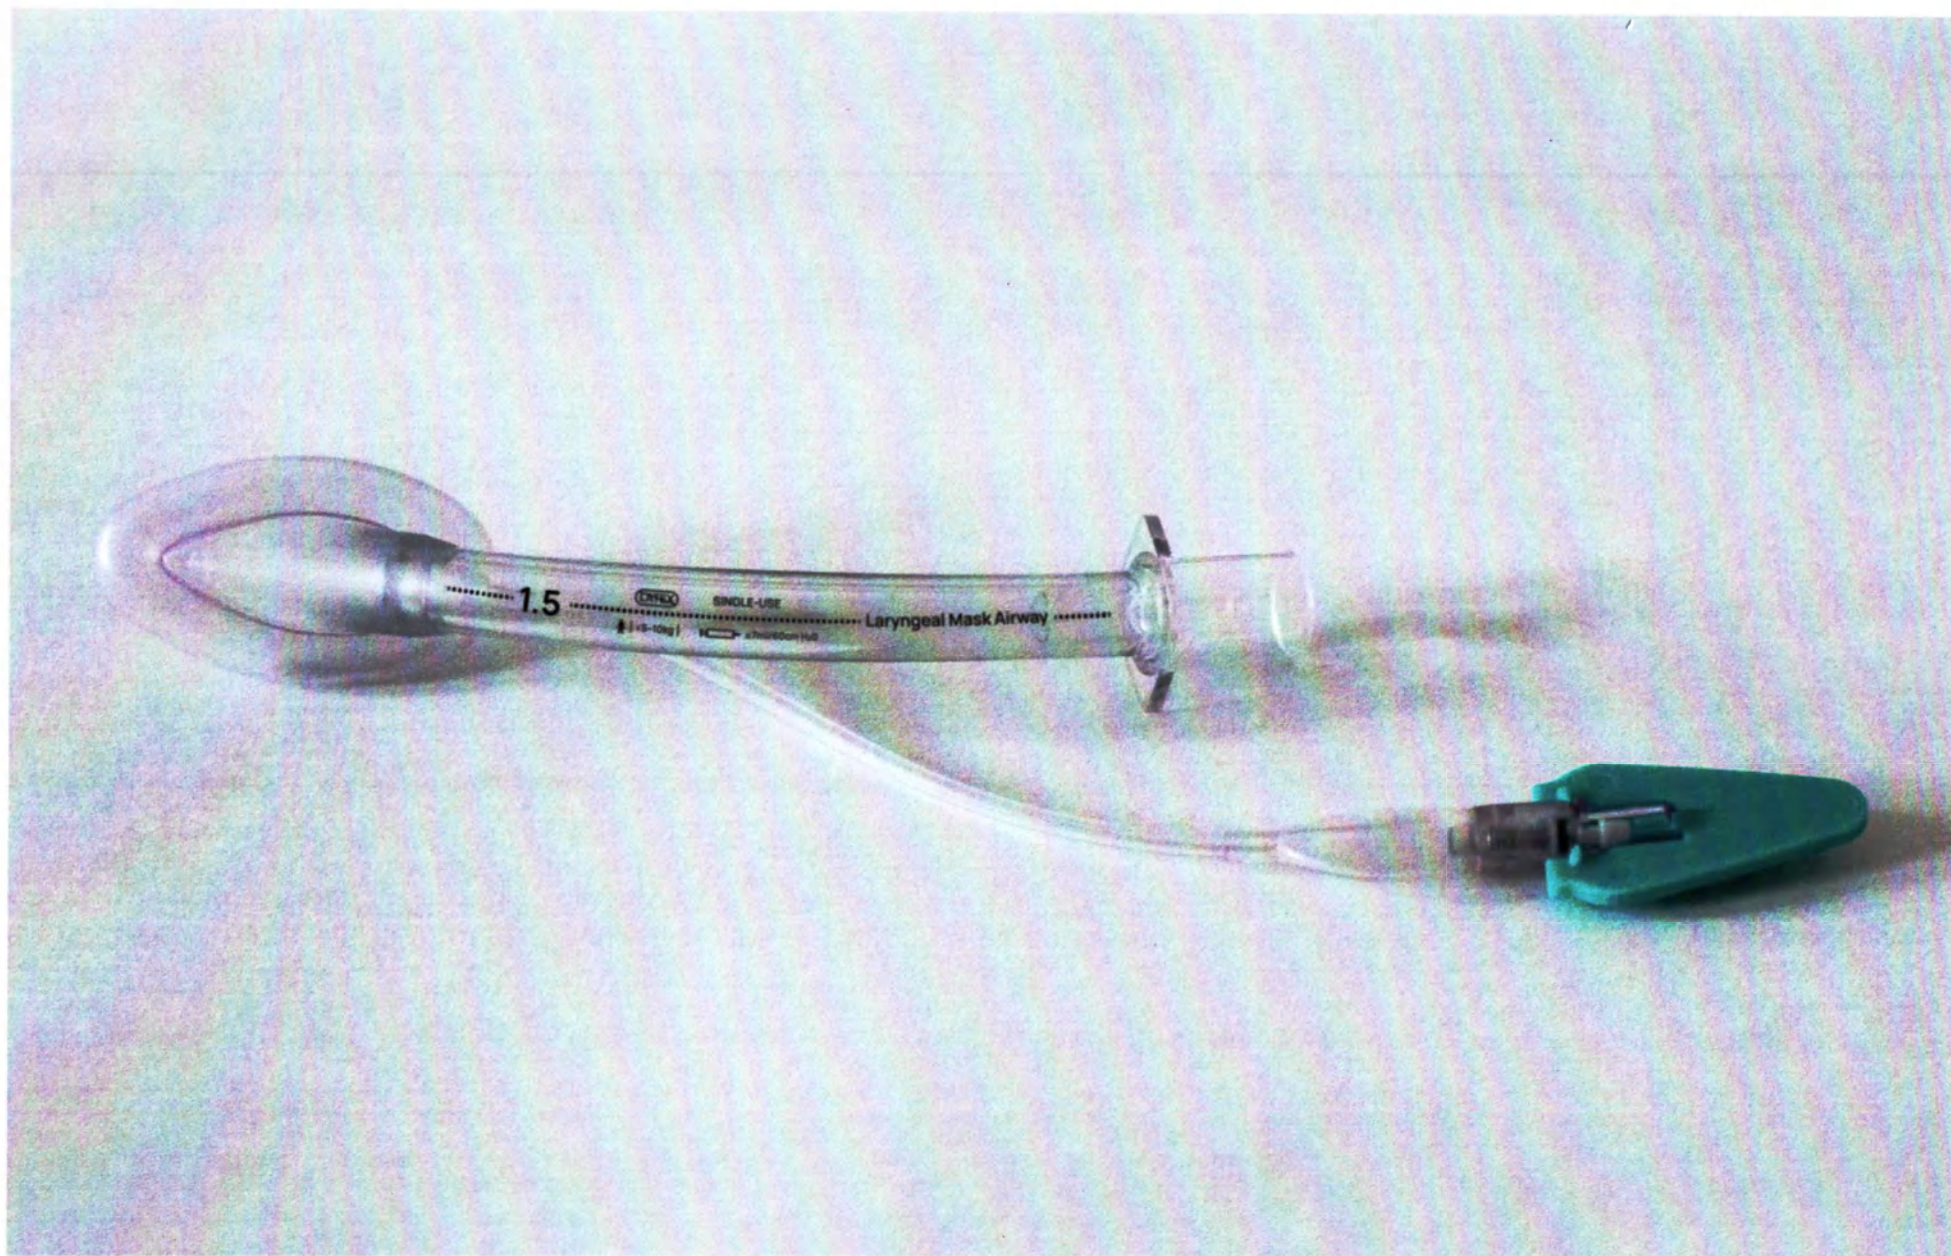


Маска ларингеальная STATIM, размер 1,5

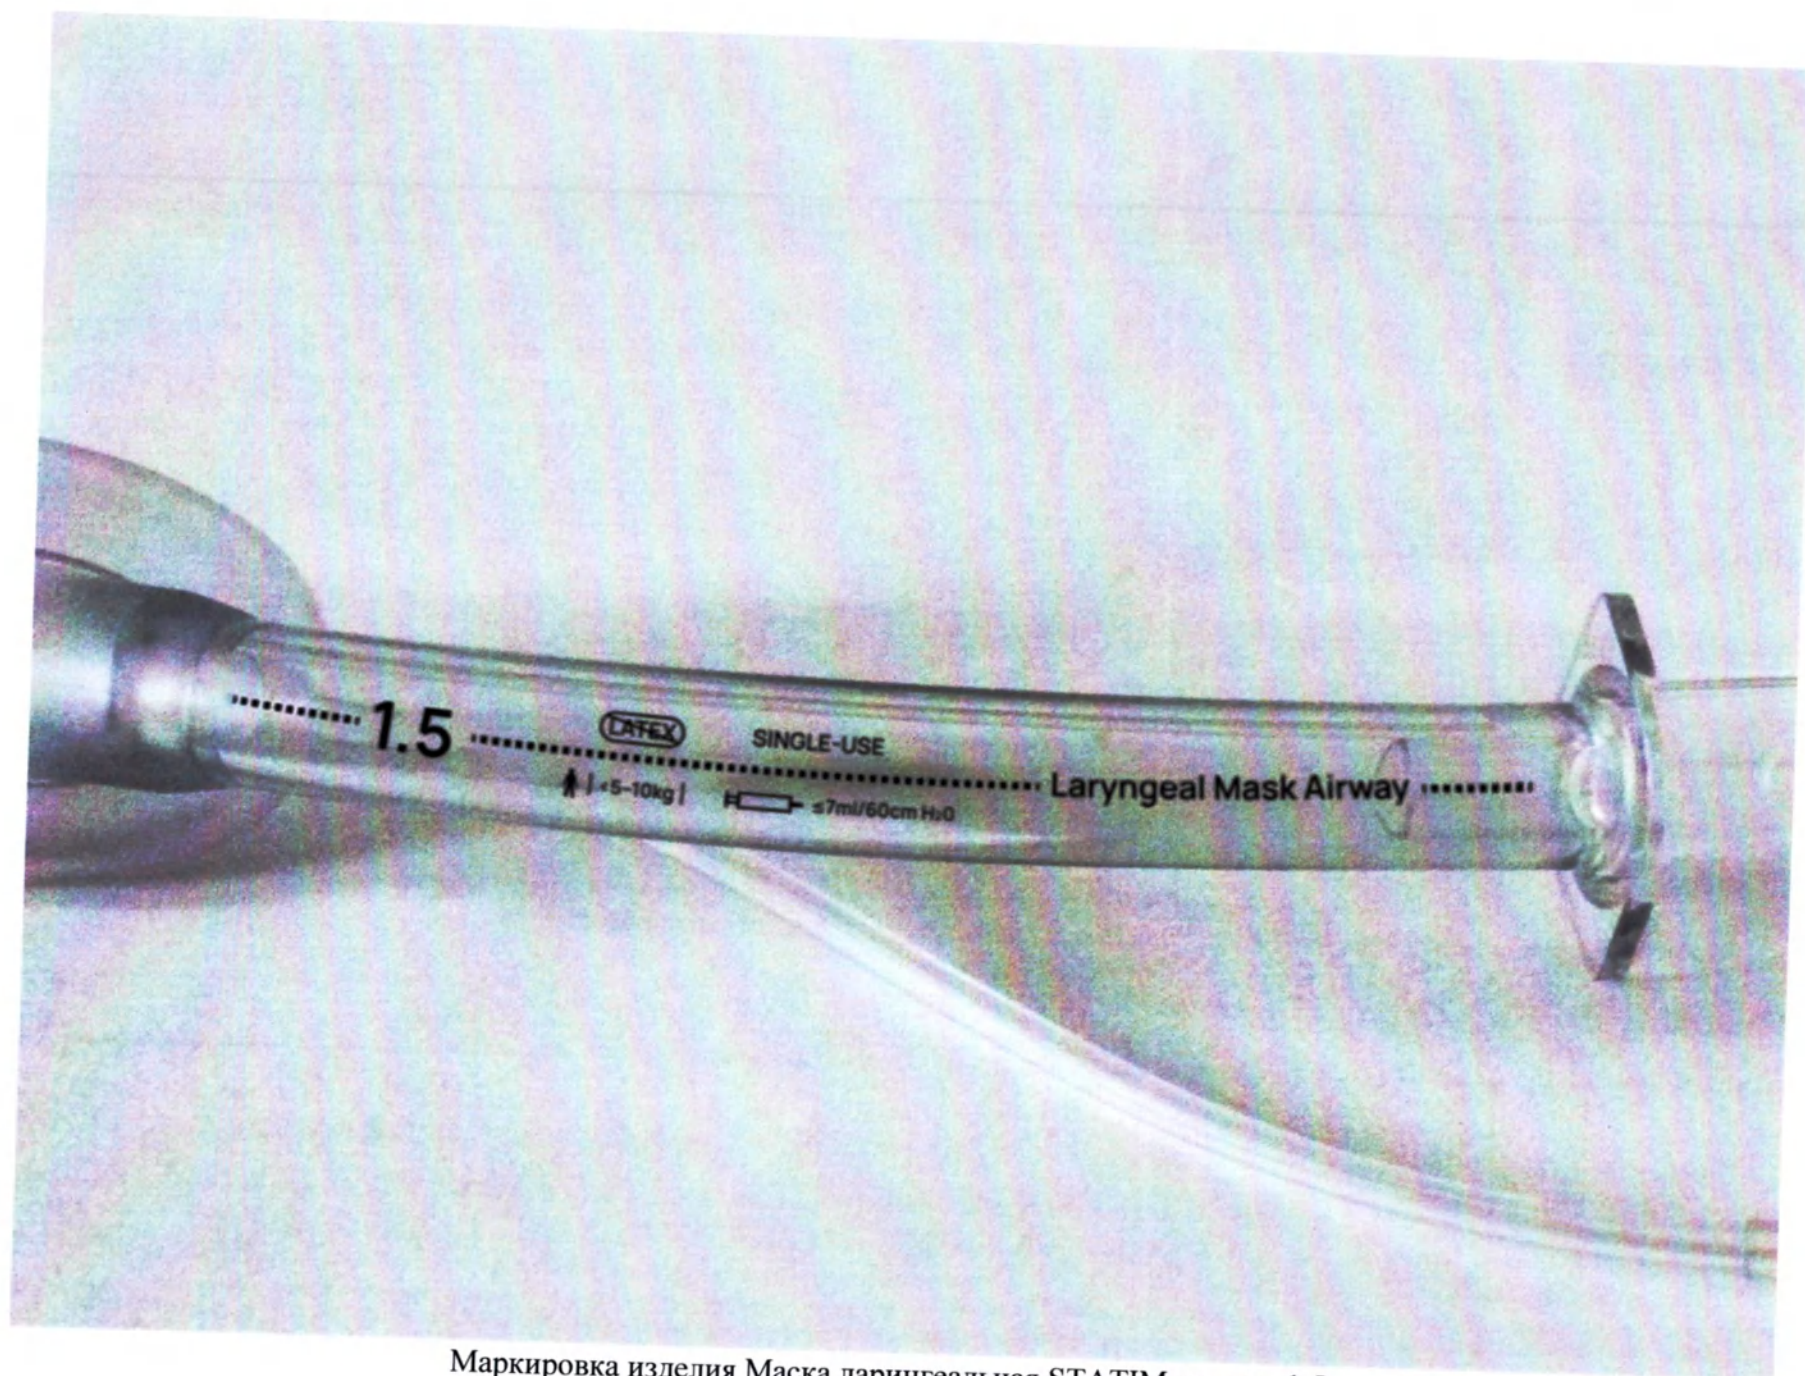


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM, размер 1,5

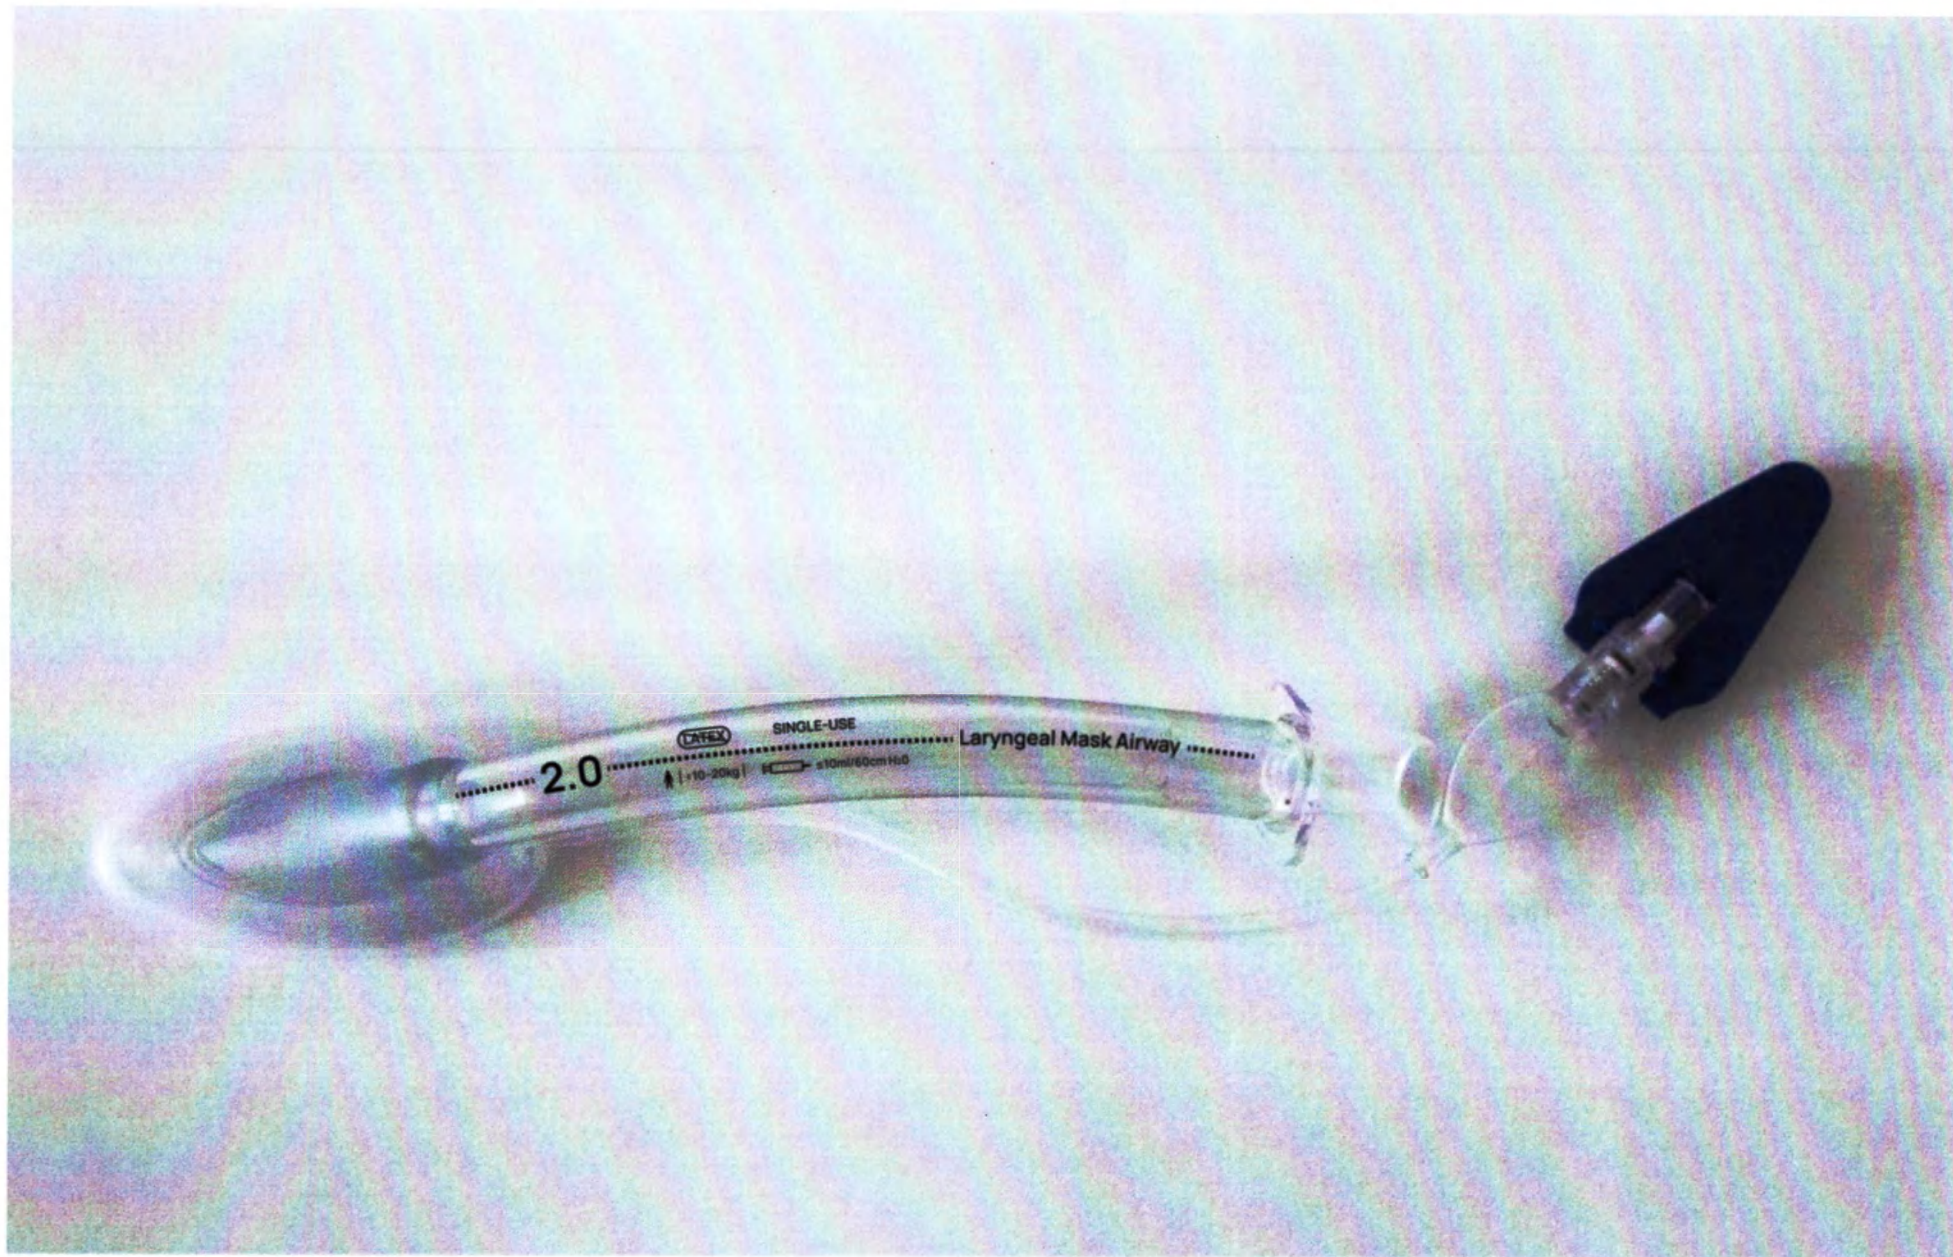


Маска ларингеальная STATIM, размер 2,0

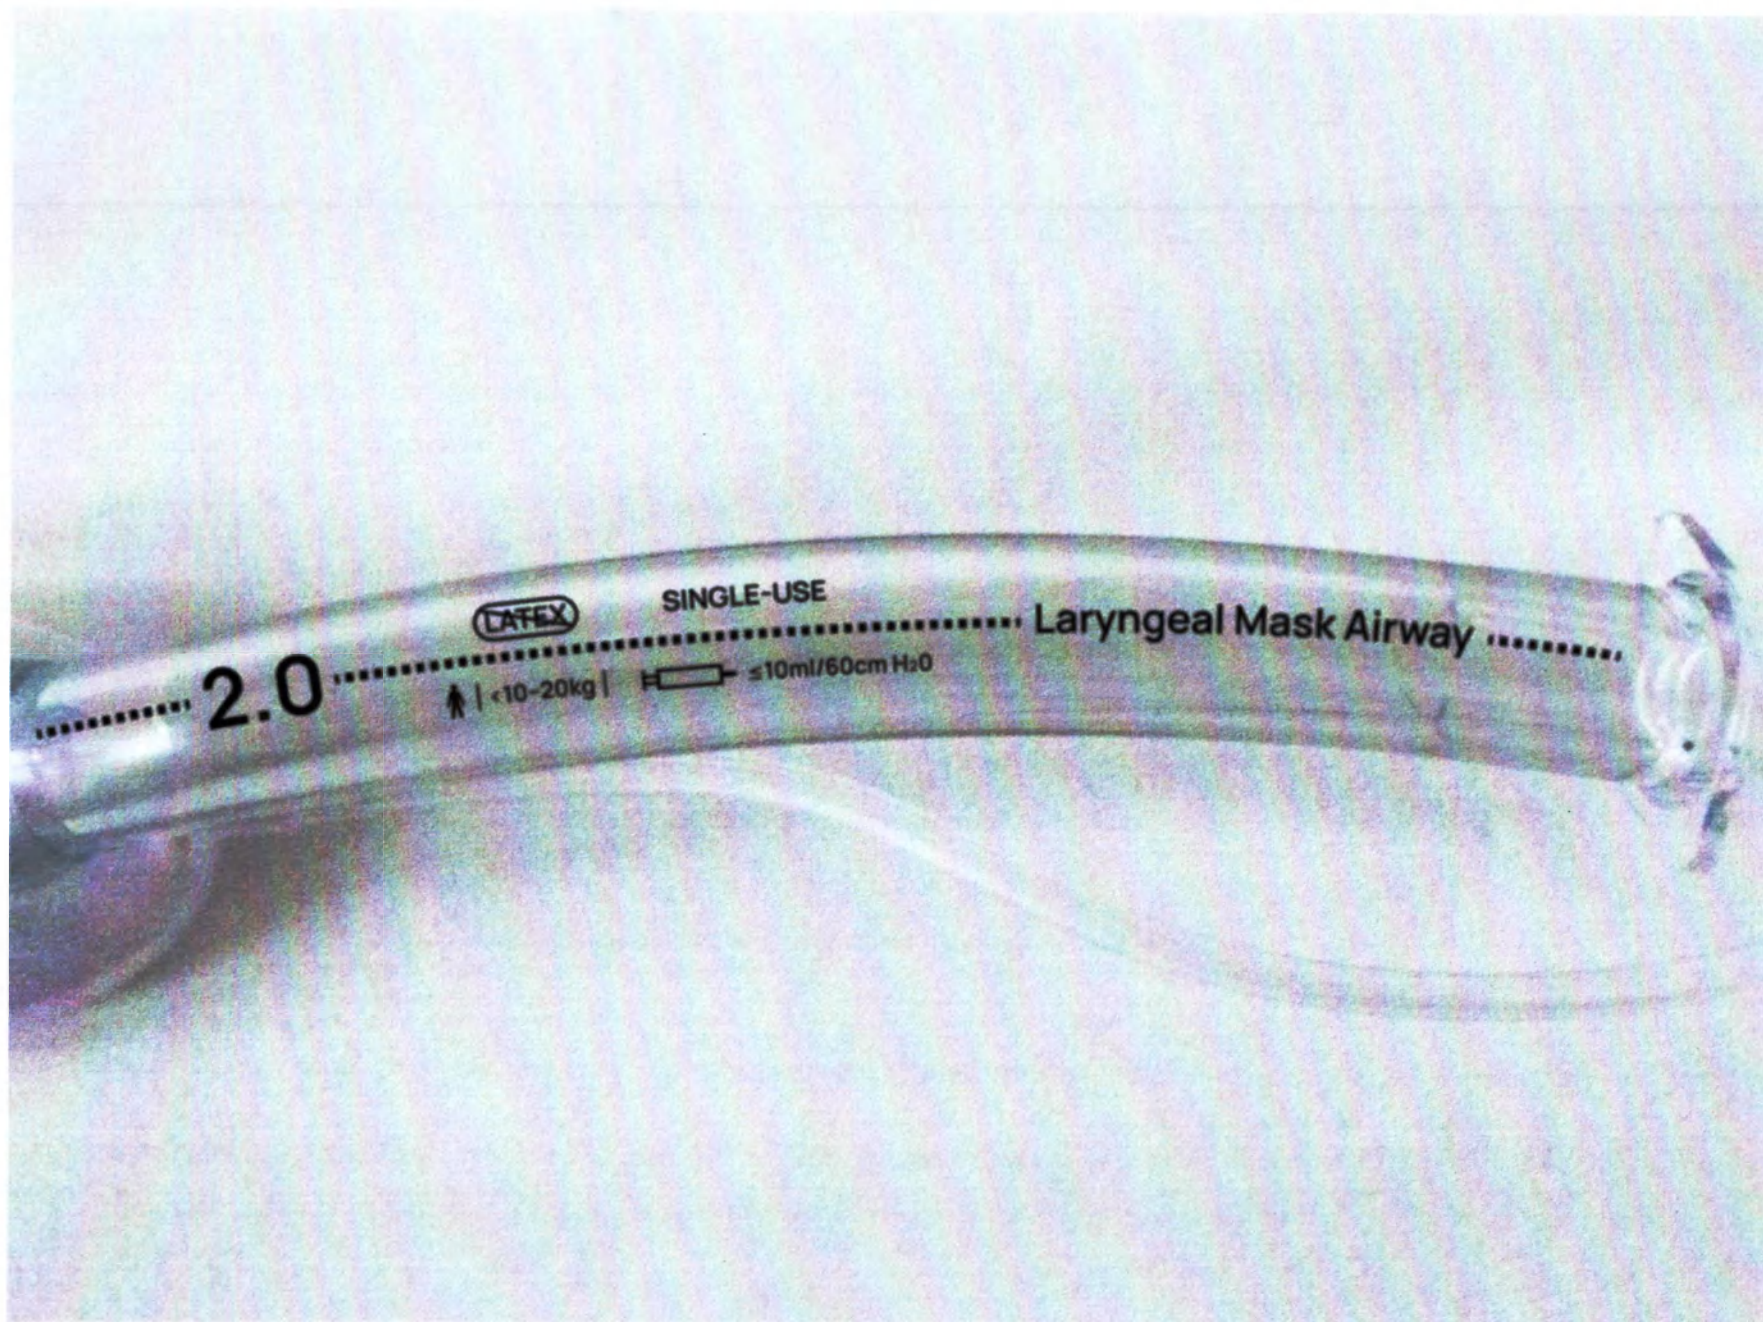


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM, размер 2,0

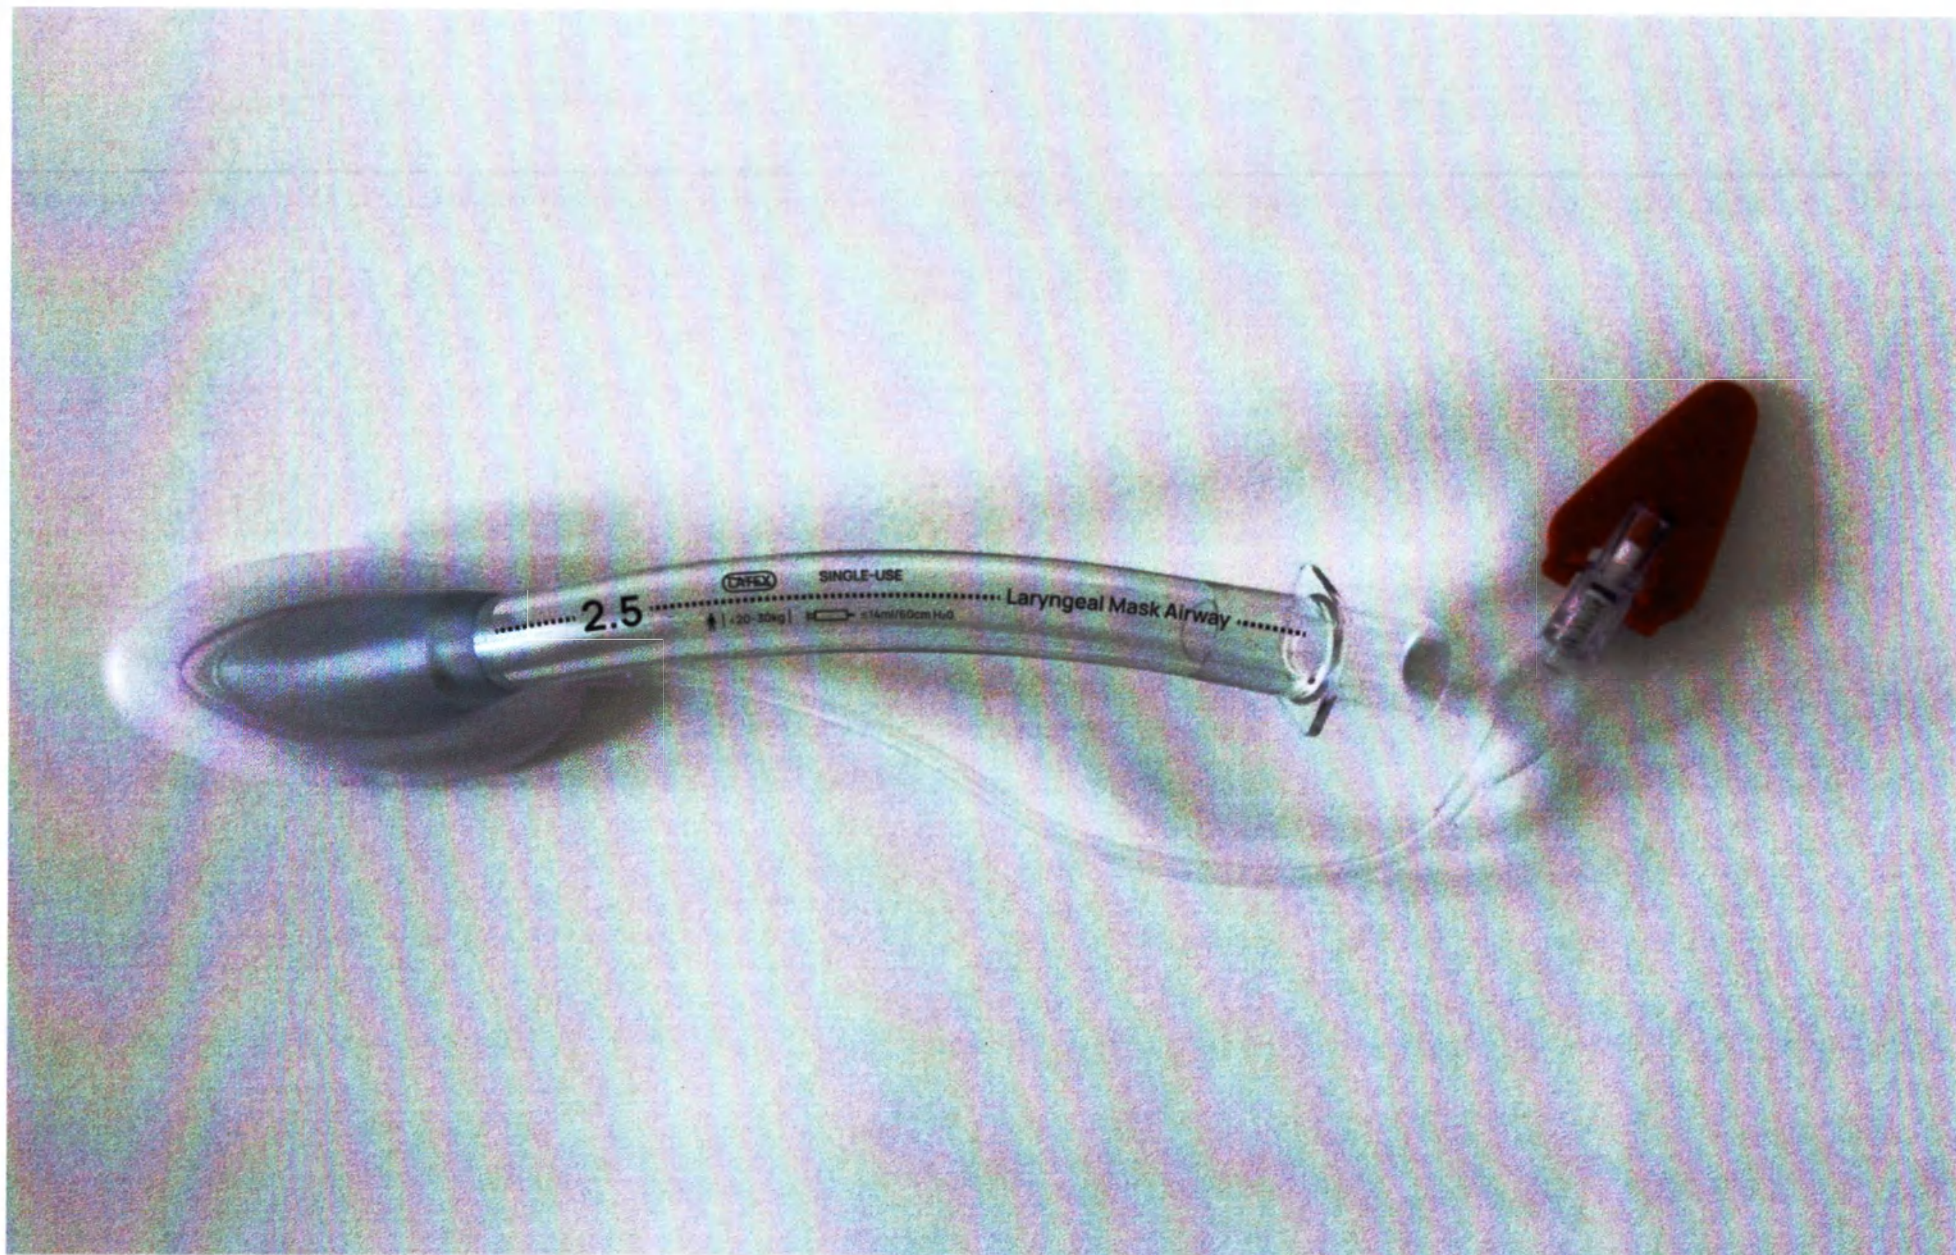


Маска ларингеальная STATIM, размер 2,5

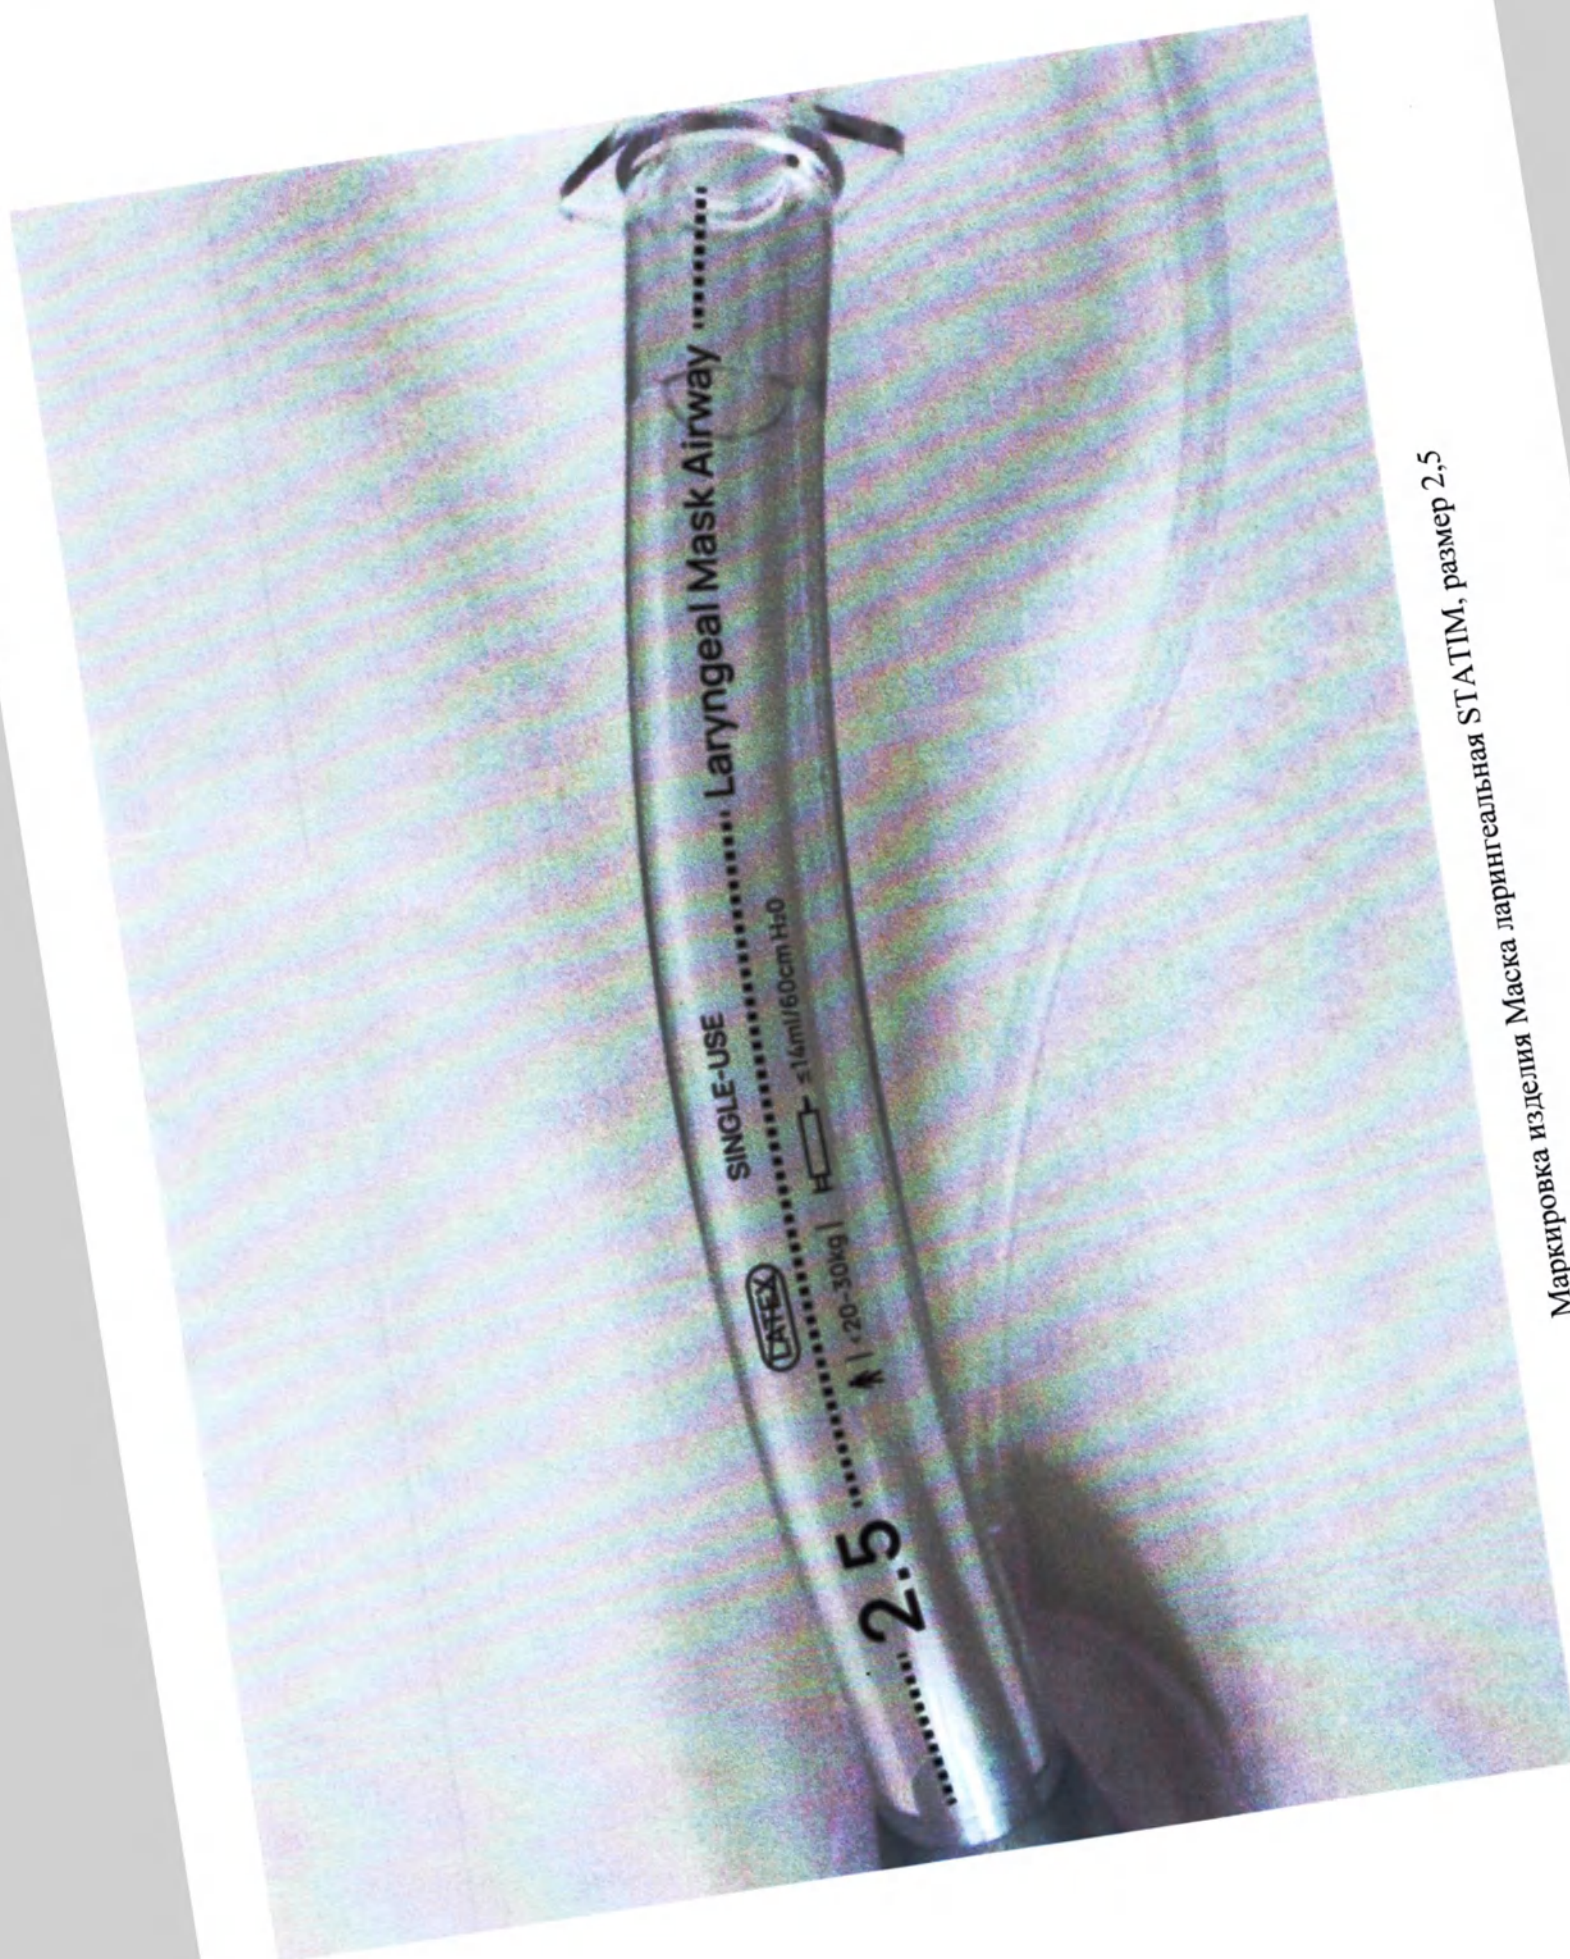


Маркировка изделия Маска ларингеальная СТАТИМ, размер 2,5

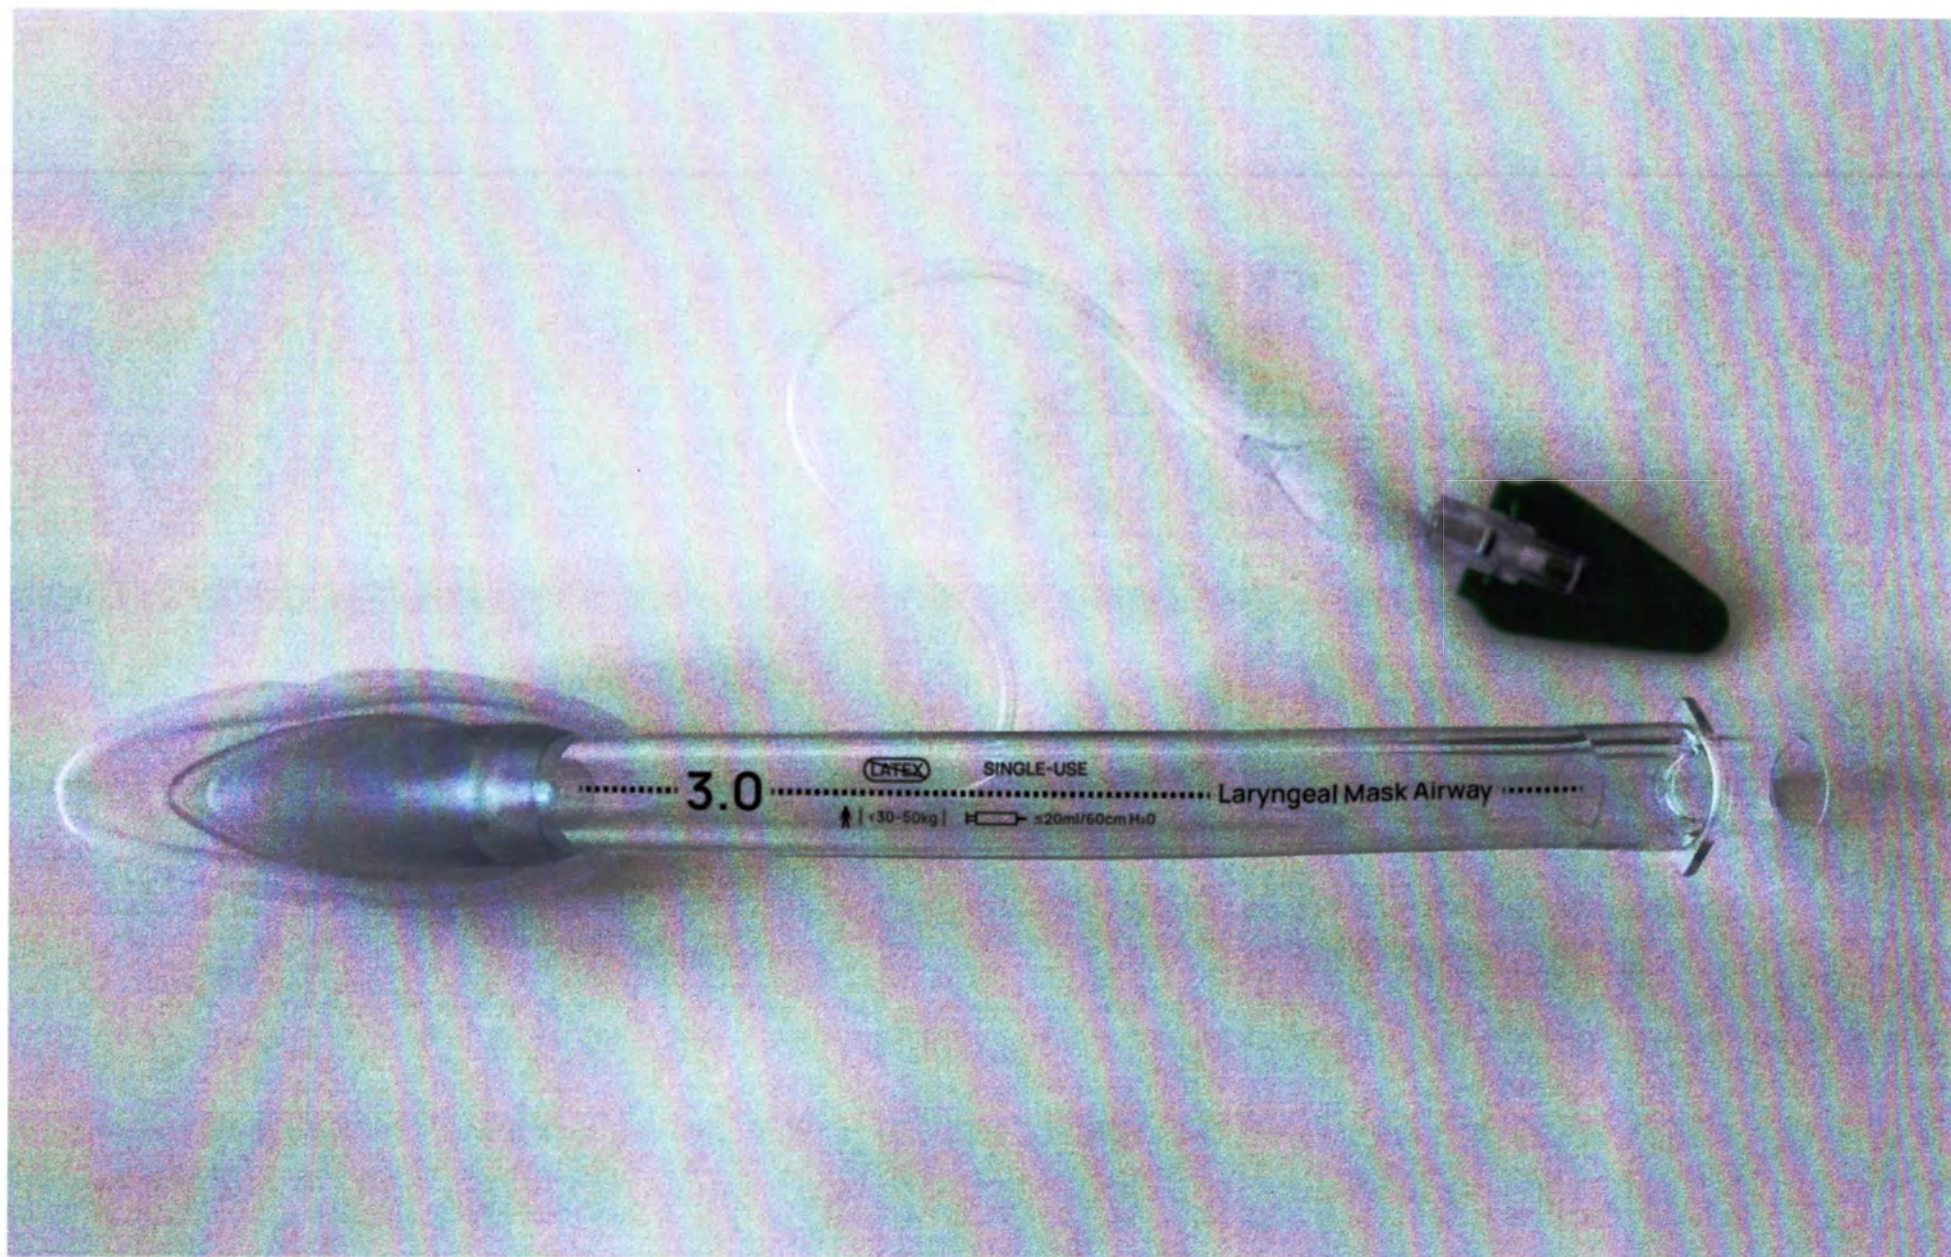


Маска ларингеальная STATIM, размер 3,0

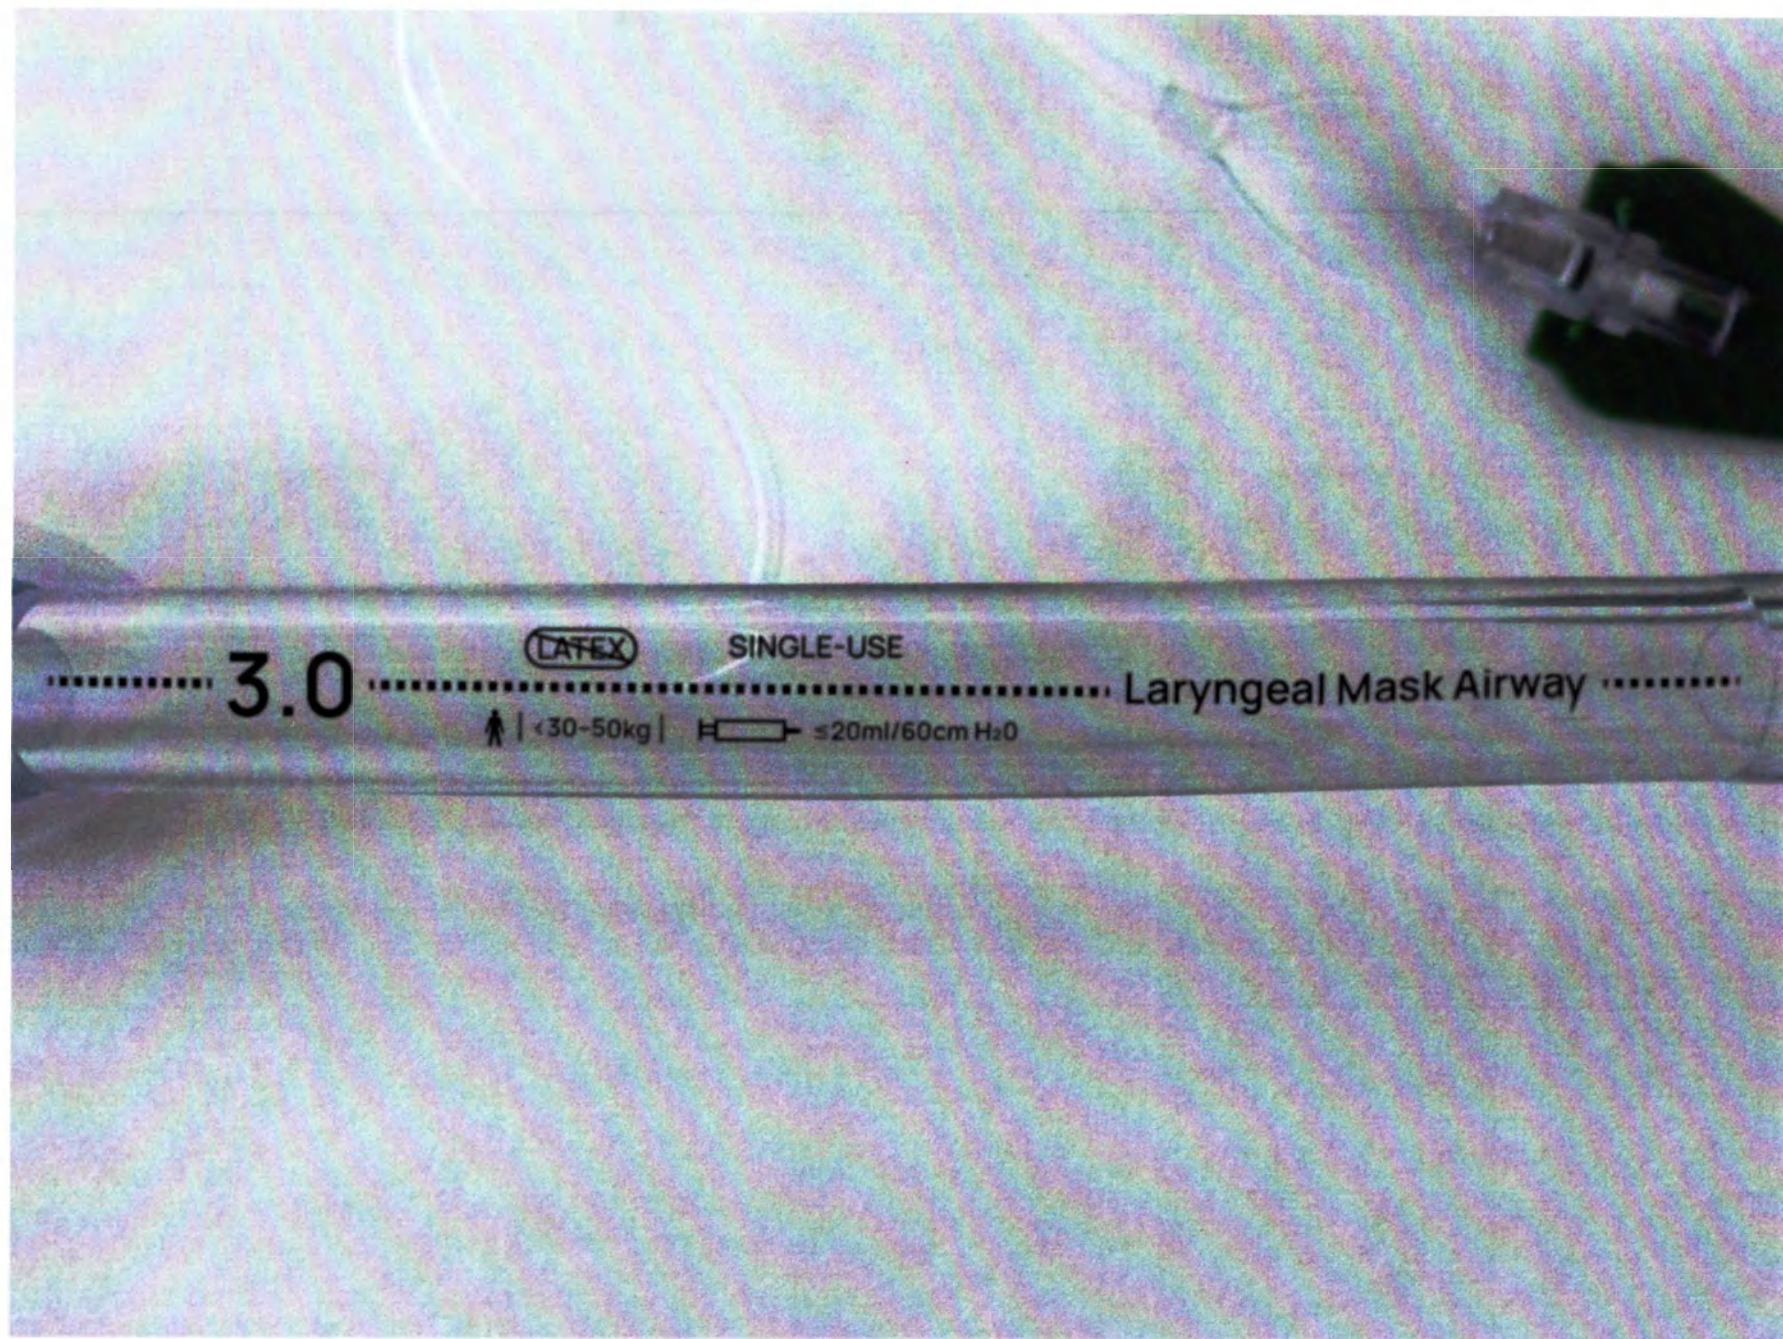


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM, размер 3,0

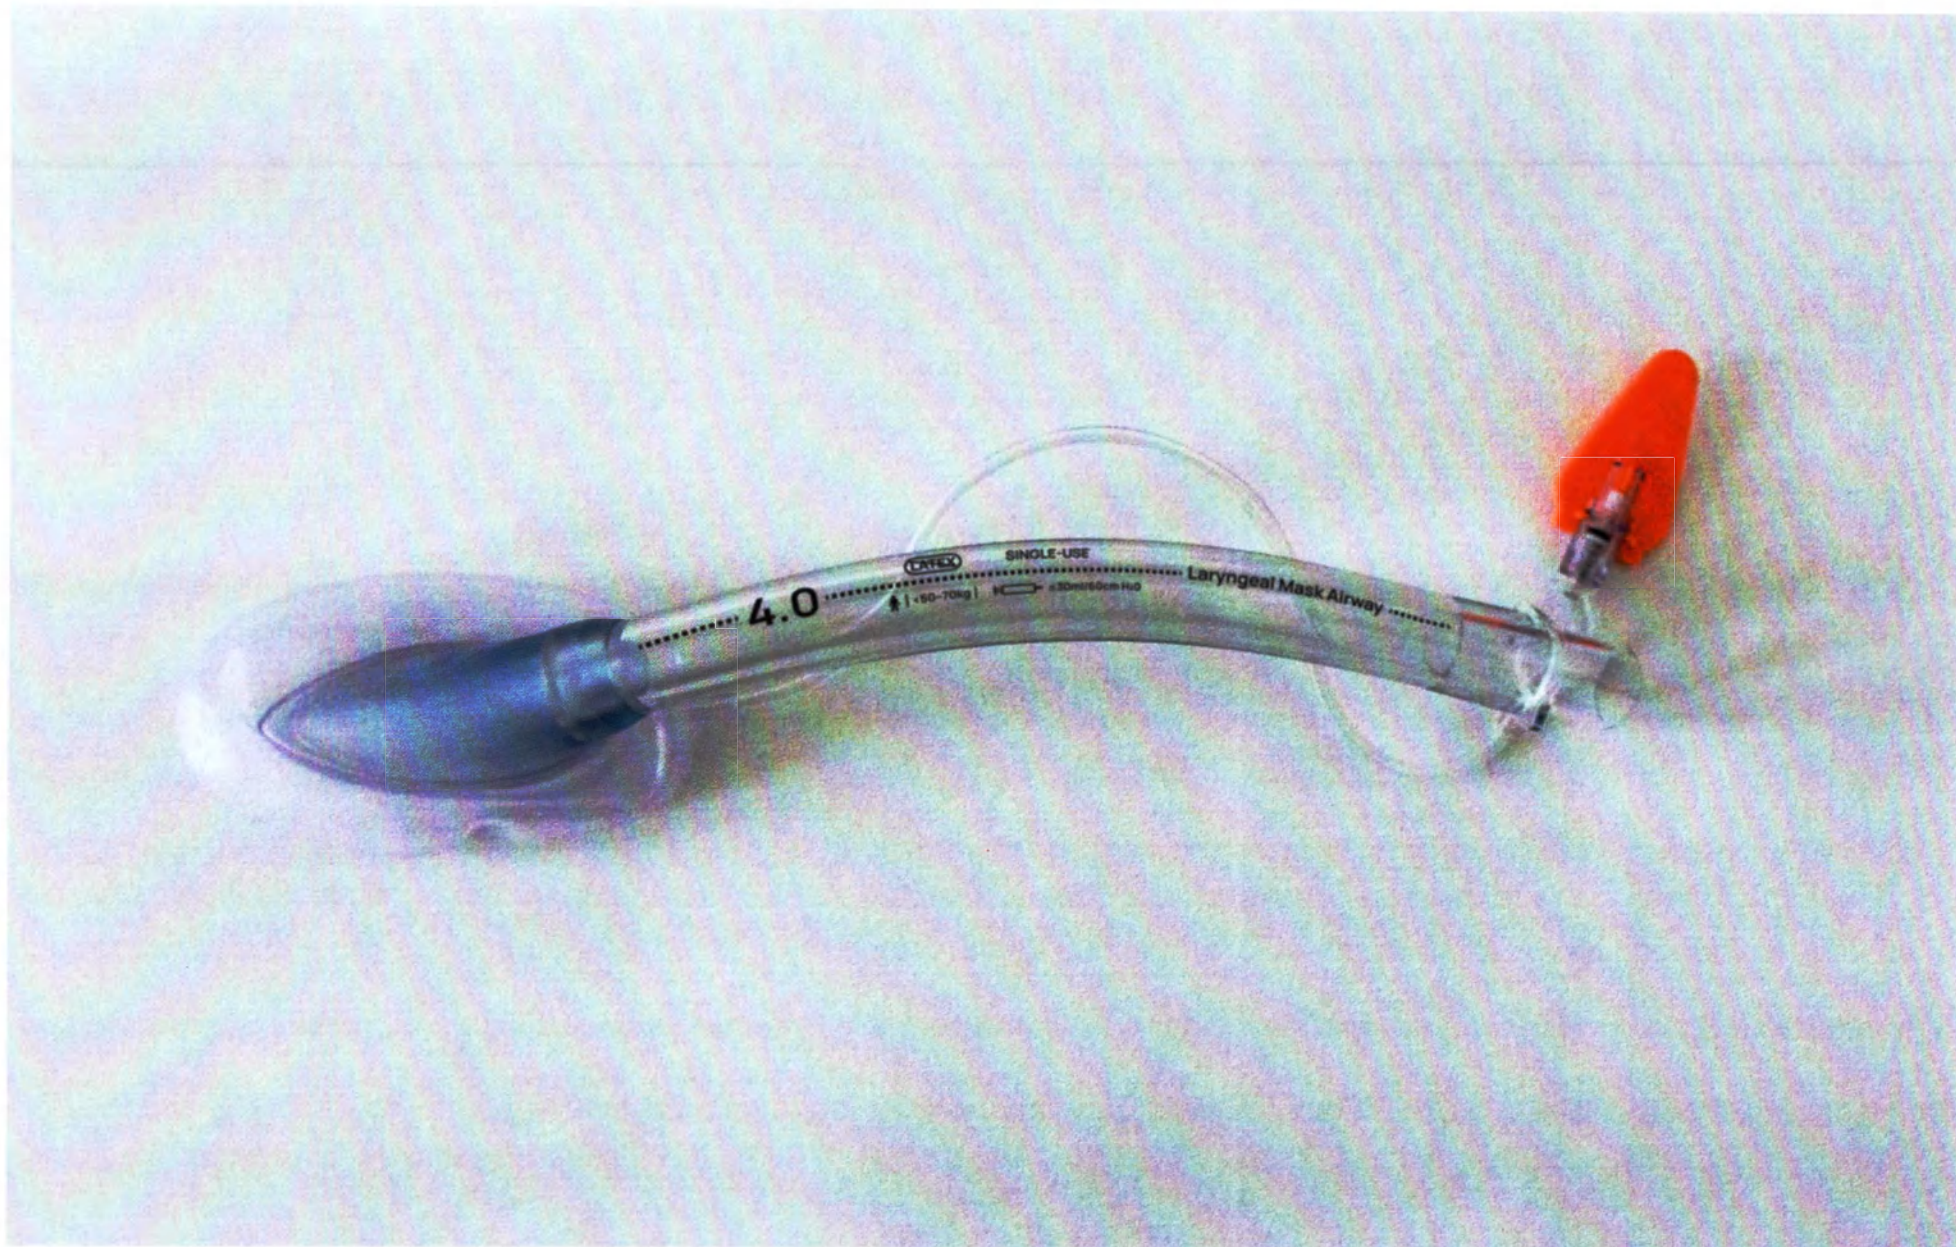


Маска ларингеальная STATIM, размер 4,0

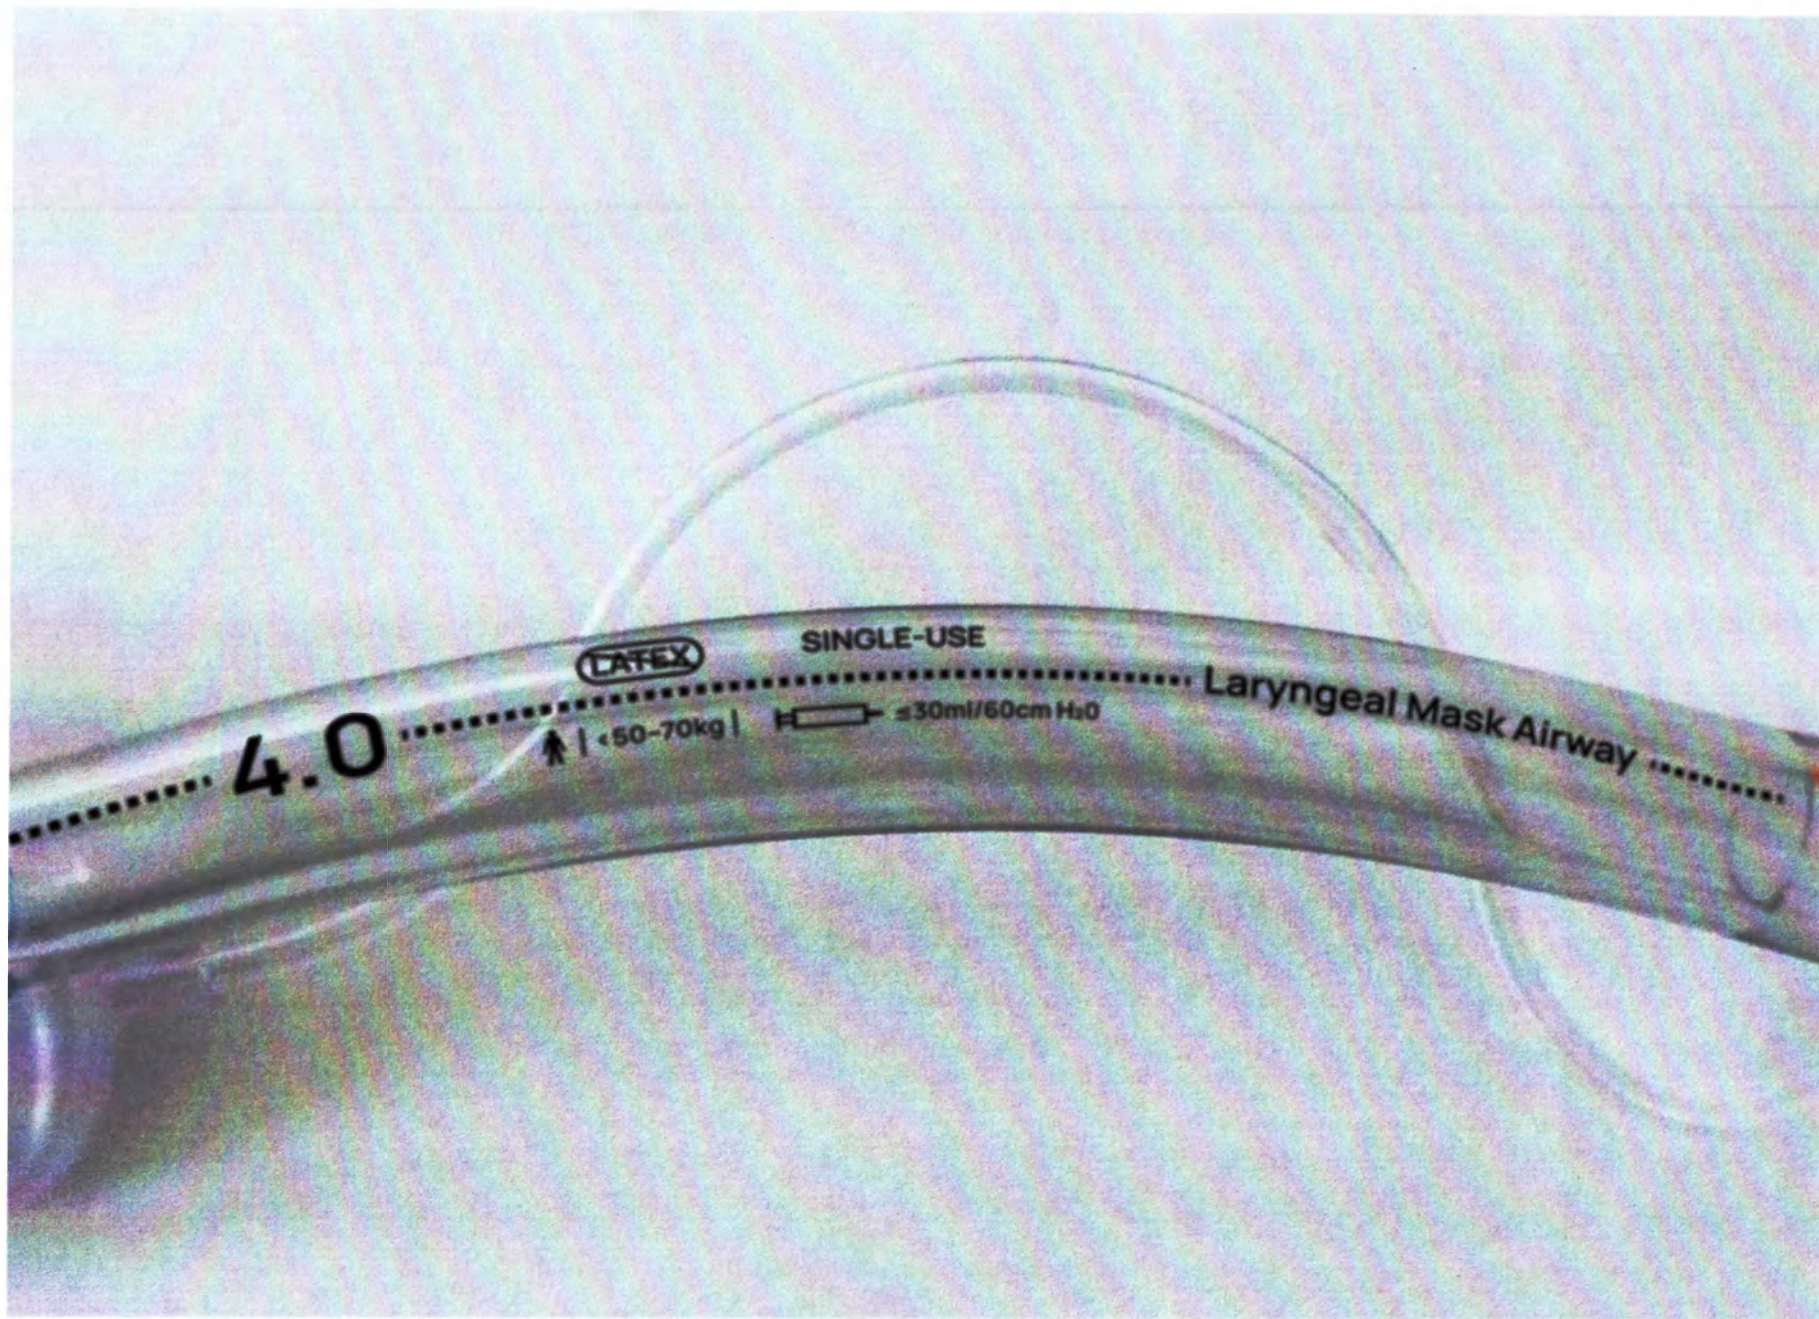


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM, размер 4,0

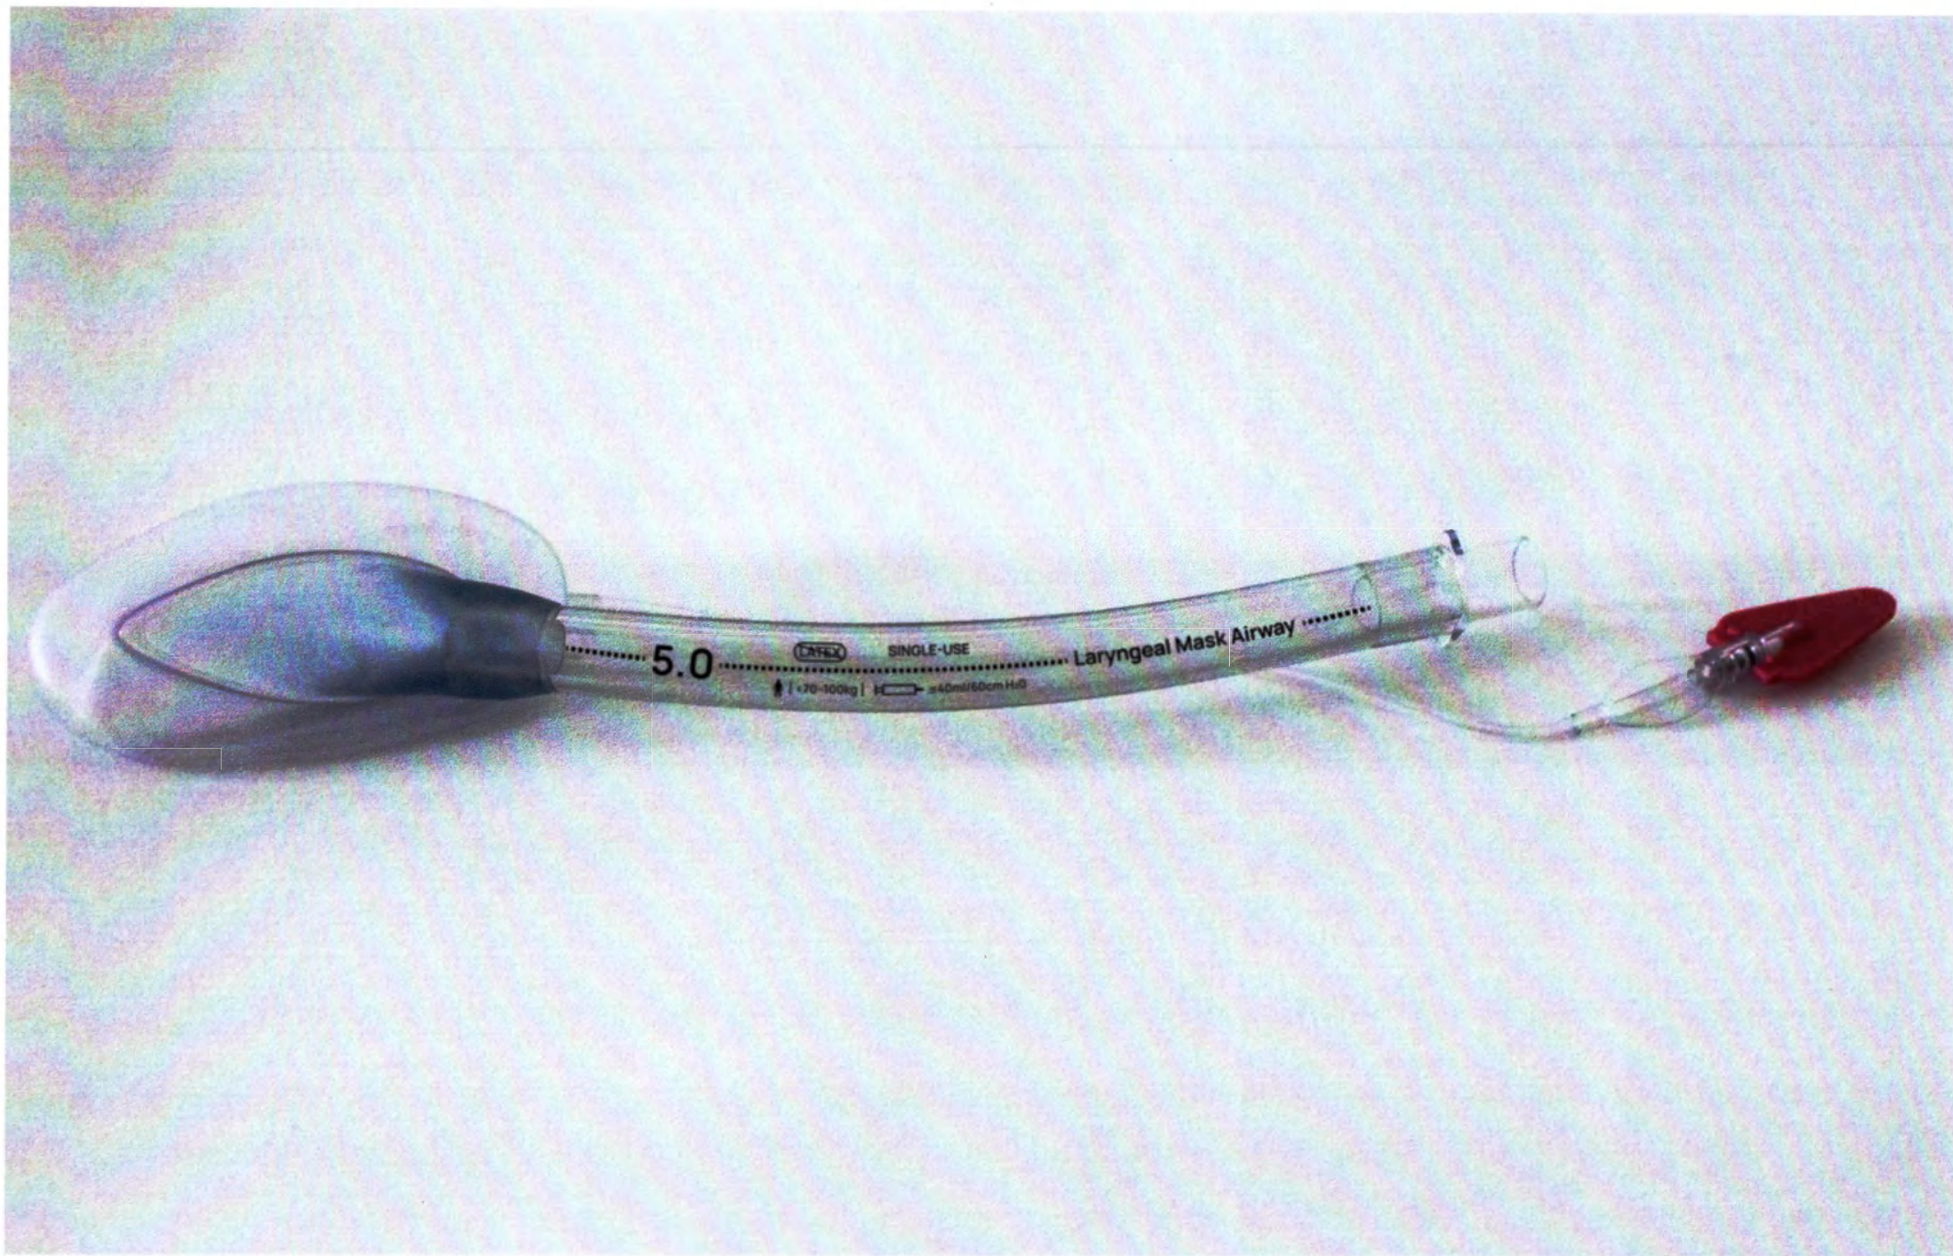


Маска ларингеальная STATIM, размер 5,0

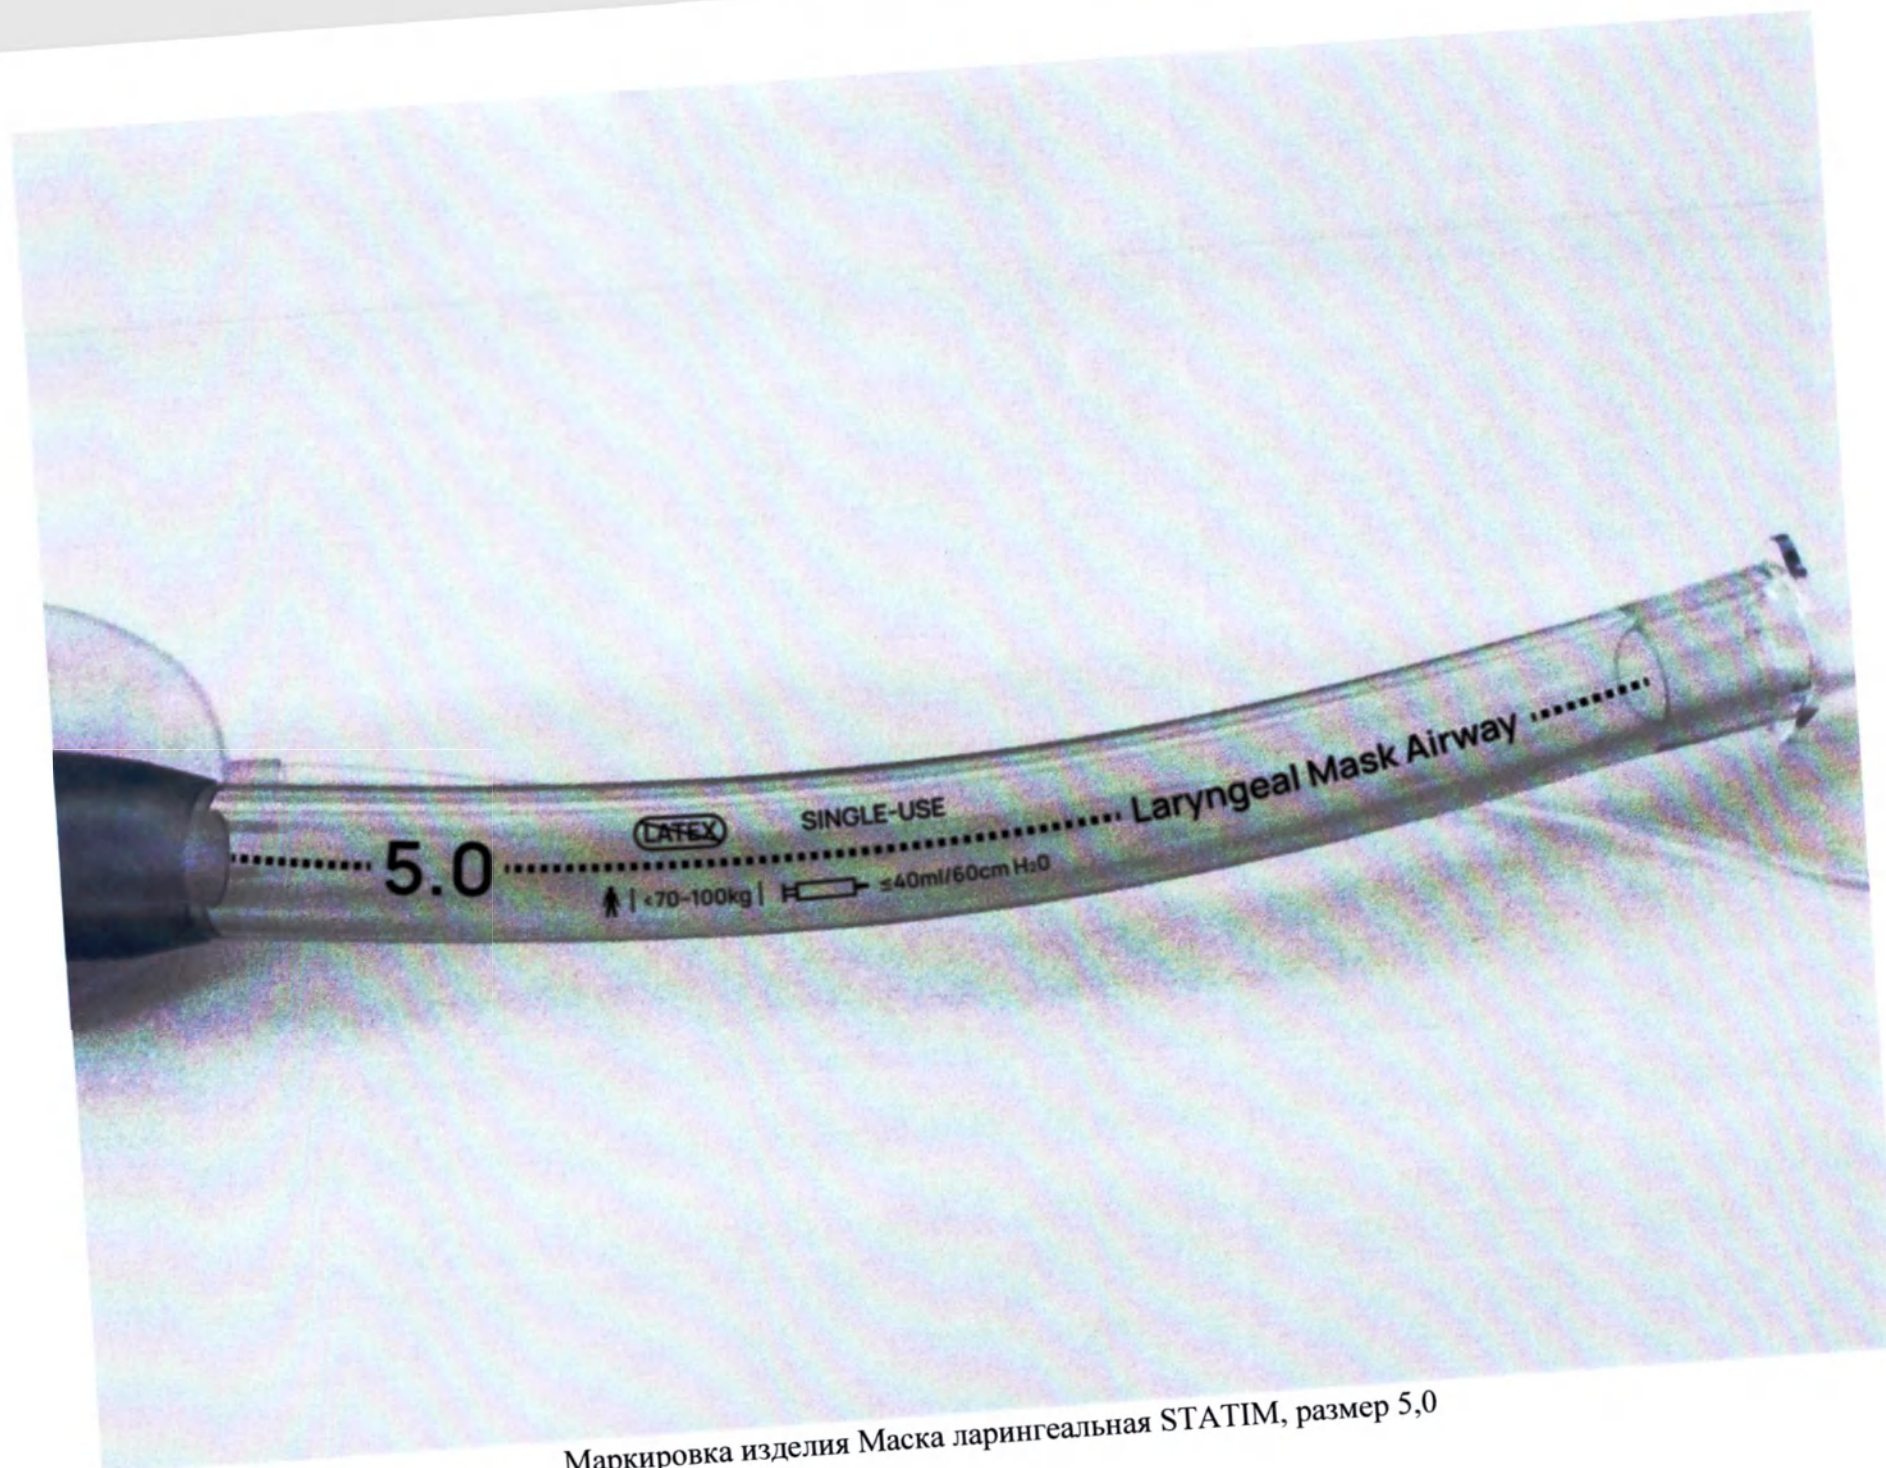

Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM, размер 5,0

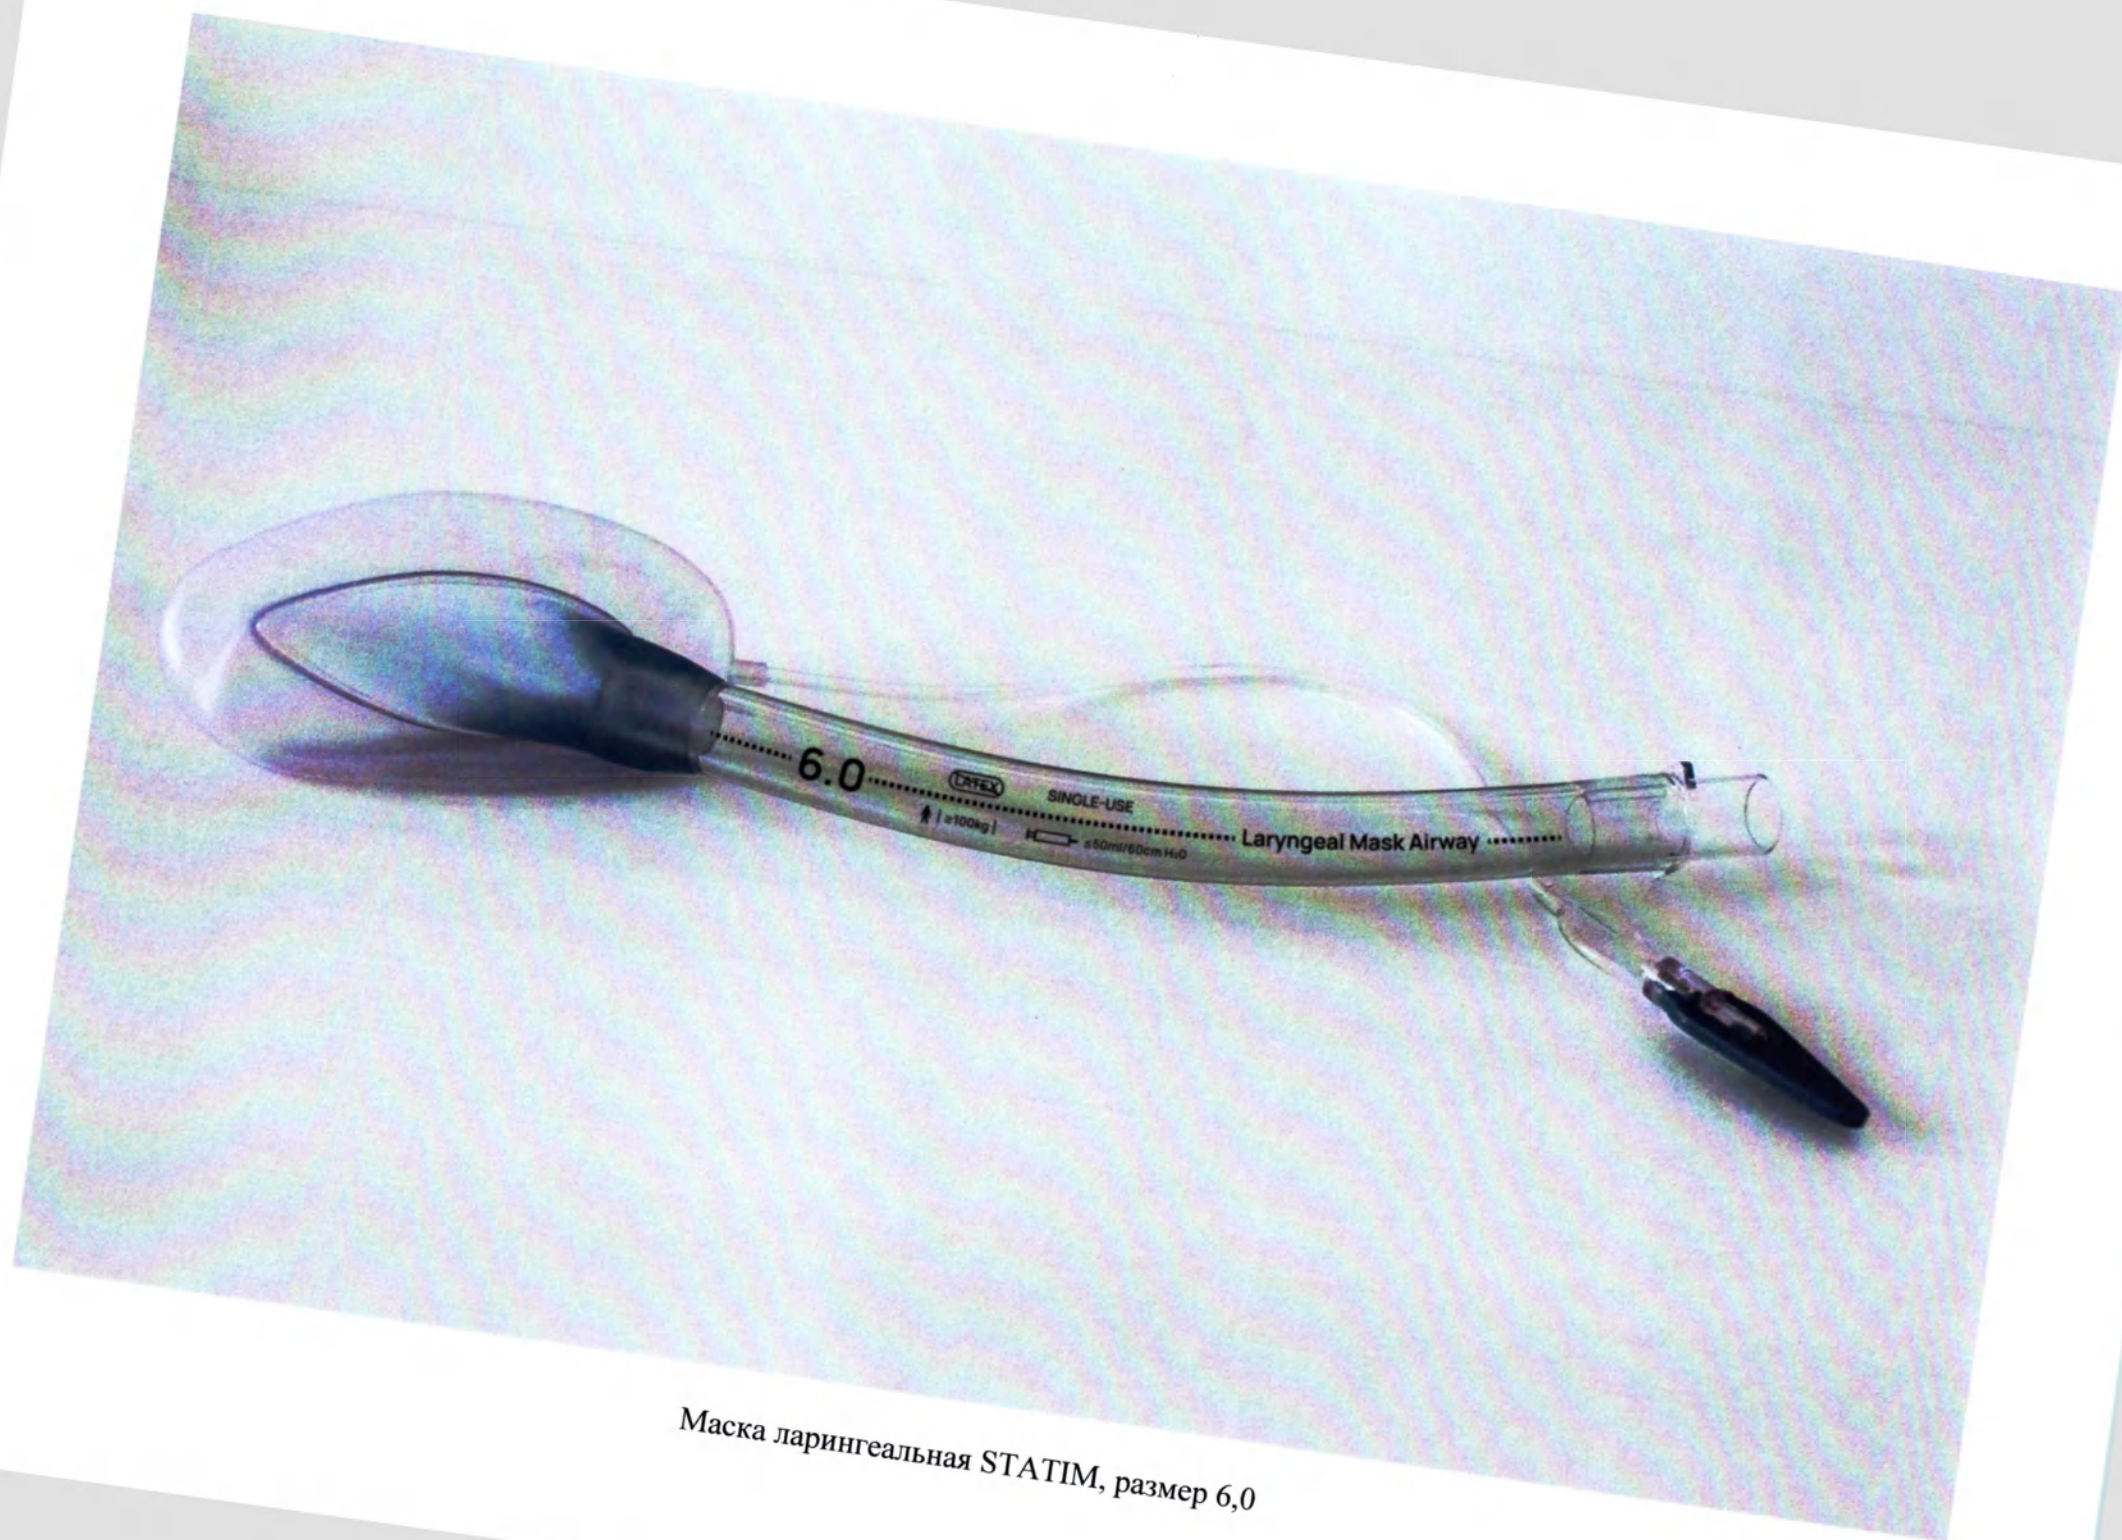


Маска ларингеальная STATIM, размер 6,0

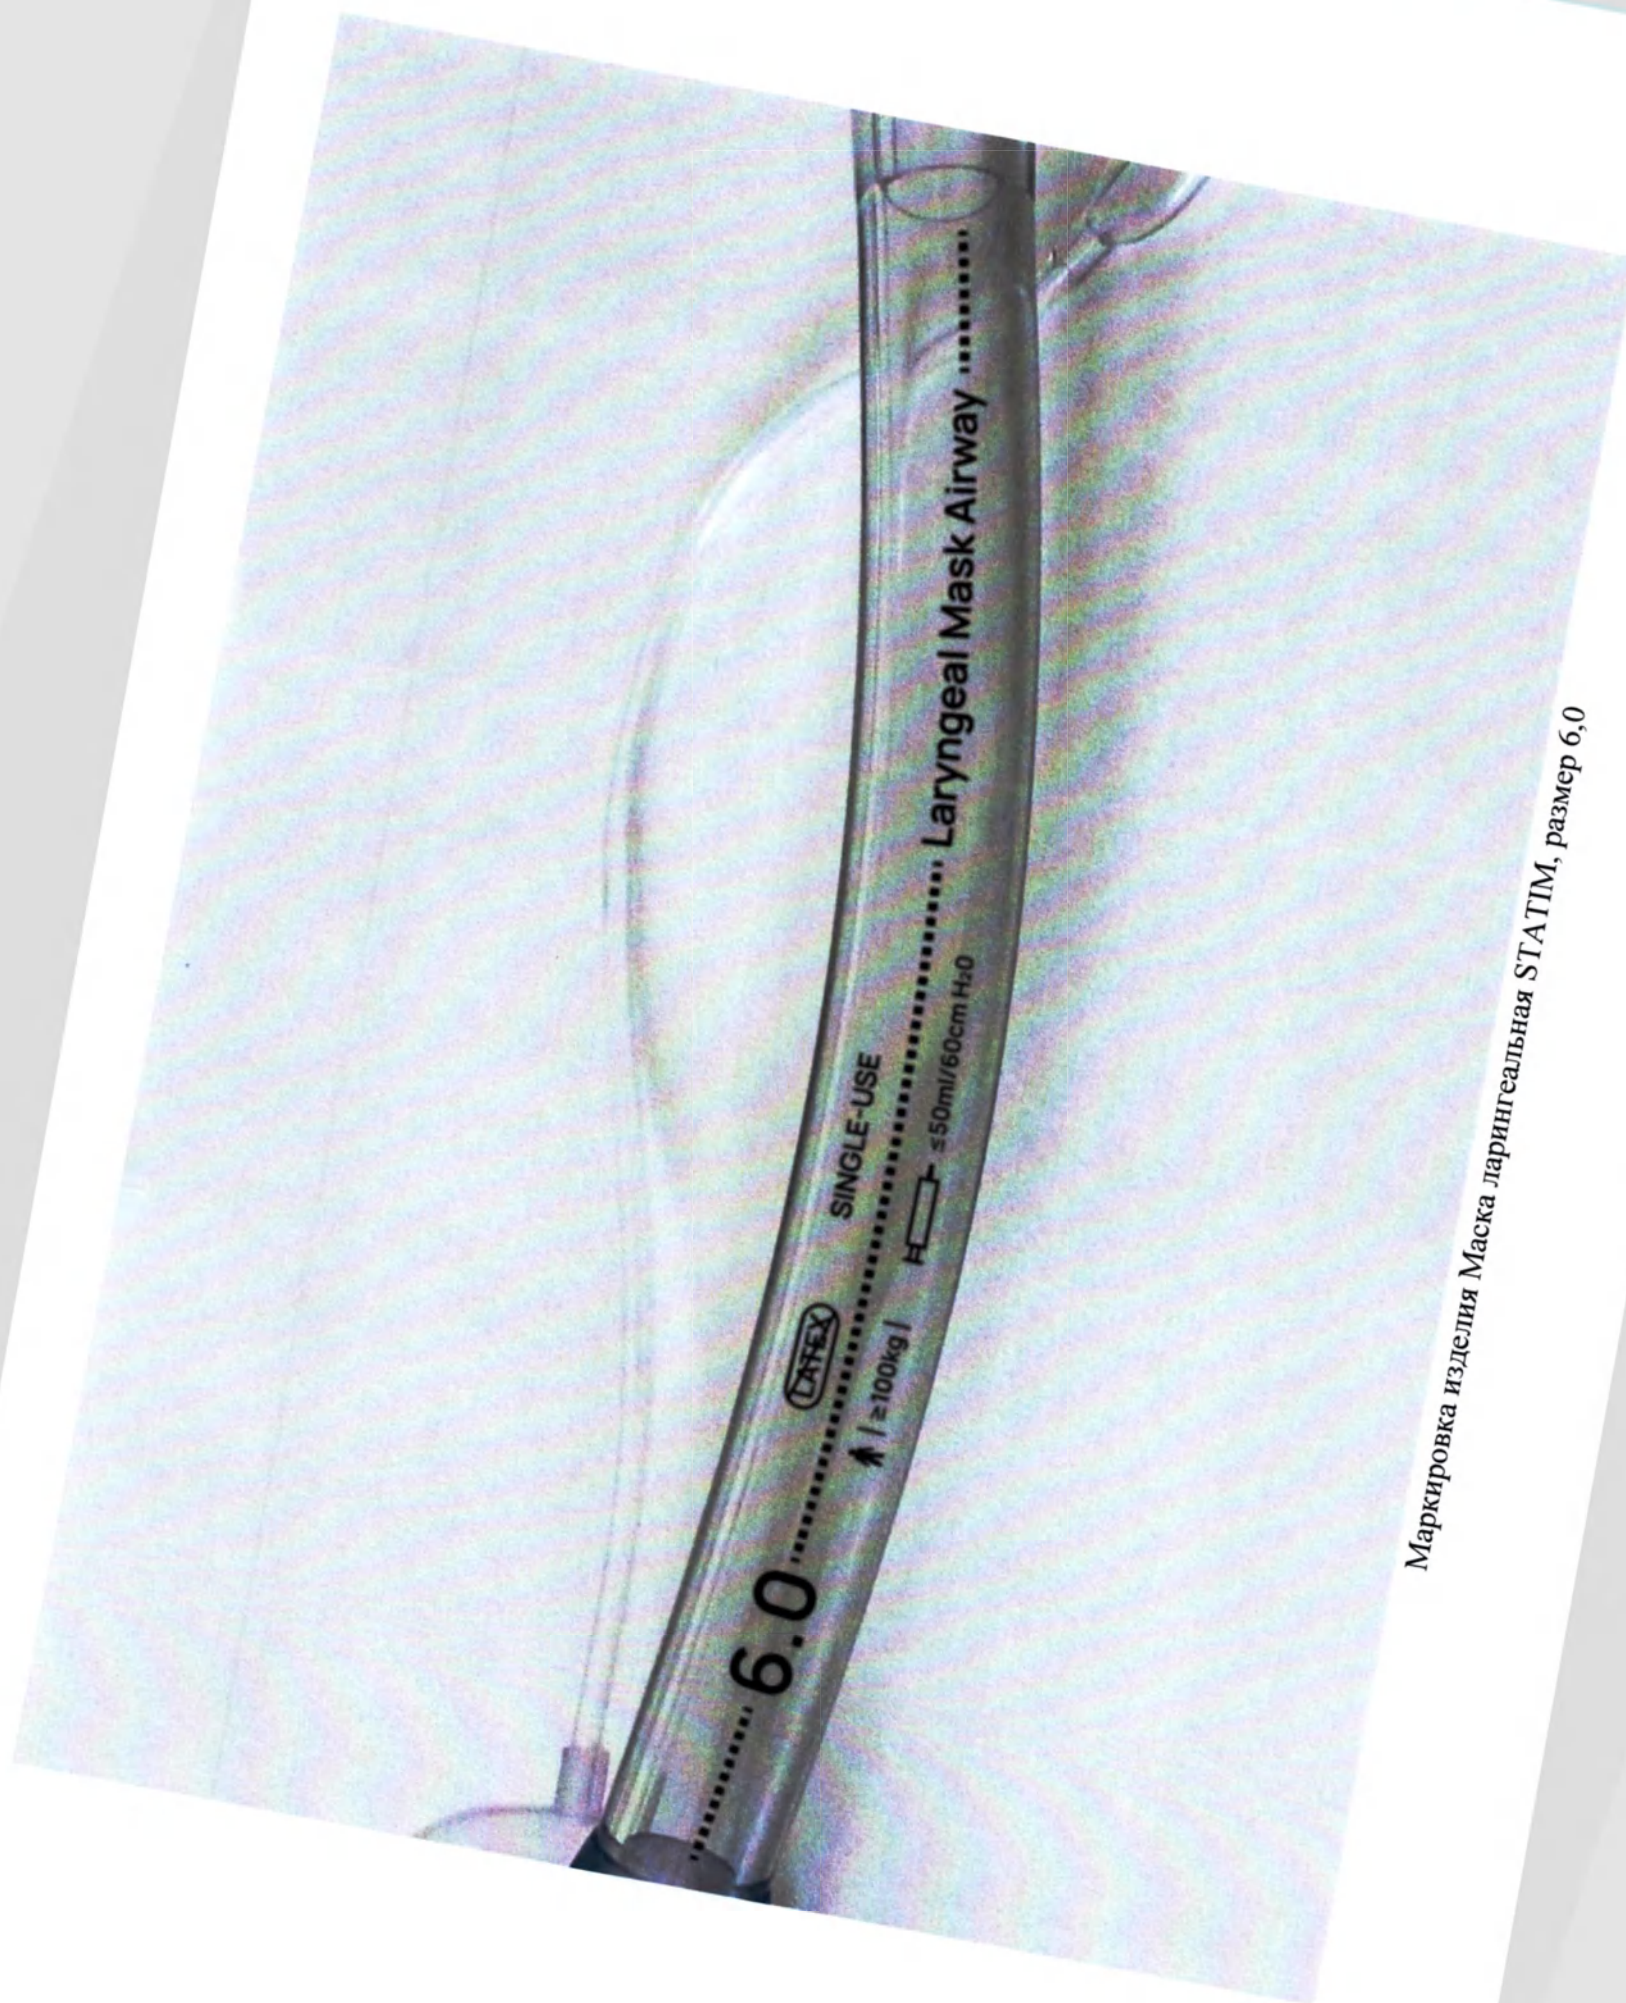

Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM, размер 6,0

Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 1,0




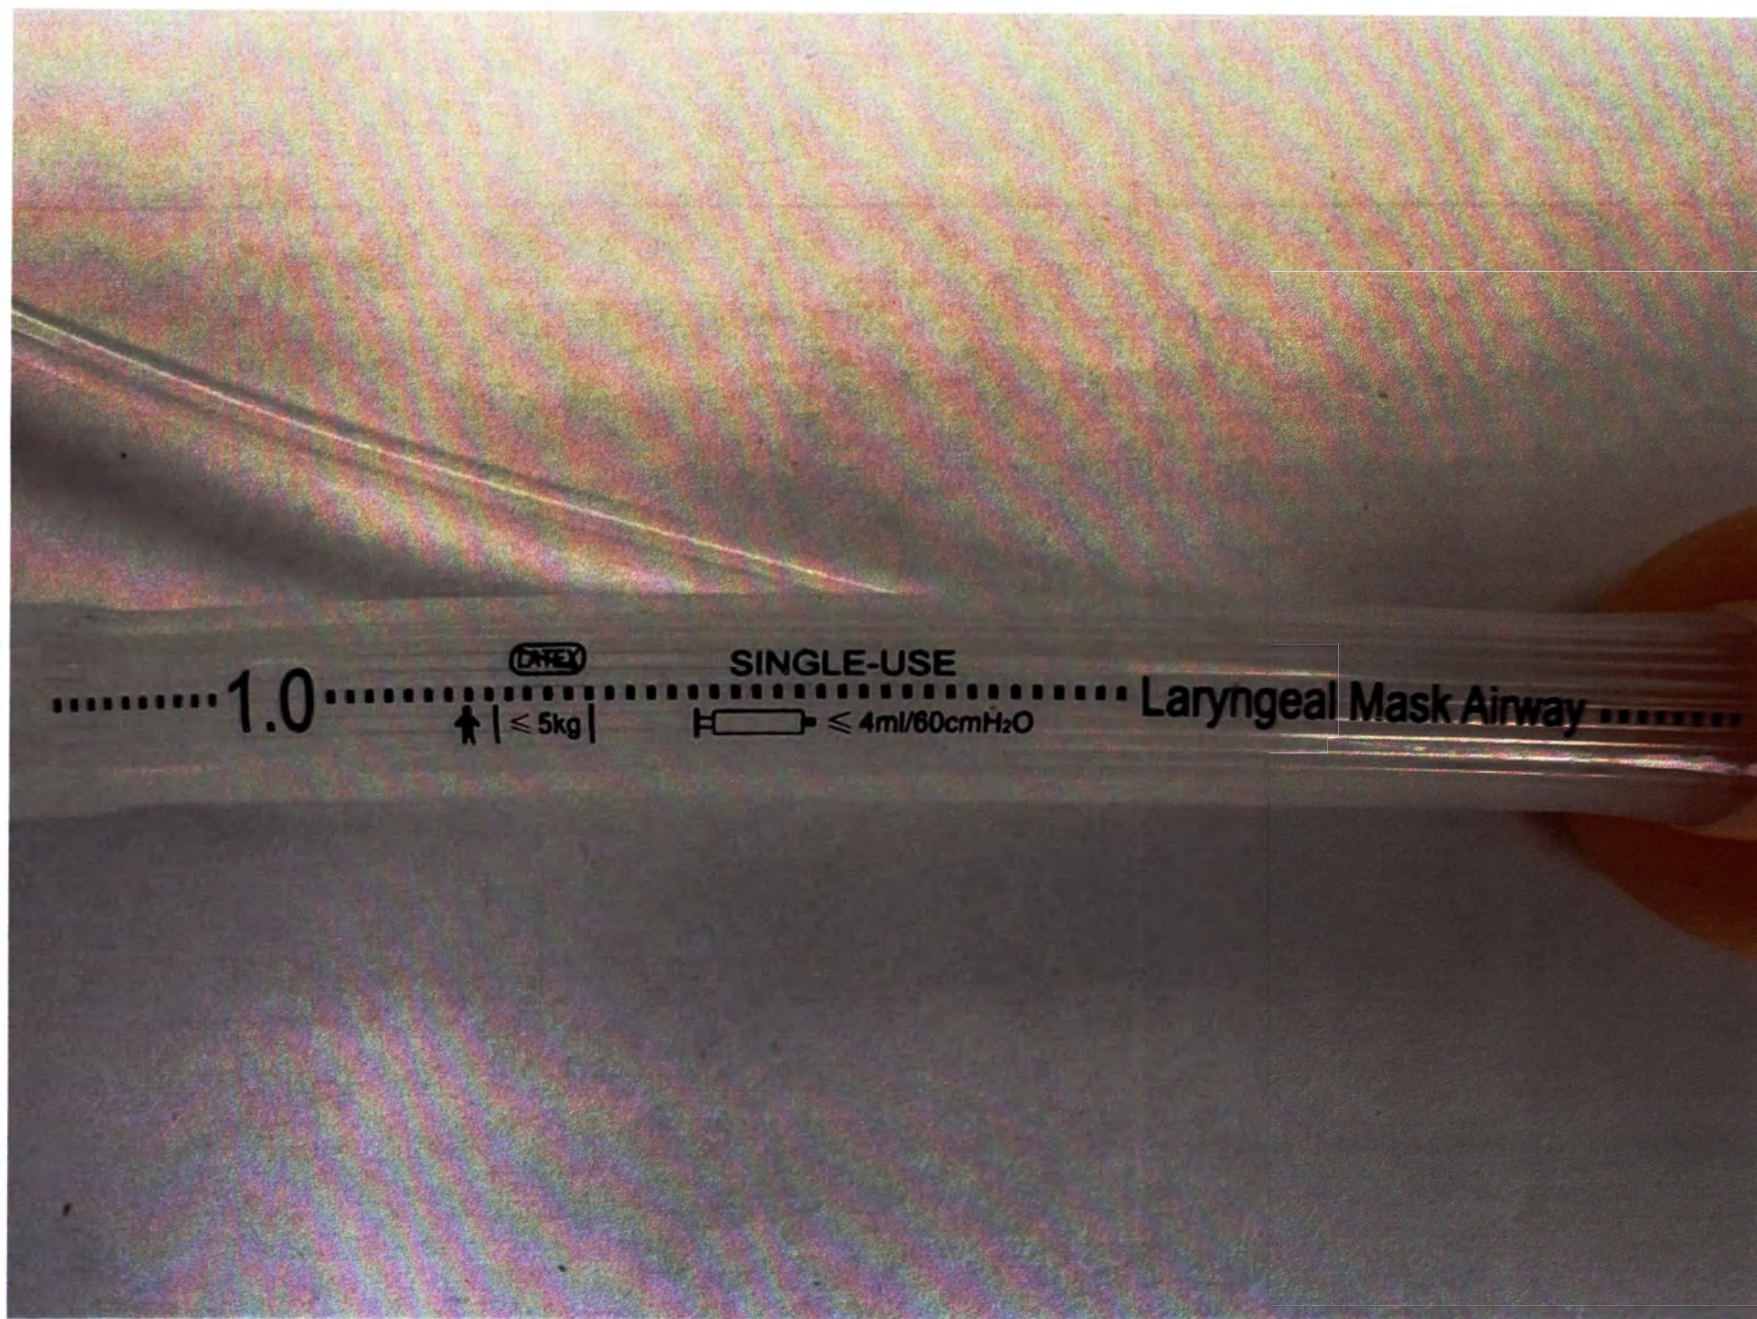


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 1,0



Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 1,5

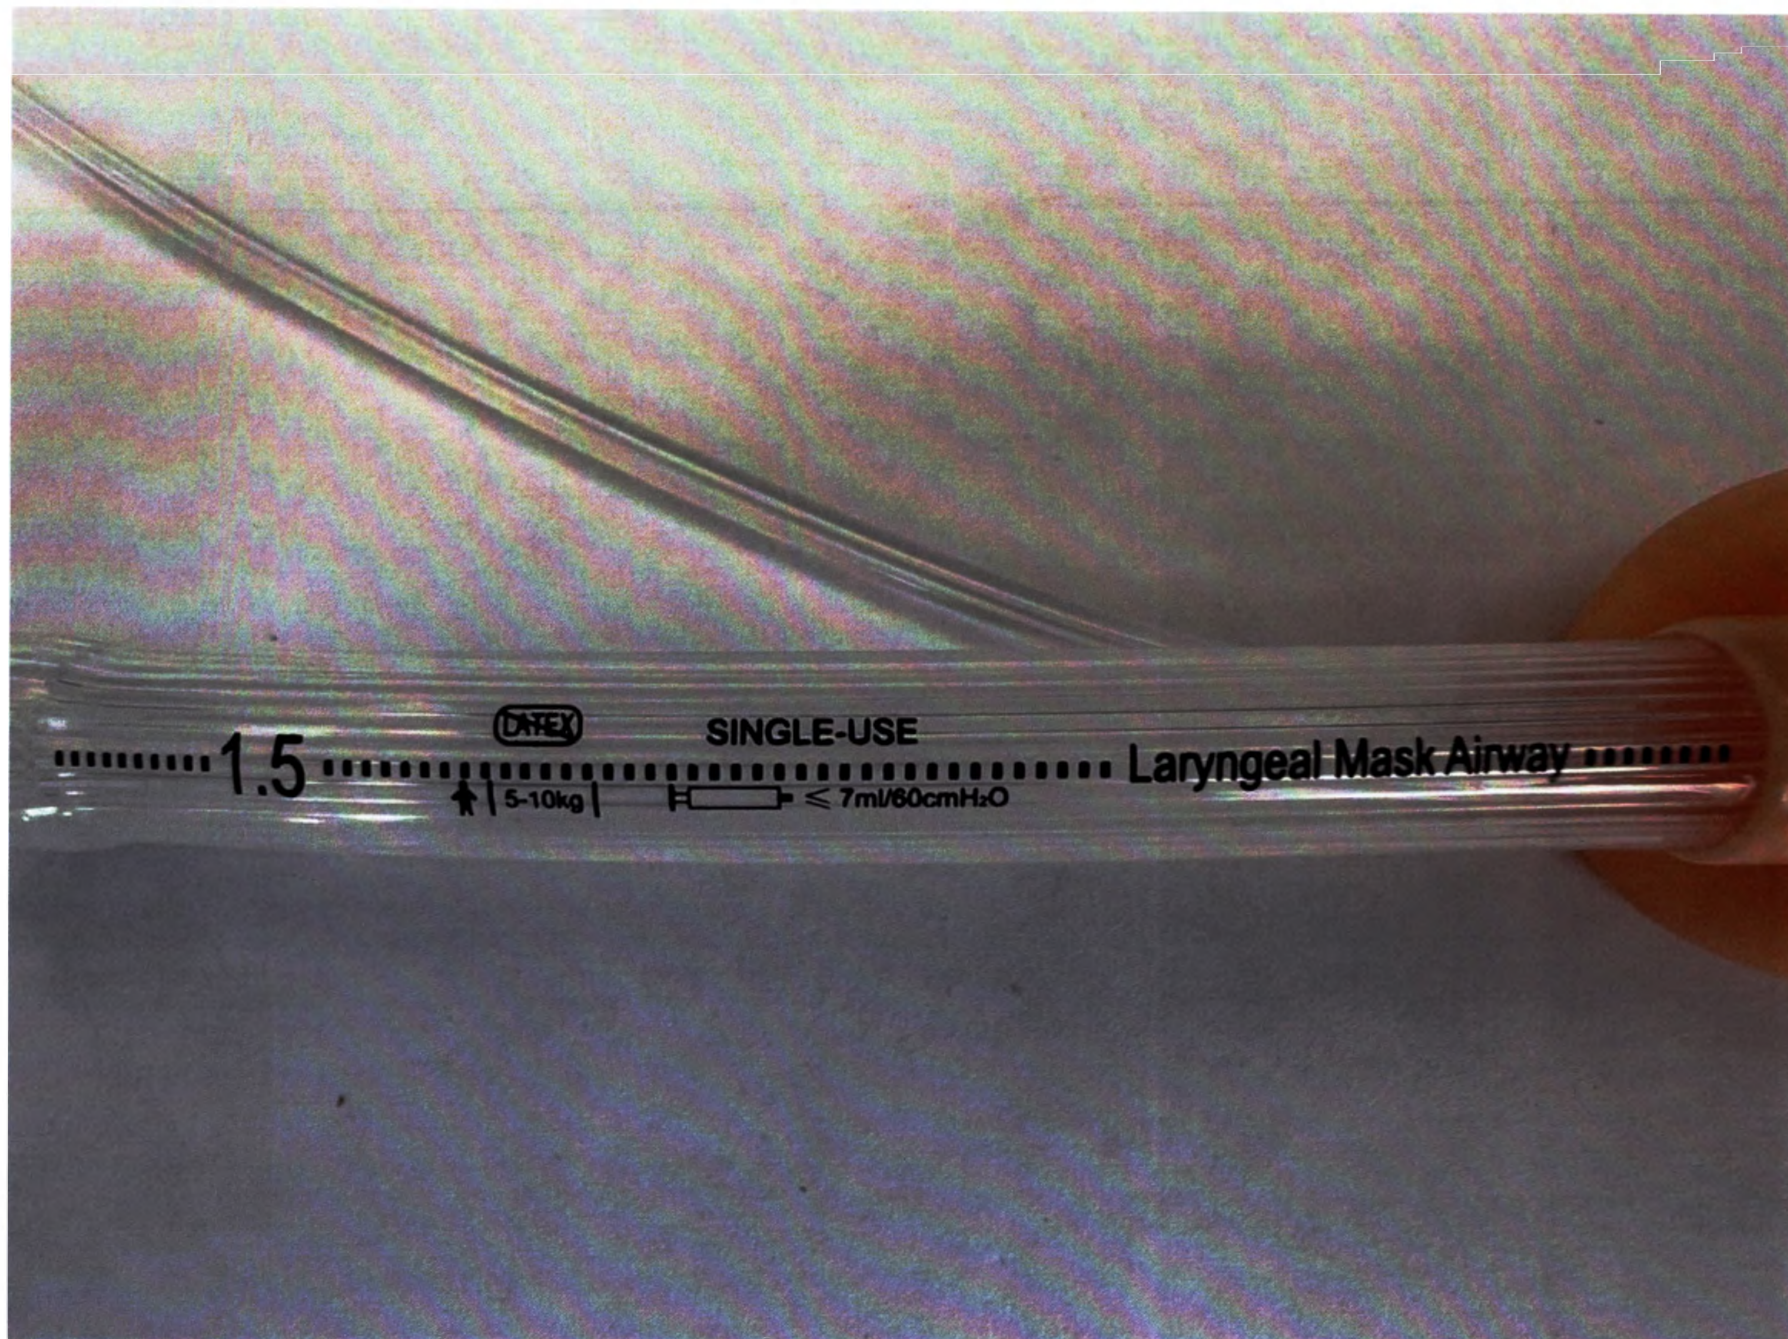

Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 1,5

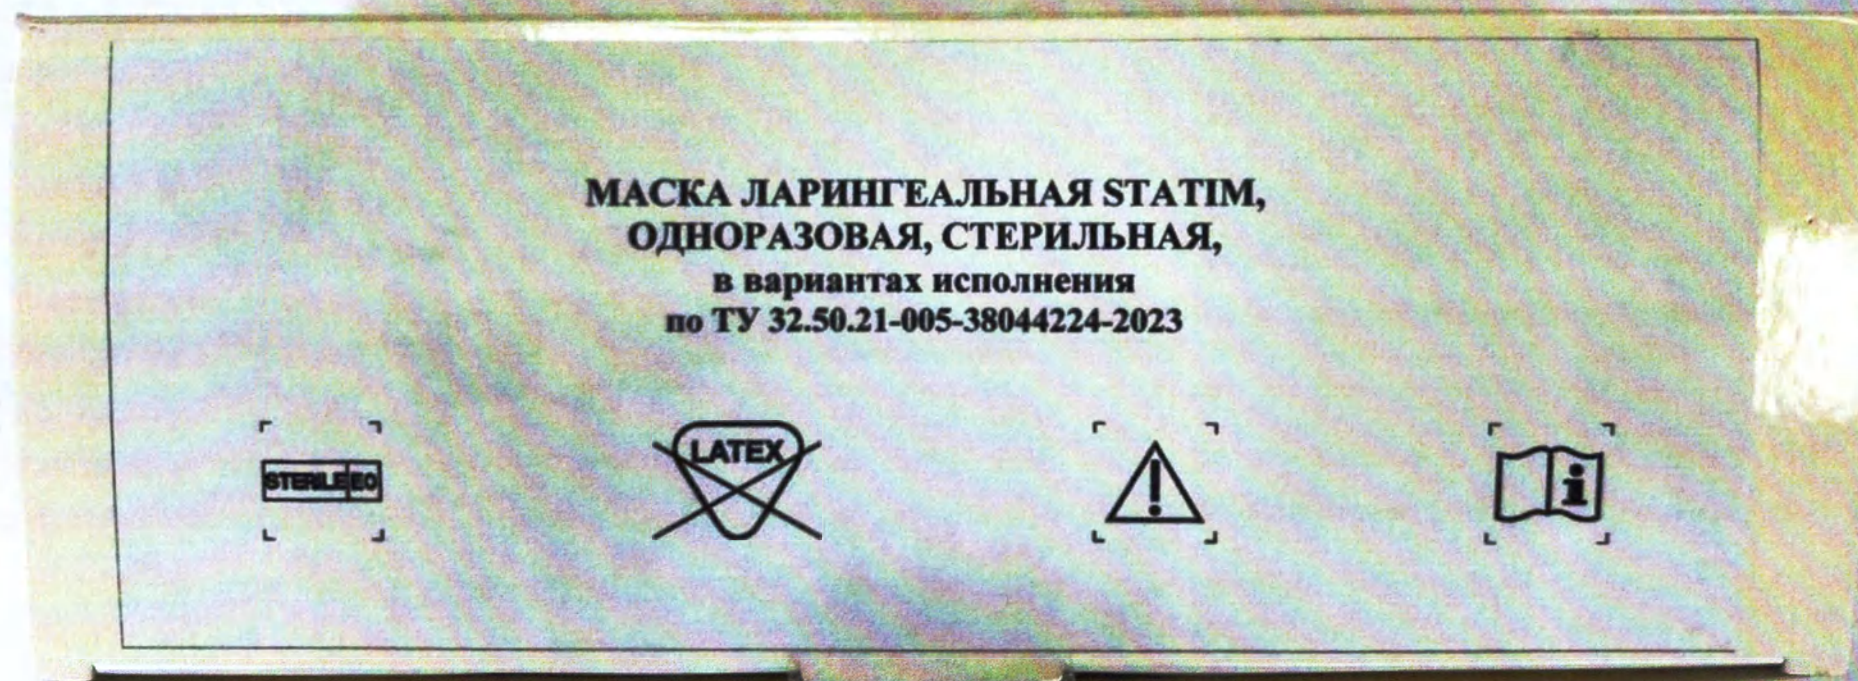

Потребительская упаковка Маски ларингеальной STATIM силиконовой, размер 1,5

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительная влажность не более 100% при плюс 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Нетоксично

STERILE

Стерильно, стерилизация оксидом этилена



Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 1,5 – 2 шт.



03.04.2024

LOT

240180



02.04.2029

REF

LM1507S1



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места производства:


ООО «РиГ Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.


Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.

Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Потребительская упаковка Маски ларингеальной STATIM силиконовой, размер 1,5

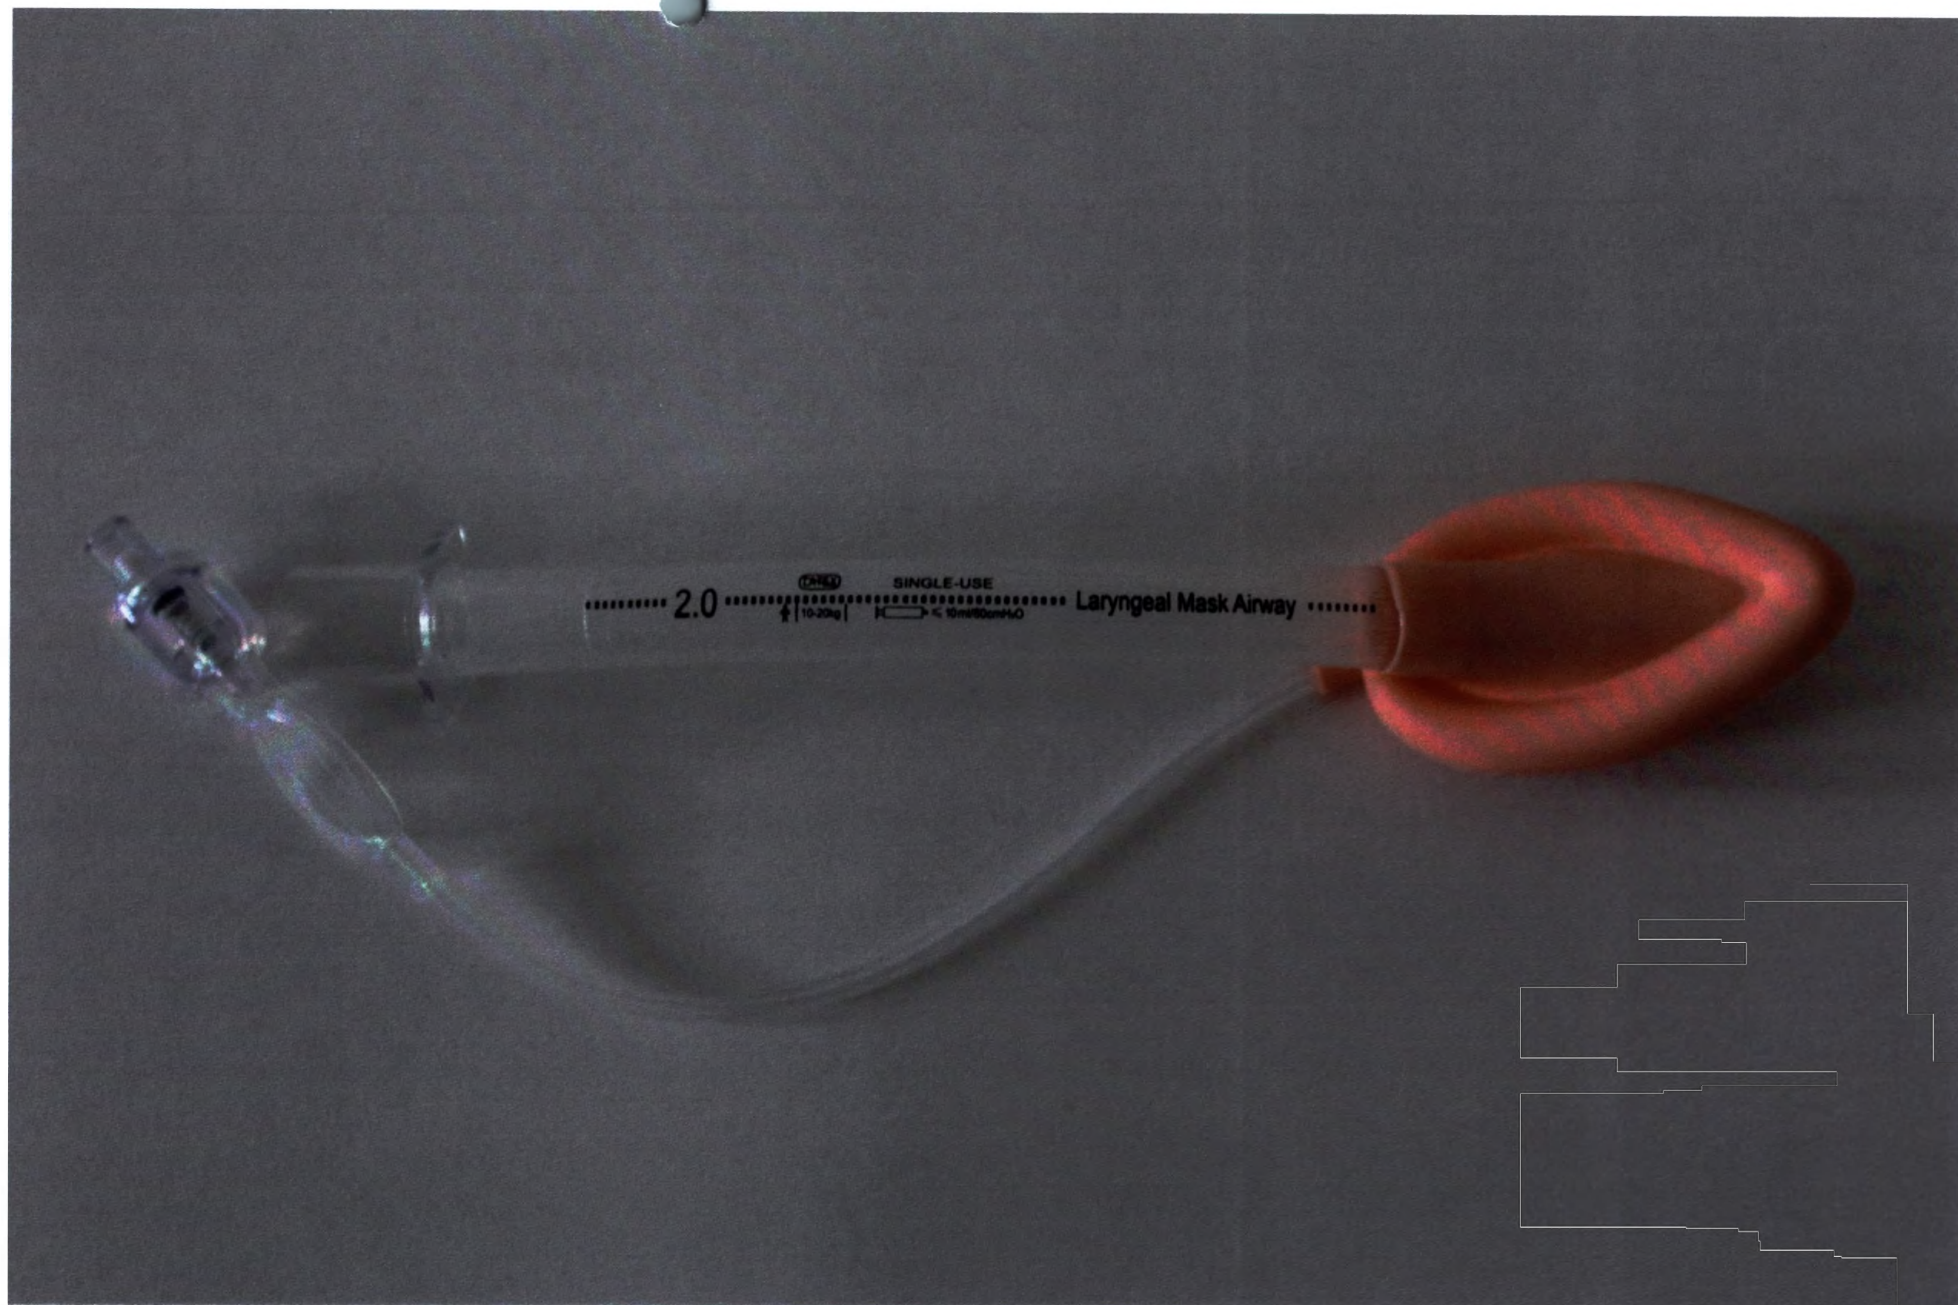


Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 2,0

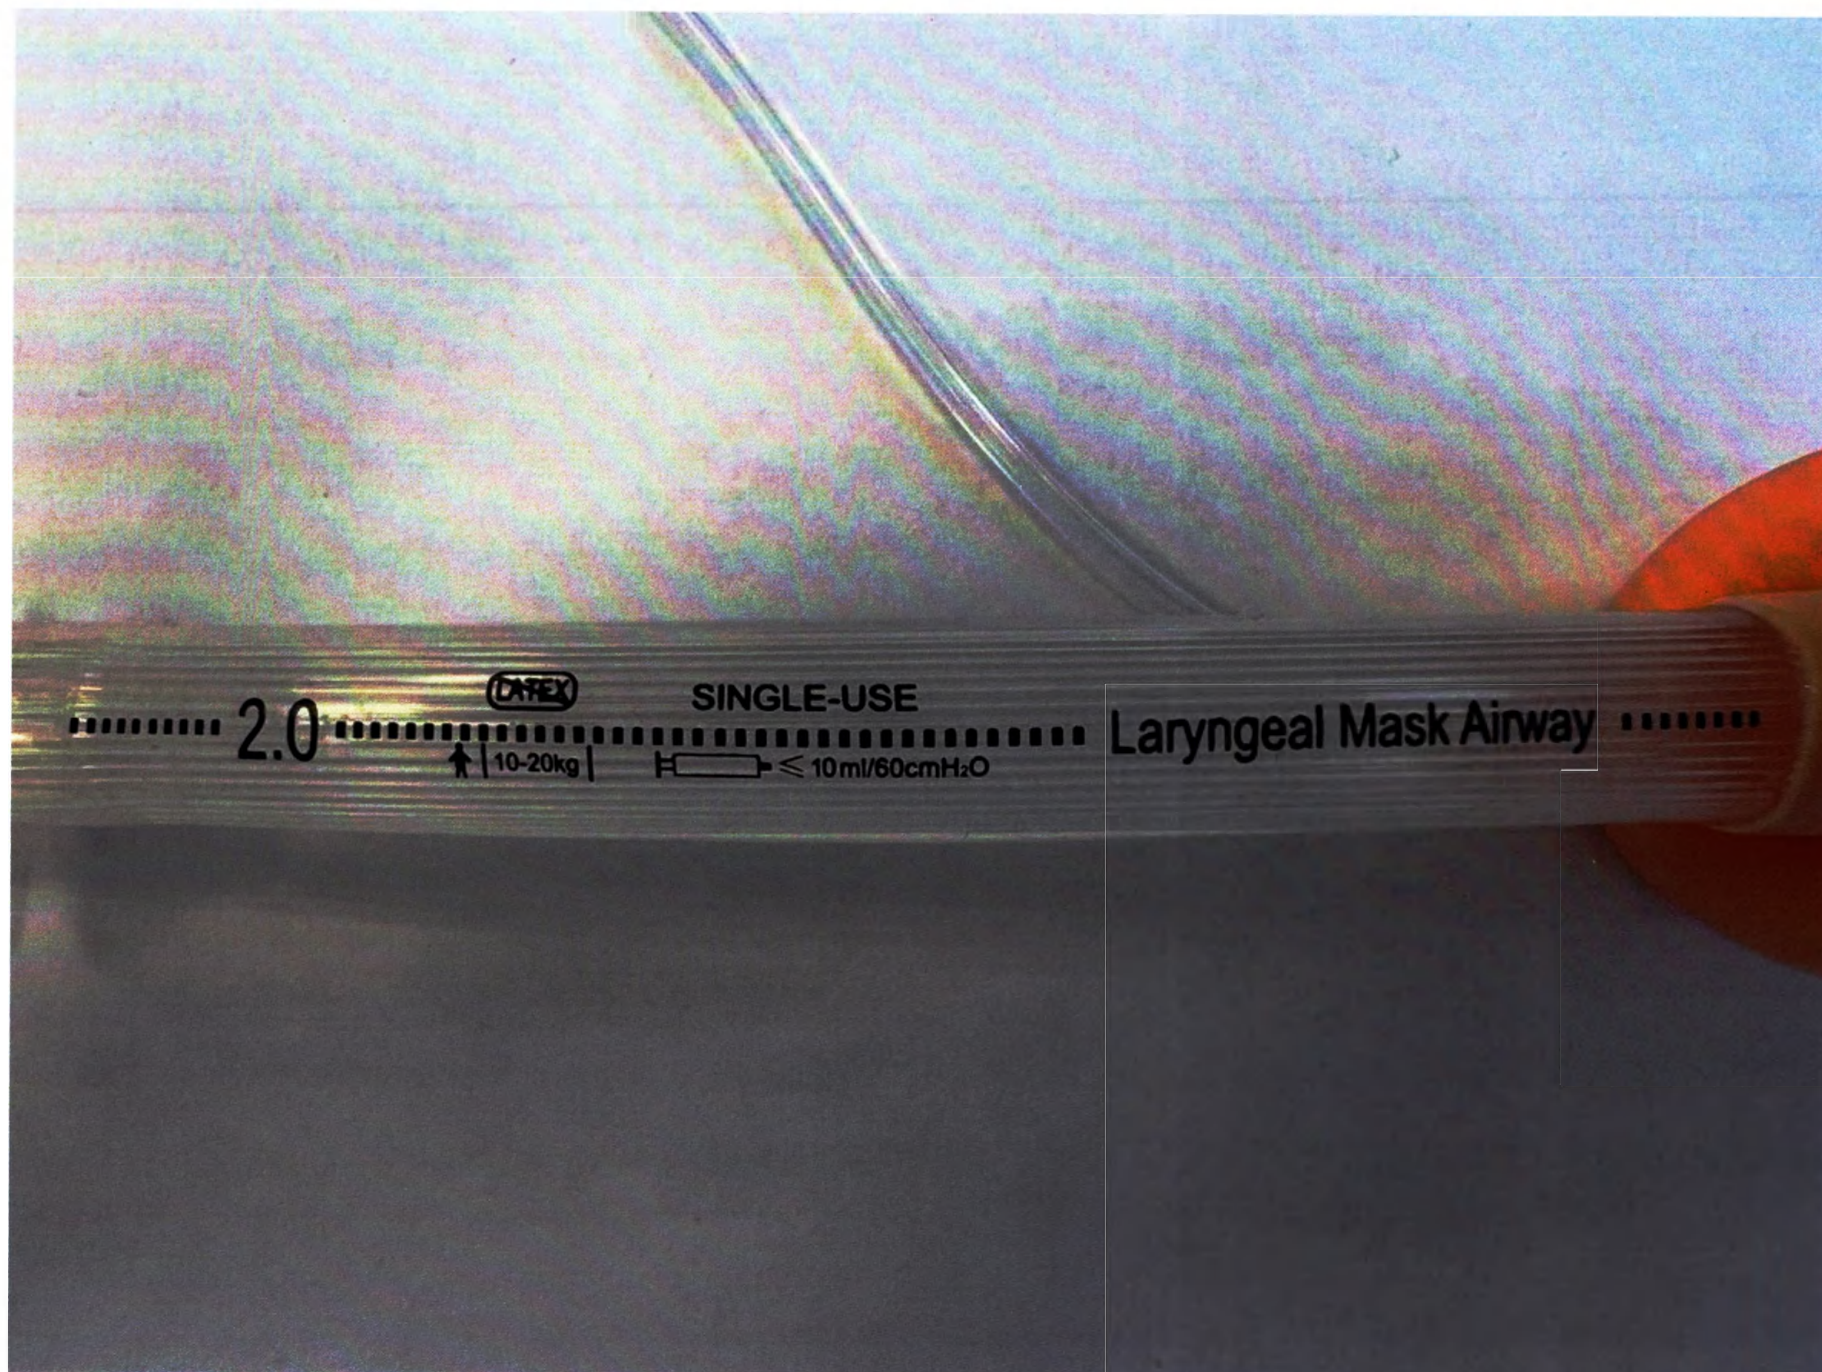

Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 2,0

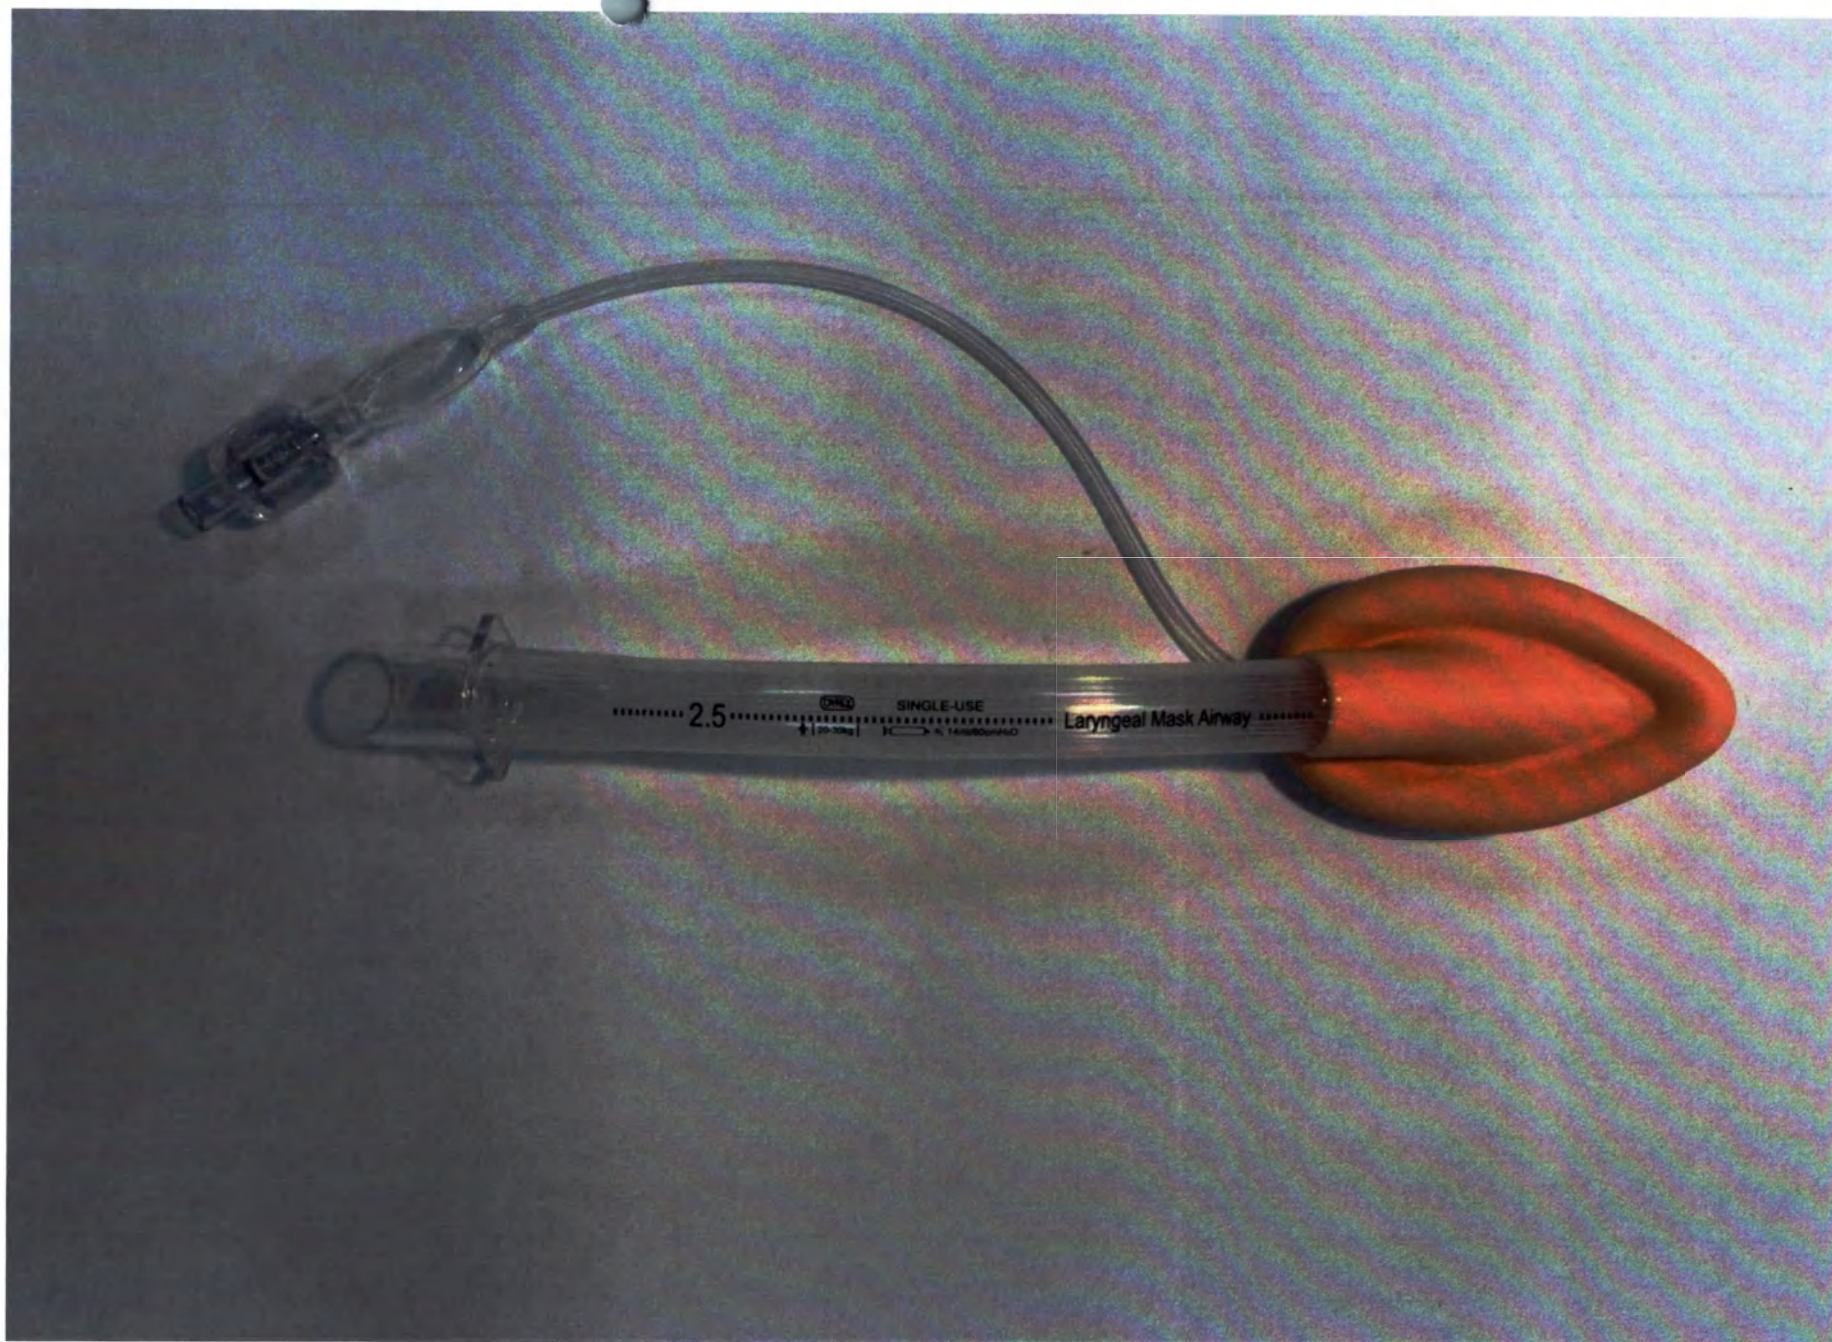


Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 2,5

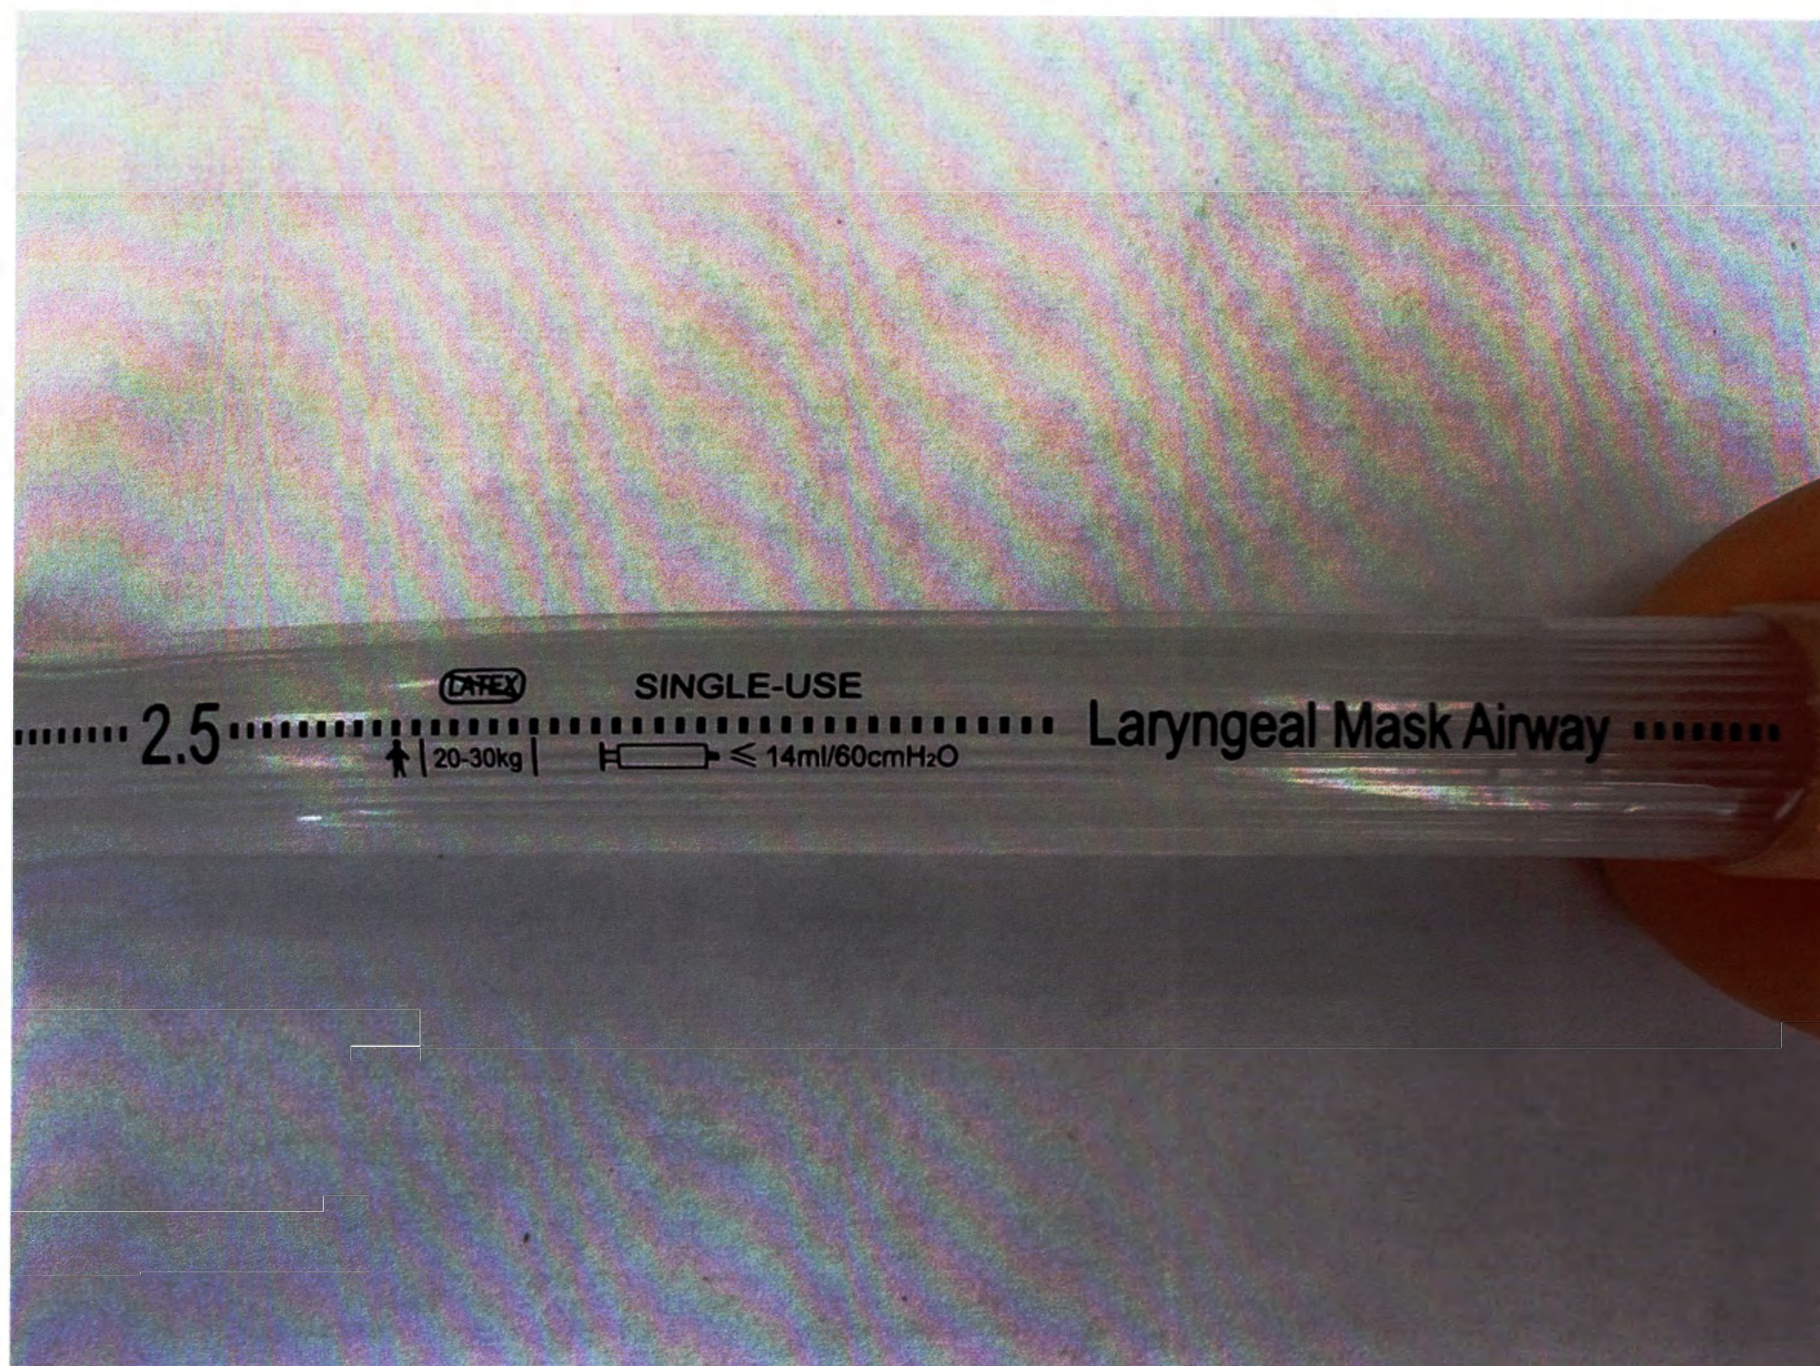


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 2,5



Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 3,0

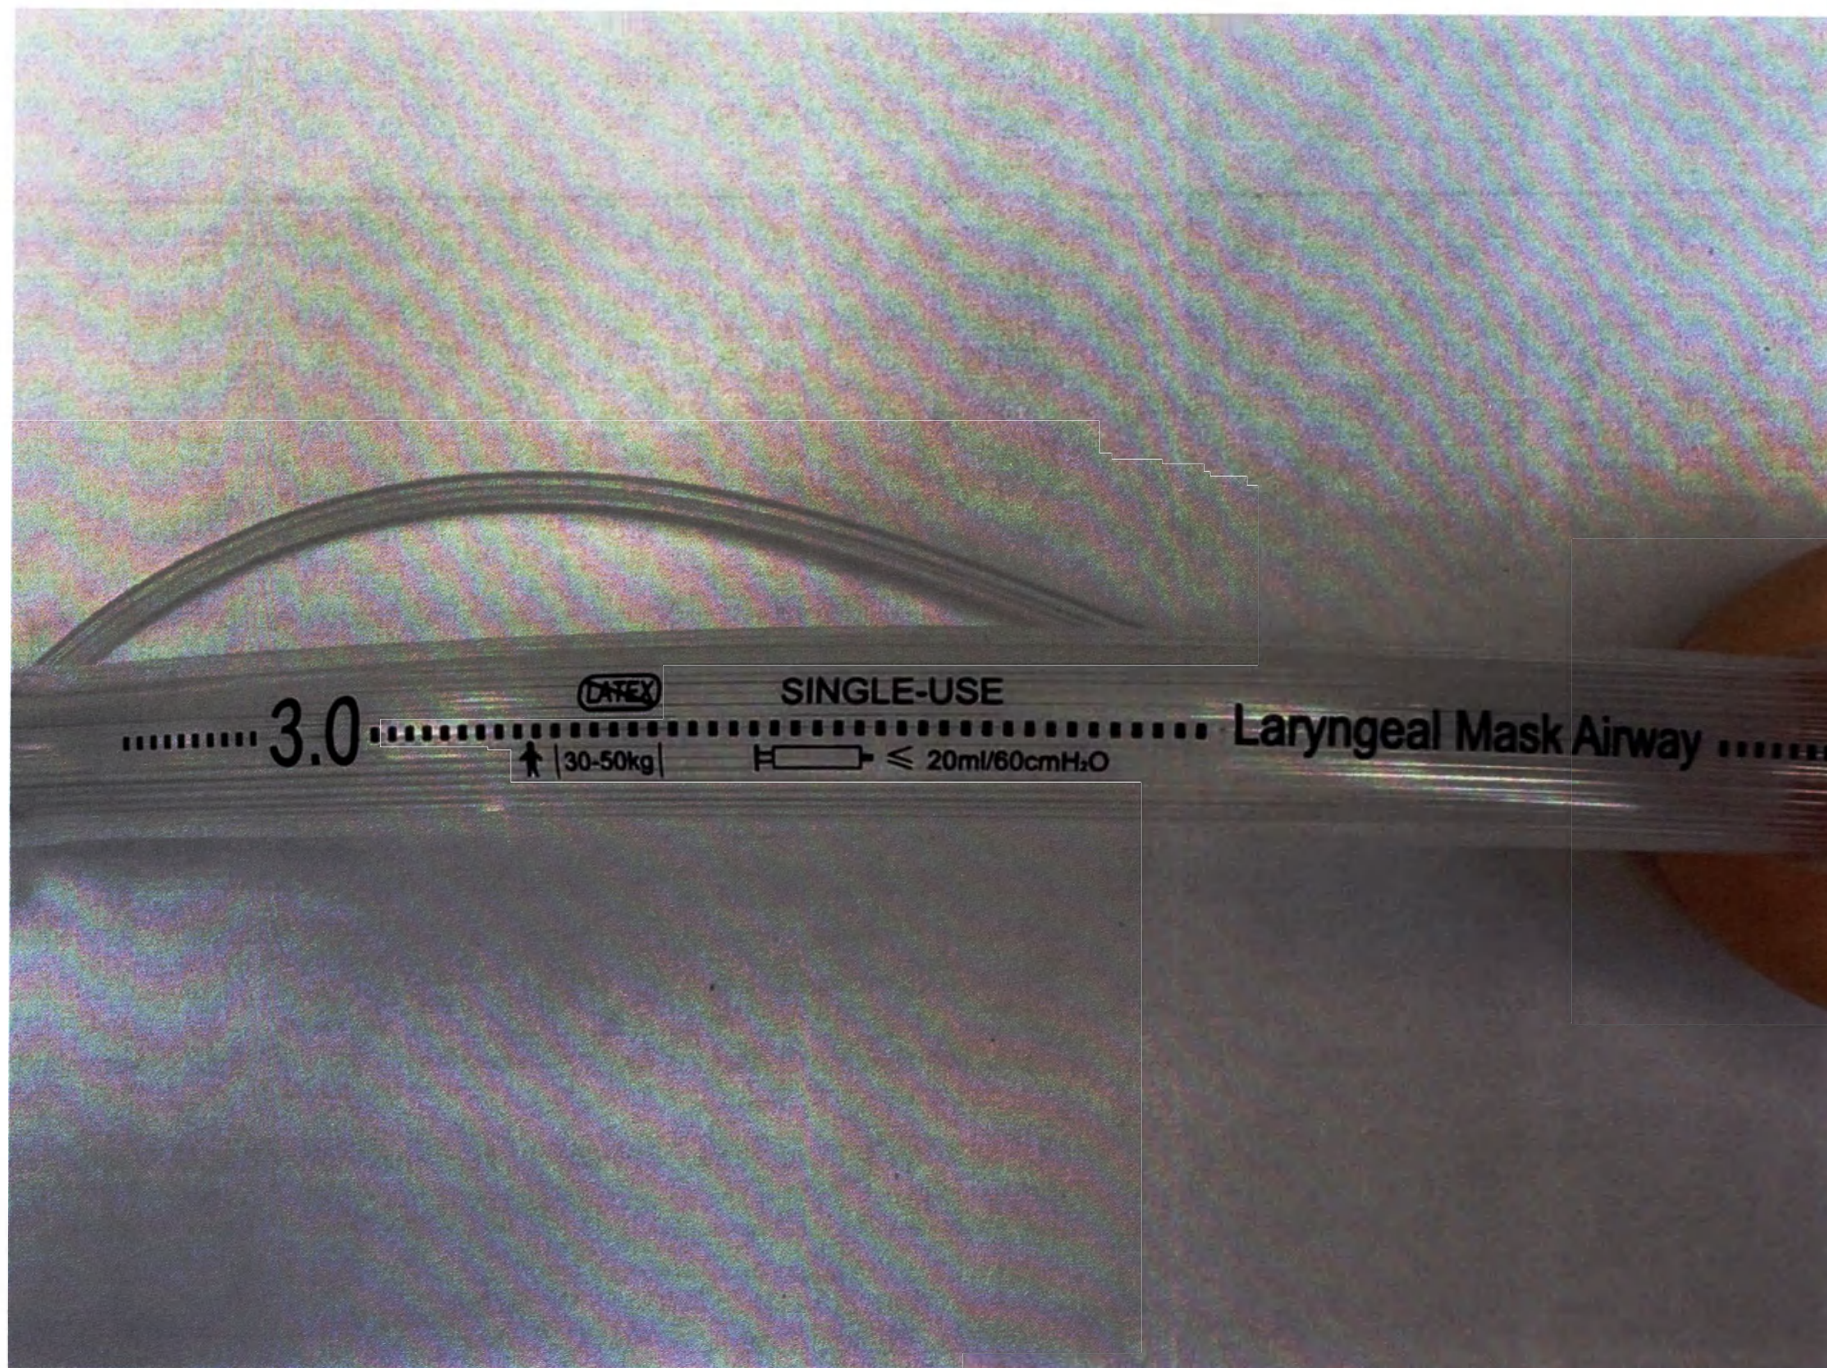

Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 3,0

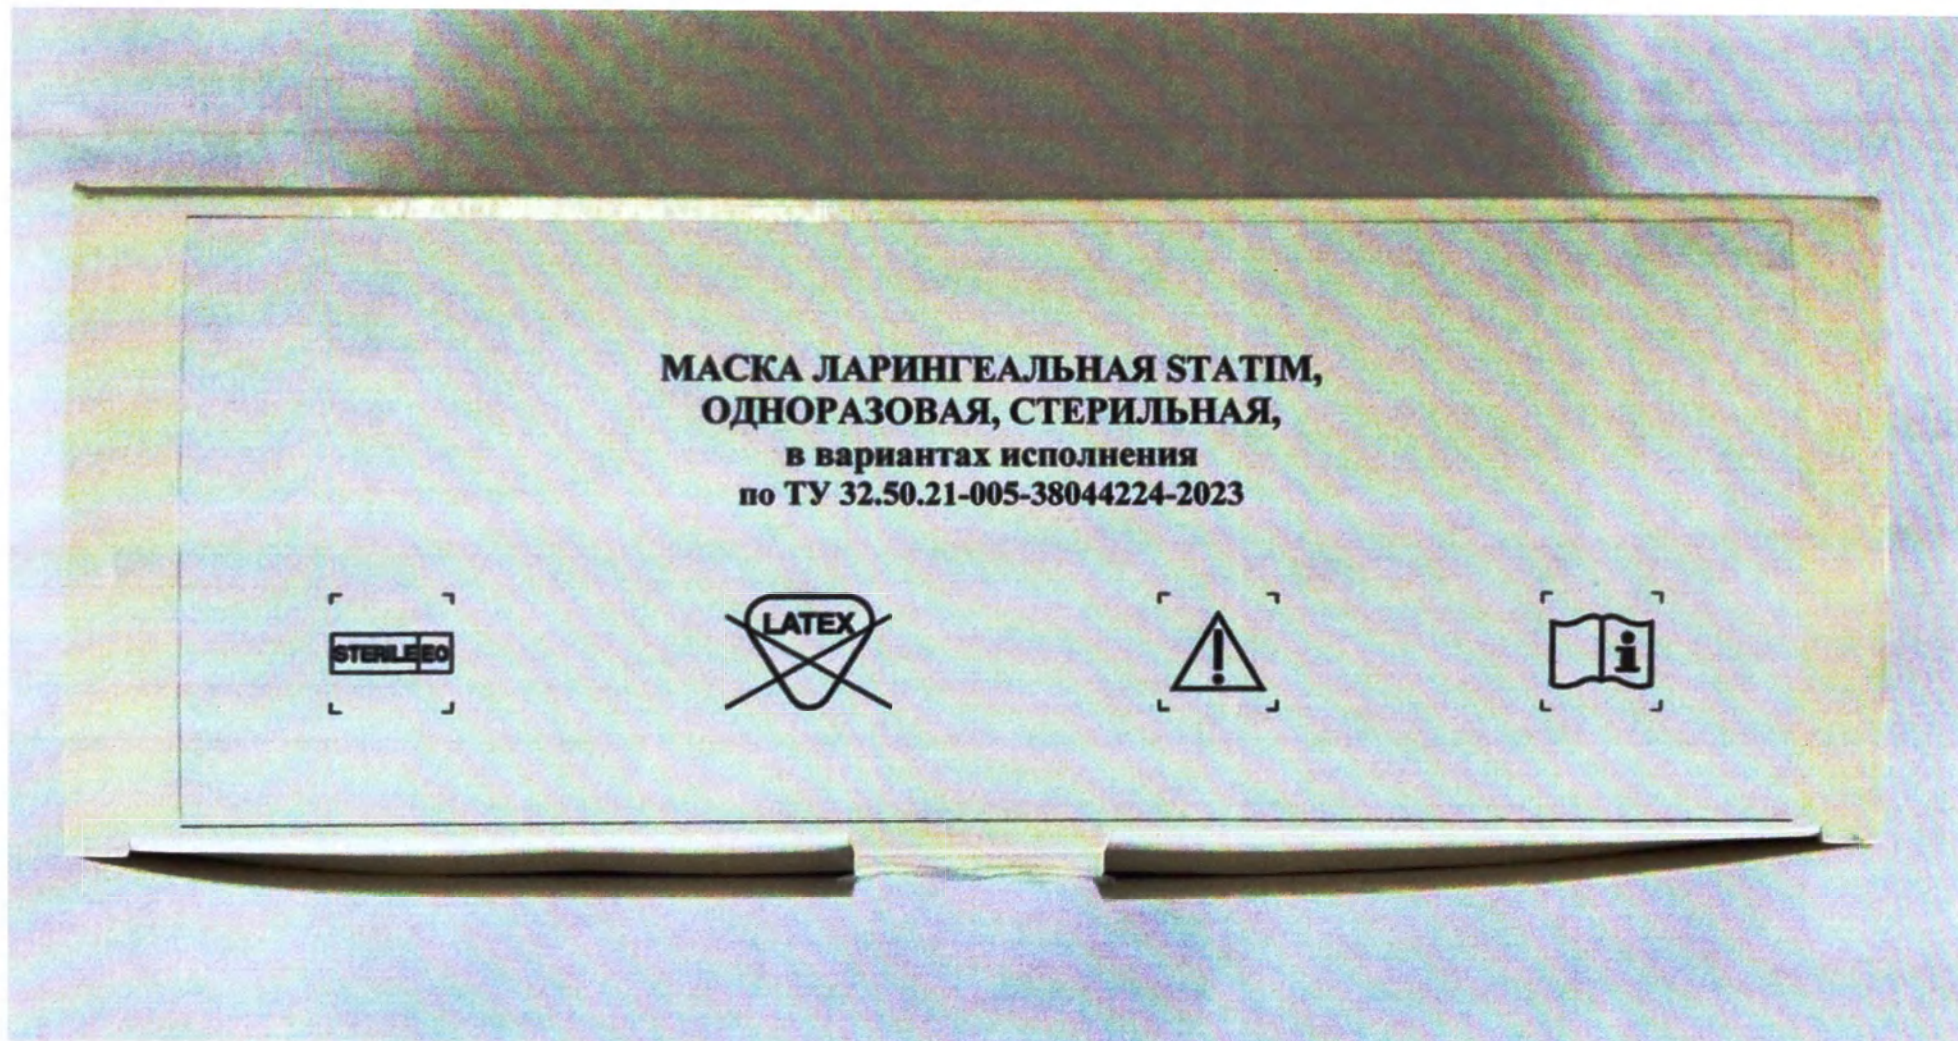

Потребительская упаковка Маски ларингеальной СТАТИМ силиконовой, размер 3,0

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительная влажность не более 100% при плюс 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Нетоксично

STERILIZED

Стерильно, стерилизация
оксидом этилена



Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер
3,0 – 2 шт.



03.04.2024

LOT

240180



02.04.2029

REF

LM3020S1



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург,
ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50


Адрес места
производства:

ООО «Риг Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область,
Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п.,
тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й
кв-л, д. 3, стр. 1.


Ningbo Foyomed Medical Instruments Co.,
Ltd.

Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin
Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Потребительская упаковка Маски ларингеальной STATIM силиконовой, размер 3,0

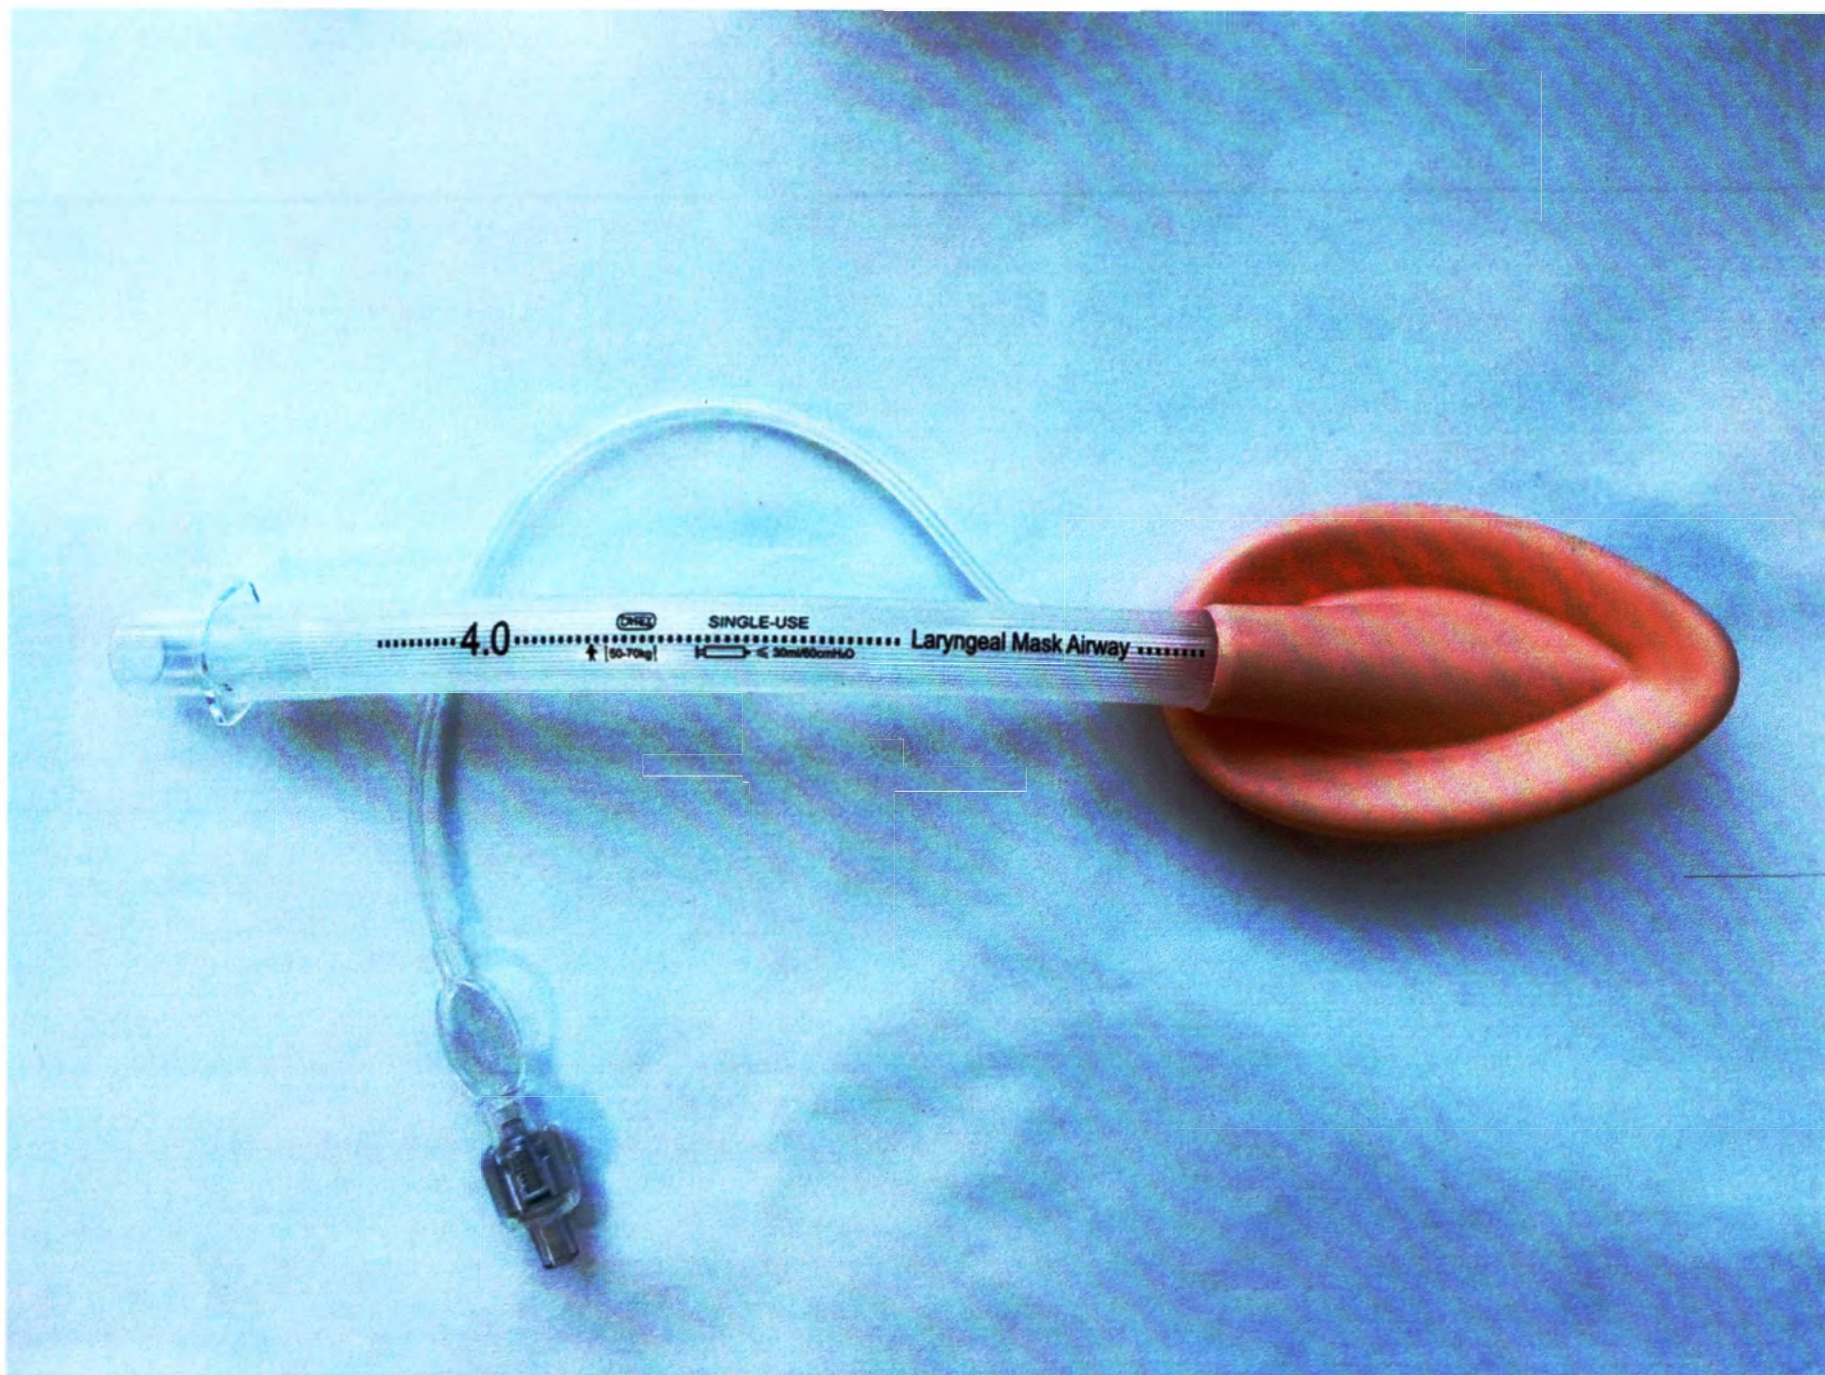


Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 4,0

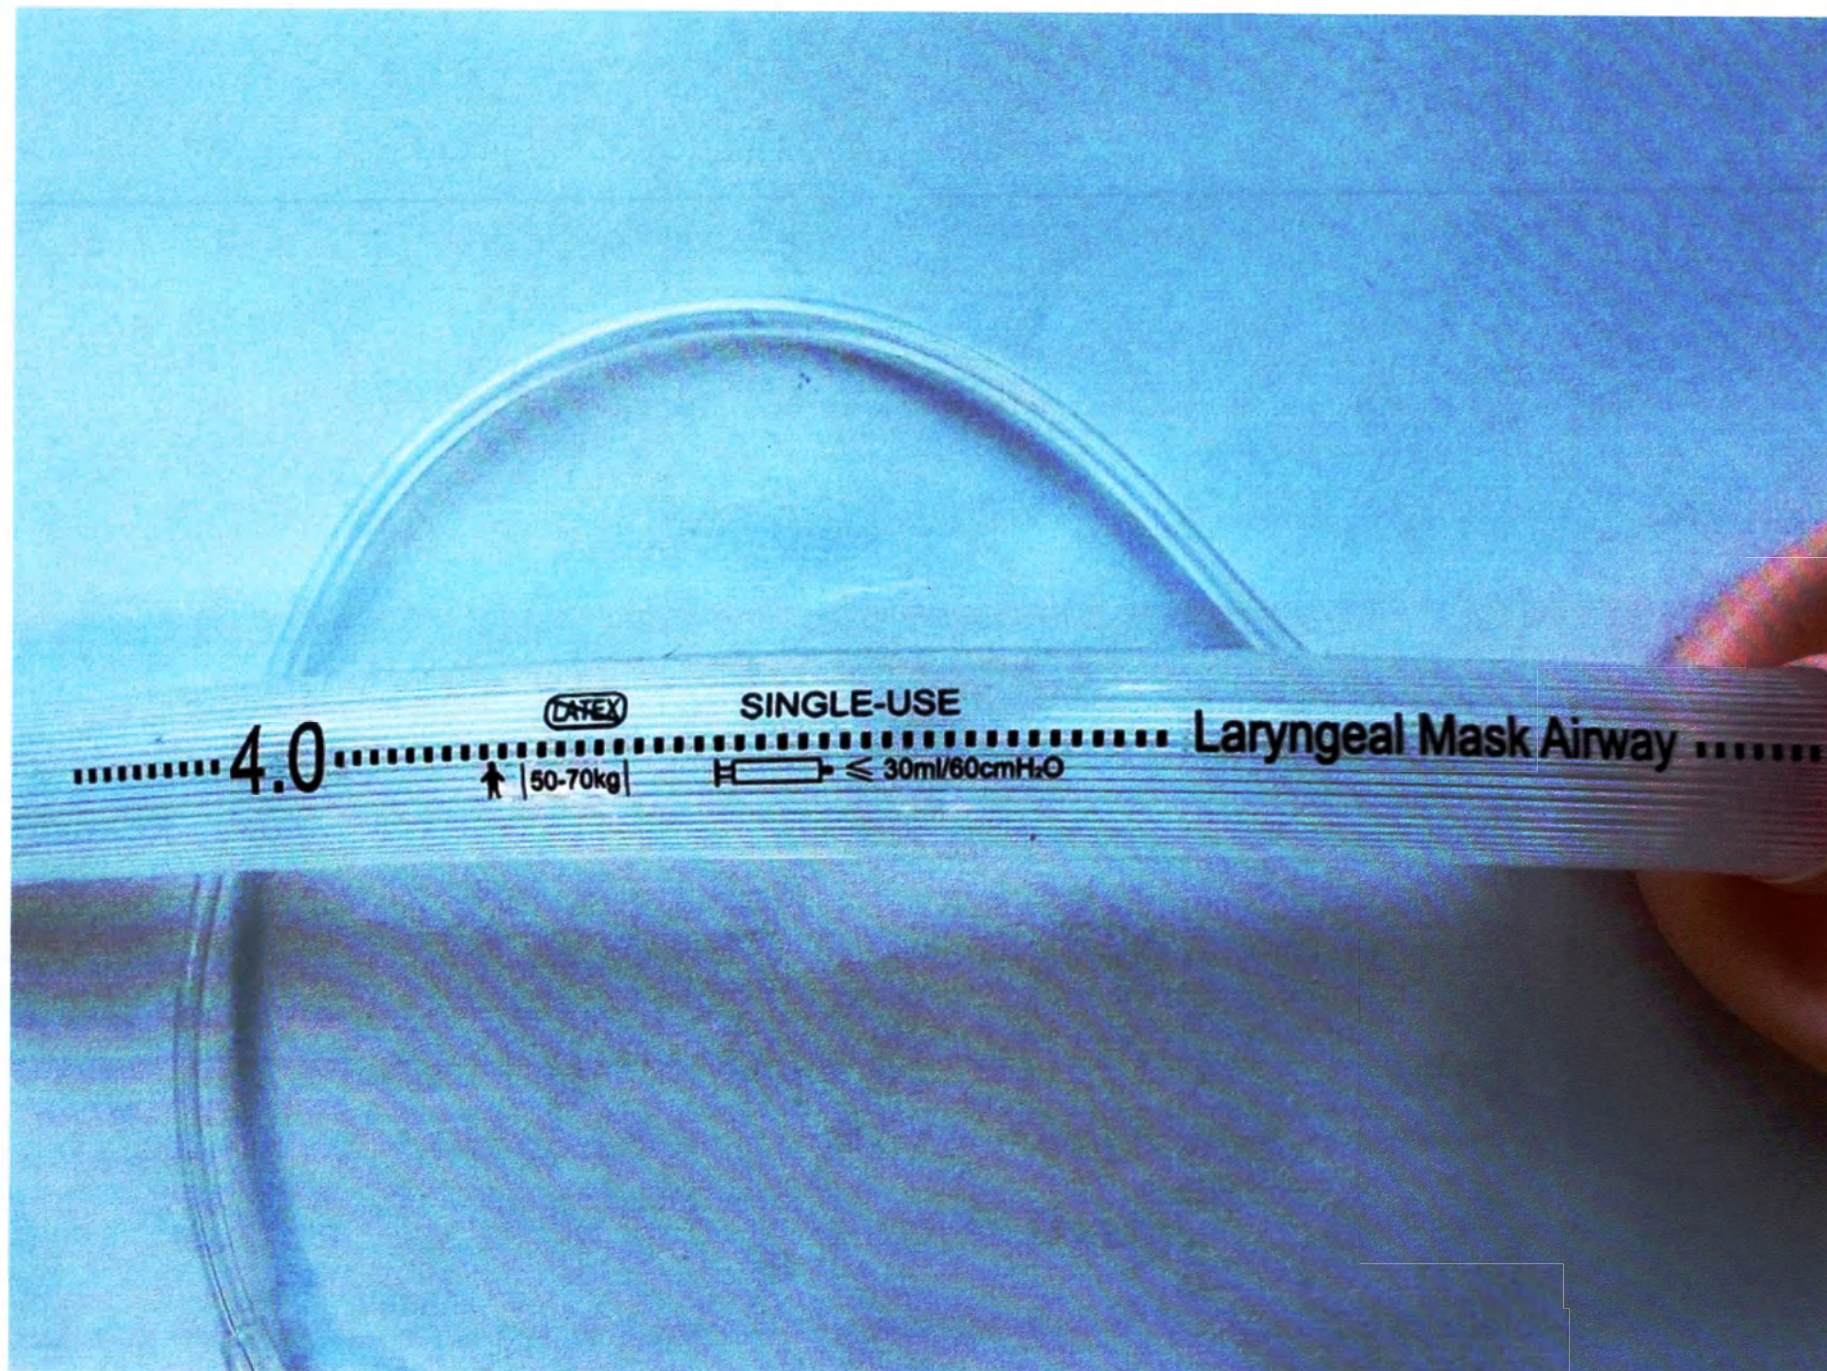


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 4,0

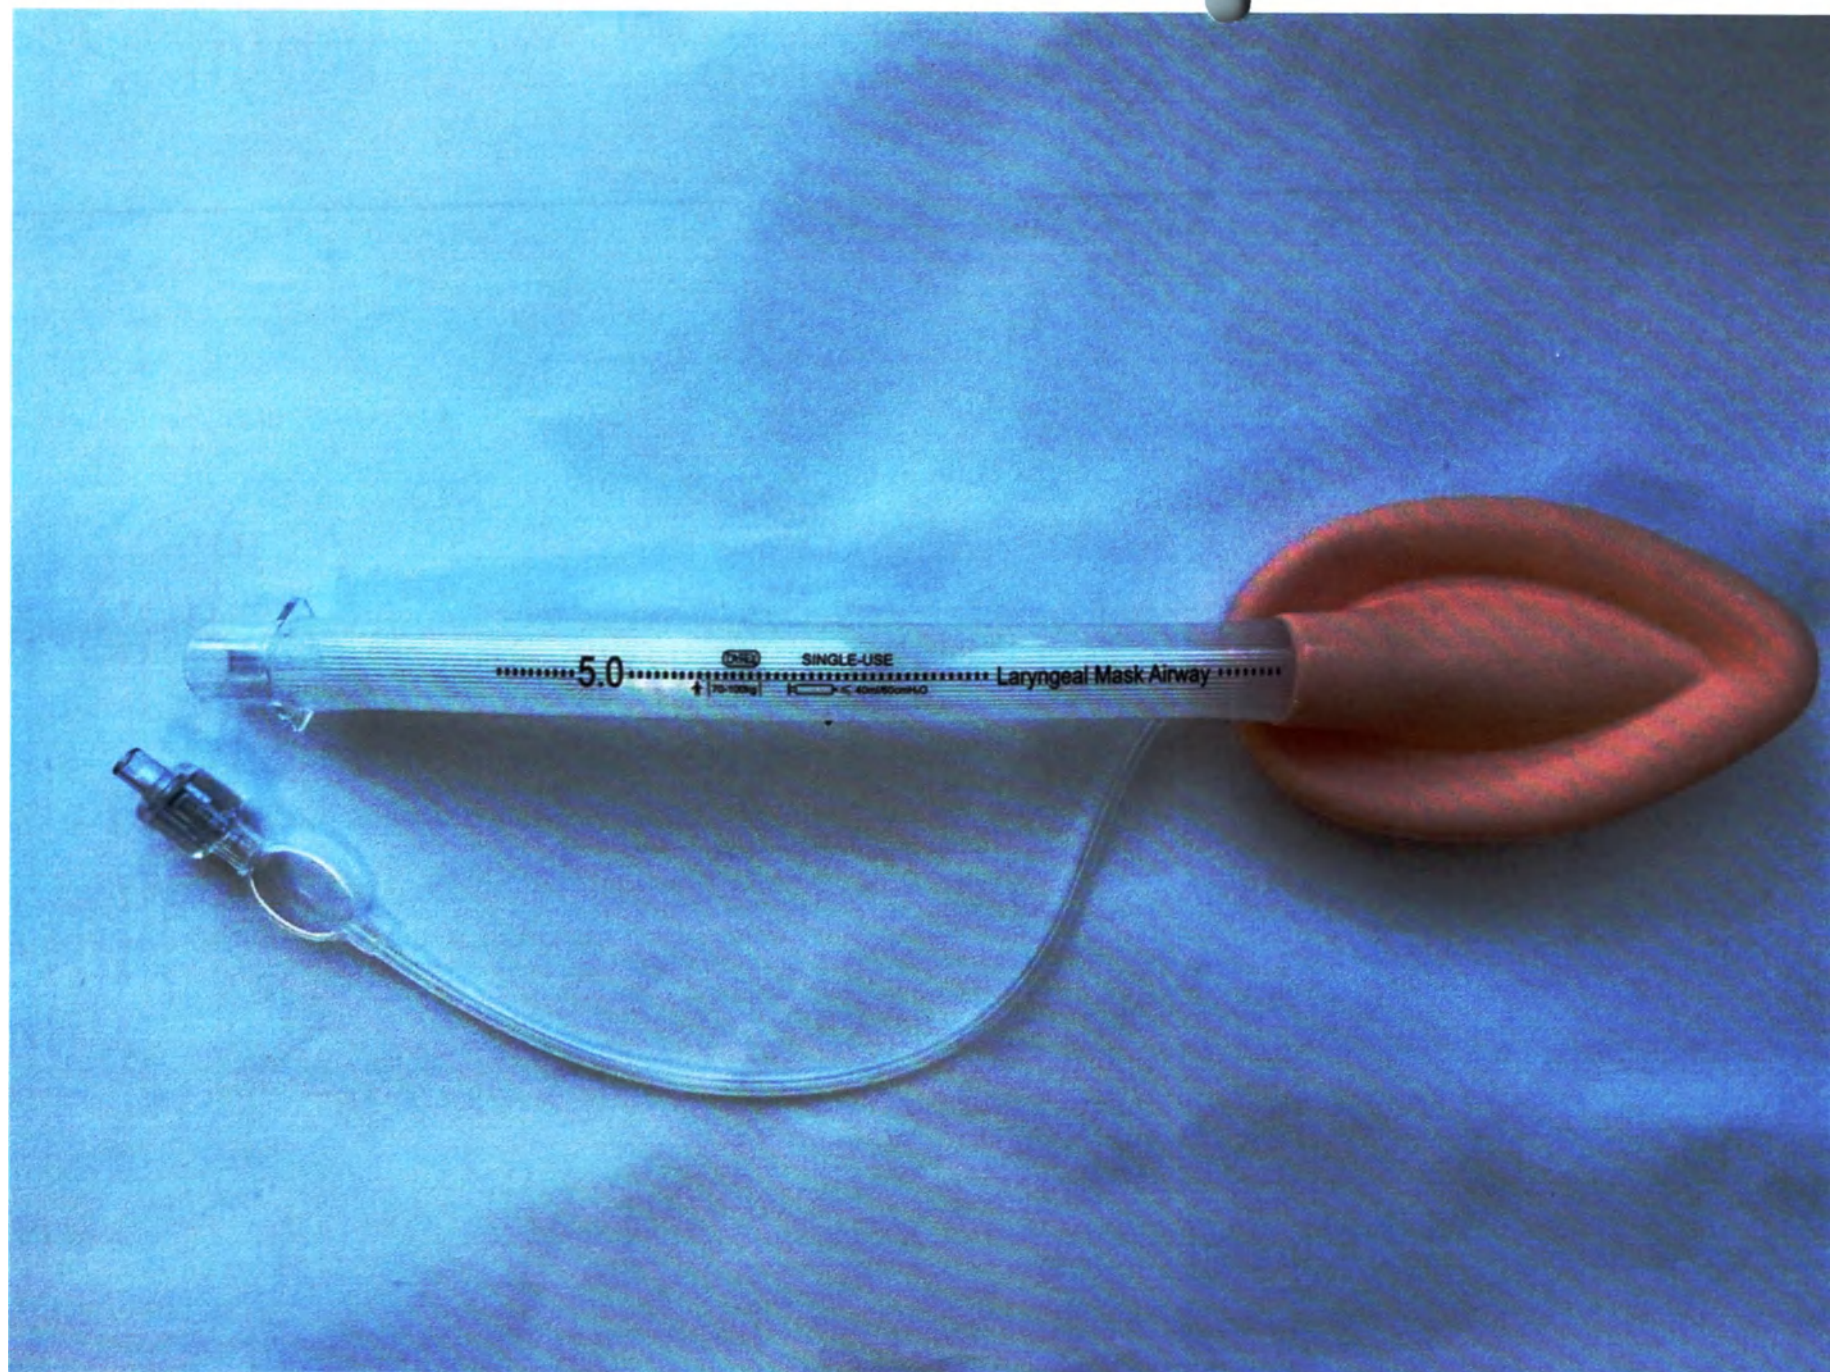


Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 5,0

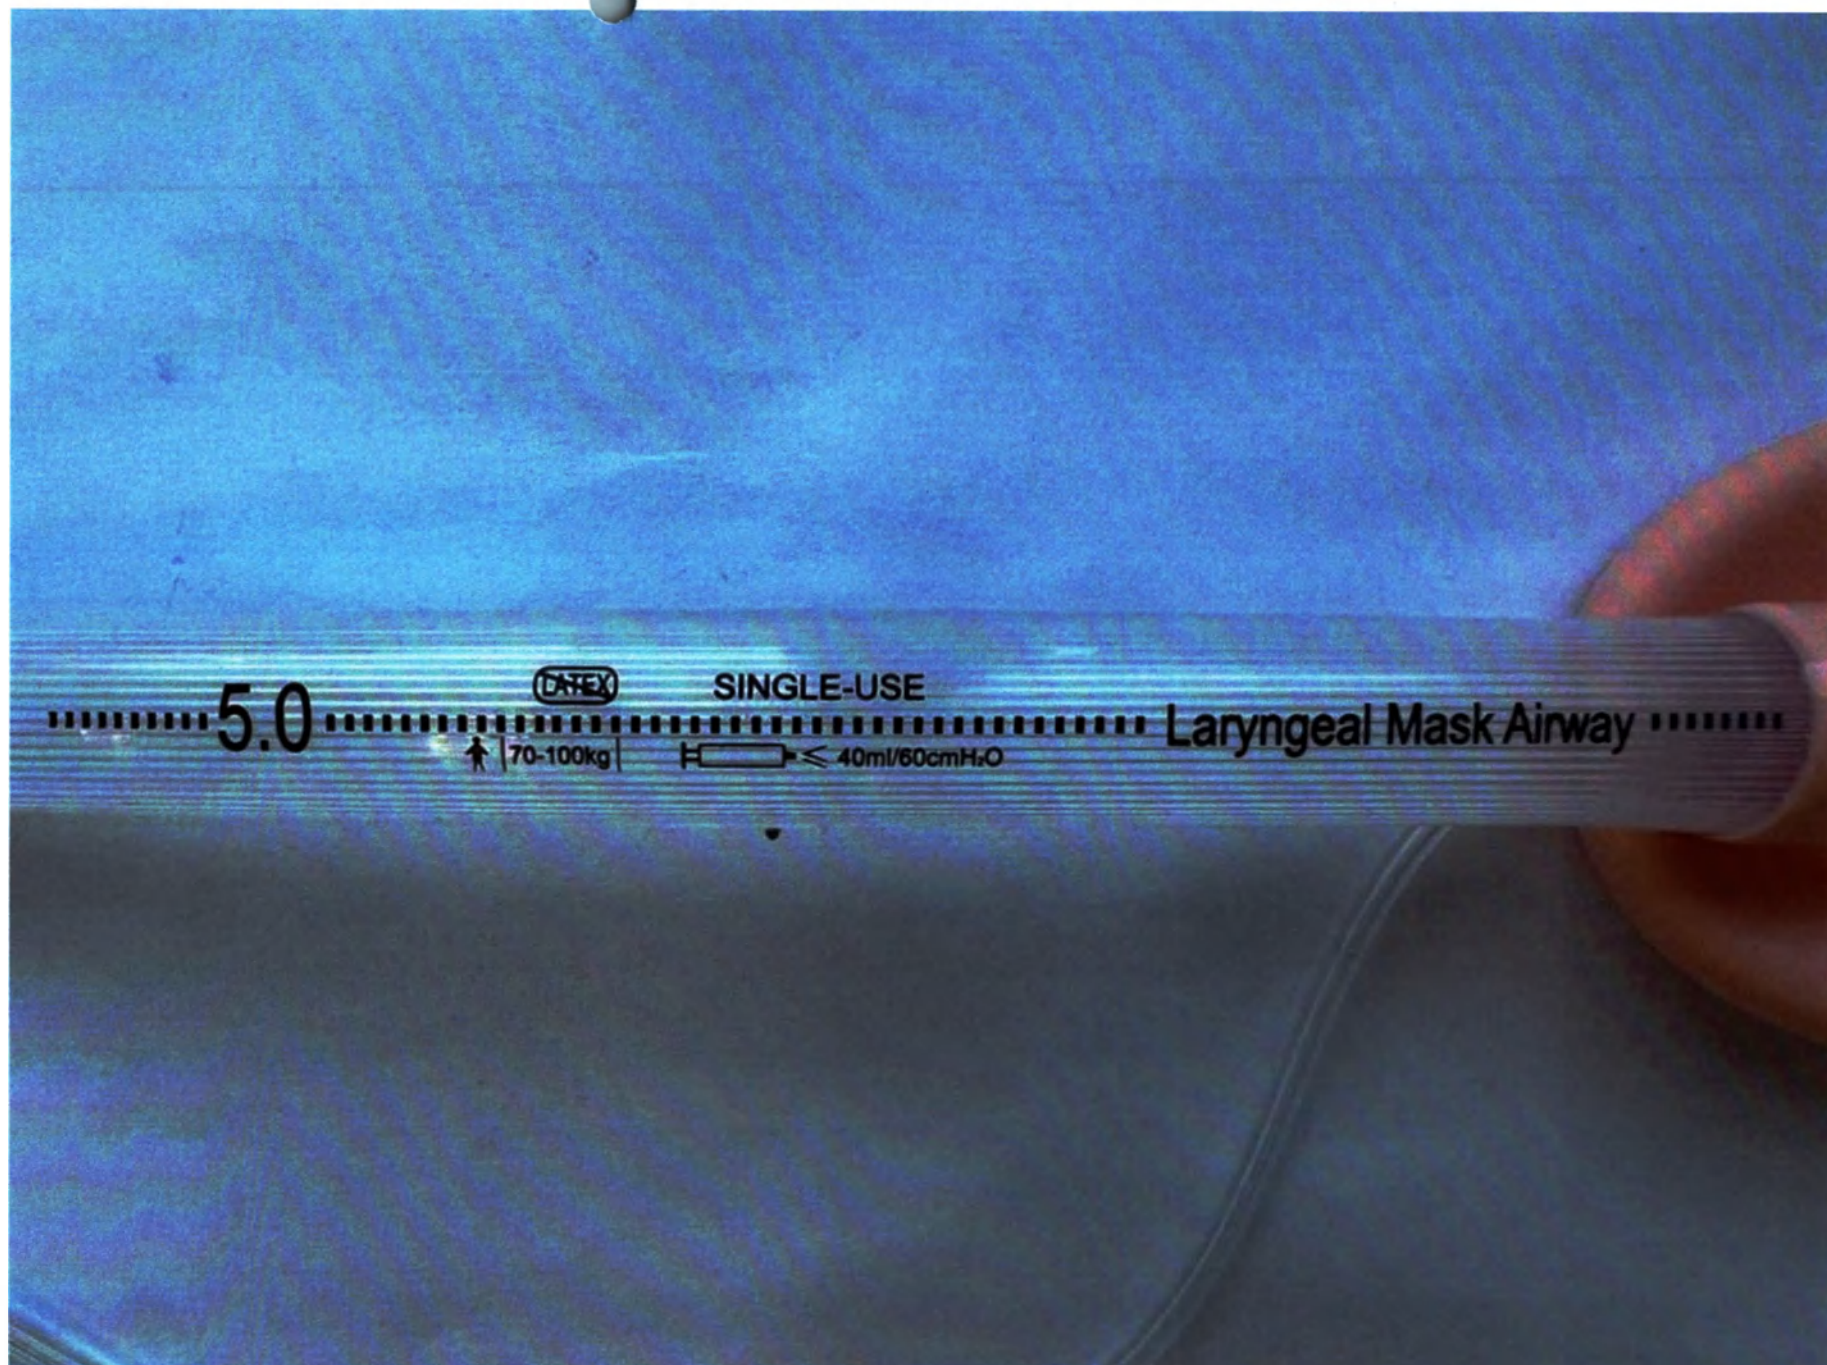


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 5,0

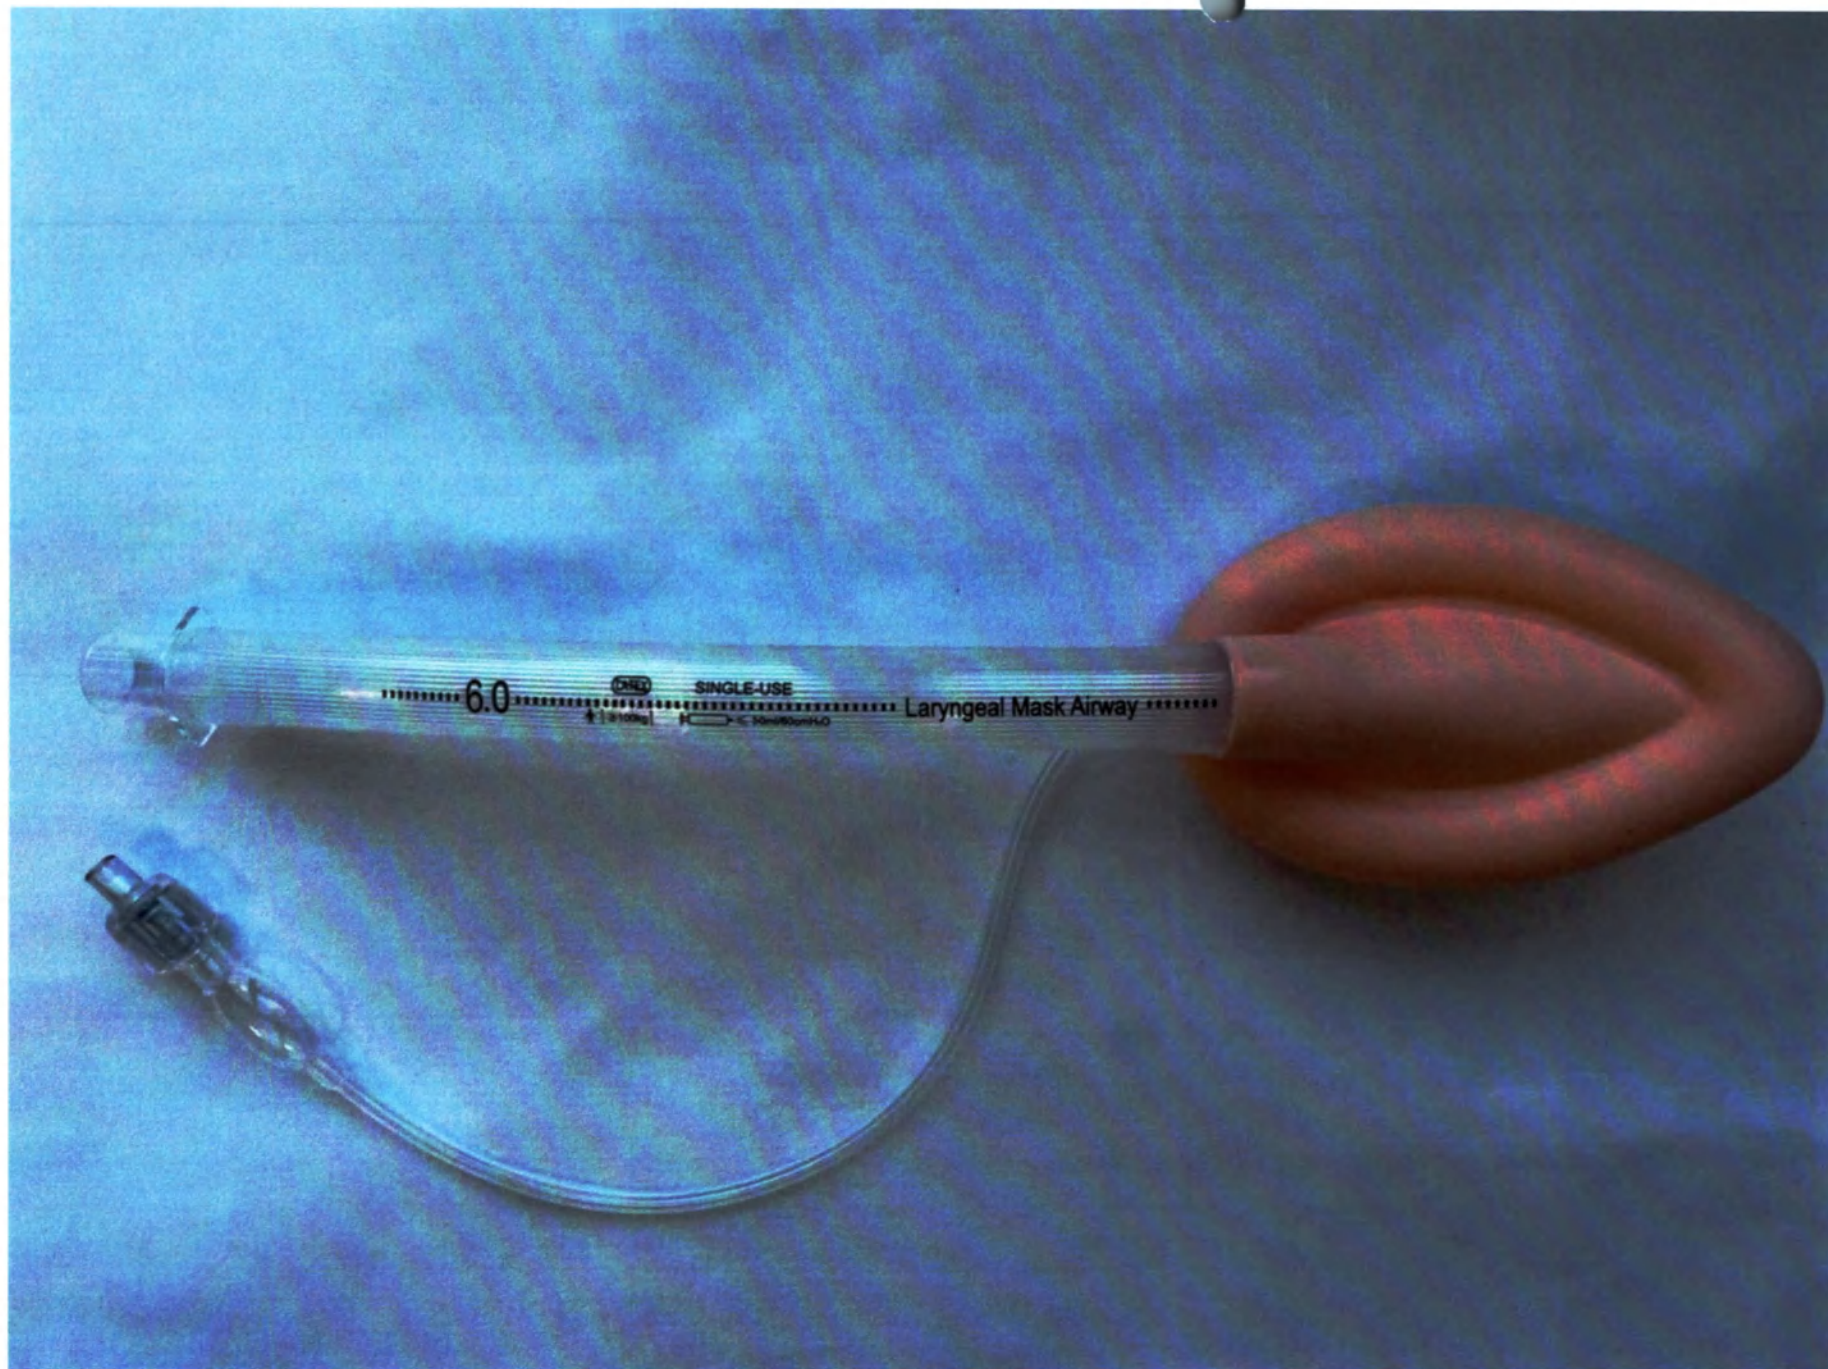


Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 6,0

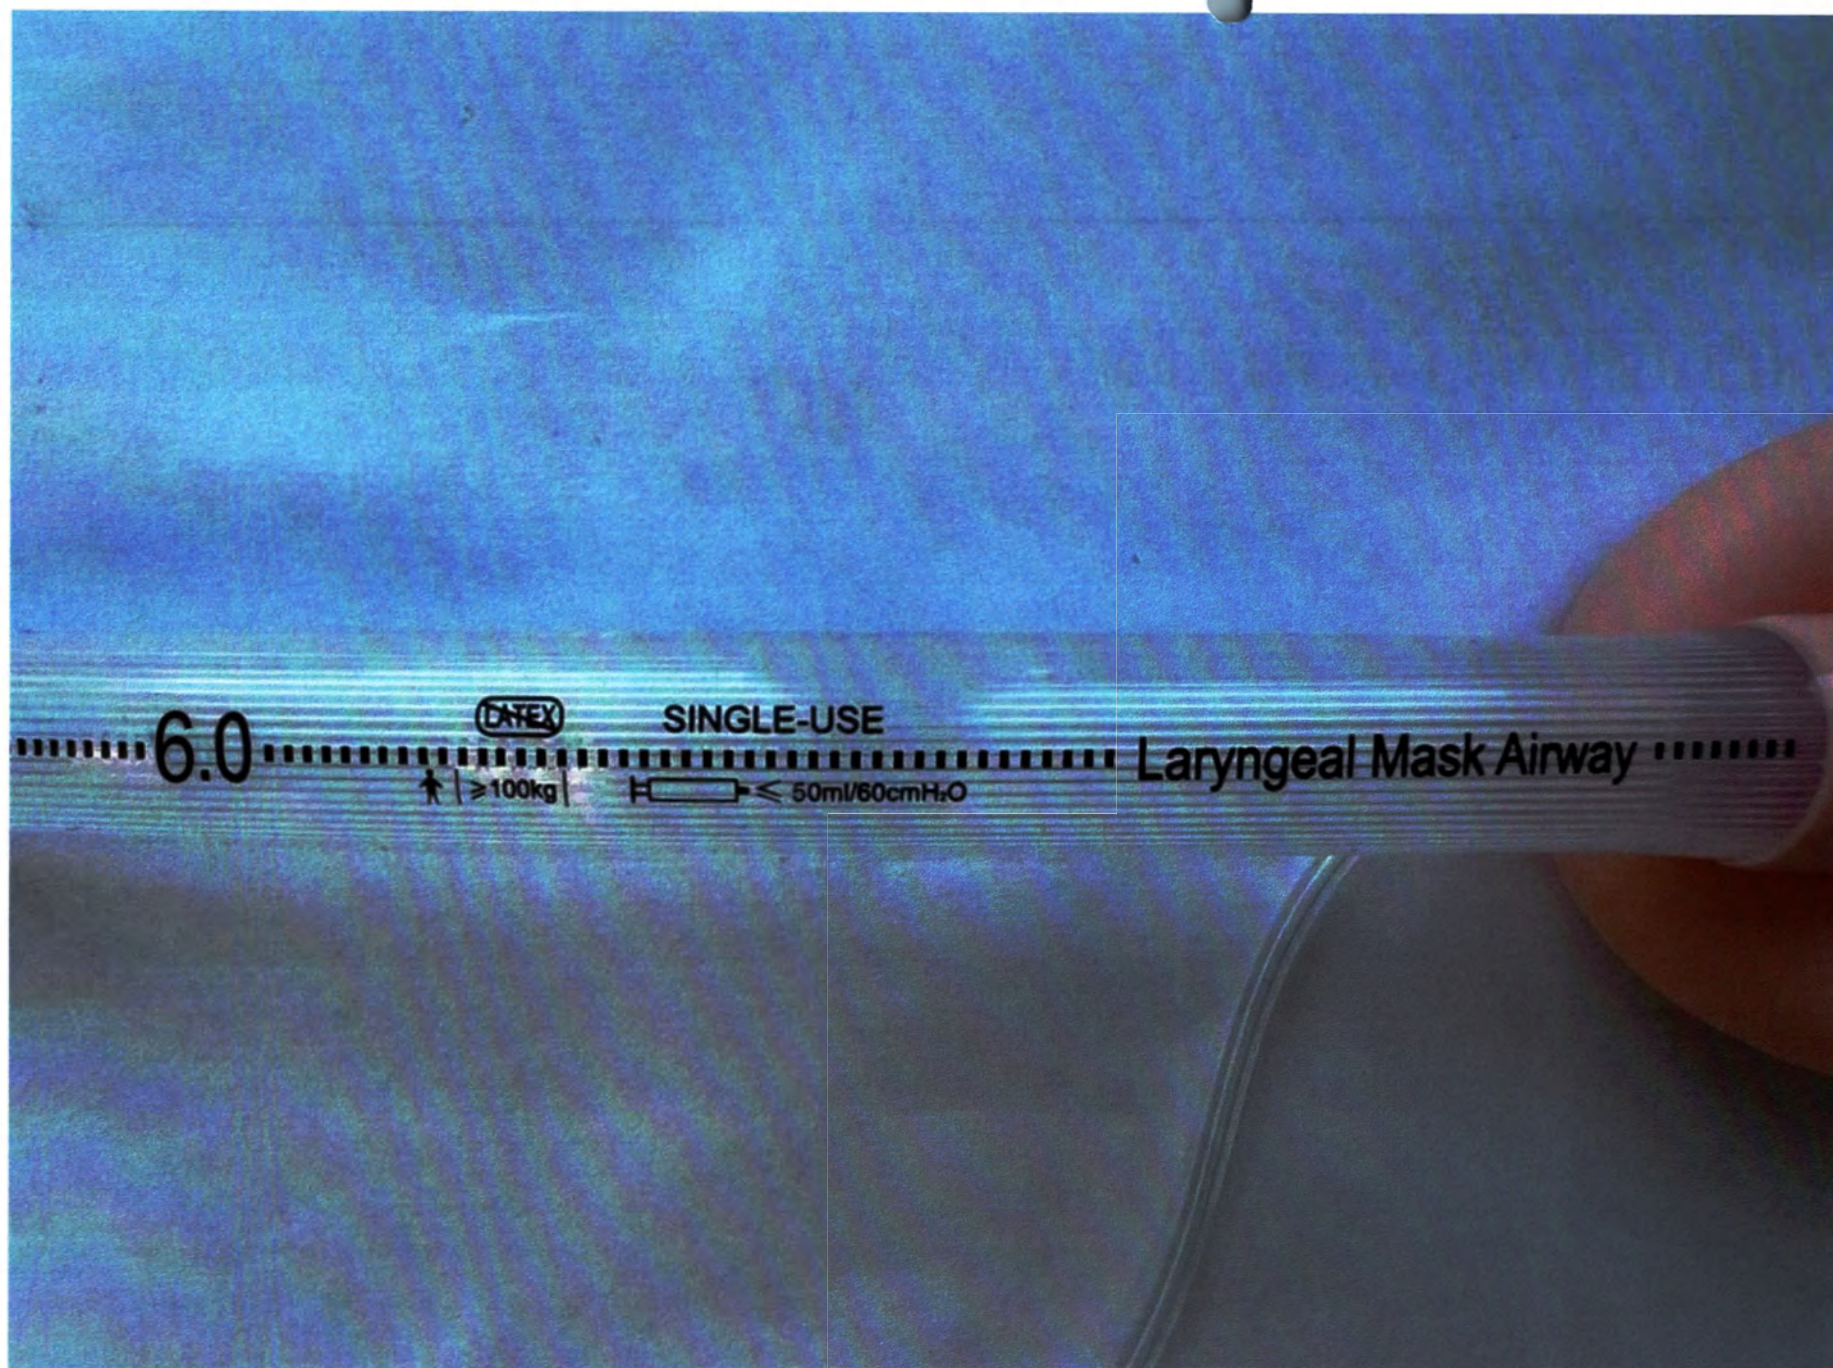


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 6,0

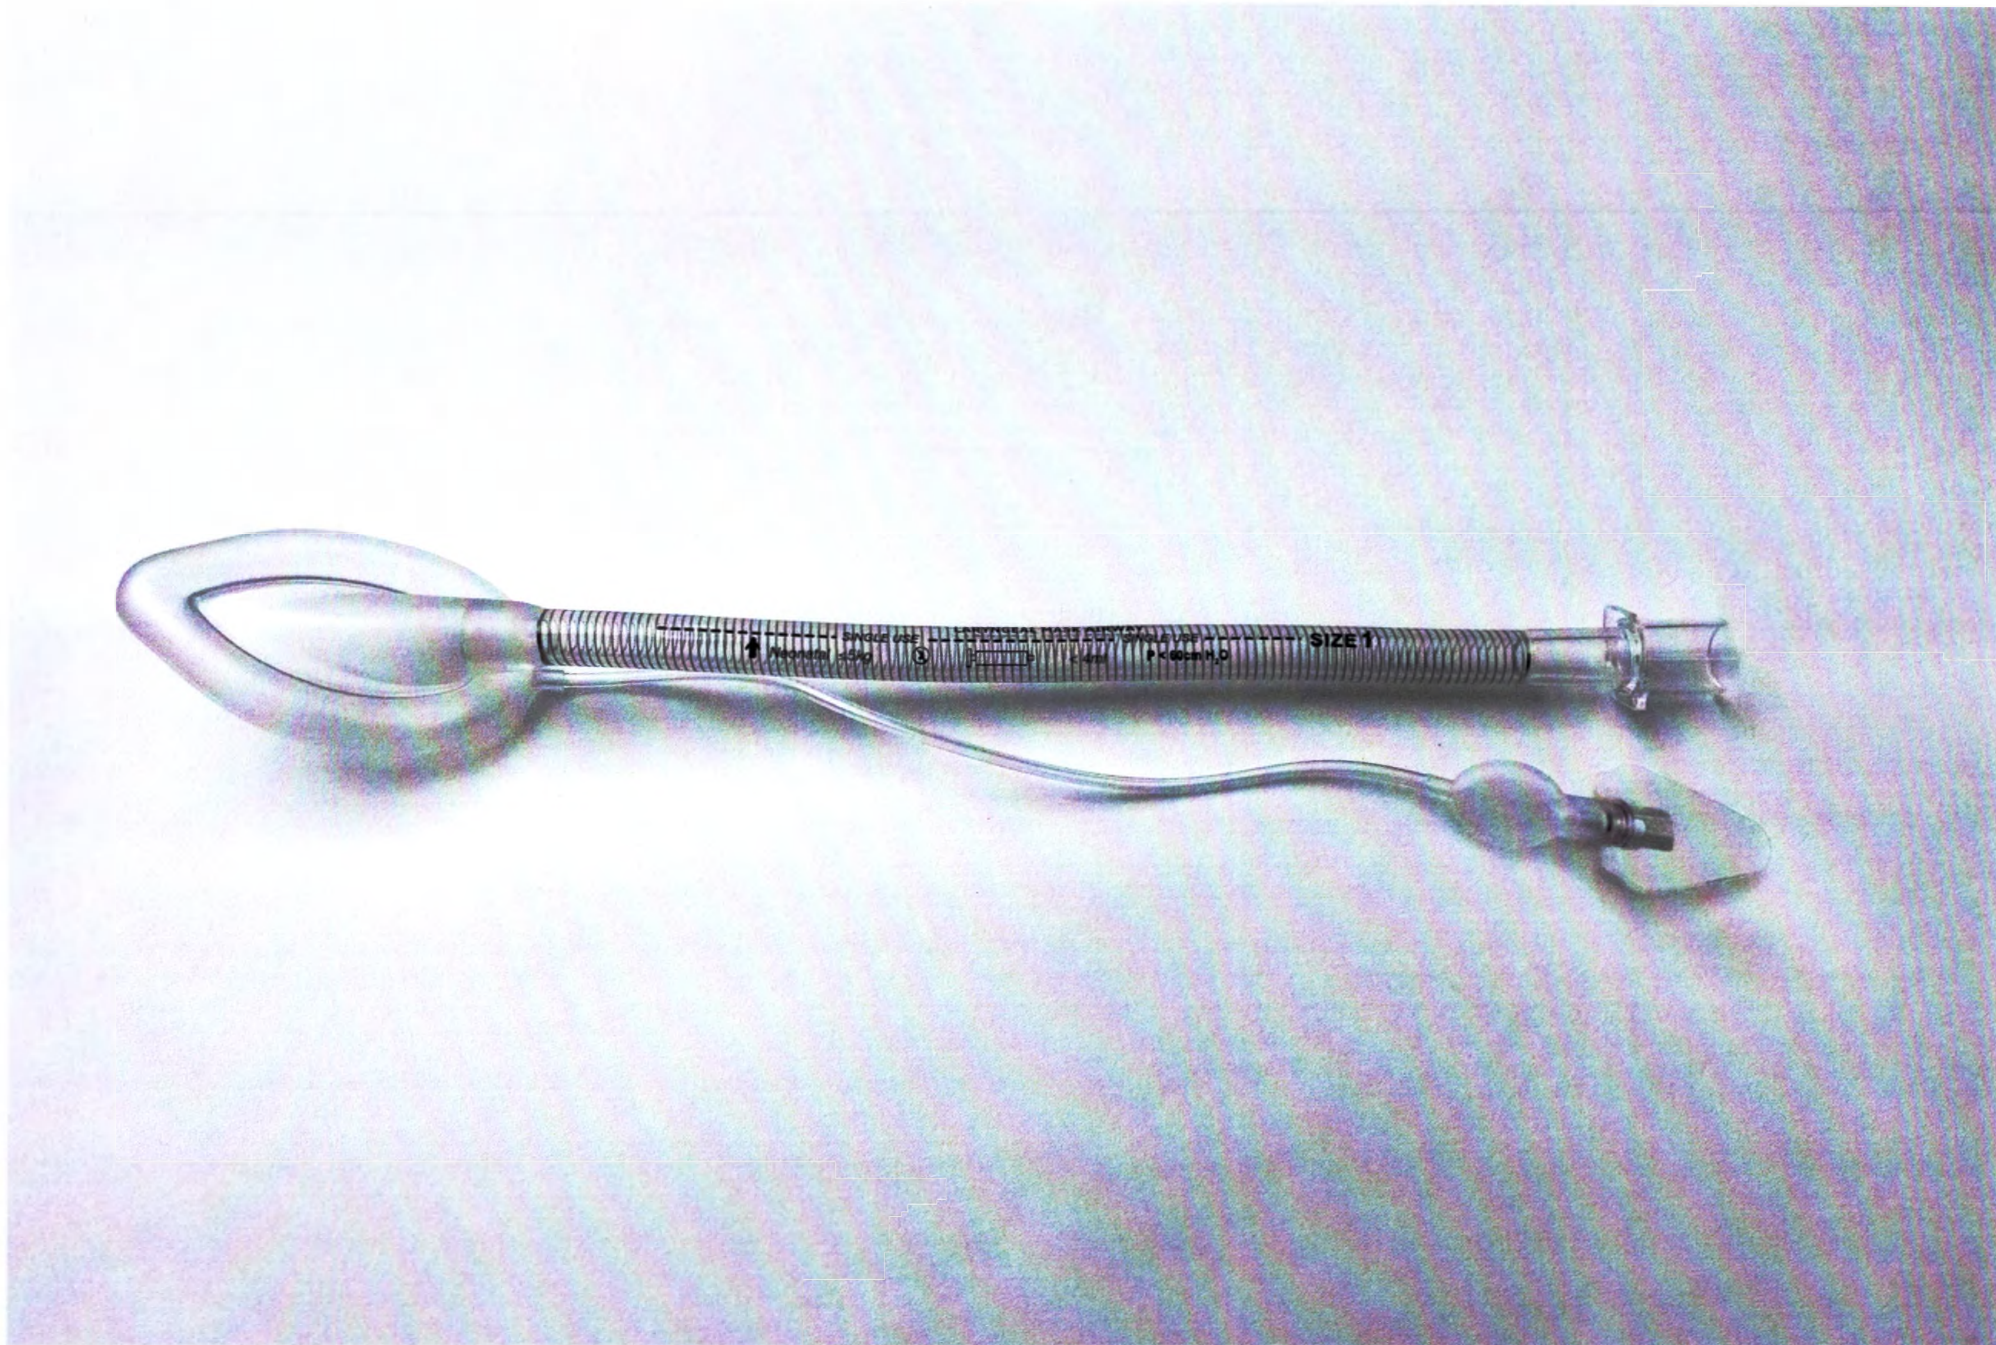


Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 1,0

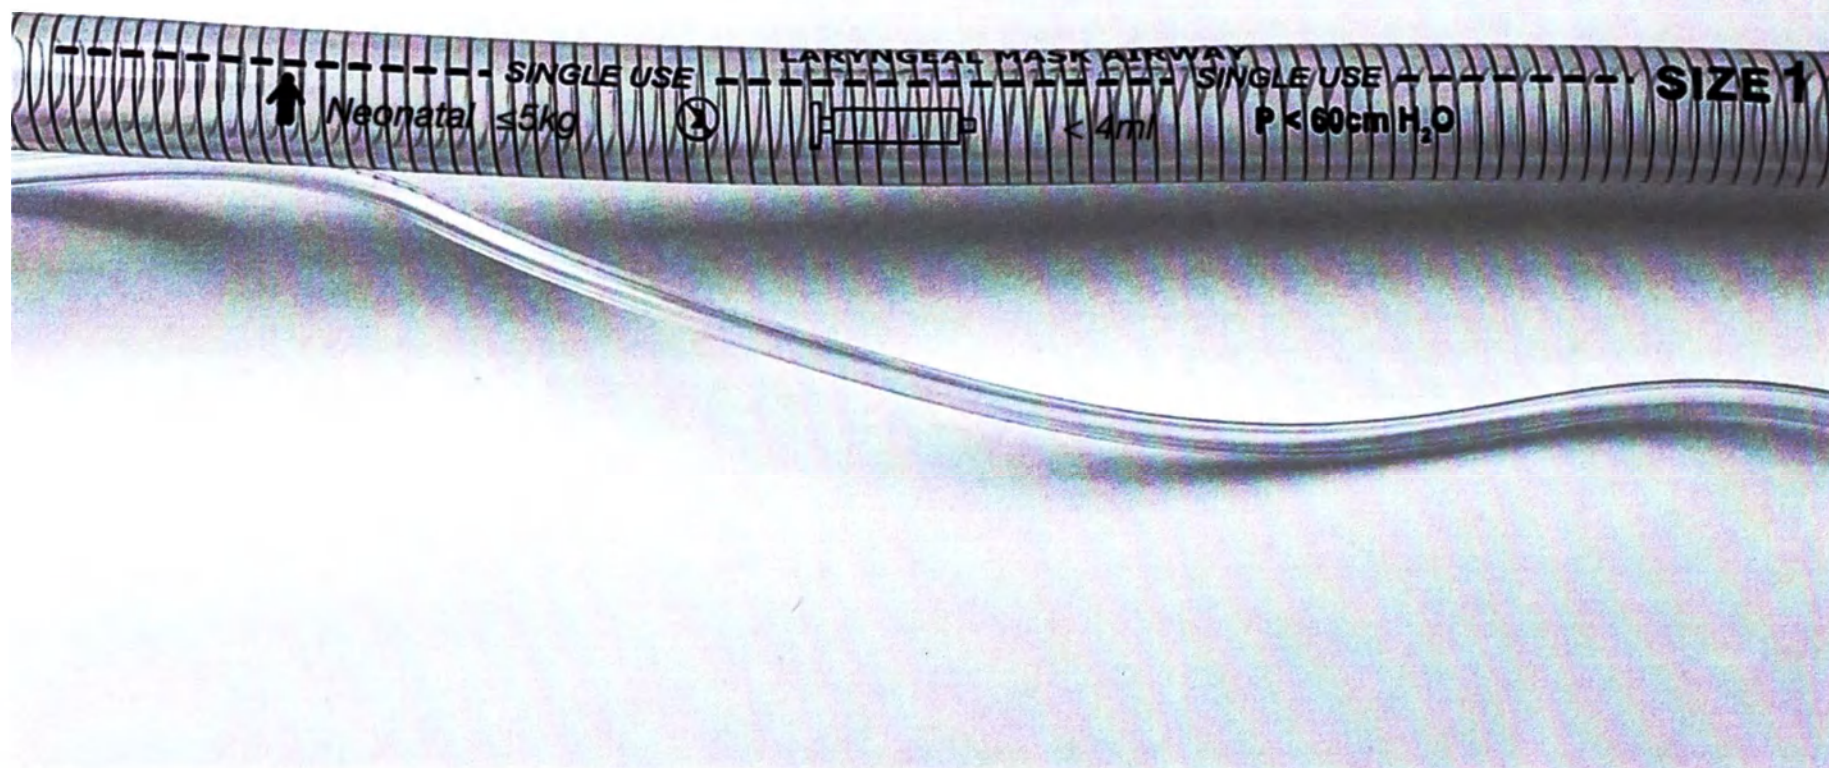


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 1,0

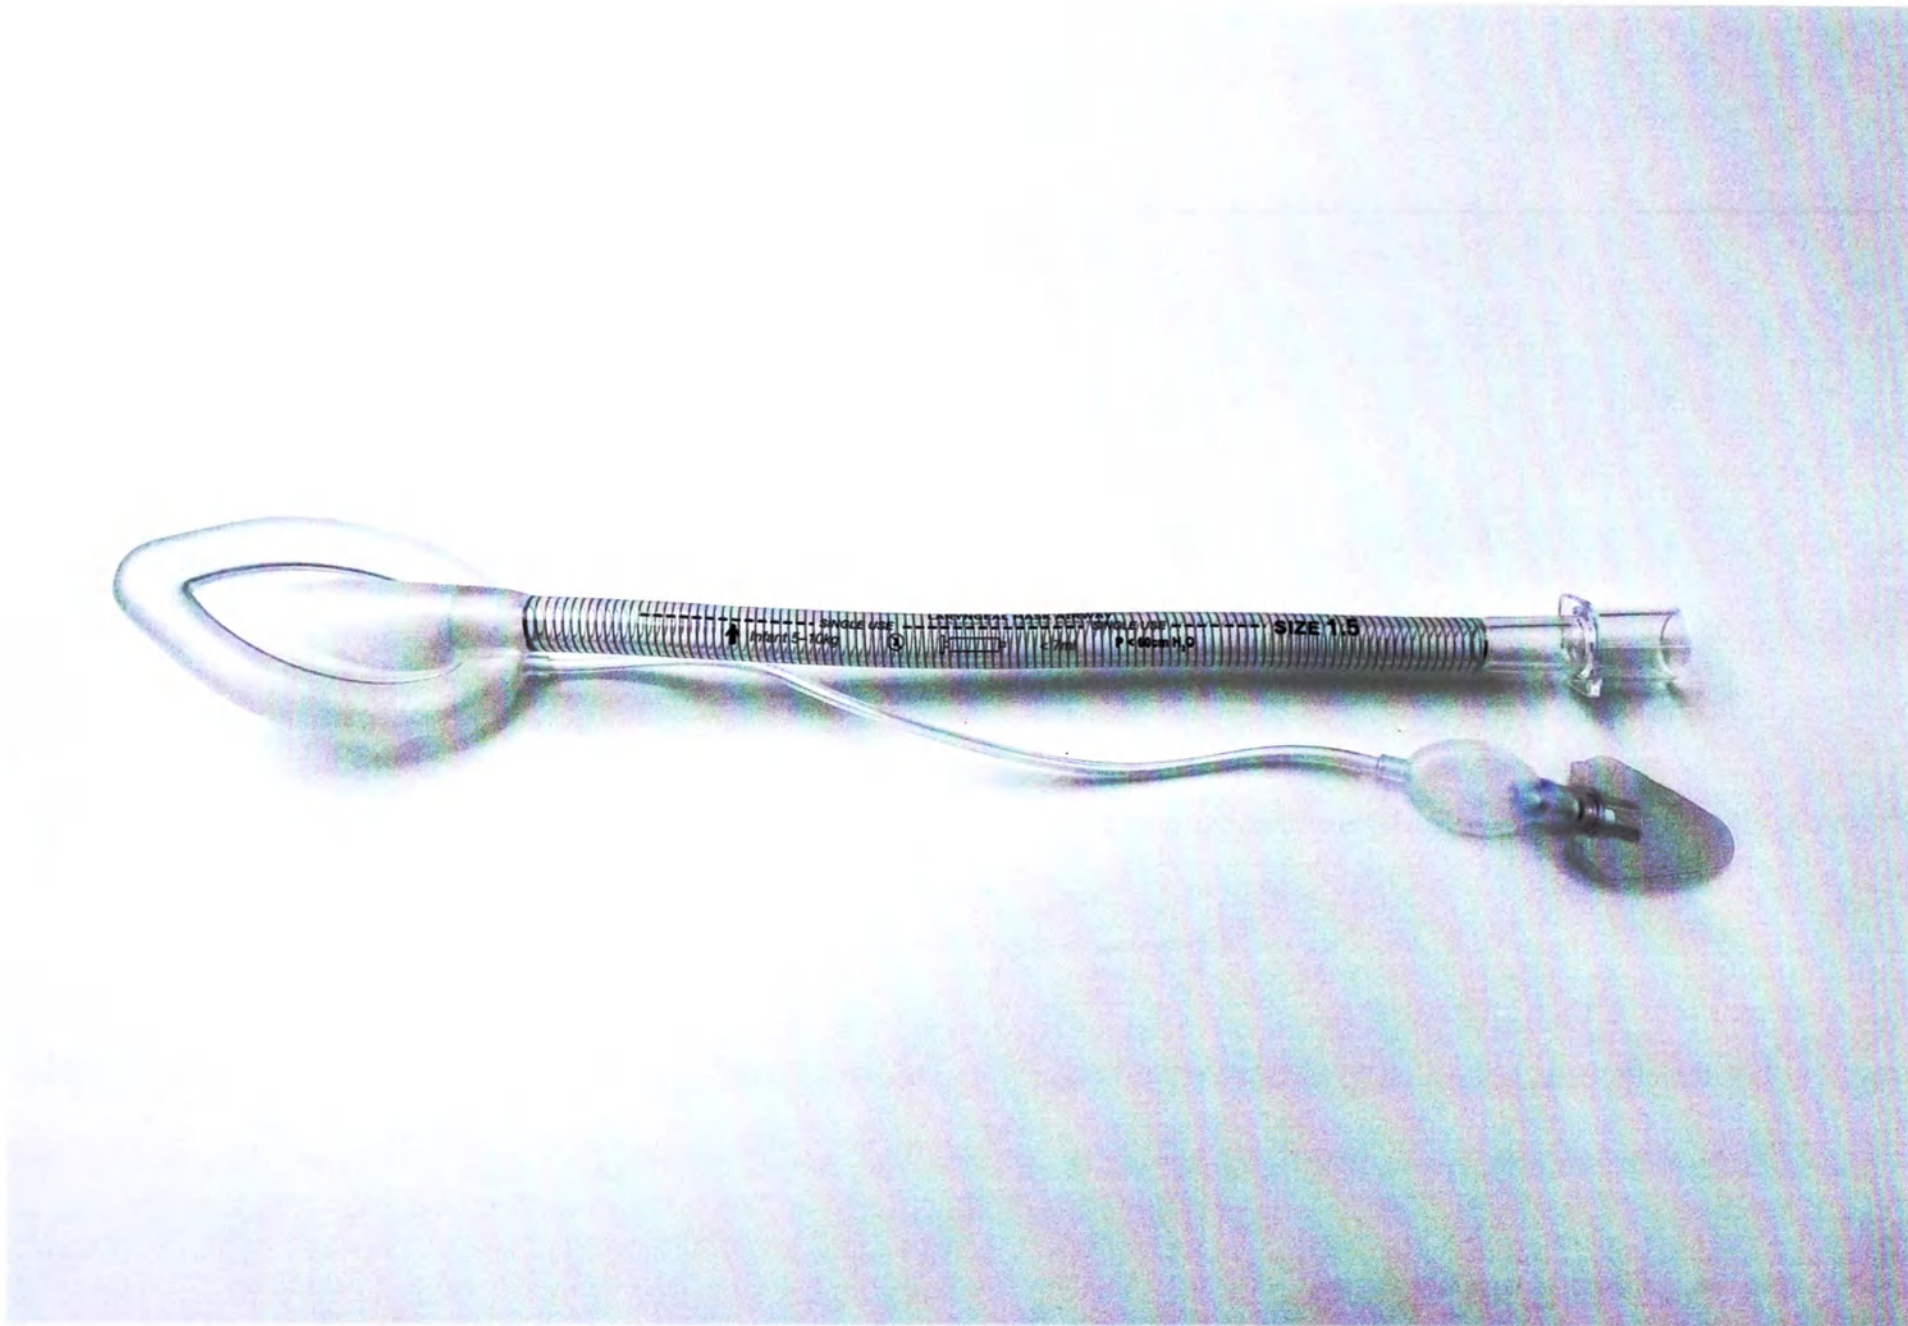

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 1,5

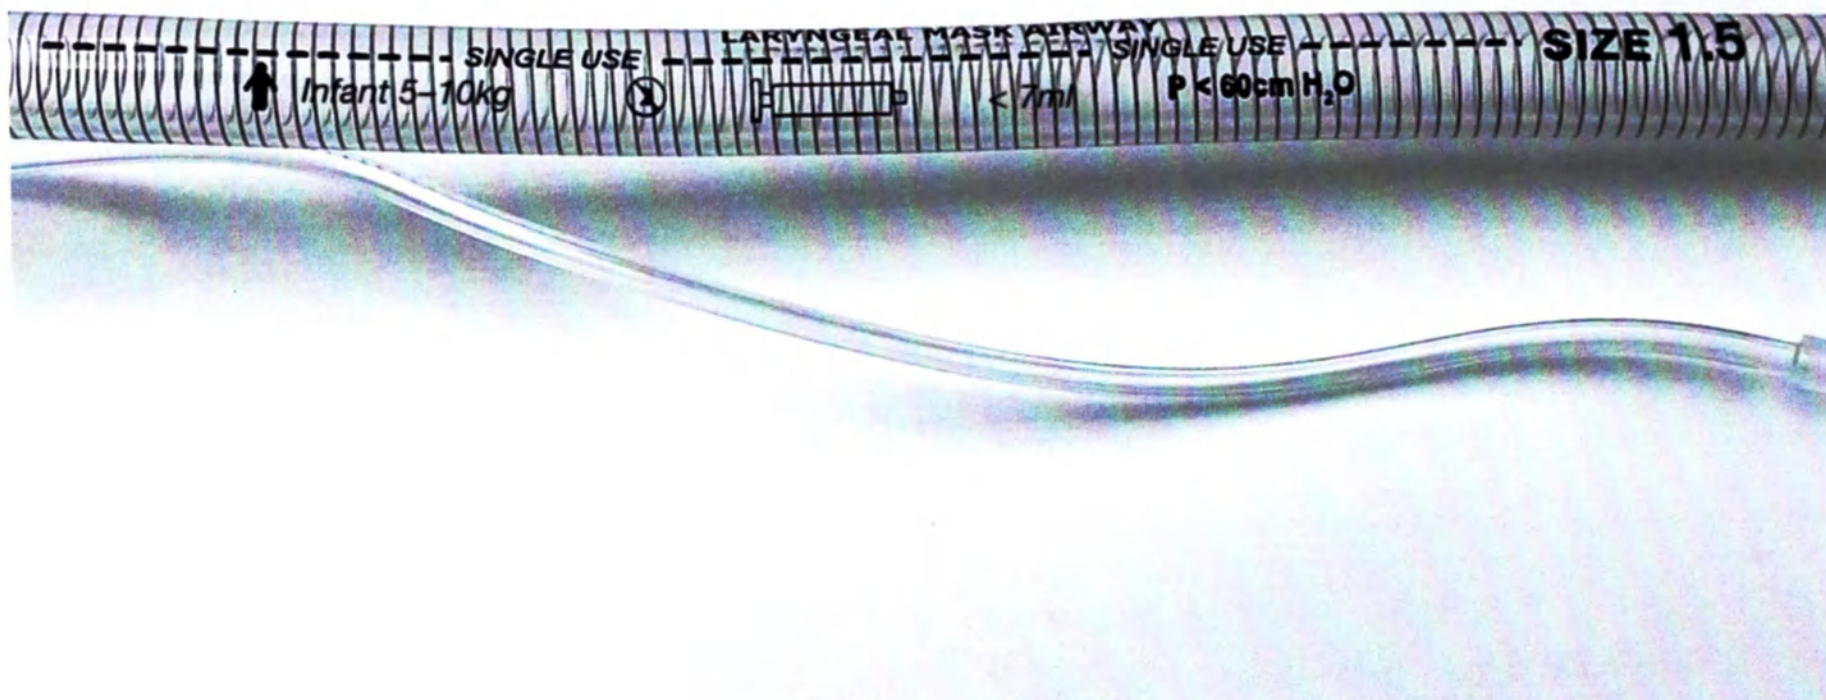

Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 1,5

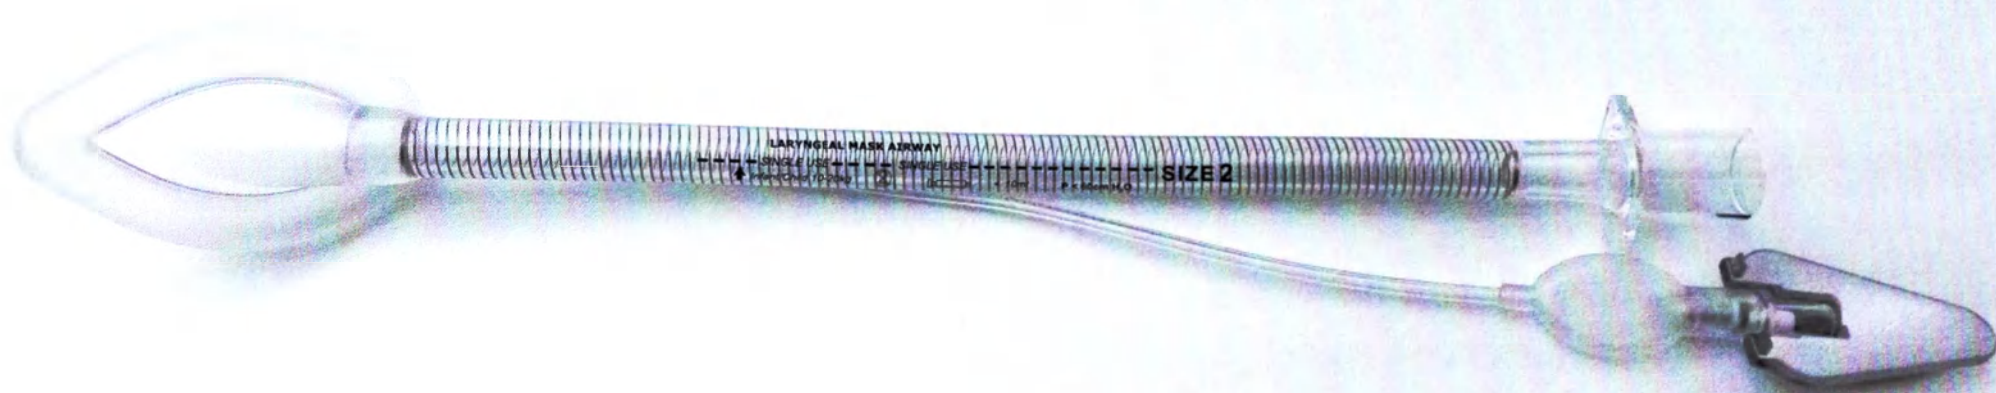

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 2,0




Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 2,0




Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 2,5




Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 2,5

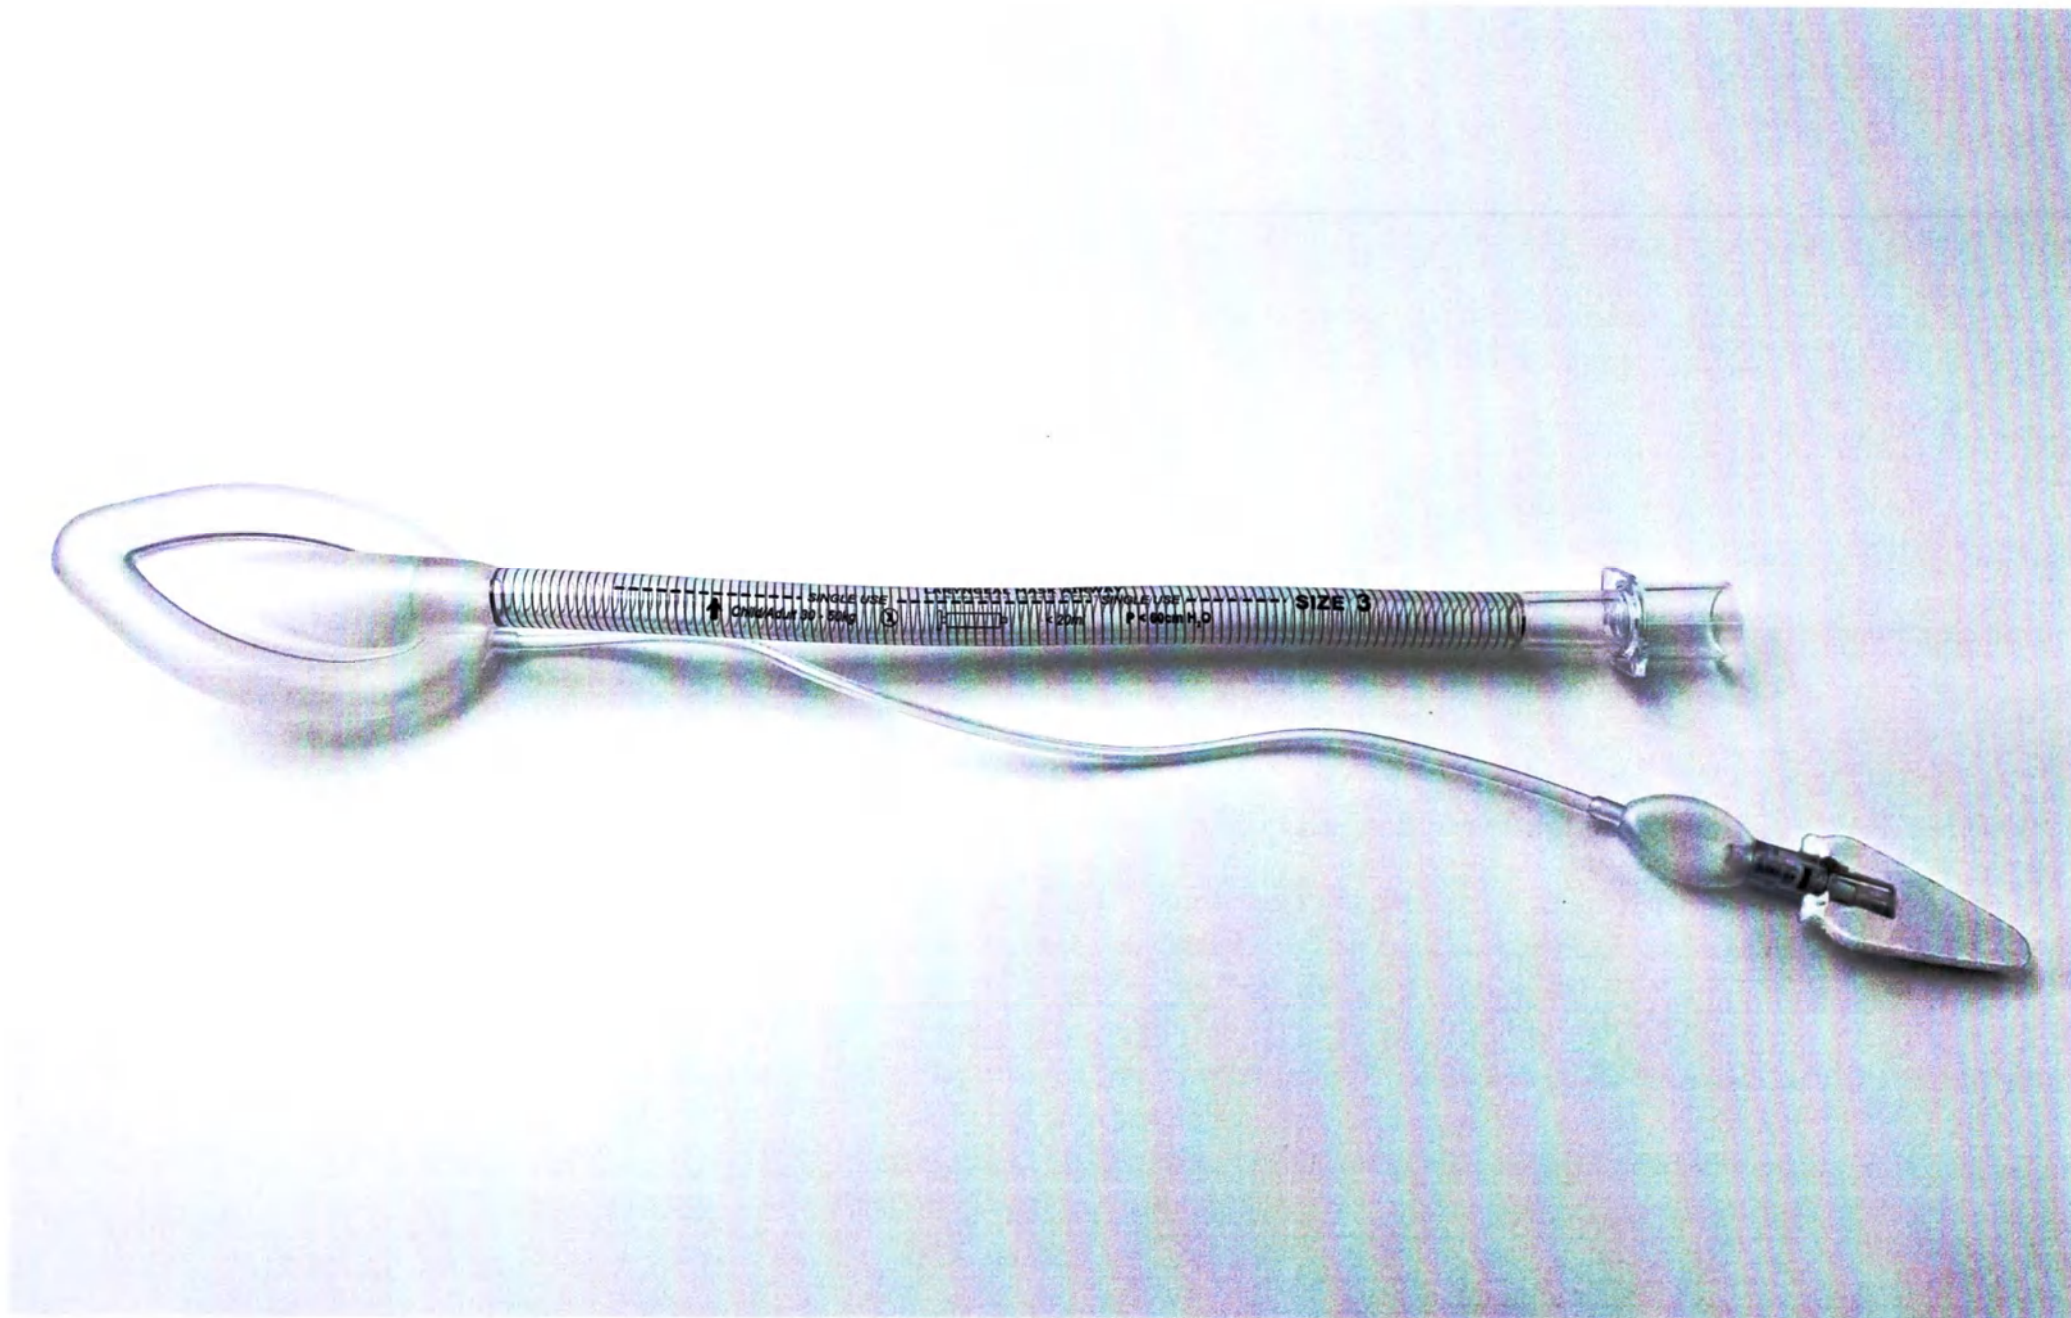


Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 3,0

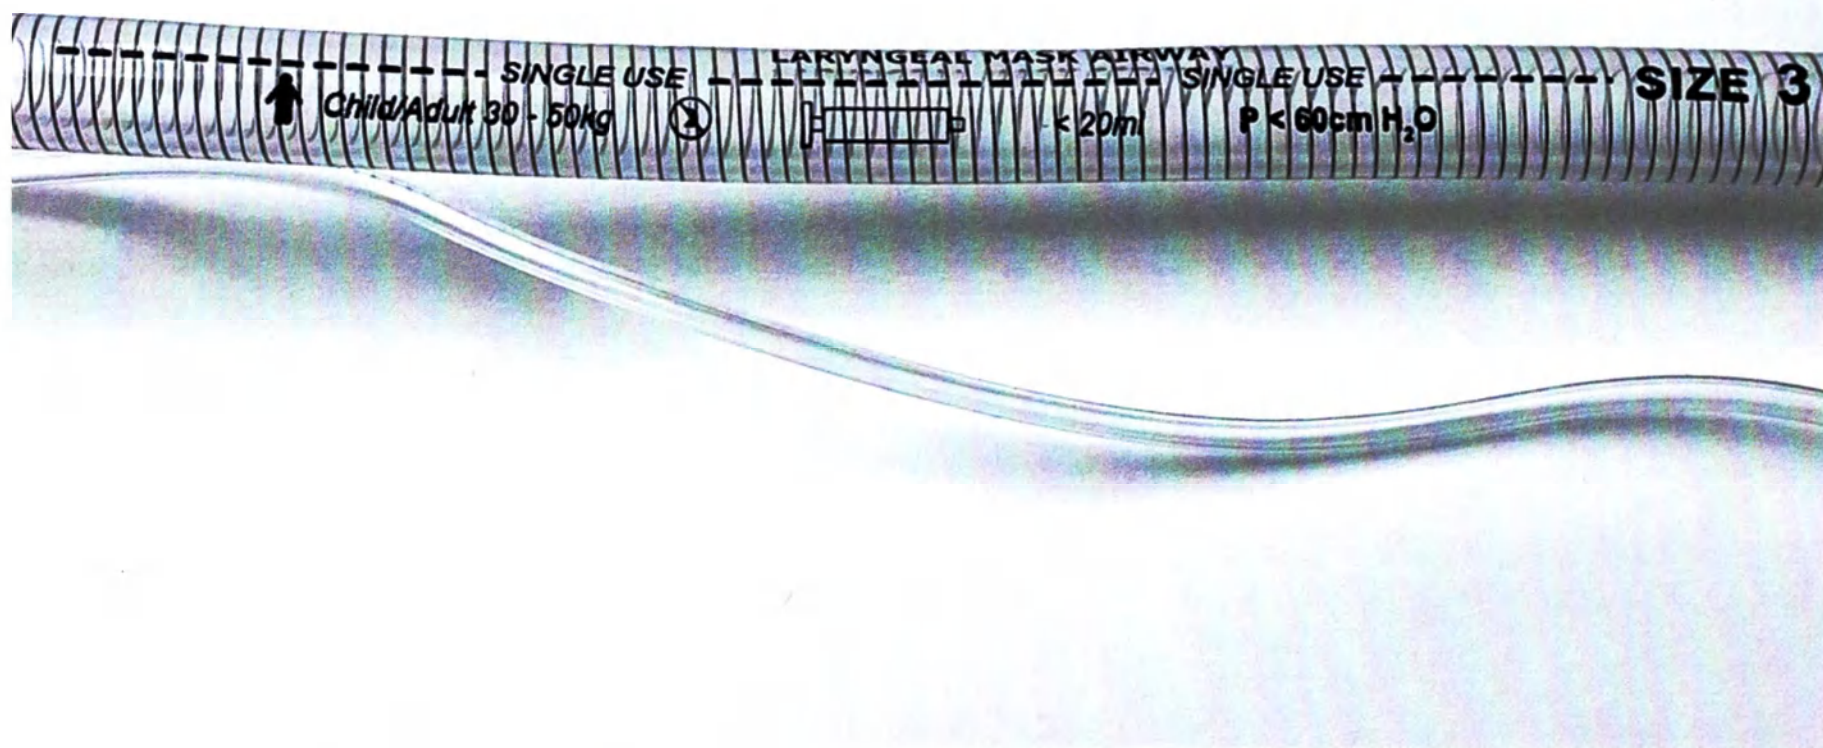


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 3,0

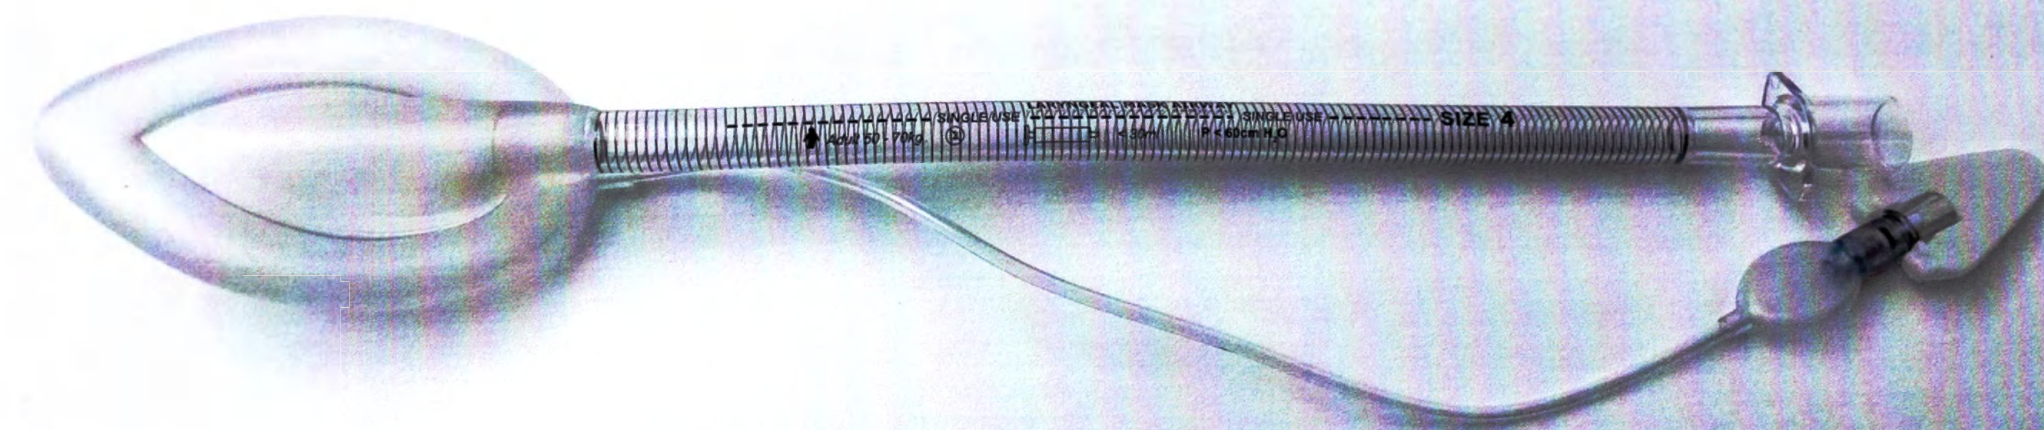


Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 4,0

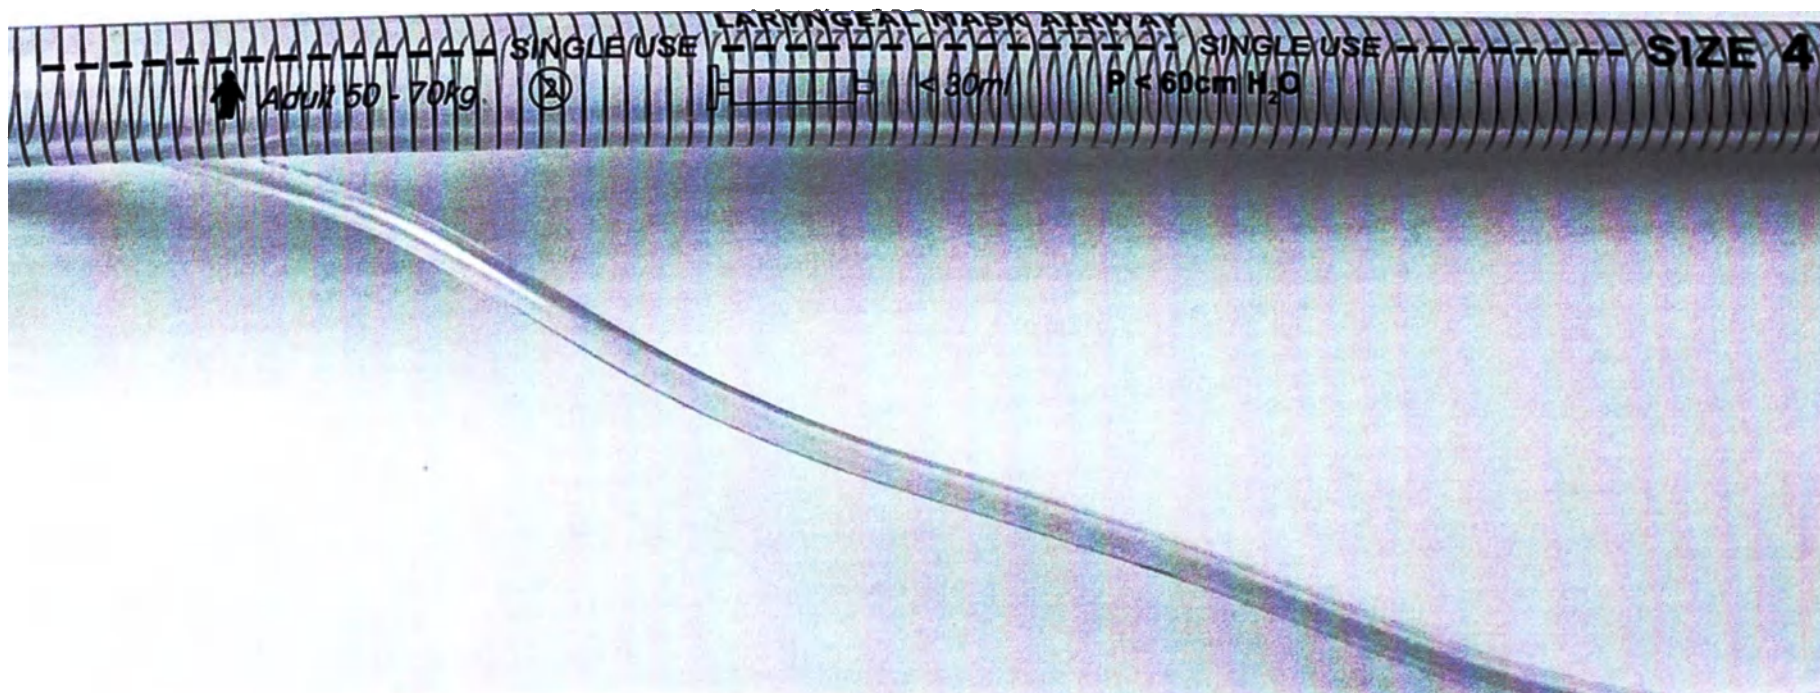


Макетировка изделия Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 4,0

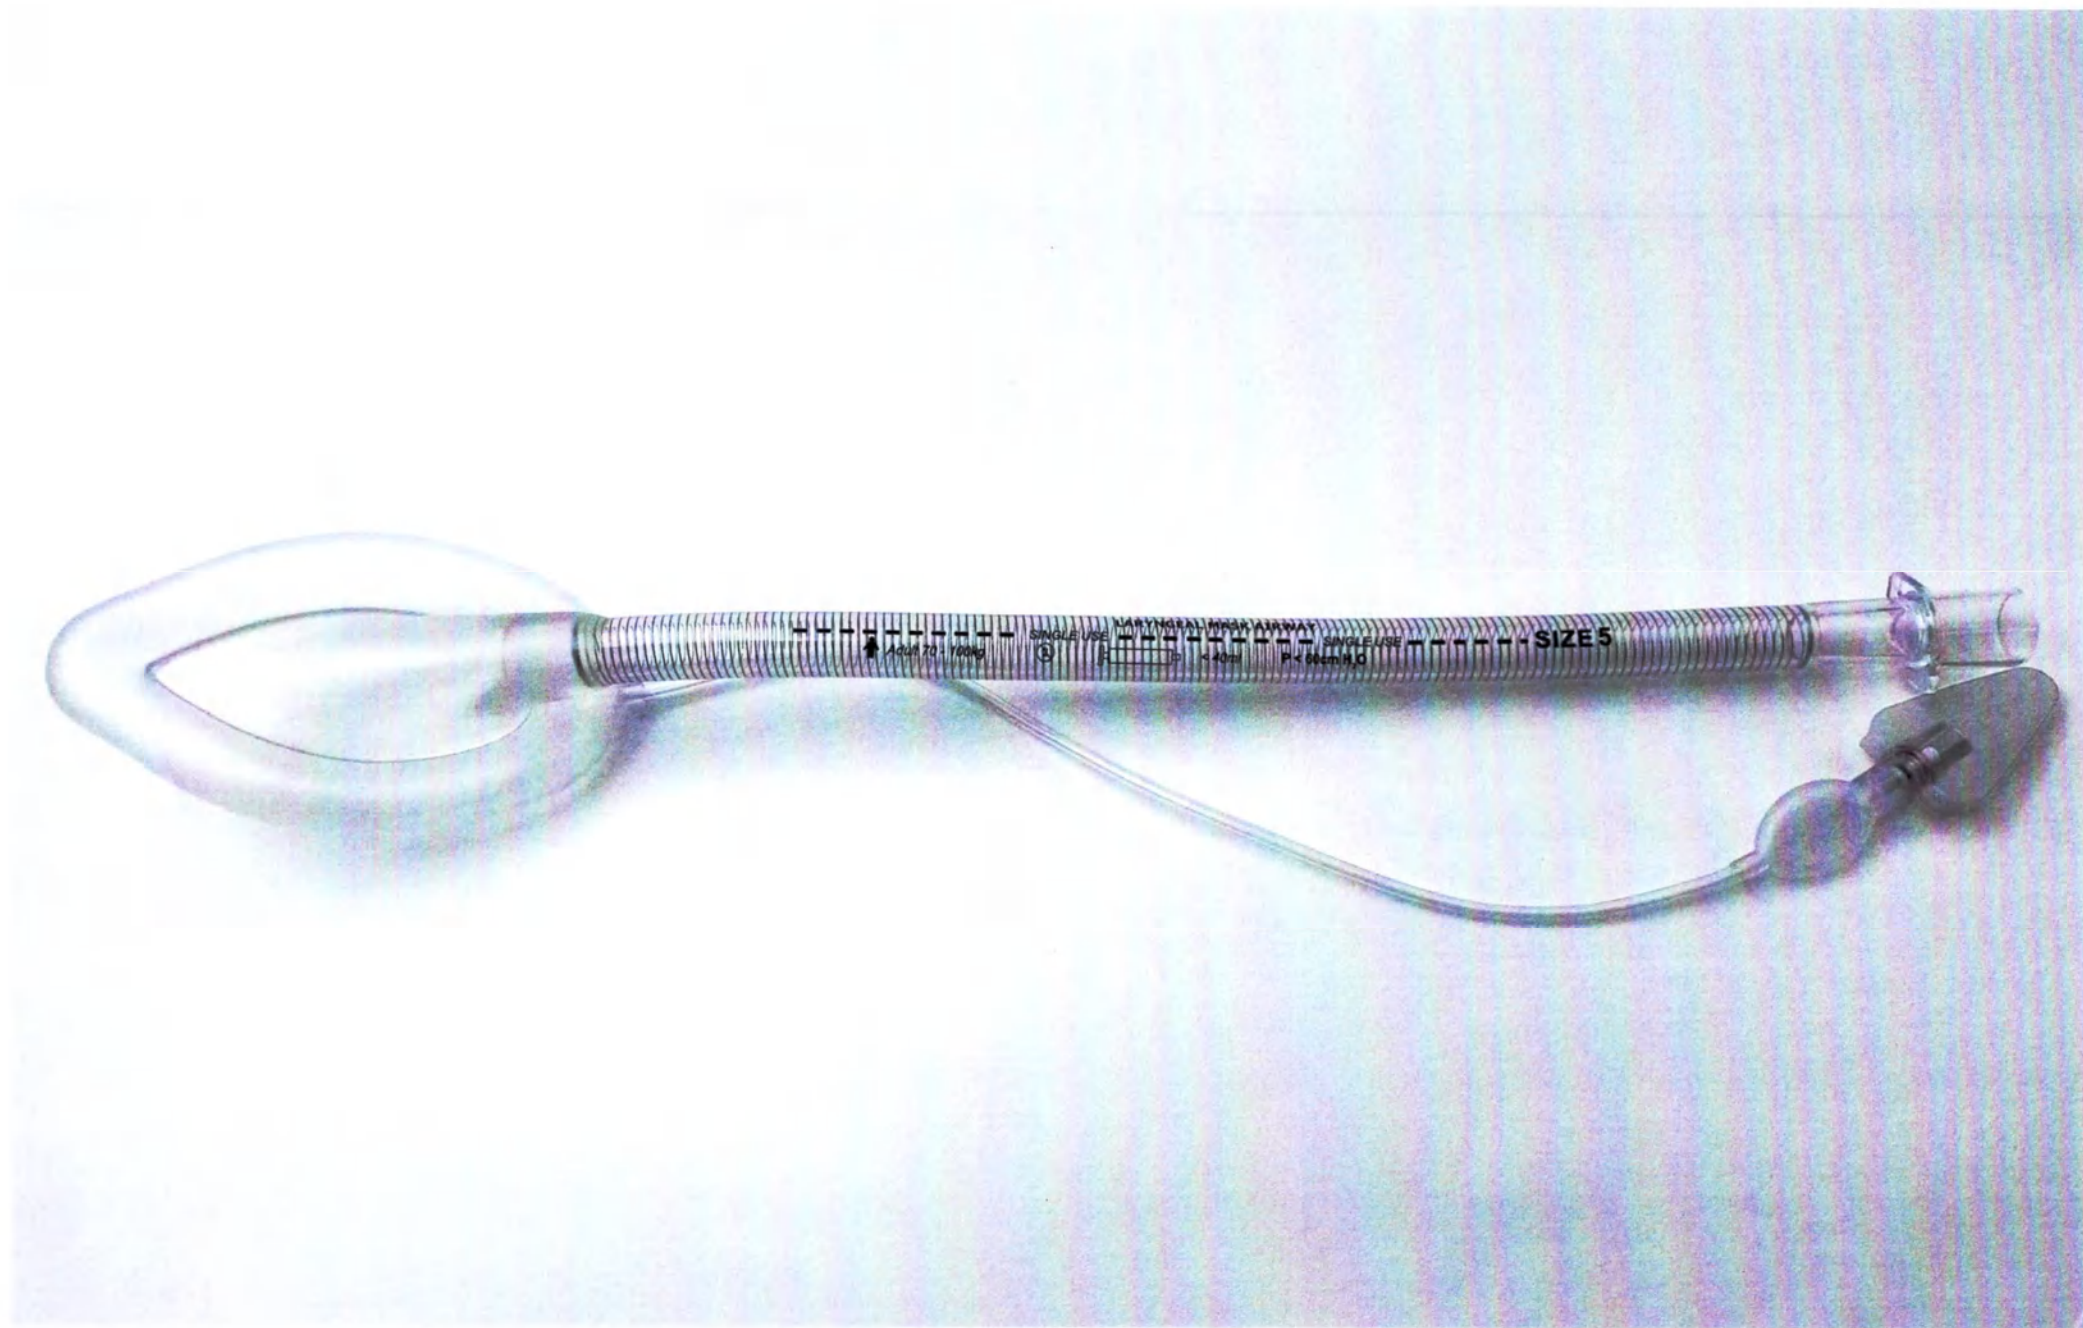


Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 5,0

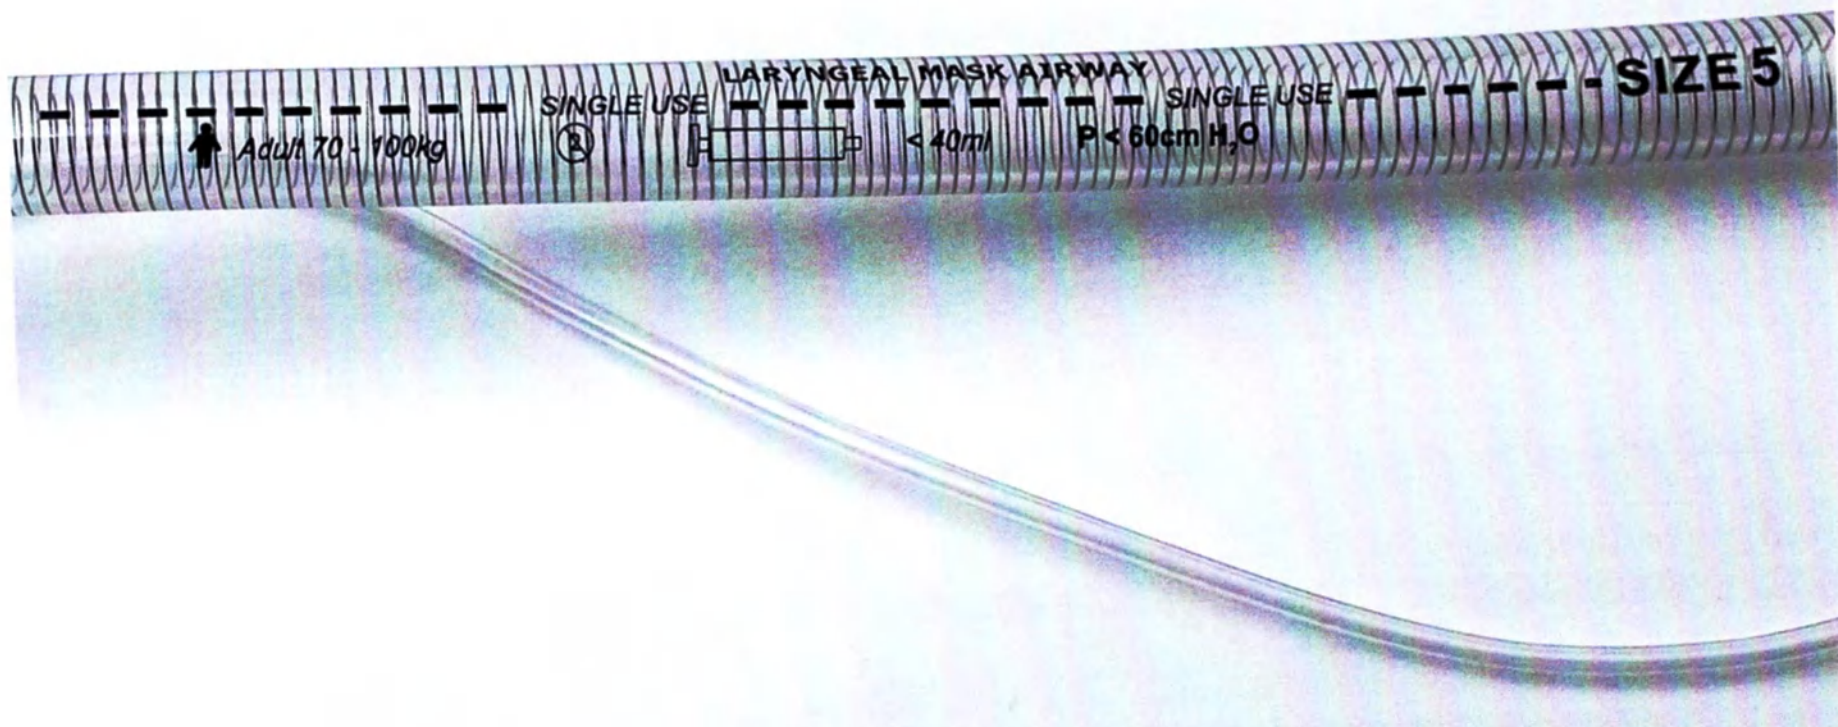


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 5,0

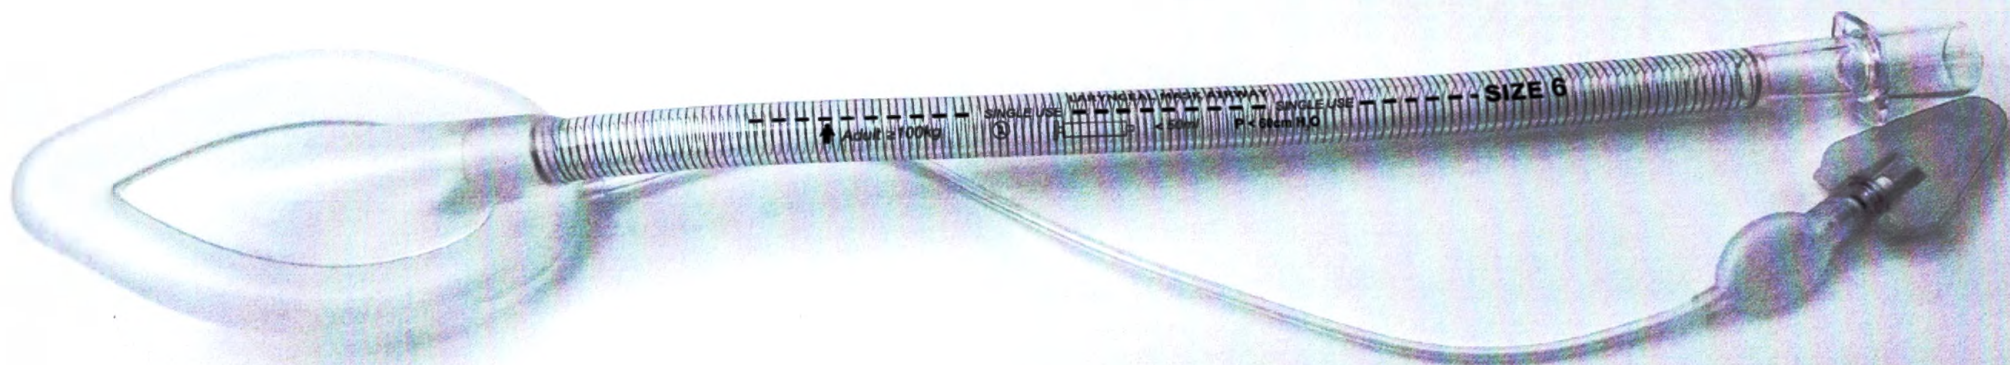


Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 6,0

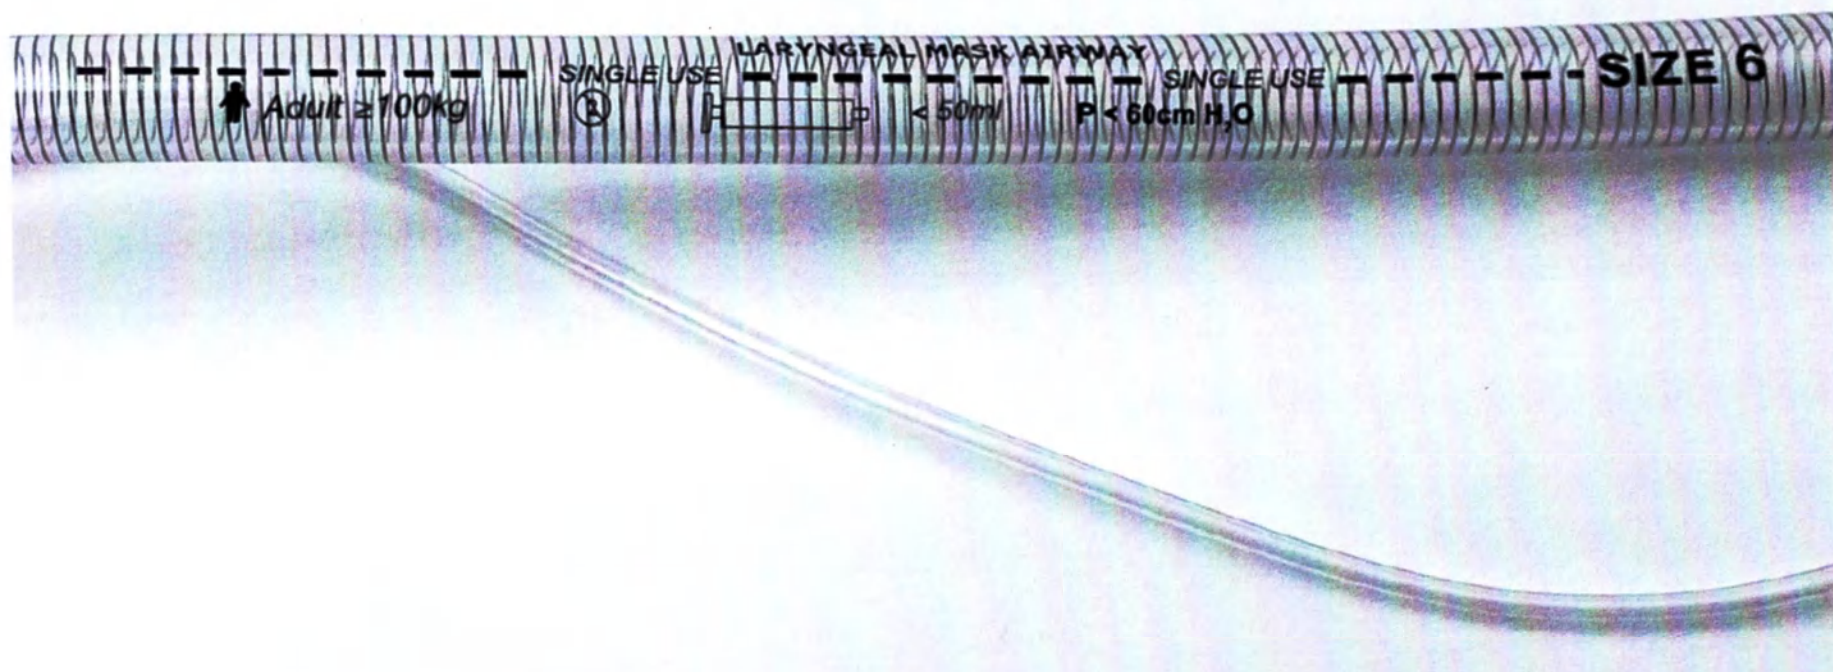


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 6,0

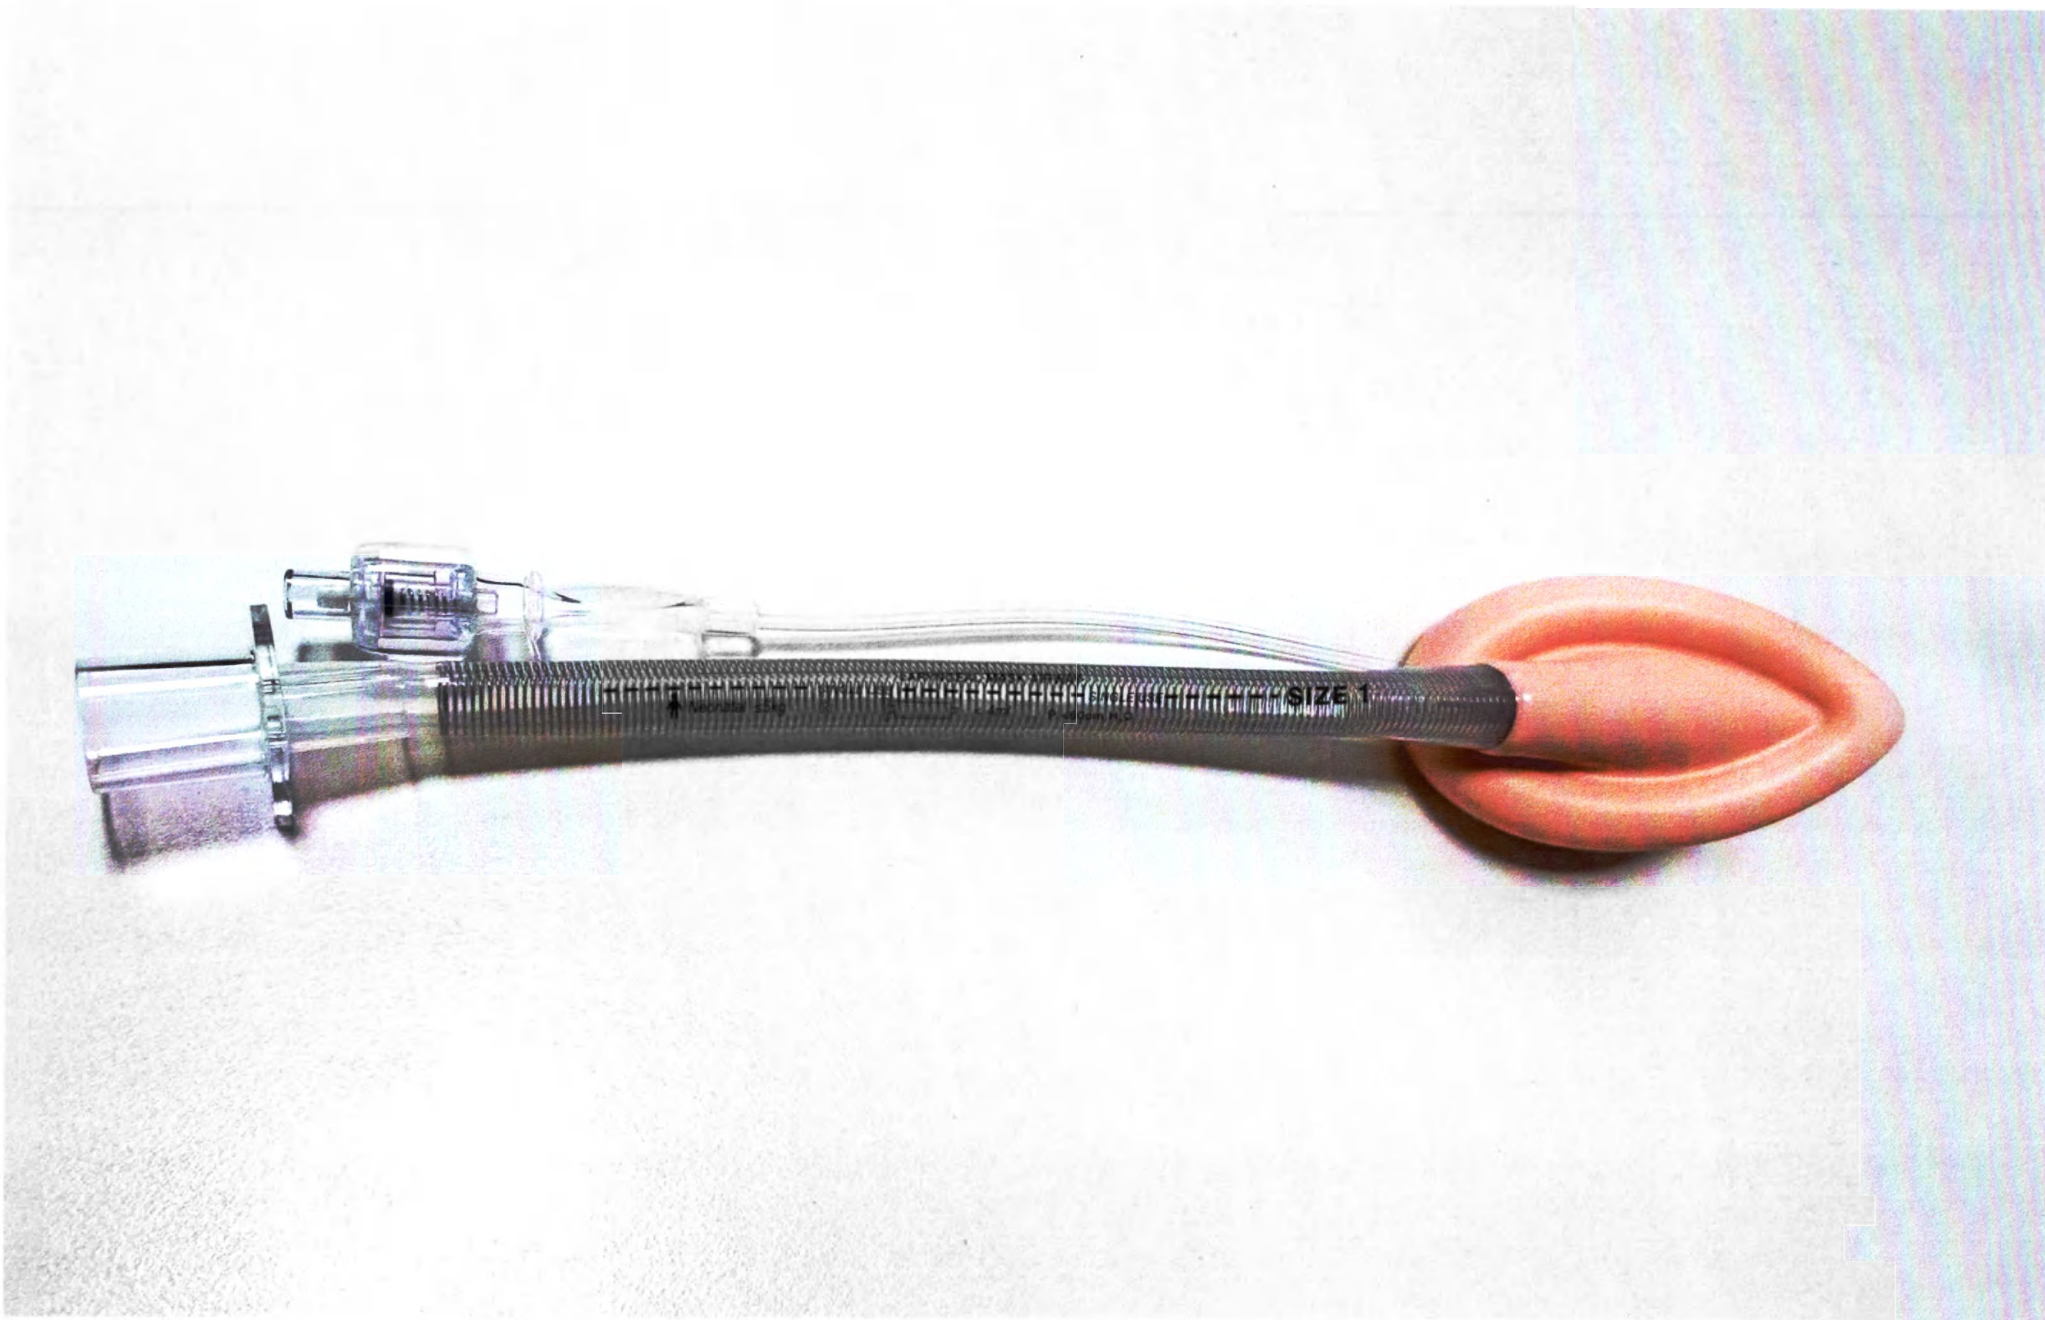


Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 1,0

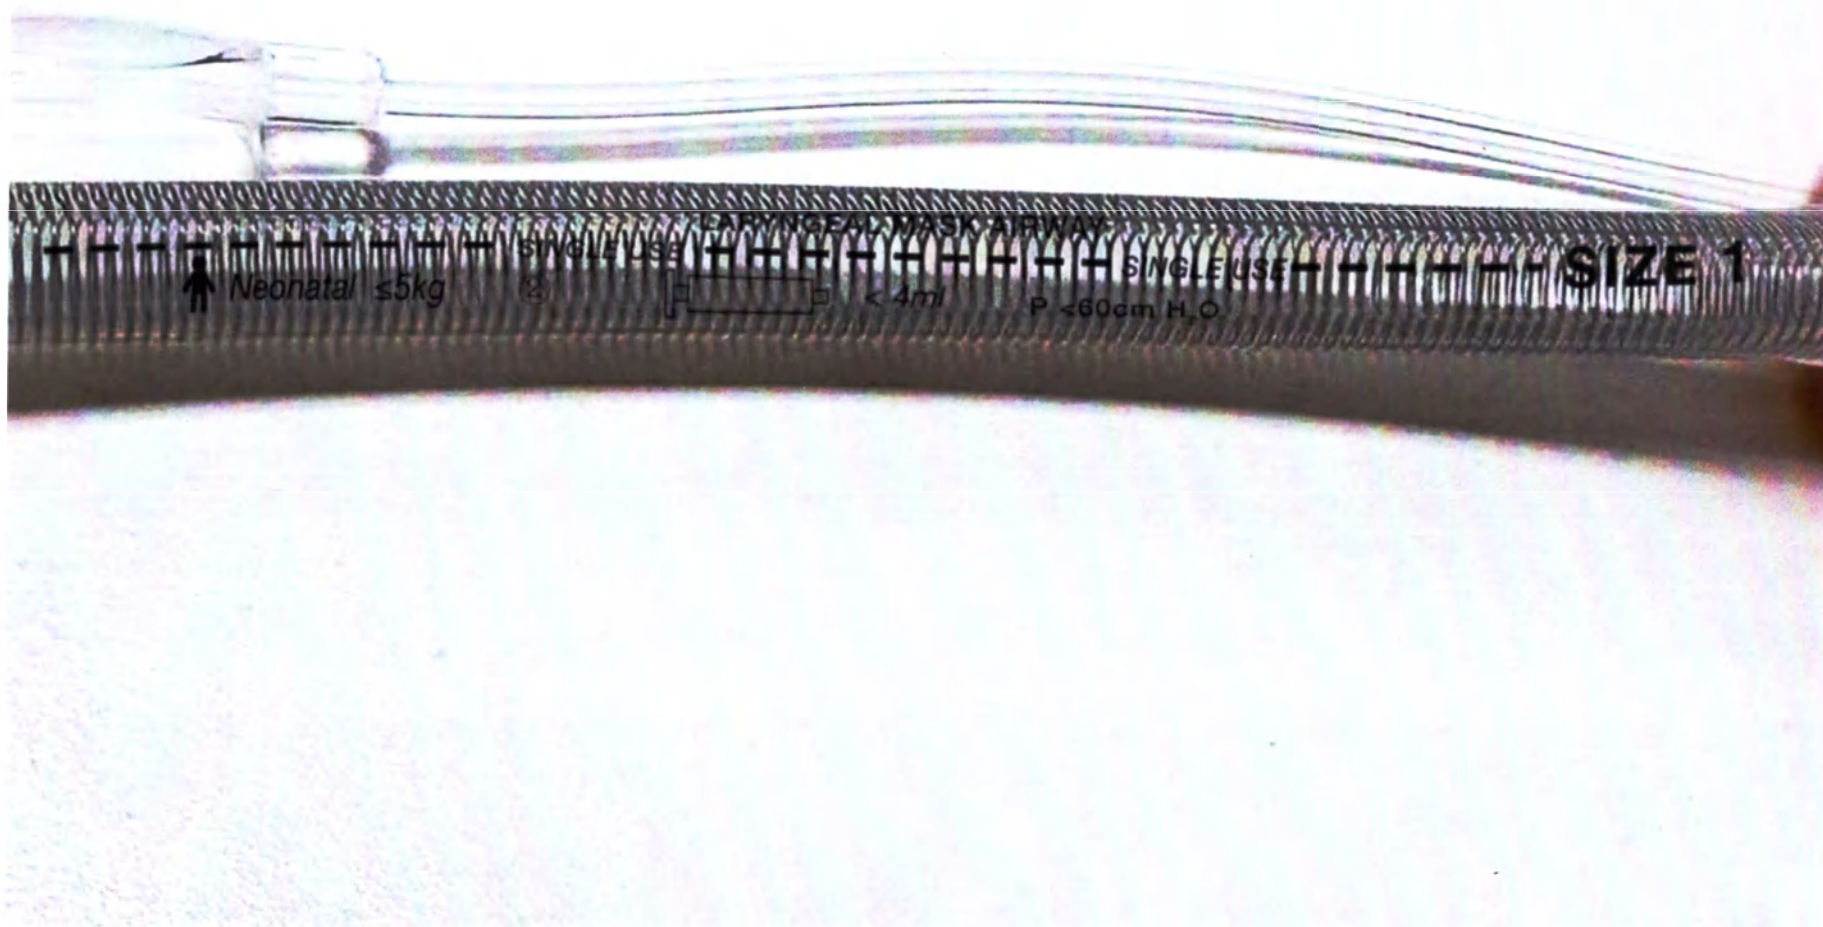


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 1,0

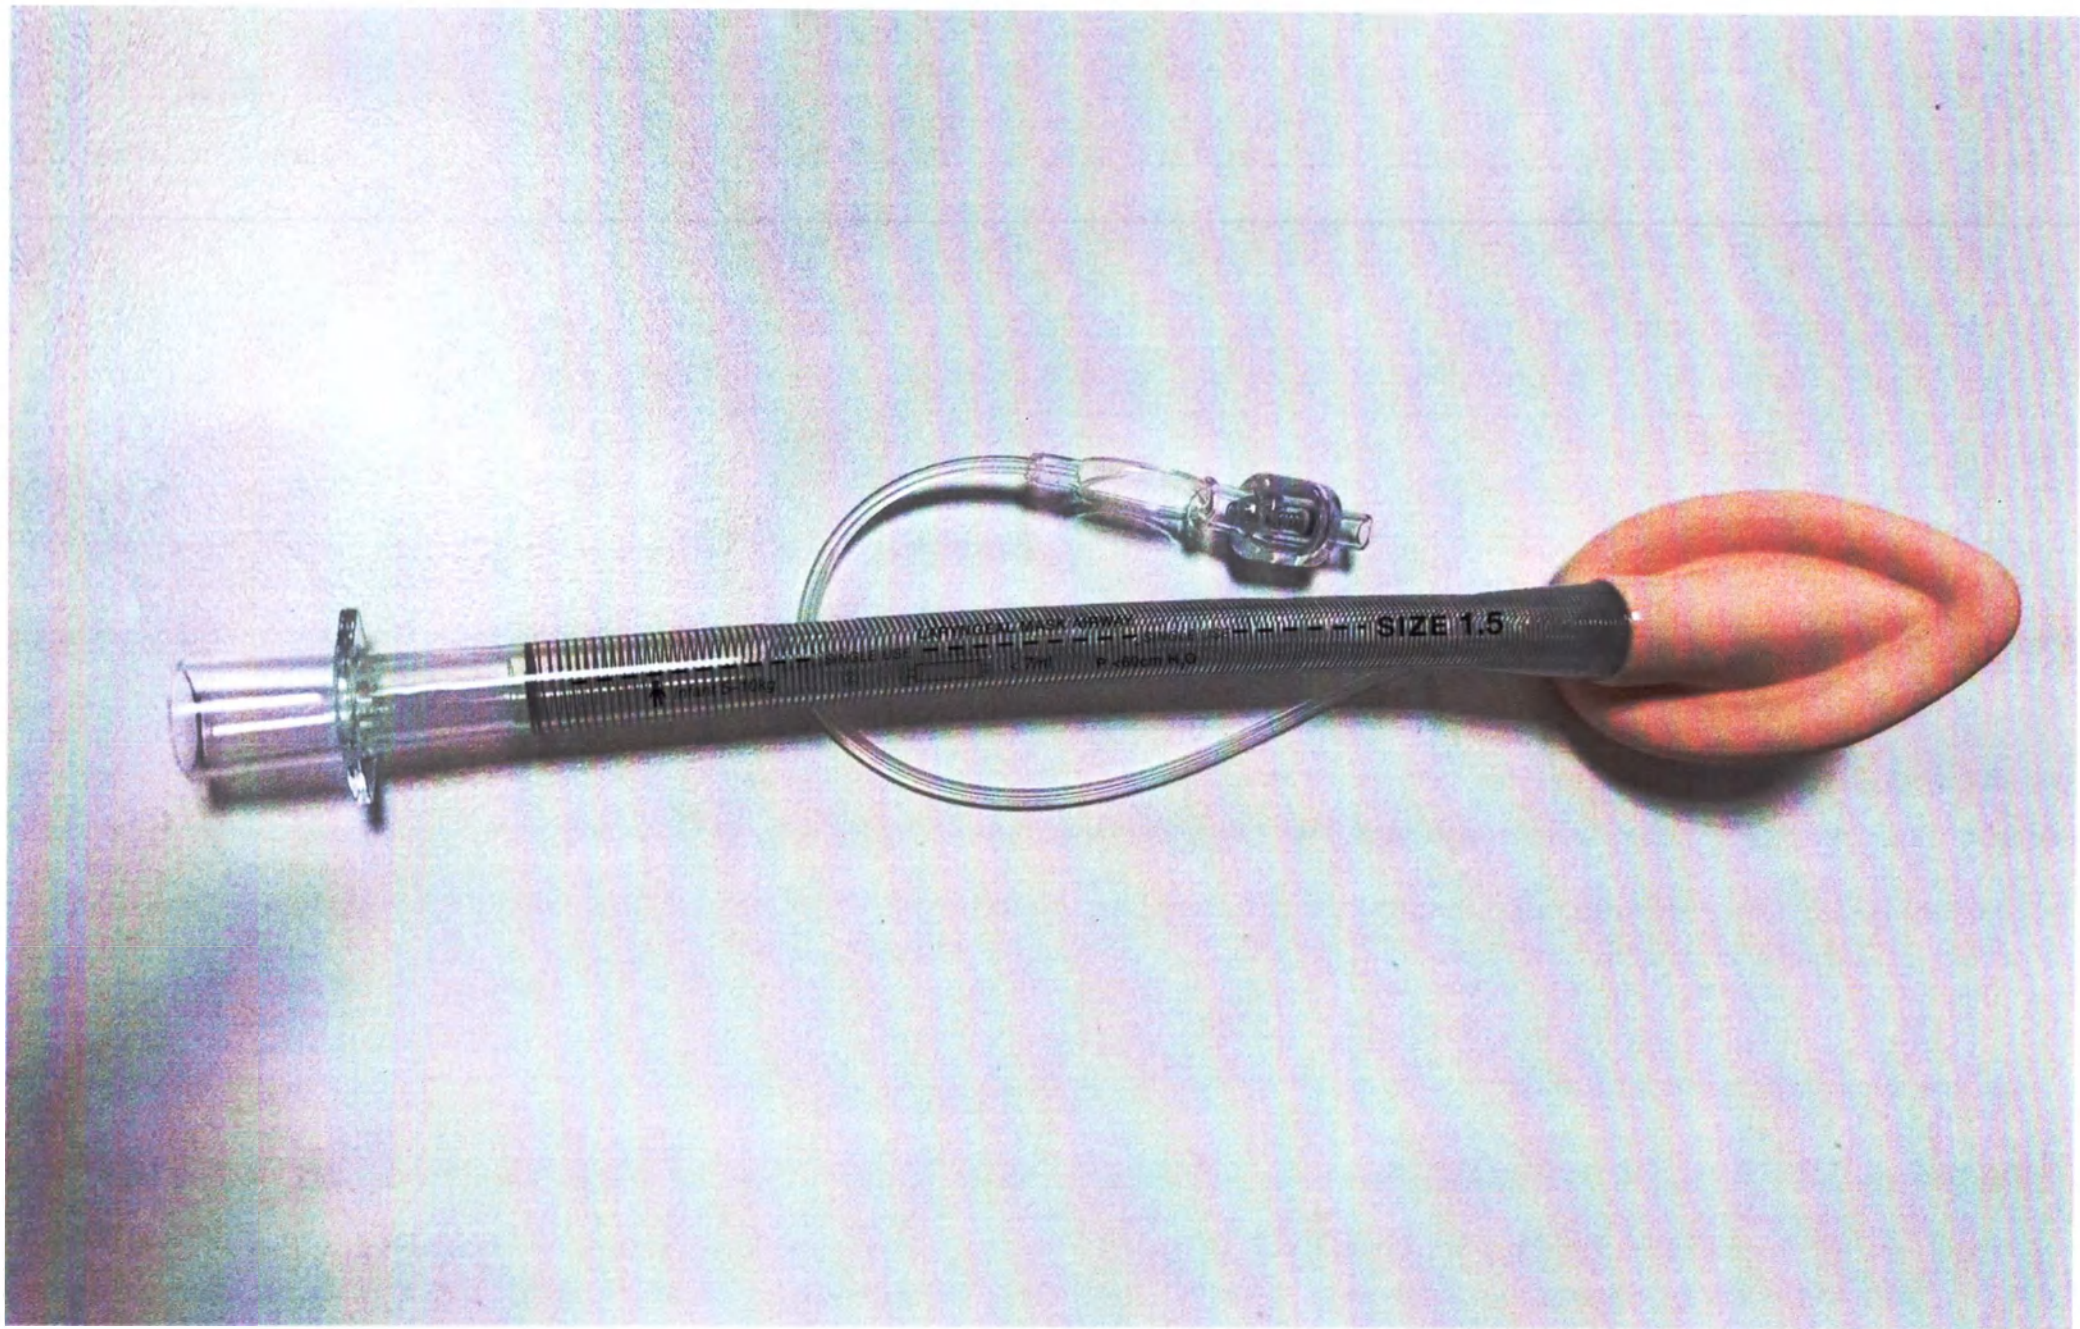


Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 1,5

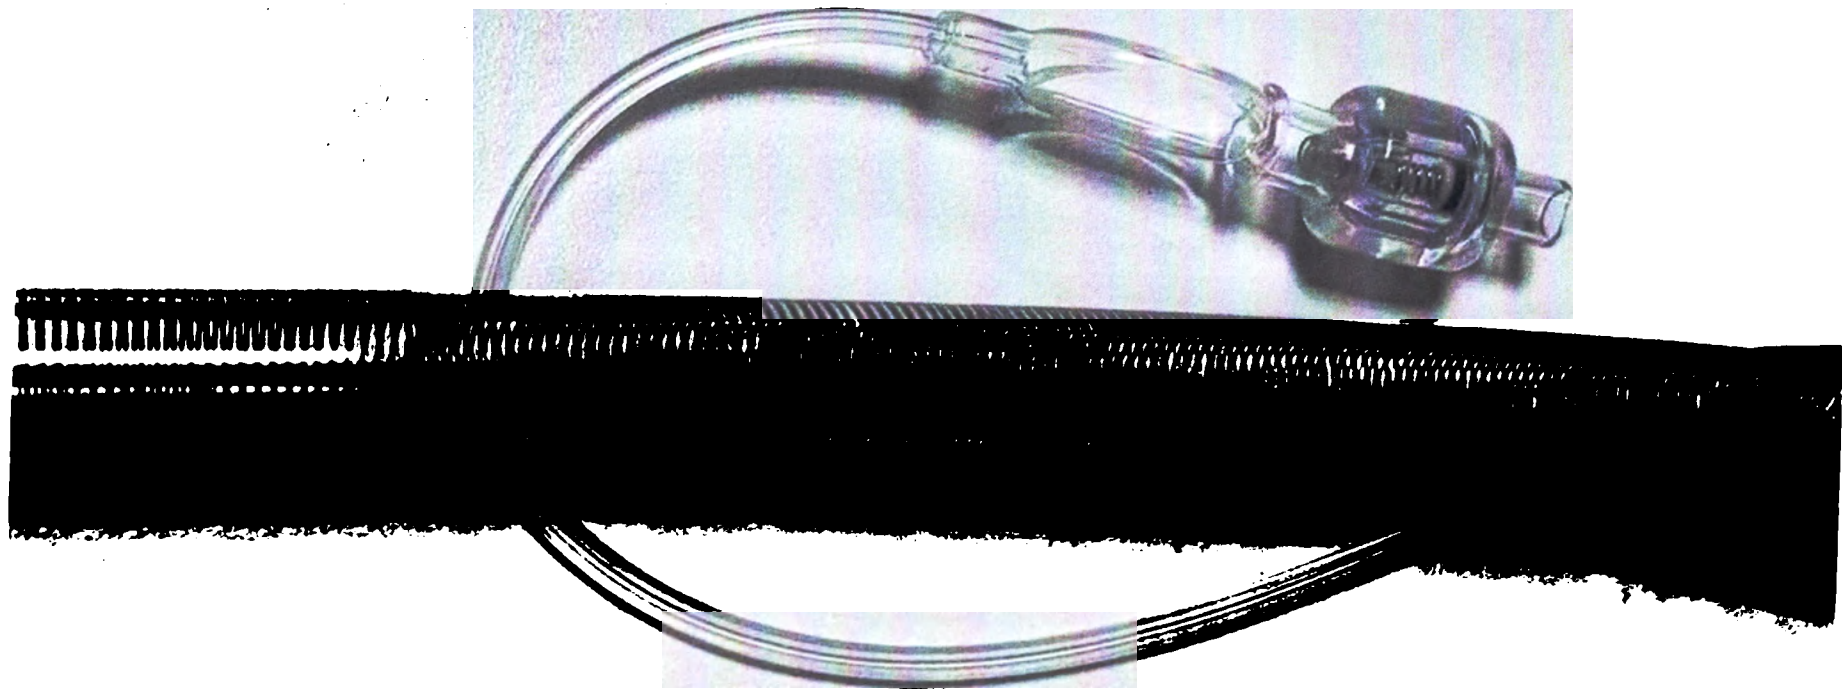


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 1,5

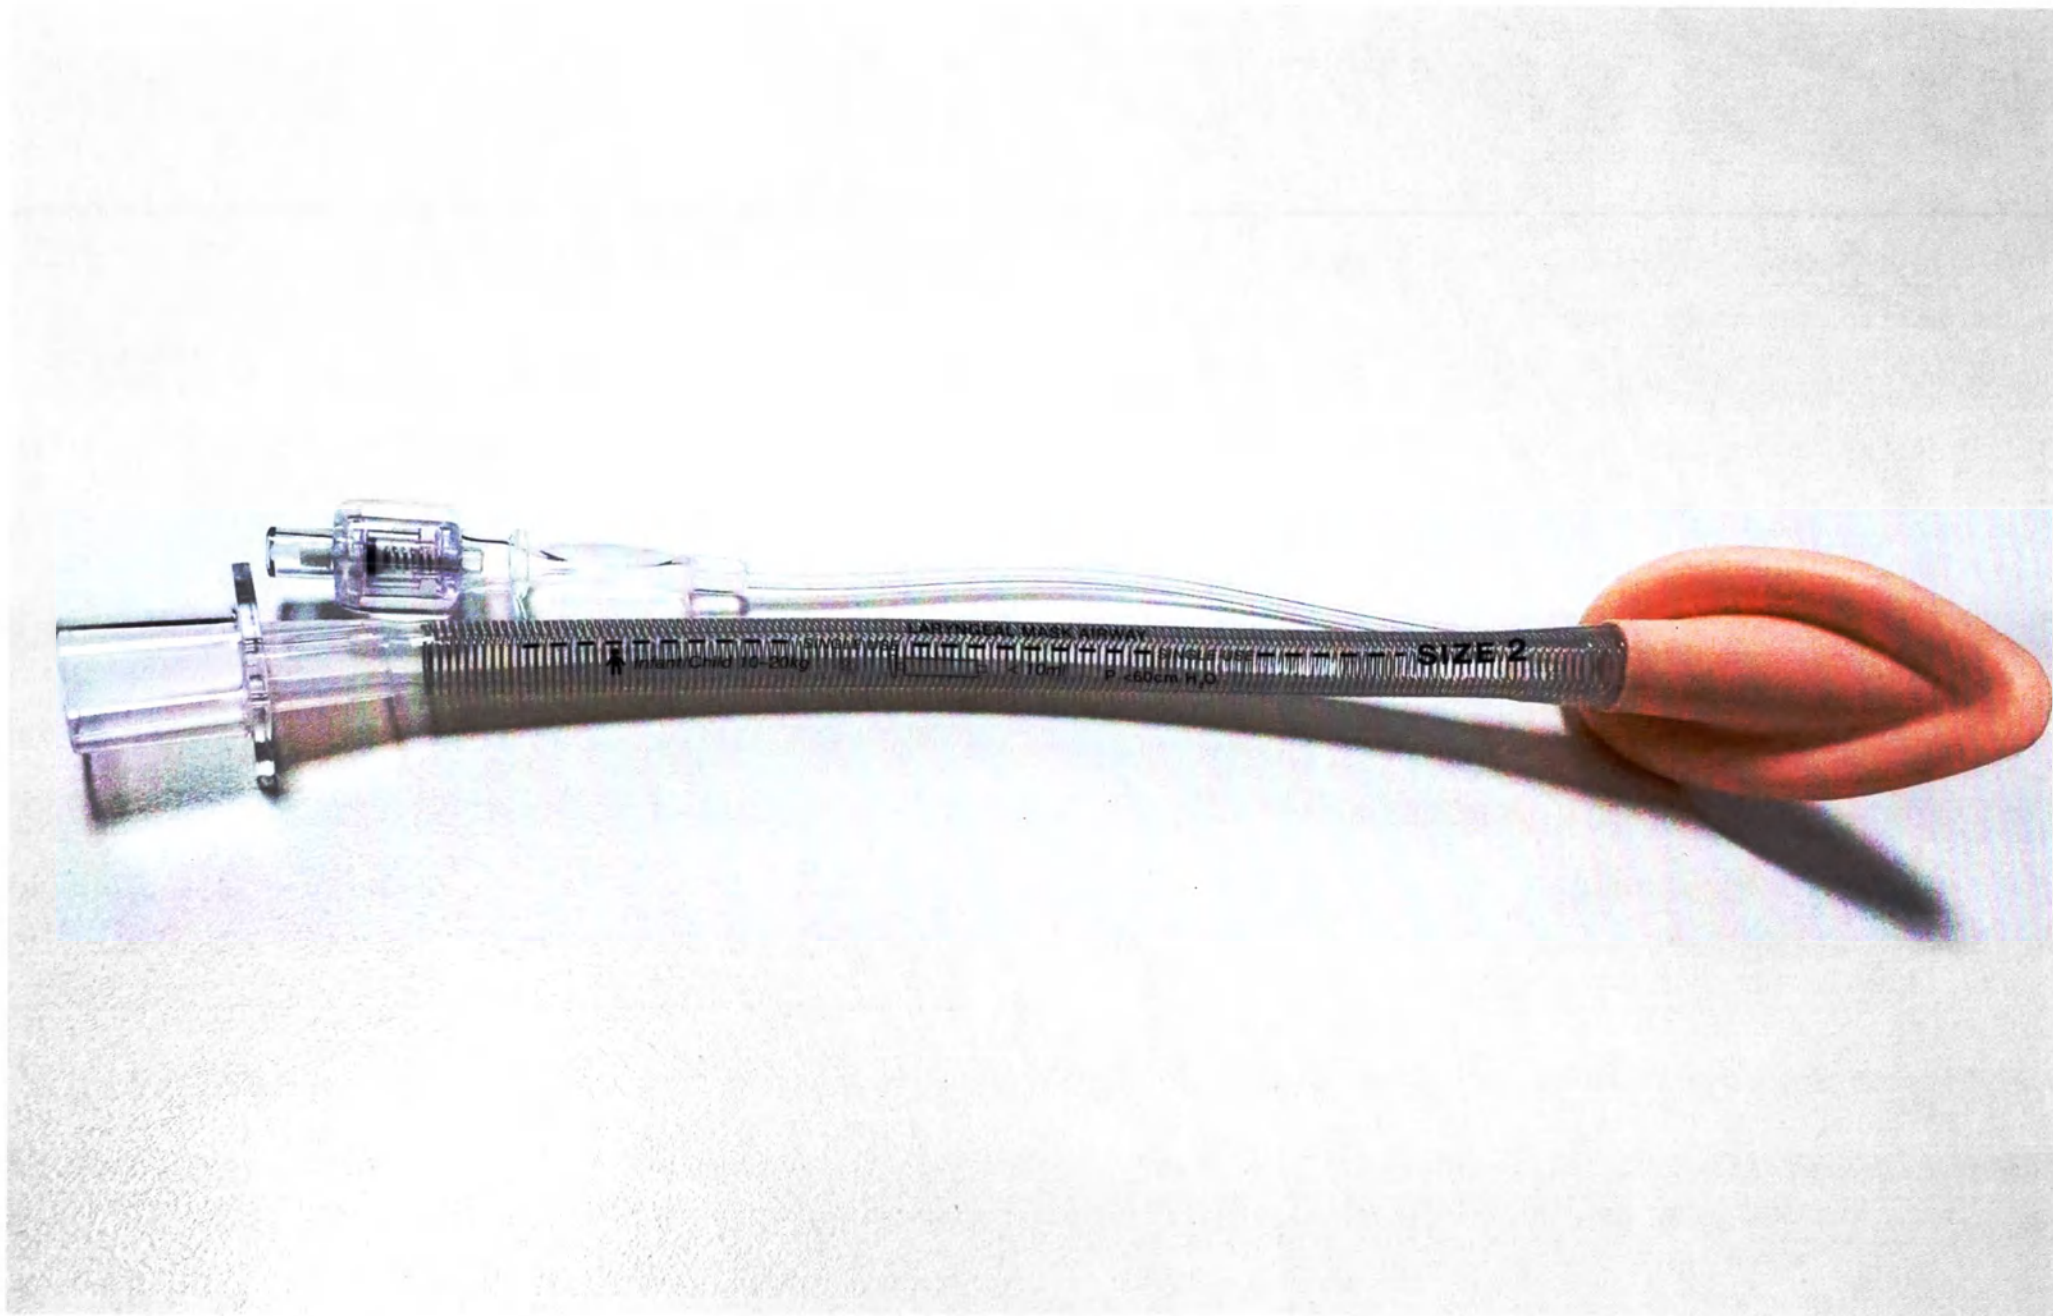


Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 2,0

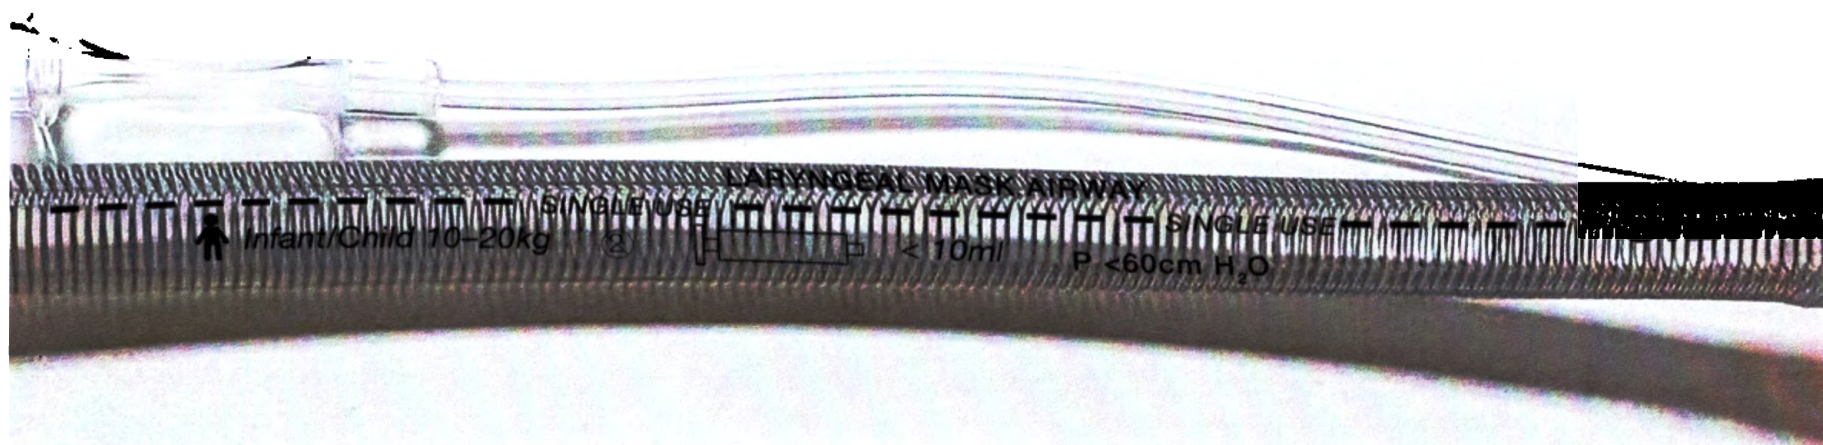


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 2,0

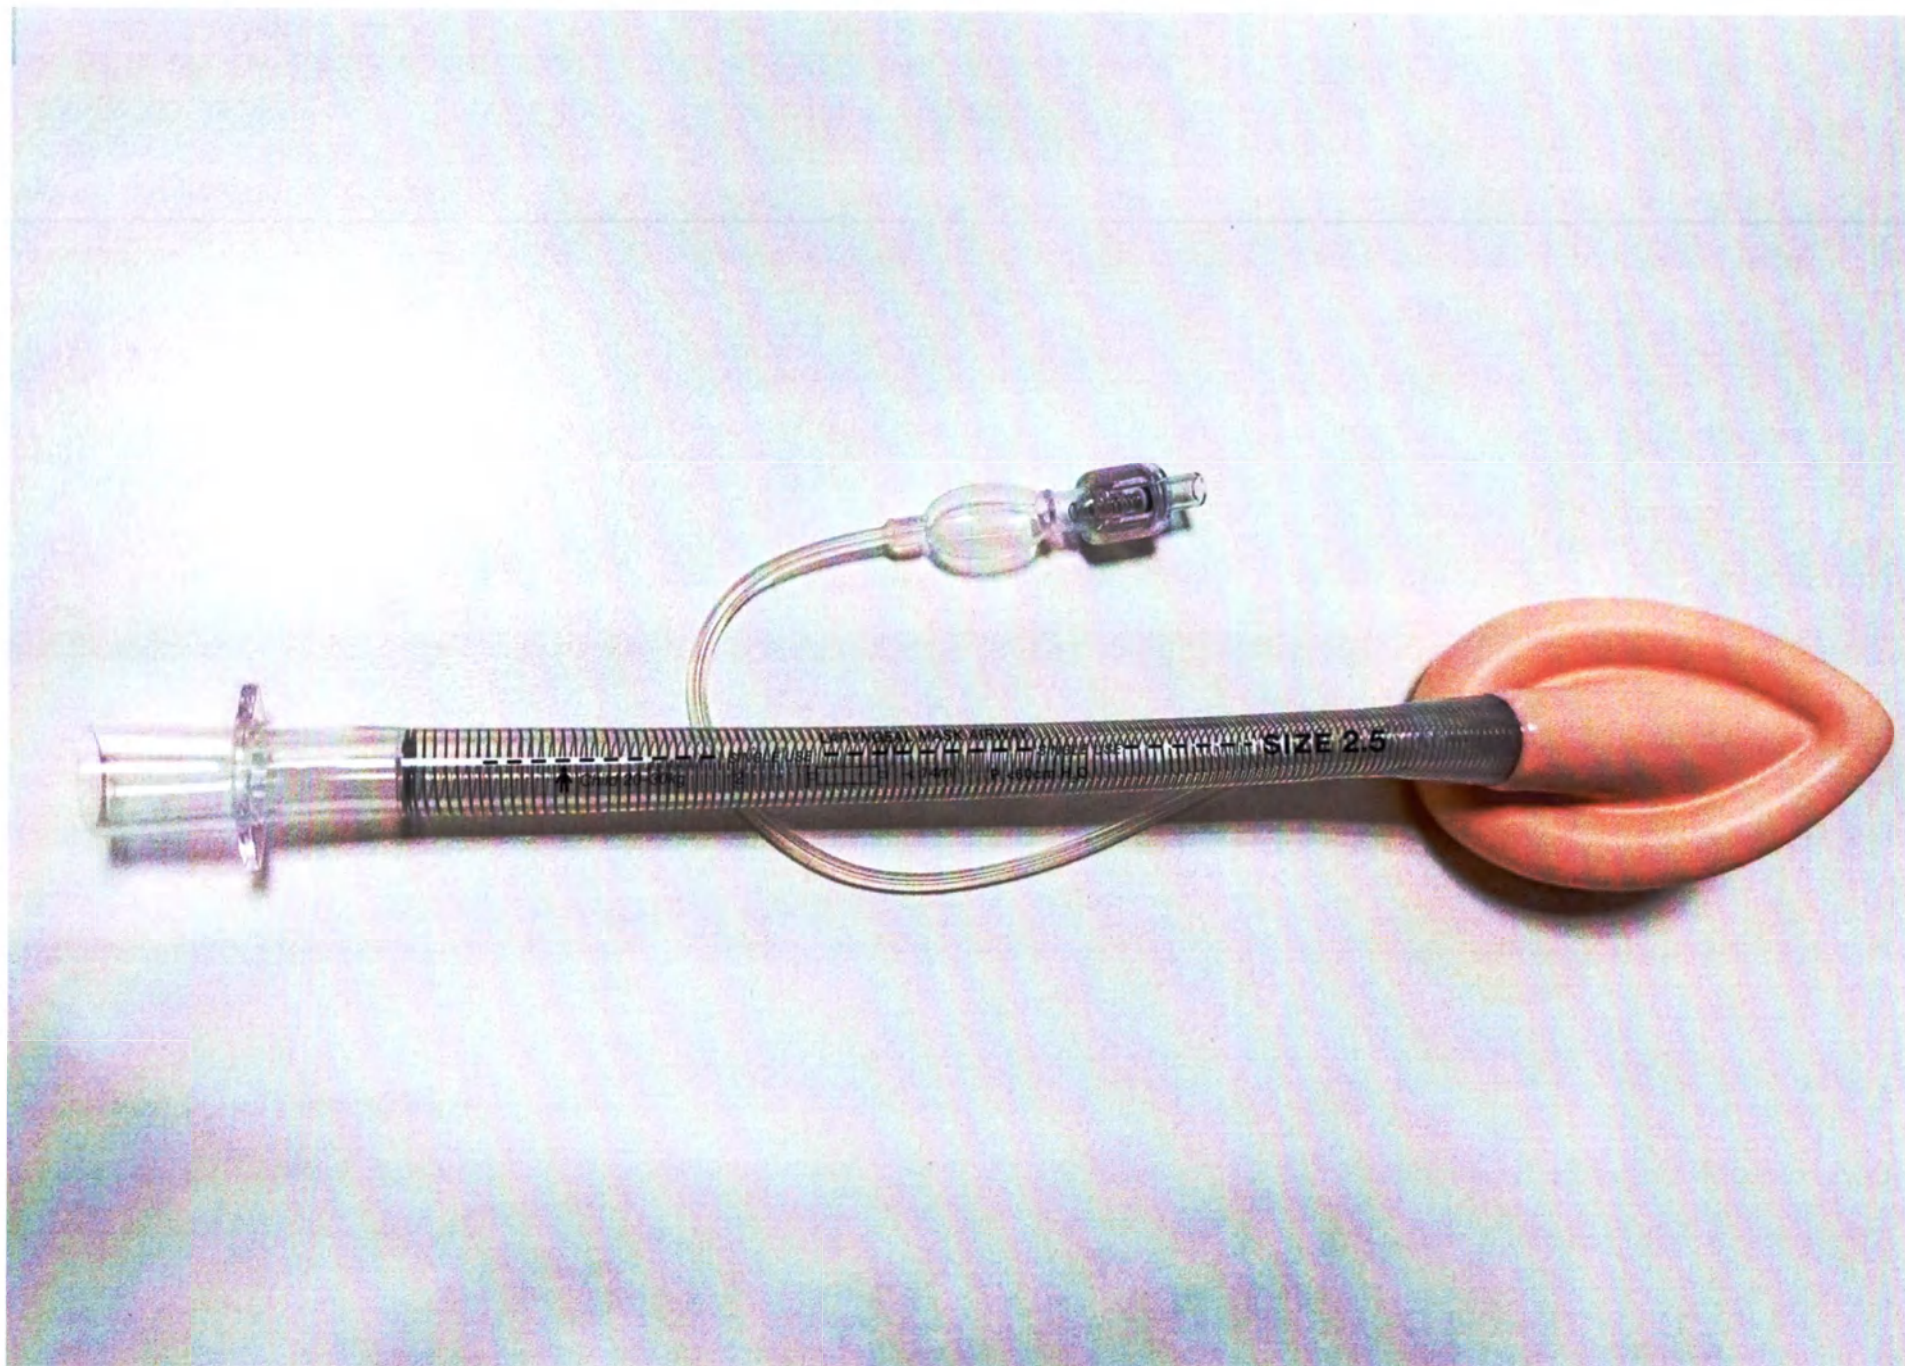


Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 2,5

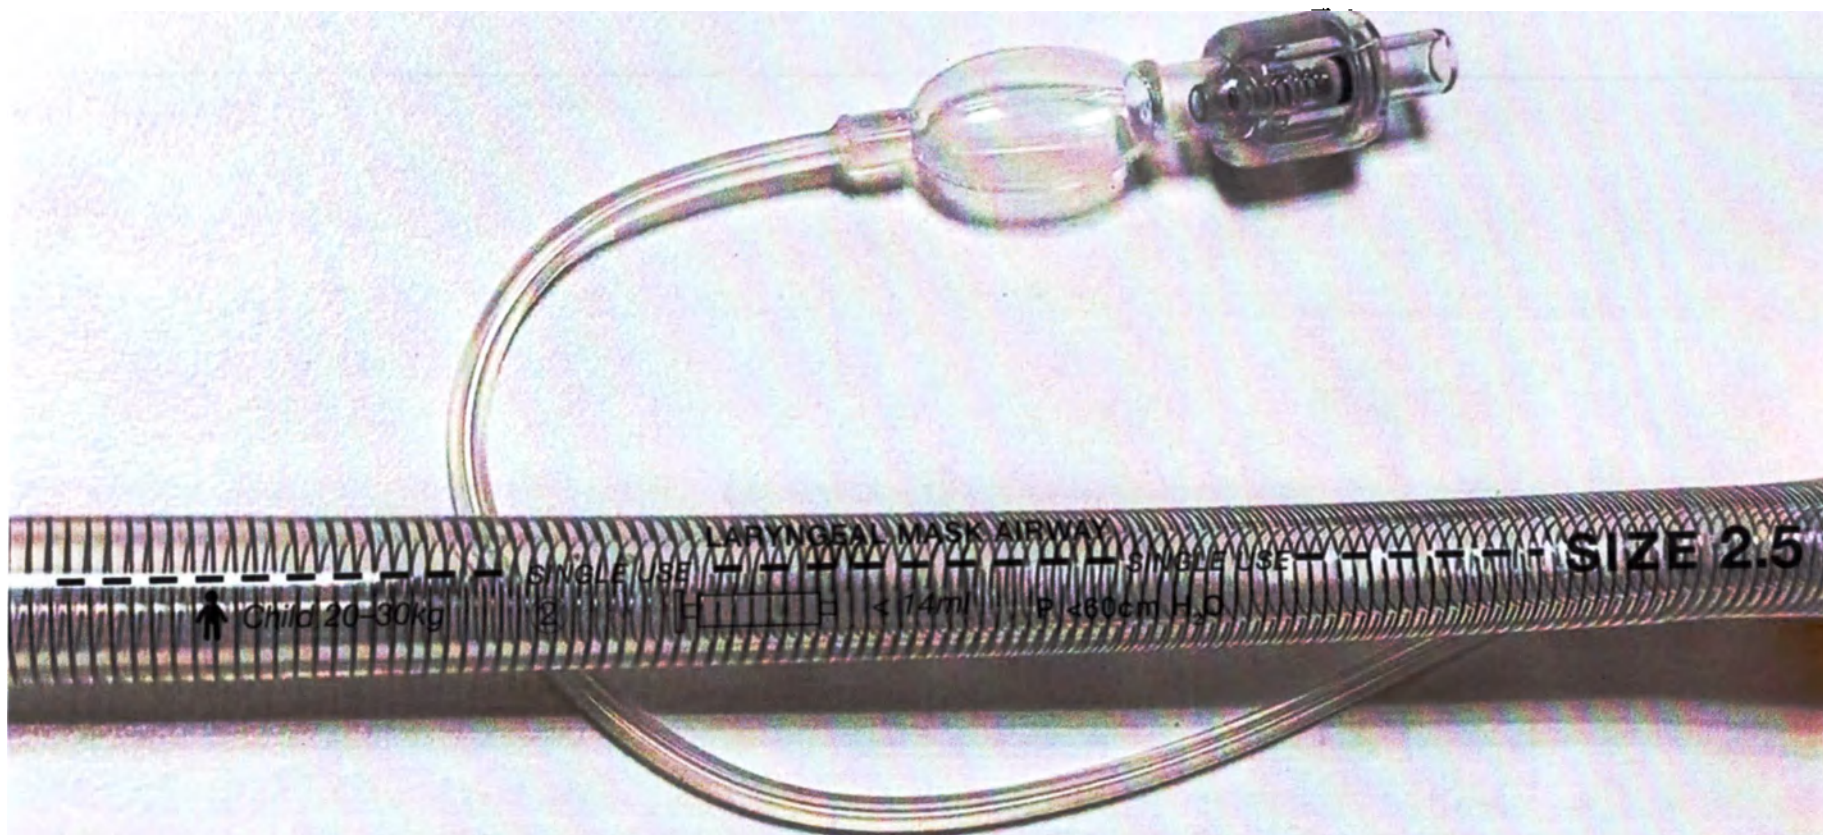


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 2,5

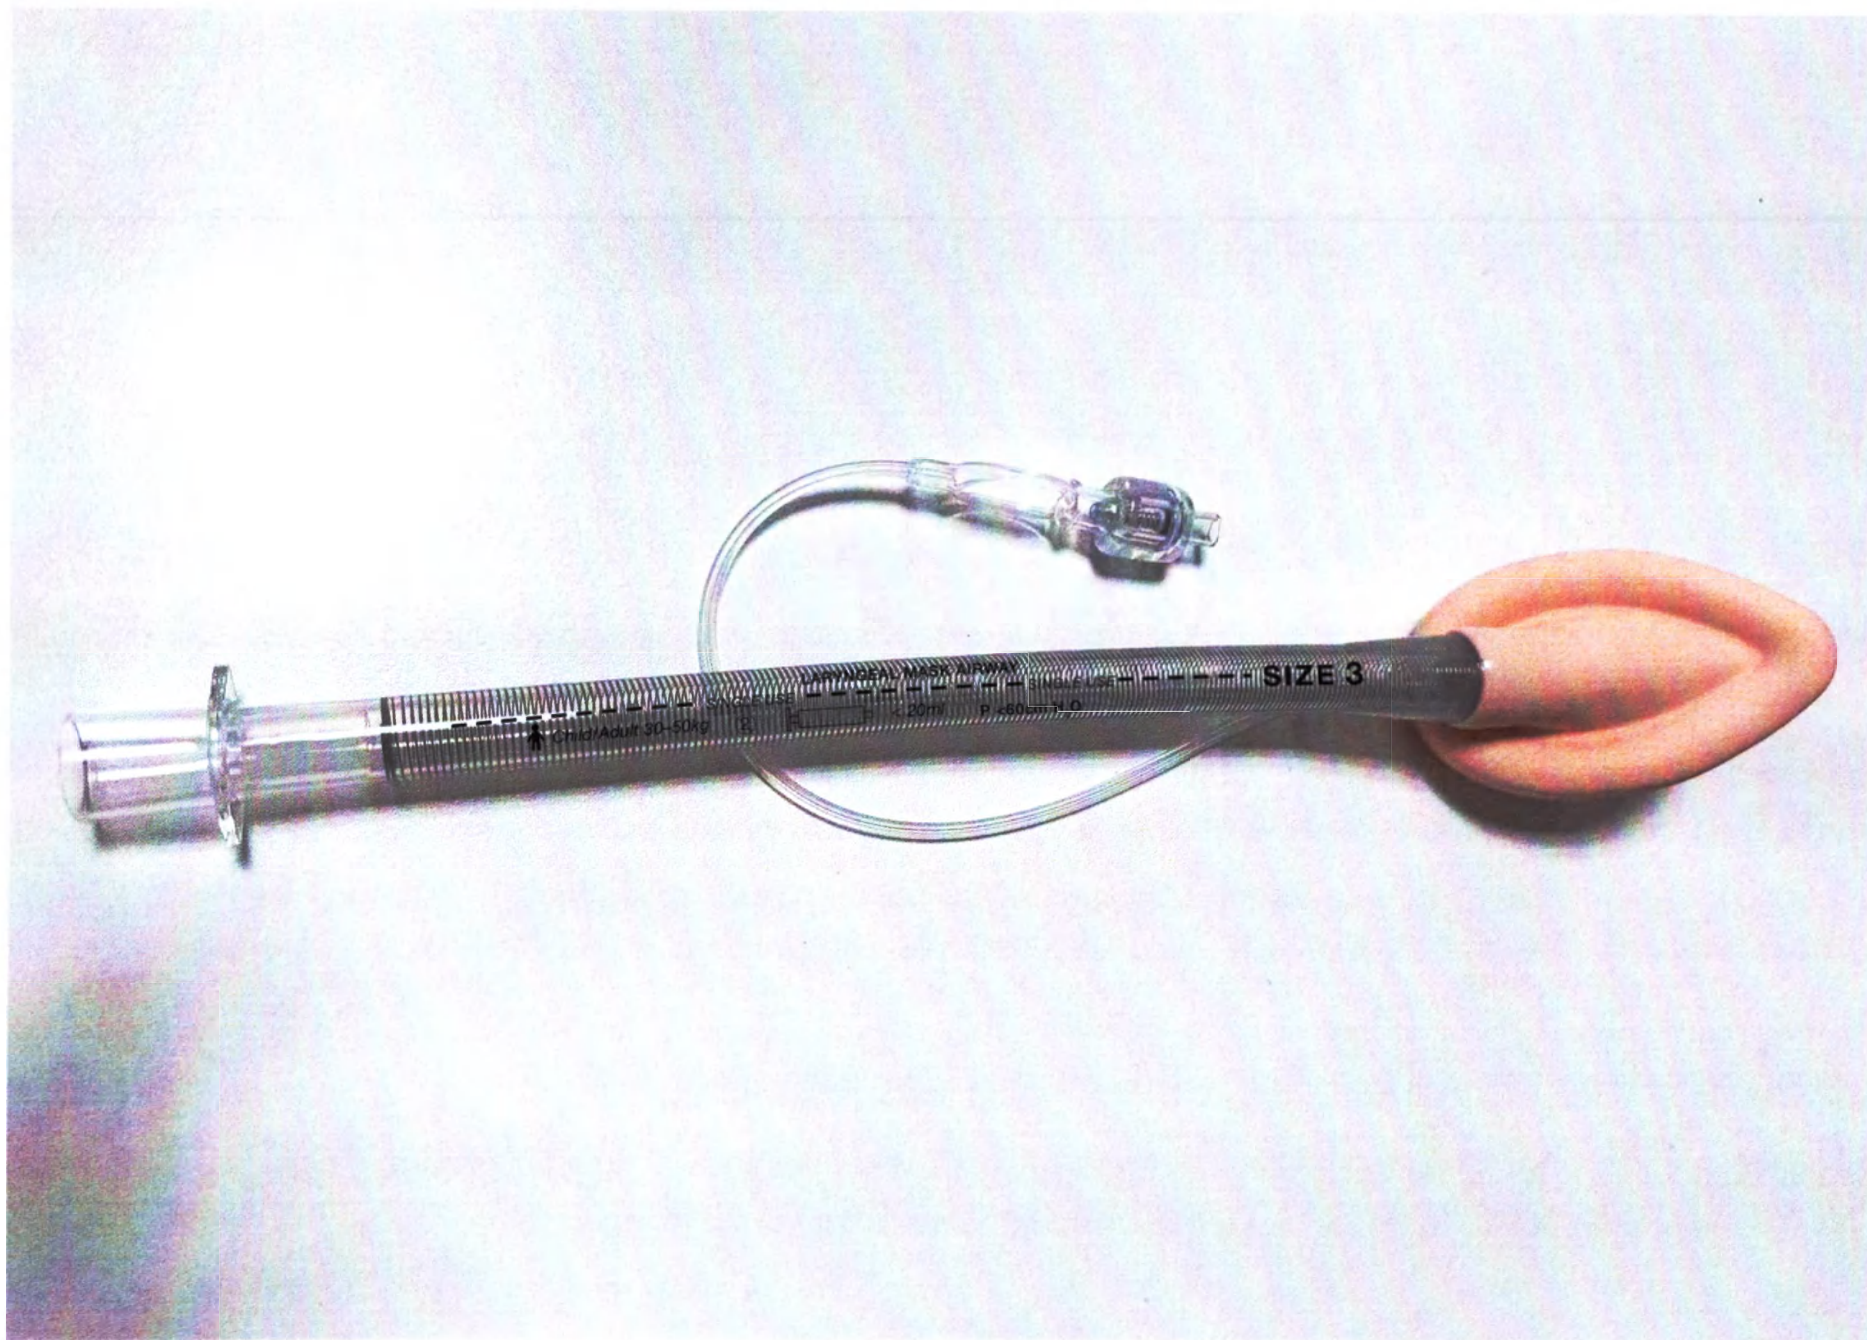


Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 3,0

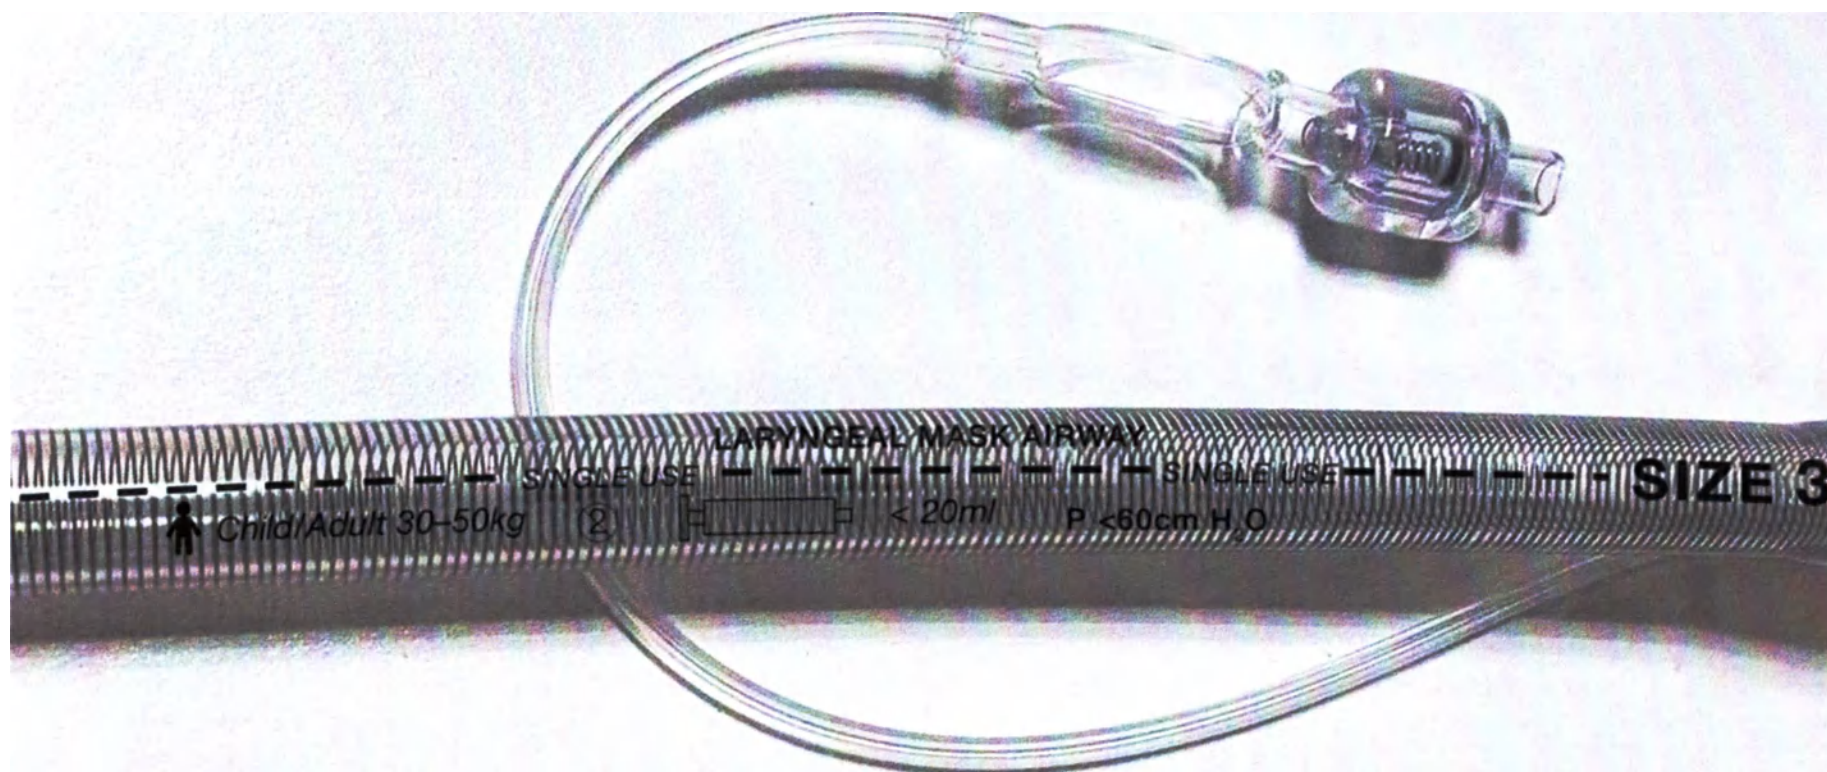

Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 3,0

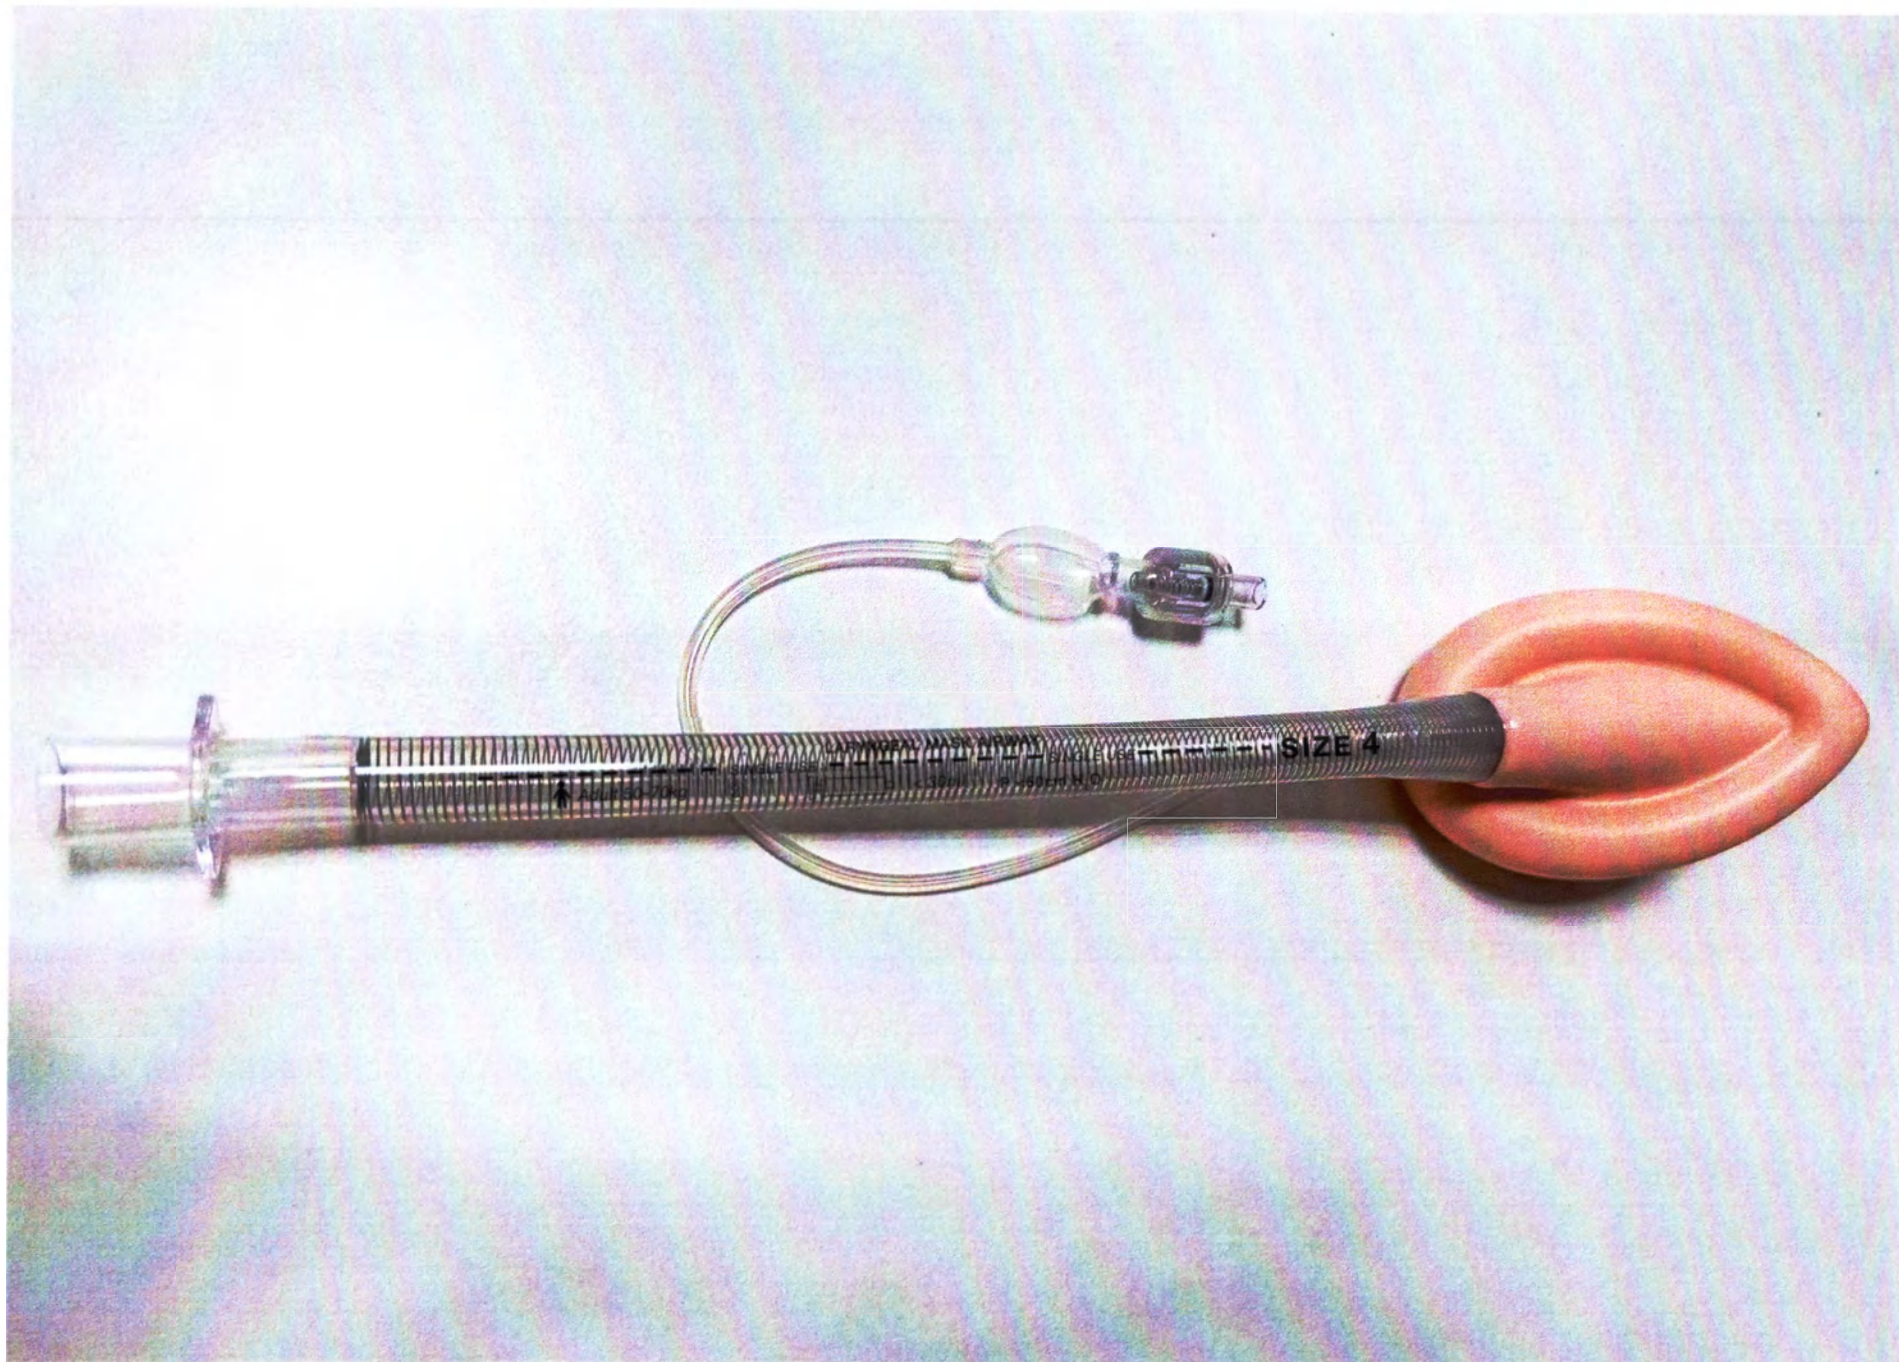

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 4,0

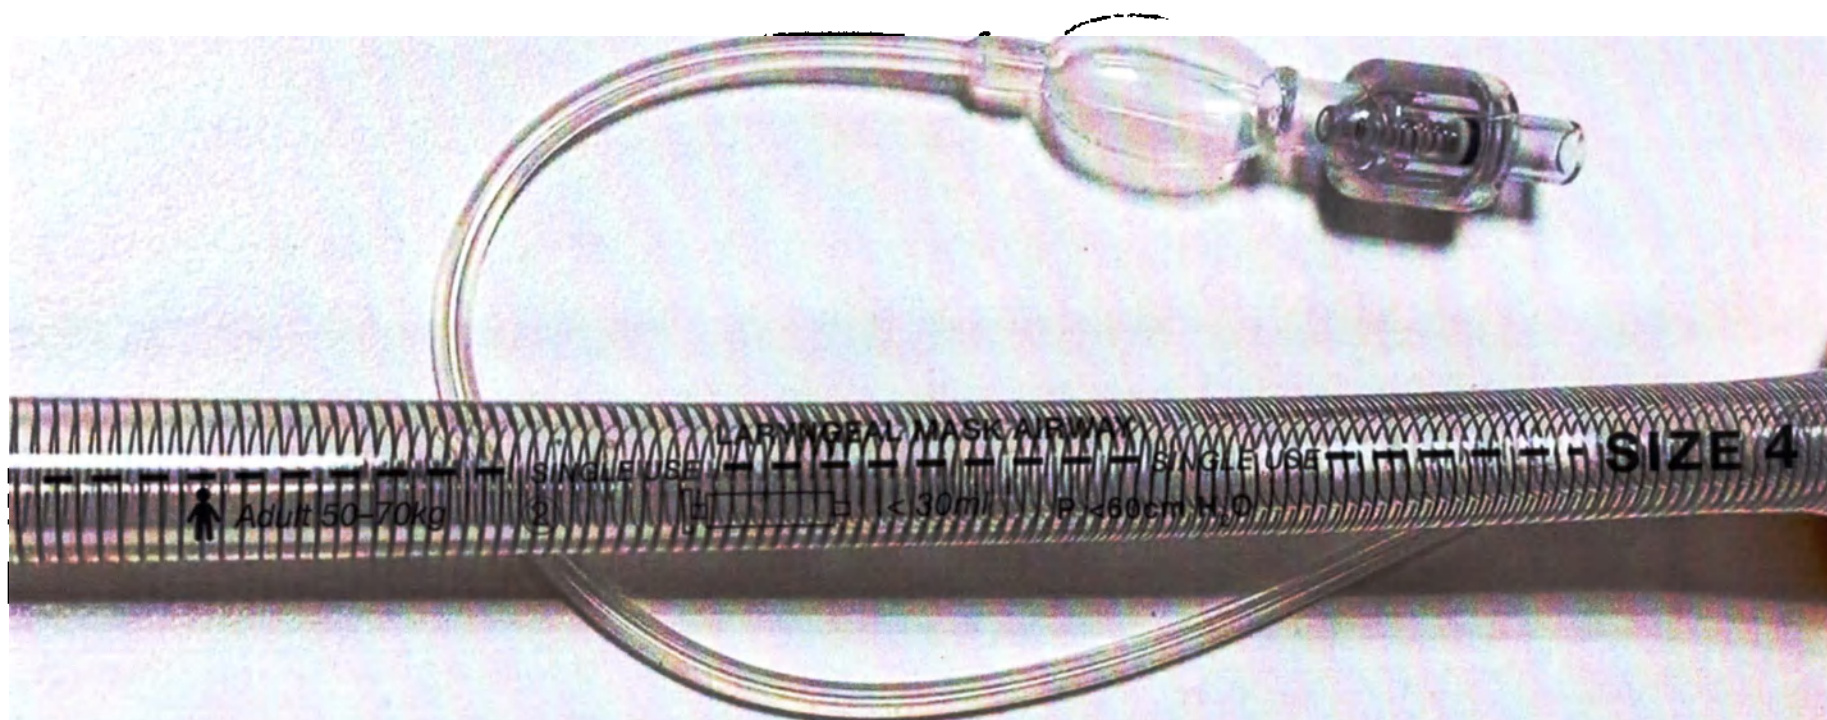

Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 4,0




Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 5,0



Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 5,0



Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 6,0

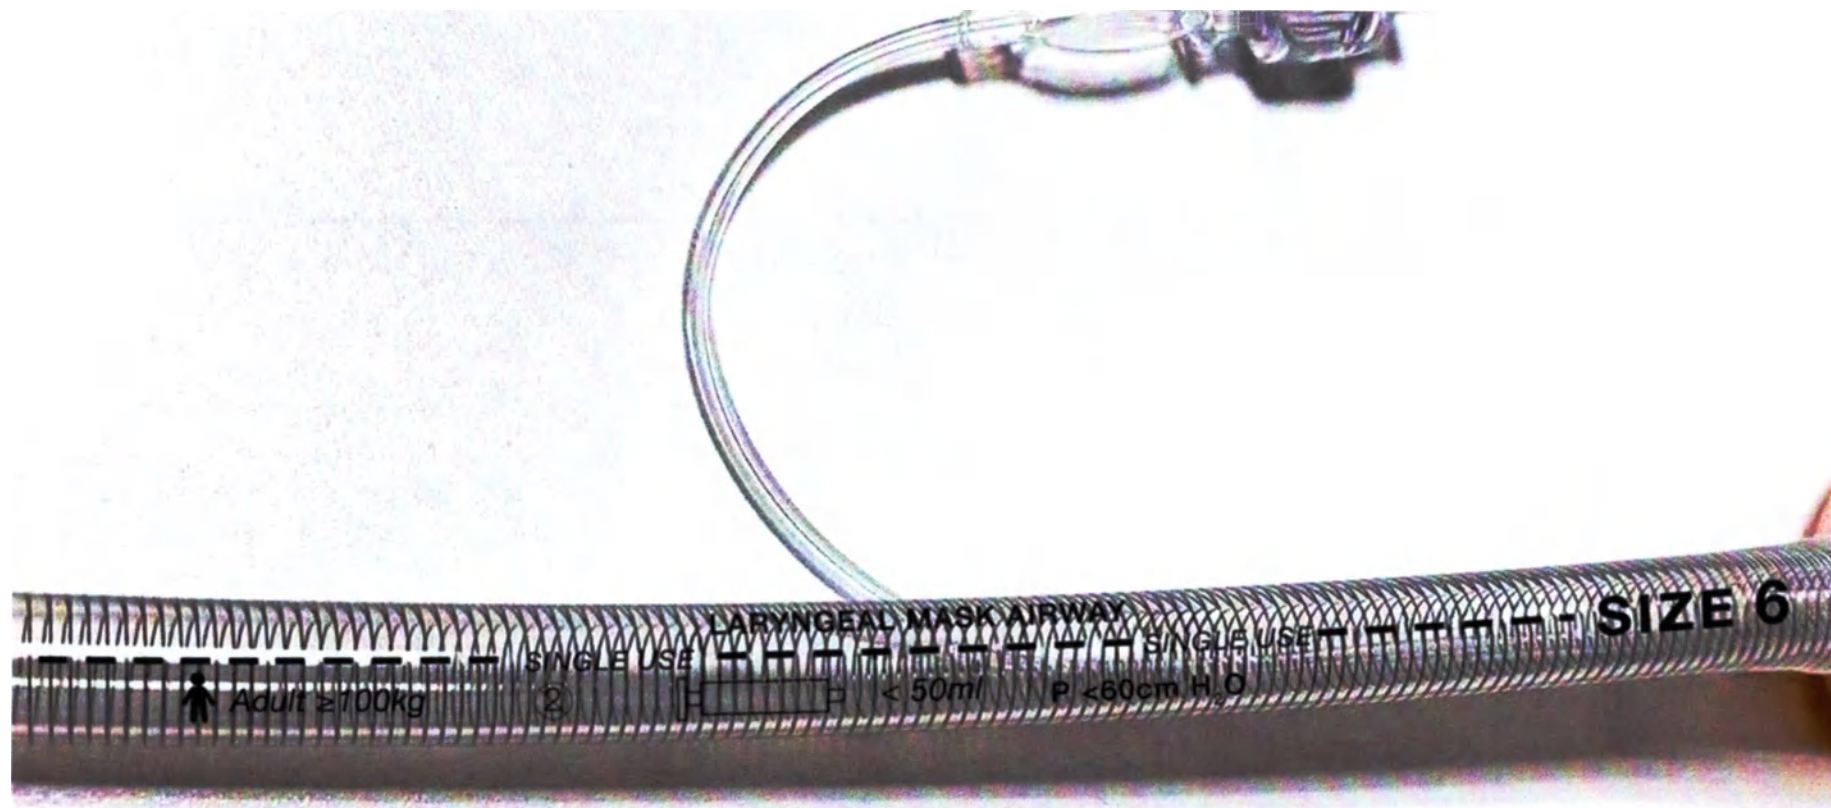


Маркировка изделия Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 6,0



Маска ларингеальная STATIM с каналом для дренирования, размер 2,5 (маркировка не наносится)



Маска ларингеальная STATIM силиконовая с каналом для дренирования, размер 3,0 (маркировка не наносится)

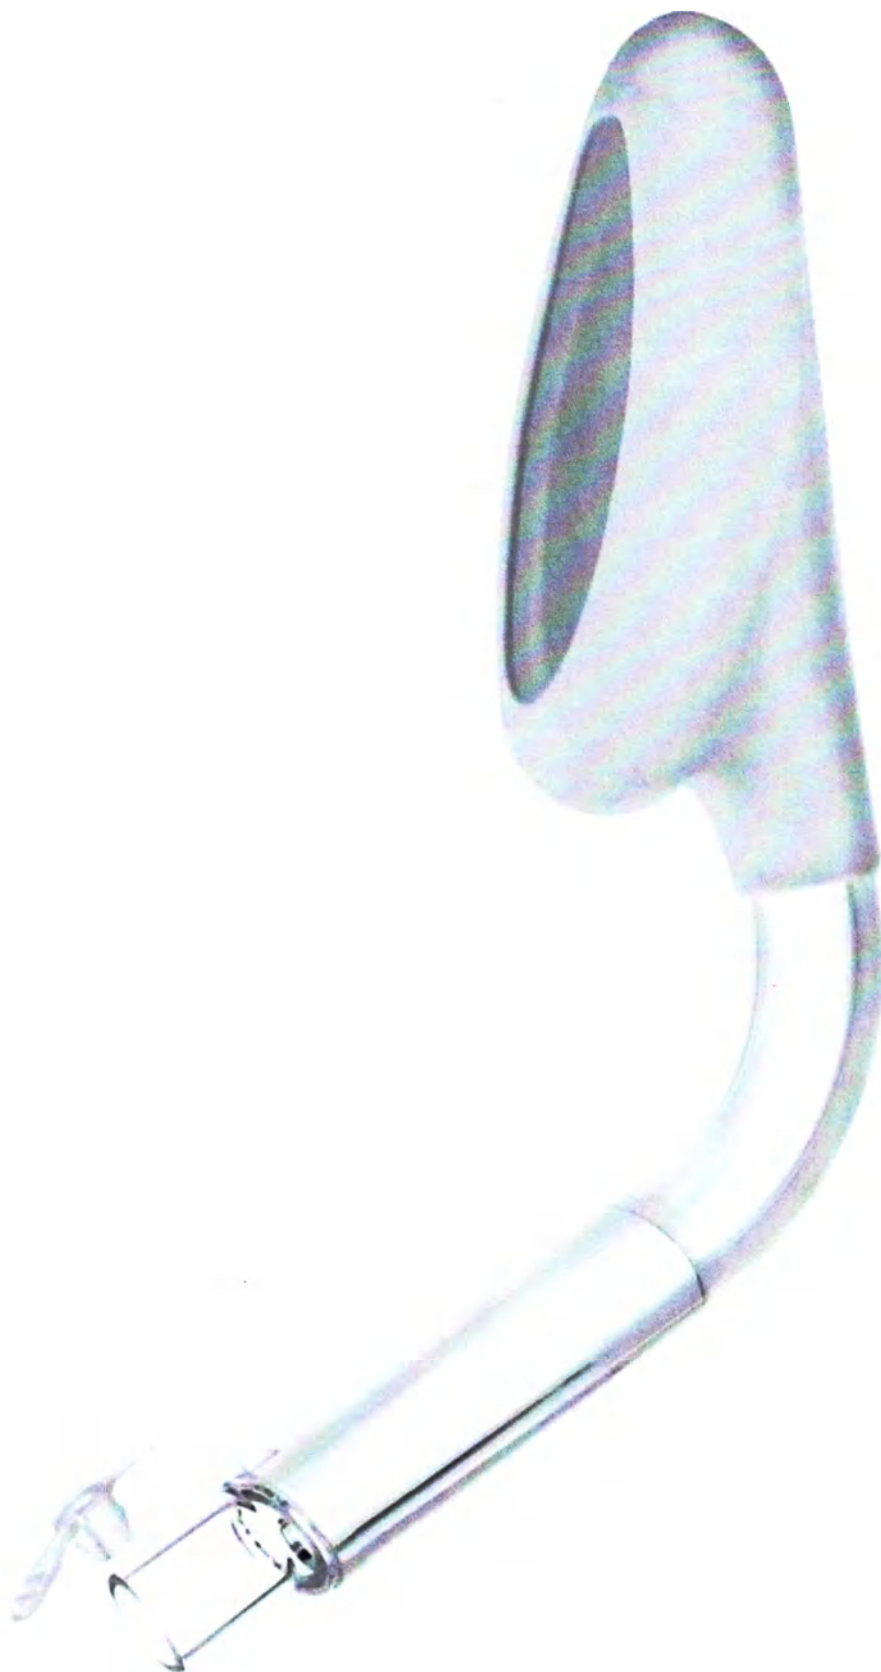

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с каналом для аспирации, размер 5,0 (маркировка не наносится)

Прошито, пронумеровано и
скреплено 71 листов

ООО «РиГ Групп Ко»

Генеральный директор

/ Г.С.Аллахвердиев

« 1 » марта 2024 г.



ОКПД2 32.50.21.129

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «РиГ Групп Ко»


Д.С. Аллахвердиев/
«3» июня 2024 г.

**МАКЕТ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная,
в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «РиГ Групп Ко»
199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Санкт-Петербург,
2024

1 Индивидуальная упаковка

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM, размер 1,0



ООО «Рнг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

ООО «РиГ Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть
пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA



Нетоксично



Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.


Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE



Не содержит латекса.

Для однократного применения

Масса пациента не более 5 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом — 4 мл, давление, создаваемое в манжете — 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная

Laryngeal Mask Airway



PY No. OT

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM, размер 1,5

Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «Риг Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Вилюзское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE

↑ | 5-10kg |

 < 7ml/60cmH₂O

Laryngeal Mask Airway

Не содержит латекса

Для одноразового применения

Масса пациента 5-10 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 7 мл, давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM, размер 2,0

 **ООО «Фнг Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места производства: **ООО «Фнг Групп Ко»**
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть
пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE

 | 10-20kg |

 < 10ml/60cmH₂O

Laryngeal Mask Airway

Не содержит латекса

Для одноразового применения

Масса пациента 10-20 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 10 мл, давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM, размер 2,5

Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «Риг Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE

↑ | 20-30kg |

 < 14ml/60cmH₂O

Laryngeal Mask Airway


Не содержит латекса

Для одноразового применения

Масса пациента 20-30 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 14 мл, давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM, размер 3,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места производства: **ООО «РиГ Групп Ко»**
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллюзское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE

 | 30-50kg |

 < 20ml/80cmH₂O

Laryngeal Mask Airway

Не содержит латекса

Для одноразового применения

Масса пациента 30-50 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 20 мл, давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM, размер 4,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
 Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
 Адрес места производства: **ООО «РиГ Групп Ко»**
 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE

 | 50-70 kg |

 < 30ml/60cmH₂O

Laryngeal Mask Airway

Не содержит латекса

Для одноразового применения

Масса пациента 50-70 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 30 мл, давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM, размер 5,0

 **ООО «Риг Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE

 | 70-100 kg |

 < 40ml/60cmH₂O

Laryngeal Mask Airway

Не содержит латекса

Для одноразового применения

Масса пациента 70-100 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 40 мл, давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM, размер 6,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места производства: **ООО «РиГ Групп Ко»**
183508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE

 **> 100kg**

 **< 50ml/60cmH₂O**

Не содержит латекса

Для одноразового применения

Масса пациента более 100 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 50 мл, давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная

Laryngeal Mask Airway



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 1,0

Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «Риг Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE

↑ | < 5kg |

< 4mm/60cmH₂O

Laryngeal Mask Airway

Не содержит латекса

Для одноразового применения

Масса пациента не более 5 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 4 мл, давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 1,5

 **ООО «Риг Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «Риг Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE

↑ | 5-10kg |

 < 7ml/60cmH₂O

Laryngeal Mask Airway

Не содержит латекса

Для одноразового применения

Масса пациента 5-10 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 7 мл, давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №ОТ.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 2,0

Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «Риг Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть
пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

 SINGLE-USE

↑ | 10-20kg |

 < 10ml/60cmH₂O

Laryngeal Mask Airway

Не содержит латекса

Для одноразового применения

Масса пациента 10-20 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 10 мл, давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 2,5

Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «Риг Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллюзское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горалово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE

↑ | 20-30kg |

 < 14ml/80cmH₂O

Laryngeal Mask Airway

Не содержит латекса

Для одноразового применения

Масса пациента 20-30 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 14 мл, давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 3,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места производства: **ООО «РиГ Групп Ко»**
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Вылюзское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.


Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE

 | 30-50kg |

 < 20ml/80cmH₂O

Laryngeal Mask Airway

Не содержит латекса

Для одноразового применения

Масса пациента 30-50 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 20 мл, давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 4,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.


Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE

 | 50-70 kg |

 < 30ml/60cmH₂O

Laryngeal Mask Airway

Не содержит латекса

Для одноразового применения

Масса пациента 50-70 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 30 мл, давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 5,0

 **ООО «Риг Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «Риг Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (J!) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE

↑ | 70-100 kg |

 < 40mmHg/50cmH₂O

Laryngeal Mask Airway

Не содержит латекса

Для одноразового применения

Масса пациента 70-100 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 40 мл, давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №ОТ.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая, размер 6,0

Адрес места производства:  ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «Риг Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:



SINGLE-USE

 | > 100kg |

 < 50ml/60cmH₂O

Laryngeal Mask Airway

Не содержит латекса

Для одноразового применения
Масса пациента более 100 кг

Максимальный объем
наполнения манжеты воздухом
– 50 мл, давление, создаваемое в
манжете – 60 см вод. ст.
Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 1,0

Адрес места производства: ООО «РиГ Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть
пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

SIZE

SINGLE USE



Neonatal < 5kg

 **< 4ml**

P < 60cm H₂O

LARYNGEAL MASK AIRWAY

Размер

Для одноразового применения

Запрет на повторное применение

Для новорожденных с массой тела не более 5 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 4 мл

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 1,5

 **ООО «Риг Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места
производства: **ООО «Риг Групп Ко»**
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

SIZE

SINGLE USE



Infant 5-10kg



< 7ml

P < 60cm H₂O

LARYNGEAL MASK AIRWAY

Размер

Для одноразового применения

Запрет на повторное применение

Для младенцев с массой тела от 5 до 10 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 7 мл

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 2,0

 **ООО «Риг Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места
производства: **ООО «Риг Групп Ко»**
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть
пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

SIZE

SINGLE USE



Infant/Child 10-20kg



< 10ml

P < 60cm H₂O

LARYNGEAL MASK AIRWAY

Размер

Для одноразового применения

Запрет на повторное применение

Для младенцев и детей с массой тела от 10 до 20 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 10 мл

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 2,5

Адрес места производства: ООО «РиГ Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Вылюзское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.


Символы, нанесенные на воздуховод маски:

SIZE

SINGLE USE



 Child 20-30kg

 < 14ml

P < 60cm H₂O

LARYNSEAL MASK AIRWAY

Размер

Для одноразового применения


Запрет на повторное применение

Для детей с массой тела от 20 до 30 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 14 мл

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 3,0

Адрес места производства: ООО «РиГ Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

SIZE

Размер

SINGLE USE

Для одноразового применения



Запрет на повторное применение

 **Child/Adult 30-50kg**

Для детей и взрослых с массой тела от 30 до 50 кг

 **< 20ml**

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 20 мл

P < 60cm H₂O

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

LARYNGEAL MASK AIRWAY

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 4,0

Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «Риг Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

SIZE

SINGLE USE



 **Adult 50-70kg**

 **< 30ml**

P < 60cm H₂O

LARYNGEAL MASK AIRWAY

Размер

Для одноразового применения

Запрет на повторное применение

Для взрослых с массой тела от 50 до 70 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 30 мл

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 5,0

Адрес места производства: ООО «РиГ Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

SIZE

SINGLE USE



 **Adult 70-100kg**

 **< 40ml**

P < 60cm H₂O

LARYNGEAL MASK AIRWAY

Размер

Для одноразового применения

Запрет на повторное применение

Для взрослых с массой тела от 70 до 100 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 40 мл

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №ОТ.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, размер 6,0

 **ООО «Риг Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места производства: **ООО «Риг Групп Ко»**
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Вылюзское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

SIZE

SINGLE USE



 **Adult > 100kg**



< 50ml

P < 60cm H₂O

LARYNGEAL MASK AIRWAY

Размер

Для одноразового применения

Запрет на повторное применение

Для взрослых с массой более 100 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 50 мл

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 1,0

Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «Риг Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть
пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (II) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

**SIZE
SINGLE USE**



 Neonatal < 5kg

 < 4ml

P < 60cm H₂O

LARYNGEAL MASK AIRWAY

Размер

Для одноразового применения

Запрет на повторное применение

Для новорожденных с массой тела не более 5 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 4 мл

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 1,5

Адрес места производства: ООО «РиГ Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Вилюзское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

**SIZE
SINGLE USE**



 **Infant 5-10kg**

 **< 7ml**

P < 60cm H₂O

LARYNGEAL MASK AIRWAY

Размер

Для одноразового применения

Запрет на повторное применение

Для младенцев с массой тела от 5 до 10 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 7 мл

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 2,0

Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «Риг Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

**SIZE
SINGLE USE**



 **Infant/Child 10-20kg**

 **< 10ml**

P < 60cm H₂O

LARYNGEAL MASK AIRWAY

Размер

Для одноразового применения

Запрет на повторное применение

Для младенцев и детей с массой тела от 10 до 20 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 10 мл

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 2,5

Адрес места производства: ООО «РиГ Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллюозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

SIZE

SINGLE USE



 Child 20-30kg

 < 14ml

P < 60cm H₂O

LARYNGEAL MASK AIRWAY

Размер

Для одноразового применения

Запрет на повторное применение

Для детей с массой тела от 20 до 30 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 14 мл

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 3,0

 **ООО «Риг Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «Риг Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

SIZE

Размер

SINGLE USE

Для одноразового применения



Запрет на повторное применение

 **Child/Adult 30-50kg**

Для детей и взрослых с массой тела от 30 до 50 кг

 **< 20ml**

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 20 мл

P < 60cm H₂O

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

LARYNGEAL MASK AIRWAY

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 4,0

ООО «Риг Групп Ко»
 Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
 Адрес места
 производства: **ООО «Риг Групп Ко»**
 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Вилюзское г. п., тер. Южная часть пр.
 зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
 OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

SIZE
SINGLE USE



 **Adult 50-70kg**

 **< 30ml**

P < 60cm H₂O

LARYNGEAL MASK AIRWAY

Размер

Для одноразового применения

Запрет на повторное применение

Для взрослых с массой тела от 50 до 70 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 30 мл

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 5,0

Адрес места производства: ООО «РиГ Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллюзское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

**SIZE
SINGLE USE**



 **Adult 70-100kg**

 **< 40ml**

P < 60cm H₂O

LARYNGEAL MASK AIRWAY

Размер

Для одноразового применения


Запрет на повторное применение

Для взрослых с массой тела от 70 до 100 кг

Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 40 мл

Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.

Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с интегрированной стальной спиралью, размер 6,0

Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «Риг Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Вилюзское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Символы, нанесенные на воздуховод маски:

SIZE	Размер
SINGLE USE	Для одноразового применения
	Запрет на повторное применение
 Adult > 100kg	Для взрослых с массой более 100 кг
 < 50ml	Максимальный объем наполнения манжеты воздухом – 50 мл
P < 60cm H₂O	Давление, создаваемое в манжете – 60 см вод. ст.
LARYNGEAL MASK AIRWAY	Маска ларингеальная



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с каналом для дренирования, размер 1,5

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллюзское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
 Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с каналом для дренирования, размер 2,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть
 пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
 Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S
 REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с каналом для дренирования, размер 2,5

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
 Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с каналом для дренирования, размер 3,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горалово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
 Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

Маска ларингеальная STATIM с каналом для дренирования, размер 4,0

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



PY N₂ OT.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с каналом для дренирования, размер 5,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
 зоны Горалово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
 Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
 OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



ПУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с каналом для дренирования, размер 1,0

Адрес места производства:  ООО «РиГ Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть
пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с каналом для дренирования, размер 1,5

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с каналом для дренирования, размер 2,0

Адрес места производства:  ООО «РиГ Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть
пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с каналом для дренирования, размер 2,5

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
 Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с каналом для дренирования, размер 3,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
 Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с каналом для дренирования, размер 4,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
 зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
 Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
 OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №ОТ.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM силиконовая с каналом для дренирования, размер 5,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места
производства: **ООО «РиГ Групп Ко»**
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. л., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с каналом для аспирации, размер 1,0

Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
ООО «Риг Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть
пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с каналом для аспирации, размер 1,5

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллюзское г. п., тер. Южная часть пр.
 зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
 Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
 OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с каналом для аспирации, размер 2,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть
 пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
 Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S
 REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с каналом для аспирации, размер 3,0

 **ООО «Риг Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с каналом для аспирации, размер 4,0

 **ООО «Риг Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места
производства: **ООО «Риг Групп Ко»**
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с каналом для аспирации, размер 5,0

 **ООО «Риг Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «Риг Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
 зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
 Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
 OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №ОТ.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью с каналом для дренирования, размер 1,5

 **ООО «Риг Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства: **ООО «Риг Групп Ко»**
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью с каналом для дренирования, размер 2,0

Адрес места ООО «РиГ Групп Ко»
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
производства: ООО «РиГ Групп Ко»
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть
пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью с каналом для дренирования, размер 2,5

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью с каналом для дренирования, размер 3,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
 Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью с каналом для дренирования, размер 5,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места
производства: **ООО «РиГ Групп Ко»**
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Вилуозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, с каналом для дренирования, со стилетом, размер 1,5

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, с каналом для дренирования, со стилетом, размер 2,0

 **ООО «Риг Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «Риг Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть
пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, с каналом для дренирования, со стилетом, размер 2,5

 **ООО «Риг Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места
производства: **ООО «Риг Групп Ко»**
188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, с каналом для дренирования, со стилетом, размер 3,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
 Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, с каналом для дренирования, со стилетом, размер 4,0

 **ООО «Фин Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «Фин Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
 Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
 Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истёкшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Маска ларингеальная STATIM с интегрированной стальной спиралью, с каналом для дренирования, со стилетом, размер 5,0

 **ООО «РиГ Групп Ко»**
Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50
Адрес места **ООО «РиГ Групп Ко»**
производства: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п., тер. Южная часть пр.
зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3, стр. 1.
Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.
Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040 Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX
	XX.XX.XXXX		XXXXXXXX

Нетоксично  Стерильно, стерилизация оксидом этилена

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.



РУ №от.....

2 Потребительская упаковка

МАСКА ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ СТАТИМ, ОДНОРАЗОВАЯ, СТЕРИЛЬНАЯ, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023



Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 45 °С, относительная влажность не должна превышать 98% при температуре плюс 35 °С и атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы I (II) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительная влажность не более 100% при плюс 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.

Утилизация: Изделия, бывшие в эксплуатации, утилизируют в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.3684-21 по классу отходов Б, а изделия с истекшим сроком хранения и / или не бывшие в употреблении – по классу отходов А.

Нитоксично



Стерильно, стерилизация
оксидом этилена



Вариант исполнения маски ларингеальной, размер XX – X шт.



XX.XX.XXXX



XXXXXXX

XX.XX.XXXX

XXXXXXXXX



ООО «РиГ Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Адрес места
производства:

ООО «РиГ Групп Ко»

188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н,
Виллозское г. п., тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв-л, д. 3,
стр. 1.

Ningbo Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.

Room 805-806, No. 299 of Jiangnan Yipin Garden, Hi-Tech Zone, 315040

Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

3 Транспортная упаковка

**Маска ларингеальная STATIM,
одноразовая, стерильная, в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.21-005-38044224-2023**

Вариант исполнения маски ларингеальной STATIM – X шт.



ООО «Риг Групп Ко»

Адрес: 199406, город Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50

Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительная влажность не более 100% при плюс 25 °С, транспортирование осуществлять всеми видами крытого транспорта, при условии их защиты от загрязнений и механических повреждений.



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX



XXXXXXXXXX




XXXXXXXXXX



Прошито, пронумеровано и
скреплено 68 листов

ООО «РиГ Групп Ко»
Генеральный директор

 / Т.С. Аллахвердиев
«10» ноя 2024 г.

