


ровано

гор

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «РПТ УНИКОС»

 С.В. Касаткина



14 » 06 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Фетальный монитор: автоматизированный кардиотокограф по ТУ 9442-003-52696471-2006 в следующих исполнениях: «Уникос-01»; «Уникос-02»; «Уникос-03»


Общее фото вариантов исполнения.

Фетальный монитор «Уникос-01» панельный одноканальный

Фетальный монитор «Уникос-01» панельный двухканальный

Фетальный монитор «Уникос-02» панельный

Фетальный монитор «Уникос-03» панельный

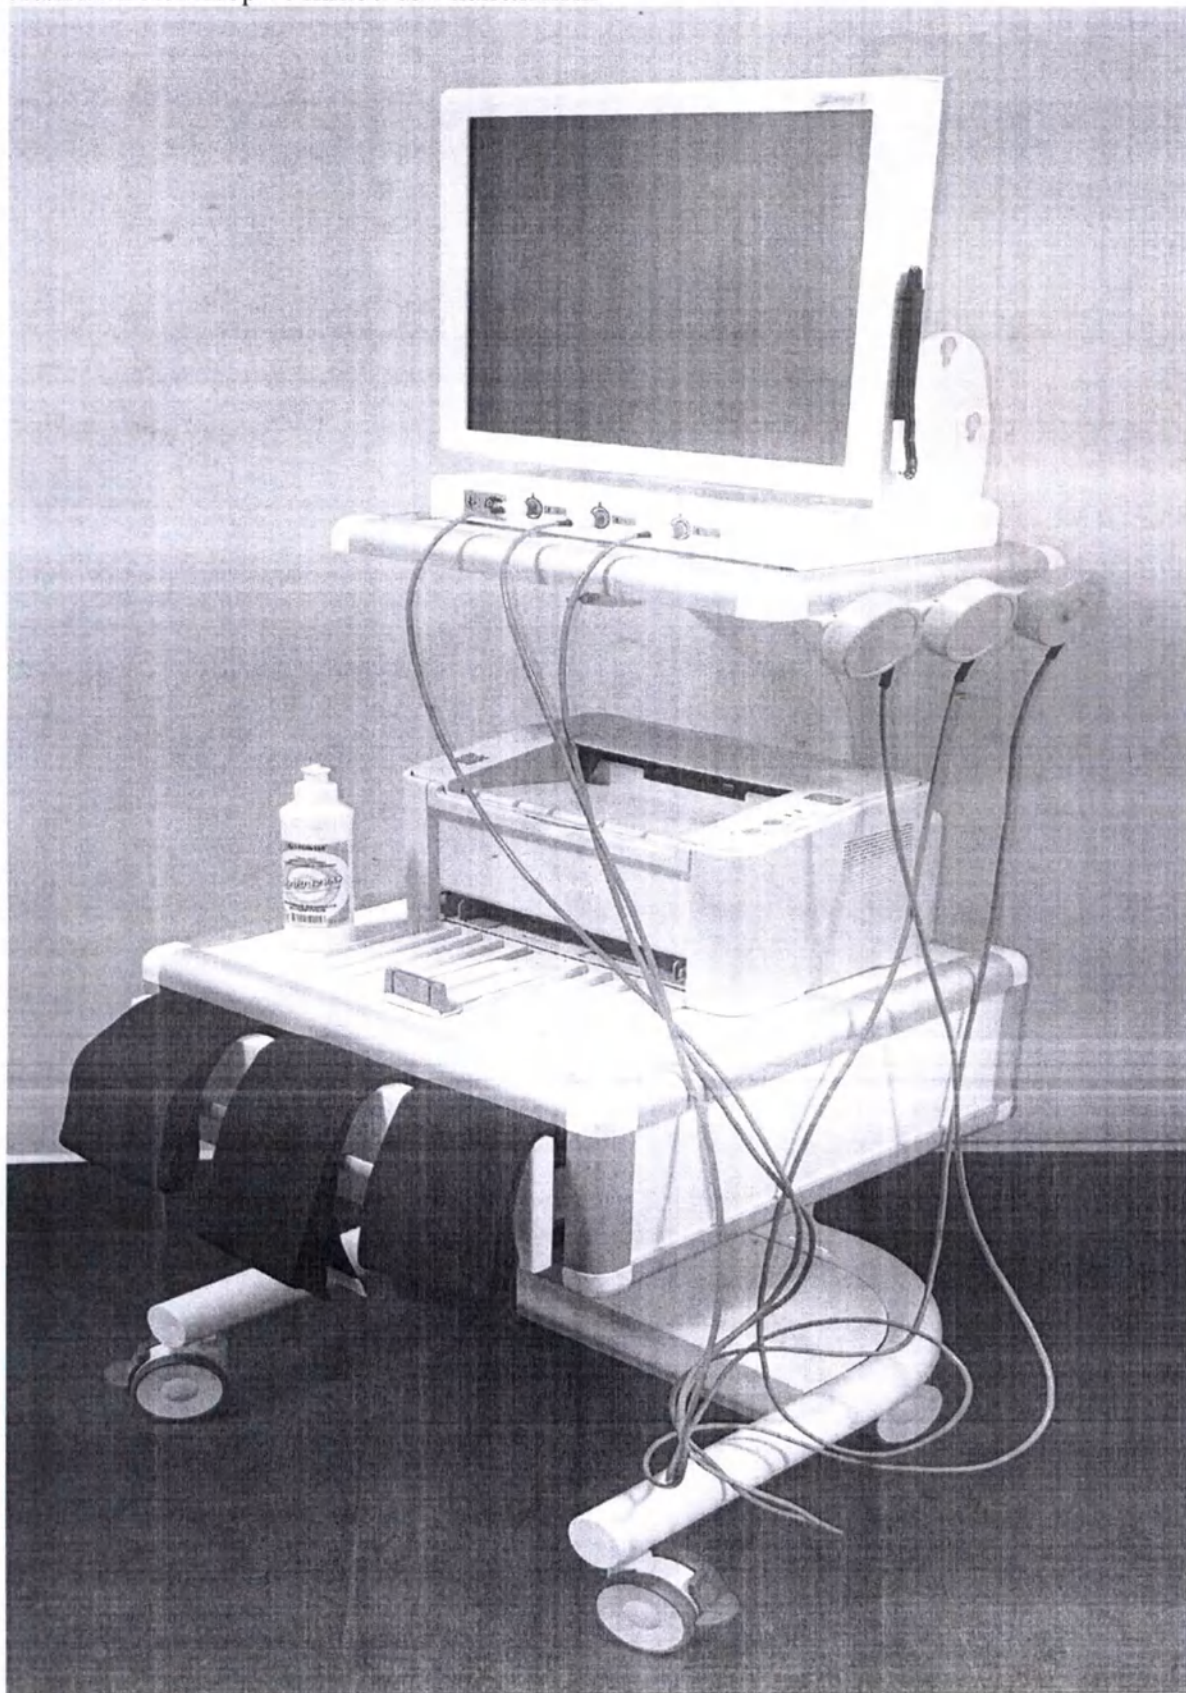

Общее фото вариантов исполнения.

Фетальный монитор «Уникос-01» ноутбук одноканальный


Фетальный монитор «Уникос-01» ноутбук двухканальный

Фетальный монитор «Уникос-02» ноутбук


Фетальный монитор «Уникос-03» ноутбук




Вычислительный модуль обработки и отображения данных медицинского исследования (компьютер типа «панельный») со стилусом
Системный ультразвуковой доплеровский модуль (медицинский блок)

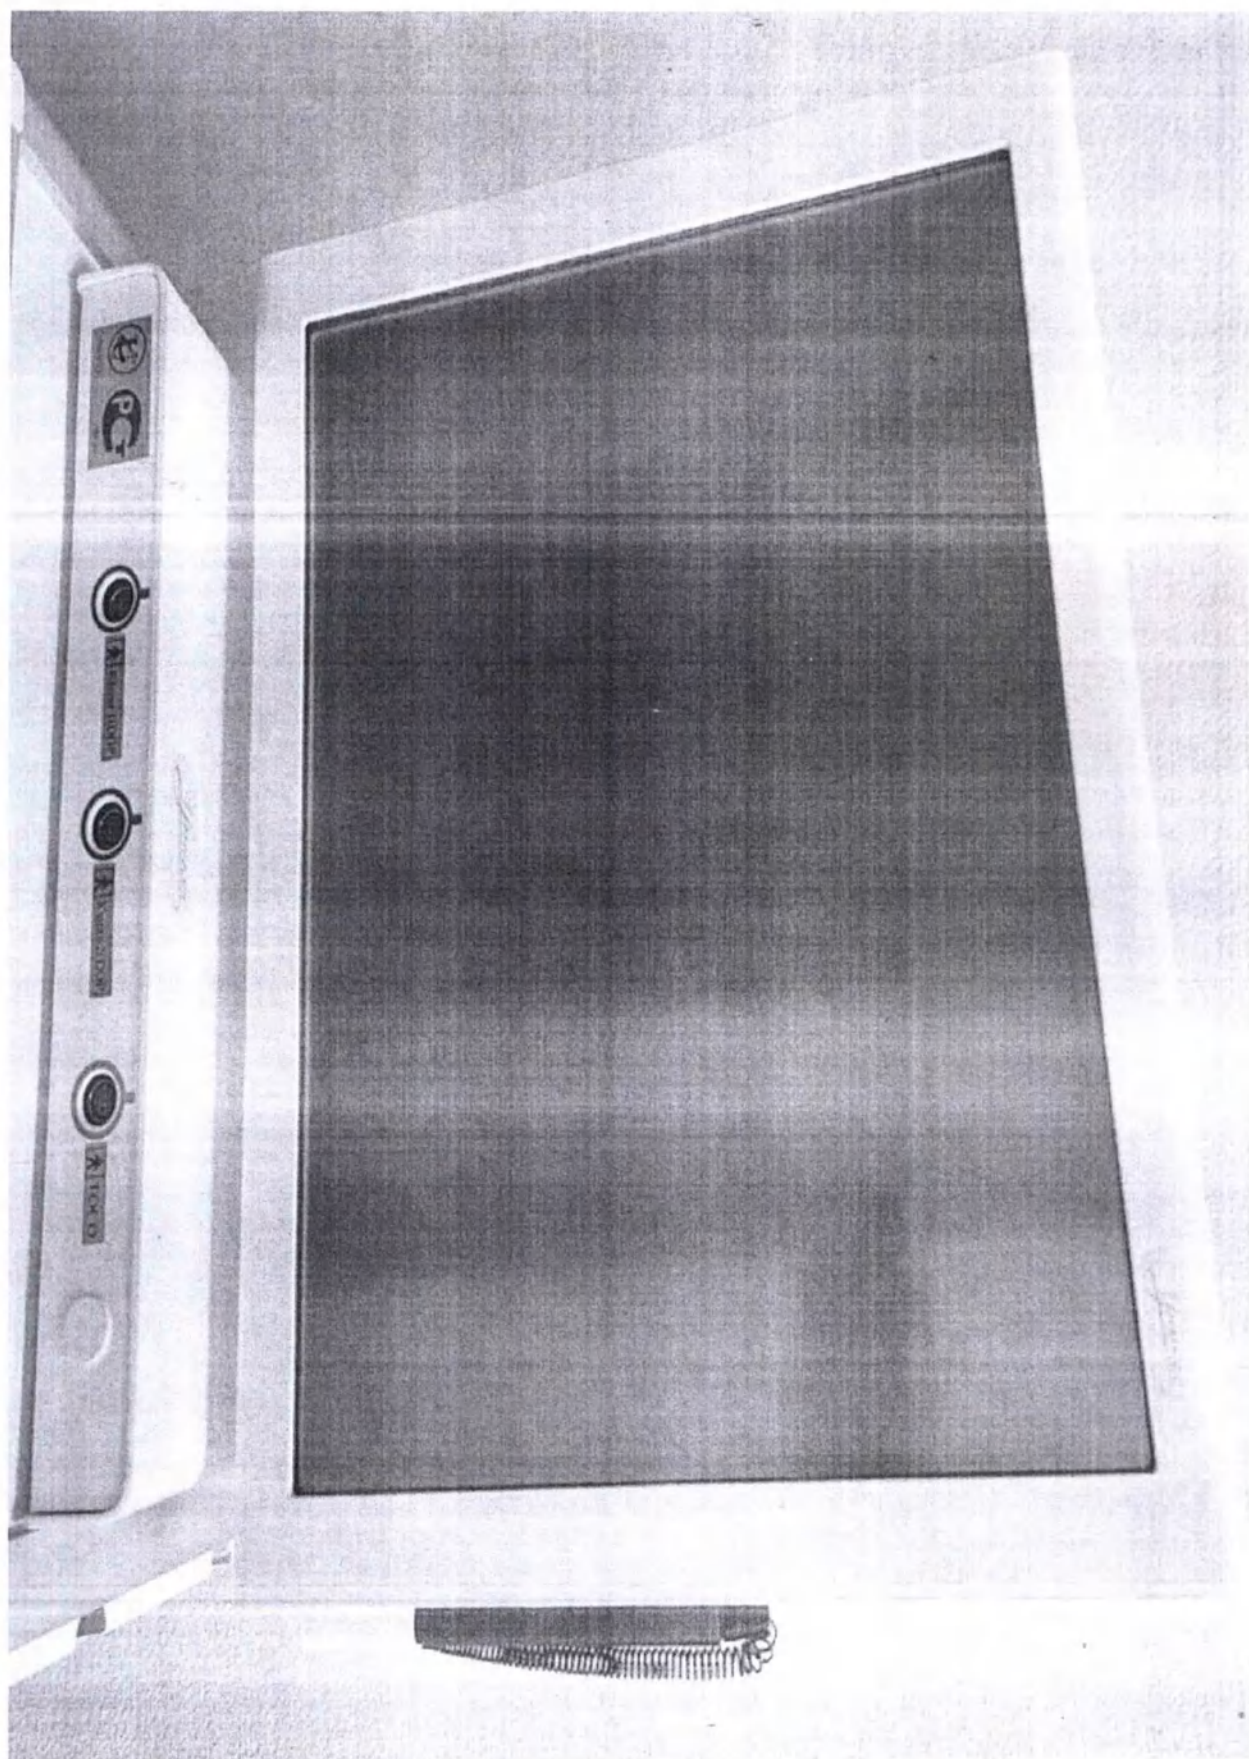

Вычислительный модуль обработки и отображения данных медицинского исследования (компьютер типа «ноутбук»)
Системный ультразвуковой доплеровский модуль (медицинский блок)

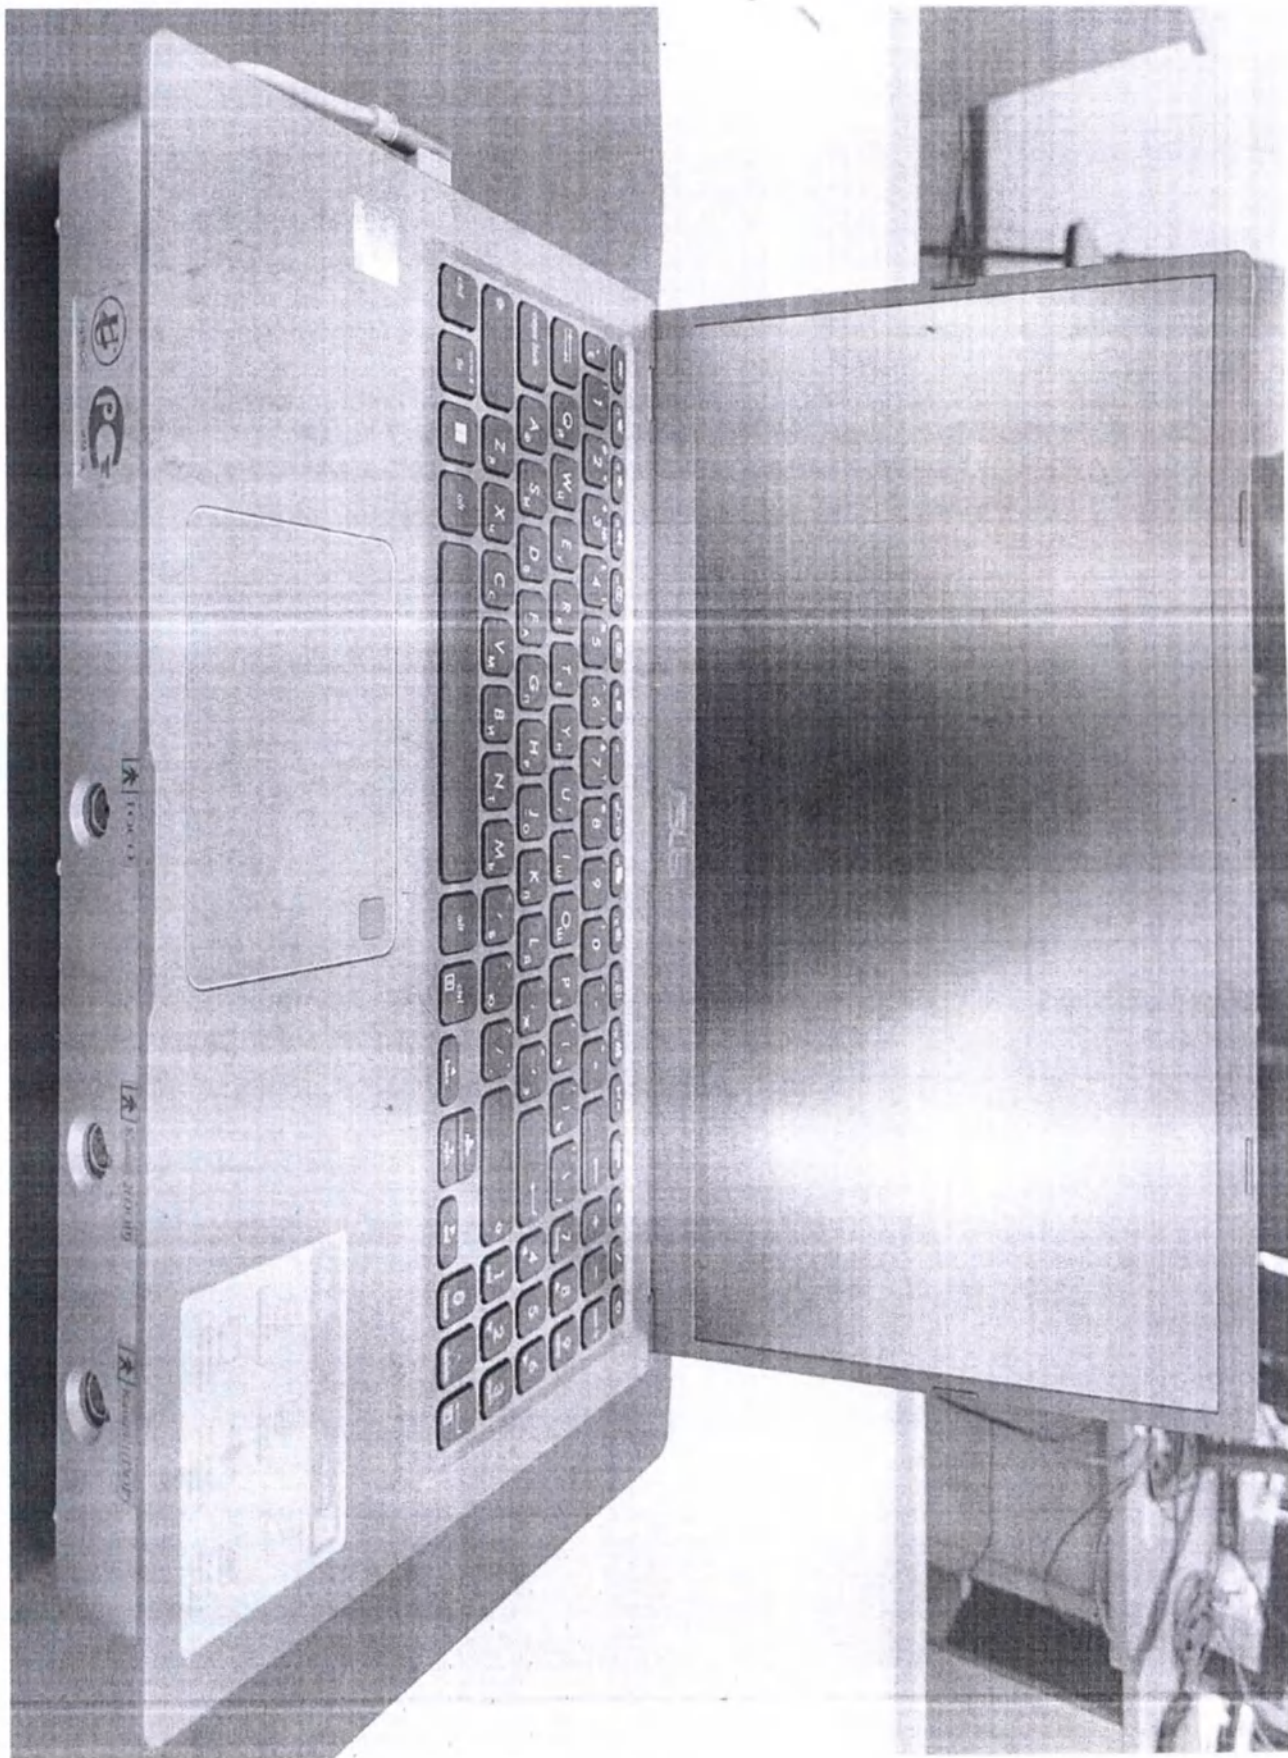

Датчик ультразвуковой доплеровский DOP

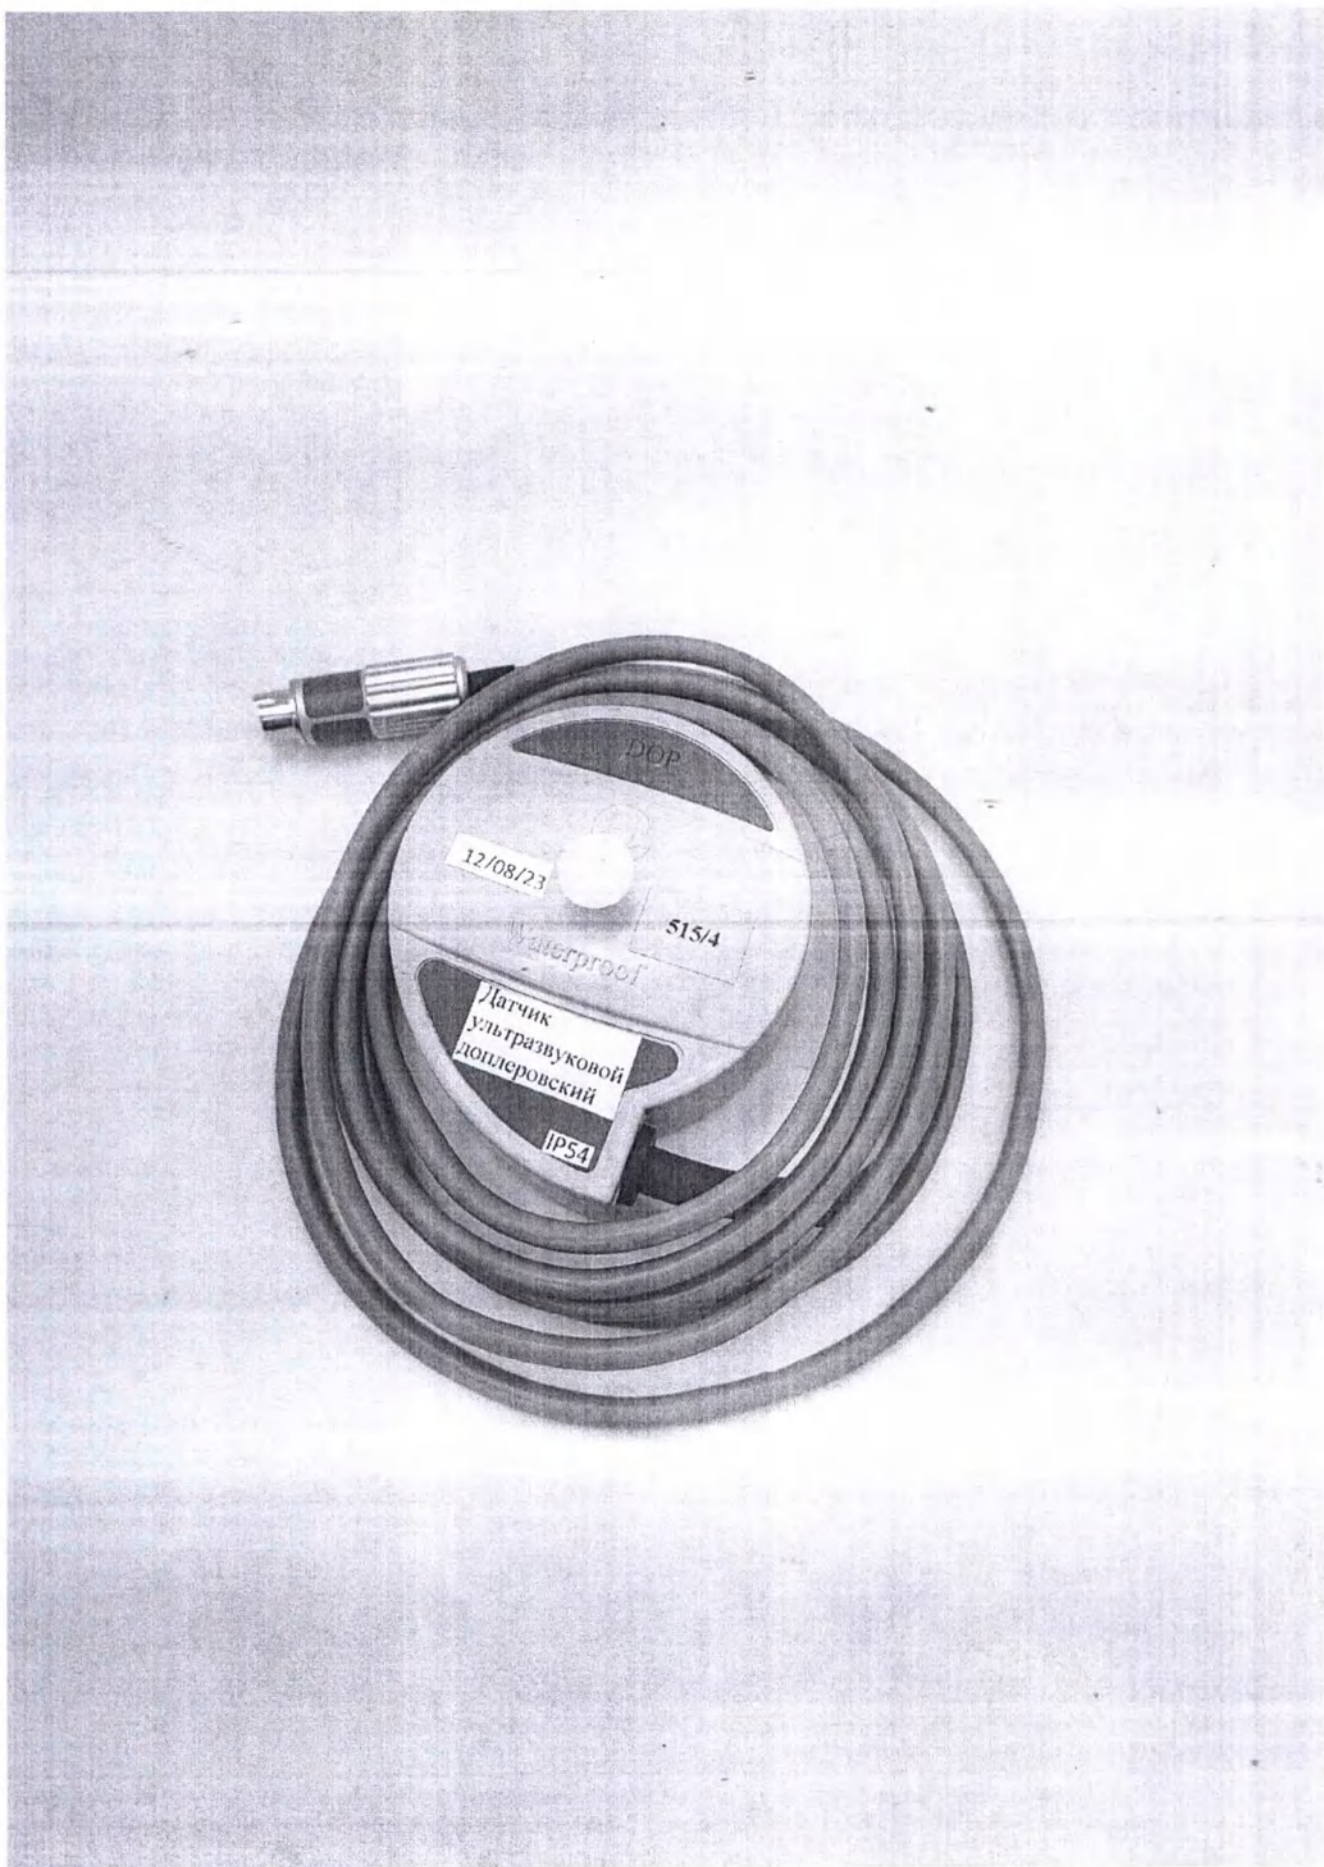


Датчик маточных сокращений ТОСО




Пояс фиксации датчика тканевый




Блок питания сетевой вариантов исполнения
Фетальный монитор «Уникос-01» панельный одноканальный
Фетальный монитор «Уникос-01» панельный двухканальный
Фетальный монитор «Уникос-02» панельный
Фетальный монитор «Уникос-03» панельный

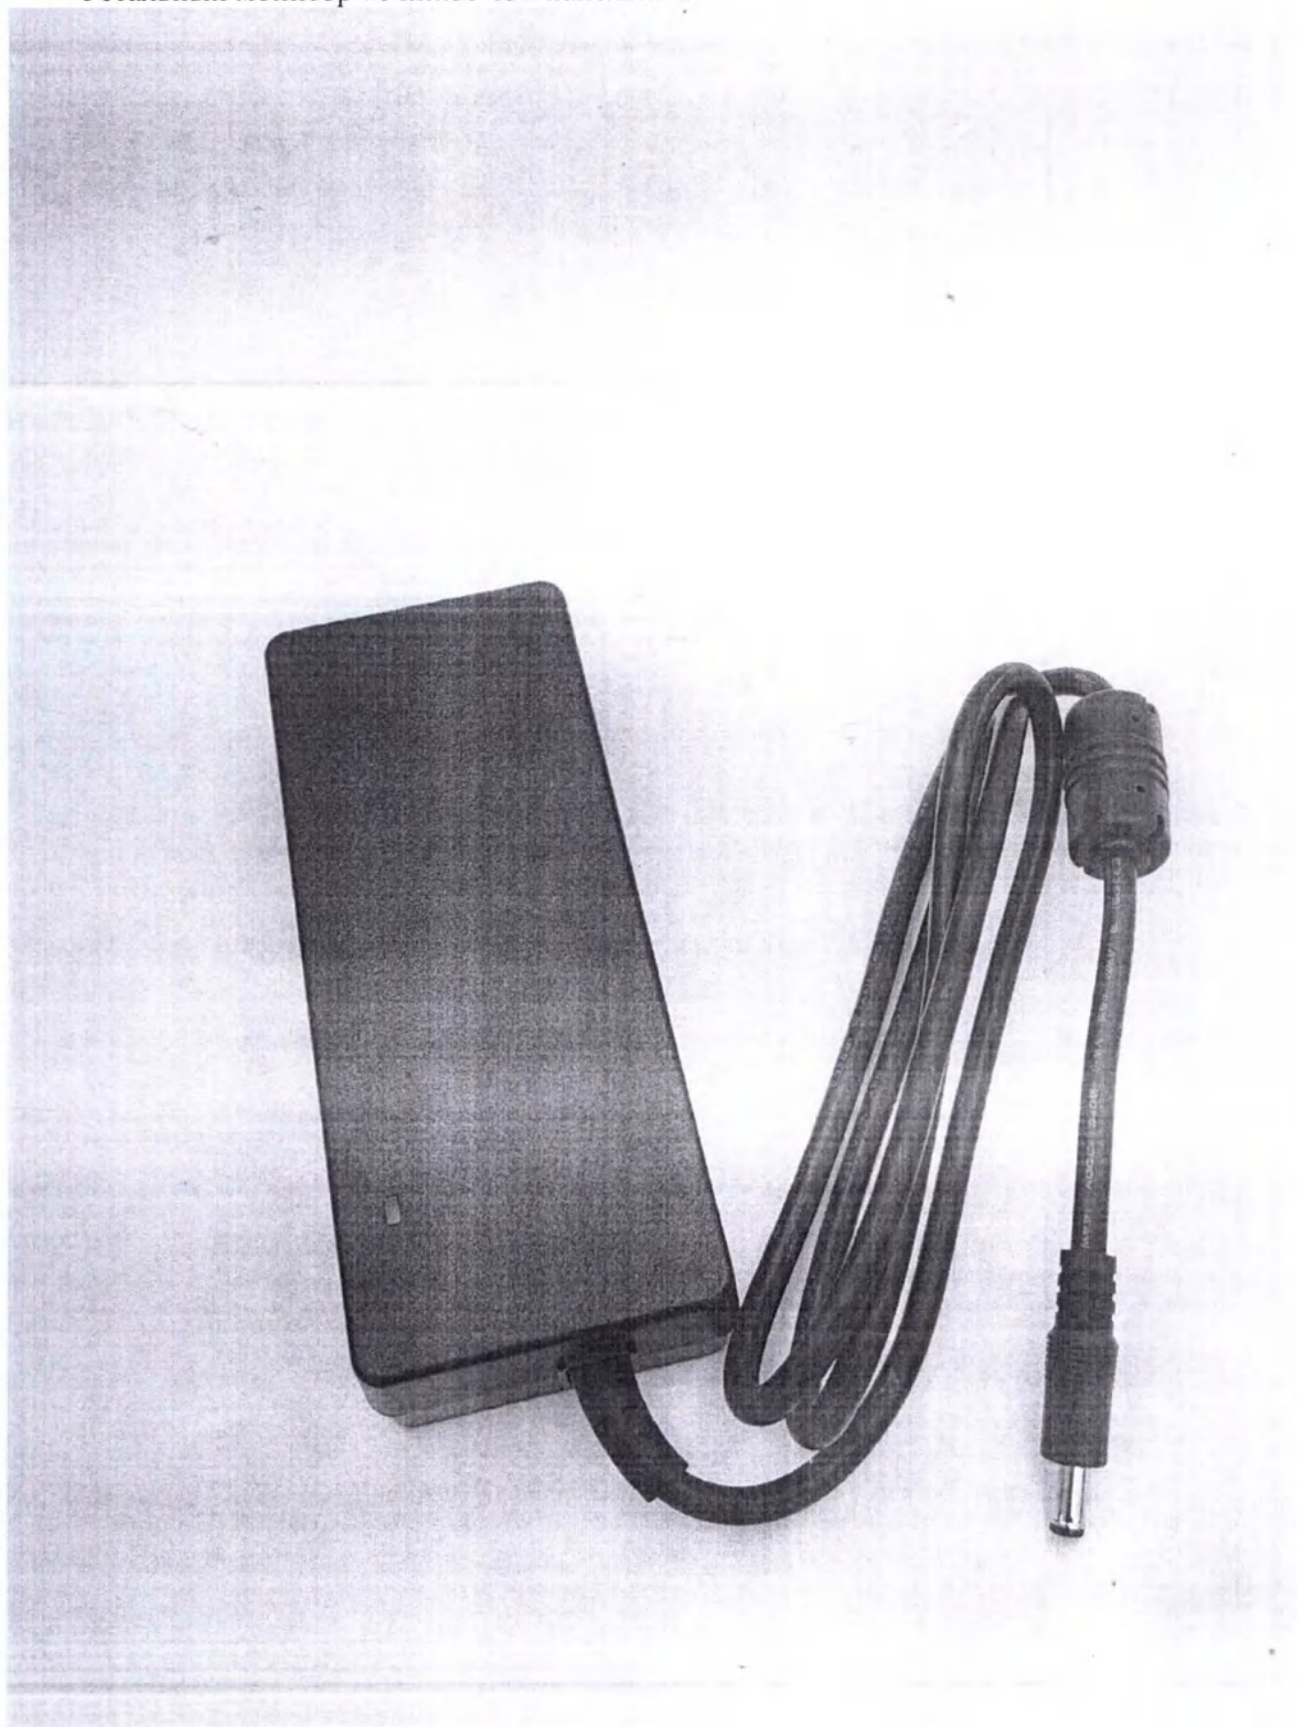


Блок питания сетевой вариантов исполнения Фетальный монитор «Уникос-01» ноутбук
одноканальный
Фетальный монитор «Уникос-01» ноутбук двухканальный
Фетальный монитор «Уникос-02» ноутбук
Фетальный монитор «Уникос-03» ноутбук

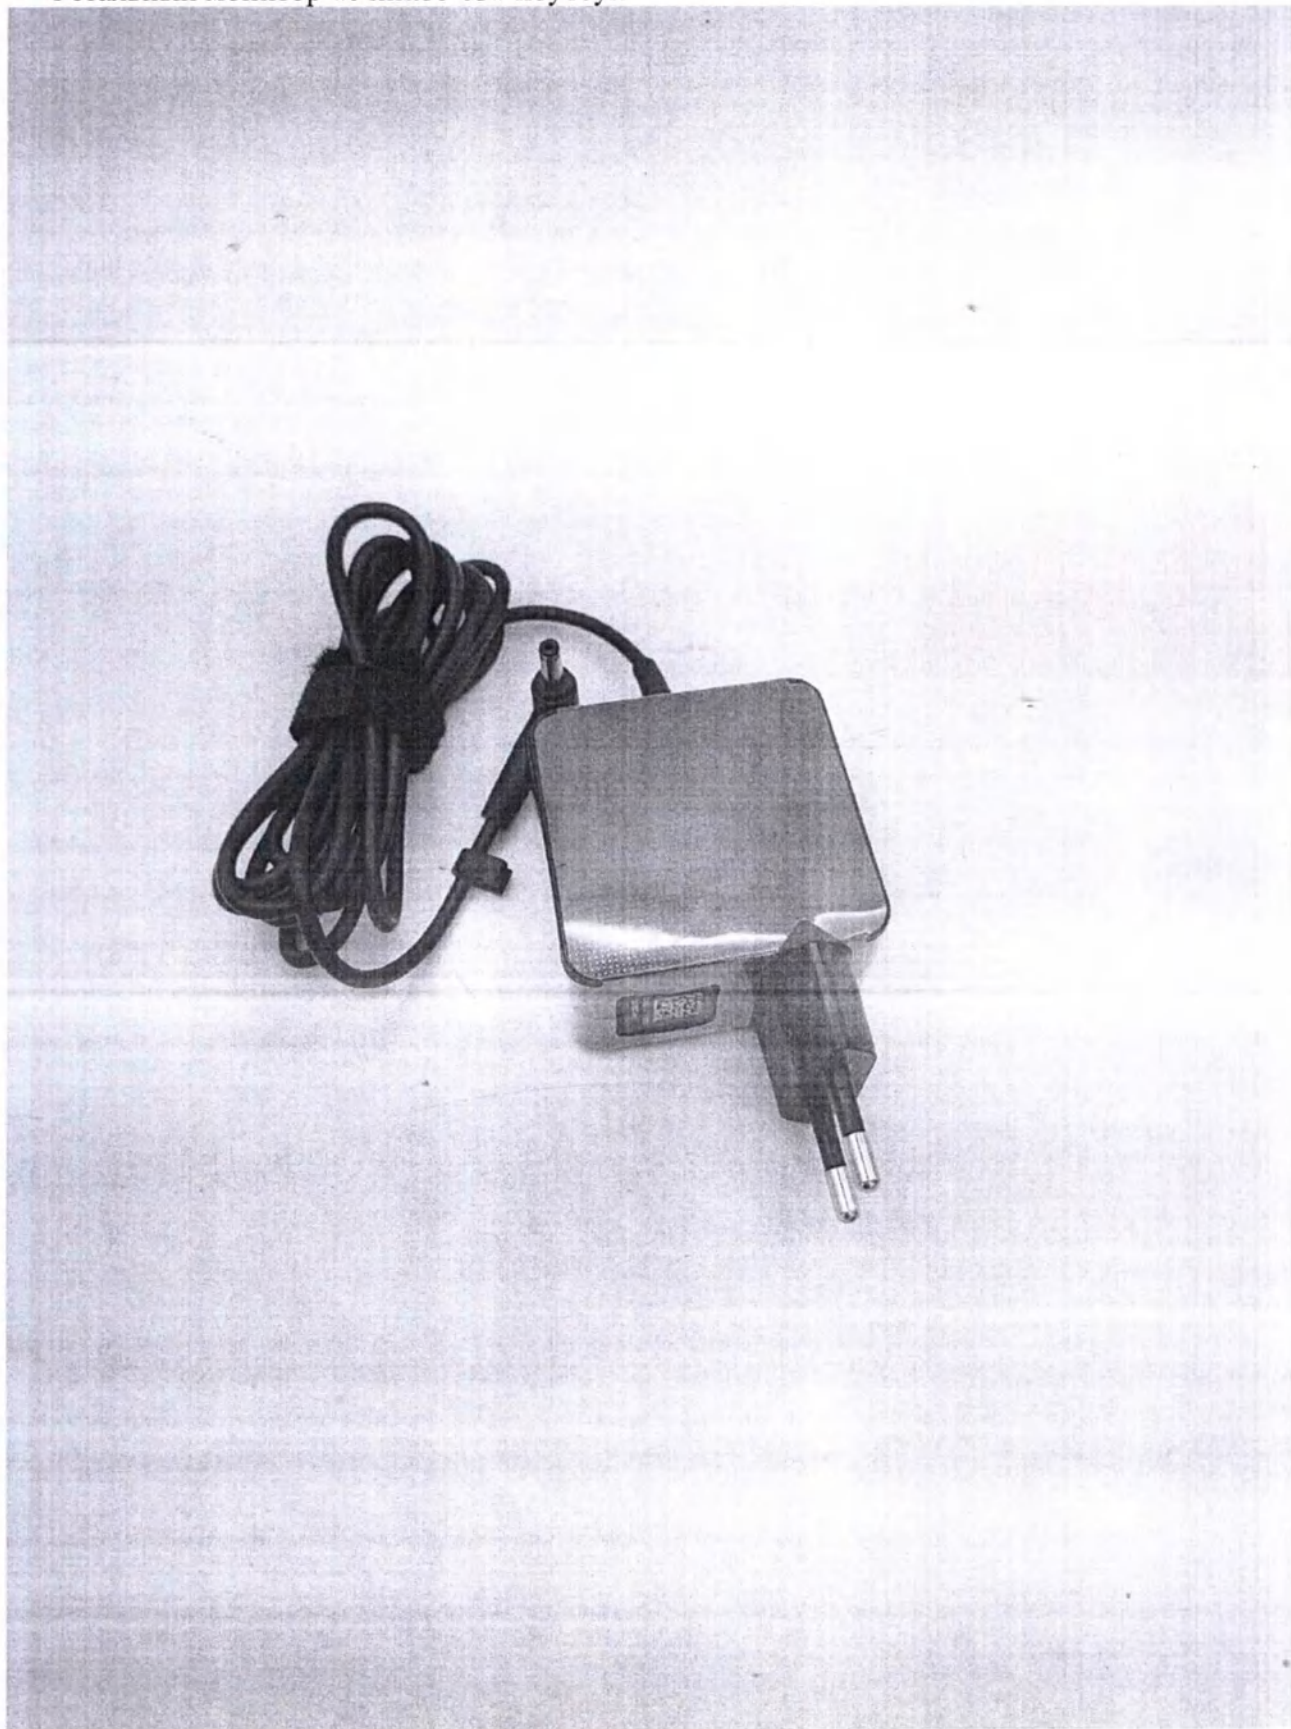

Шнур сетевой «GreenConnection» GA-CL12GP8-2 (только вариантов исполнения
Фетальный монитор «Уникос-01» панельный одноканальный
Фетальный монитор «Уникос-01» панельный двухканальный
Фетальный монитор «Уникос-02» панельный
Фетальный монитор «Уникос-03» панельный)

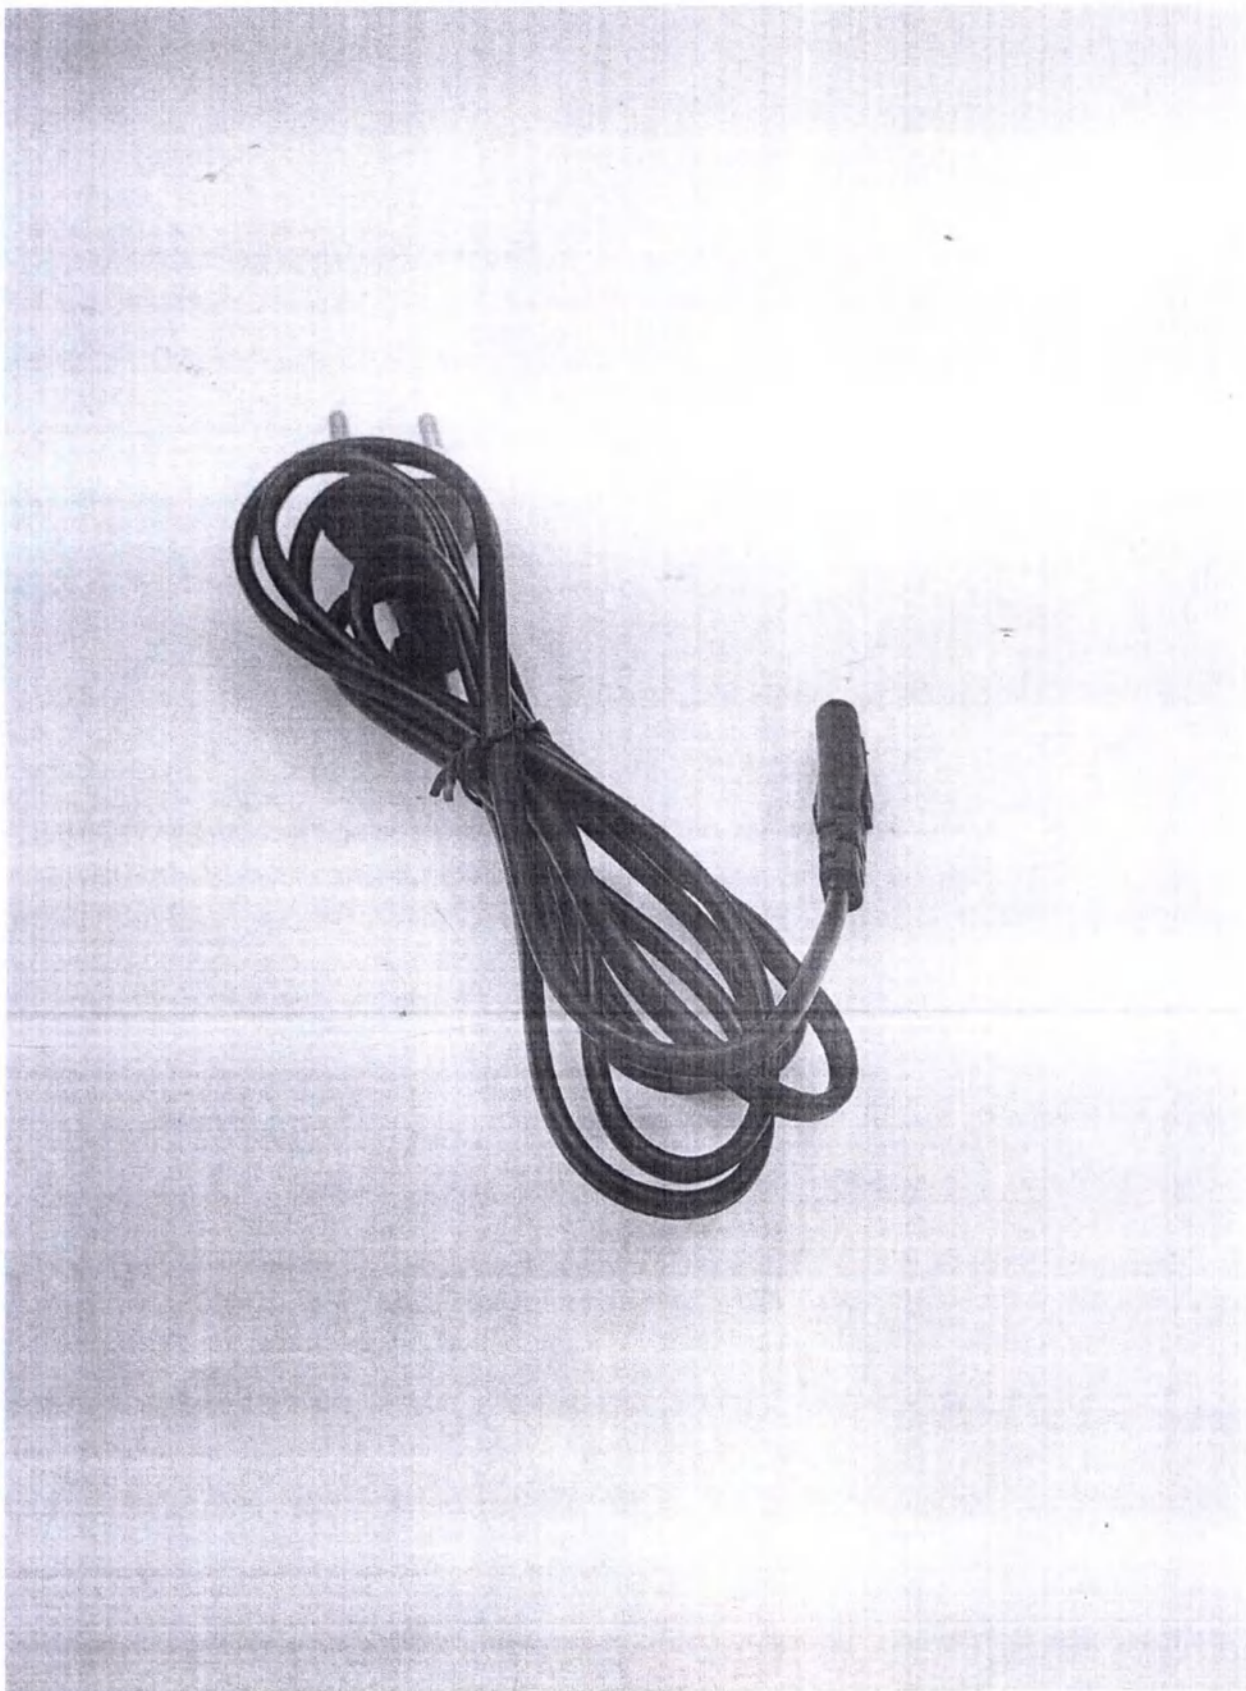


Программное обеспечение Fetal – 1 шт.;

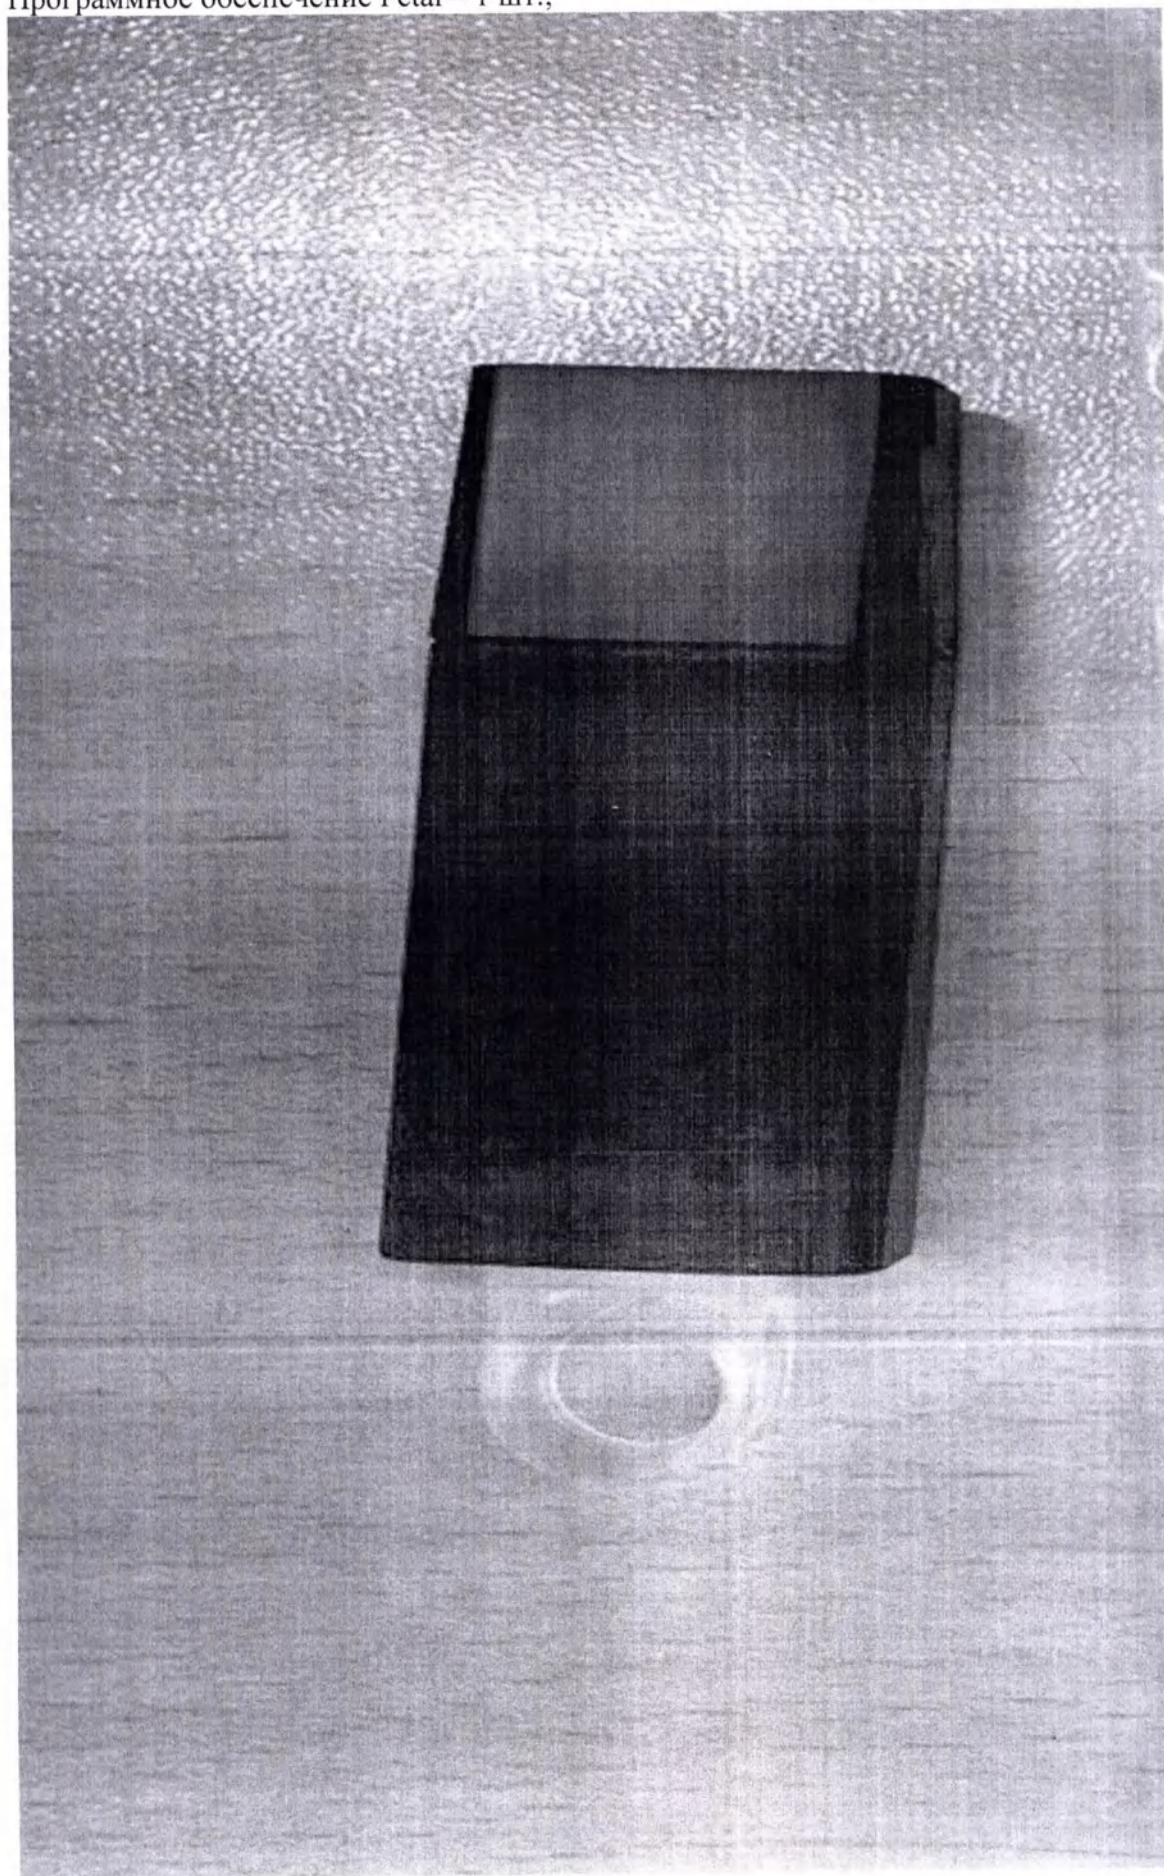

Печатающее устройство (принтер) Pantum P2518 производства Джухай Пантум
Электроникс Ко., Лтд КНР – 1 шт. (при необходимости).



Специализированная тележка AR-H24 производства ОДО «Аркодор», республика Беларусь – 1 шт. (при необходимости).

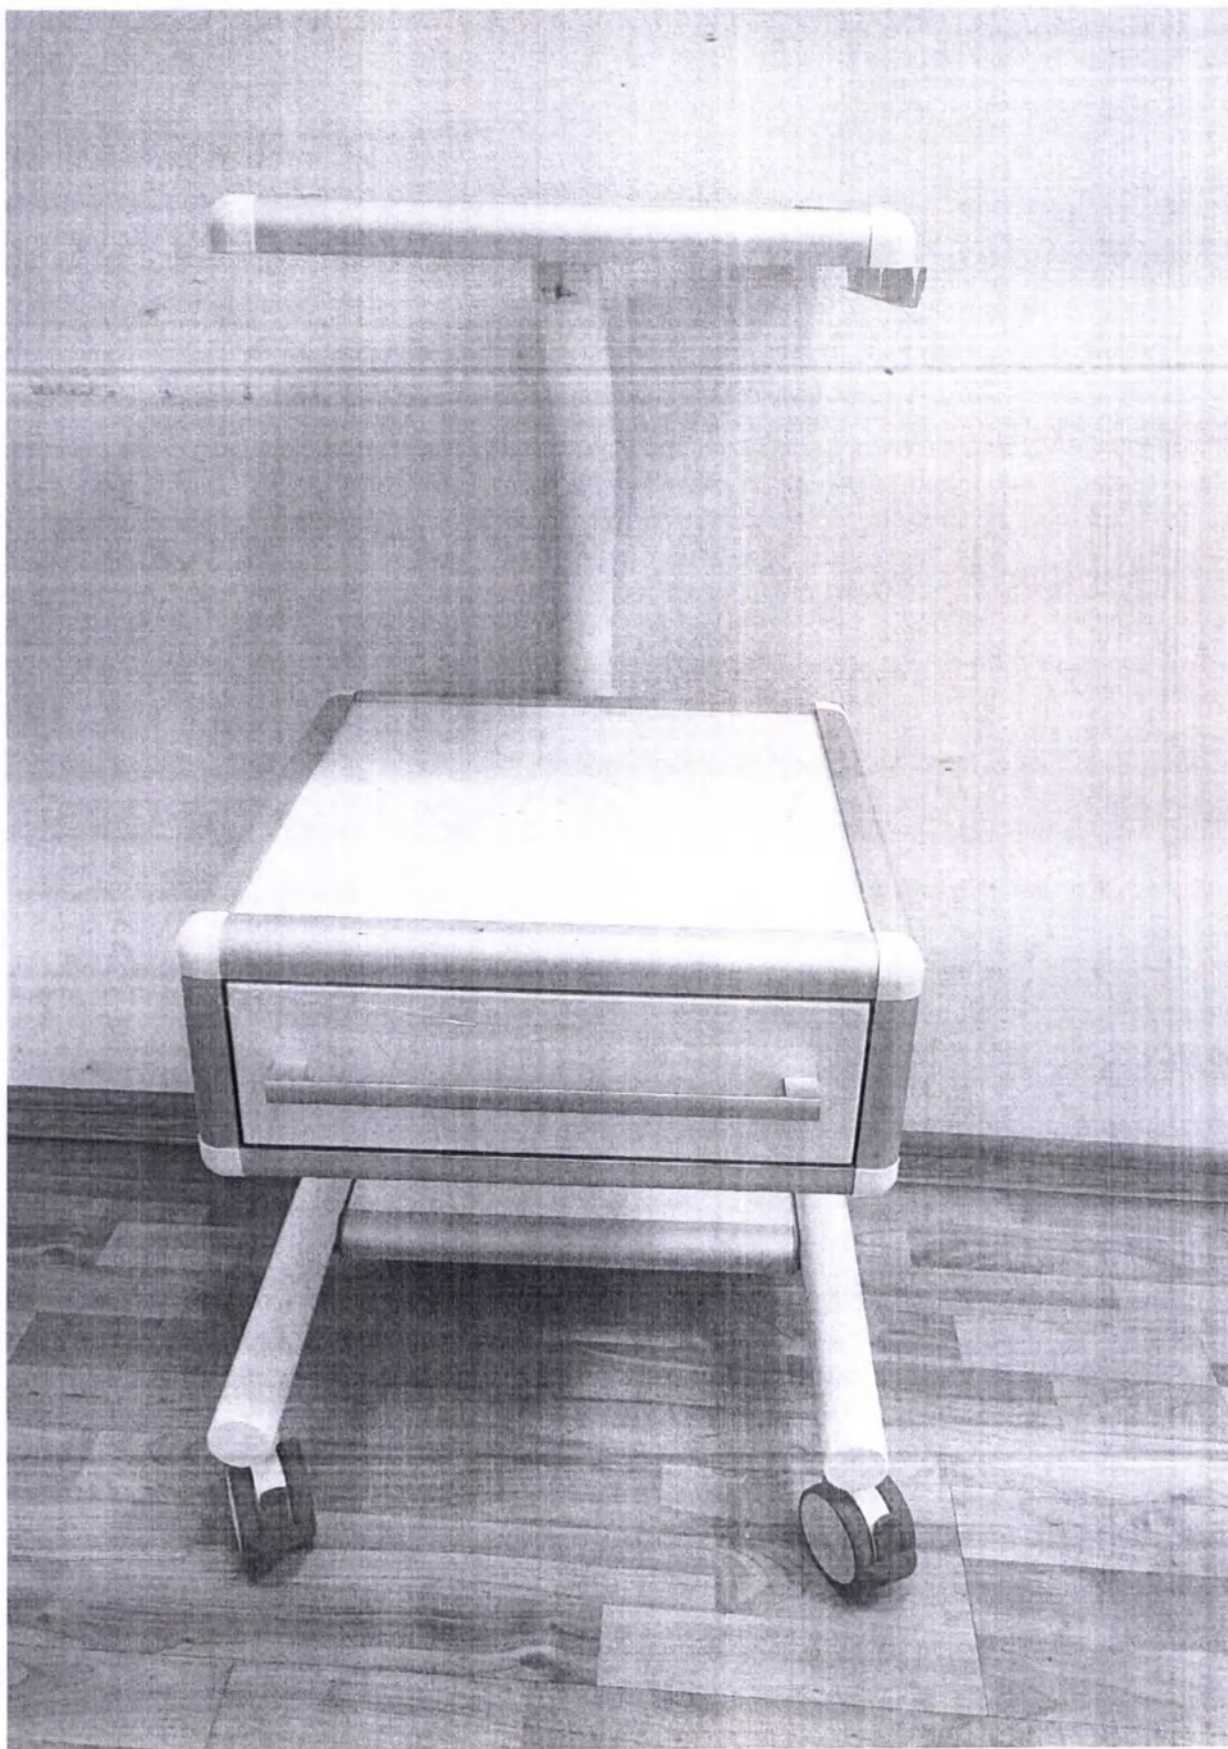


Гель для ультразвуковых исследований и терапии «Медиагель» по ТУ 9398-023-76063983-2015, вариант исполнения: гель для ультразвуковых исследований и терапии «Медиагель» высокой вязкости бесцветный, массой 0,25 кг, производства ООО «Гельтек-Медика», Россия (РУ № РЗН 2016/3706).- 1 шт.(при необходимости).



Макет маркировки медицинского изделия на примере Фетального монитора «Уникос-03»
ноутбук

	Общество с ограниченной ответственностью РПТ УНИКОС (ООО «РПТ УНИКОС») 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, пом.Т, ком. 22, эт. 2	
Фетальный монитор: автоматизированный кардиотокограф «Уникос-03» ноутбук ТУ 9442-003-52696471-2006		 
SN XXXX XXXX		IP20
	XXXXXX г.	== 19 5 60 5-

Макет маркировки медицинского изделия на примере Фетального монитора «Уникос-03»
панельный

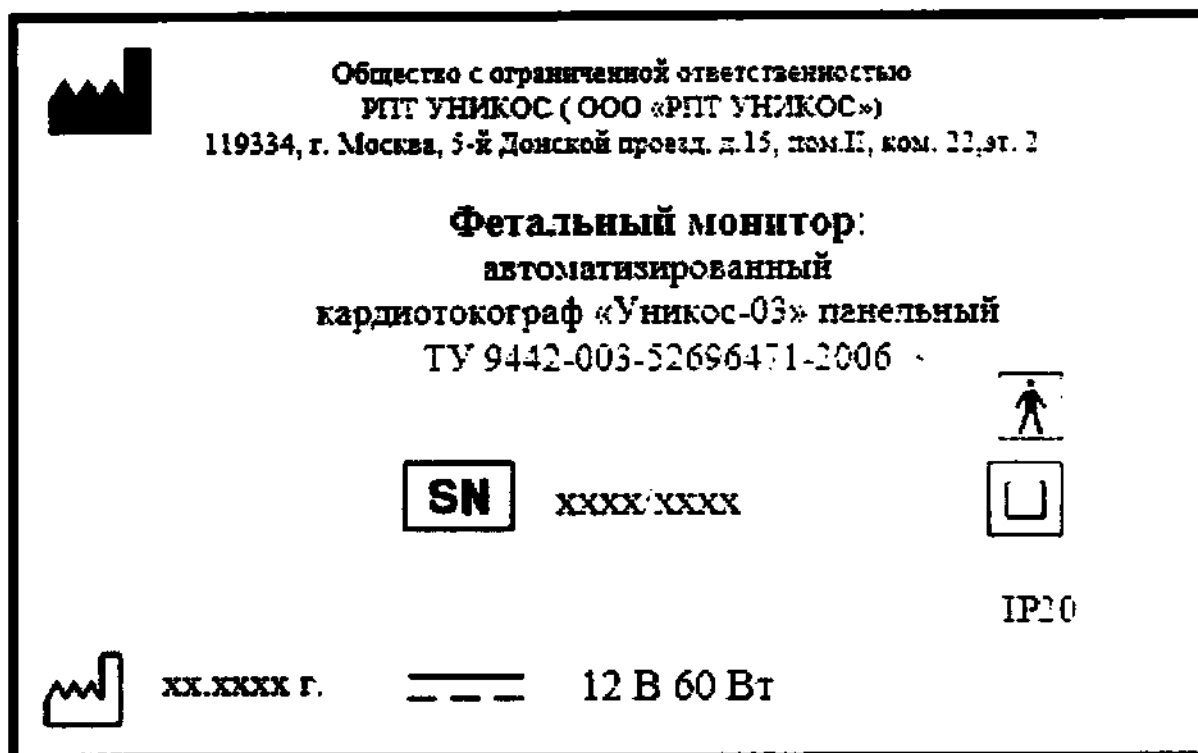

Макет маркировки транспортной упаковки на примере Фетального монитора «Уникос-03» ноутбук

Фетальный монитор: автоматизированный кардиотокограф по ТУ 9442-003-52696471-2006 в следующих исполнениях: «Уникос-01»; «Уникос-02»; «Уникос-03»

Фетальный монитор «Уникос-03» ноутбук:

- Вычислительный модуль обработки и отображения данных медицинского исследования (компьютер типа «ноутбук») – 1 шт.;
- Системный ультразвуковой доплеровский модуль (медицинский блок) – 1 шт.;
- Датчик ультразвуковой доплеровский DOP – 5 шт.;
- Датчик маточных сокращений ТОСО – 5 шт.;
- Пояс фиксации датчика тканевый – 10 шт.;
- Блок питания сетевой – 1 шт.;
- Программное обеспечение Fetal – 1 шт.;
- Печатающее устройство (принтер) Pantum P2518 производства Джухай Пантум Электроникс Ко., Лтд. КНР – 1 шт.;
- Гель для ультразвуковых исследований и терапии «Медиагель» по ТУ 9398-023-76063983-2015, вариант исполнения: гель для ультразвуковых исследований и терапии «Медиагель» высокой вязкости бесцветный, массой 0,25 кг. производства ООО «Гельтек-Медика», Россия (ПУ № РЗН 2016/3706).- 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.



ООО «РПТ УНИКОС», Россия

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, пом.11, ком. 22, эт. 2



xx.xxxx



XXXXX/XXXXX

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11471 от xx.xx.xxxx г.

Макет маркировки транспортной упаковки специализированной тележки AR-H24 производства ОДО «Аркодор», республика Беларусь на примере Фетального монитора «Уникос-03» ноутбук

Фетальный монитор: автоматизированный кардиотокограф по ТУ 9442-003-52696471-2006 в следующих исполнениях: «Уникос-01»; «Уникос-02»; «Уникос-03»


Фетальный монитор «Уникос-03» ноутбук:

- Специализированная тележка AR-H24 производства ОДО «Аркодор», республика Беларусь – 1 шт.




Регистрационное удостоверение № ФСР 2011 11471 от XX.XX.XXXX г.

Макет маркировки упаковки датчика ультразвукового доплеровского DOP

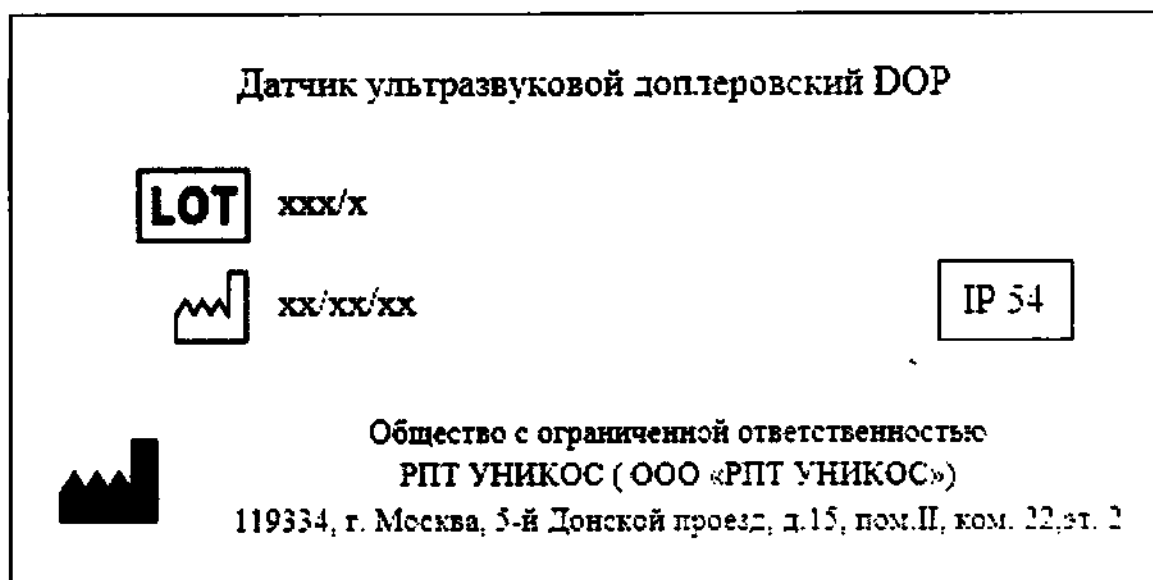

Макет маркировки упаковки датчика маточных сокращений ТОСО

Датчик маточных сокращений ТОСО	
Серийный номер монитора	xx/xxxx
	xx/xx/xx
	Общество с ограниченной ответственностью РПТ УНИКОС (ООО «РПТ УНИКОС») 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, пом.II, ком. 22, эт. 2
IP 54	

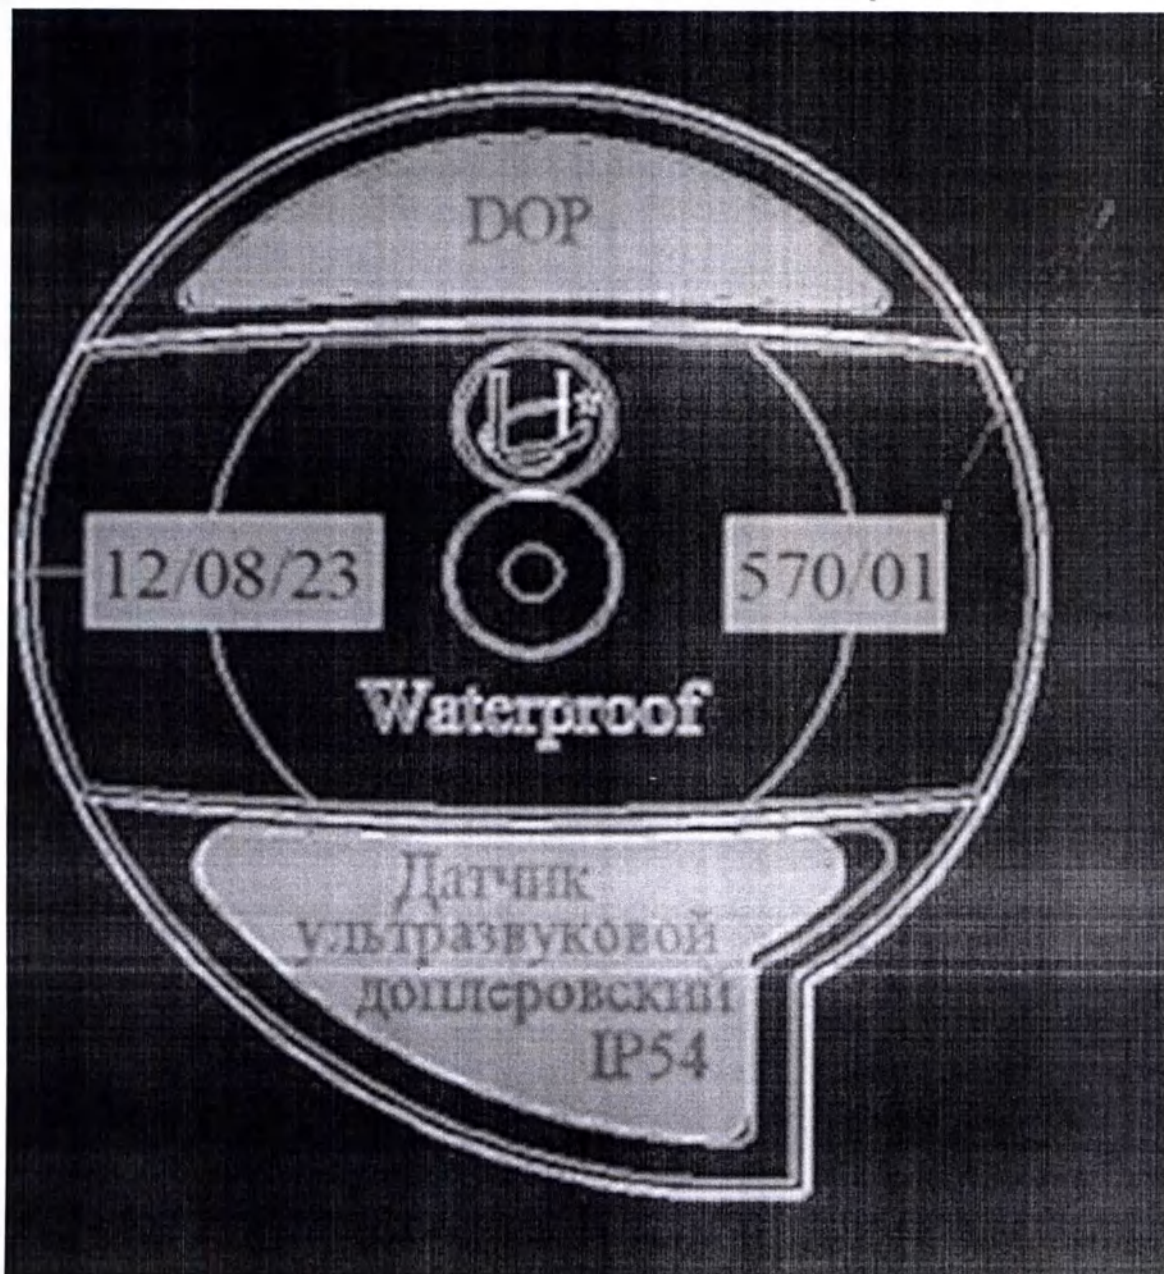




Маркировка блока питания сетевого

Пример маркировки блока питания с компьютером типа «ноутбук»



Пример маркировки блока питания с компьютером типа «панельный»

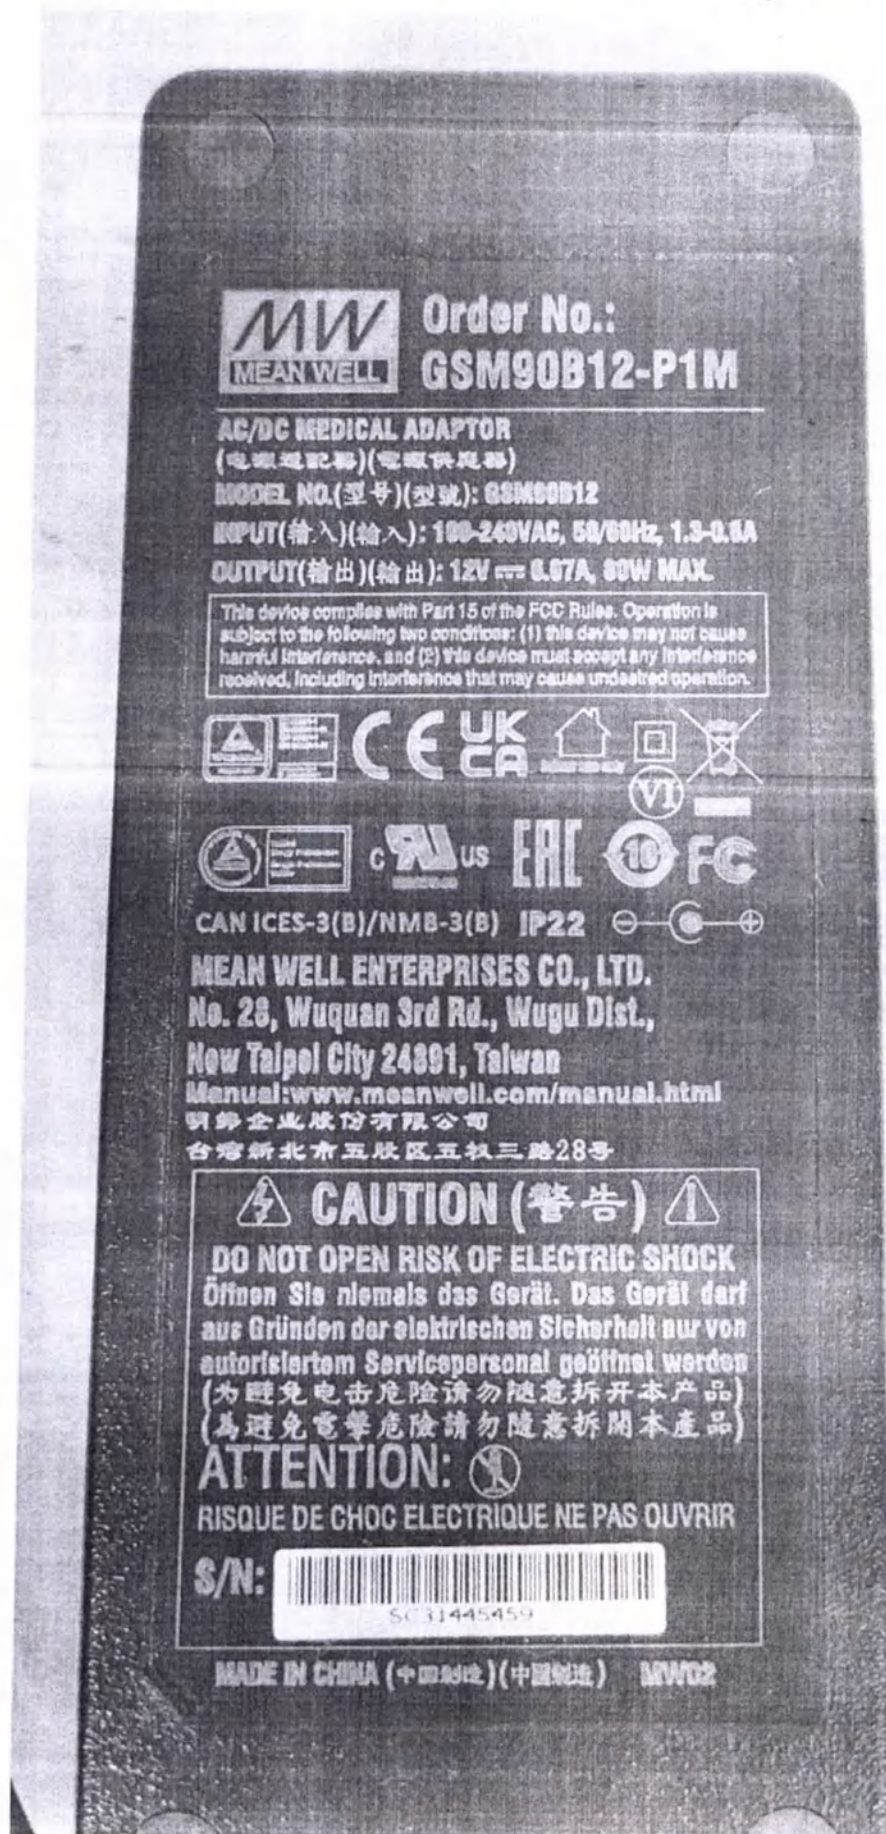

Макет маркировки специализированной тележки AR-H24 производства ОДО «Аркодор», республика Беларусь.

	Общество с дополнительной ответственностью АРКОДОР (ОДО «АРКОДОР»).	
	220004, Республика Беларусь, Минск, ул. К.Цеткин, д. 18, к.3, ком. 38	
	Специализированная тележка	
	AR-H24	
	SN	XXXX XXX IP20
	XX.XXXX г.	~ 220-240 В 50 60 Гц макс 10А
	Масса: 25 кг	
	Безопасная рабочая нагрузка: 17,5 кг	

