

«УТВЕРЖДАЮ»

Представитель по доверенности № 23-20 от 24.06.2023 г.

ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»



Маполис А.П.

«21» декабря 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Имплантат интрадермальный AquaLuna с гиалуронатом натрия 20 мг/мл и лидокаином 3 мг/мл для контурной пластики, варианты исполнения: AquaLuna Light, AquaLuna 3, AquaLuna 5»

Bloomage Biotechnology Co., Ltd., China
Блюмейдж Биотехнолоджи Ко., Лтд., Китай

Рисунок 1 – Лицевая сторона пачки из картона Aqualuna Light

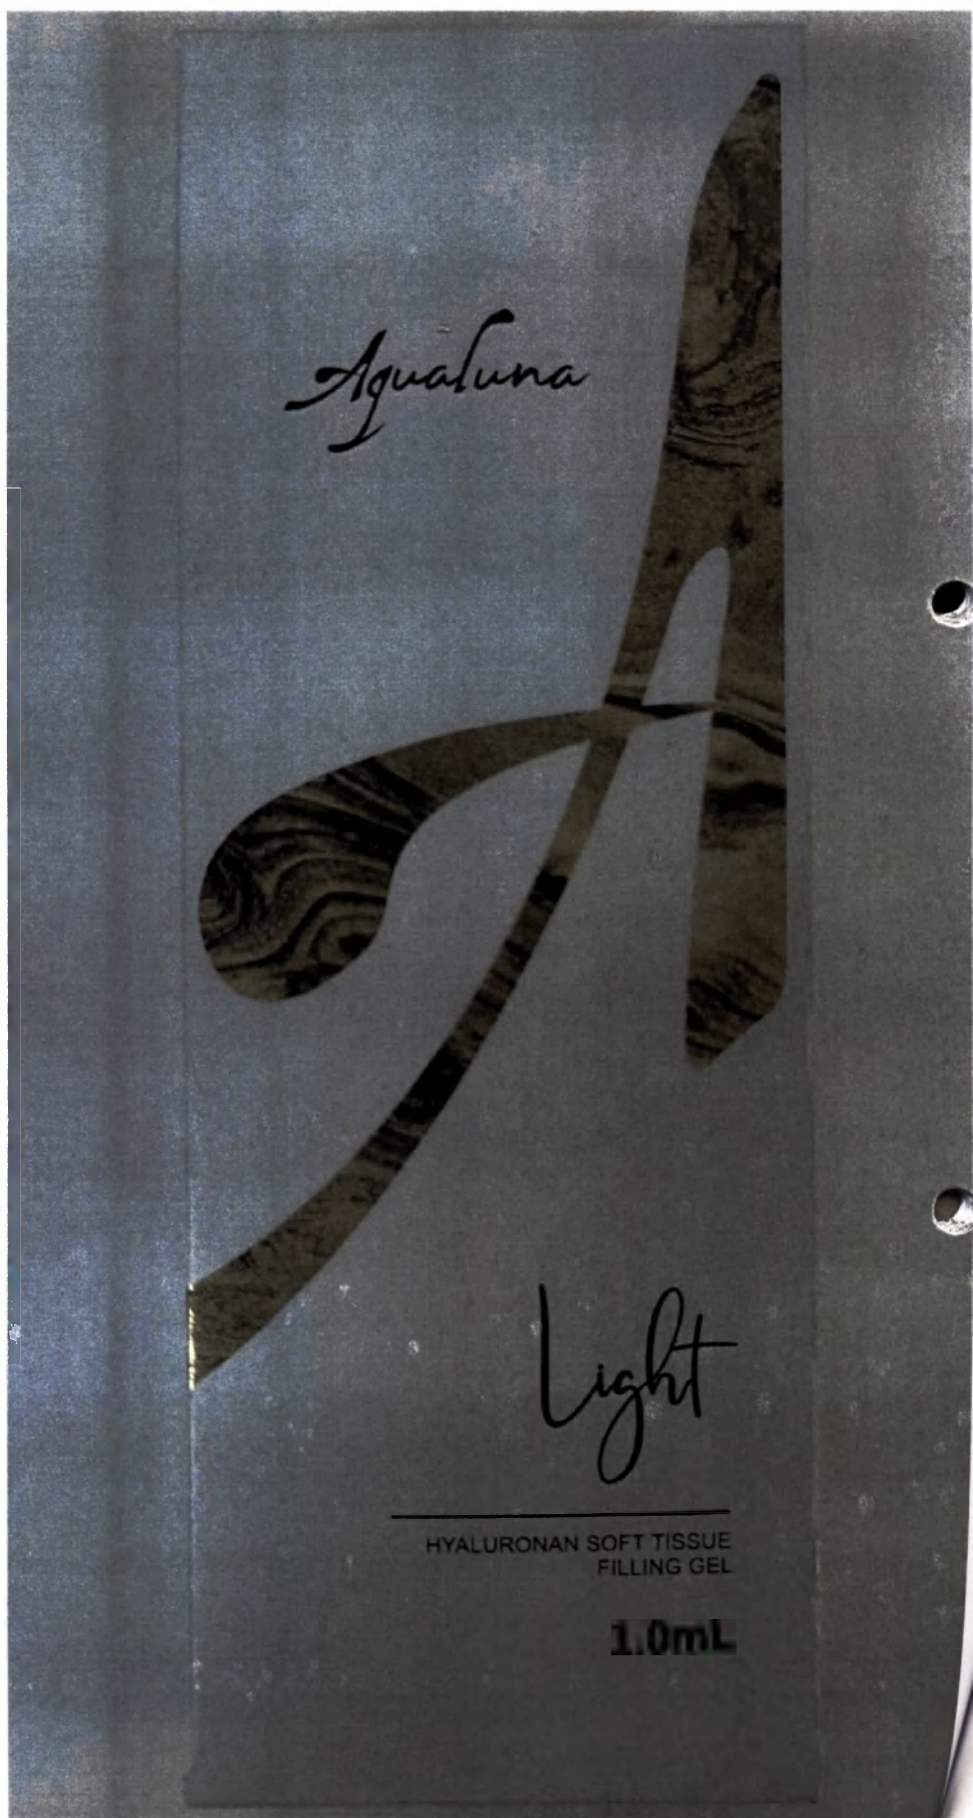




Рисунок 2 – Лицевая сторона пачки из картона AquaLuna 3


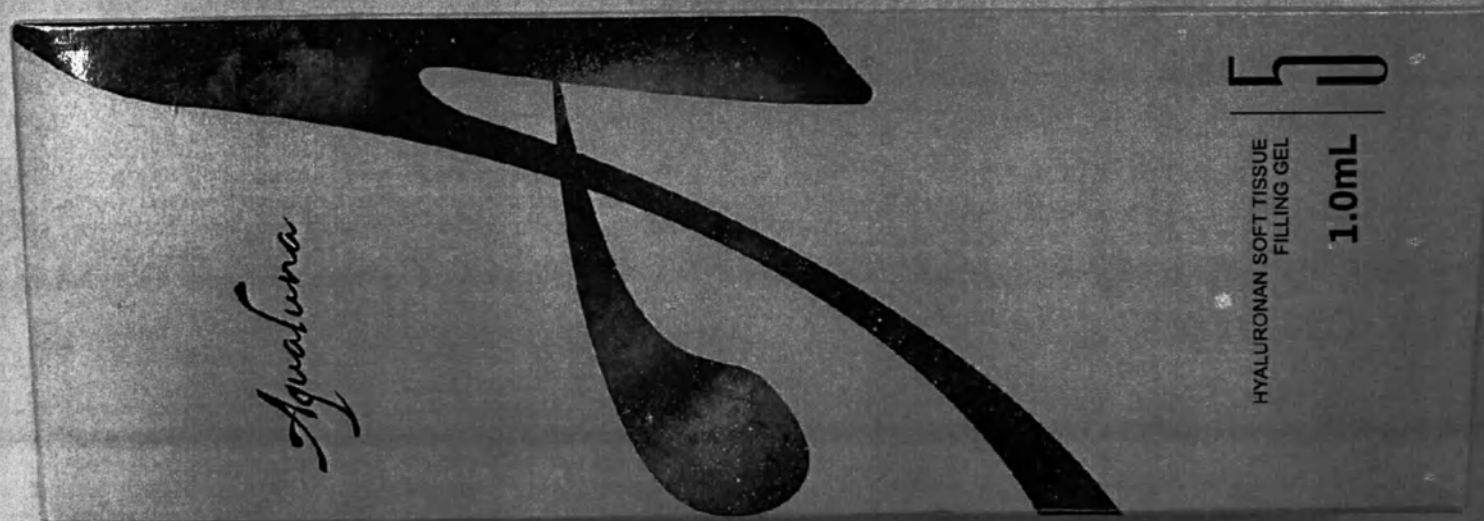


Рисунок 3 – Лицевая сторона пачки из картона AquaLuna 5

Имплантат интрадермальный AquaLuna Light с гиалуронатом натрия 20 мг/мл и лидокаином 3 мг/мл для контурной пластики, 1 мл
Изделие предназначено для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для коррекции средних и глубоких мимических морщин и складок. 1 упаковка содержит 1 шприц 1 мл, 2 иглы 30G x 1/2", 2 наклейки с информацией об имплантате, инструкцию по применению.
Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.
Стерильно. Не токсично. Срок годности: 36 месяцев.
Условия хранения: хранить при температуре от 2°C до 25°C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Хранить в недоступном для детей месте.
Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия:
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв.5.
Тел.: +7 (495) 414-43-00, E-mail: info@developconsult.ru.
Регистрационное удостоверение: №XXXX от XX.XX.XXXX г.



Bloomage Biotechnology Co., Ltd.
No. 679 Tianchen St. High Tech Development Zone Jinan, 250101, P.R. China



6948060432642

Рисунок 4 – Обратная сторона пачки из картона AquaLuna Light

Имплантат интрадермальный AquaLuna 3 с гиалуронатом натрия 20 мг/мл и лидокаином 3 мг/мл для контурной пластики, 1 мл

Изделие предназначено для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для коррекции средних и глубоких мимических морщин и складок.

1 упаковка содержит 1 шприц 1 мл, 2 иглы 27G x 1/2", 2 наклейки с информацией об имплантате, инструкцию по применению.

Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично. Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: хранить при температуре от 2°C до 25°C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия:

ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв.5.





Тел.: +7 (495) 414-43-00, E-mail: info@developconsult.ru.

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.

Needles 2x27 Gx1/2"

STERILE

STERILE



Bloomage Biotechnology Co., Ltd.

No. 678 Tianchen St. High-Tech Development Zone Jhuai, 356101, P.R. China



BLOOMAGE
BIOTECH

6948060432833

Рисунок 5 – Обратная сторона пачки из картона AquaLuna 3

Имплантат интрадермальный AquaLuna 5 с гиалуронатом натрия 20 мг/мл и лидокаином 3 мг/мл для контурной пластики, 1 мл
Изделие предназначено для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для коррекции средних и глубоких мимических морщин и складок. 1 упаковка содержит 1 шприц 1 мл, 2 иглы 27G x 1/2", 2 наклейки с информацией об имплантате, инструкцию по применению.
Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.
Стерильно. Не токсично. Срок годности: 36 месяцев.
Условия хранения: хранить при температуре от 2°C до 25°C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Хранить в недоступном для детей месте.
Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия:
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв.5.
Тел.: +7 (495) 414-43-00, E-mail: info@developconsult.ru.
Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.

6948060432734

Рисунок 6 – Обратная сторона пачки из картона AquaLuna 5

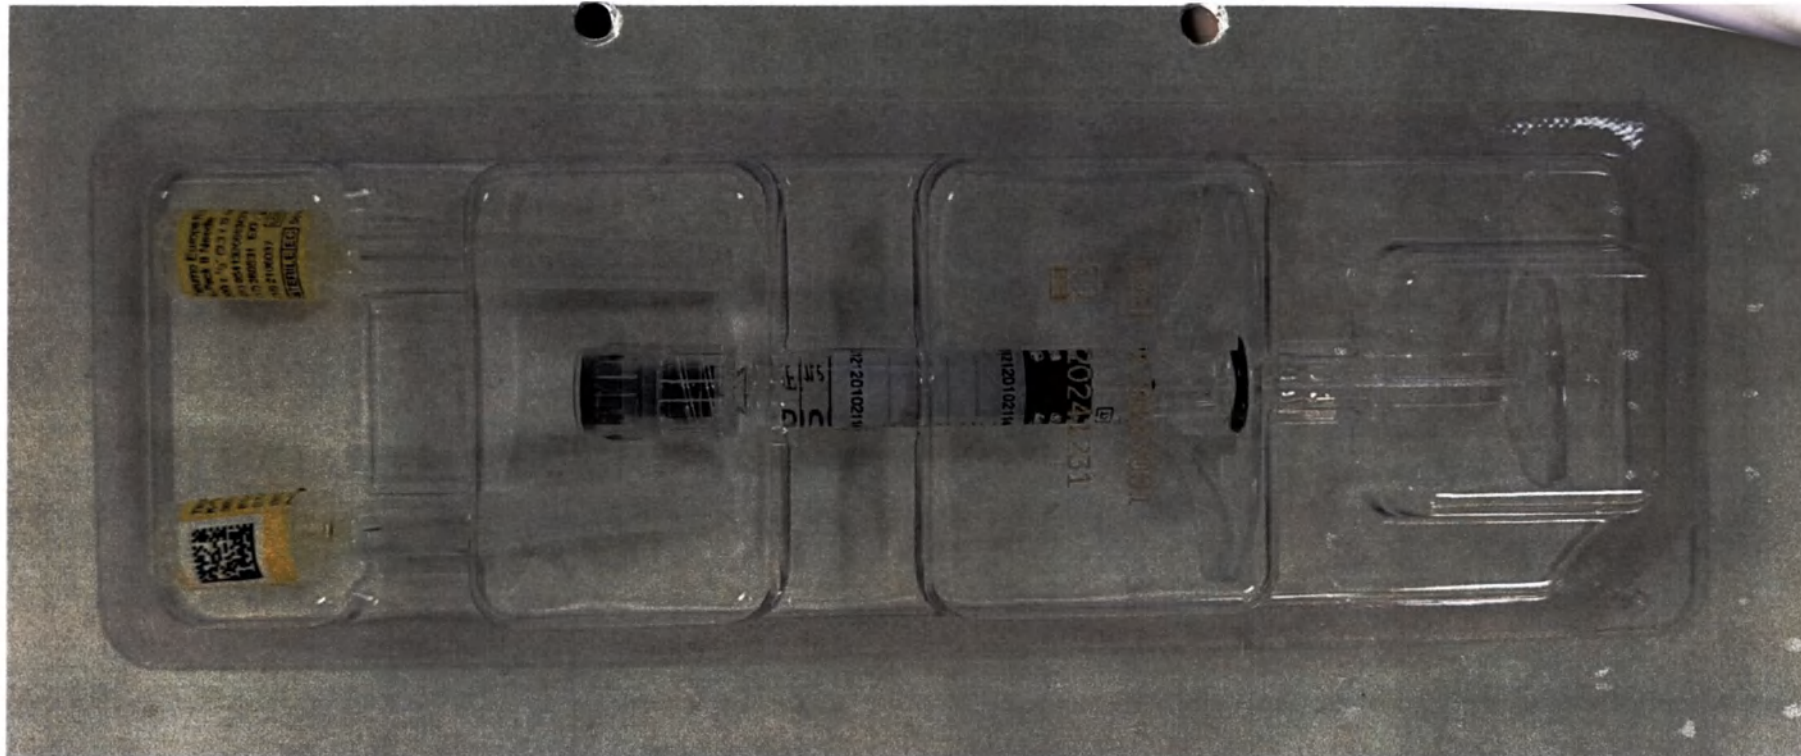


Рисунок 7 – Лицевая сторона блистера со шприцом AquaLuna Light



Рисунок 8 – Лицевая сторона блистера со шприцом AquaLuna 3



Рисунок 9 – Лицевая сторона блистера со шприцом AquaLuna 5

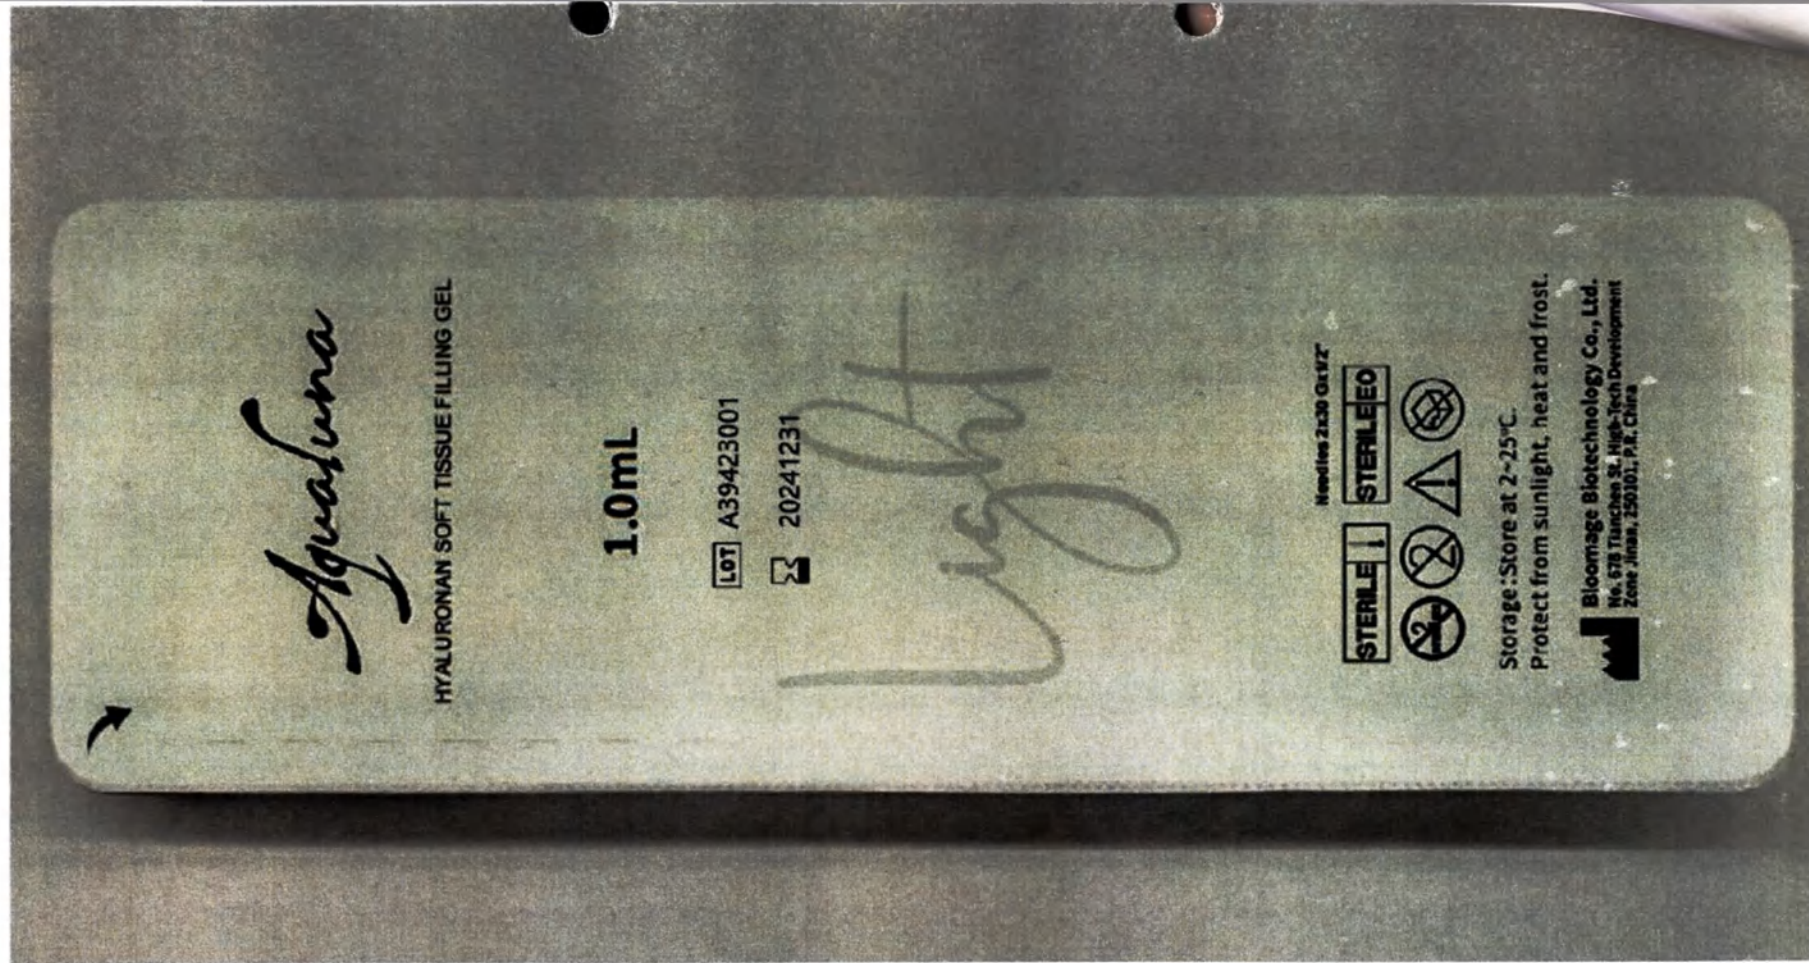


Рисунок 10 — Обратная сторона блистера со шприцом AquaLuna Light

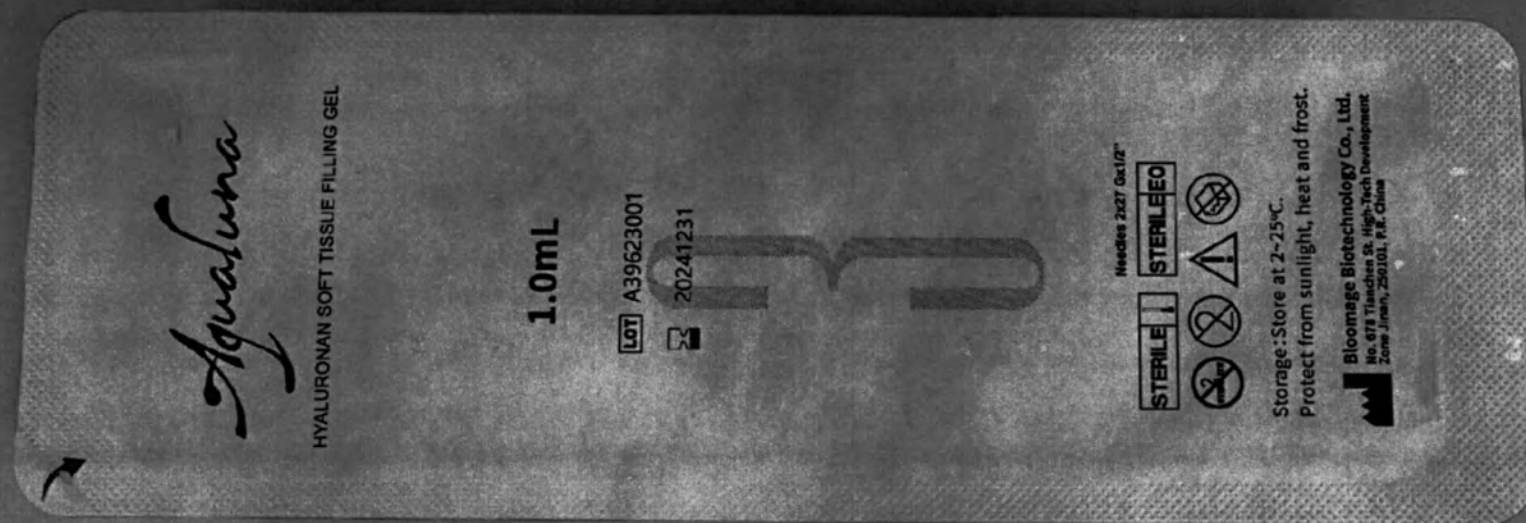


Рисунок 11 — Обратная сторона блистера со шприцом AquaLuna 3

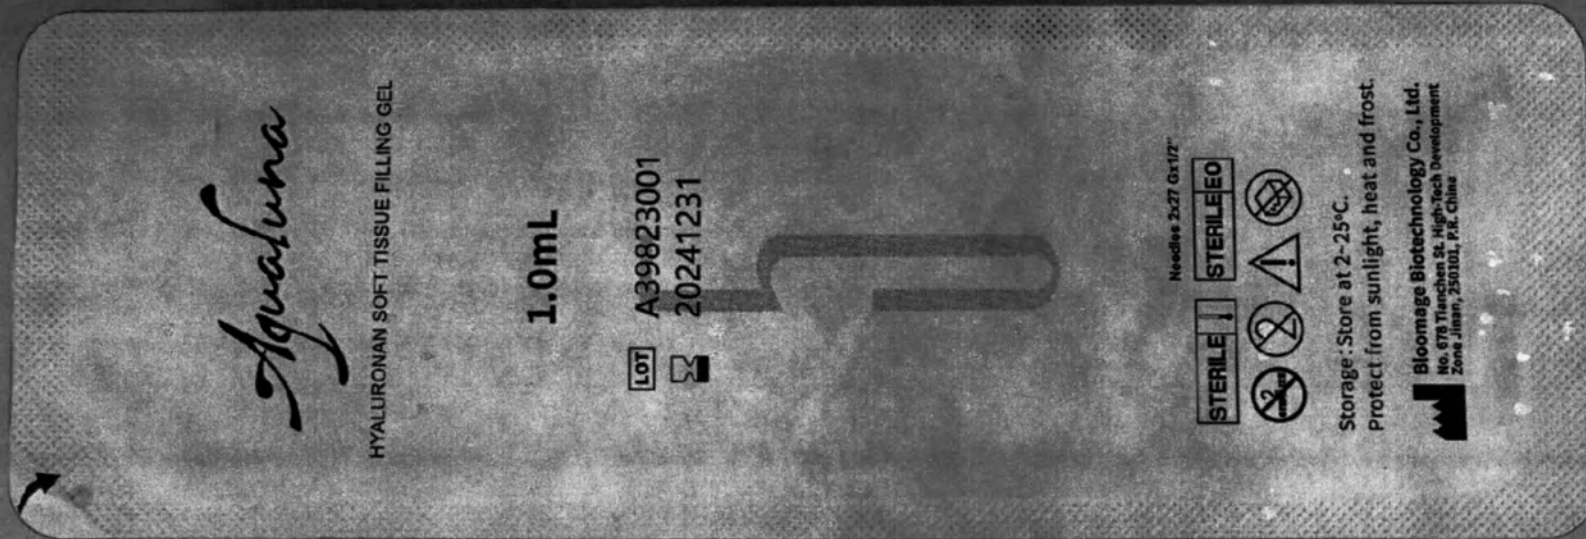


Рисунок 12 — Обратная сторона блистера со шприцом AquaLuna 5

Имплантат интрадермальный AquaLift с гиалуронатом натрия 20 мг/мл и лидокаином 1 мг/мл для контурной пластики, 1 мл

Изделие предназначено для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для коррекции средних и глубоких мимических морщин и складок.

1 упаковка содержит 1 шприц 1 мл, 2 иглы 30G x 1/2", наклейку с информацией об имплантате, инструкцию по применению.

Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично.

Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: Хранить при температуре от 2°C до 25°C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью

«ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ», 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв.5,

Тел.: +7 (495) 414-43-00, E-mail: info@developconsult.ru.

Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.

Рисунок 13 – Этикетка на русском языке

Прошито и пронумеровано
скреплено печатью 14

Представитель
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»
по доверенности от 24.06.2023 г.
А.П. Май
12

