


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РУМЭКС Медикал»

 Н.В. Макарова
«~~28~~» ~~11~~ 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Набор офтальмологический одноразовый Vitreo Line Trocar в вариантах исполнения

**Набор офтальмологический одноразовый Vitreo Line Trocar в варианте исполнения Vitreo Line Trocar TS-23 (6 наборов в уп.)
в составе набора:**

1. троакар – 3 шт.;
2. инфузионная линия - 1 шт.,
3. инструкция по применению - 1 шт.

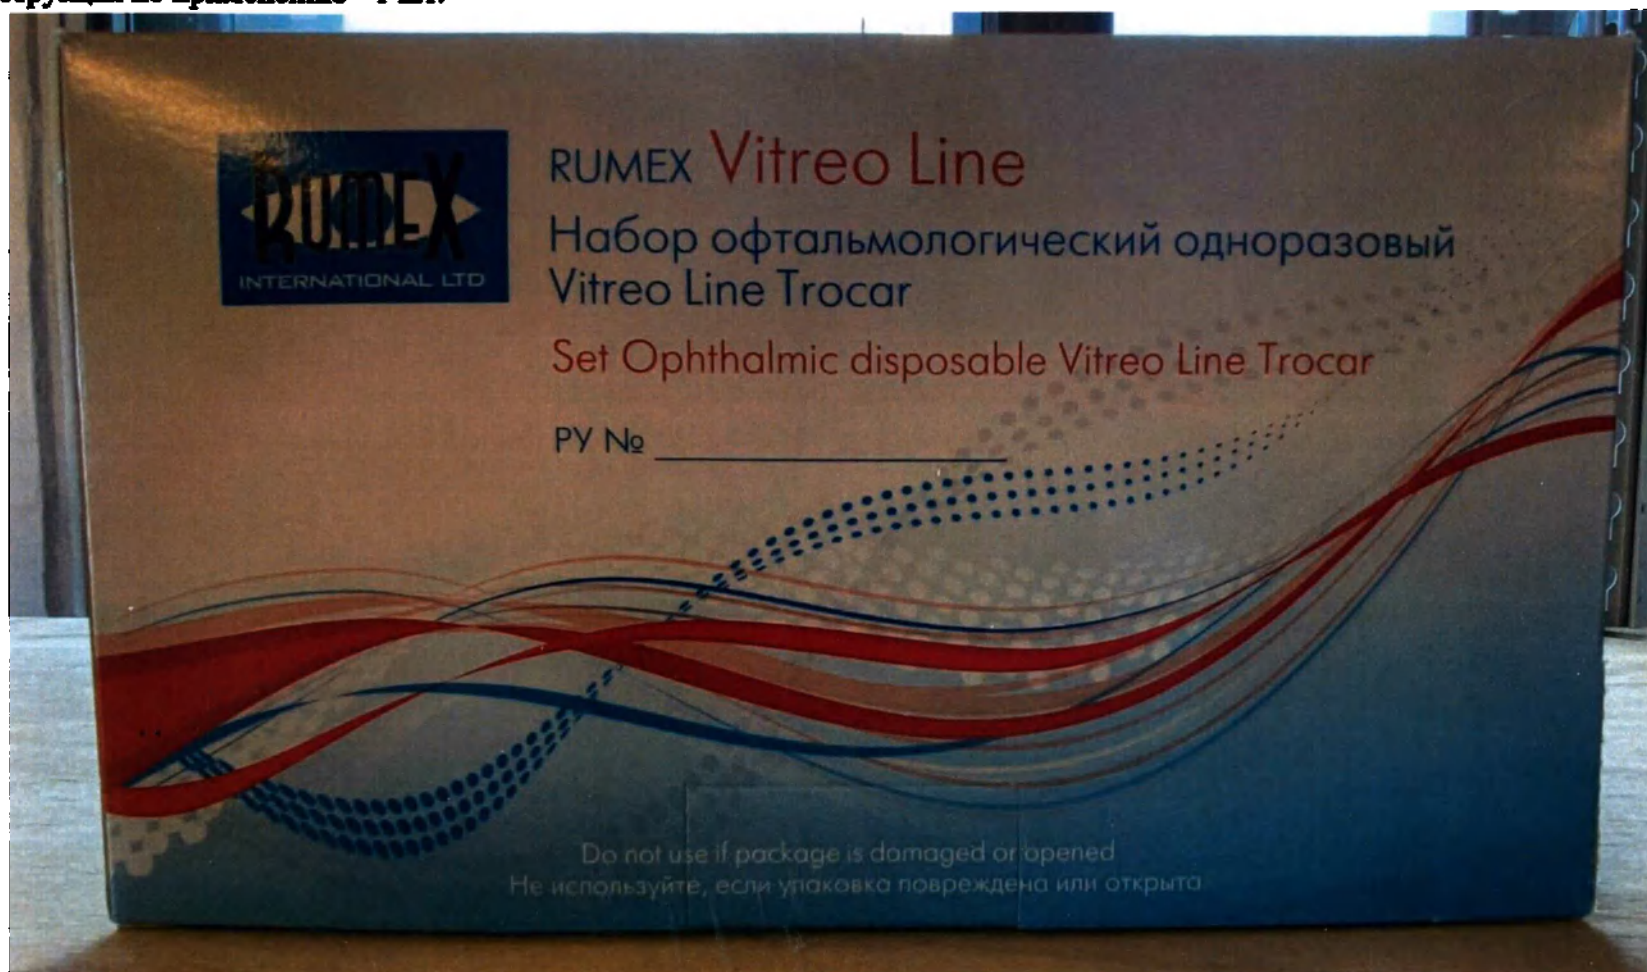


Рисунок 1 – Потребительская упаковка. Вид спереди.



Рисунок 2 – Потребительская упаковка. Вид сбоку 1.

For any questions and correspondence
please address to:

RUMEX INTERNATIONAL LTD
311 Shoreham street, Sheffield,
South Yorkshire, S2 4FA, UK

E-mail: info@rumexinternational.ltd.uk
www.rumexinternational.ltd.uk

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:

ООО «РУМЭКС Медикал»
123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20 стр. 16
Тел.: +7 (495) 966-09-15

Страна происхождения: Италия



Производитель: «РУМЕКС
ИНТЕРНЕШИОНАЛ ЛТД»,
Великобритания

311 Shoreham street, Sheffield,
South Yorkshire, S2 4FA, UK

Рисунок 3 – Потребительская упаковка. Вид сбоку 2.

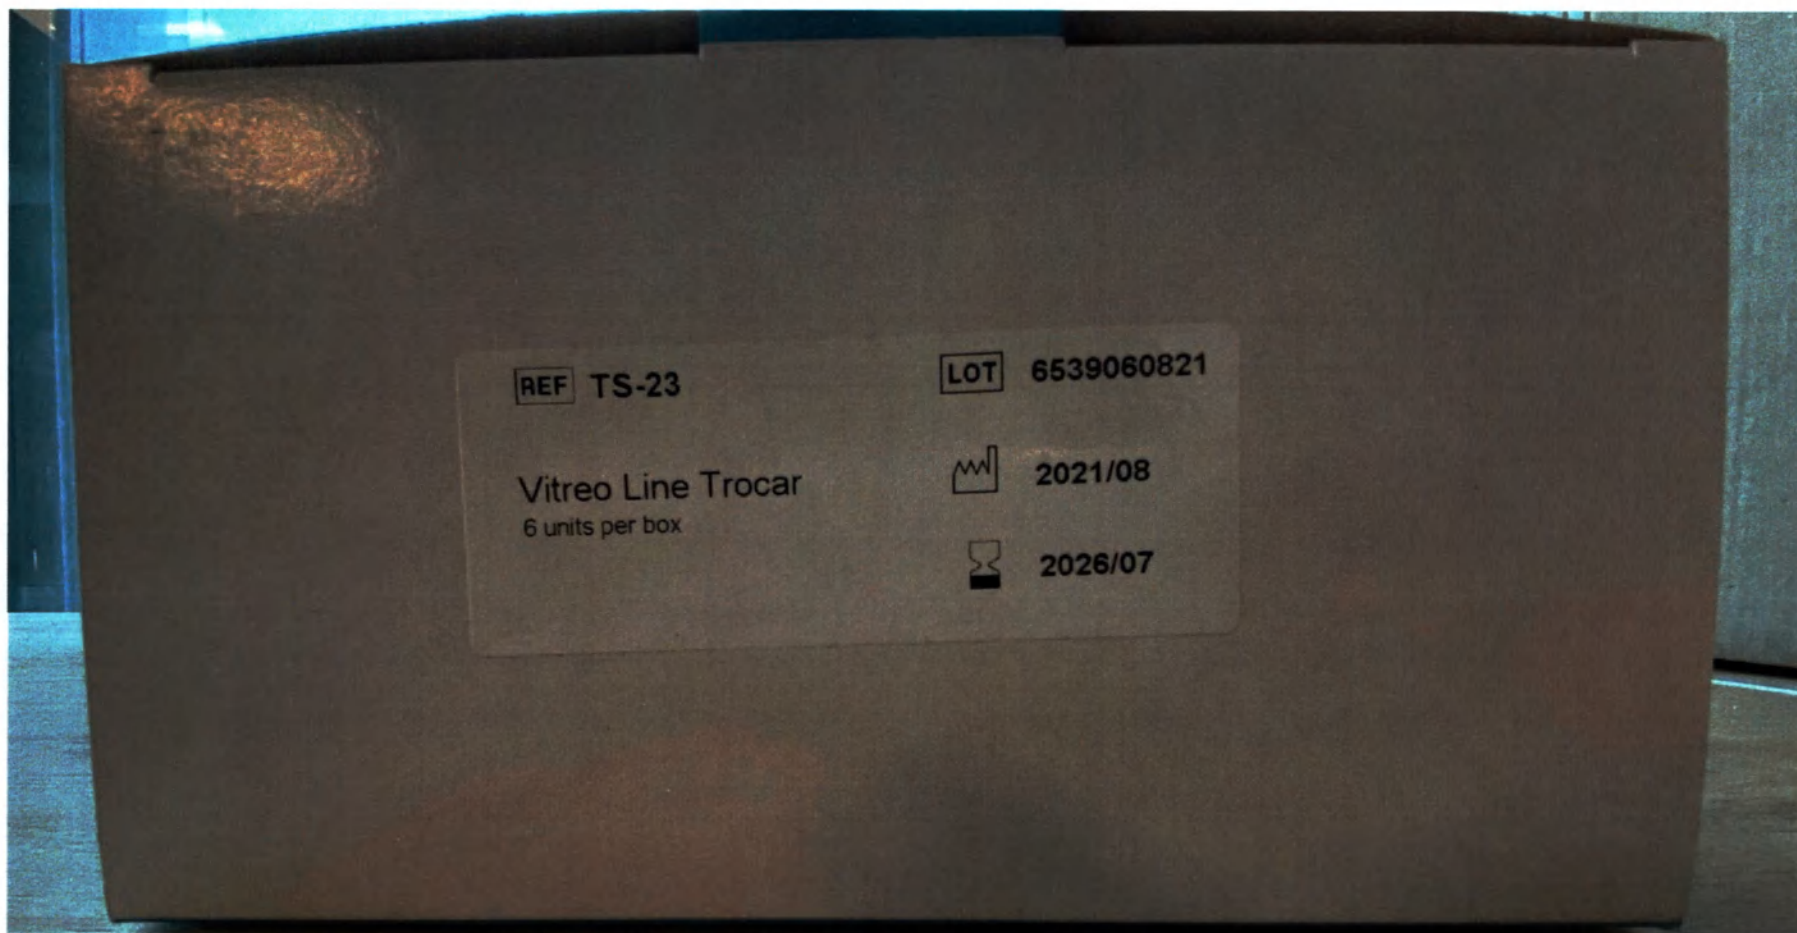


Рисунок 4 – Потребительская упаковка. Вид сверху (для Набора офтальмологического одноразового Vitreo Line Trocar TS-23).

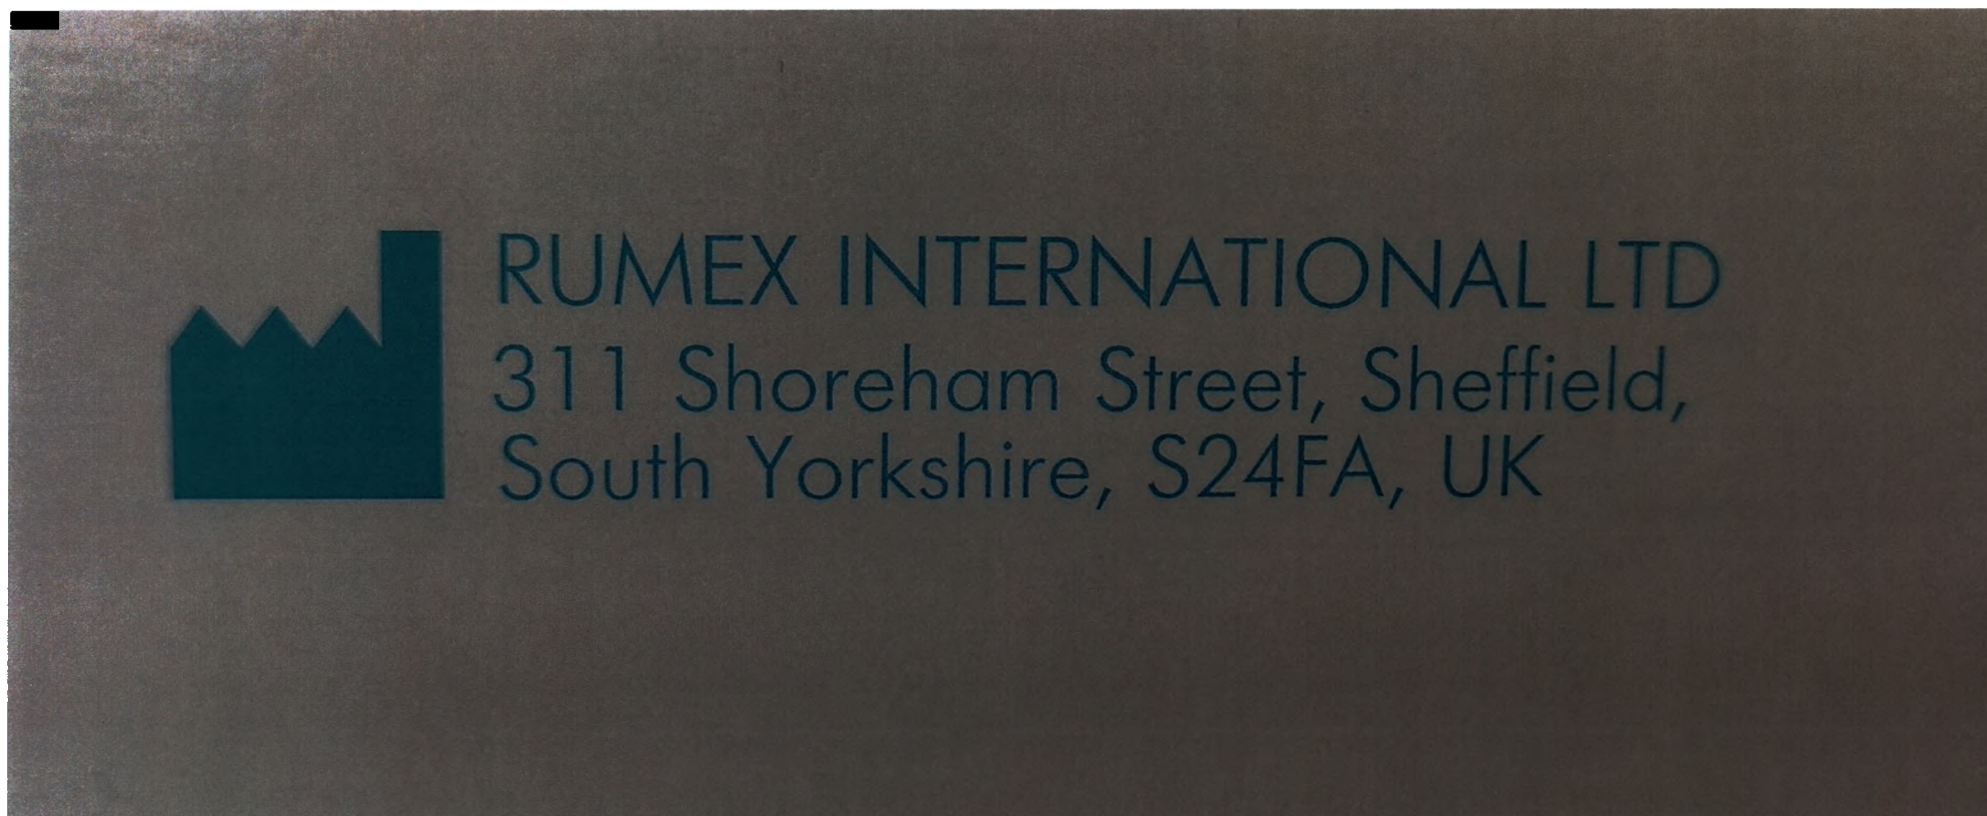


Рисунок 5 – Потребительская упаковка. Вид сзади.



Рисунок 6 – Набор офтальмологический одноразовый Vitreo Line Trocar TS-23 в индивидуальной упаковке

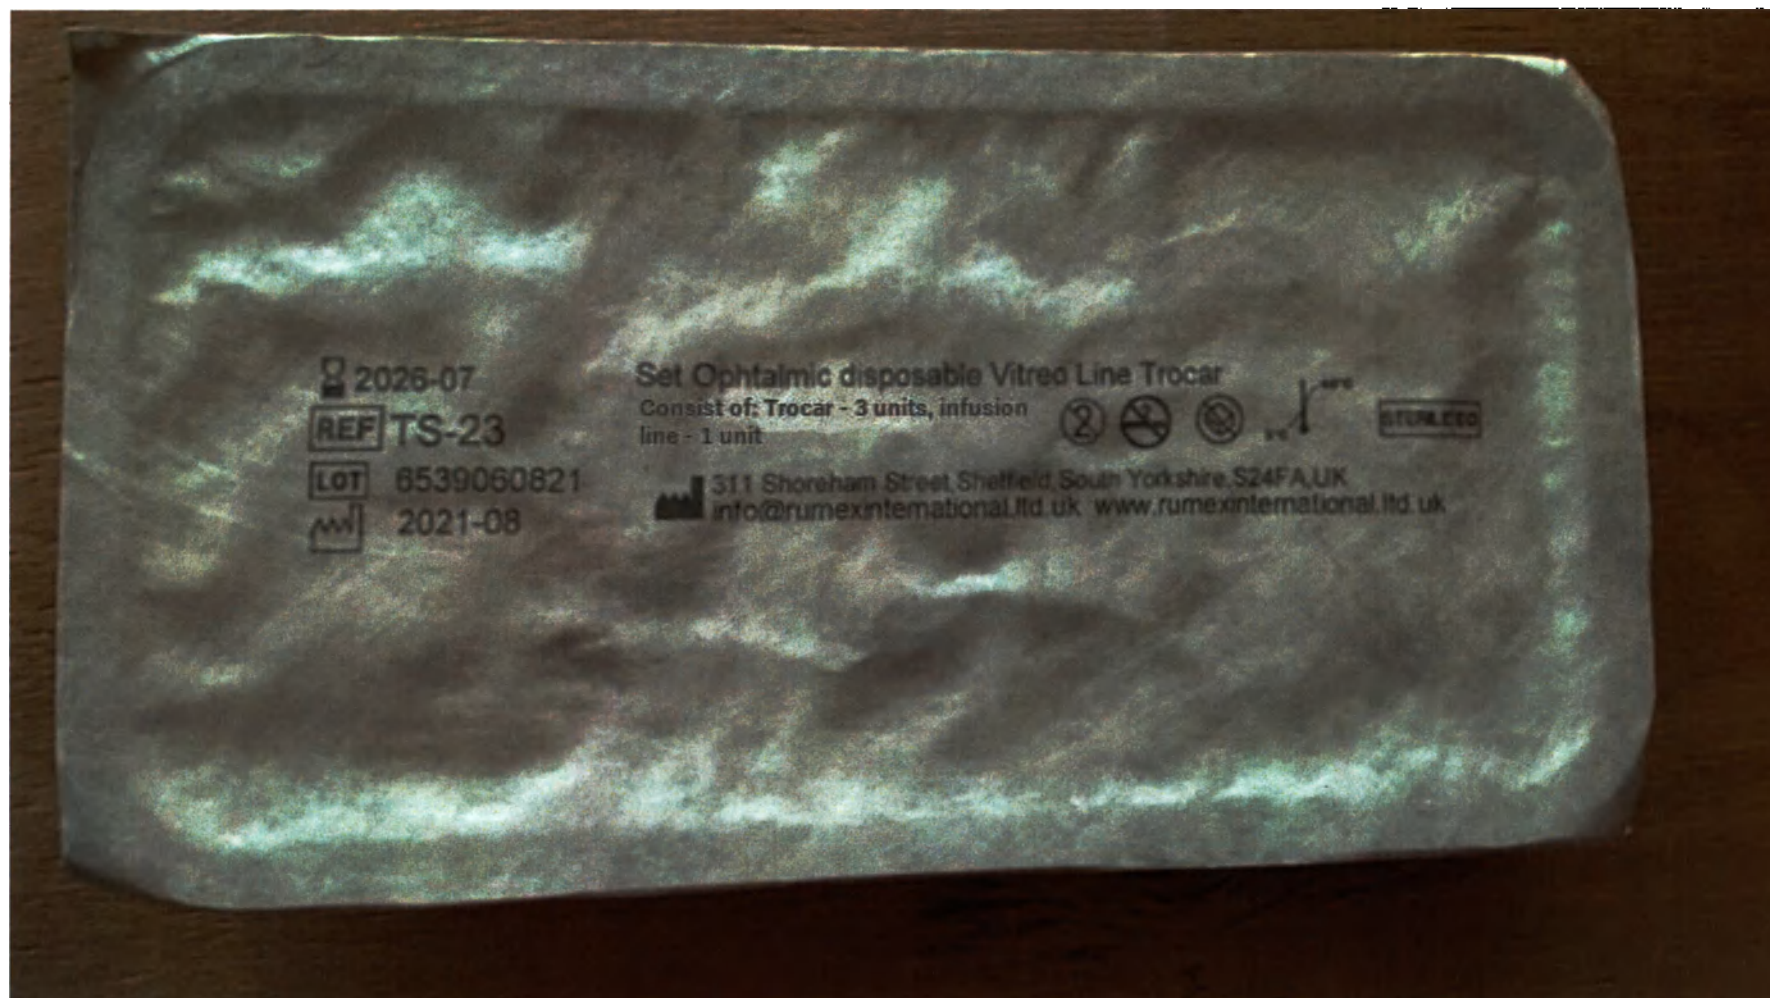


Рисунок 7 – Индивидуальная упаковка. Вид сзади.



Рисунок 8 – Троакар

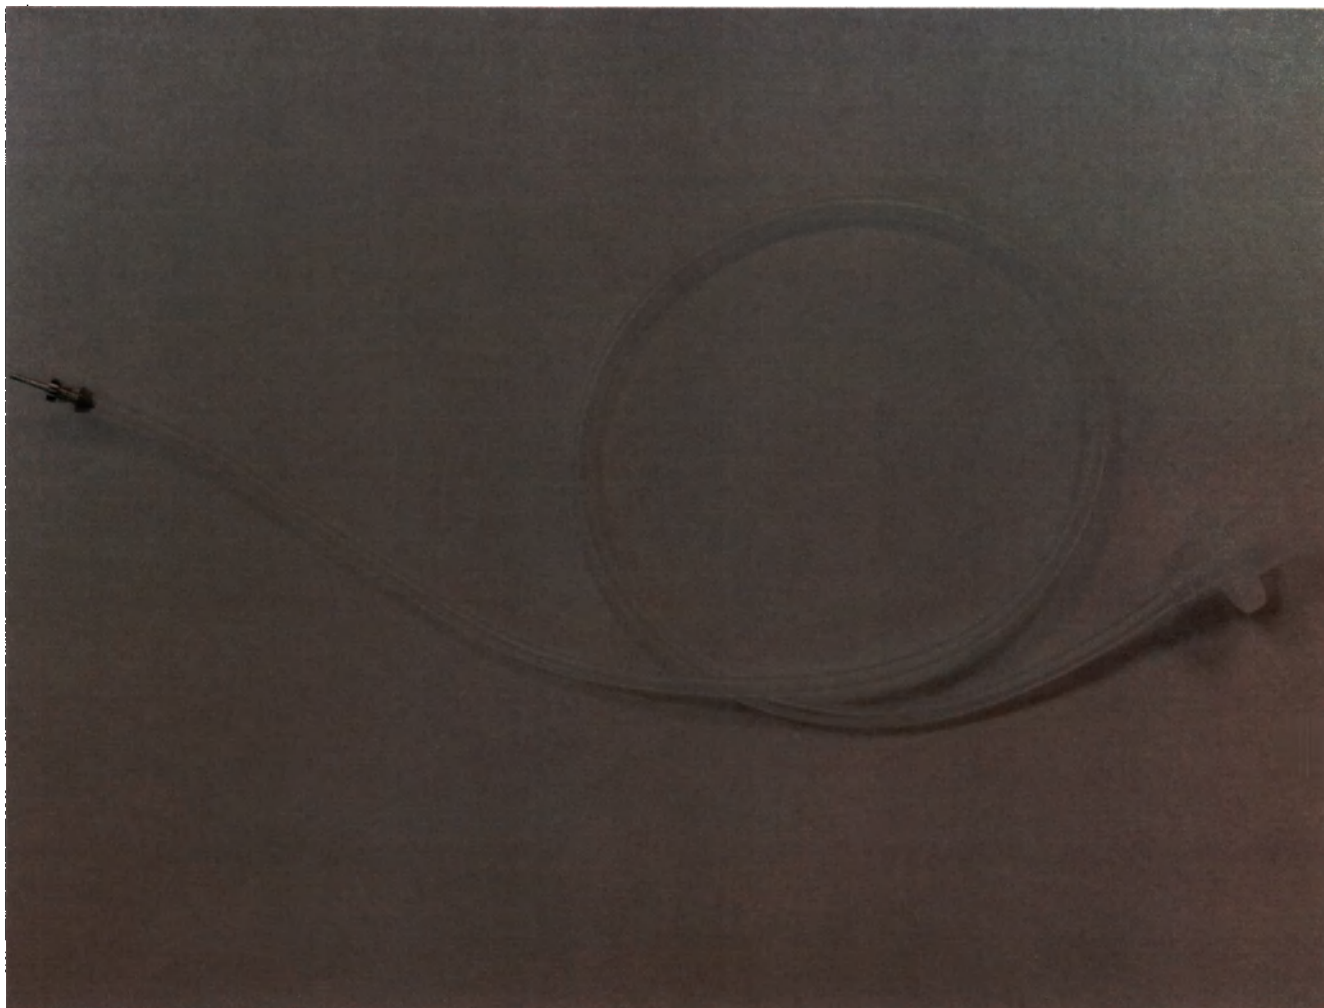


Рисунок 9 – Инфузионная линия

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор офтальмологический одноразовый Vitreo Line Trocar в вариантах
исполнения

1

Рисунок 10 – Инструкция по применению.

**Набор офтальмологический одноразовый Vitreo Line Trocar в варианте исполнения Vitreo Line Trocar TS-25 (6 наборов в уп.)
в составе набора:**

- 4. троакар – 3 шт.;**
- 5. инфузионная линия - 1 шт.,**
- 6. инструкция по применению - 1 шт.**

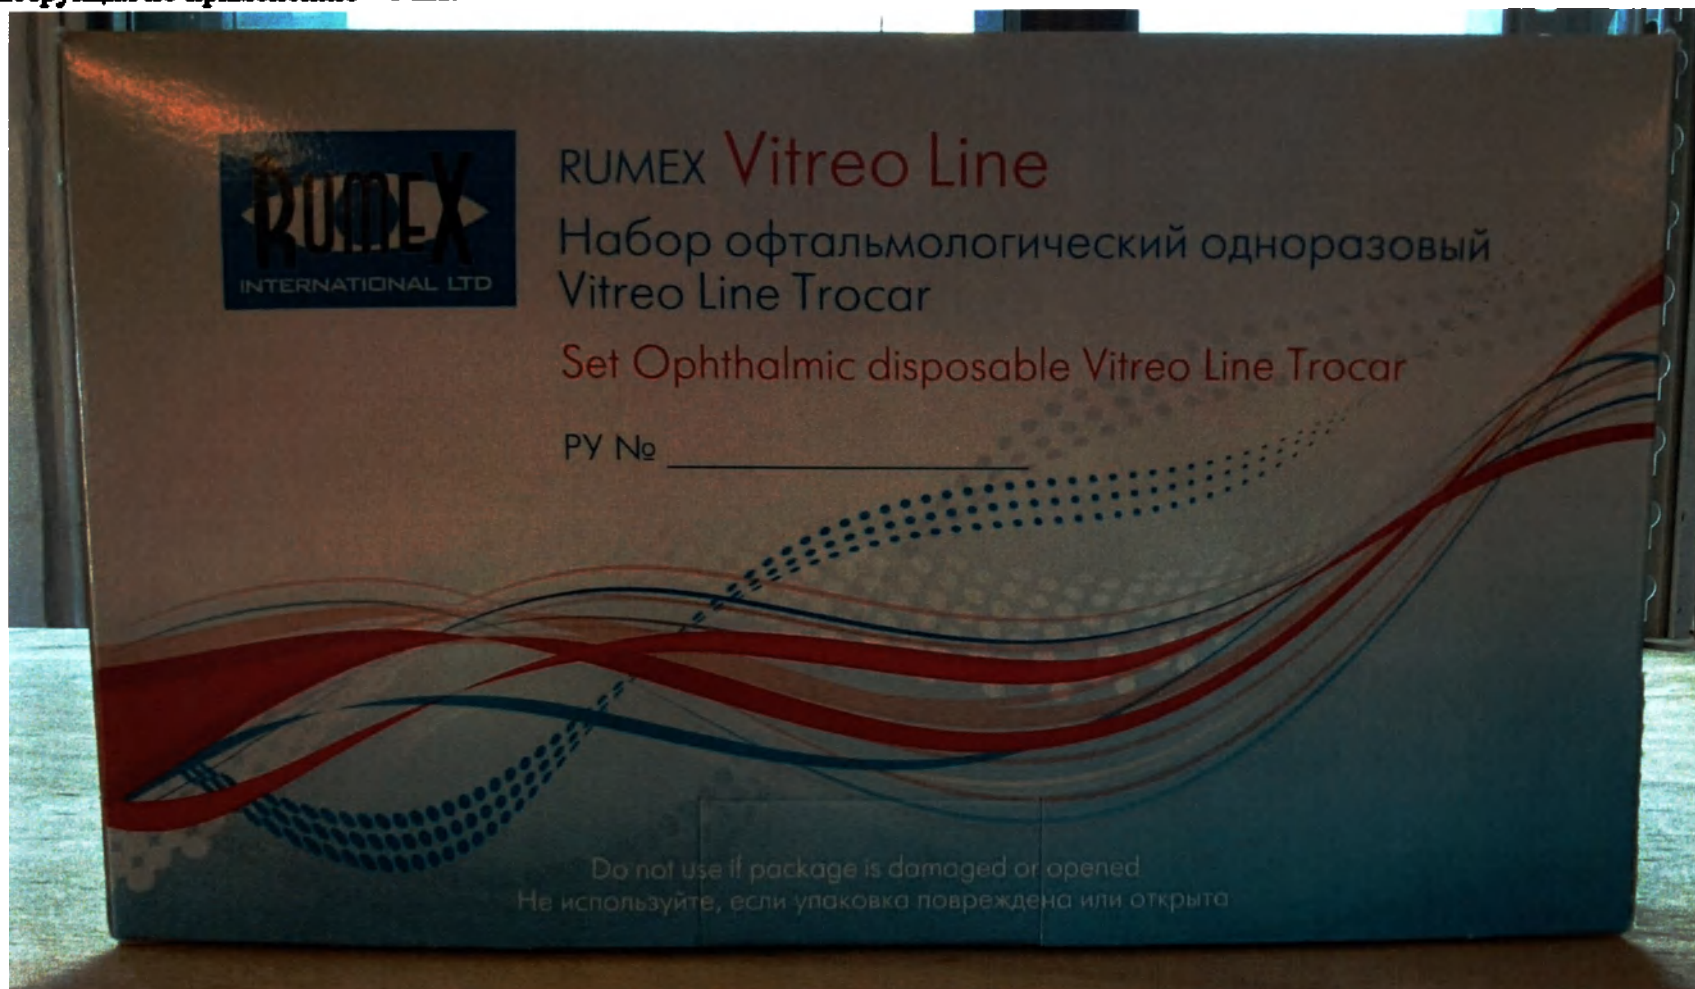


Рисунок 11 – Потребительская упаковка. Вид спереди.



Рисунок 12 – Потребительская упаковка. Вид сбоку 1.

For any questions and correspondence
please address to:

RUMEX INTERNATIONAL LTD
311 Shoreham street, Sheffield,
South Yorkshire, S2 4FA, UK

E-mail: info@rumexinternational.ltd.uk
www.rumexinternational.ltd.uk

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:

ООО «РУМЭКС Медикал»
123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20 стр. 16
Тел: +7 (495) 966-09-15

Страна происхождения: Италия



Производитель: «РУМЕКС
ИНТЕРНЕШИОНАЛ ЛТД»,
Великобритания

311 Shoreham street, Sheffield,
South Yorkshire, S2 4FA, UK

Рисунок 13 – Потребительская упаковка. Вид сбоку 2.

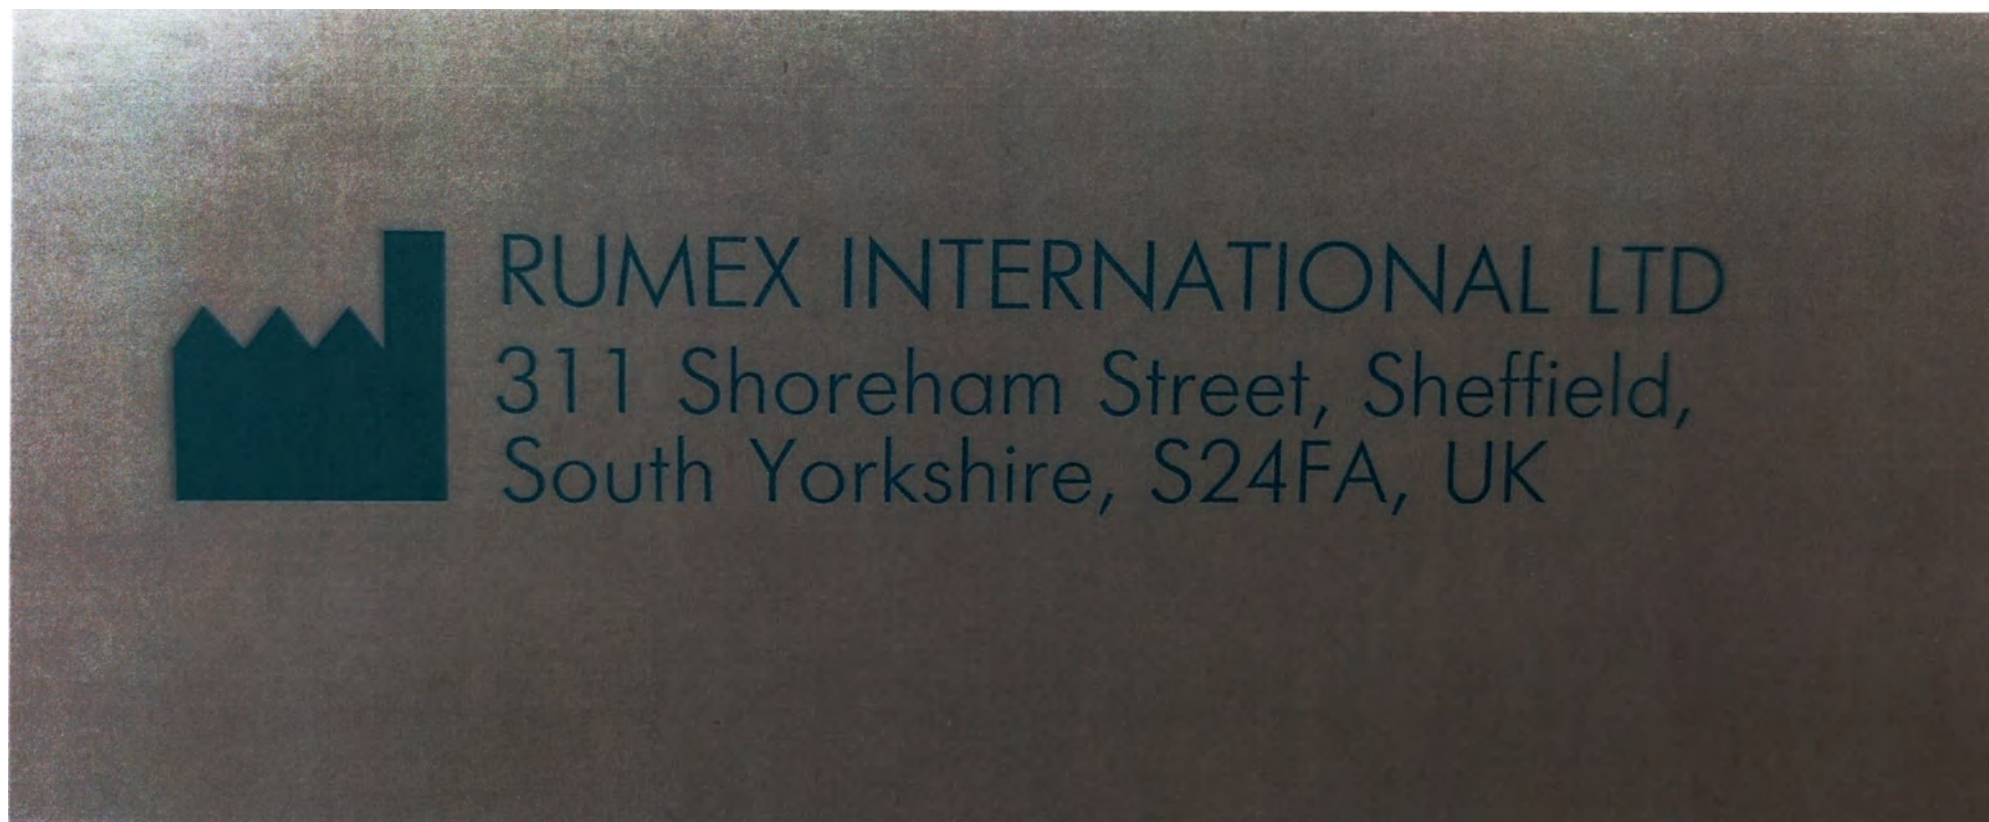


Рисунок 14 – Потребительская упаковка. Вид сзади

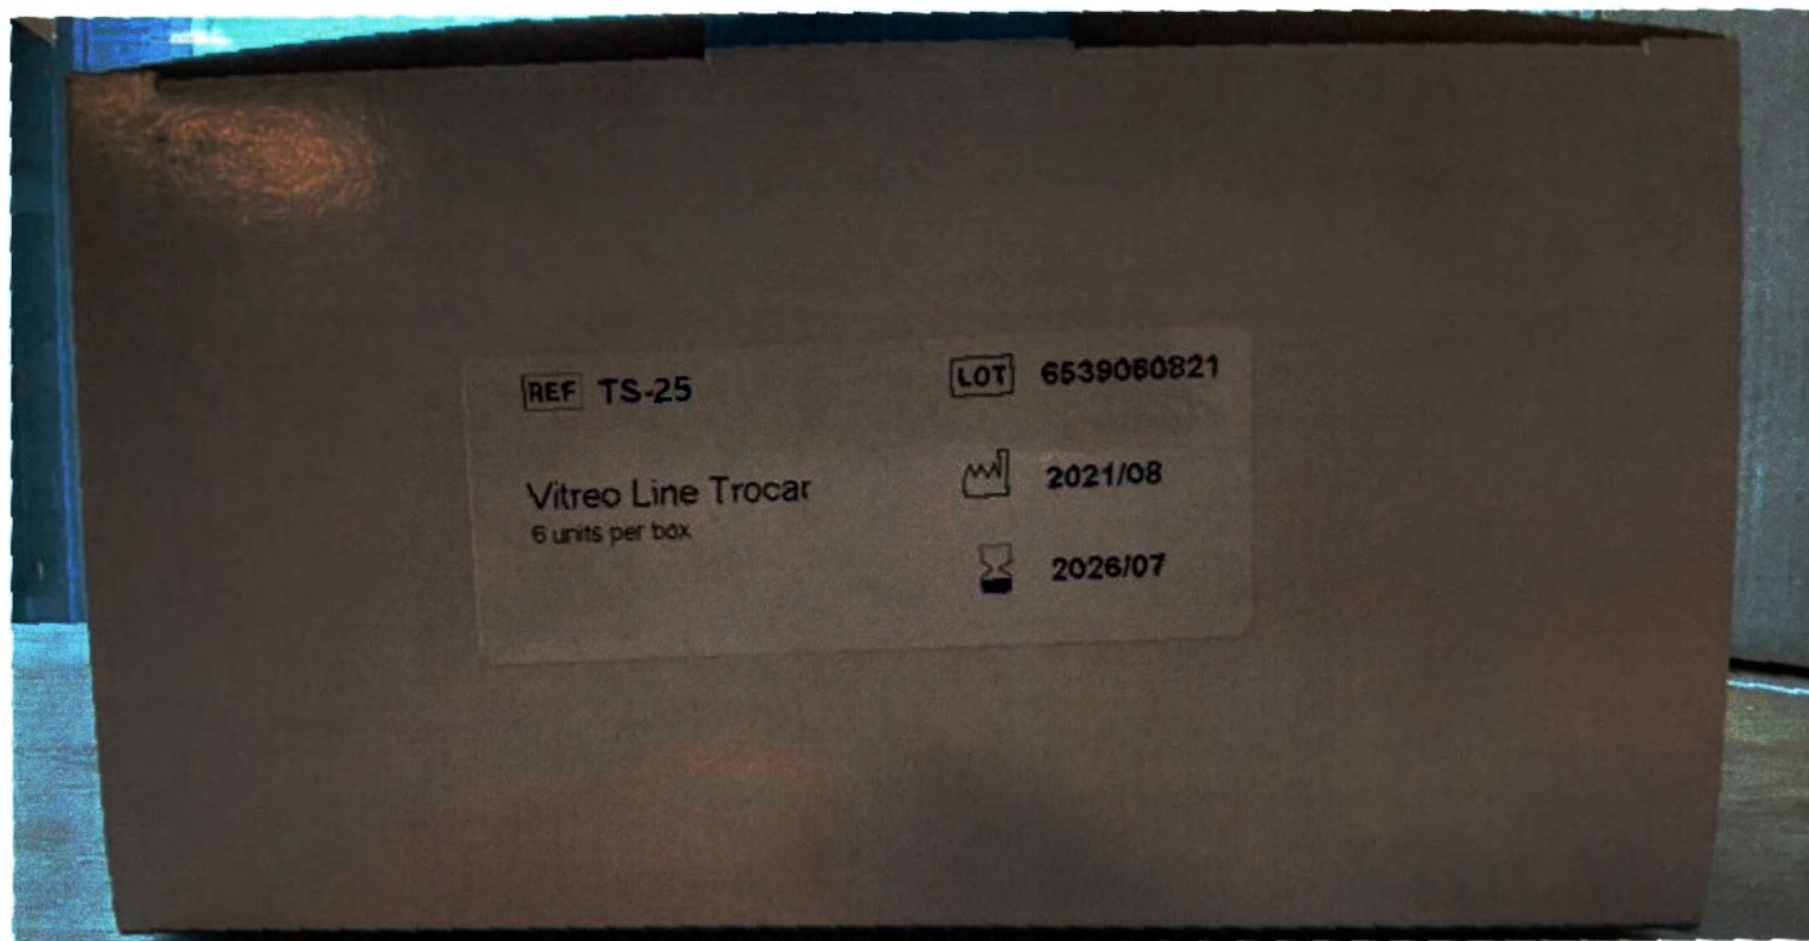


Рисунок 15 – Потребительская упаковка. Вид сверху (для Набора офтальмологического одноразового Vitreo Line Trocar TS-25).

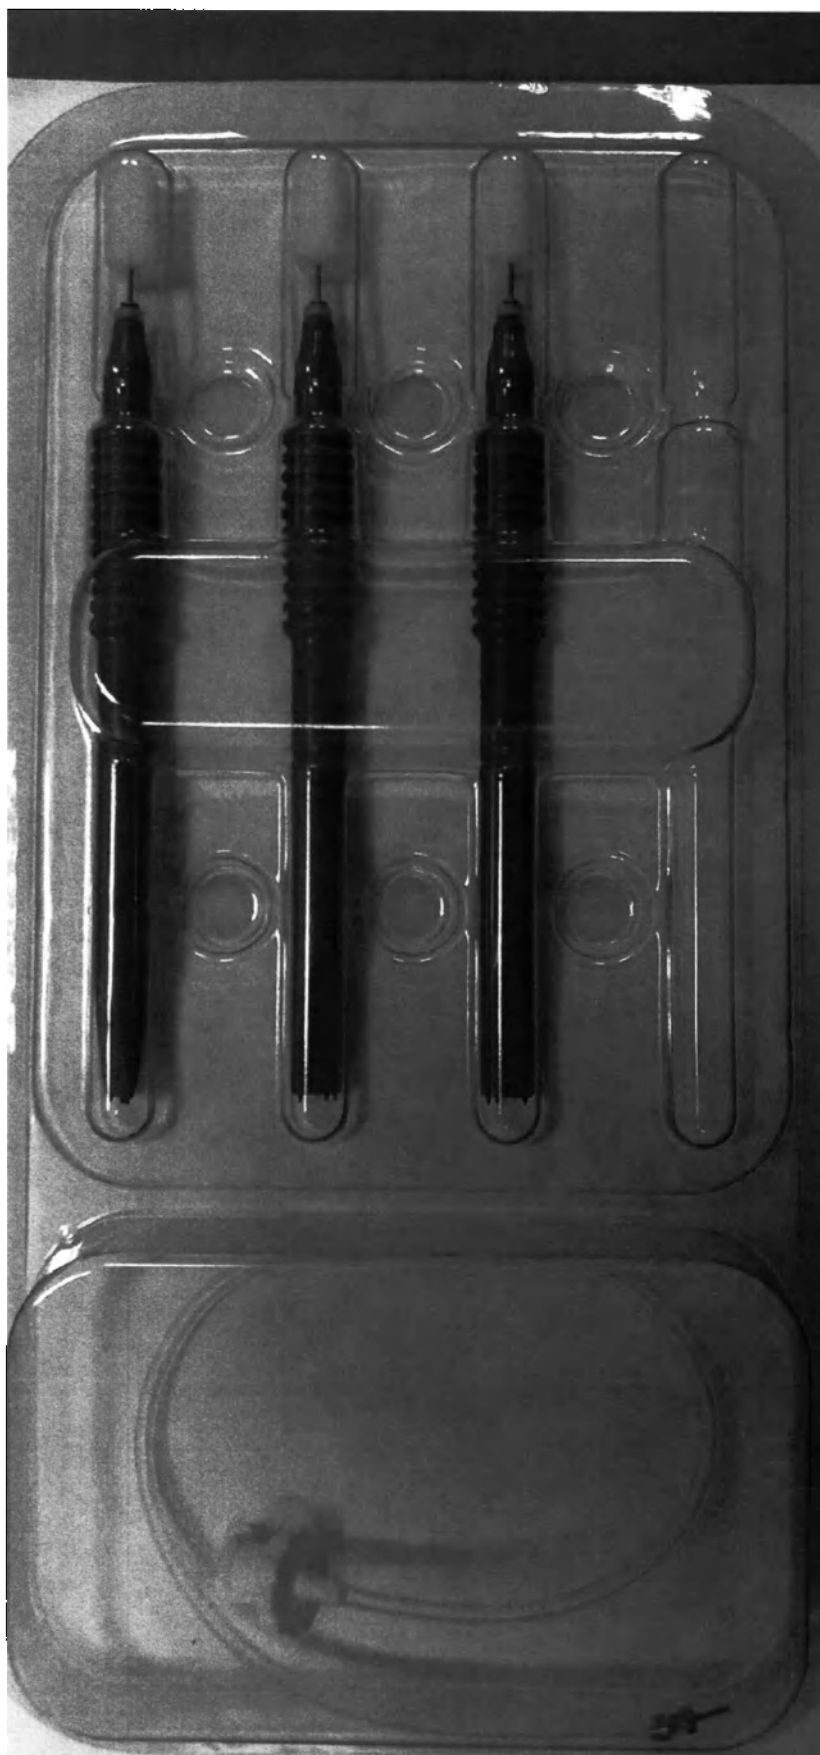


Рисунок 16 – Набор офтальмологический одноразовый Vitreo Line Trocar TS-25 в индивидуальной упаковке

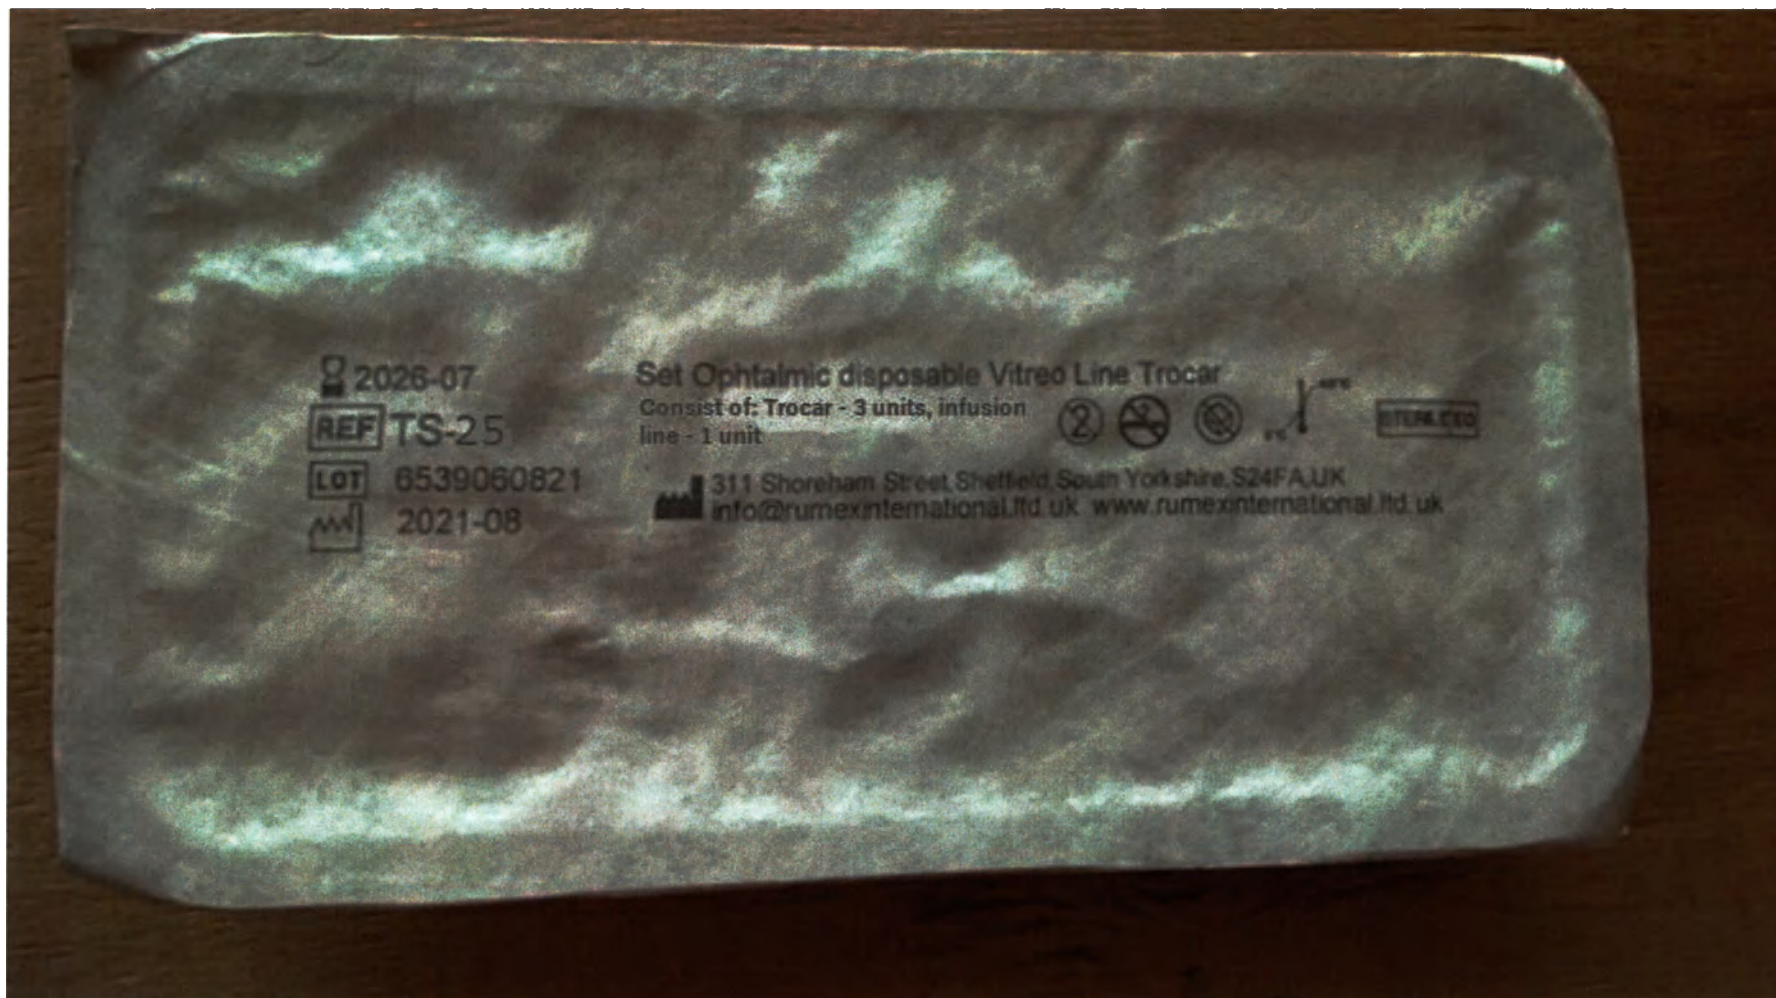


Рисунок 17 – Индивидуальная упаковка. Вид сзади.



Рисунок 18 – Троакар

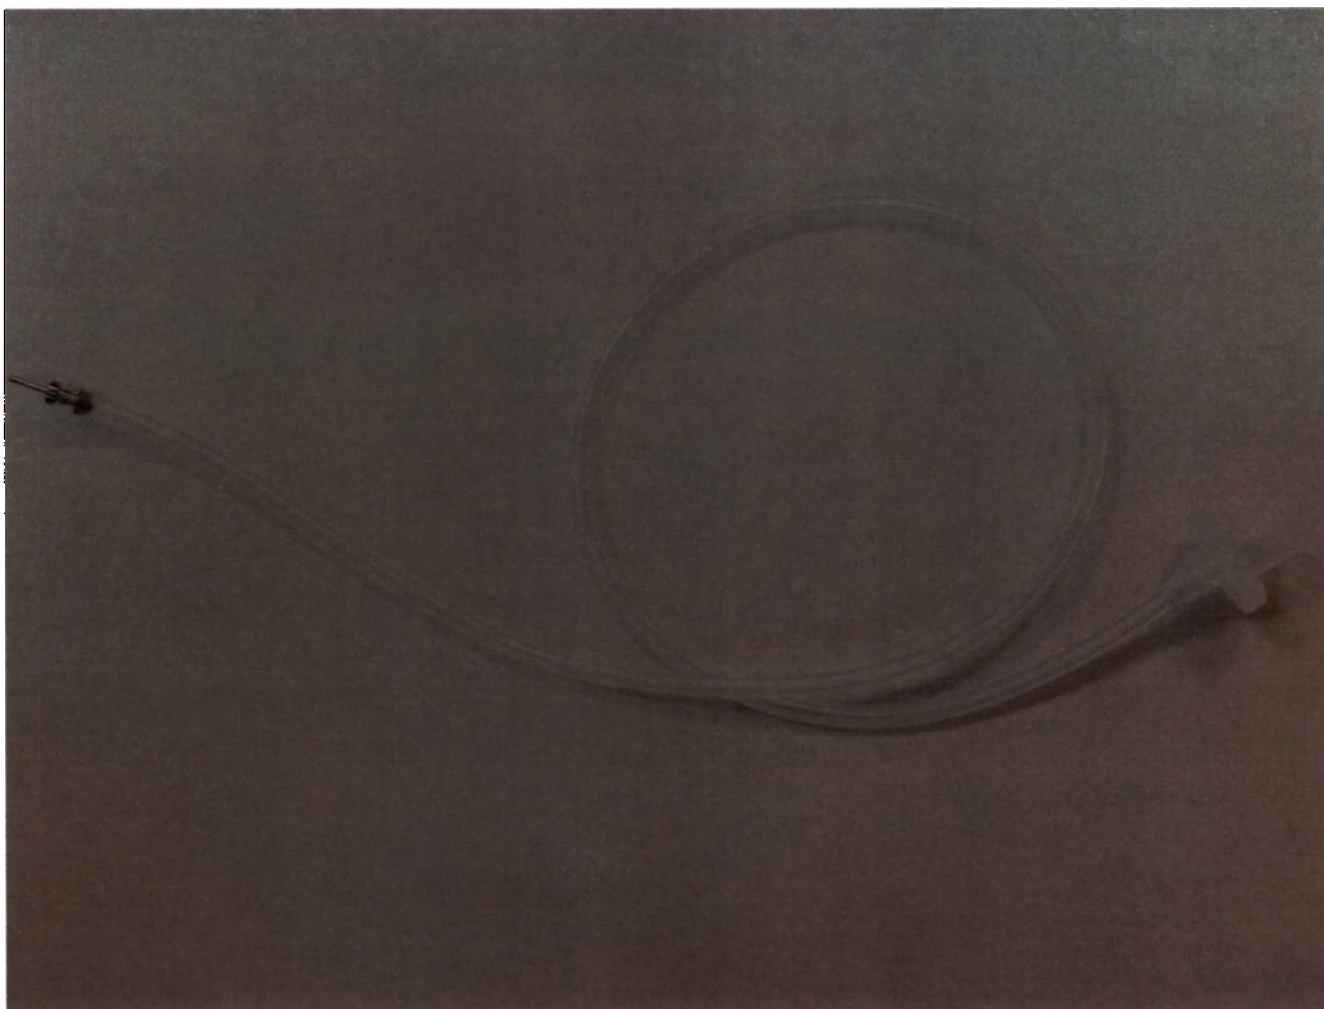


Рисунок 19 – Инфузионная линия

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Набор офтальмологический одноразовый Vitreo Line Trocar в вариантах
исполнения**

1

Рисунок 20 – Инструкция по применению

Набор офтальмологический одноразовый Vitreo Line Trocar в варианте исполнения Vitreo Line Trocar TS-27 (6 наборов в уп.)
в составе набора:

- 7. троакар – 3 шт.;
- 8. инфузионная линия - 1 шт.,
- 9. инструкция по применению - 1 шт.

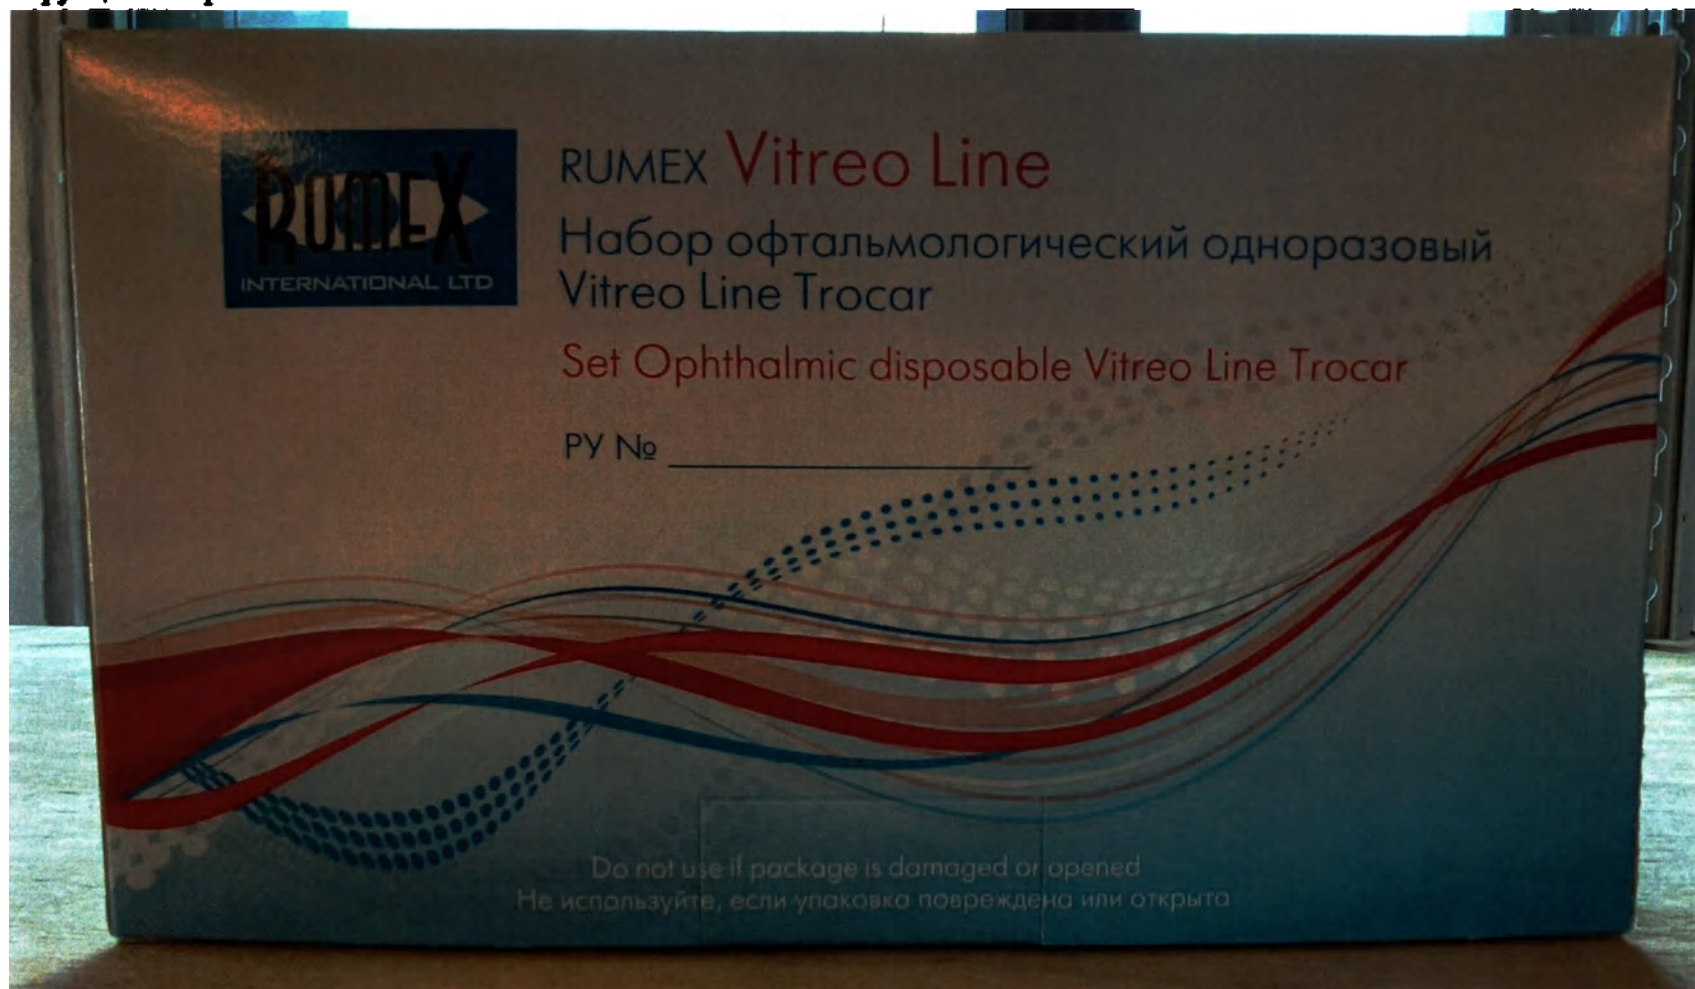


Рисунок 21 – Потребительская упаковка. Вид спереди.



Рисунок 22 – Потребительская упаковка. Вид сбоку 1.

For any questions and correspondence
please address to:

RUMEX INTERNATIONAL LTD
311 Shoreham street, Sheffield,
South Yorkshire, S2 4FA, UK

E-mail: info@rumexinternational.ltd.uk
www.rumexinternational.ltd.uk

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:

ООО «РУМЭКС Медикал»
123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20 стр. 16
Тел: +7 (495) 966-09-15

Страна происхождения: Италия



Производитель: «РУМЕКС
ИНТЕРНЕШИОНАЛ ЛТД»,
Великобритания

311 Shoreham street, Sheffield,
South Yorkshire, S2 4FA, UK

Рисунок 23 – Потребительская упаковка. Вид сбоку 2.

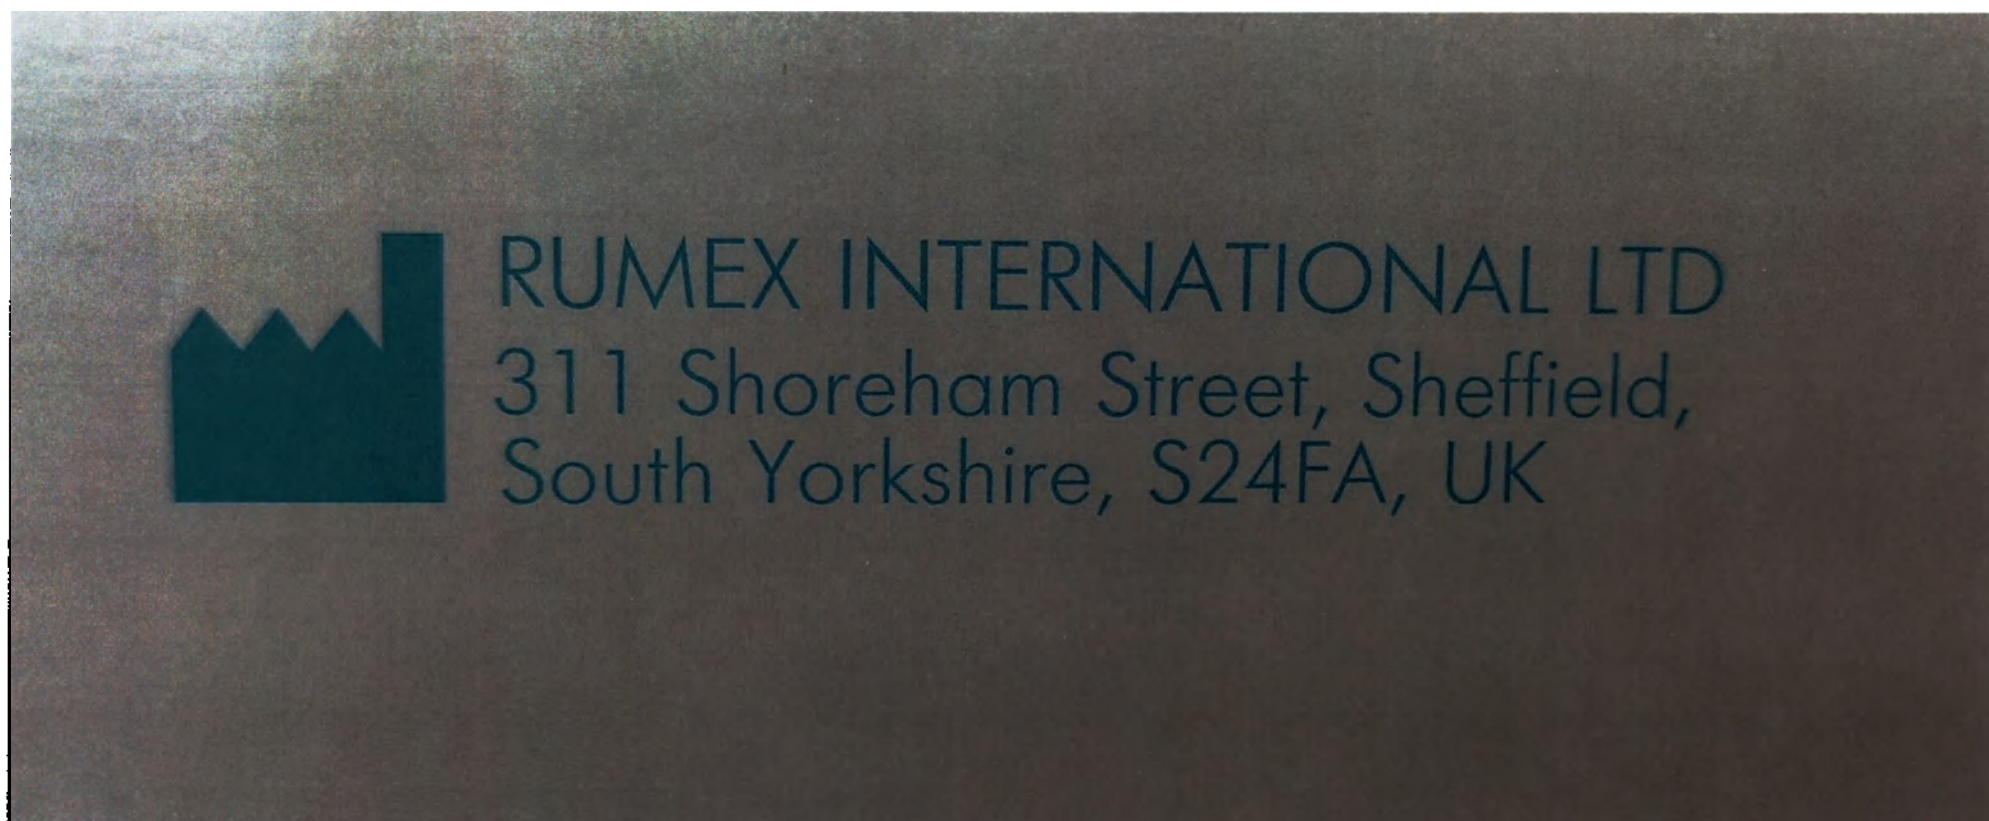


Рисунок 24 – Потребительская упаковка. Вид сзади

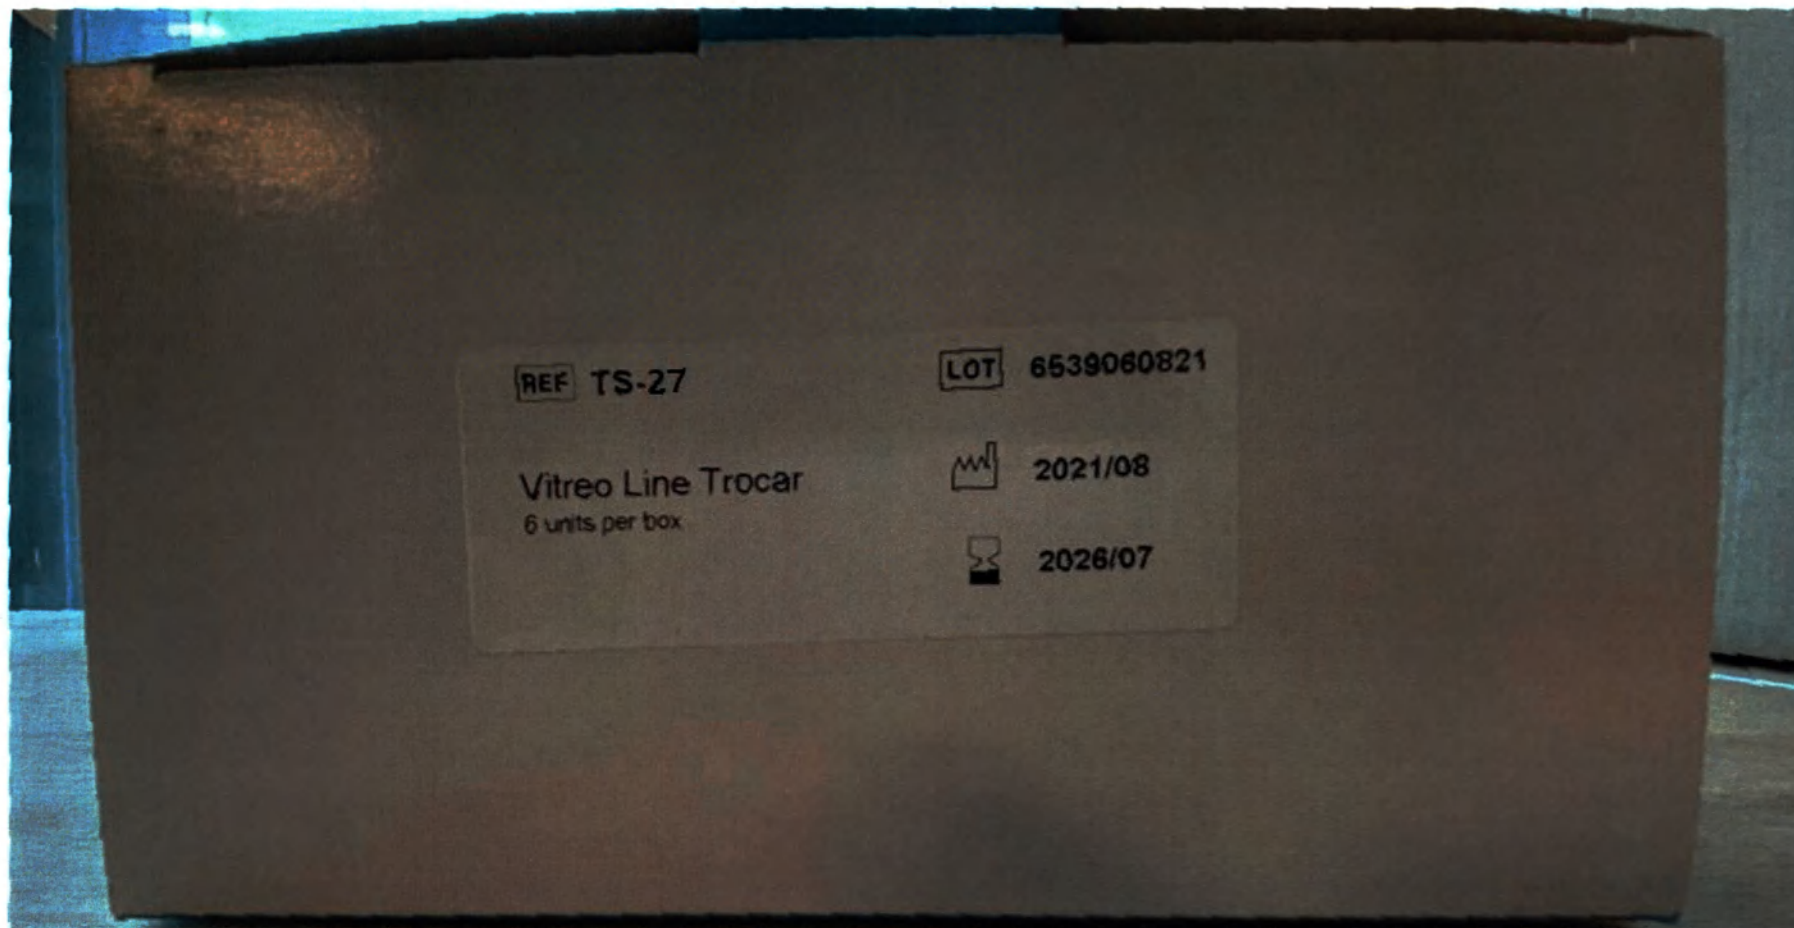


Рисунок 25 – Потребительская упаковка. Вид сверху (для Набора офтальмологического одноразового Vitreo Line Trocar TS-27).



Рисунок 26 – Набор офтальмологический одноразовый Vitreo Line Trocar TS-27 в индивидуальной упаковке

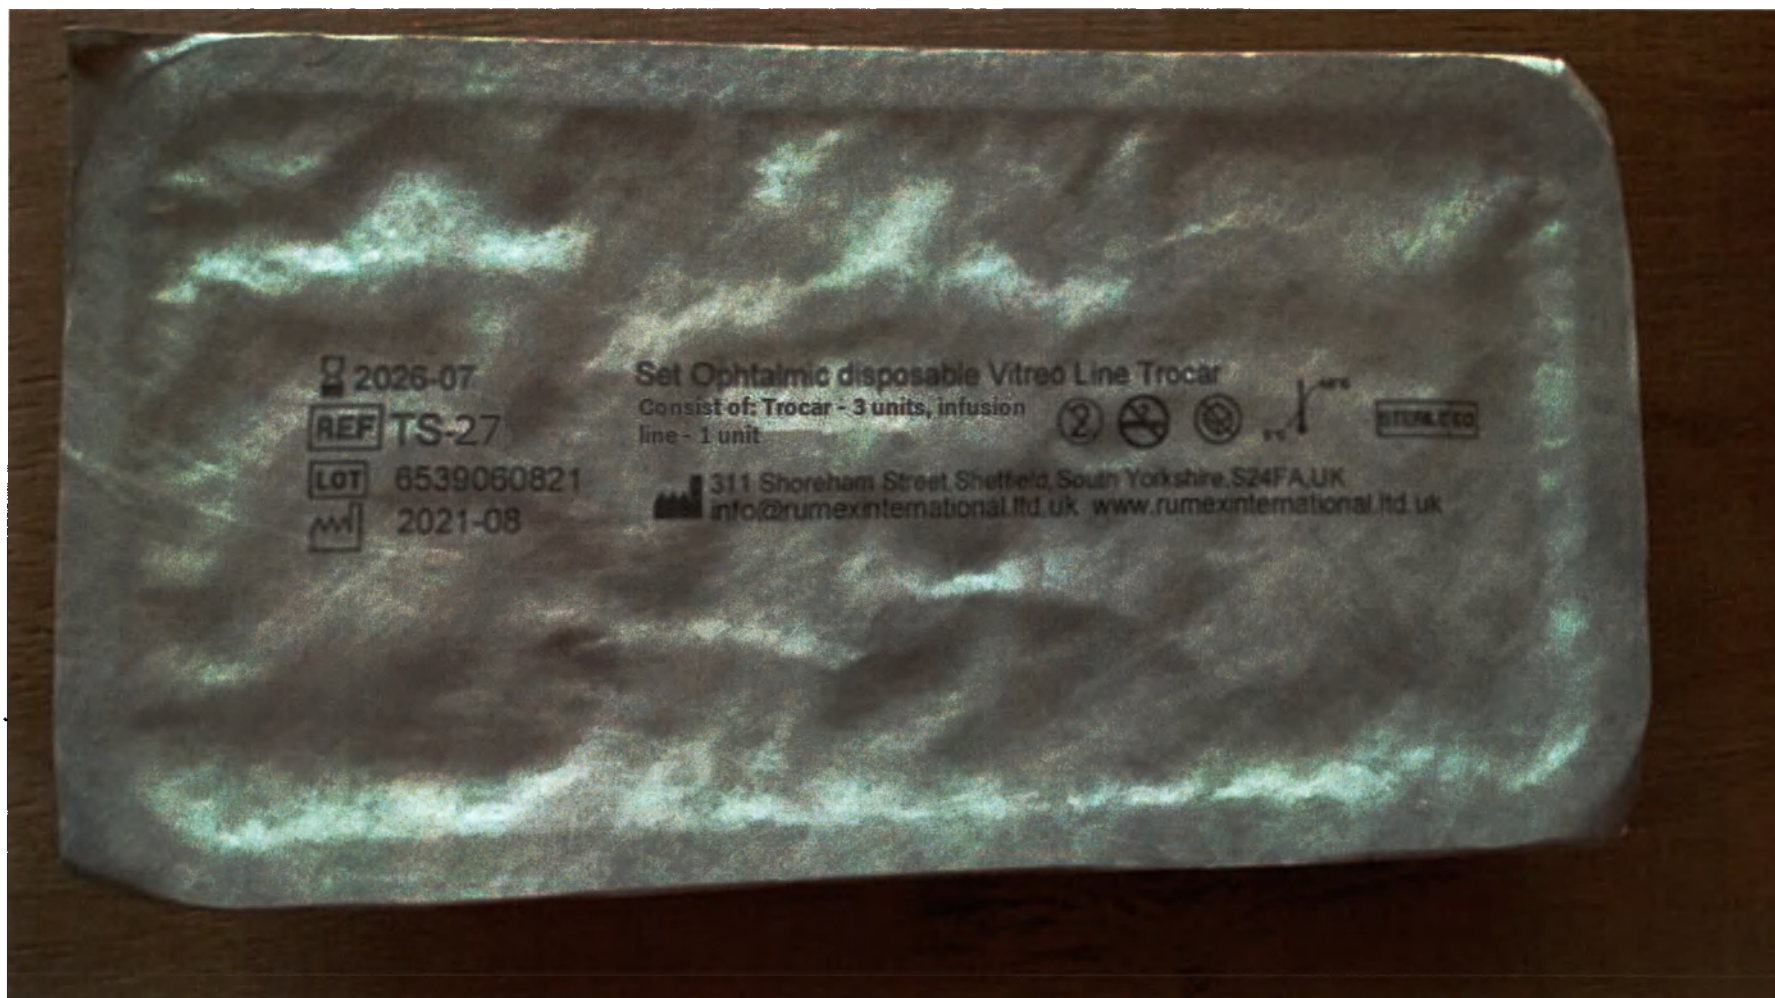


Рисунок 27 – Индивидуальная упаковка. Вид сзади.

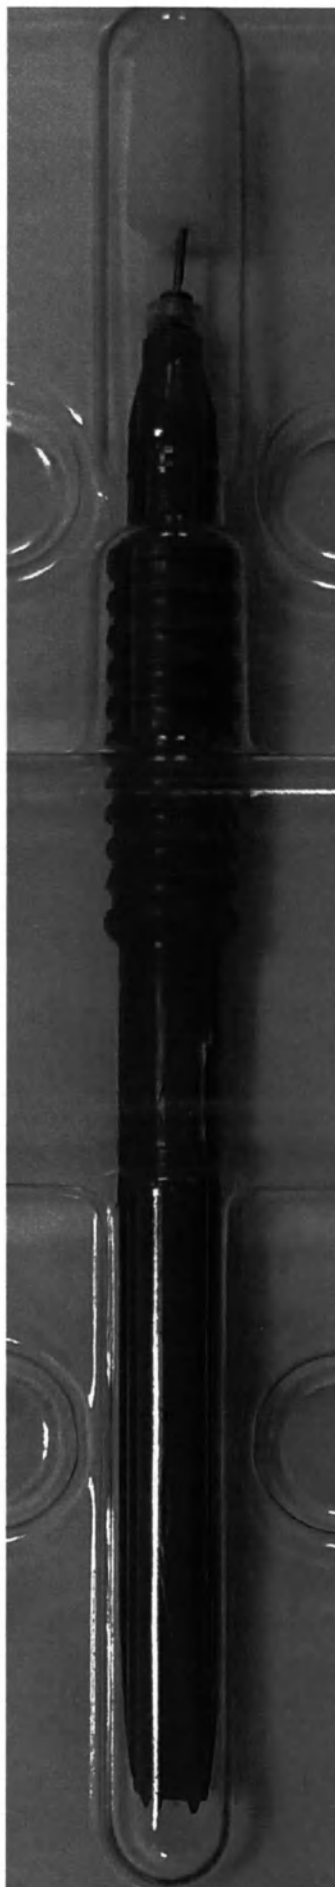


Рисунок 28 – Троакар

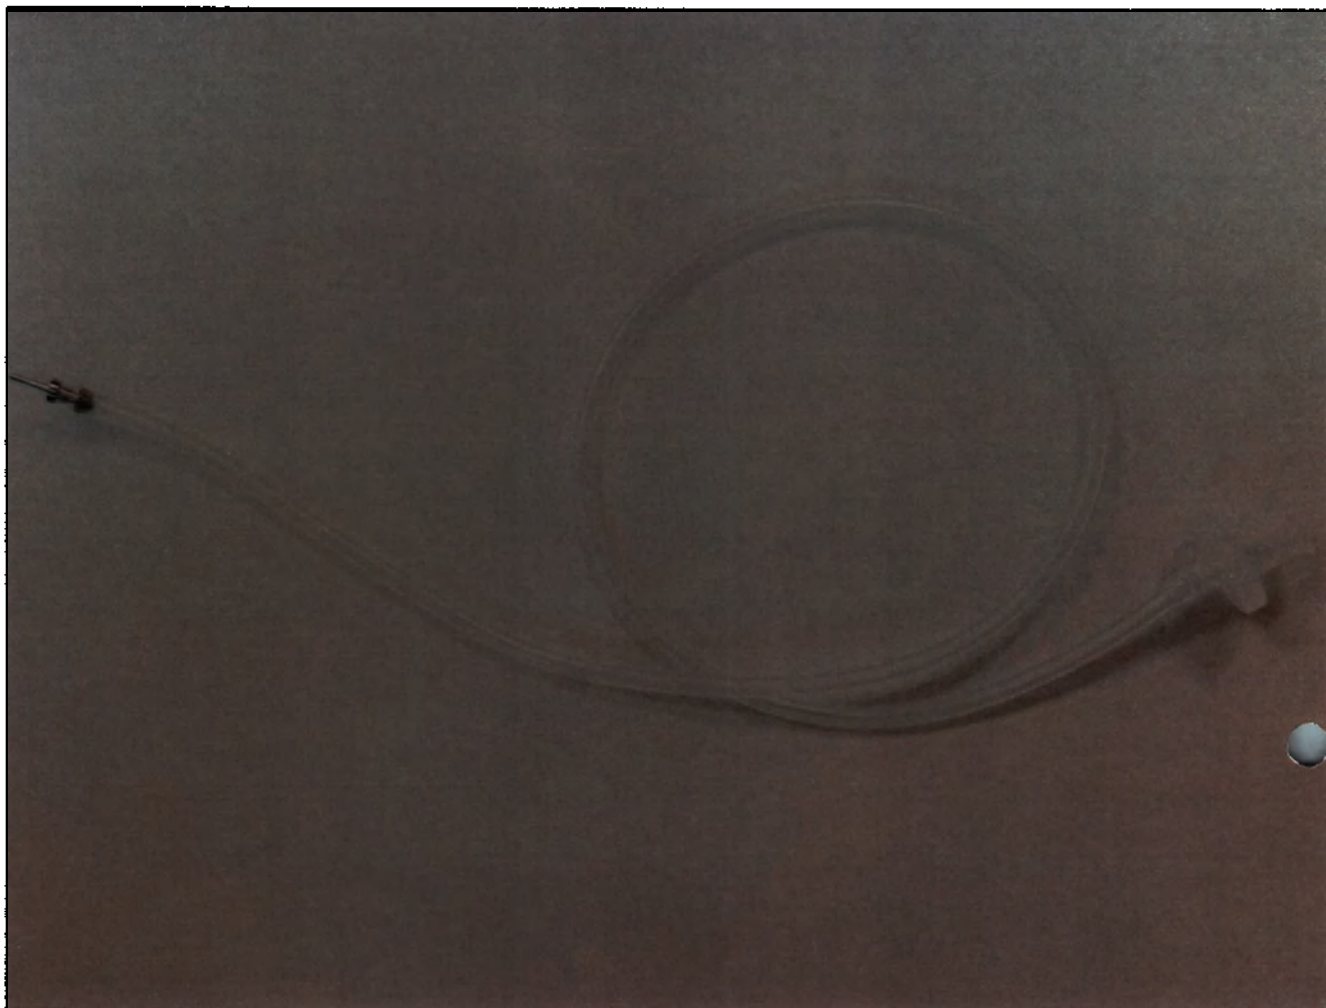


Рисунок 29 – Инфузионная линия

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Набор офтальмологический одноразовый Vitreo Line Trocar в вариантах
исполнения**

1

Рисунок 30 – Инструкция по применению

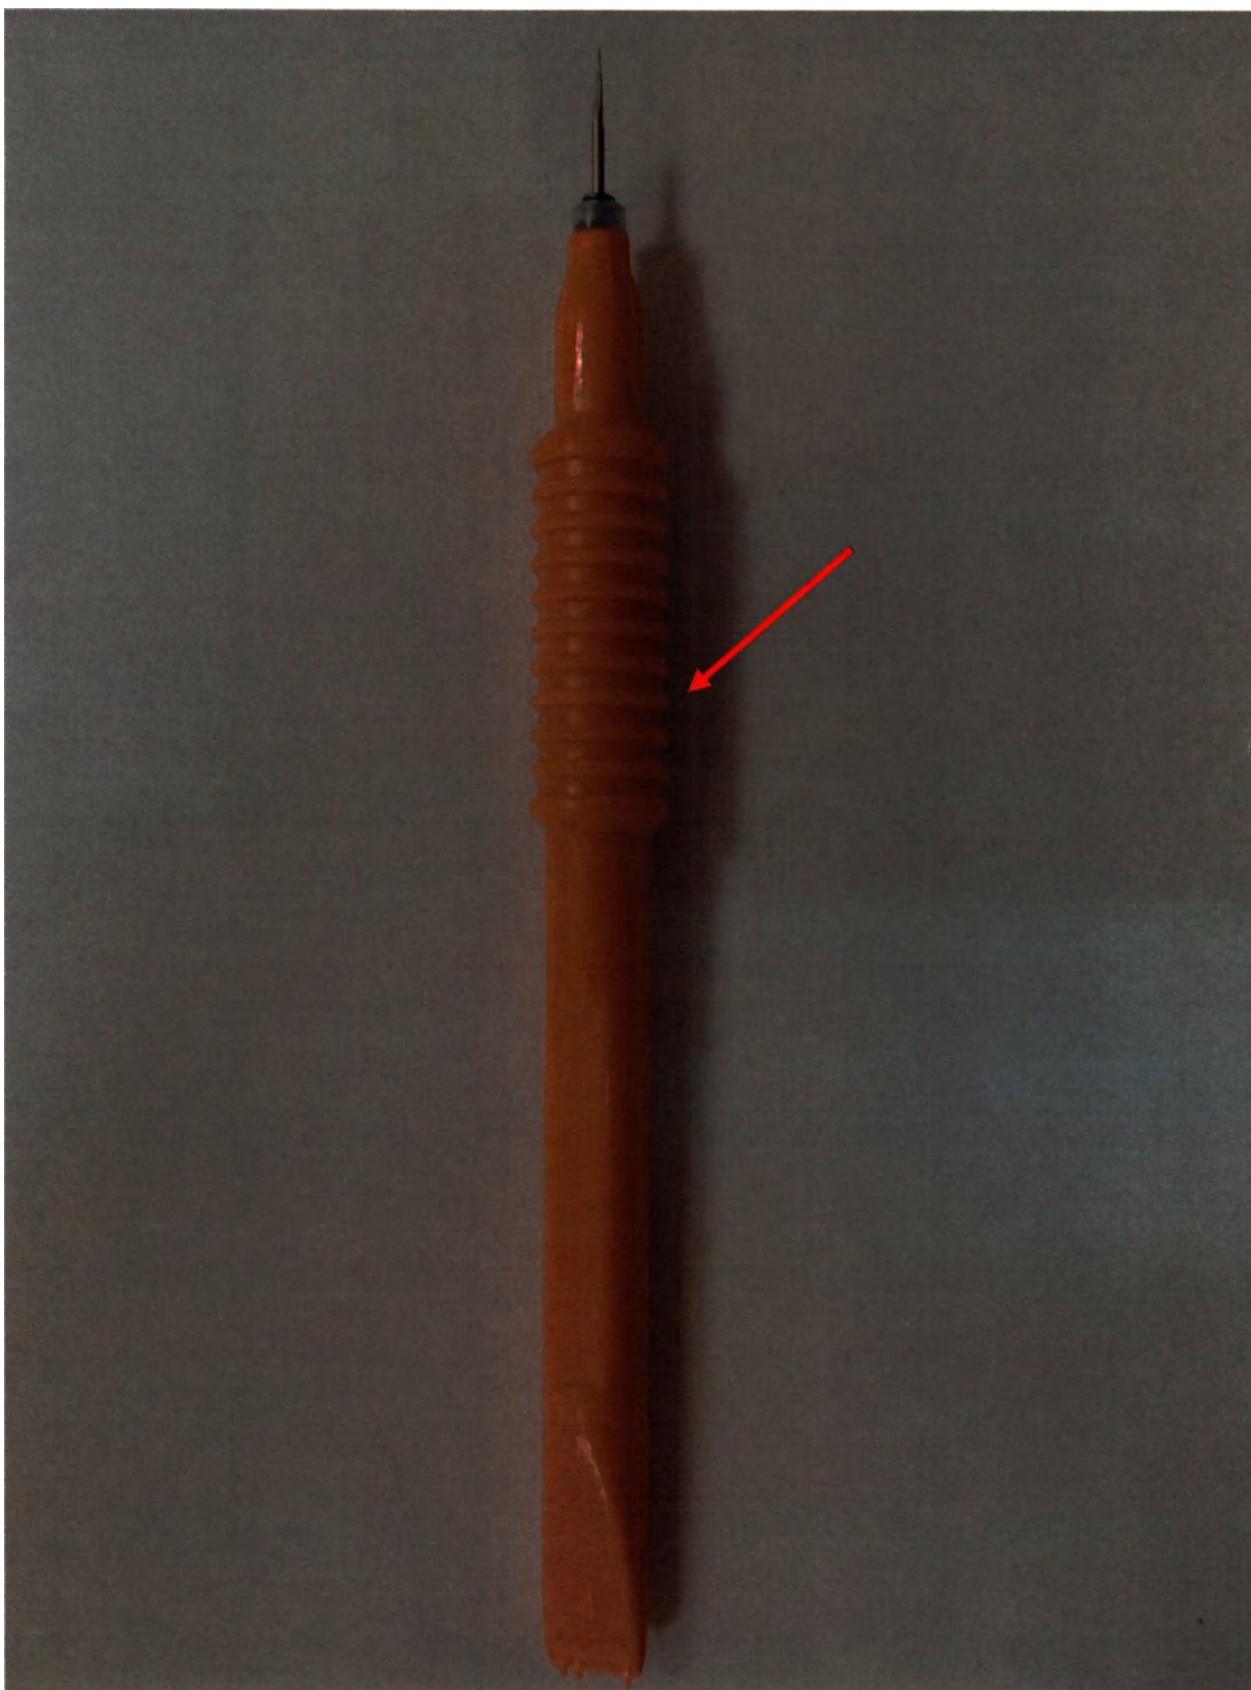


Рисунок 31 – Ручка



Рисунок 32 – Лезвие.



Рисунок 33 – Порт.

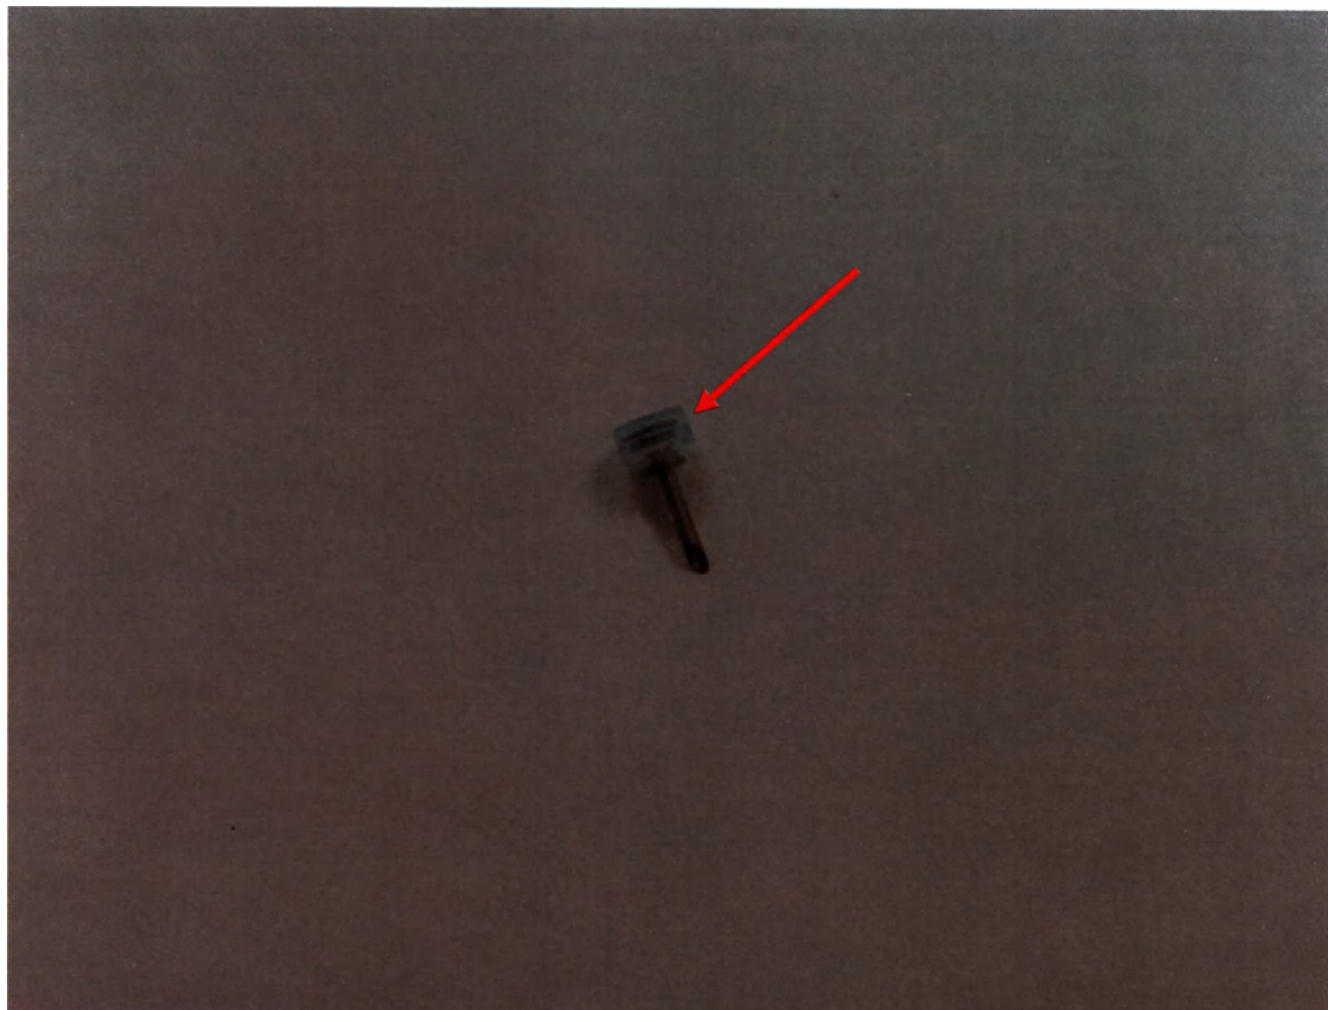


Рисунок 34 – Силиконовый клапан.



Рисунок 35 – Транспортная упаковка.

Прошито, пронумеровано

19
двадцать лист (а/ов)

Скреплено печатью.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
МАКАРОВА Н.В.