

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«13» февраля 2024 г.


М.П.



Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ТТГ» для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ, TSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-227-65614693-2022»


Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп., Реагент для разведения образцов (R3), 4,0 мл/уп.)

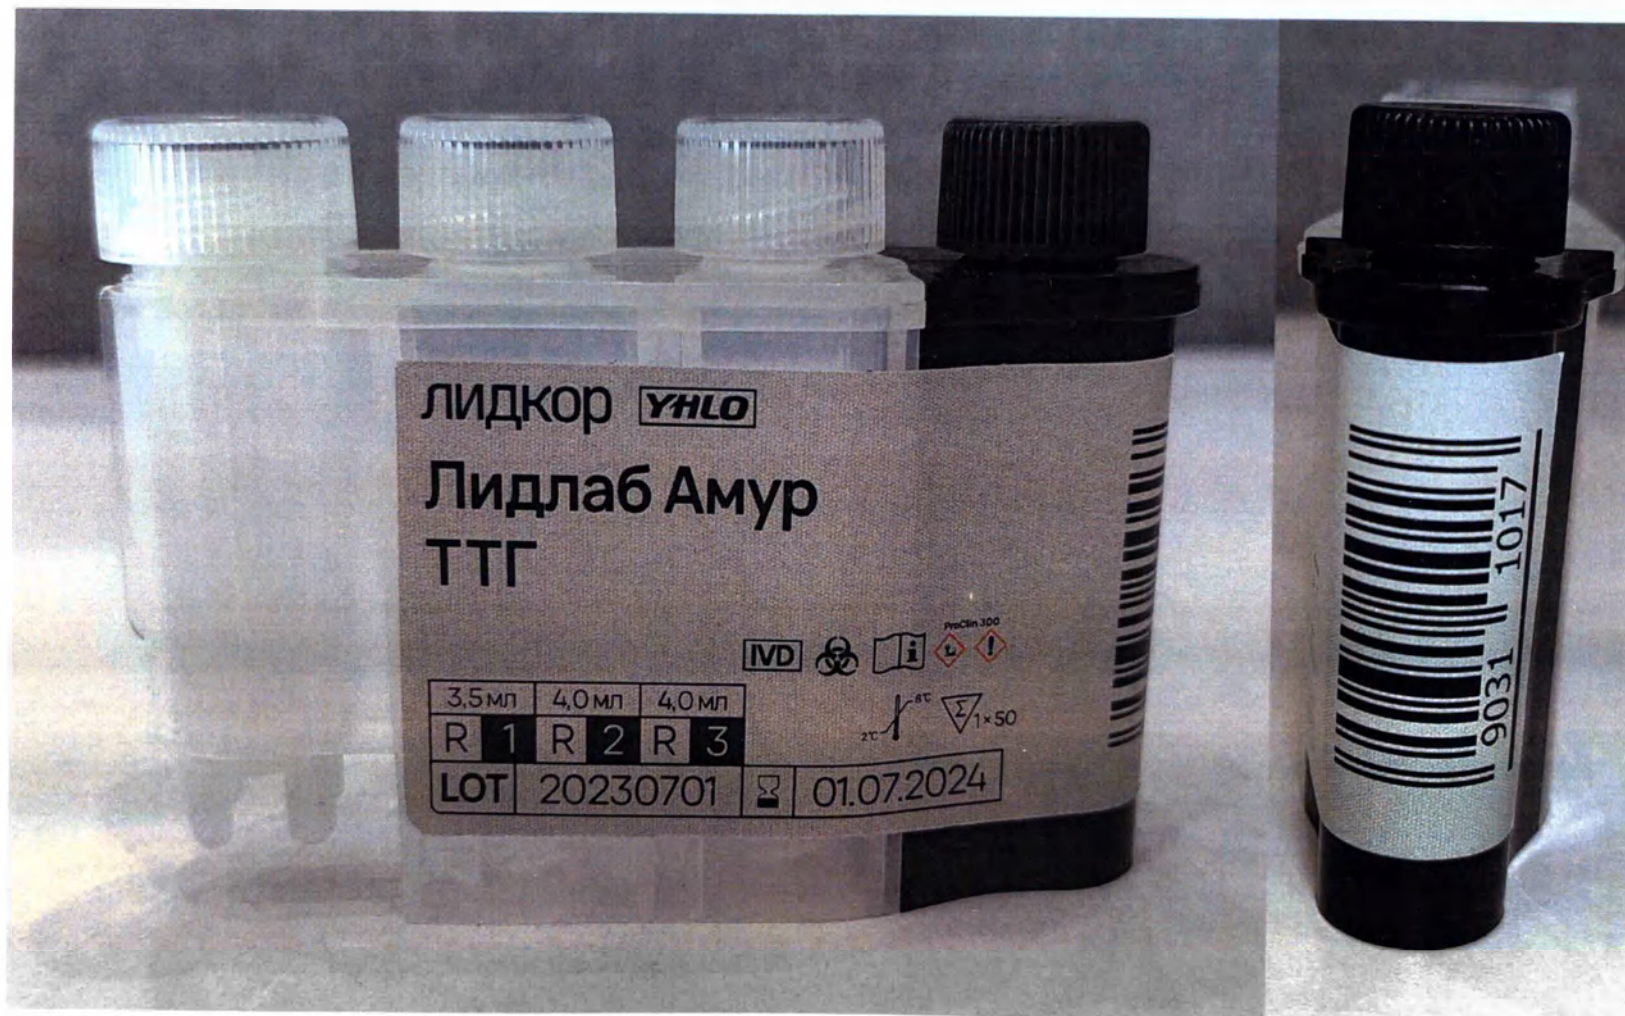


Пароизоляционные крышки




Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон

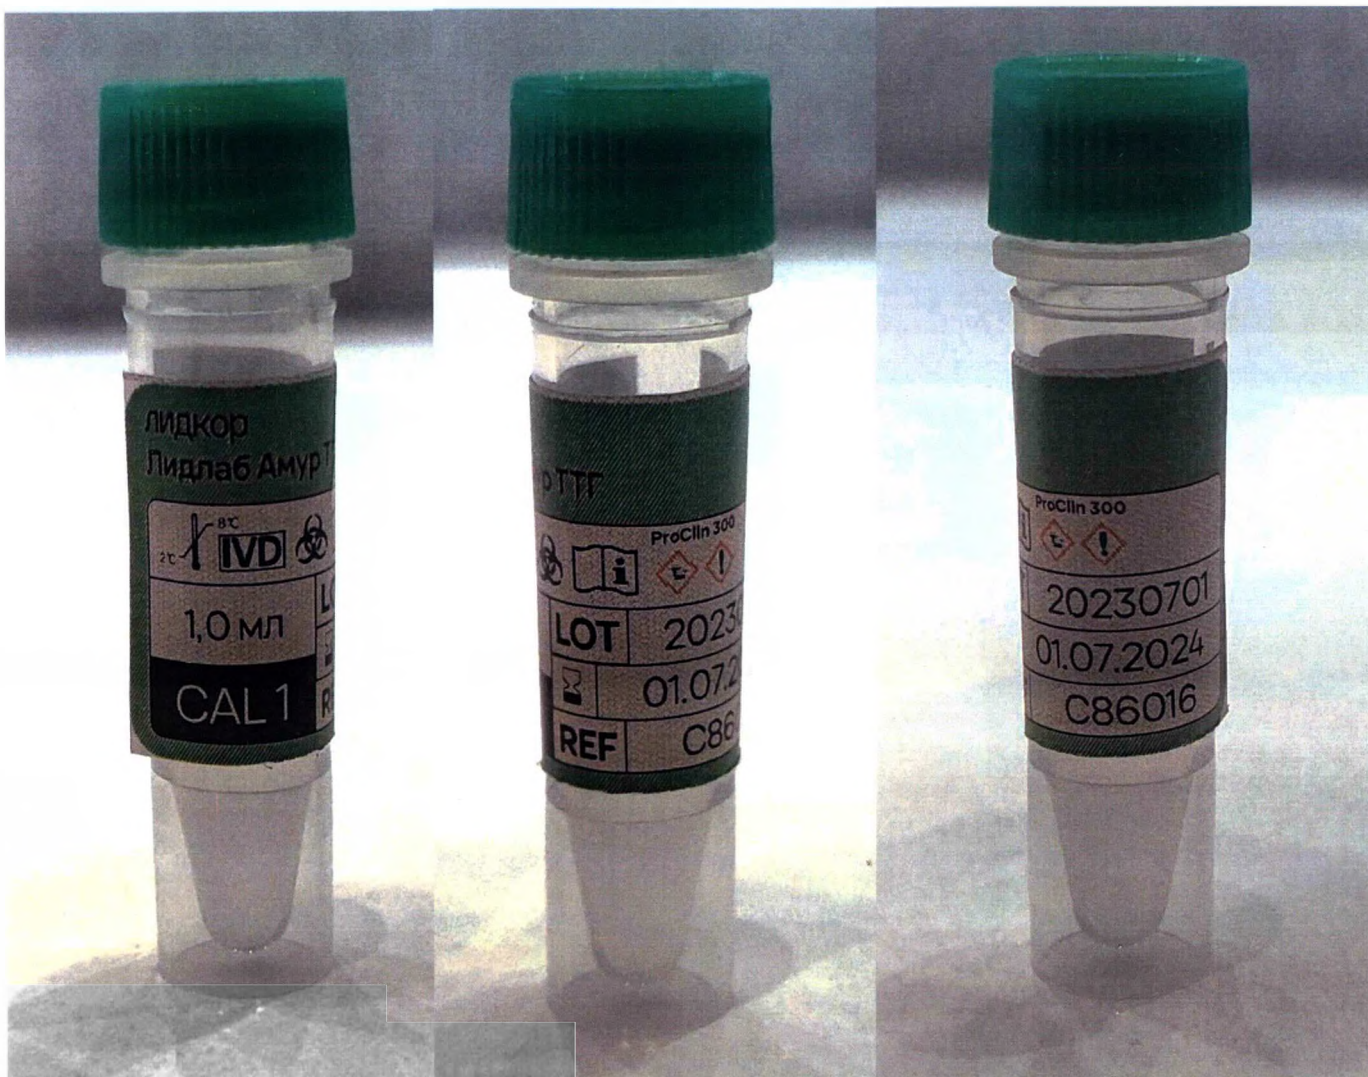

Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон

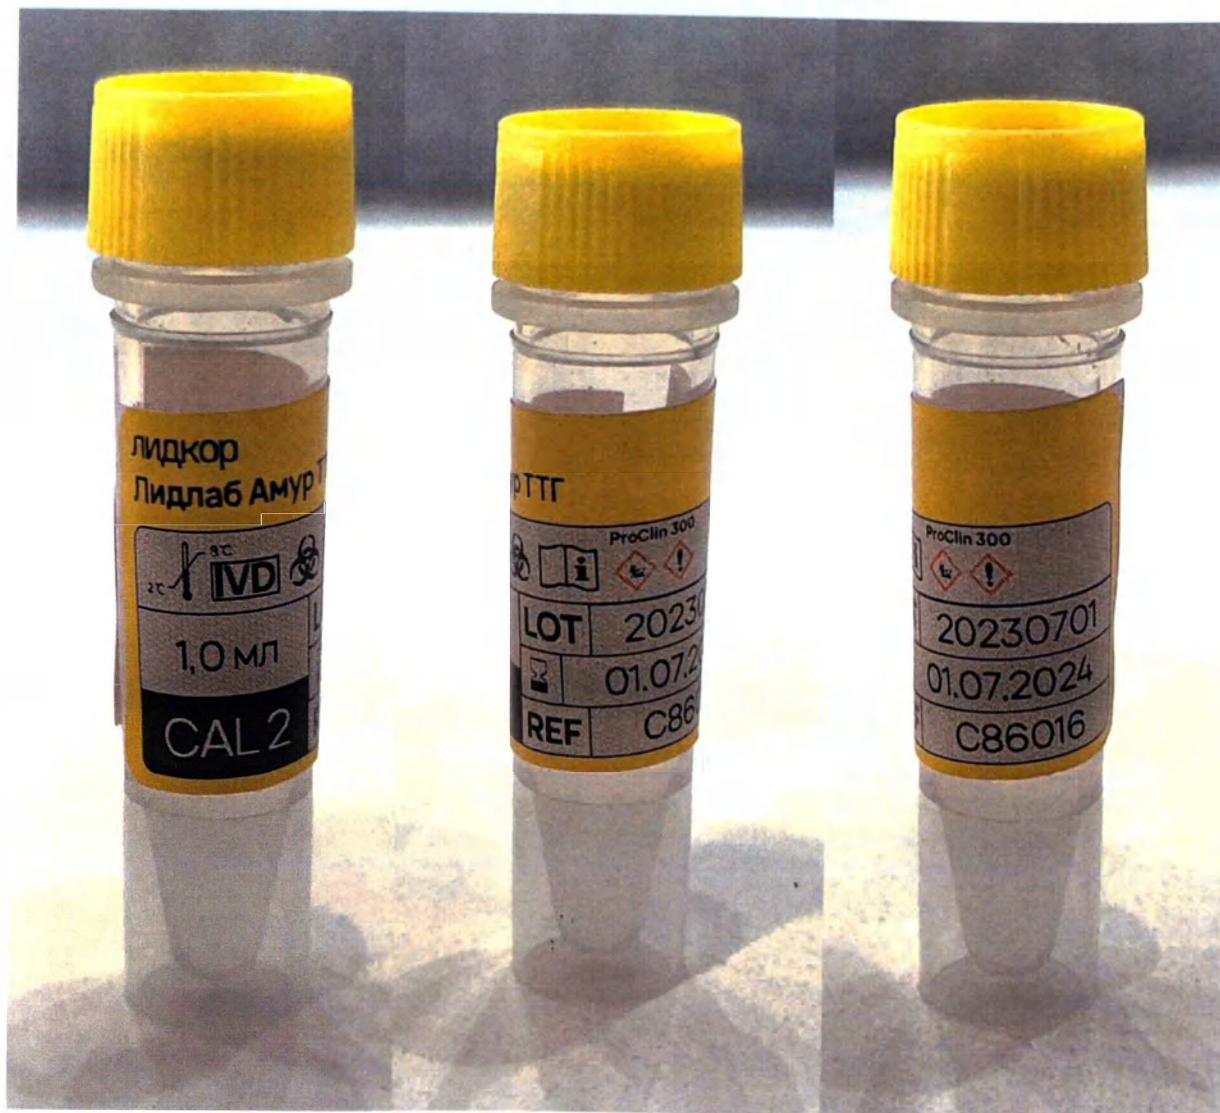


Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон

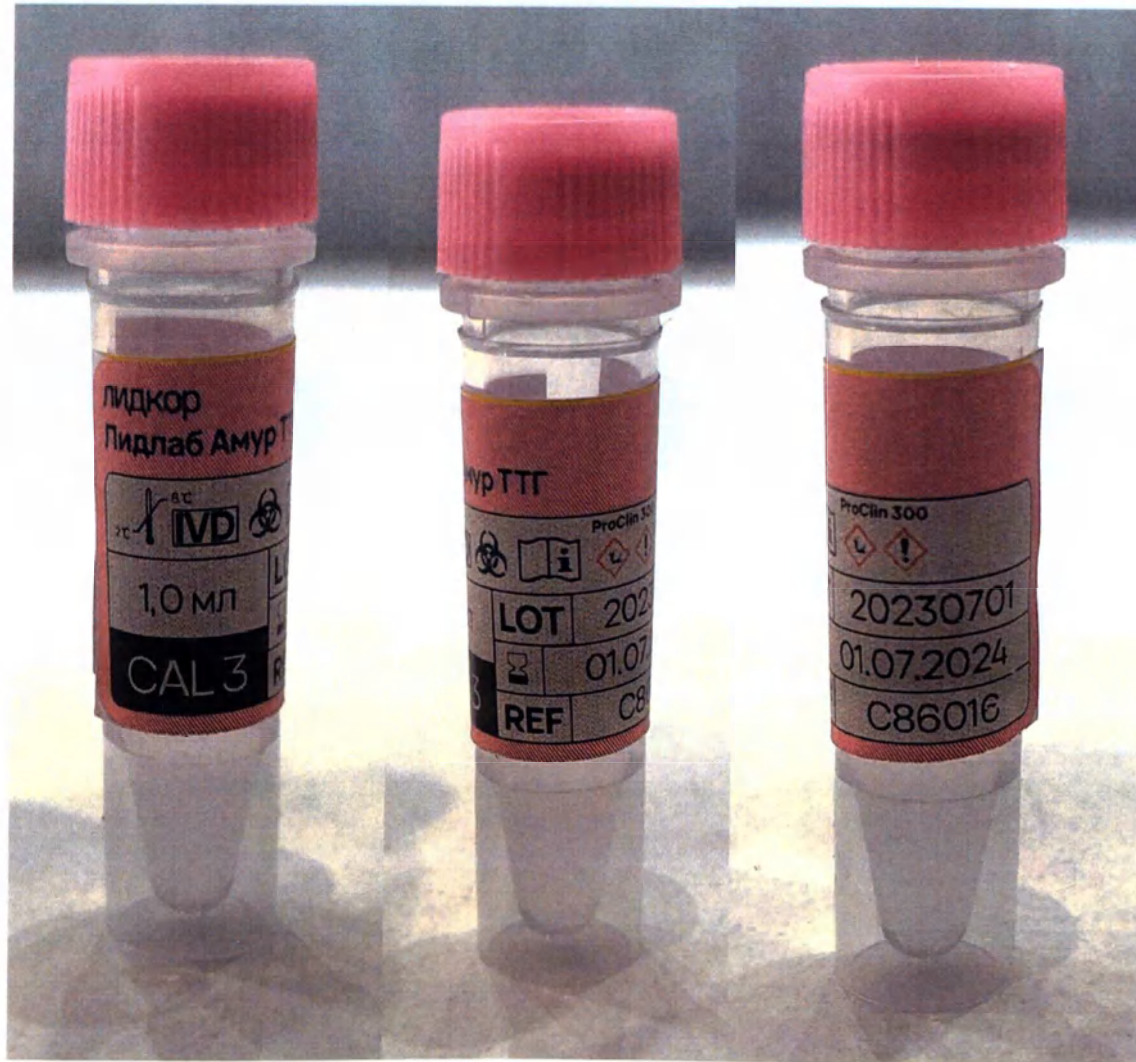

Потребительская упаковка



Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)

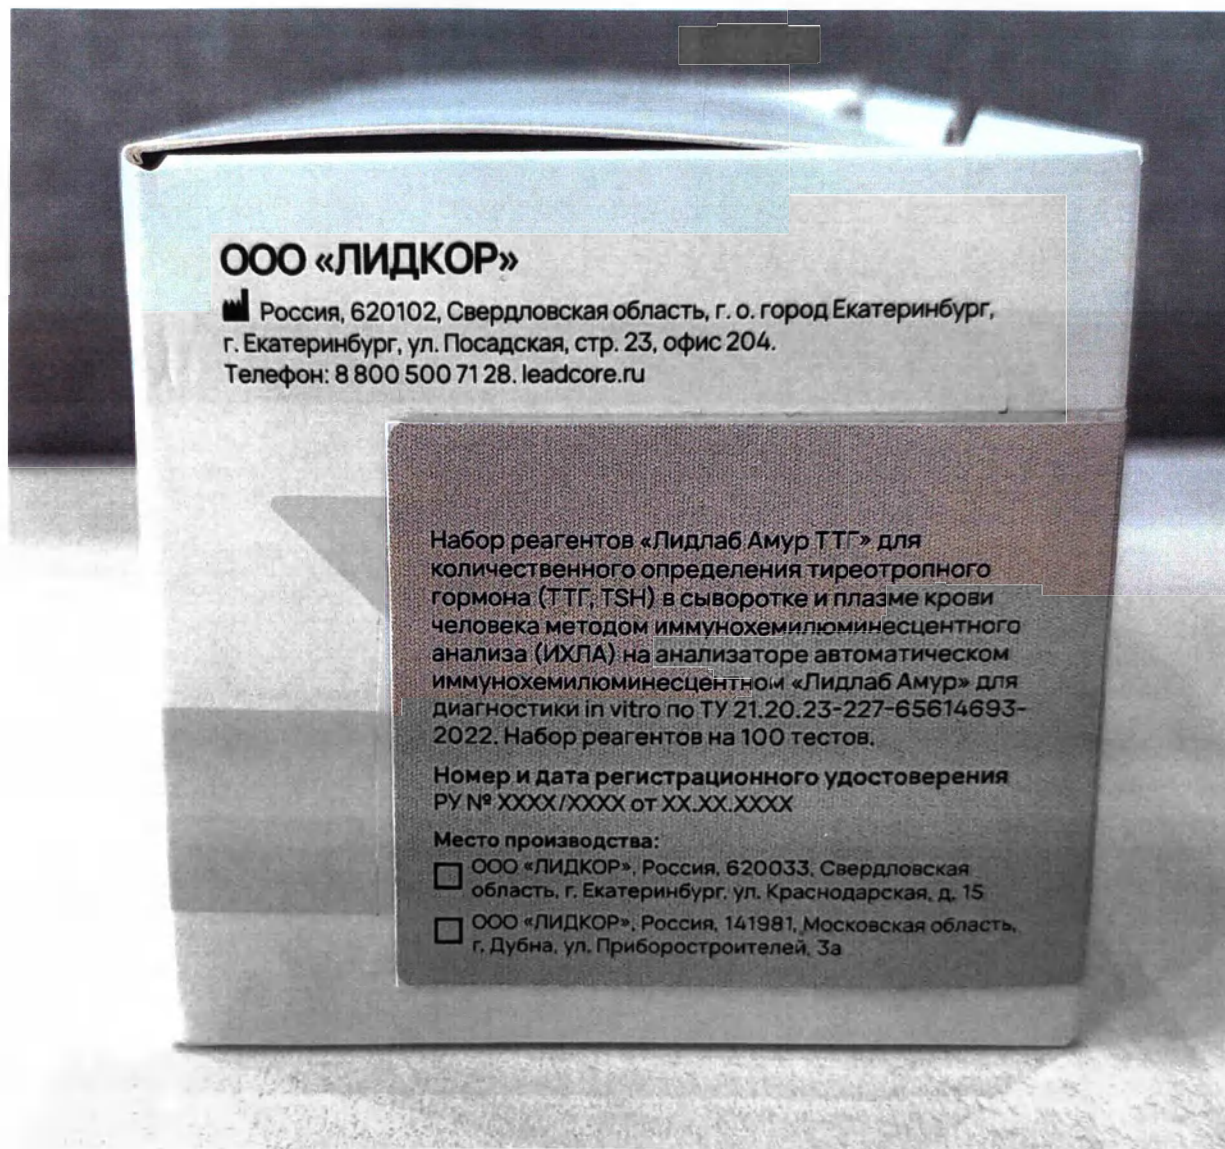

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТТГ» для
количественного определения тиреотропного
гормона (ТТГ, TSH) в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-227-65614693-
2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)

лидлаб



Лидлаб Амур ТТГ

Набор реагентов на 200 тестов

YNLO

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп. Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп. Реагент для разведения образцов (R3), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.



01.07.2023

LOT	20230701	01.07.2024	REF	C86016
-----	----------	------------	-----	--------

Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)

ООО «ЛИДКОР»

620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 7128. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТТГ» для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ, TSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-227-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, За


Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)

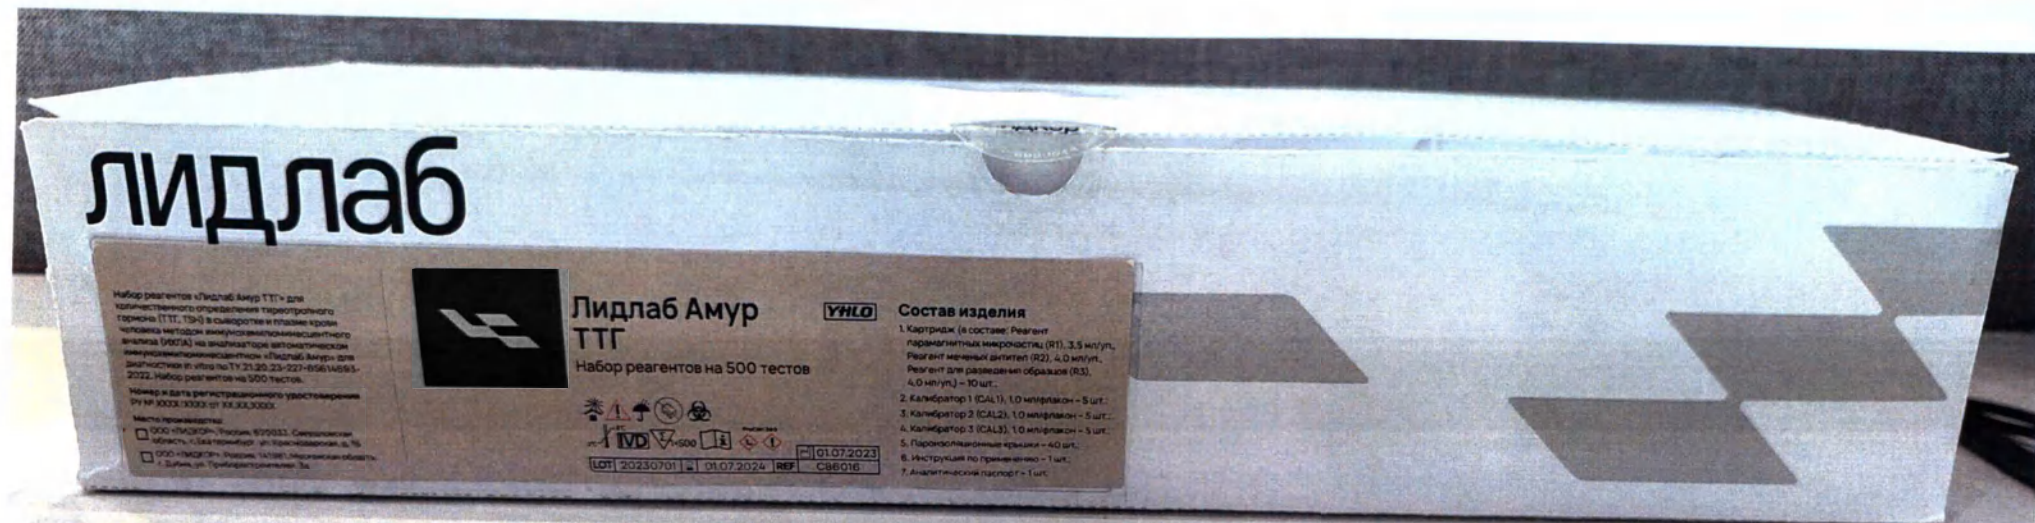

Потребительская упаковка 500 тестов (вид спереди)

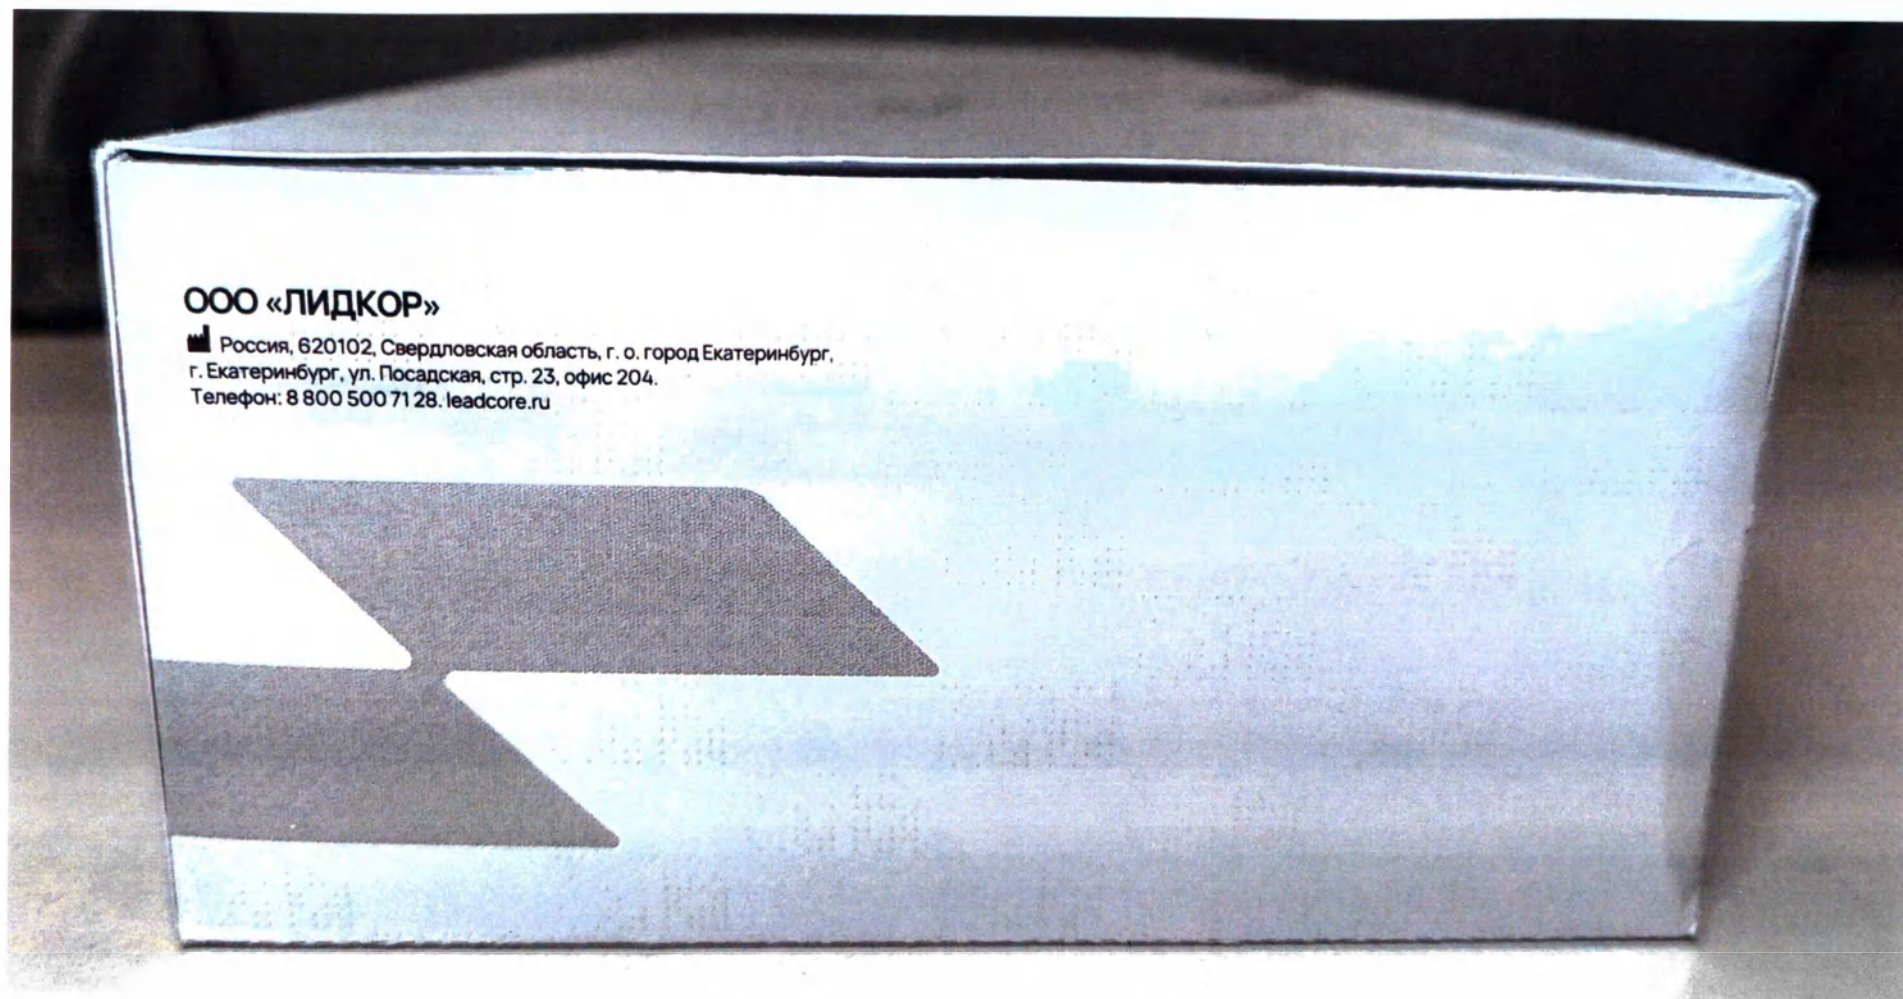

Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)

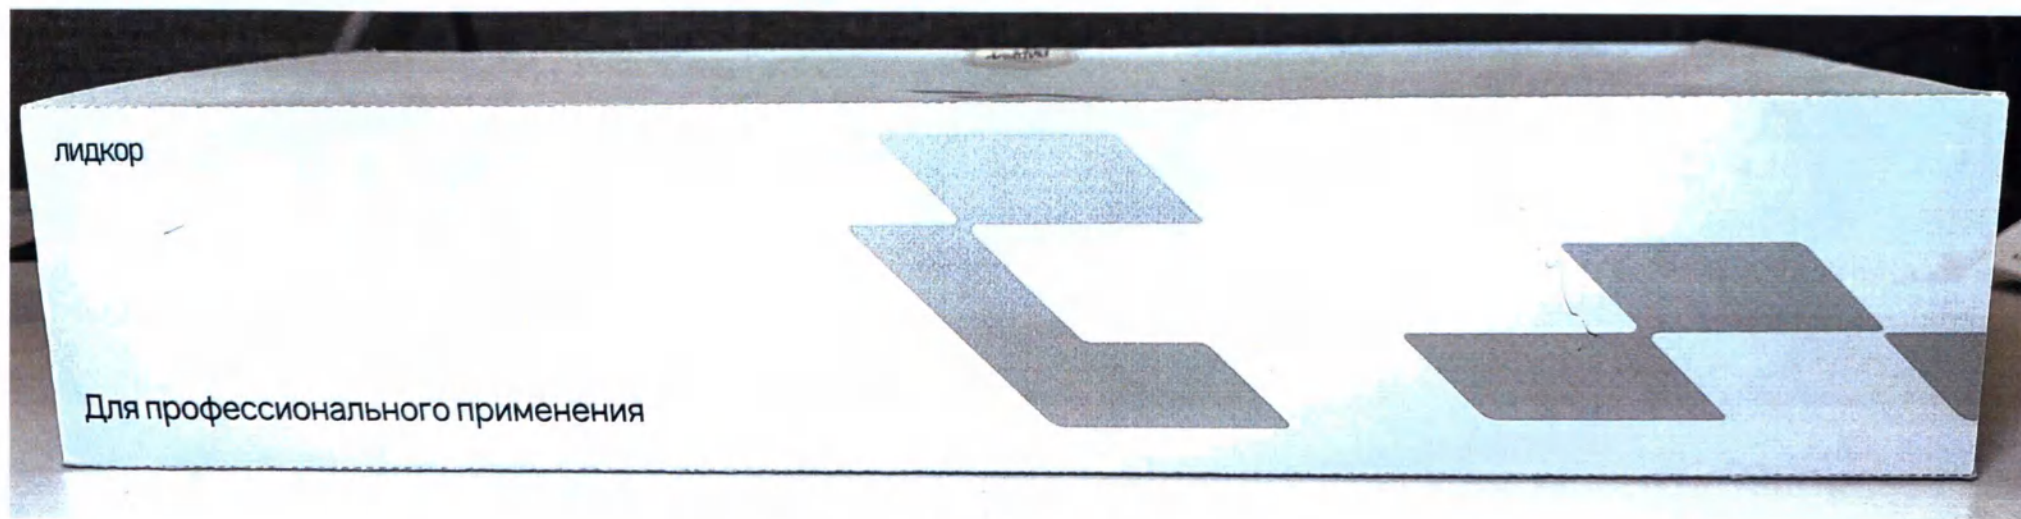

Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)

лидлаб

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТТГ» для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ, TSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-227-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX.


Место производства:
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, За



**Лидлаб Амур
ТТГ**

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO



Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 10 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТТГ» для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ, TSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-227-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX.

Место производства:


☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, За



**Лидлаб Амур
ТТГ**

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO




Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 10 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Потребительская упаковка 1000 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)

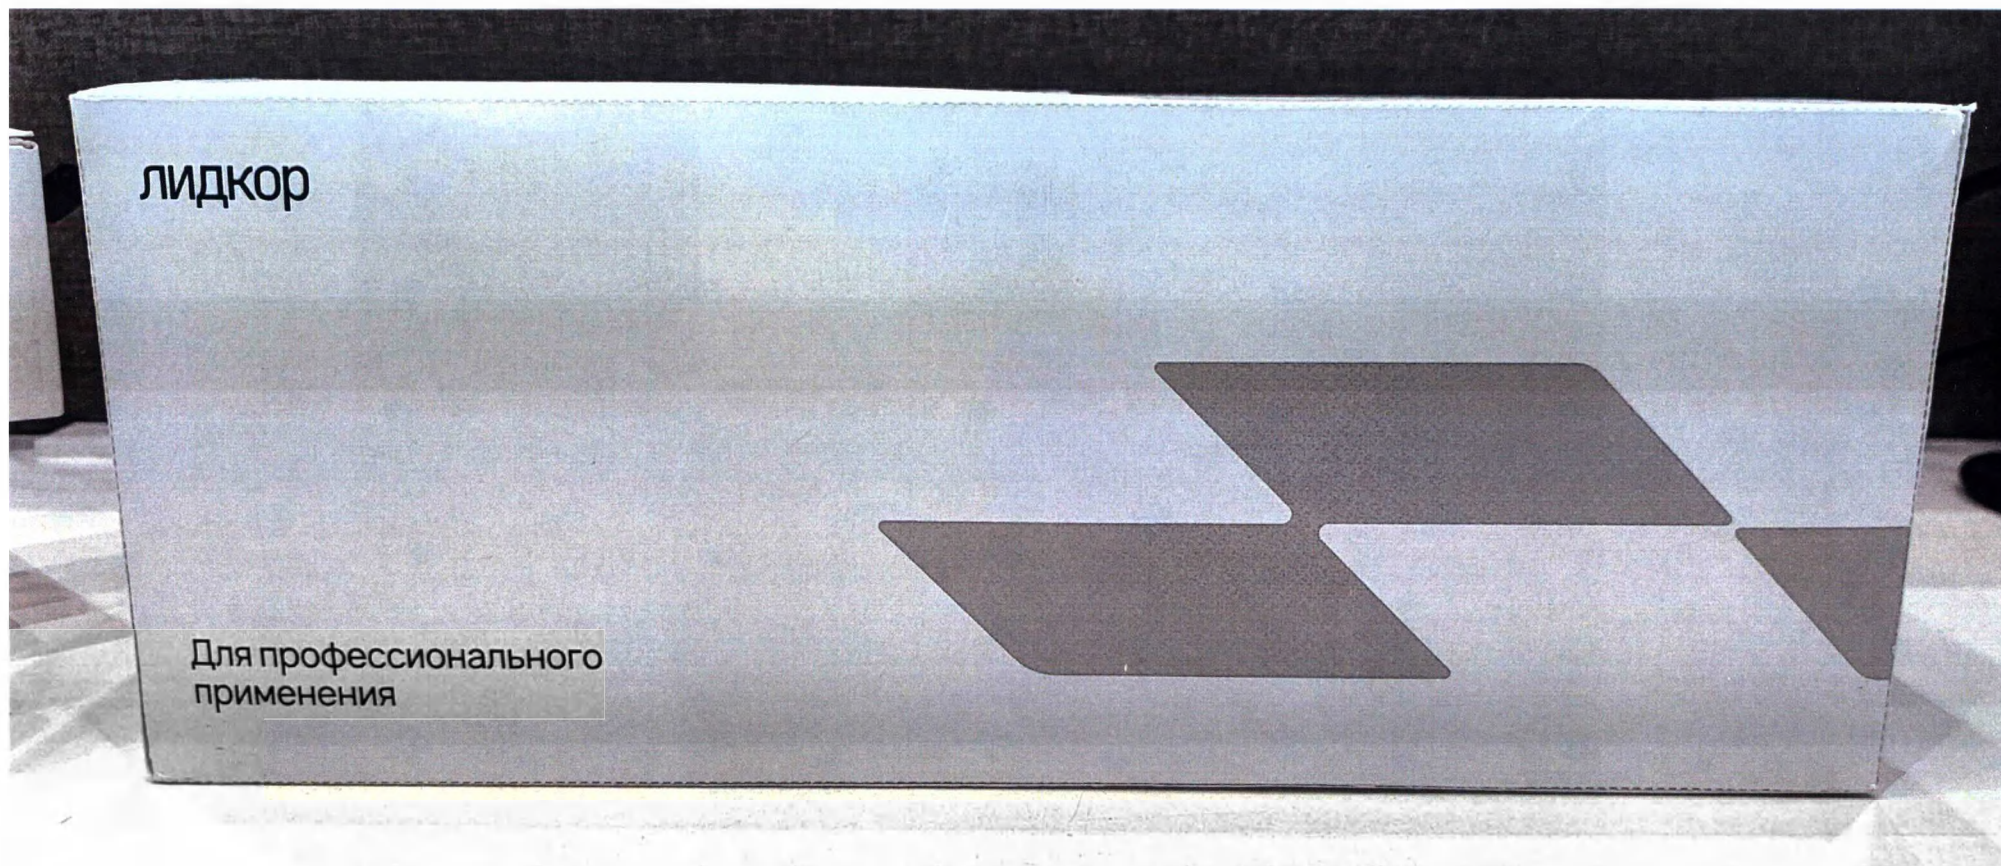

Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)



Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.

Групповое фото.




Транспортная упаковка





Набор реагентов «Лидлаб Амур ТТГ» для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ, TSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-227-65614693-2022



IVD

Σ 200



Proclin 300



Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023	
LOT	20230701	01.07.2024	REF	C86016	





Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

24 (двадцать четыре) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»



/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут


«01» июля 2023 г.




МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ТТГ» для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ, TSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-227-65614693-2022»

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.,
 Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп., Реагент для разведения образцов
 (R3), 4,0 мл/уп.)

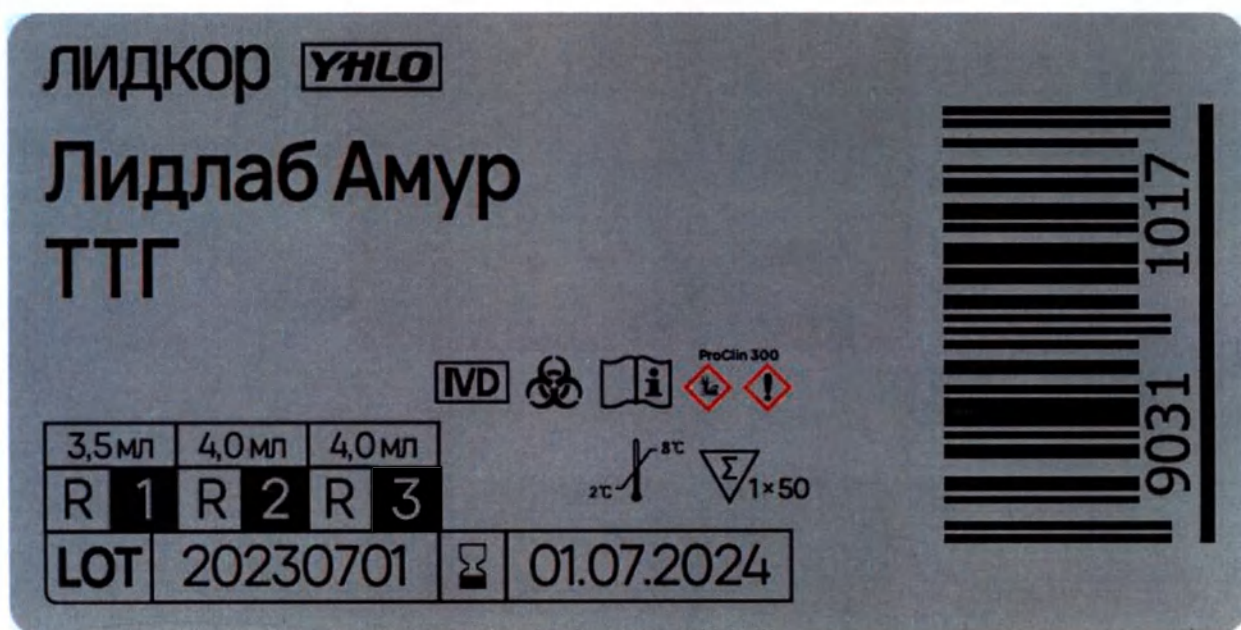


Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон

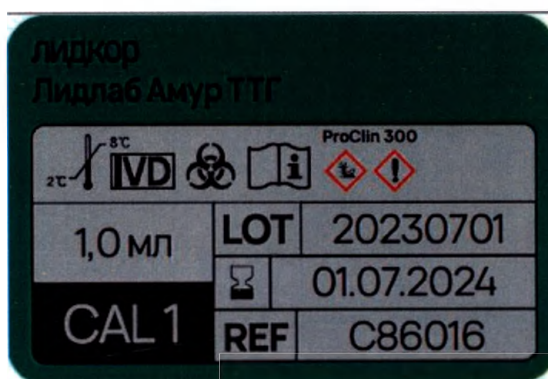

Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон



Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон

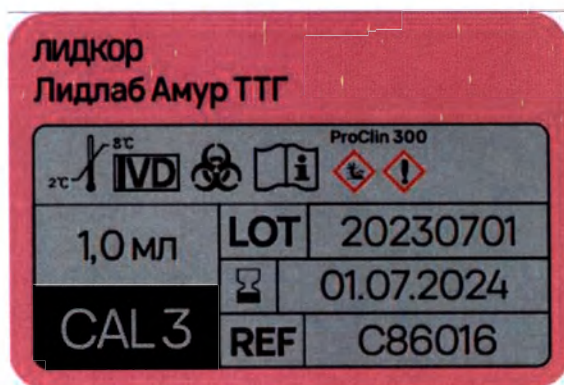

Пароизоляционные крышки



QR-code



Наклейка



Потребительская упаковка

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТТГ» для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ, TSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилуминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилуминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-227-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



**Лидлаб Амур
ТТГ**

Набор реагентов на 100 тестов



Ресурсы 300

01.07.2023

LOT 20230701 01.07.2024 REF C86016

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп., Реагент для разведения образцов (R3), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.

2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.

3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.

4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 1 шт.

5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.

6. Инструкция по применению – 1 шт.

7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТТГ» для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ, TSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилуминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилуминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-227-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



**Лидлаб Амур
ТТГ**

Набор реагентов на 200 тестов



Ресурсы 300

01.07.2023

LOT 20230701 01.07.2024 REF C86016

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп., Реагент для разведения образцов (R3), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.

2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.

3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.

4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.

5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.

6. Инструкция по применению – 1 шт.

7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТТГ» для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ, TSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилуминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилуминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-227-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



**Лидлаб Амур
ТТГ**

Набор реагентов на 500 тестов



Ресурсы 300

01.07.2023

LOT 20230701 01.07.2024 REF C86016

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп., Реагент для разведения образцов (R3), 4,0 мл/уп.) – 10 шт.

2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.


3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.

4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 5 шт.


5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.

6. Инструкция по применению – 1 шт.


7. Аналитический паспорт – 1 шт.

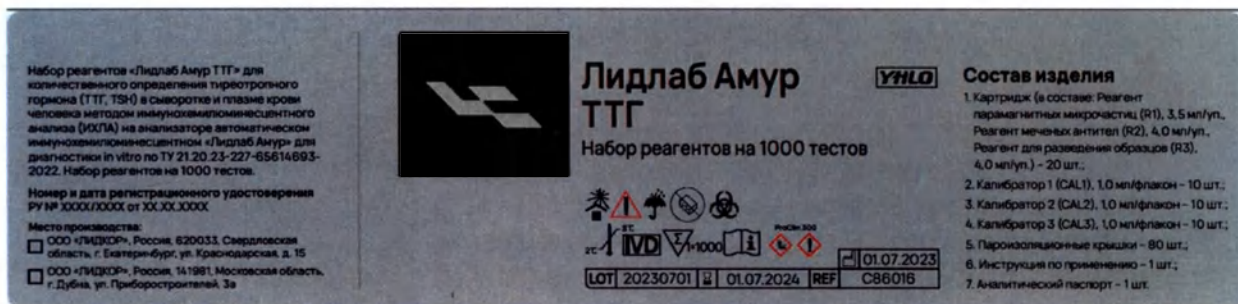


Потребительская коробка

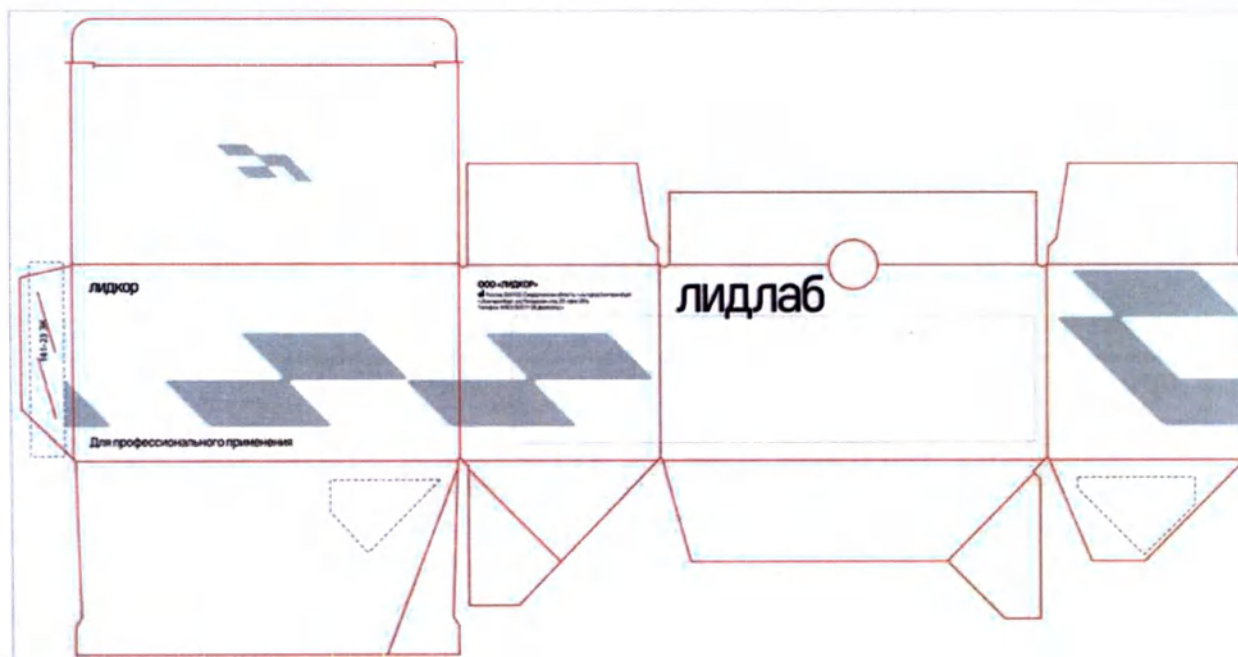

Транспортная упаковка

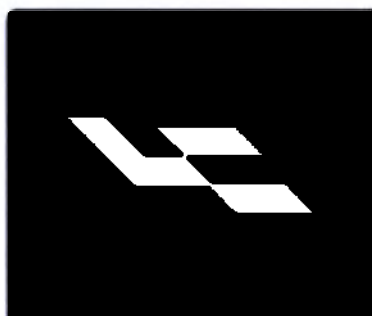

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТТГ» для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ, TSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-227-65614693-2022

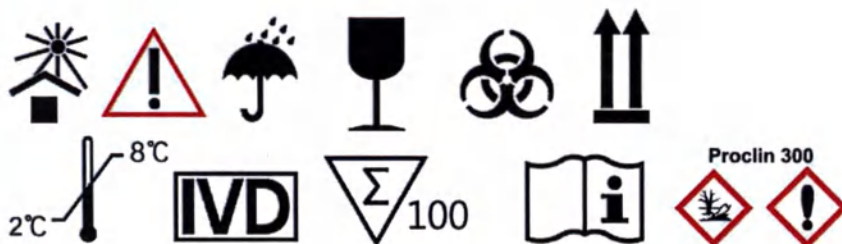

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86016




Набор реагентов «Лидлаб Амур ТТГ» для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ, TSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-227-65614693-2022




Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86016

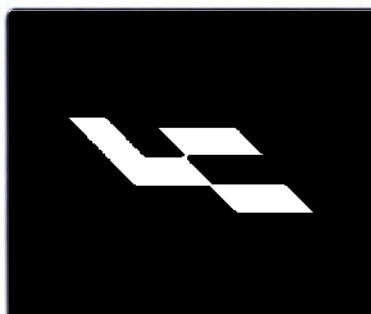


Набор реагентов «Лидлаб Амур ТТГ» для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ, TSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-227-65614693-2022

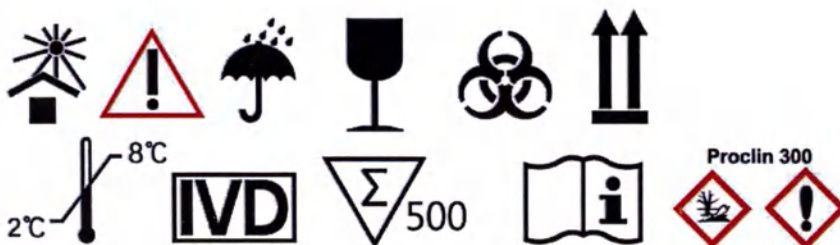

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024
REF	C86016		

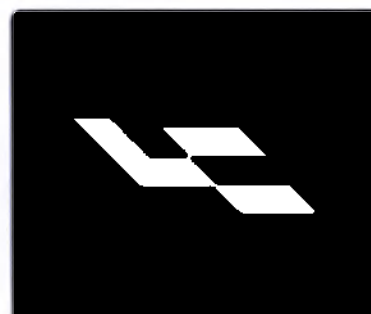

Набор реагентов «Лидлаб Амур ТТГ» для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ, TSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-227-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024
REF	C86016		

КОПИЯ
ВЕРНА

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (семь) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

