

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«25» декабря 2023 г.


М.П.




Фотографические изображения общего вида

**«Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 19-9» для количественного определения
ракового антигена 19-9 (СА 19-9) в сыворотке и плазме крови человека
методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе
автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-220-65614693-2022»**


Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)

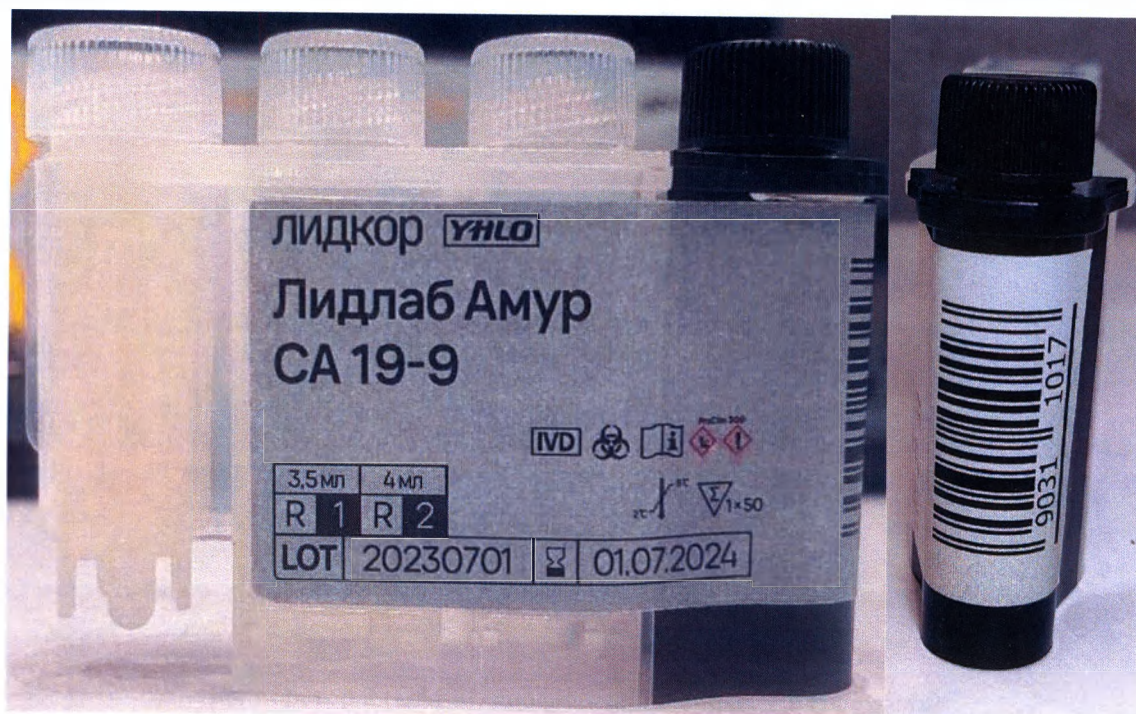


Пароизоляционные крышки

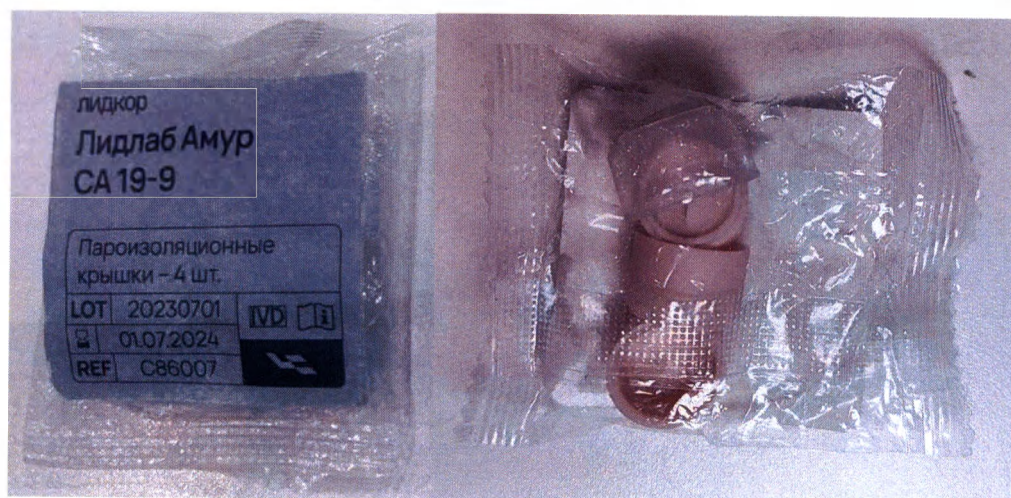

Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

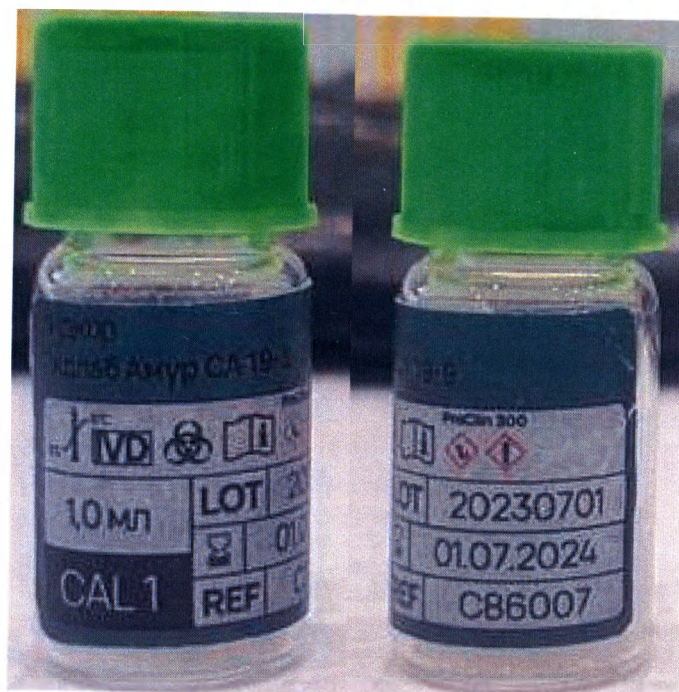

Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

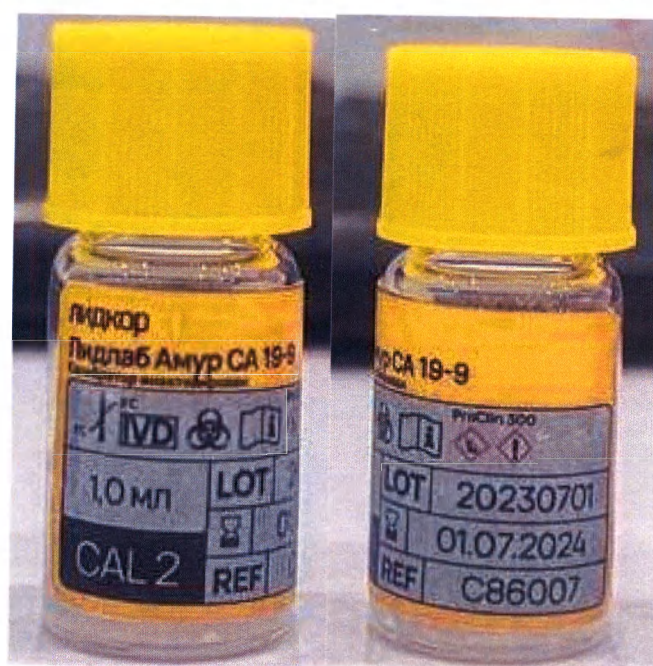

Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон



Потребительская упаковка



Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 19-9»
для количественного определения ракового
антигена 19-9 (СА 19-9) в сыворотке и плазме
человека методом иммунохемилюминесцентного
анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-220-65614693-
2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела
к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а


Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)

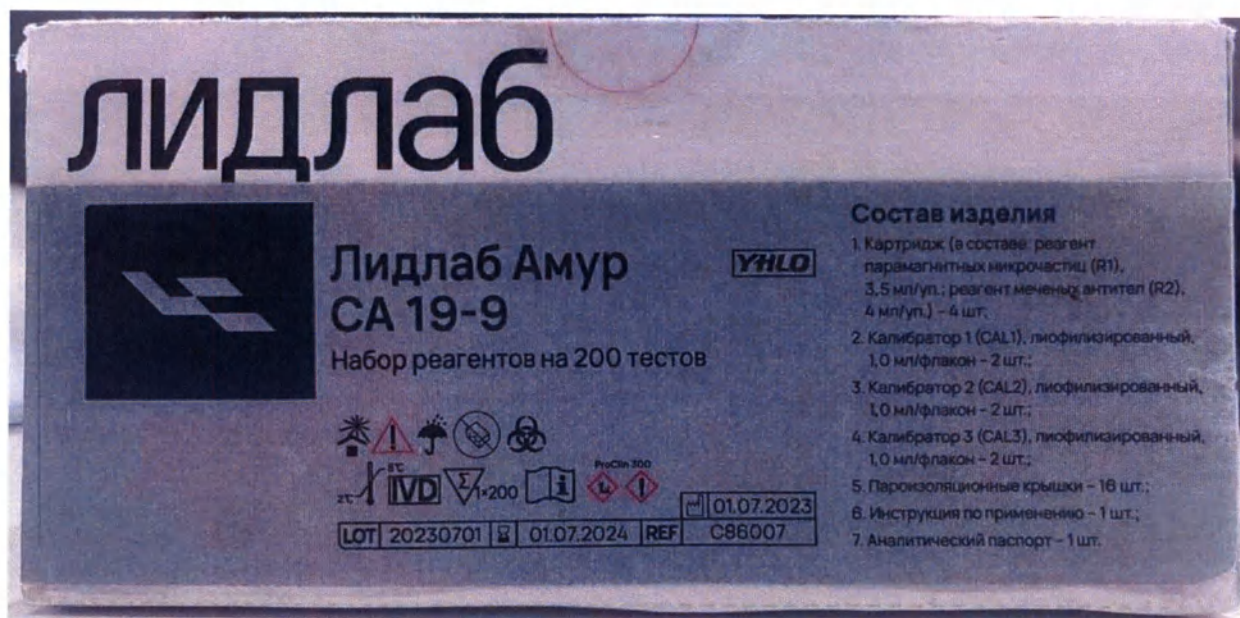

Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)

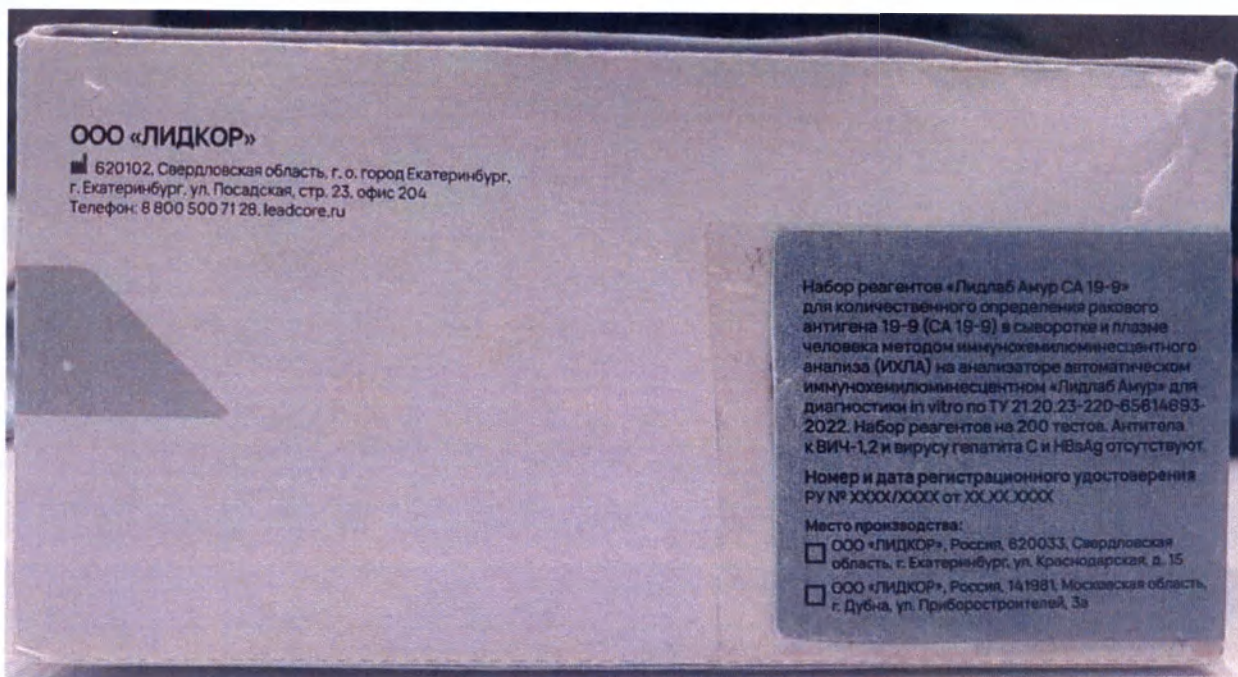


Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)



Потребительская упаковка 500 тестов (вид спереди)

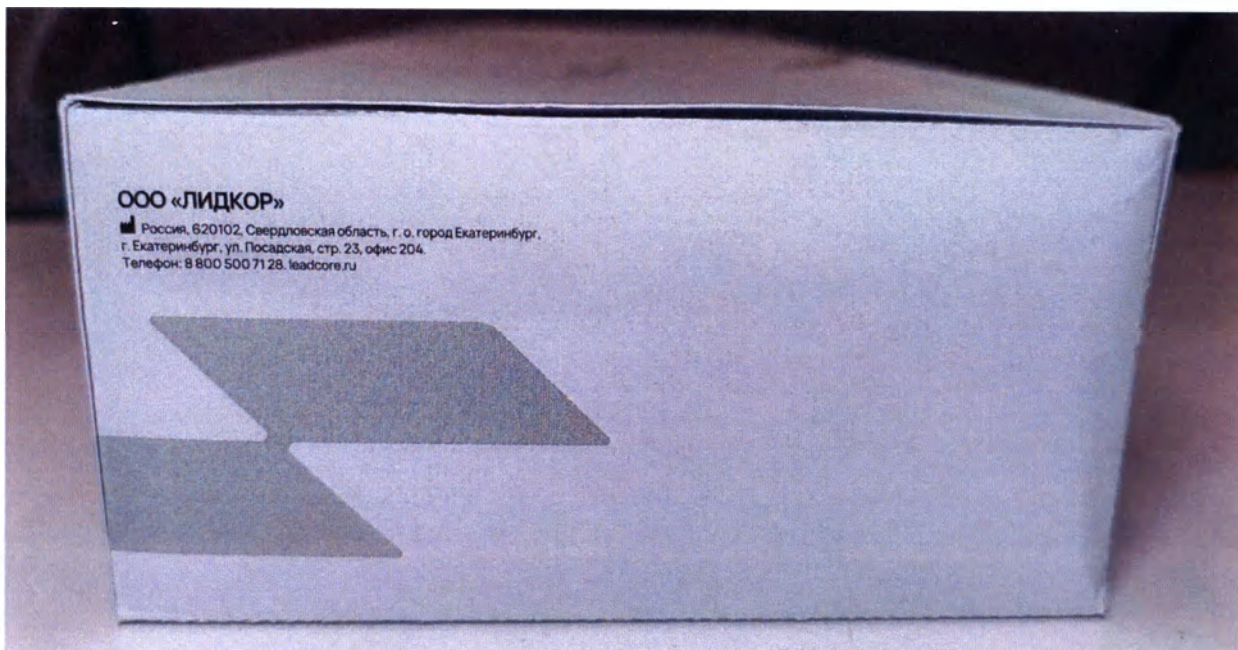

Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)

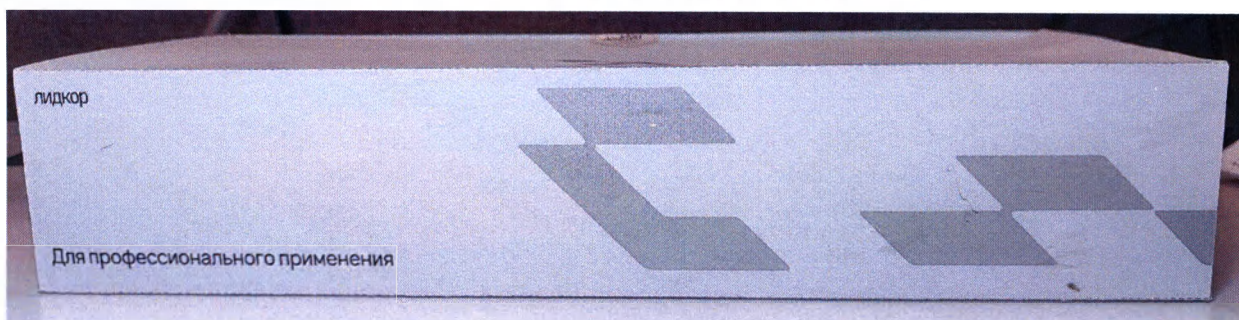


Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)




Потребительская упаковка 1000 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)

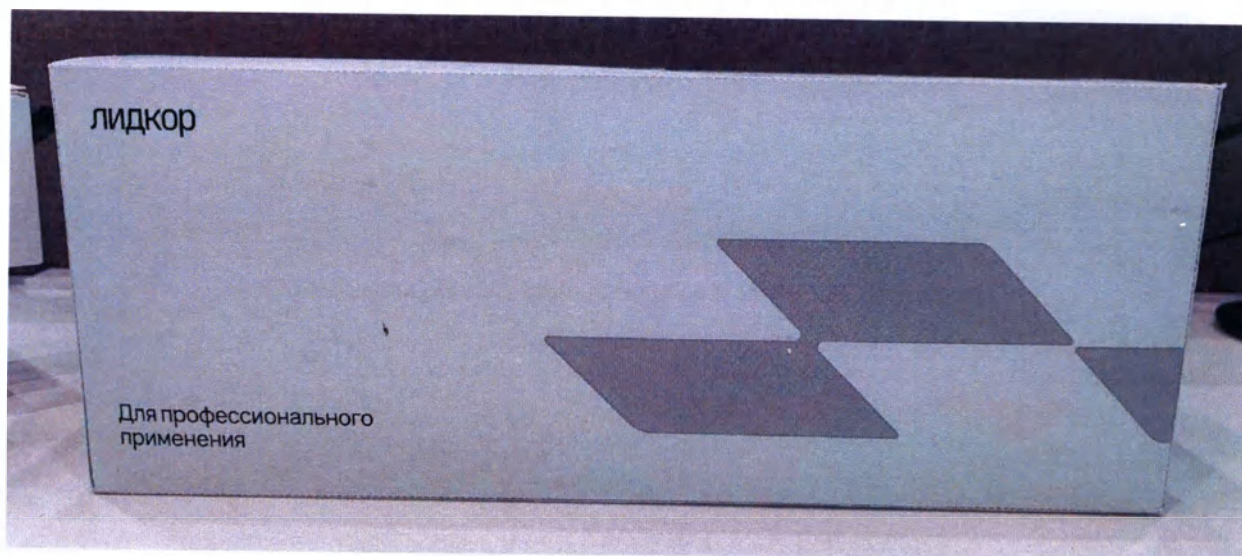

Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)

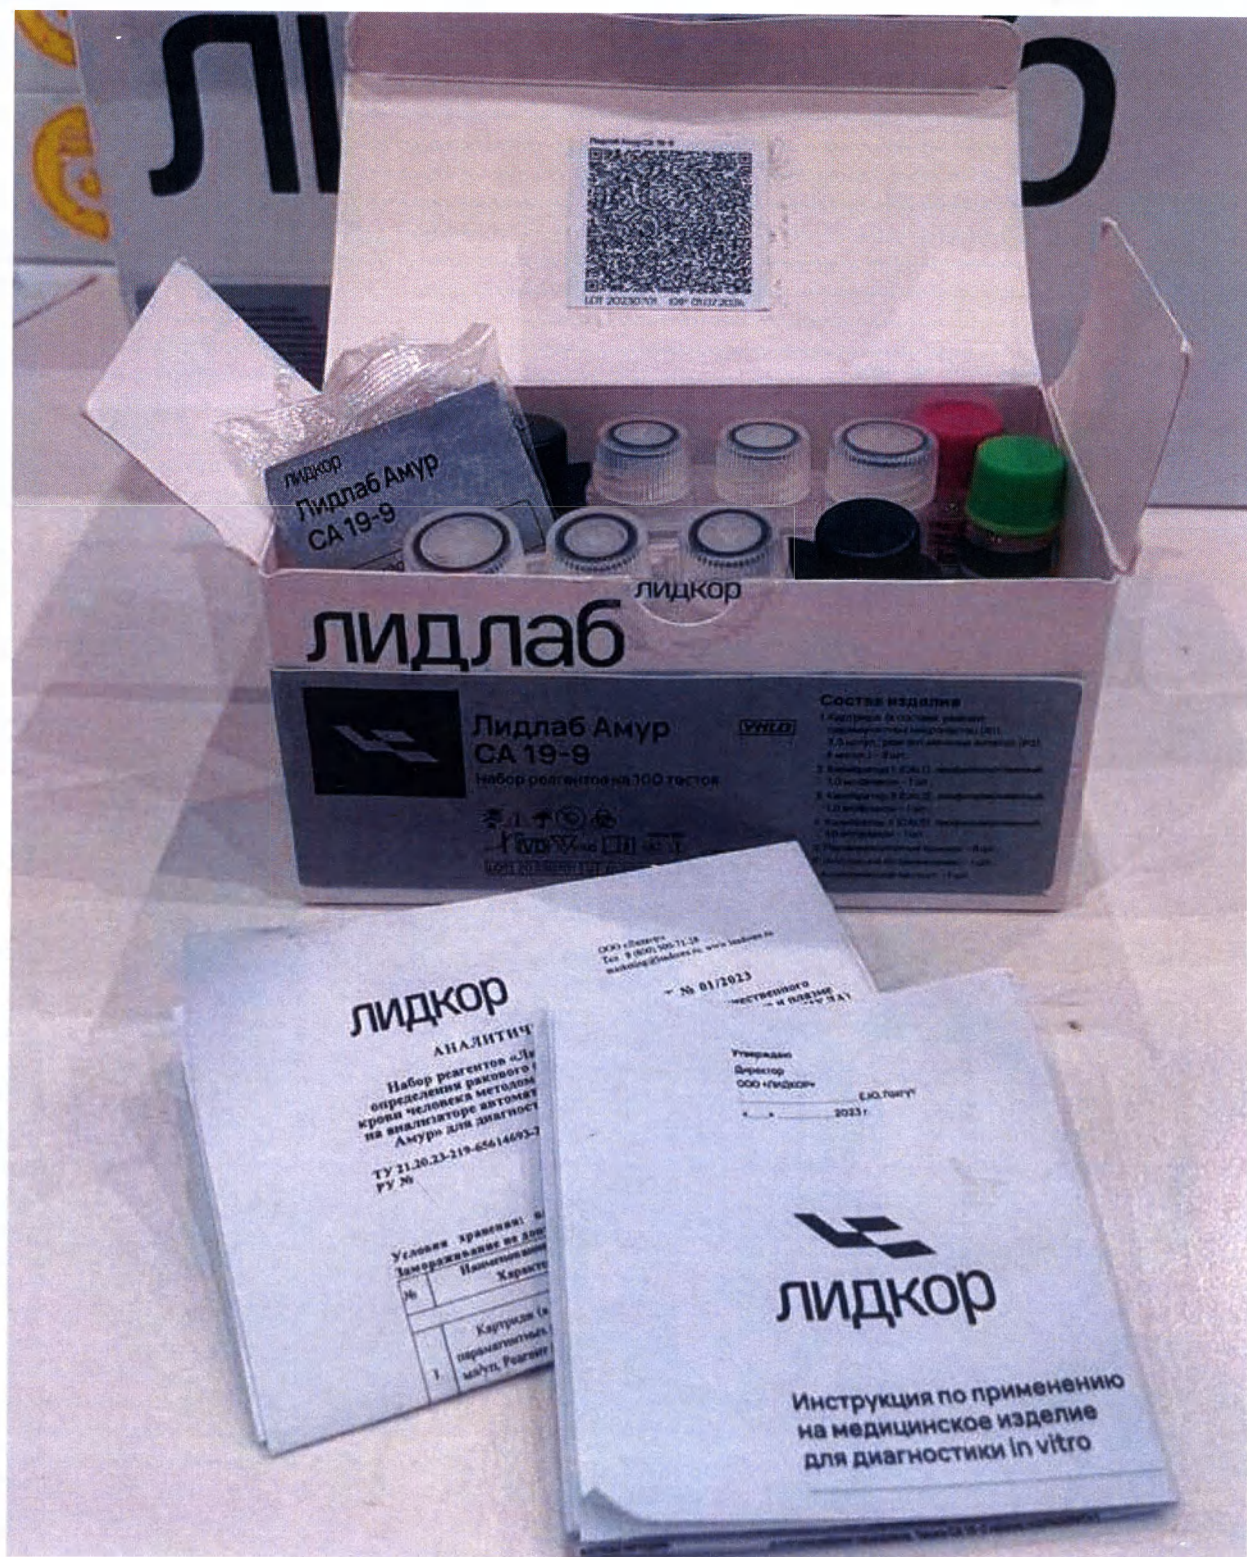

Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.



Групповое фото.

Транспортная упаковка





Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

13 (тринадцать) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



КОПИЯ
ВЕРНА

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"



Е.Ю. Гохгут


«25» декабря 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 19-9» для количественного определения
ракового антигена 19-9 (СА 19-9) в сыворотке и плазме крови человека
методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе
автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-220-65614693-2022»

Картридж (в составе: реагент парамагнитных частиц (R1), 3,5 мл/уп; реагент меченных антител (R2), 4,0 мл/уп.)

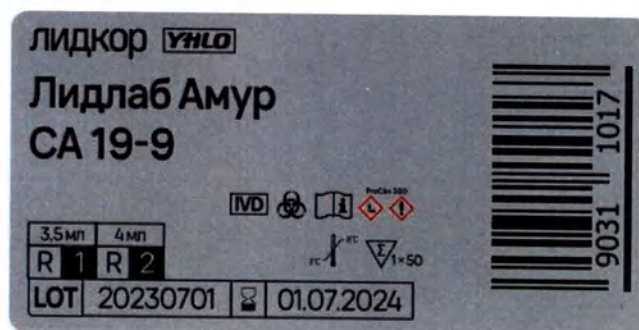

Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный



Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный



Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный



Пароизоляционные крышки



QR-code



Наклейка



Потребительская упаковка

Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 19-9» для количественного определения ракового антигена 19-9 (СА 19-9) в сыворотке и плазме человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-220-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВРЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HbSAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроительная, 3а





Лидлаб Амур СА 19-9

Набор реагентов на 100 тестов








Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) – 2 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.


Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 19-9» для количественного определения ракового антигена 19-9 (СА 19-9) в сыворотке и плазме человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-220-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВРЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HbSAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроительная, 3а





Лидлаб Амур СА 19-9

Набор реагентов на 200 тестов








Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 19-9» для количественного определения ракового антигена 19-9 (СА 19-9) в сыворотке и плазме человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-220-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВРЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HbSAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроительная, 3а





Лидлаб Амур СА 19-9

Набор реагентов на 500 тестов








Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) – 10 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.


Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 19-9» для количественного определения ракового антигена 19-9 (СА 19-9) в сыворотке и плазме человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-220-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВРЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HbSAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроительная, 3а





Лидлаб Амур СА 19-9

Набор реагентов на 1000 тестов









Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) – 20 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.


Потребительская коробка

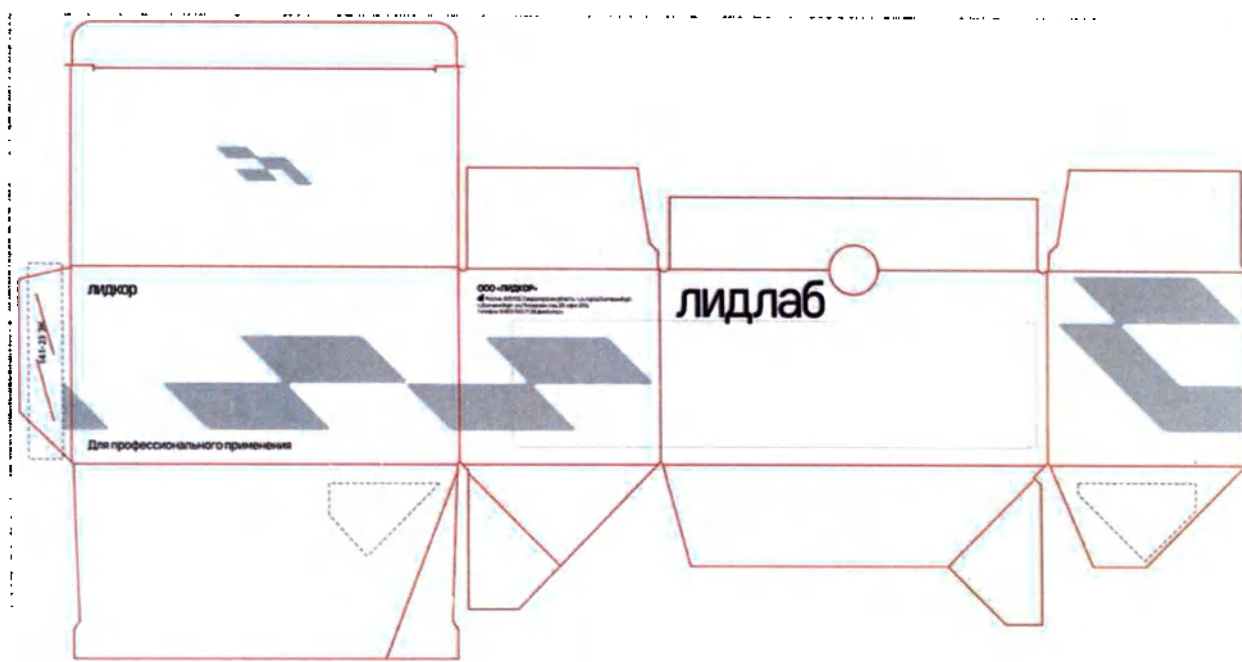

Транспортная упаковка



Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 19-9» для количественного определения ракового антигена 19-9 (СА 19-9) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-220-65614693-2022

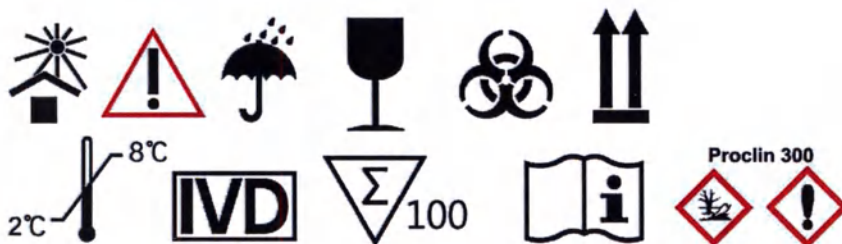

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C86007




Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 19-9» для количественного определения ракового антигена 19-9 (СА 19-9) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-220-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C86007

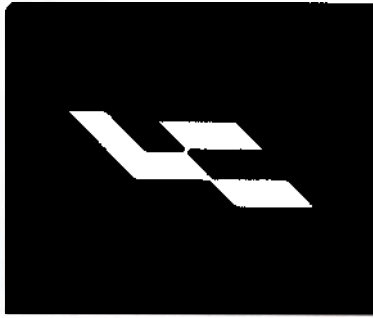


Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 19-9» для количественного определения ракового антигена 19-9 (СА 19-9) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-220-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C86007

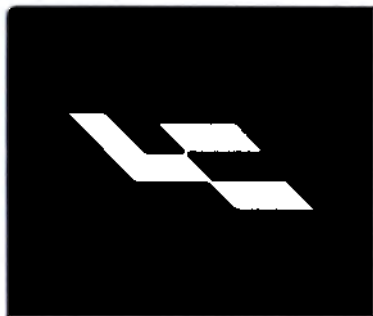

Набор реагентов «Лидлаб Амур СА 19-9» для количественного определения ракового антигена 19-9 (СА 19-9) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-220-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C86007

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (семь) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

