



GE Healthcare

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, дом 10,
Помещ. I, этаж 14, ком. 30

Т: +7 495 739 6931

Ф: +7 495 739 6932

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента
Регистрации и Сертификации
Россия и СНГ

«28» июля 2022 года



 Харитонов А.П.
подпись/печать

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с
принадлежностями»,**

производства

GE Medical Systems Information Technologies, Inc. /

ДжиИ Медикал Системз Информейшн Технолоджиз, Инк., США



Фото 1.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»: 1. Системная тележка,

4. Персональный компьютер с частотой 2 ГГц и более (встроен в системную тележку),
 000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
 Принадлежности: 1. ЖК Монитор.



Фото 2.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»: 1. Системная тележка (маркировка).



Фото 3.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru ;жности: 1. ЖК Монитор (маркировка).

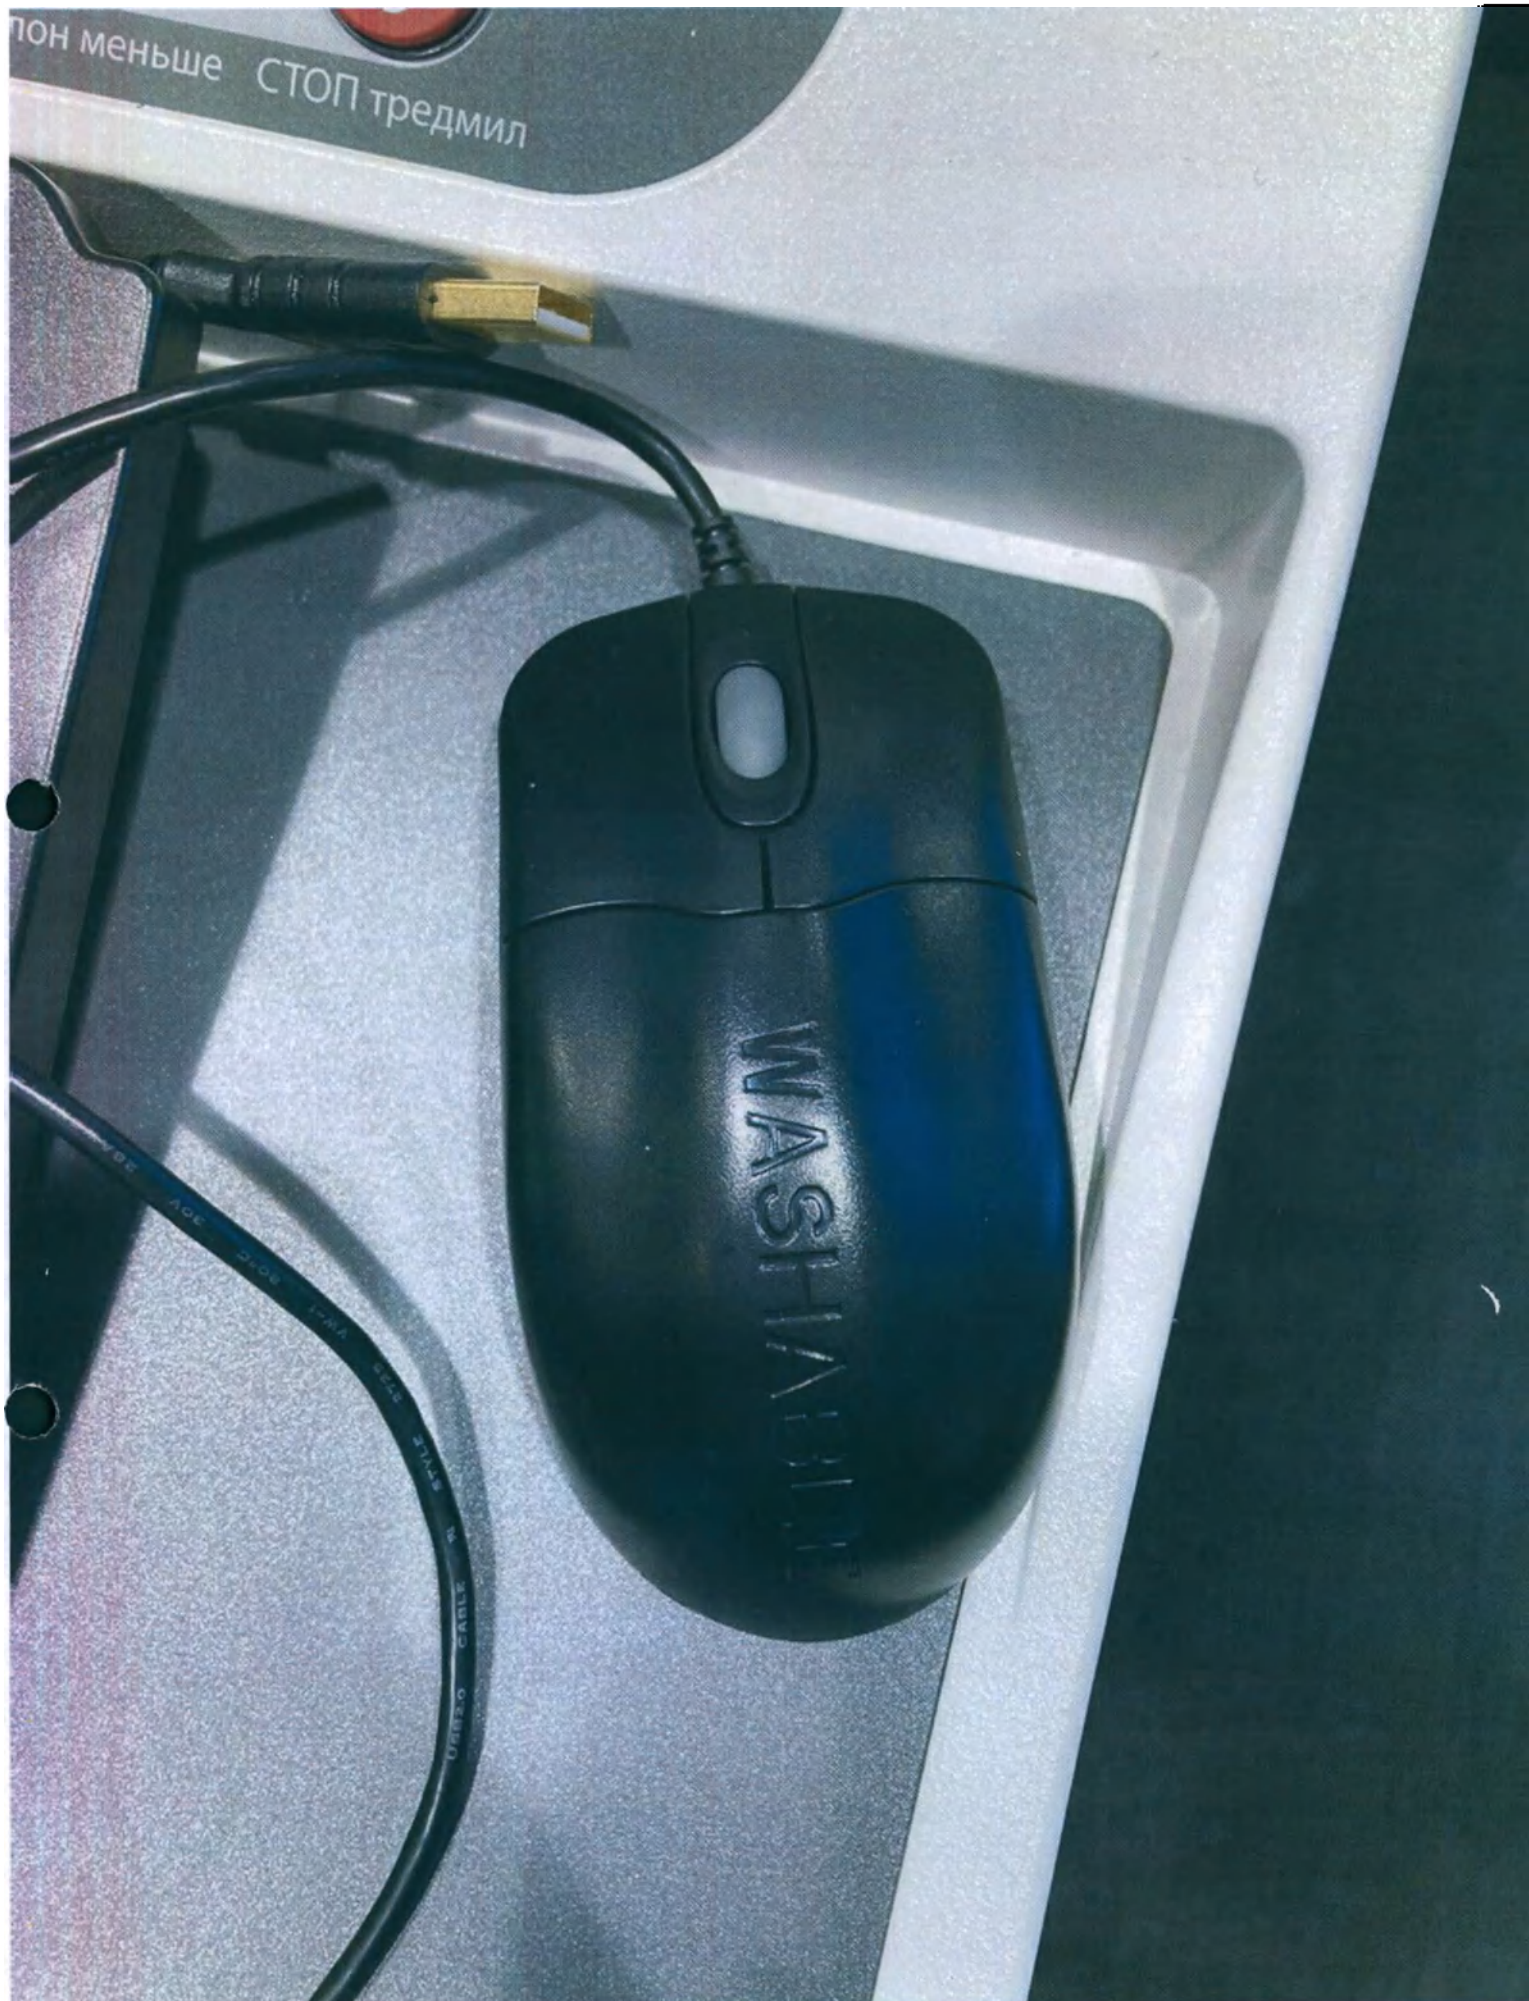


Фото 4.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»: 2. Манипулятор мышь.



Фото 5.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»: 2. Манипулятор мышь (маркировка).



Фото 6.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU чesкого стресс-тестирования «CASE»: 3. Клавиатура.



Фото 7.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»: 3. Клавиатура (маркировка).



Фото 8.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»: 5. Терморегистратор.



Фото 9.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru 5. Терморегистратор (маркировка)



Фото 10.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru ского стресс-тестирования «CASE»: 6. Кабель питания.



Фото 11.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU эского стресс-тестирования «CASE»: 6. Кабель питания (маркировка).

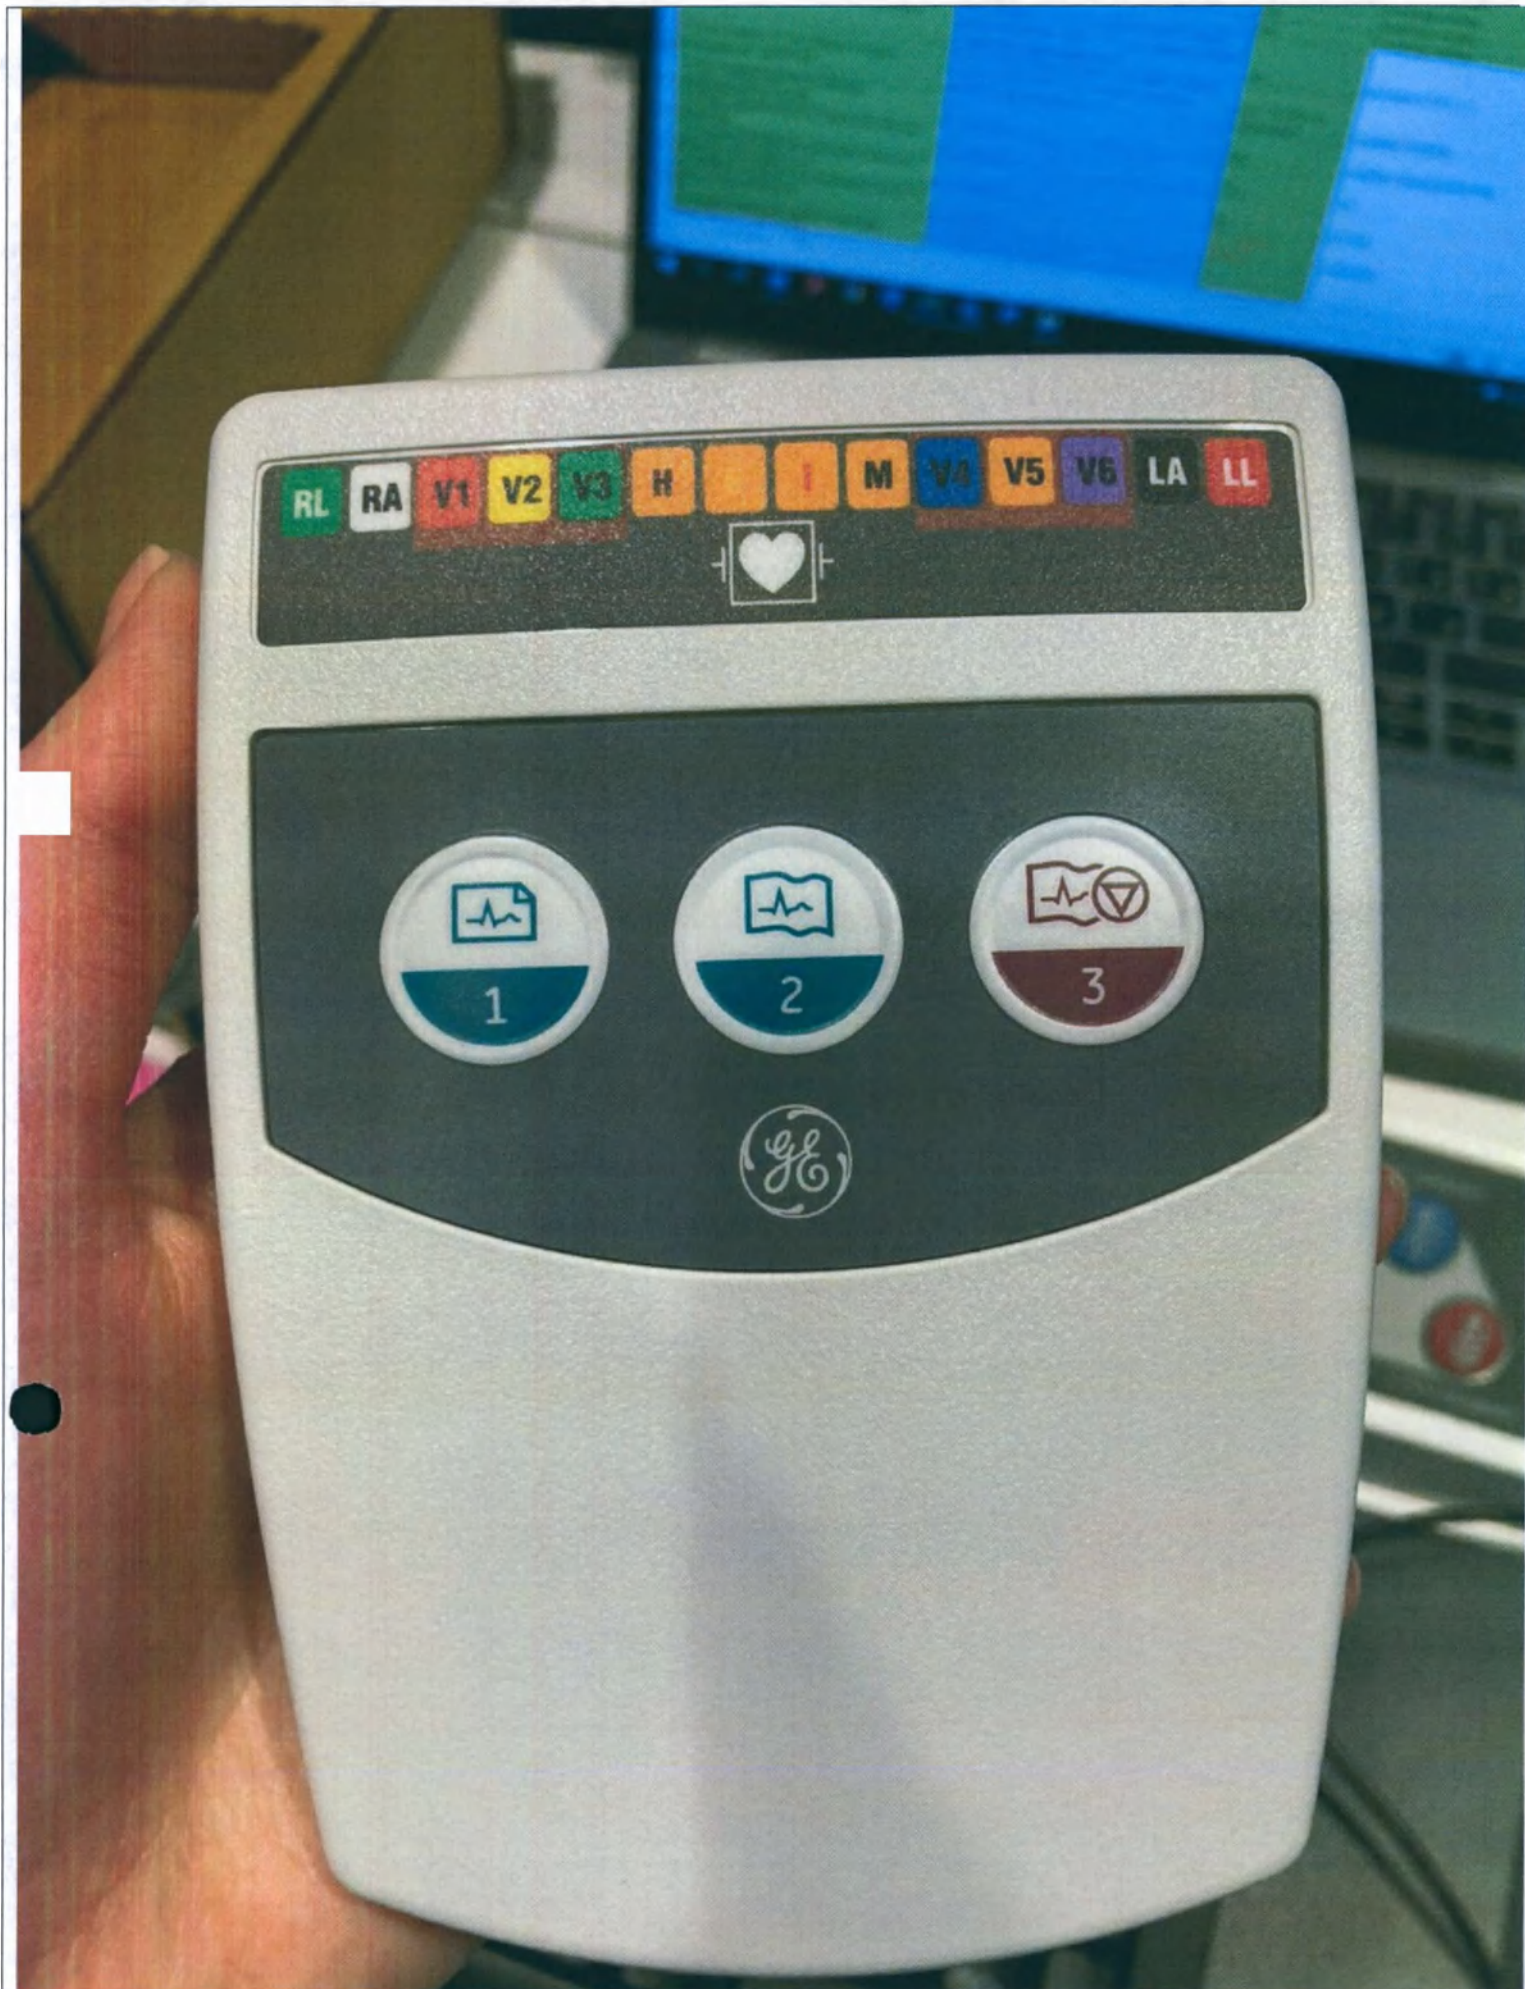


Фото 12.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

Модуль пациента CAM 14.



Фото 13.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

7. Модуль пациента CAM 14 (маркировка).

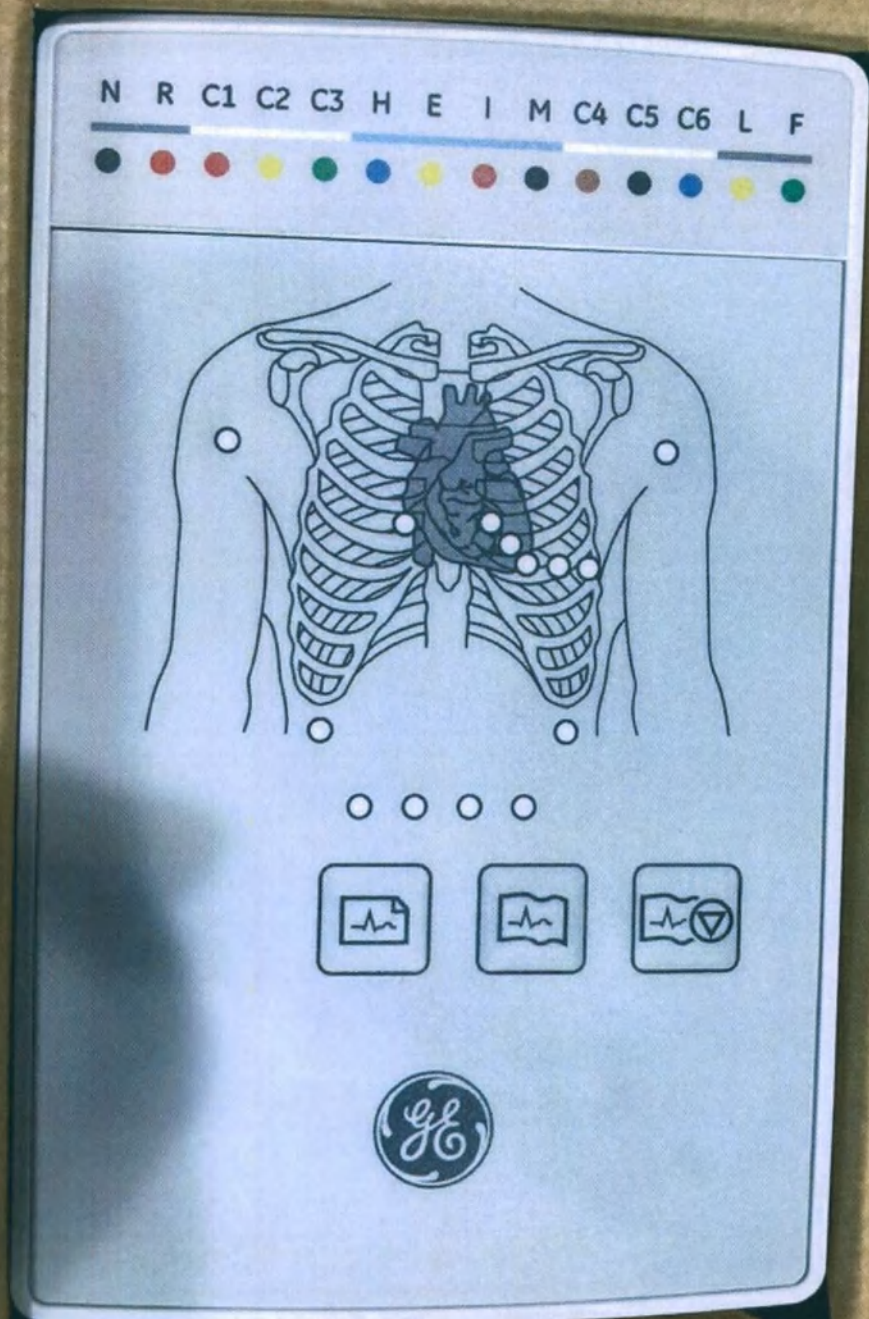


Фото 14.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

в.

Модуль пациента CAM CONNECT 14.



UDI (01) 00840682125307 (21) VU519510064SA (11) 191218
REF 2091686-001 CAM CONNECT 14
2019-12-18
SN V U 5 1 9 5 1 0 0 6 4 S A
ASSEMBLED IN MEXICO
LBL P/N: 2091684-001

CAM CONNECT 14
GE Medical Systems Information Technologies, Inc.
8200 W, Tower Ave, Milwaukee, WI 53223 USA
Power input: 5.0V~1A
CE 0459
TÜV Rheinland
IPX4
Rx Only
ASSEMBLED IN MEXICO
I/b no.-2093044-001

Фото 15.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. Модуль пациента CAM CONNECT 14 (маркировка).



Фото 16.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

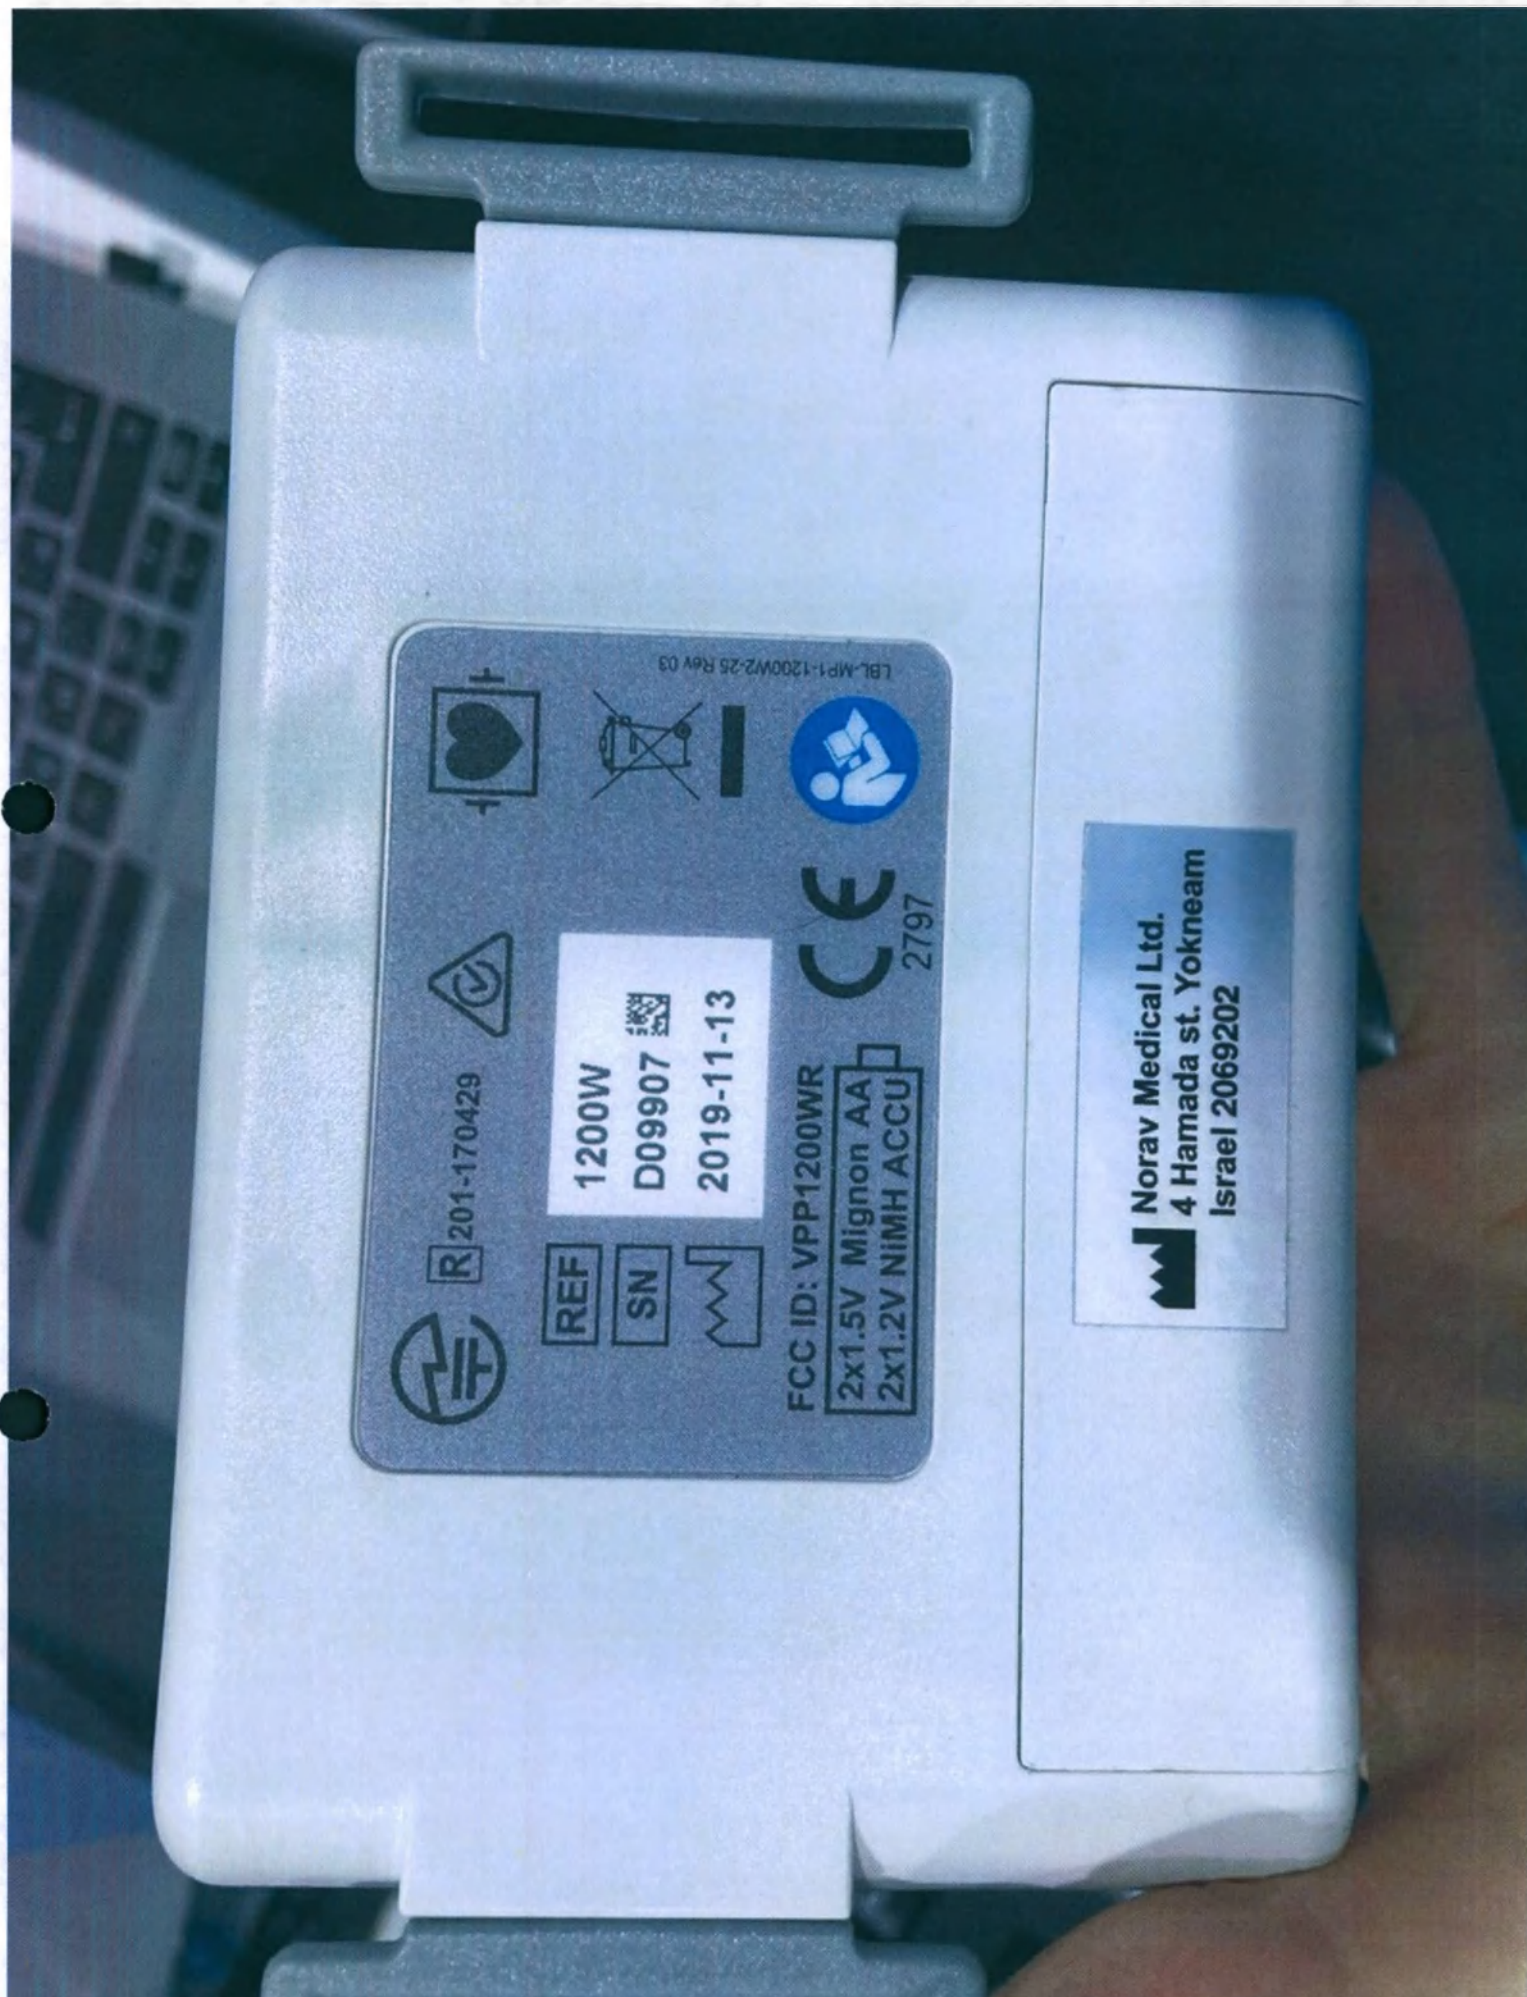


Фото 17.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

у. модуль пациента GEH-ECG 1200 (маркировка).



Фото 18.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

MODEL NO. **T2100-ST2**

SN GEDC-2051

REF 2097357-002

Private Label MFG: GE Medical Systems
Information Technologies, Inc
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223, USA

MFG MODEL NO. TMX428 220

MFG PART NO. 317-07927 GE

VOLTAGE: 220/240 SPLIT PHASE ~

220/240 ~

AMPS: 13 HERTS: 50/60



2018-11



FULL VISION INC.

3017 FULL VISION DRIVE,
NEWTON, KANSAS USA 67114-9750

317-160-315



Фото 19.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:



Фото 20.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU рдиологического стресс-тестирования «CASE»:

11. Велозргомметр eBike basic (при необходимости), РУ № РЗН 2017/6303.



Фото 21.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. Белорегистр EBike basic (при необходимости), РУ № РЗН 2017/6303 (маркировка).



Фото 22.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

12. Белоэргометр eBike EL (при необходимости), РУ № РЗН 2017/6303.



Фото 23.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

12. Велоэргометр eBike EL (при необходимости), РУ № РЗН 2017/6303 (маркировка).



Фото 24.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

13. Спирометр Spiro-SP TrueFlow Sensor.



Фото 25.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

15. Спирометр Spiro-SP TrueFlow Sensor (маркировка).



Фото 26.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

14. Автоматический измеритель артериального давления Tango M2.



Фото 27.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

14. Автоматический измеритель артериального давления Tango M2 (маркировка).

GE Healthcare

CASE™ V7.0

Руководство оператора

Код продукта SSF

Версия программного обеспечения 7.0



Фото 28.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Радиологического стресс-тестирования «CASE»:

15. Документация на бумажных, электронных или оптических носителях.

GE Healthcare

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями

Приложение к Руководству оператора для РФ



Фото 29.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

15. документация на бумажных, электронных или оптических носителях.



Фото 30.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:



Фото 31.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru ктроды одноразовые взрослые, детские.



Фото 32.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10. Электроды одноразовые взрослые, детские.



Фото 33.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

16. Электроды одноразовые взрослые, детские.



Фото 34.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10. Электроды одноразовые взрослые, детские.



Фото 35.


Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU электроды одноразовые взрослые, детские.

SilverTRACE™ ECG Electrodes,
35x41mm Oval, Foam, Solid Gel

00600 / 15:21:05

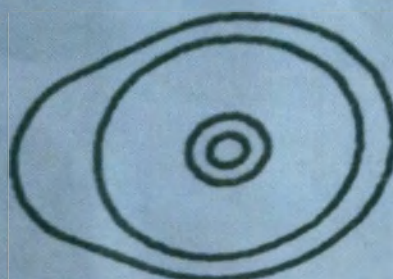

QTY

30

REF


2014768-001

GTIN

19005531001951

LOT

200326-0163



2023-03-26

(01)19005531001951(10)200326-0163(17)220326

V2

Фото 36.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

10. Электроды одноразовые взрослые, детские (маркировка).



Фото 37.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE»:

ООО ЦРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru

17. Электроды системы вакуумной аппликации многоразовые.



Фото 38.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: 2.

Чехол для модуля сбора данных.



Фото 39.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: ?

Чехол для модуля сбора данных (маркировка).



Фото 40.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: 3.

Адаптеры для многоэлектродов типа Банан.

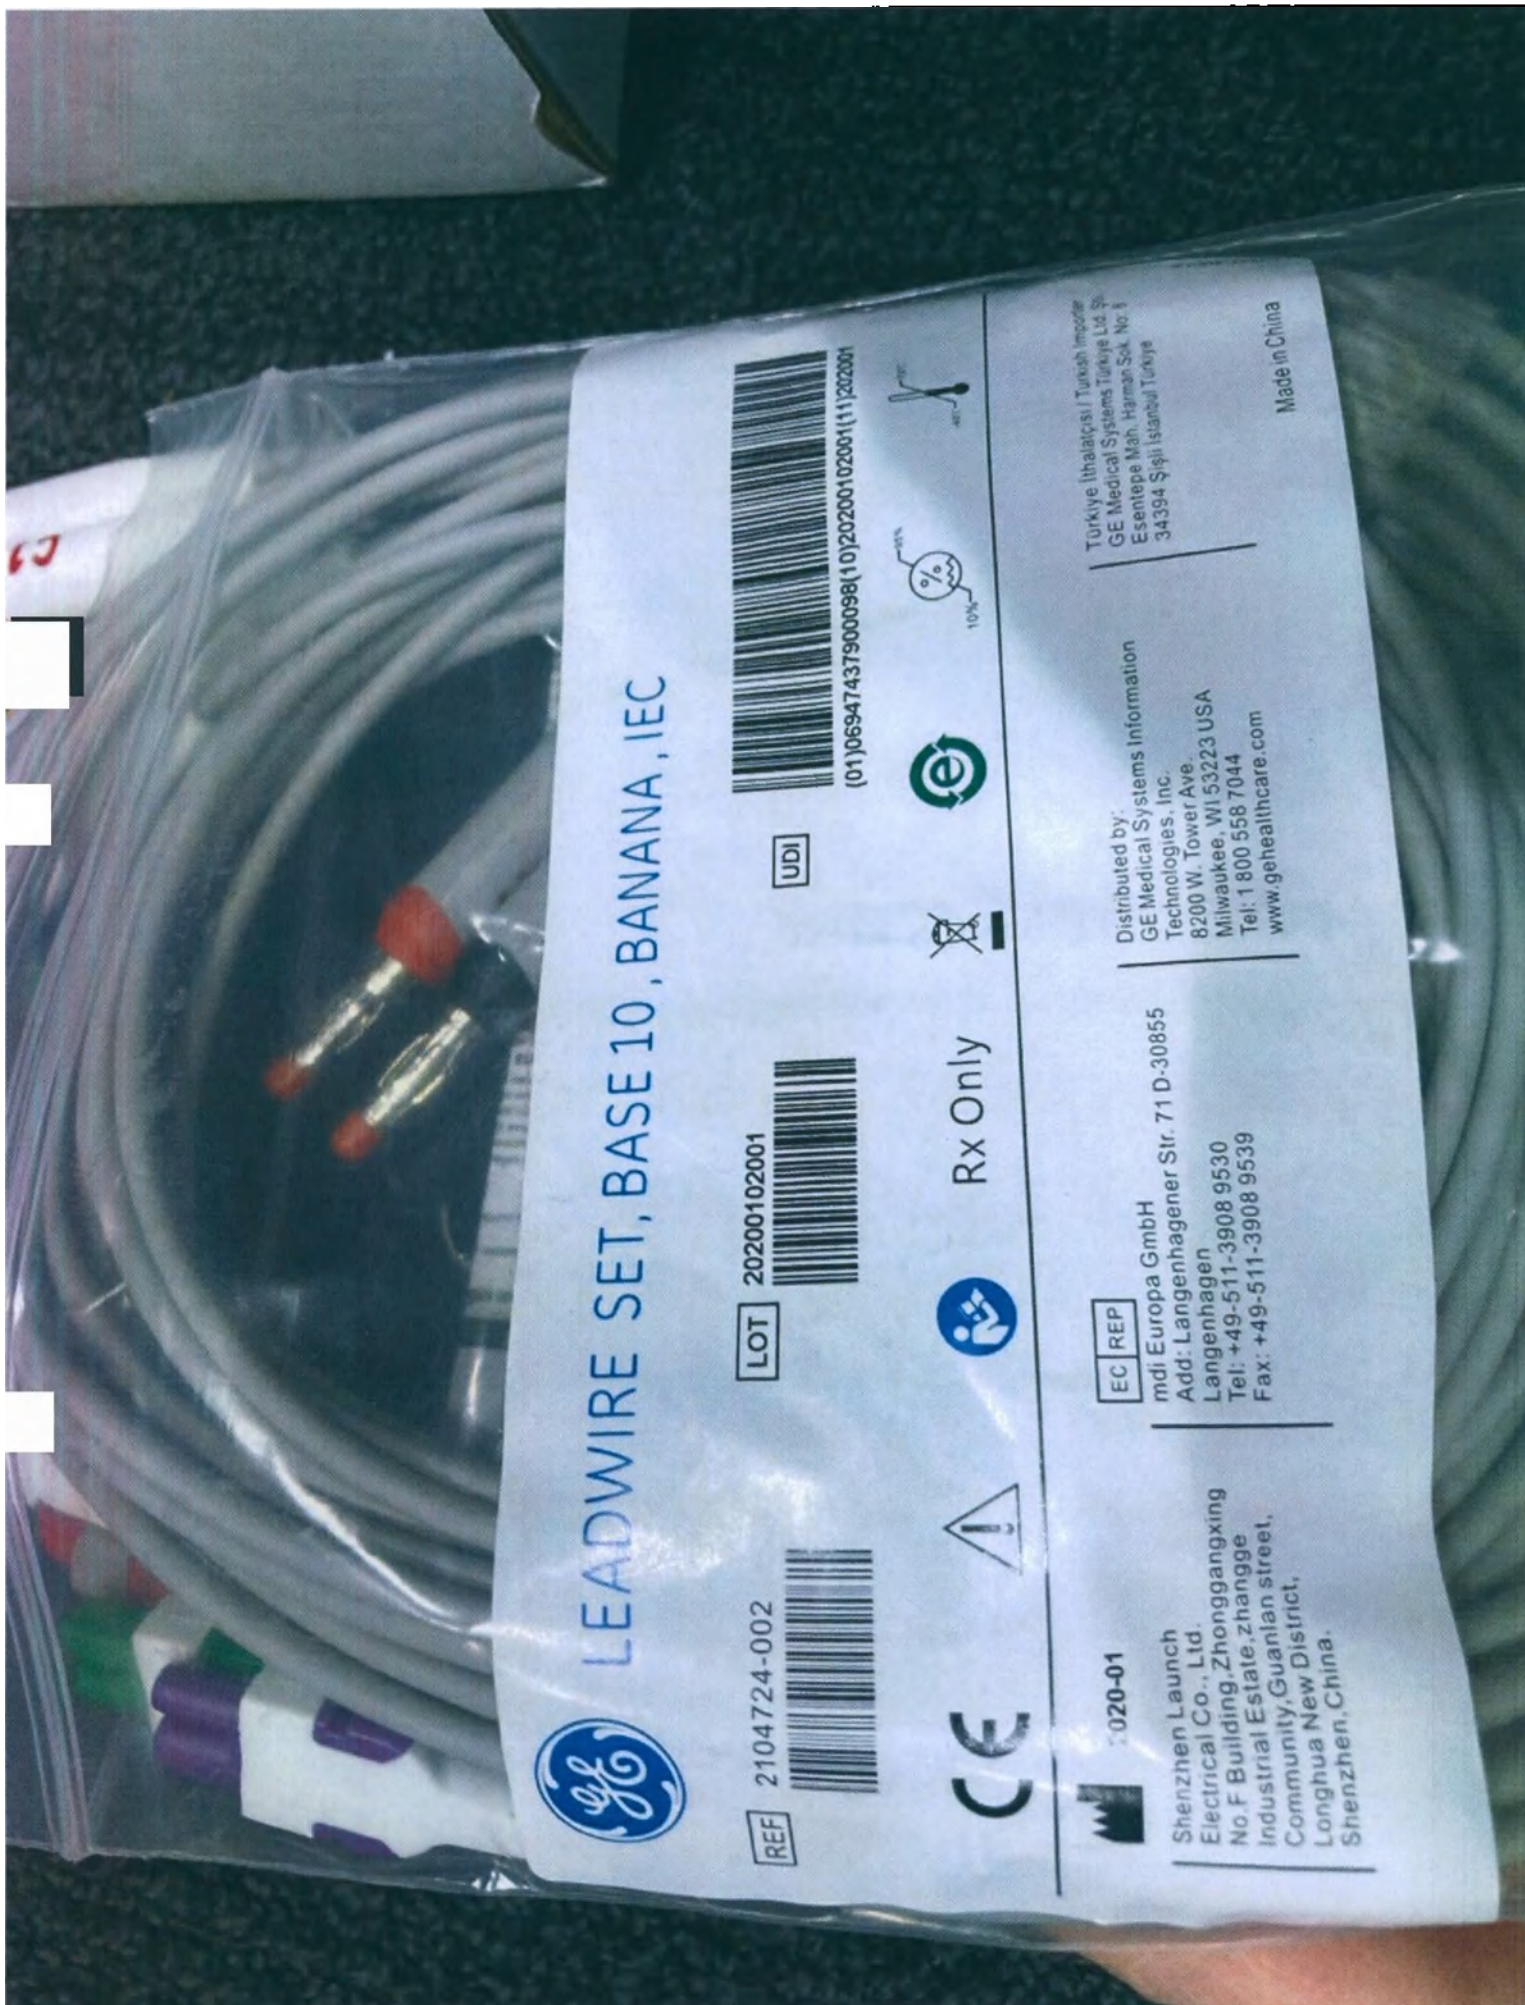


Фото 41.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: 2

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Адаптеры для многоэлектродов типа Банан (маркировка).



Фото 42.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
Принадлежности: 4. Адаптеры для многоэлектродов типа Граббер.



LEADWIRE SET, BASE 10, GRABBER, IEC

REF

2104748-001



LOT

20200115001





UDI



(01)06947437900135(10)20200115001(11)200100



Rx Only



2020-01

Shenzhen Launch
Electrical Co., Ltd.
No. F Building, Zhonggangxing
Industrial Estate, zhangge
Community, Guanlan street,
Longhua New District,
Shenzhen, China.

EC REP

mdi Europa GmbH
Add: Langenhagener Str. 71 D-30855
Langenhagen
Tel: +49-511-3908 9530
Fax: +49-511-3908 9539

Distributed by:
GE Medical Systems Information
Technologies, Inc.
8200 W. Tower Ave.
Milwaukee, WI 53223 USA
Tel: 1 800 558 7044
www.gehealthcare.com

Türkiye İthalatçısı / Turkish Importer
GE Medical Systems Türkiye Ltd. Şti.
Esentepe Mah. Harman Sok. No: 8
34394 Şişli İstanbul Türkiye

Made in China

- EN Leadwire Set, Base 10, Grabber, IEC
- BG Комплект отвеждания, базови 10, захващане, IEC
- HR Komplet odvoda, osnovni 10 kom., sa hvataljkom, IEC
- CS Souprava vodičů, 10 základních, Grabber, IEC
- DA Strømførende ledningssæt, base 10, Grabber, IEC
- LT Elektrodų laidų rinkinys, 10 laidų, „Grabber“ tipo, IEC
- NO Ledningssett, base 10, grabber, IEC
- PL Zestaw przewodów odprowadzeniowych, podstaw 10, uchwyty, IEC
- PT-BR Conjunto do fio de derivação, Base 10, Grampo, IEC

- LV Novadijumu vadu komplekts, pamata 10, satvērējs, IEC
- LT Elektrodų laidų rinkinys, 10 laidų, „Grabber“ tipo, IEC
- NO Ledningssett, base 10, grabber, IEC
- PL Zestaw przewodów odprowadzeniowych, podstaw 10, uchwyty, IEC
- PT-BR Conjunto do fio de derivação, Base 10, Grampo, IEC



Фото 44.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
Принадлежности: 5. Адаптеры для многоразовых электродов типа Мактрод.

Asia Headquarters
 GE Medical Systems
 Information Technologies Asia, GE (China) Co., Ltd.
 No. 1 Huafu Road,
 Zhongnang Hi-tech Park Pudong,
 Shanghai, People's Republic of China 201203
 Tel: +86 21 3877 7888
 Fax: +86 21 3877 7402

Türkiye Yetkili
 GE Medical Systems
 Information Technologies A.Ş. GE (Türkiye) Co., Ltd.
 No. 1. Hürriyet Caddesi
 Kat: 3. Kat
 Beşiktaş, İstanbul 34398, Türkiye
 Tel: +90 212 387 78 88
 Fax: +90 212 387 74 02

EC REP
 GE Medical Systems
 Information Technologies GmbH
 Munzingerstrasse 5
 79111 Freiburg, Germany
 Tel: (49) 761 45 43 0

EC REP
 GE Medical Systems
 Information Technologies, Inc.
 8200 W. Tower Ave.
 Milwaukee, WI 53223 USA
 US Tel: (800) 558-7044
 Canada Tel: (800) 668-0732
 www.gehealthcare.com

GE Medical Systems
 Information Technologies, Inc.
 8200 W. Tower Ave.
 Milwaukee, WI 53223 USA
 US Tel: (800) 558-7044
 Canada Tel: (800) 668-0732
 www.gehealthcare.com

GE Medical Systems
 Information Technologies, Inc.
 8200 W. Tower Ave.
 Milwaukee, WI 53223 USA
 US Tel: (800) 558-7044
 Canada Tel: (800) 668-0732
 www.gehealthcare.com

CAM 14 ECG Connector Set
 Macrode, 14/Set, IEC

CAM 14 心电图接头套件
 鳄鱼夹式, 14个/套, IEC

REF 900178-202 **Rev** P

Lot 256679 **Exp** 2020-07

GE Medical Systems
 Information Technologies, Inc.

GE Medical Systems
 Information Technologies, Inc.

Фото 45.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 5. Адаптеры для многоэлектродов типа Мактрод (маркировка).



Фото 46.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
Принадлежности: 6. Переходники для ЭКГ.



ADAPTER CLIP, WIDE MOUTH CLIP, 14 PACK

REF 2104729-001



LOT 20190905001






UDI



(01)06947437950116(10)20190905001(11)201909



Rx Only

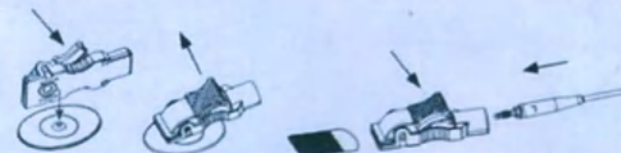

2019-09

Shenzhen Launch
Electrical Co., Ltd.
No. F Building, Zhonggangxing
Industrial Estate, Zhangge
Community, Guanlan street,
Longhua New District,
Shenzhen, China.

EC REP

mdi Europa GmbH
Add: Langenhagener Str. 71 D-30855
Langenhagen
Tel: +49-511-3908 9530
Fax: +49-511-3908 9539

Distributed by:
GE Medical Systems Information
Technologies, Inc.
8200 W. Tower Ave.
Milwaukee, WI 53223 USA
Tel: 1 800 558 7044
www.gehealthcare.com

Türkiye İthalatçısı / Turkish Importer
GE Medical Systems Türkiye Ltd. Şti.
Esentepe Mah. Harman Sok. No: 8
34394 Şişli İstanbul Türkiye

Made in China

LA0841_REVA

EN Adapter Clip, Wide Mouth Clip, 14 pack

BG Адаптерен клипс, широк клипс, 14 в опаковка

HR Spojnica s adapterom, široka spojnica, 14 komada

CS Svorkový adaptér, široká svorka

PL Adapterklemme, klemme med bred mund, pakke med 14 stk

NL Adapterklem, brede klemmenen met nokket van 14

LV Adaptera klipsis, plats klipsis, iepakojumā 14 gab.

LT Adapterio spaustukas, plačiažiotis spaustukas, 14 vnt. pakuotė

NO Adapterklype, vidåpen munnklype, 14 pakke

PL Zacisk adaptera, zacisk szeroki, zestaw 14 szt.

PT-88 Clipping adapter

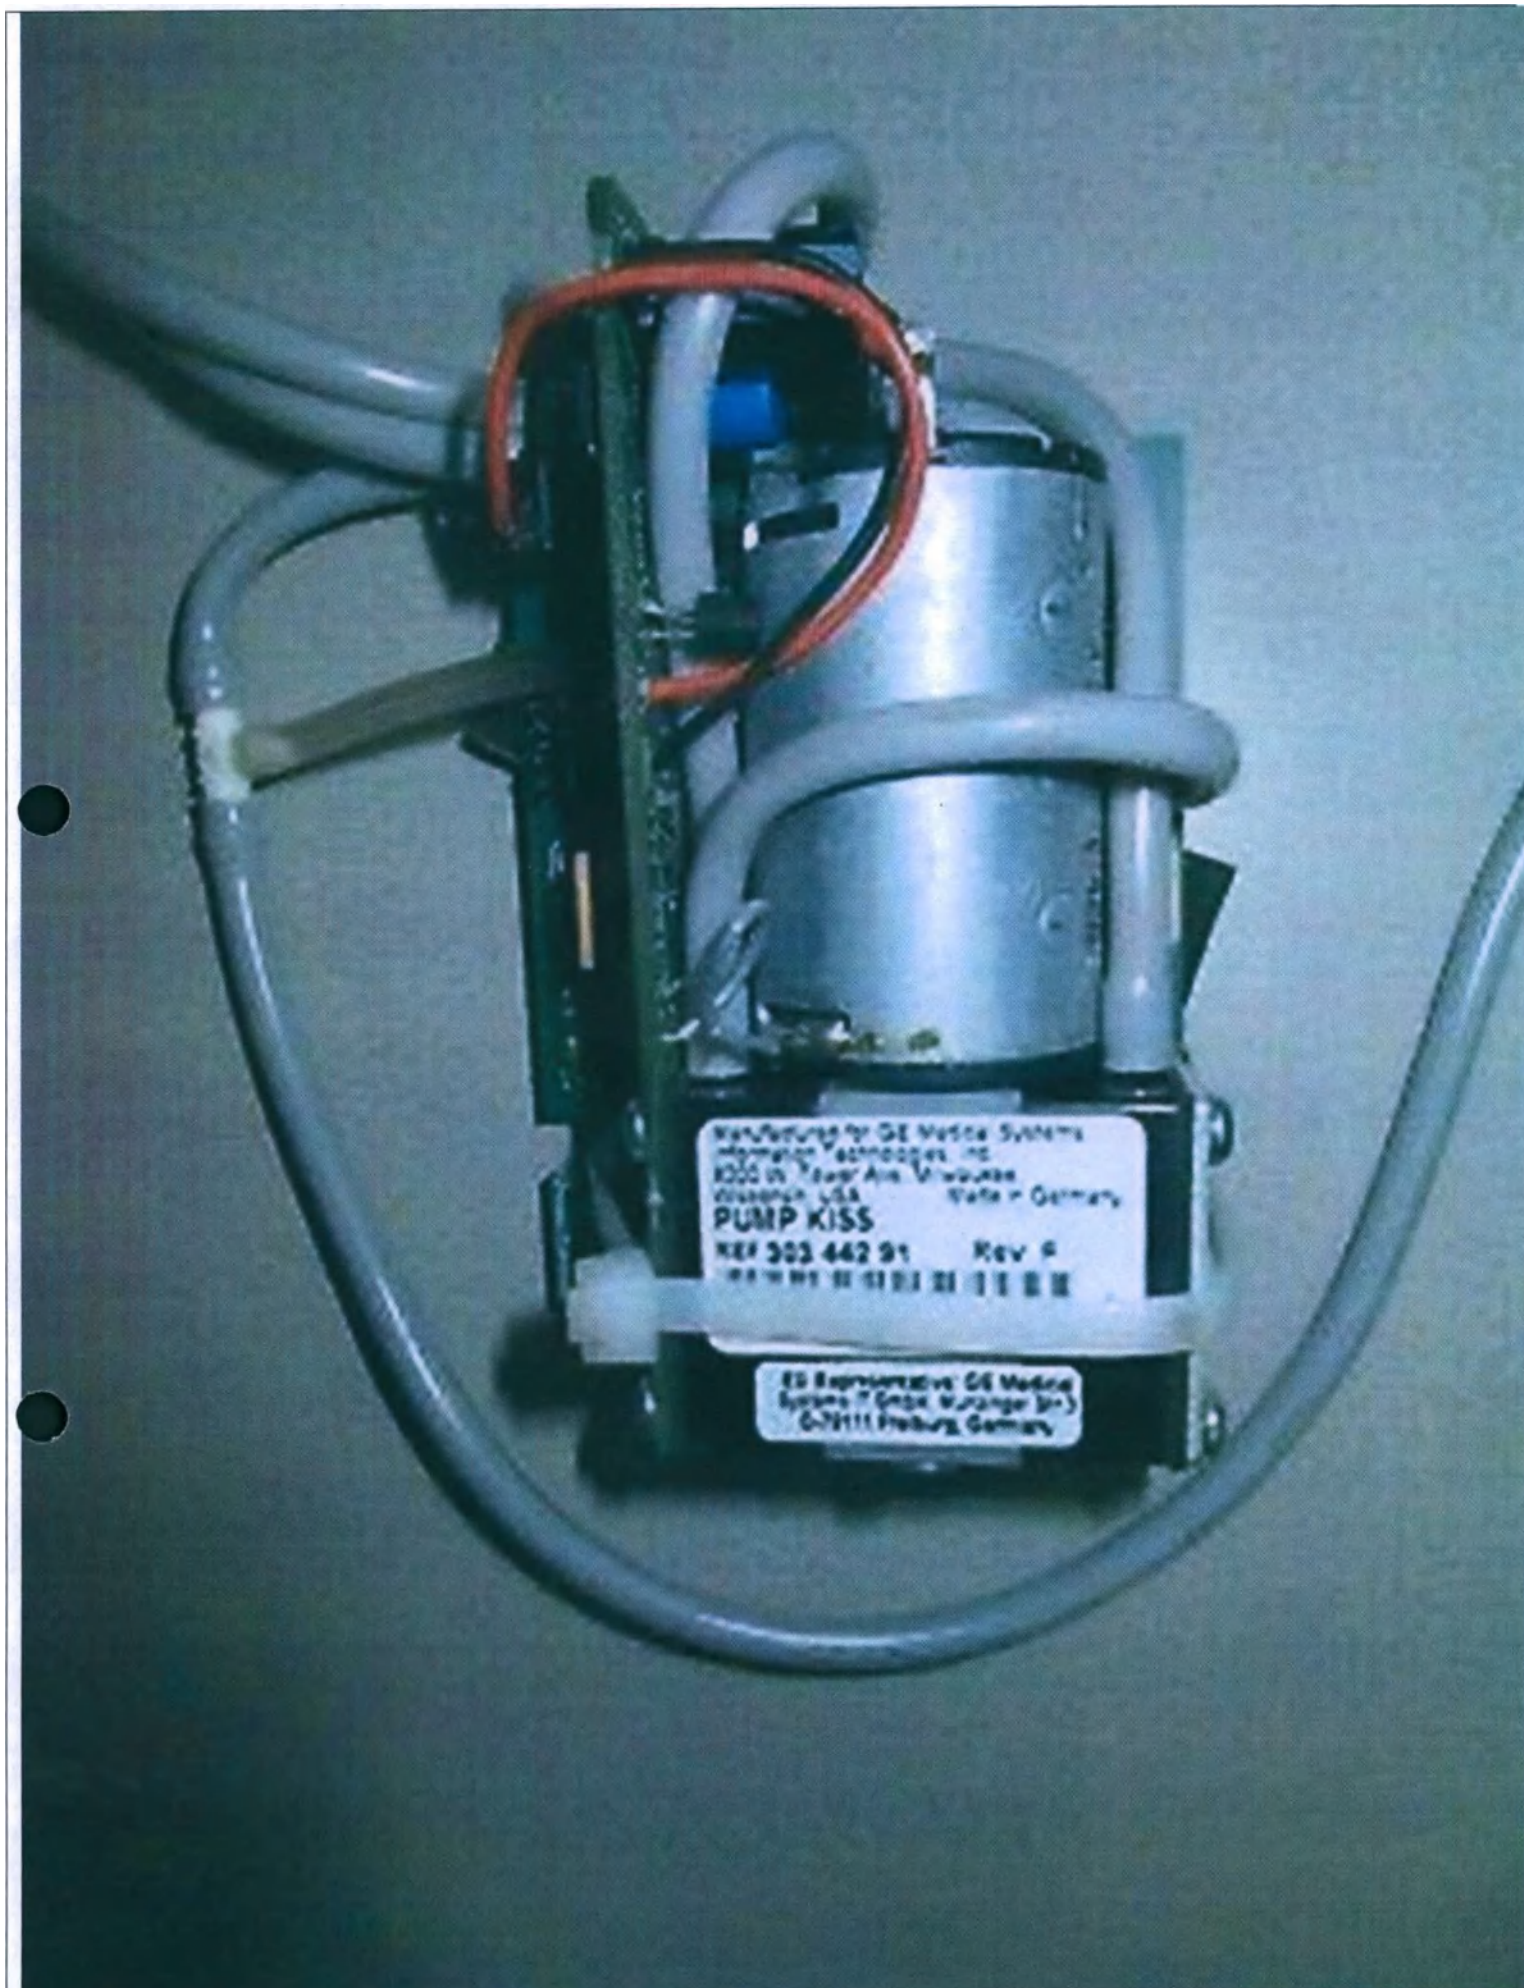


Фото 48.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: 7. Внутренний насос KISS CASE.



Фото 49.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: 2

Переходник для системы KISS для крепления на велоэргометре.

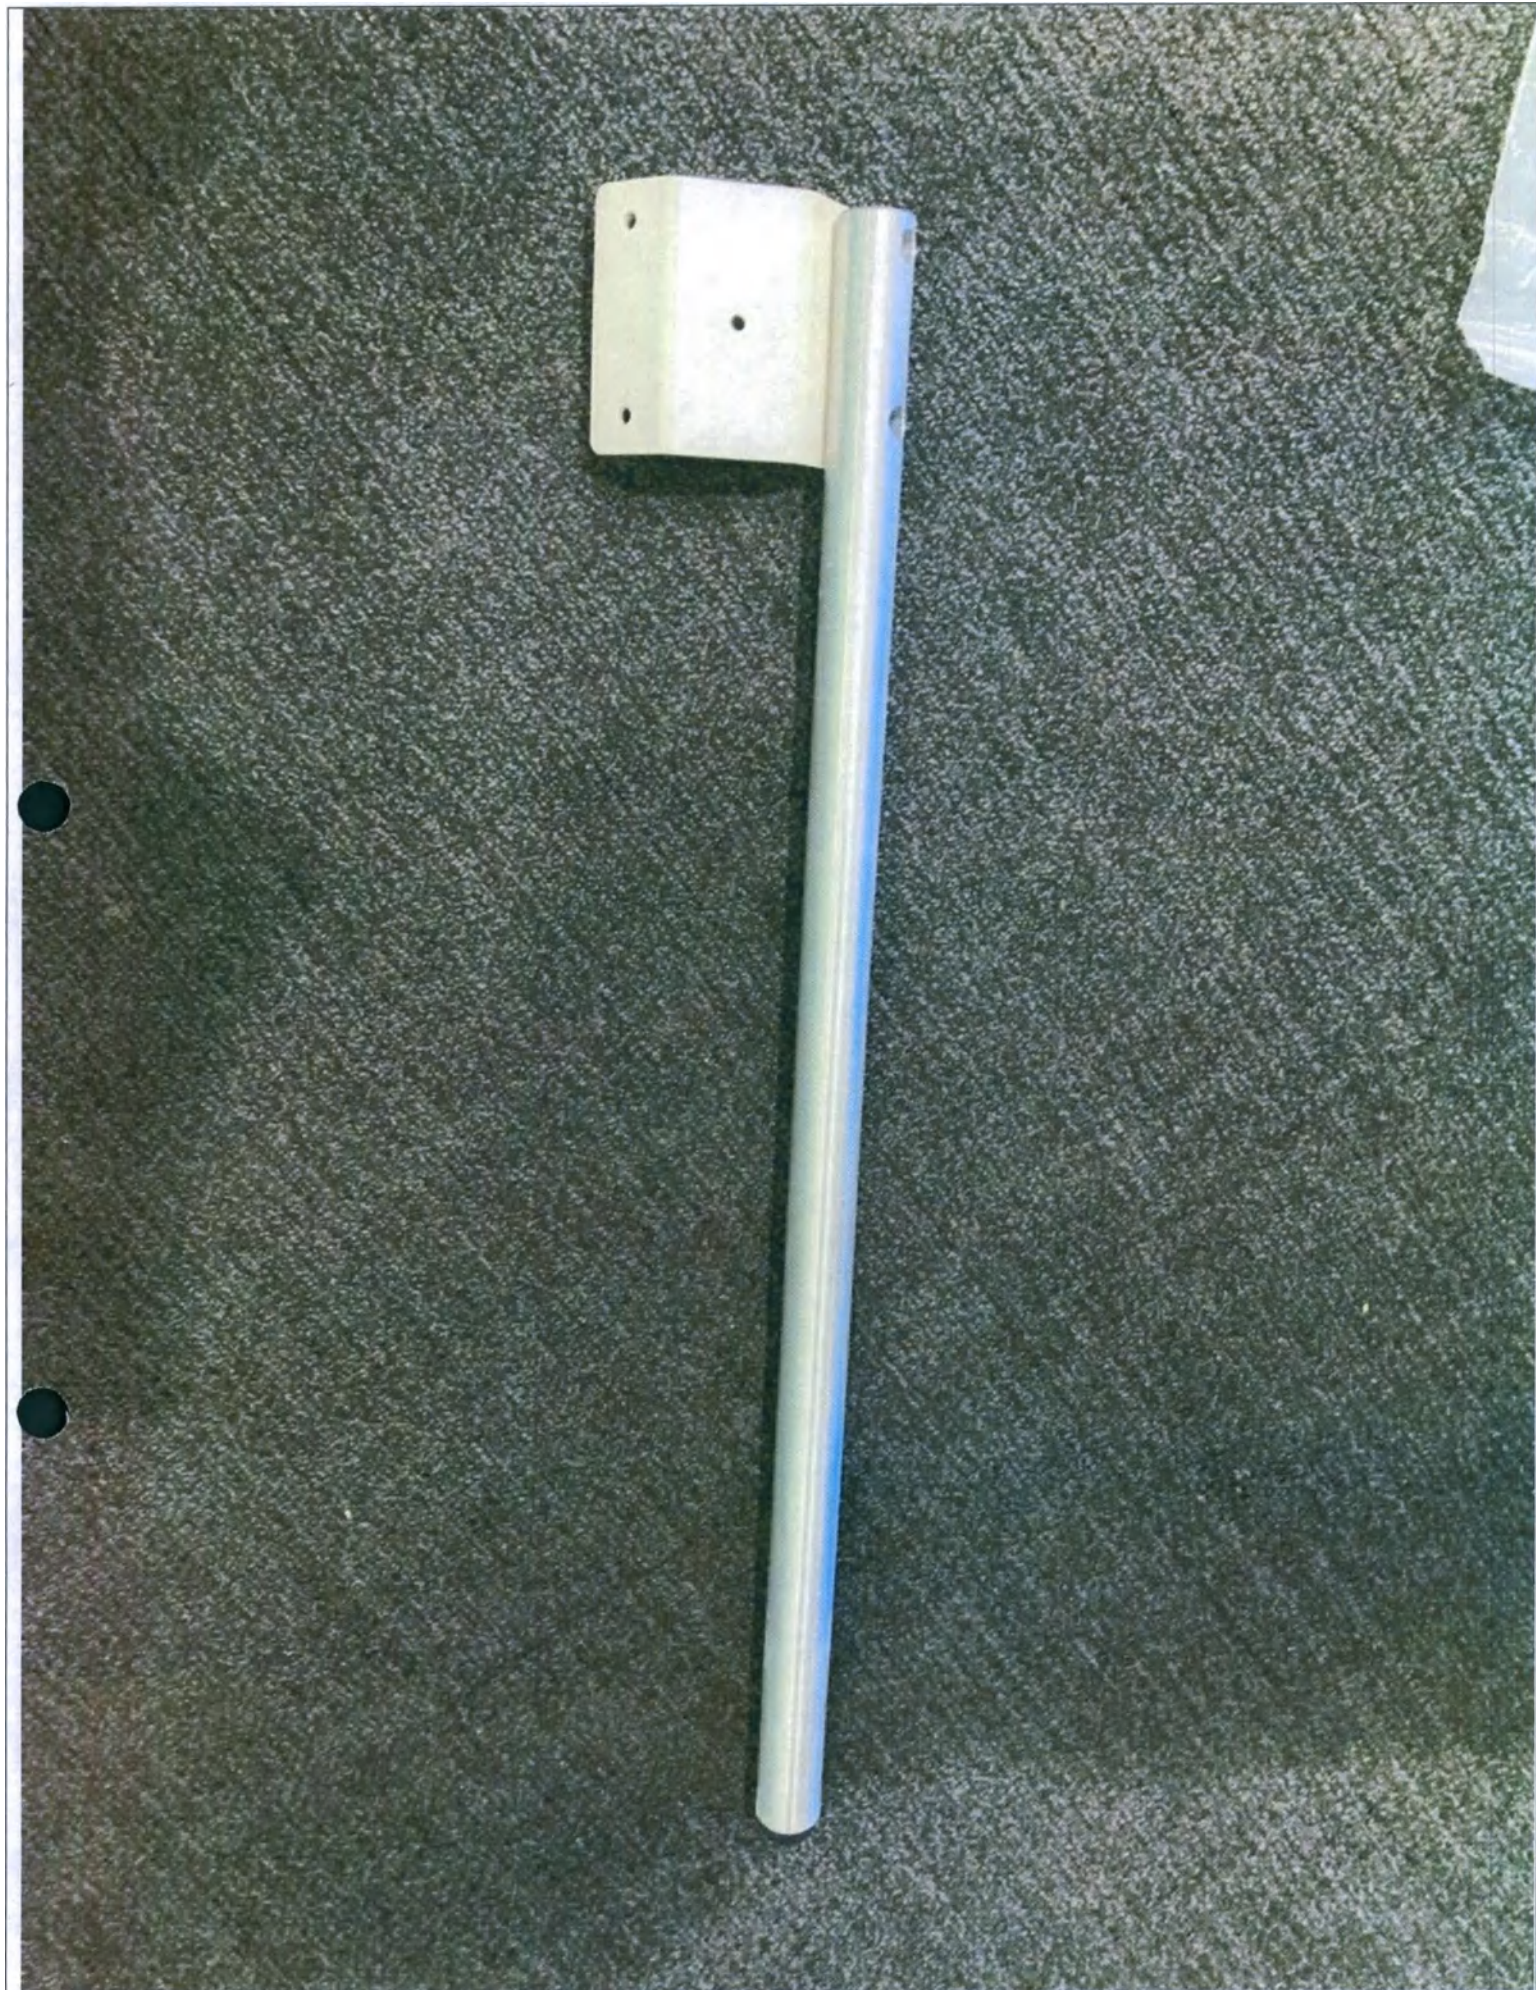


Фото 50.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности:

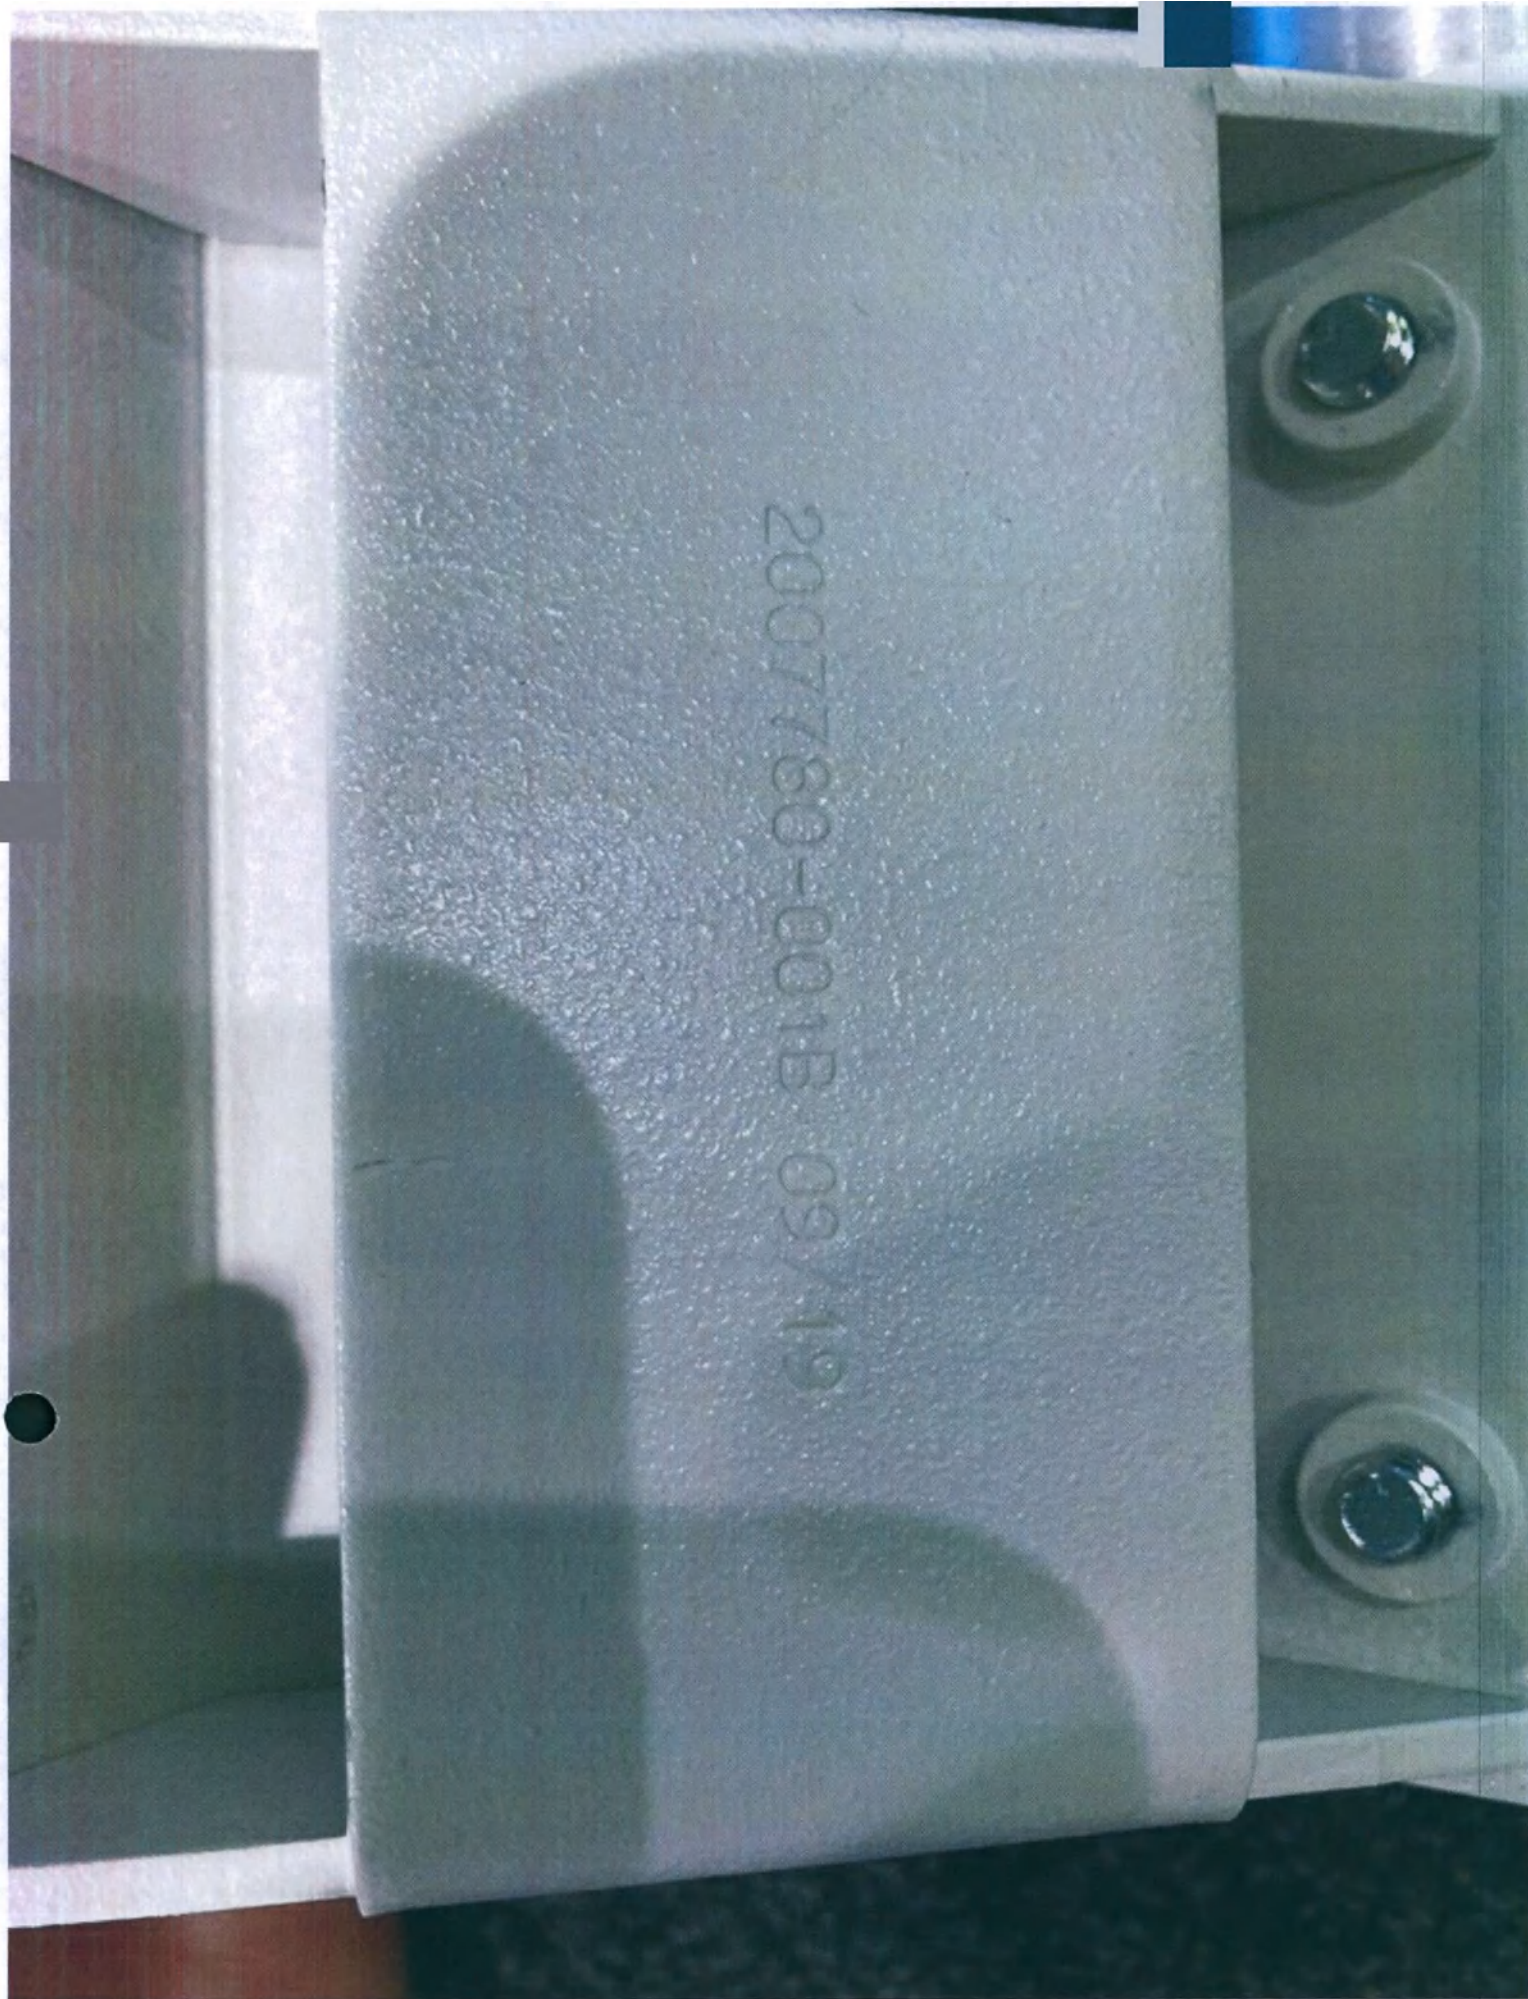


Фото 51.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности:

ООО ЦРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru

У. держатель для системы KISS для крепления на системной тележке (маркировка).



Фото 52.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРПМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru иное крепление для вакуумной аппликации электродов KISS



Фото 53.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности:



Фото 54.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности:

11. Настольное крепление для вакуумной аппликации электродов KISS (маркировка).



Фото 55.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности:

12. Держатель модуля подключения.


Фото 56.

Washer Filter D=20x5 Pack of 100

REF 93204775



Rev B

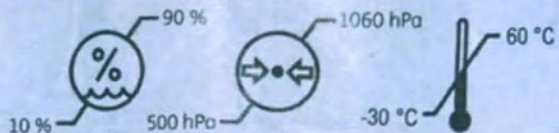

GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.
8200 W. Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA
US Tel: (300) 558-7044
Canada Tel: (800) 668-0732

EC REP

GE Medical Systems
Information Technologies GmbH
Munzinger Strasse 5
D-79111 Freiburg, Germany
Tel: +49 761 4543-0



Made in Germany

LOT Hu051

2020-07



lbl p/u p/l Rev. A



GE Healthcare



Фото 57.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: 14. Соединительный серийный кабель для велоэргометра с маркировкой.



Фото 58.

**Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
Принадлежности: 15. Соединительный серийный кабель для беговой дорожки.**



Фото 59.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: 16 IISB кабель для велоэргометра/беговой дорожки с маркировкой.



Фото 60.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности:

17. Кабель соединительный для подключения тележки системы к сети с маркировкой.

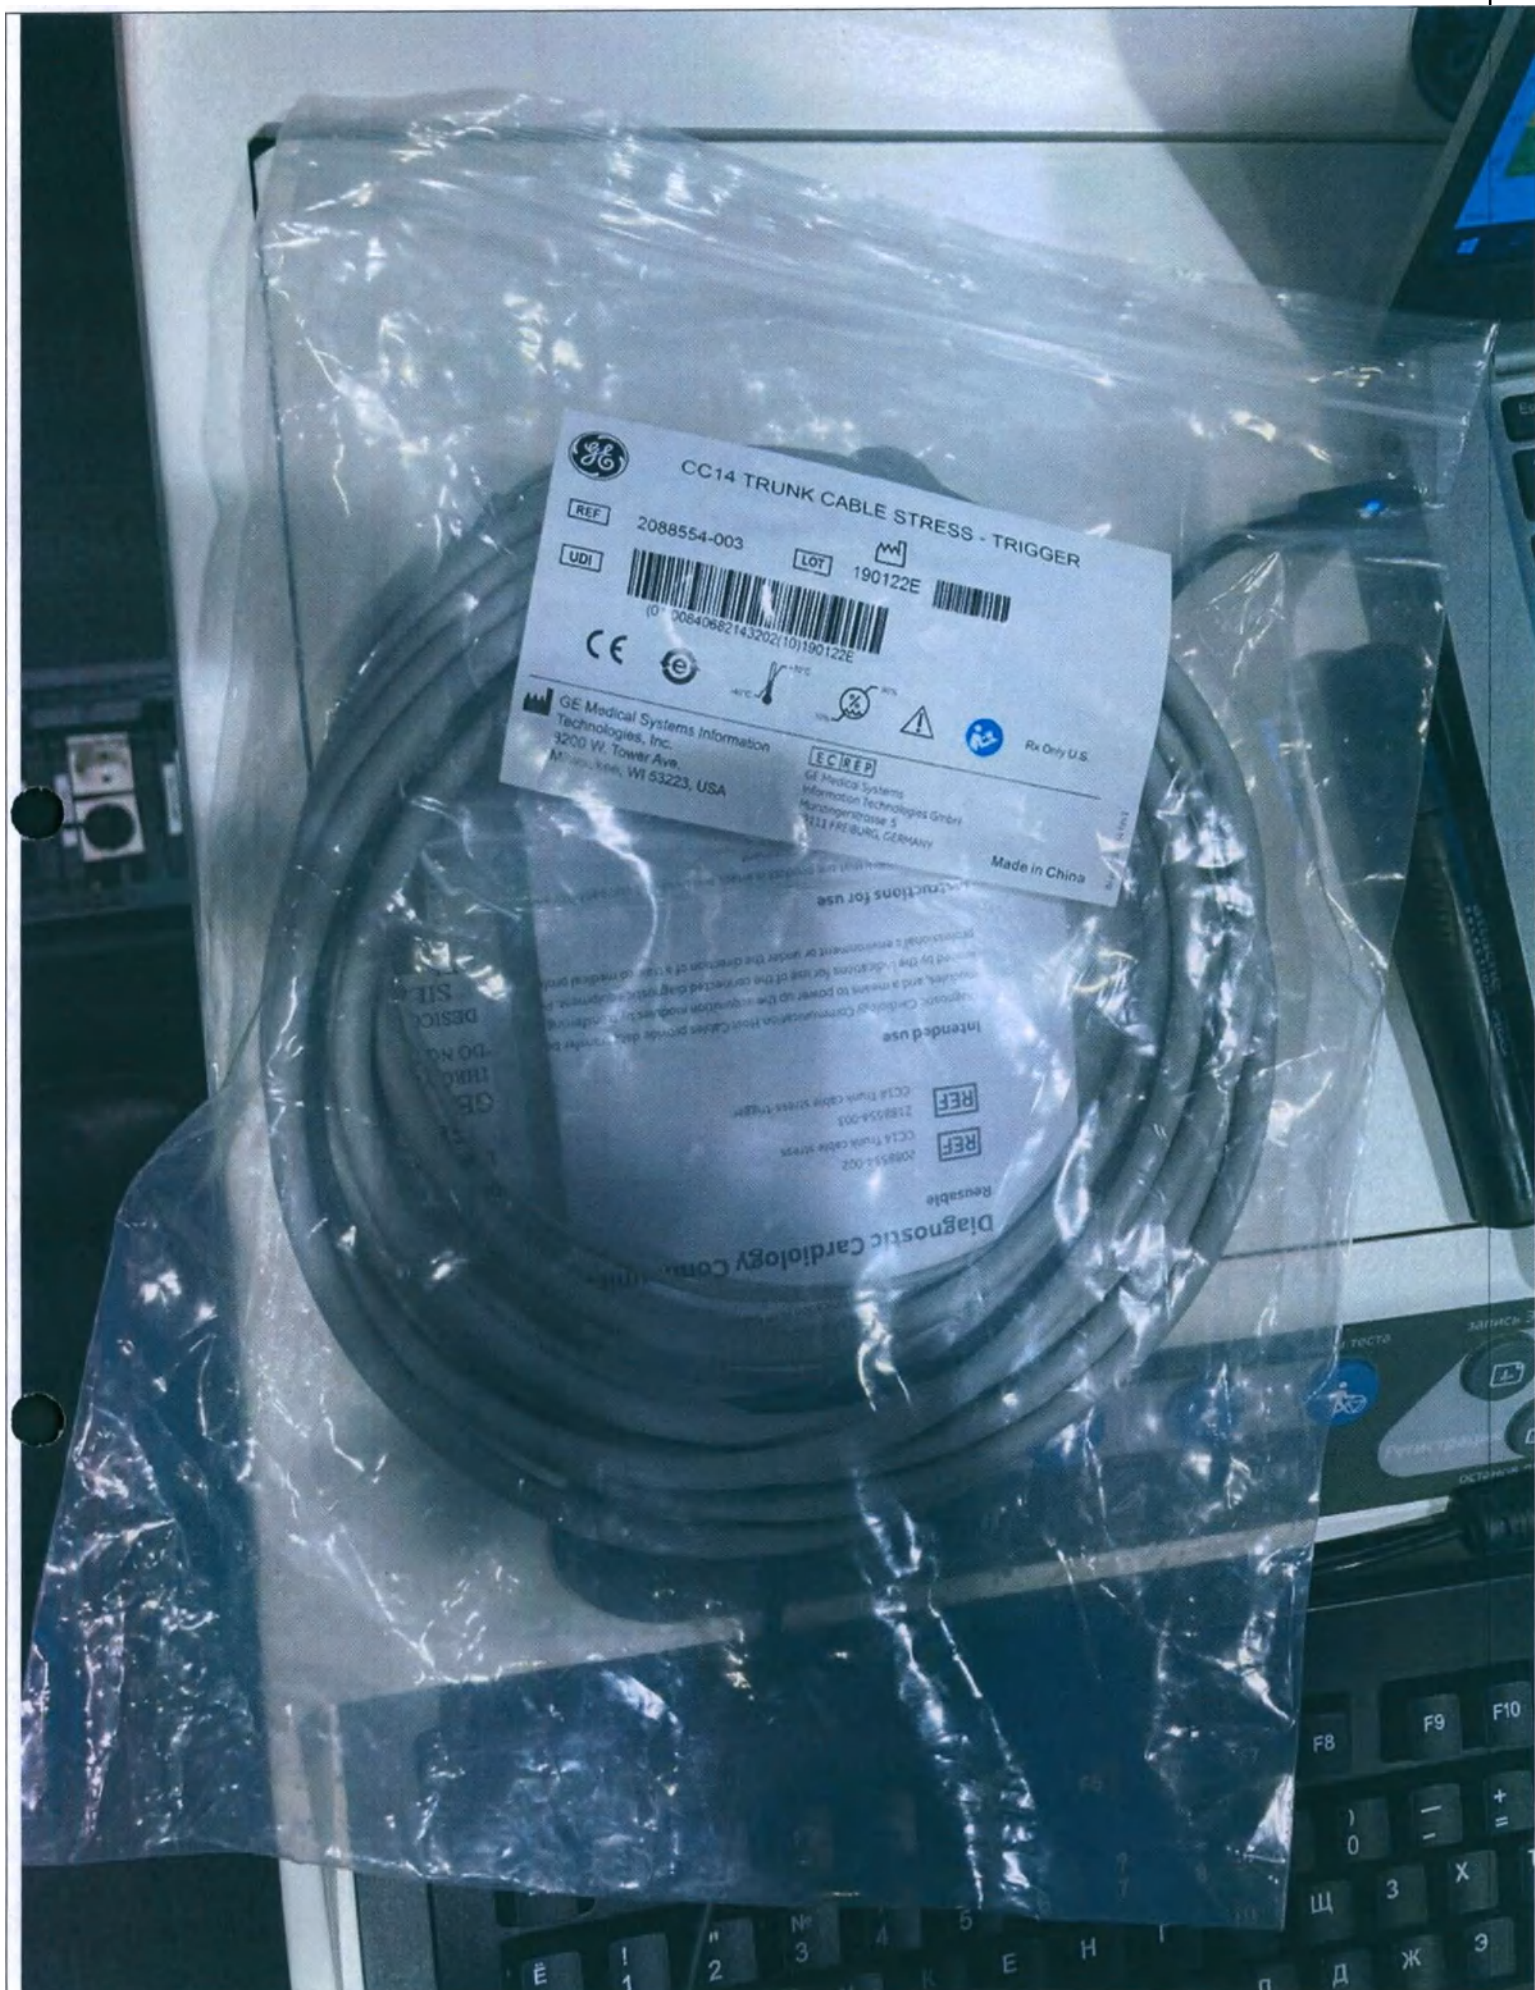


Фото 61.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
Принадлежности: 18. Кабель соединительный тележка – модуль получения данных с маркировкой

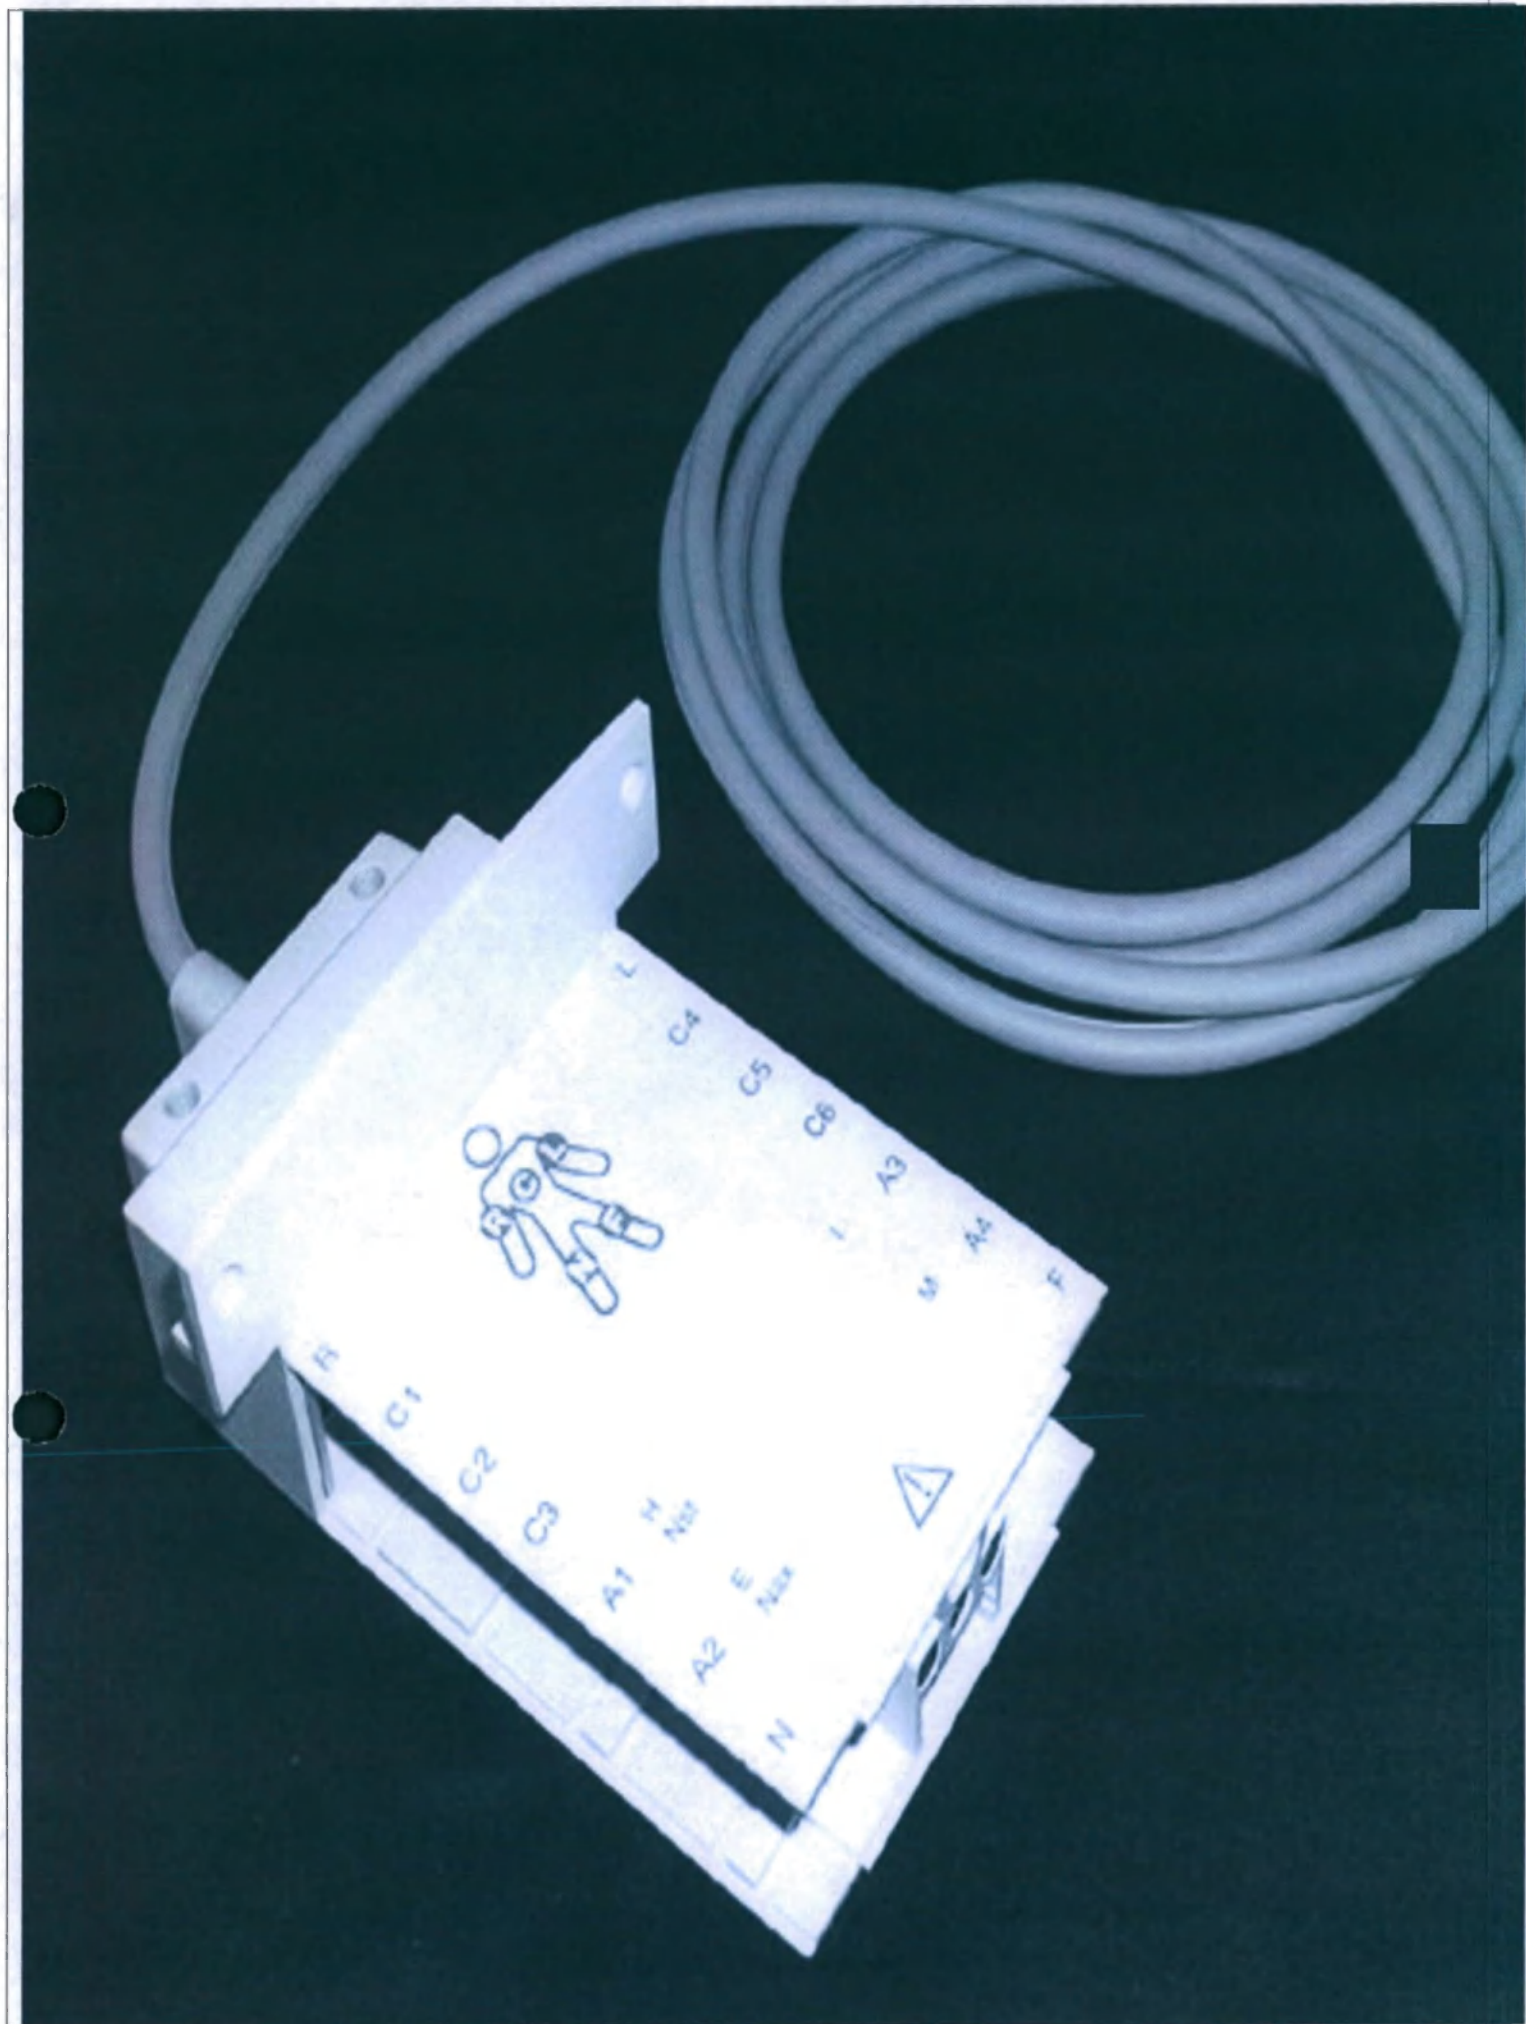


Фото 62.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

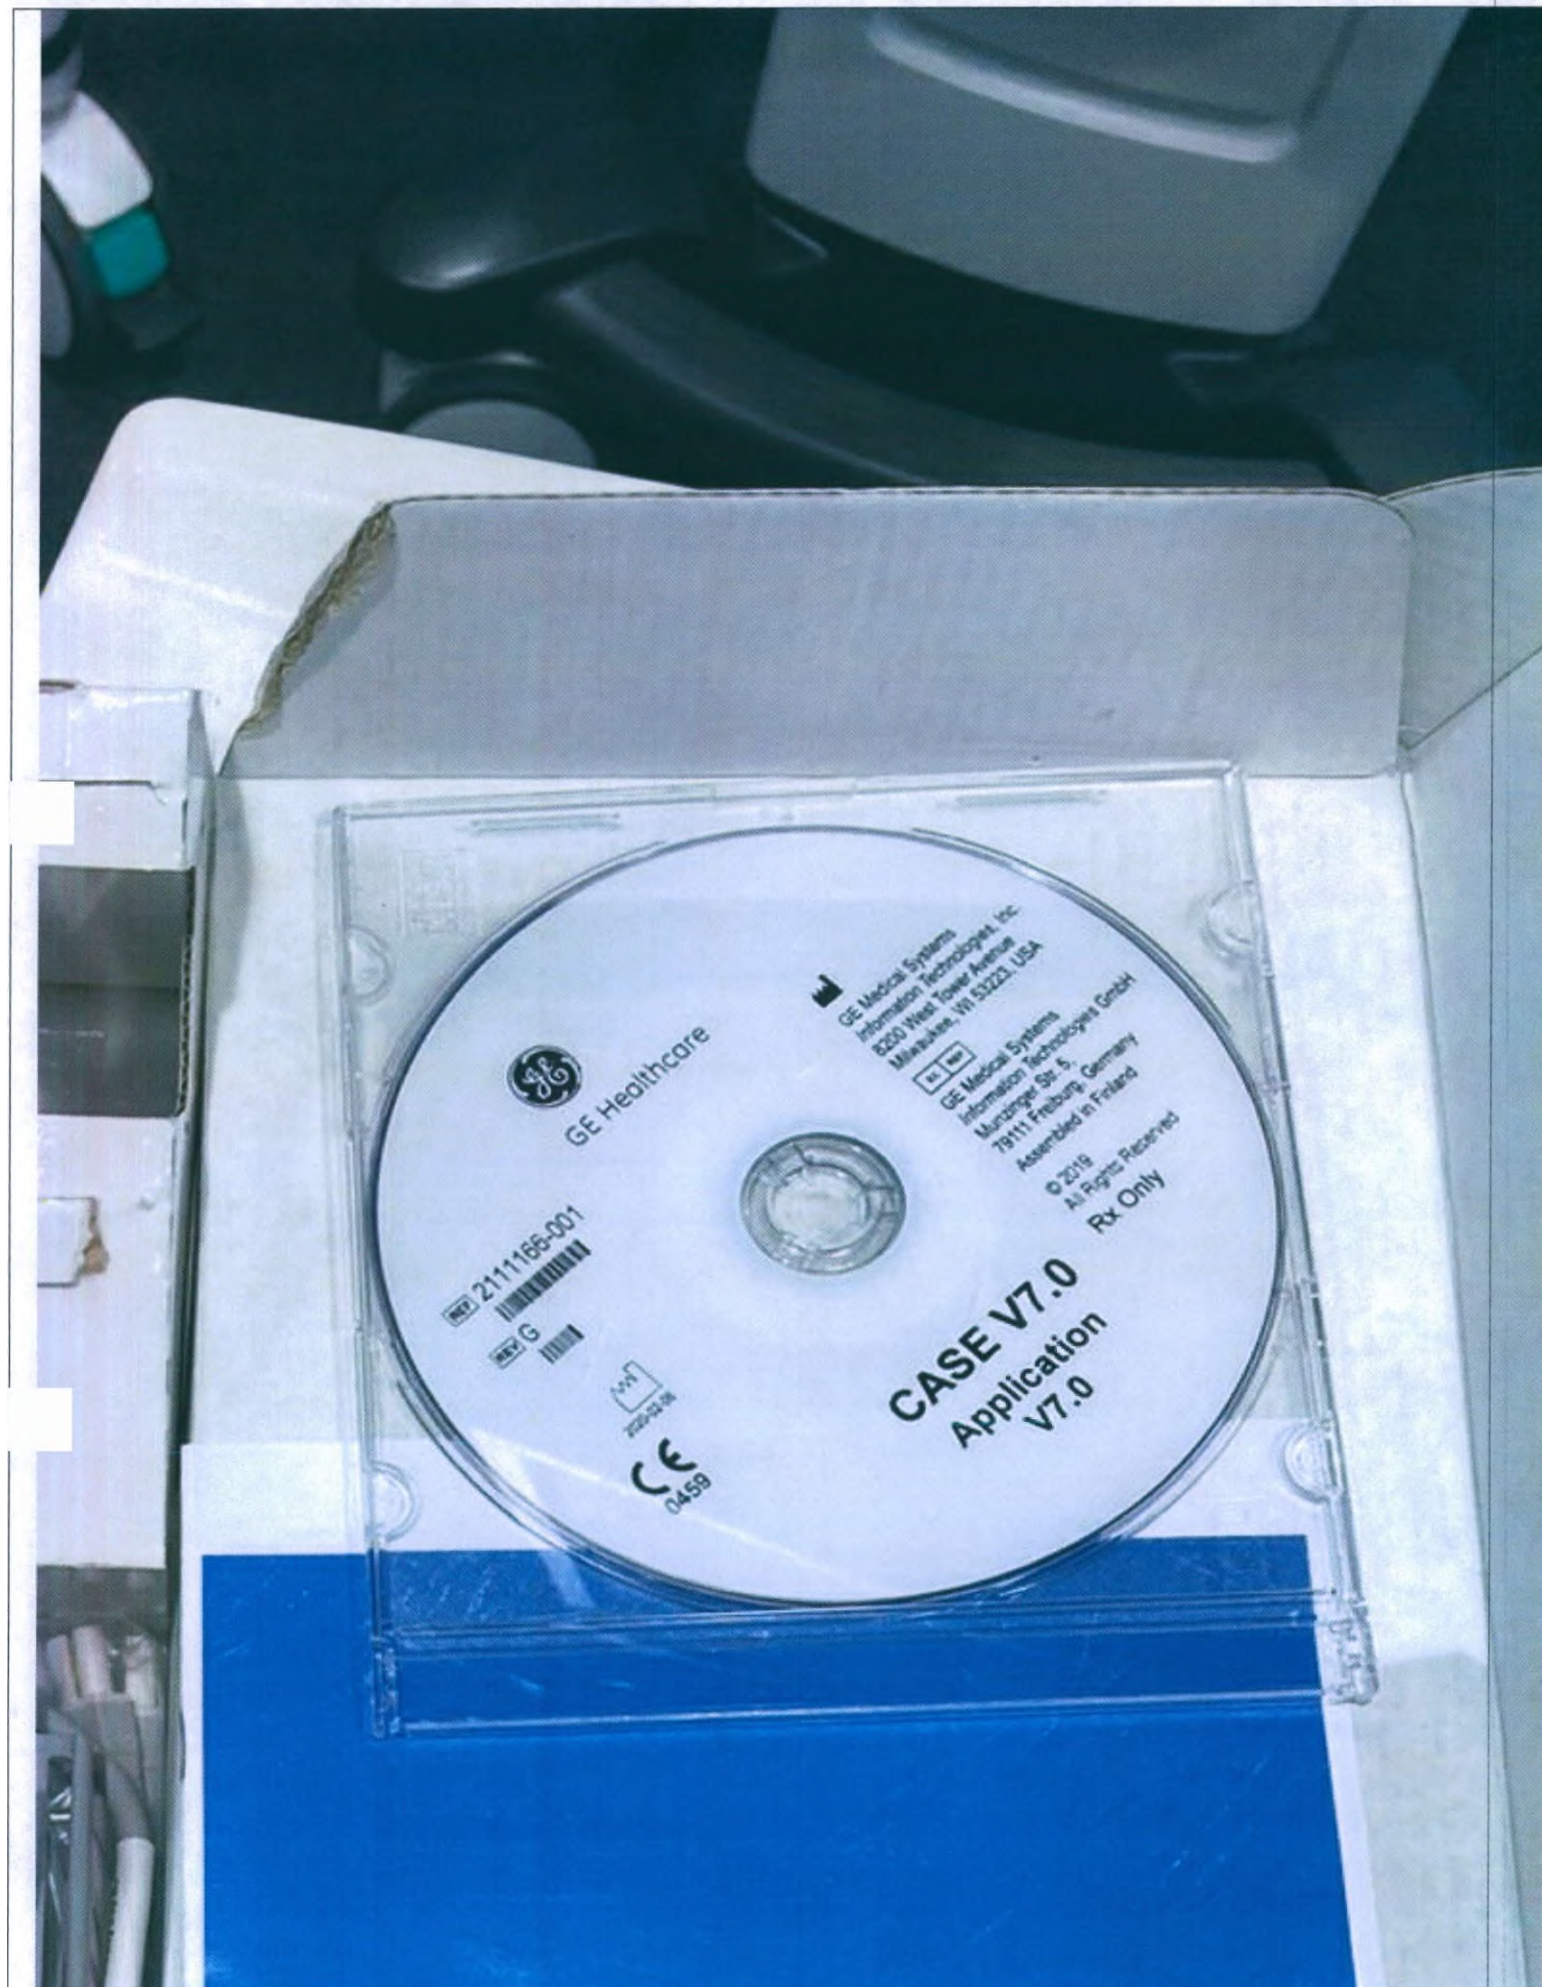


Фото 63.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: 20. Программное обеспечение на электронных или оптических носителях с маркировкой.



Фото 64.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 1: 21. Спреи электродные во флаконе менее 20 мл.

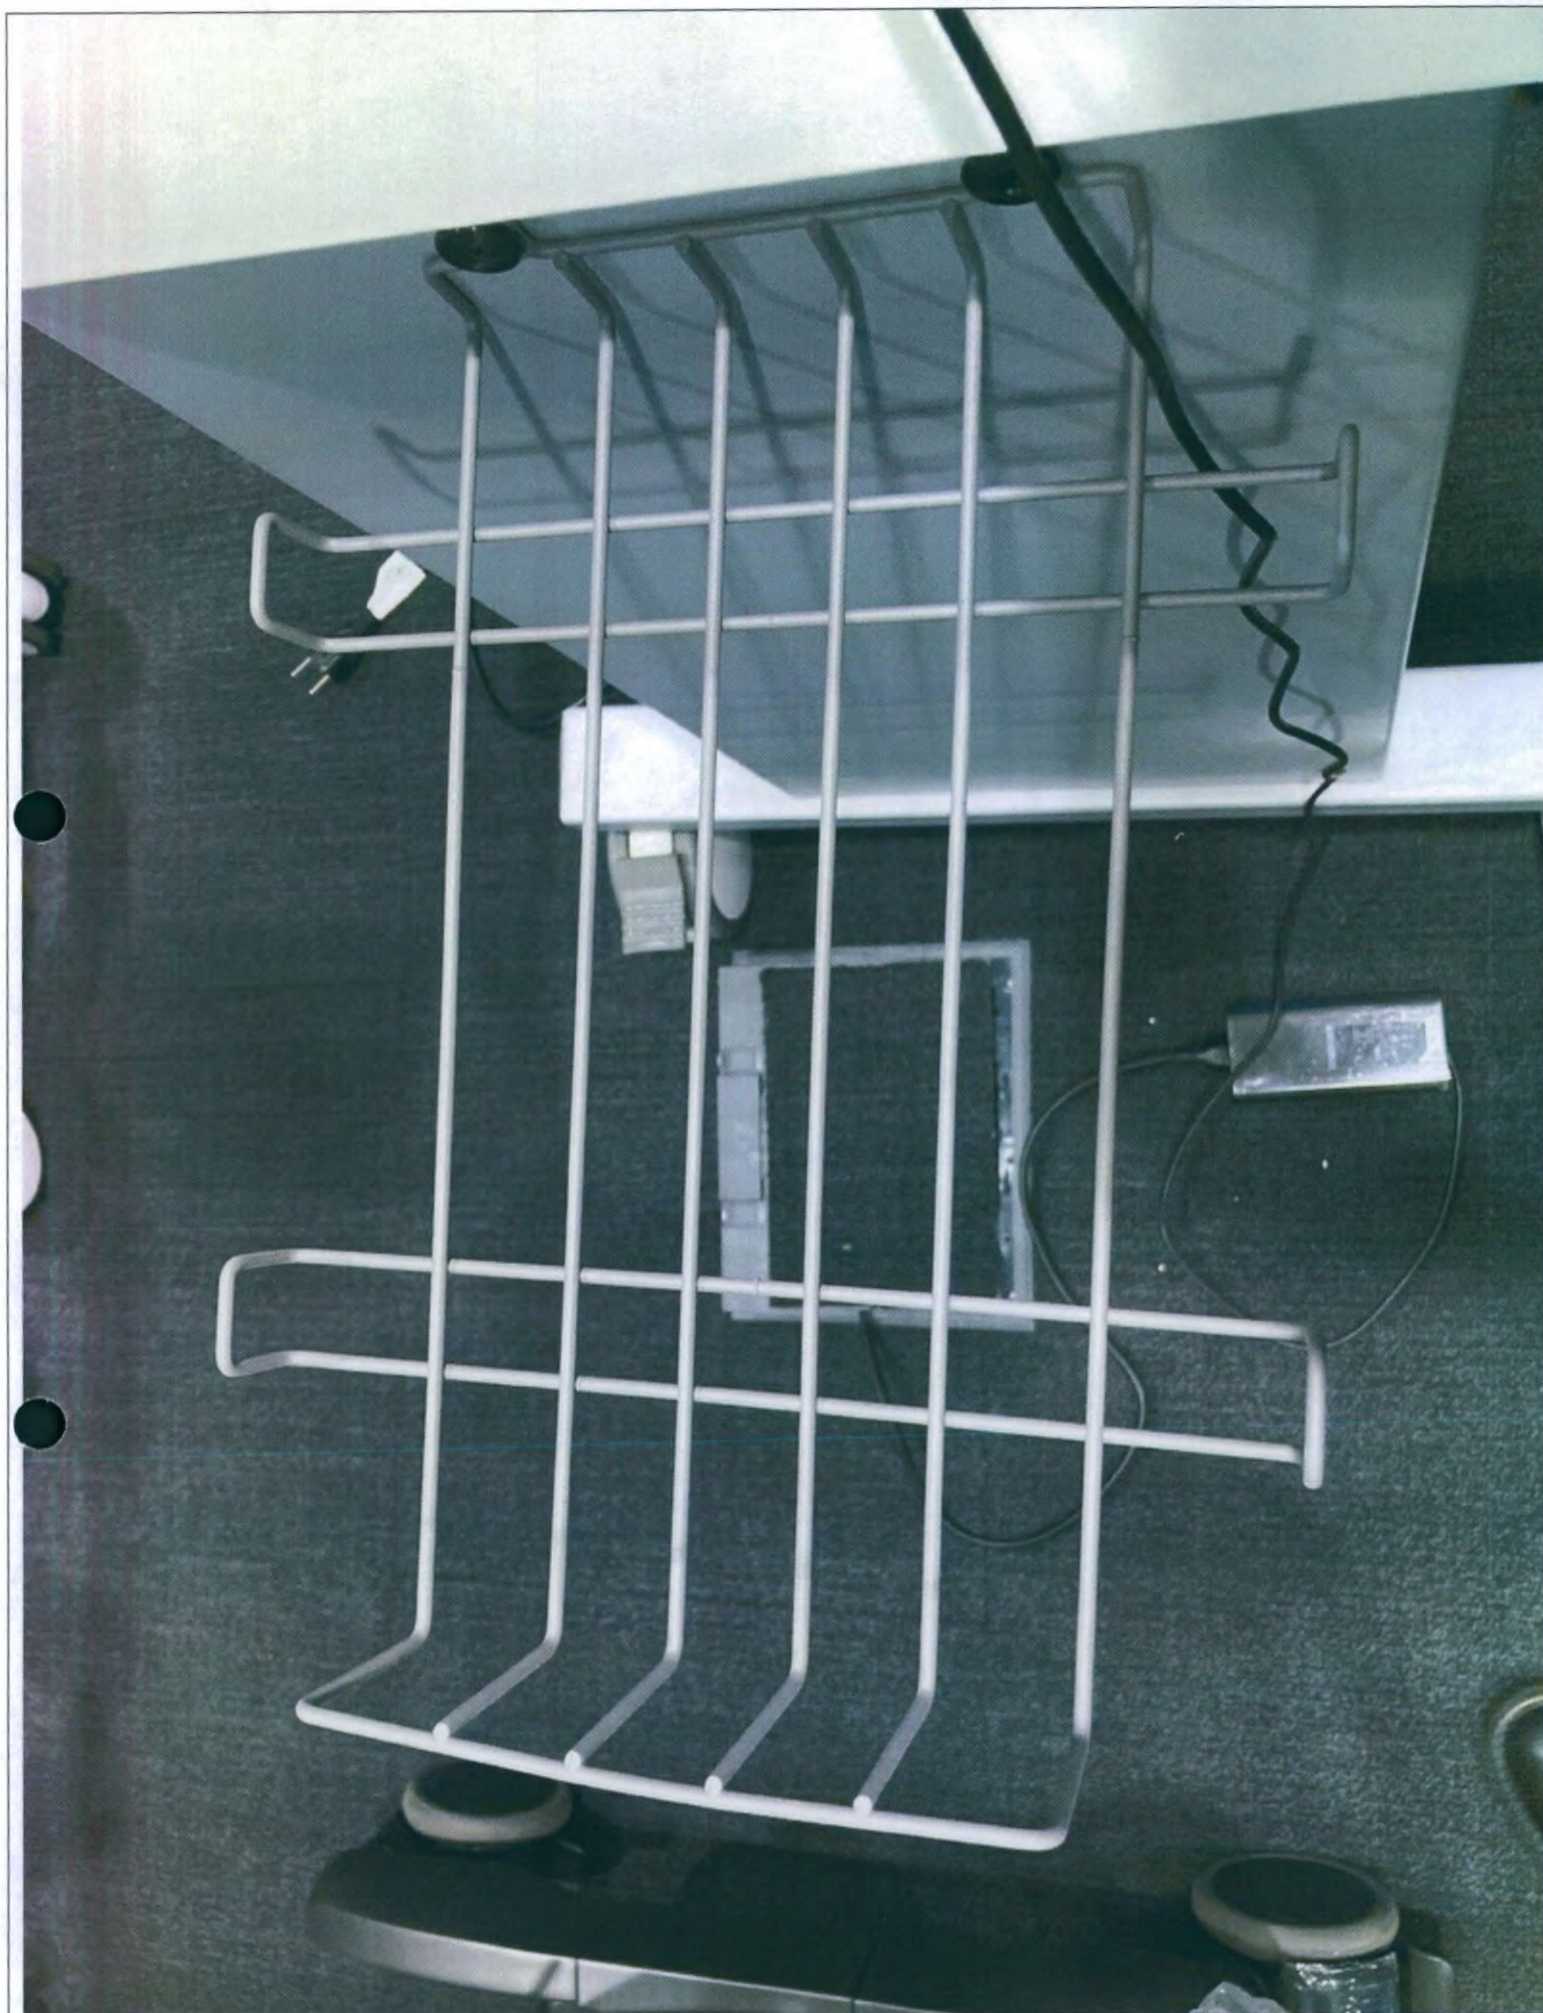


Фото 65.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
Принадлежности: 22. Лоток для бумаги.



Фото 66.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
 принадлежность: 23. Набор отведений для ЭКГ покоя с адаптерами IEC.



Фото 67.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru

принадлежности: 24. Набор из 10 проводов отведений.



Фото 68.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru

принадлежности: 25. Набор из 14 проводов отведений.

CAM 14 ECG Leadwire

Universal, Mixed Length, 14 per set


CAM 14 心电图导联线

通用, 混合长度, 14 根/套

REF 420101-001

Rev

T



GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.
通用电气医疗系统信息技术公司
8200 W. Tower Ave.
Milwaukee, WI 53223 USA
US Tel: (800) 558-7044
Canada Tel: (800) 668-0732
www.gehealthcare.com

EC REP

GE Medical Systems
Information Technologies GmbH
Munzingerstrasse 5
79111 Freiburg, Germany
Tel: (49) 761 45 43 0

Made in China
中国制造



GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.

256754

LOT

2020-06



Ref p/n 2064857-001_A

GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.
8200 W. Tower Ave.
Milwaukee, WI 53223 USA
Tel: (800) 558-7044
Fax: (800) 668-0732
1-800-558-7044 (US Only)
1-800-668-0732 (Canada Only)

EC REP

GE Medical Systems
Information Technologies GmbH
Munzingerstrasse 5
79111 Freiburg, Germany
Tel: (49) 761 45 43 0
Fax: (49) 761 45 43 233

Asia Headquarters

GE Medical Systems
Information Technologies Asia Co., Ltd.
11 Huafu Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Shanghai, People's Republic of China 201201
Tel: (86) 21 581 1200
Fax: (86) 21 581 1112

Фото 69.



Фото 70.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:



Фото 71.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: 27.

Система вакуумной аппликации электродов KISS.



Фото 72.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Панельности 27 Система вакуумной аппликации электродов KISS (маркировка).



CAM-USB / T-KISS

OA
OB

Фото 74.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: 20 Помпа для системы вакуумной аппликации электродов KISS.



CLASSIFIED
UL[®] US
E180632
 MEDICAL EQUIPMENT
 UL 60601-1 / CAN/CSA C22.2 No. 801.1
 IPX0
 Manufactured in Freiburg, Germany

GE Medical Systems Information
 Technologies GmbH, Munzinger Str. 5,
 79111 Freiburg, Germany

EC REP **PG**
 10,8V...13,2V DC 2A **CE** 0459

SN 101304703

QR CODE
 CAM-USB IN INTERFACE A/T KISS V2
 REF 2040438-009_REV-G
 (01)00840682109673
 (21)101304703
 (11)210417 2021-04-17

GE Medical Systems Information
 Technologies, Inc., 8200 W. Tower Ave,
 Wisconsin, USA
 Made in Germany

LBL P/N: 2060450-072

Configured in Finland
 lbl p/n 2060450-072 Rev.B

Фото 75.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:



Фото 76.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности:



Фото 77.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности:

31. Заглушки для распределительного блока системы KISS.

Blind Plug KISS

REF

30344427



Rev C



GE Medical Systems
Information Technologies Inc
8200 W. Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA
USTel: (800) 558-7044
Canada Tel: (800)663-0732

EC REP

GE Medical Systems
Information Technologies GmbH
Munzinger Strasse 5
D-79111 FREIBURG, Germany
Tel: +49 761 4543-0



Made in Germany

lbi p/n 2051023-001 Rev. A



GE Healthcare

LOT 1098519



2019 - 11

Фото 78.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности:

31. Заглушки для распределительного блока системы KISS (маркировка).

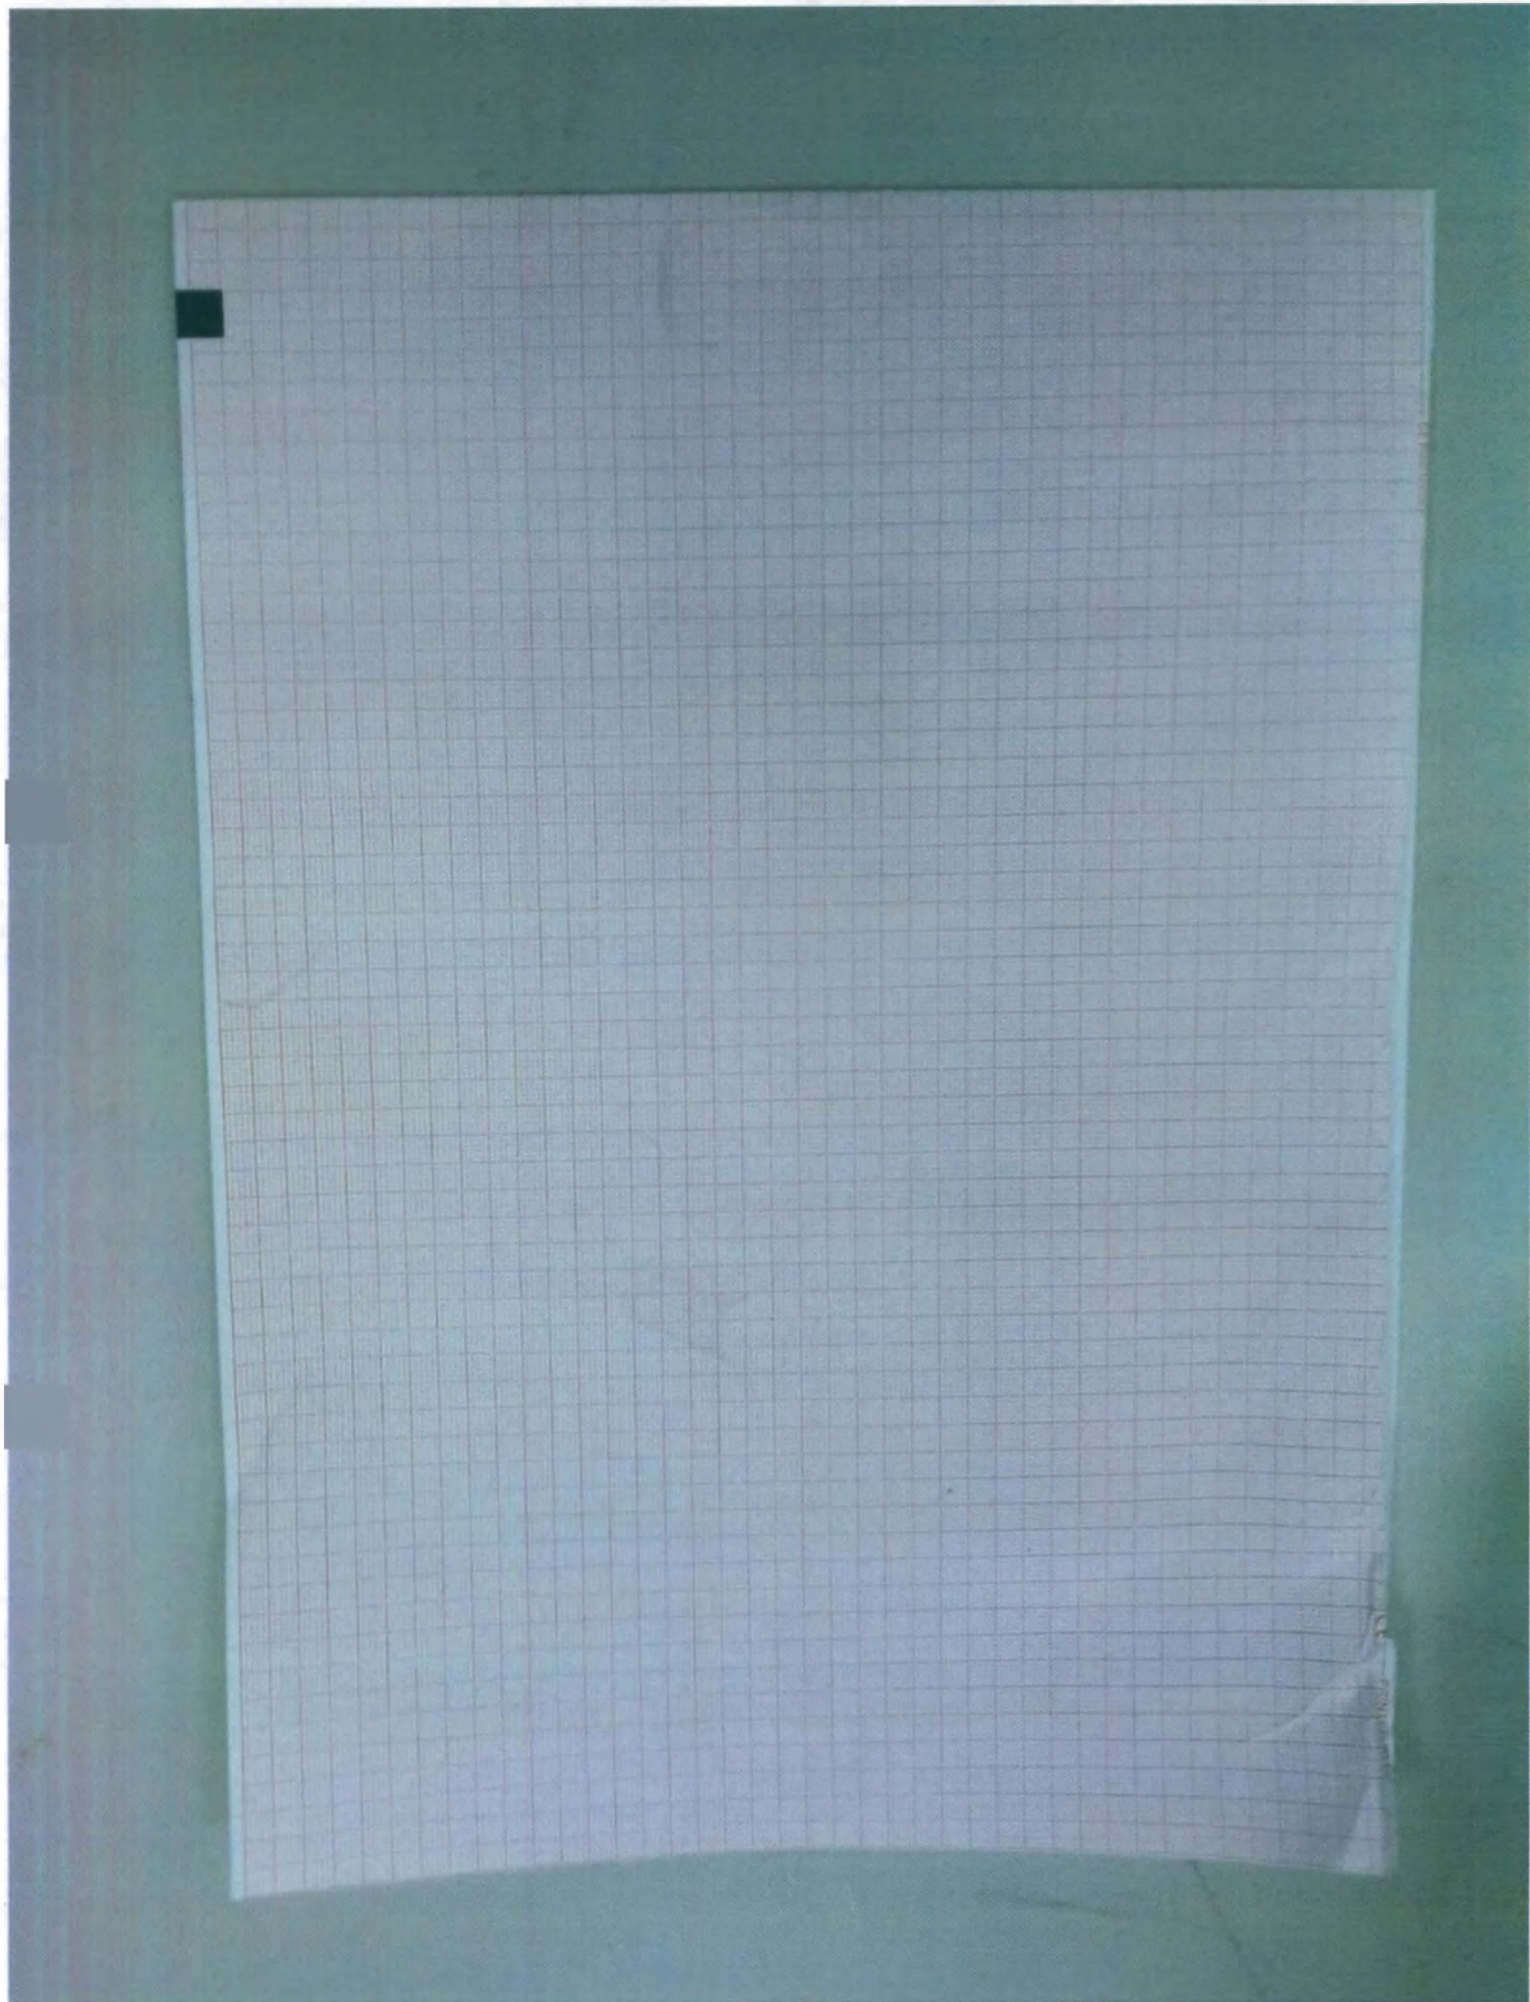


Фото 79.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности:

32. Термобумага А4.



Paper A4, Red Grid 205mm Wide,
Z-Fold, Block Queue, 150 sheets, 10 packs

REF 2104772-001

LOT

0000032909

QTY 1

en Paper A4, Red Grid 205mm Wide, Z-Fold, Block Queue,
150 sheets, 10 packs

hr Papir A4, crvena mreža širine 205 mm, Z-preklop,
red blokova, 150 listova, 10 paketa

da Papir A4, rødt gitter 205 mm bredt, Z-foldet, blokkø,
150 ark, 10 pakker

nl Papier A4, rood raster 205mm breed, Z-vouw,
blokkenrij, 150 vellen, 10 per pak

fr Papier A4, grille rouge 205 mm de largeur, pli Z,
série de carrés noirs, 150 feuilles, 10 paquets

de Papier A4, rotes Gitter 205mm breit, Z-Falz, Blockreihe,
150 Blätter, 10 Pakete

et Paber A4, 205 mm laiune punane joonestik,
Z-voltimisega, järjekorra blokeerimine, 150 lehte, 10 pakki

hu A4 papír, 205mm széles piros kocka, Z-hajtás,
tömbösor, 150 lap, 10 köteg

it Carta A4, millimetrata larghezza 205mm, piegatura a
fisarmonica, con tacca nera, 150 fogli, 10 confezioni

ja 用紙 A4、レッド方眼 205mm 幅、折りたたみ連続式、
ミシン目ブロック、150 枚、10 パック

kk A4 қағазы, Қызыл тор ені 205 мм, қатпарлы бүктеме,
блокты, 150 парақ, 10 қаптама

ko 용지 A4, 적색 격자 205mm 너비, Z접기, 블록 대기열,
150매, 10팩

no Papir A4, Rødt rutenett 205mm bredt, Z-fold,
blokket marg, 150 ark, 10 pakker

pt Papel A4, Grelha vermelha 205mm de largura,
dobra em Z, Bloco 150 folhas, 10 pacotes

pt-b Papel A4, Grade vermelha, 205mm de largura,
Dobra em Z, Fila de blocos, 150 folhas, 10 pacotes

ro Hârtie A4, caroiă roșu 205 mm lățime, pliure în Z, marca
lateral de identificare tip bloc, 150 de file, 10 pachete

zh A4 纸, 205mm 宽红格, Z 型折叠, 块队列,
150 张, 10 包

es Papel A4, cuadrícula roja de 205mm de ancho, plegado
en Z, fila de cuadrados negros, 150 hojas, 10 paquetes

sv Papper A4, Rött rutnät 205mm brett, Z-vikning,
färg markör, 150 blad, 10 paket

tr A4 kağıdı, Kırmızı Şerit 205mm Genişlik, Z Katlı,
Blok Sıralı, 150 yaprak, 10 paket

fi Paperi A4, Punainen ruudukko 205mm Leveä,
Z-Taitto, Reikäriivi, 150 arkkia, 10 pakettia

ru Бумага тепловая регистрационная для ЭКГ
диагностики, формат A4, красная сетка,
ширина 205mm, фальцовка гармошкой,
квадратные метки, 150 листов, 10 упаковок

Nissha Medical Technologies Ltd
Torbay Business Park
Woodview Road
Paignton, Devon, TQ4 7HP UK
+44(0) 1803 860 100

EC REP Nissha Medical Technologies SAS
Z.A. des Boutries
12 rue des Cayennes
78700 Conflans Sainte Honorine, France
+33(0)1 39 72 66 66

Printed in UK

Distributed by:
GE Healthcare Finland Oy
Kuusankatu 2
FI-00510 Helsinki, Finland
Tel. +358 10 394 11
www.gehealthcare.com

Türkiye İthalatçı / Turkish Importer
GE Medical Systems Türkiye Ltd. Şti.
Eminönü Mah. Hürriyet Sok. No: 8
34394 Şişli, İstanbul Türkiye



(01)05060441915153

MD

CE



4012017C
GCB47.03

Фото 80.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности:



Фото 81.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: 33. Носовой зажим.



Фото 82.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: 33. Носовой зажим (маркировка).



Фото 83.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU принадлежности: 34. Загубник.



Фото 84.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 34. Загубник (маркировка).

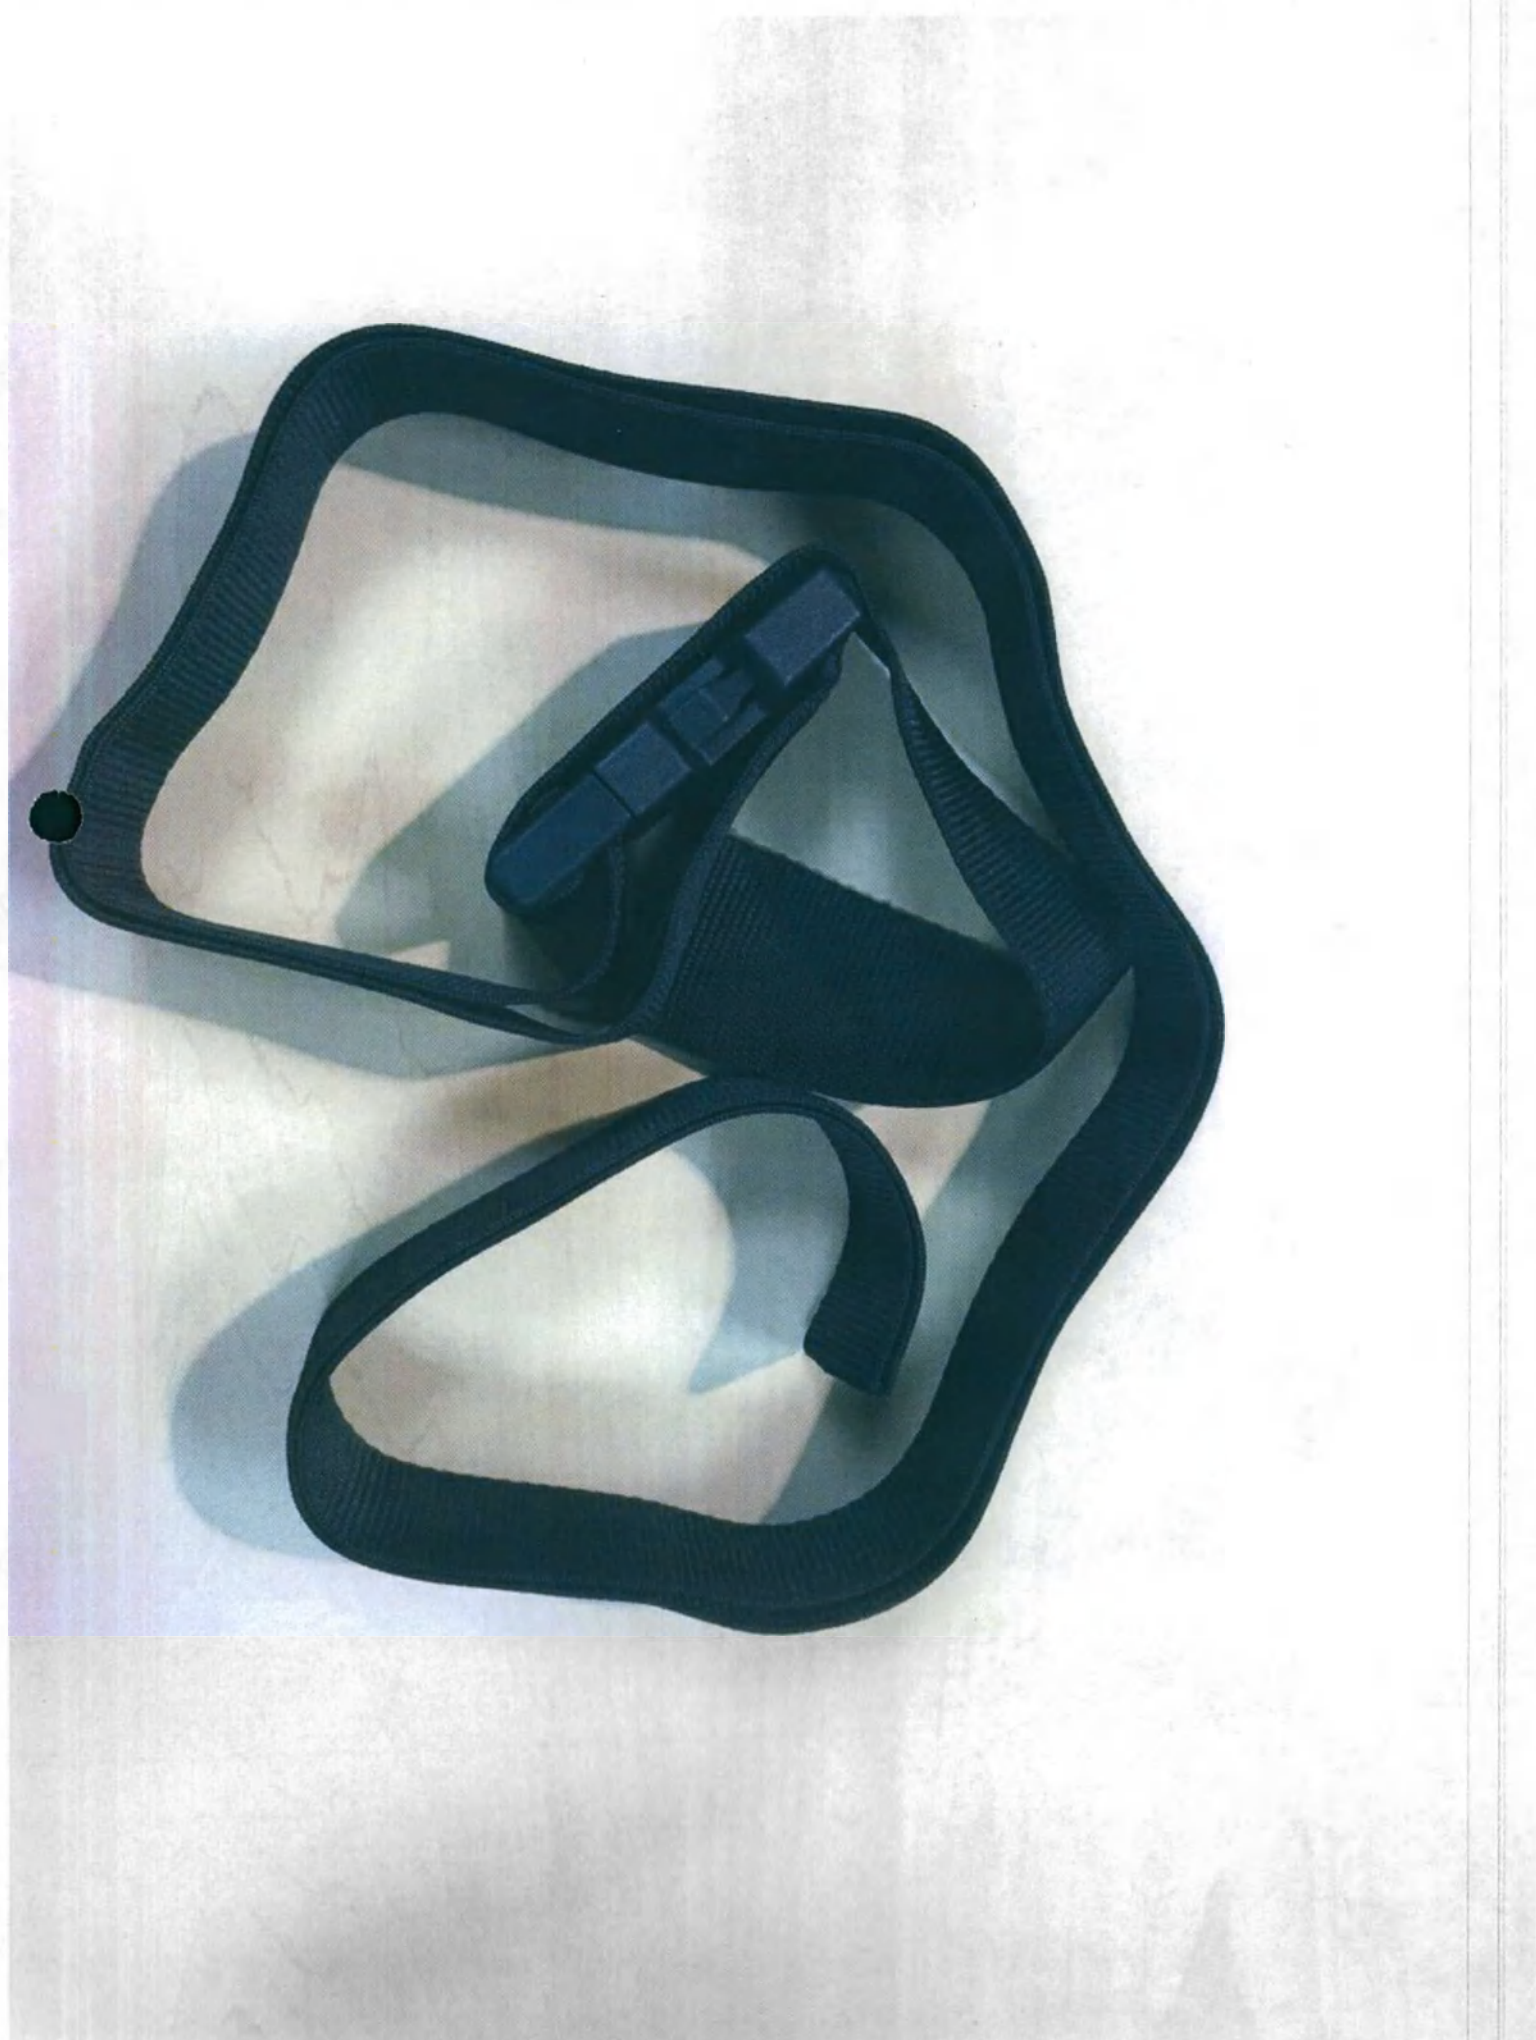


Фото 85.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
Принадлежности: 35. Ремень для модуля пациента.

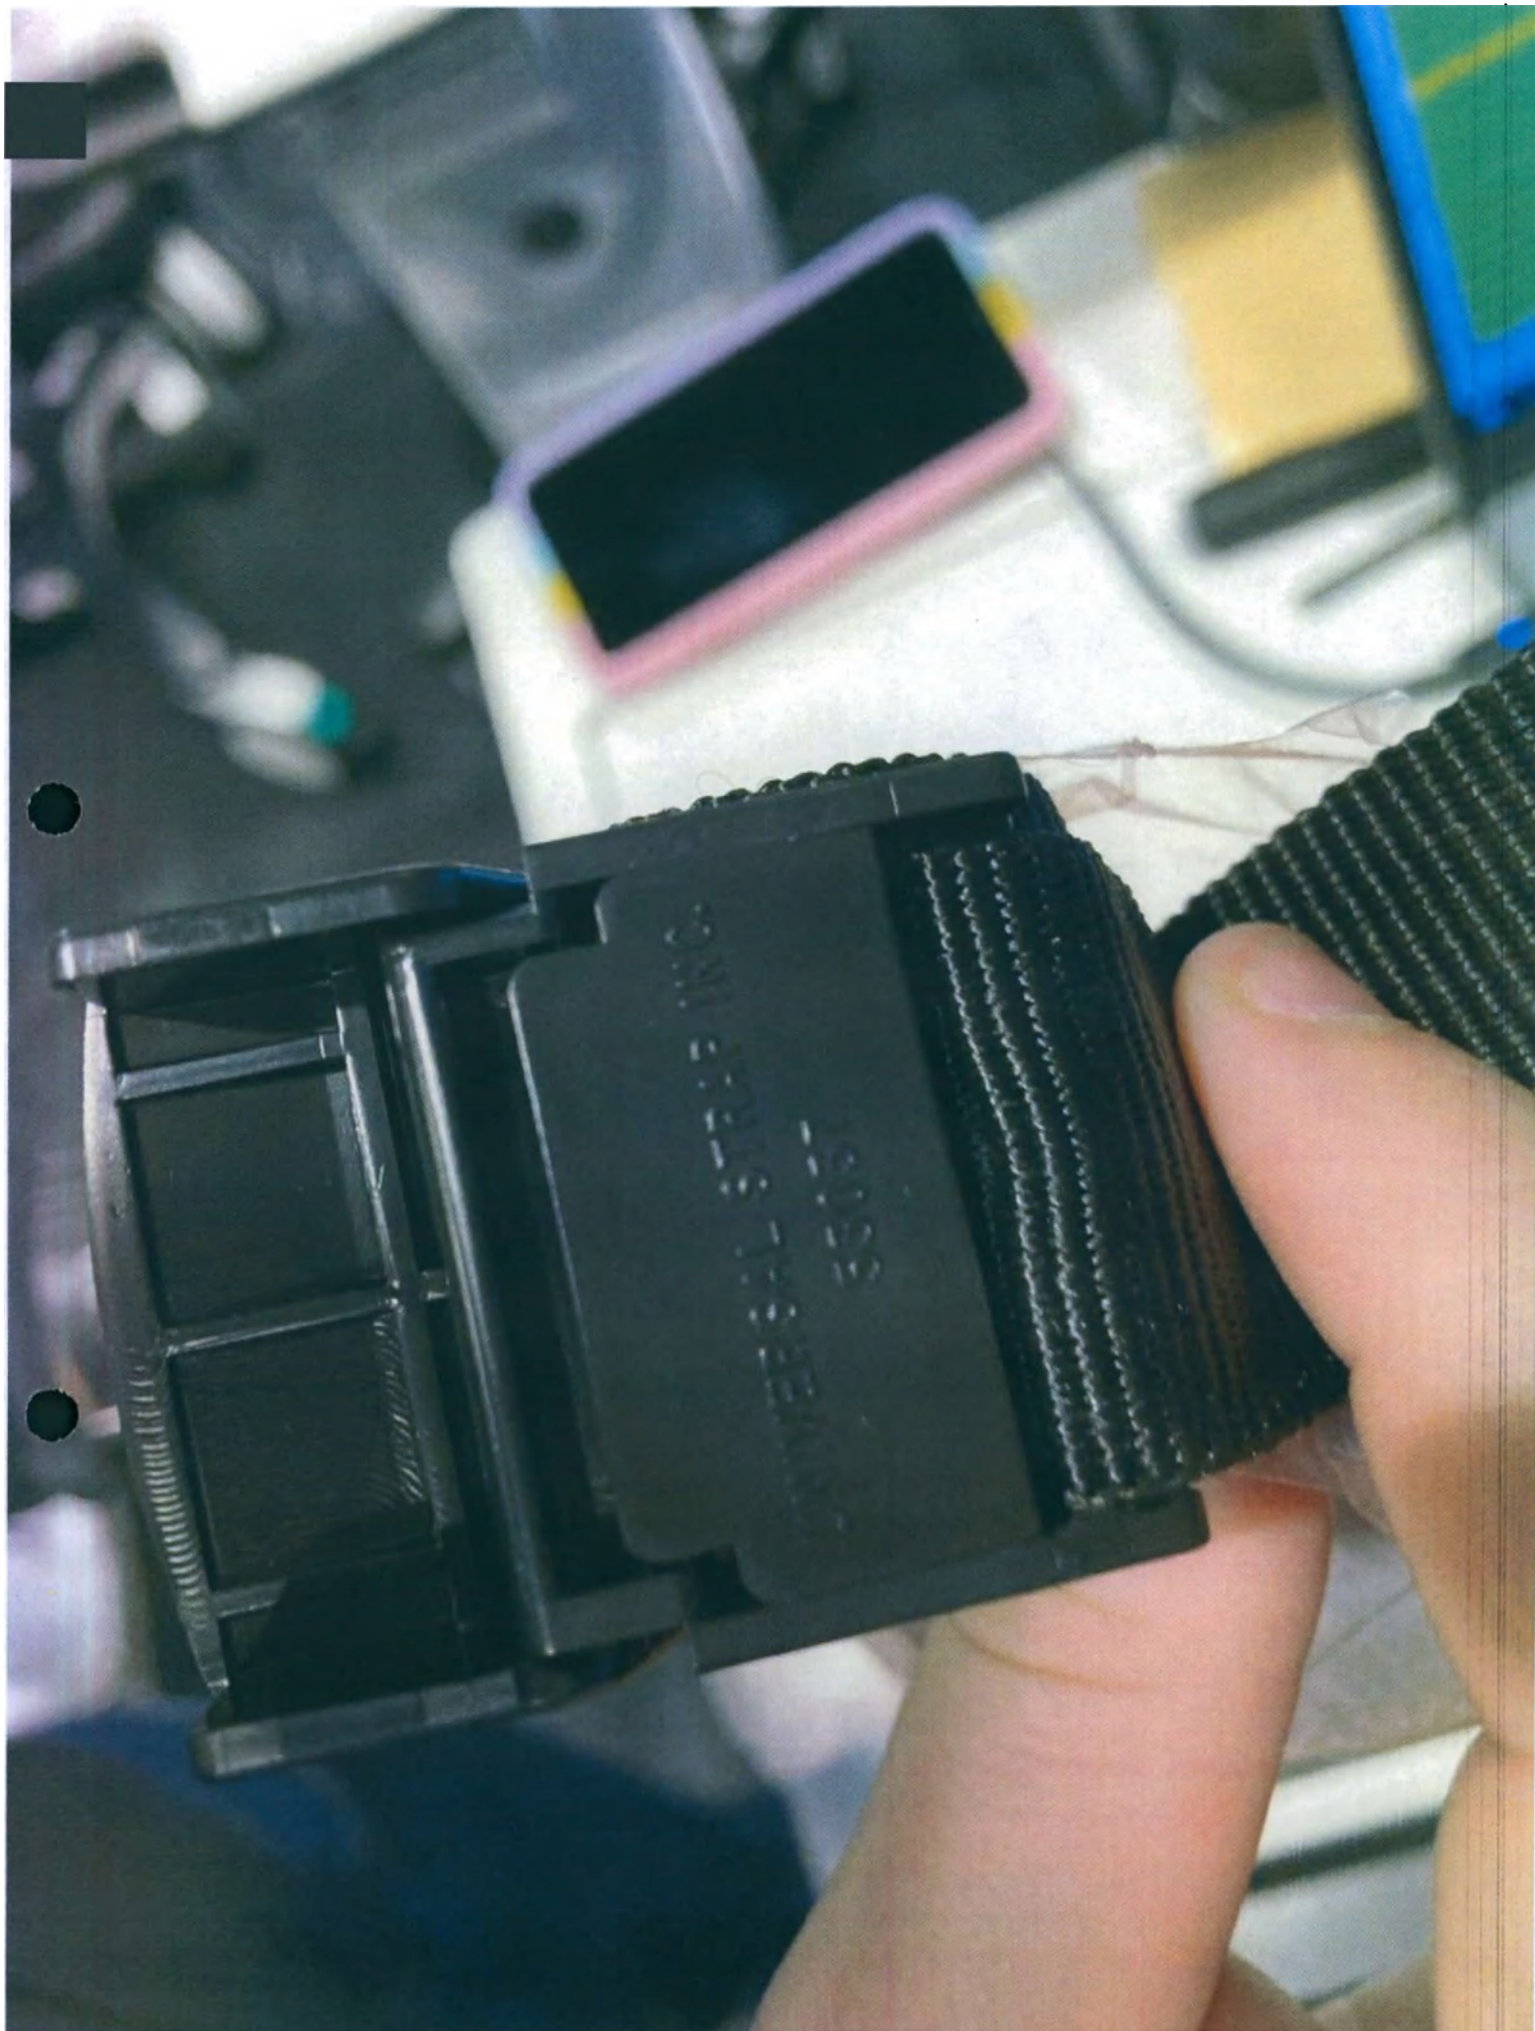


Фото 86.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 35.

Ремень для модуля пациента (маркировка).

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DiCOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202		15
	RESM Rest ECG Measurement	676022547474		15
	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737		15
	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt...	717463343454		15
	ERGM Remote View	014625276277		15
	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710		15
	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser...	662225425105		15
	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network ...	633104574174		15
	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser...	415552224360		15
	TWAA T Wave Alternans	402260732567		15
	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667		15
	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)			15
	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230		15
	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656		15
	BRWS MUSE Browser	437106765241		15
	RISK Risk Factors and Scores	761515710116		15
	EOGH ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471		15
	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175		15
	EPDF Export Report as PDF	217065556657		15
	EWRD Export Report as WORD	714575364620		15
	CDRW Archive to External Media			15

Print

Help

Фото 87.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 36. Программный ключ для активации программного обеспечения
 измерение ЭКГ покоя на оптических или электронных носителях, или код активации на
 бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
☒	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202		15
☒	RESM Rest ECG Measurement	676022547474		15
☒	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737		15
☒	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt...	717463343454		15
☒	ERGM Remote View	014625276277		15
☒	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710		15
☒	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser...	662225425105		15
☒	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network ...	633104574174		15
☒	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser...	415552224360		15
☒	TWAA T Wave Alternans	402260732567		15
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667		15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)			15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230		15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656		15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241		15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116		15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471		15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175		15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657		15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620		15
☒	CDRW Archive to External Media			15

Print

Help

Фото 88.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 37. Программный ключ для активации программного обеспечения
 интерпретации ЭКГ покоя на оптических или электронных носителях, или код активации
 на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DiCOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
☒	ERG3	Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452687	15
☒	CWEB	CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY	Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF	2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS	MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK	Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH	ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471	15
☒	EXPD	Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF	Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD	Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW	Archive to External Media		15
☒	DSPC	Screen Display Configuration	342243726061	15
☒	ITBL	In-Test Tabular Summary	615204367013	15
☒	ITRD	In-Test Trend	631744371607	15
☒	PRVT	Previous Test Retrieval	376016243653	15
☒	XEMR	EMR Interface	755767423644	15
☒	DICM	DiCOM Interface	756750374301	15
☒	ESPI	Ergospirometry		15
☒	STHY	ST/HR hysteresis	721547003466	15
☒	EXTI	Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Print

Help

Фото 89.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 38. Программный ключ для активации программного обеспечения
 гистерезис ST/ЧСС и интерпретация результатов теста с нагрузкой на оптических, или
 в носителях или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DiCOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667		15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)			15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230		15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656		15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241		15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116		15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module h...	727336473471		15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175		15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657		15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620		15
☒	CDRW Archive to External Media			15
☒	DSPC Screen Display Configuration	342243726061		15
☒	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013		15
☒	ITRD In-Test Trend	631744371607		15
☒	PRVT Previous Test Retrieval	376016243653		15
☒	XEMR EMR Interface	755767423644		15
☒	DiCM DiCOM Interface	756750374301		15
☒	ESPI Ergospirometry			15
☒	STHY ST/HR hysteresis	721547003466		15
☒	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277		15

Print

Help

Фото 90.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 39. Программный ключ для активации программного обеспечения
 гистерезис ST/ЧСС на оптических или электронных носителях, или код активации на
 бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DiCOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
☒	ERG3	Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667	15
☒	CWEB	CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY	Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF	2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS	MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK	Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH	ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471	15
☒	EXPD	Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF	Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD	Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW	Archive to External Media		15
☒	DSPC	Screen Display Configuration	342243726061	15
☒	ITBL	In-Test Tabular Summary	615204367013	15
☒	ITRD	In-Test Trend	631744371607	15
☒	PRVT	Previous Test Retrieval	376016243653	15
☒	XEMR	EMR Interface	755767423644	15
☒	DICM	DICOM Interface	756750374301	15
☒	ESPI	Ergospirometry		15
☒	STHY	ST/HR hysteresis	721547003466	15
☒	EXTI	Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Print

Help

Фото 91.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: 40. Программный ключ для активации программного обеспечения

выявления и документирования аритмий на оптических или электронных носителях, или

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DiCOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202		15
	RESM Rest ECG Measurement	676022547474		15
	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737		15
	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt...	717463343454		15
	ERGM Remote View	014625276277		15
	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710		15
	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser...	662225425105		15
	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network ...	633104574174		15
	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser...	415552224360		15
	TWAA T Wave Alternans	402260732567		15
	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667		15
	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)			15
	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230		15
	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656		15
	BRWS MUSE Browser	437106765241		15
	RtSK Risk Factors and Scores	761515710116		15
	ECGH ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471		15
	EXPD Export Data as XML/Excel	211706624175		15
	EPDF Export Report as PDF	217065556657		15
	EWRD Export Report as WORD	714575364620		15
	CDRW Archive to External Media			15

Print

Help

Фото 92.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 41. Программный ключ для активации программного обеспечения
 оценки факторов риска на оптических или электронных носителях, или код активации на
 бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DiCOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...		
☒	RESB	Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15	
☒	RESM	Rest ECG Measurement	676022547474	15	
☒	RESI	12 SL ECG Interpretation	564577352737	15	
☒	ERG2	Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt...	717463343454	15	
☒	ERGM	Remote View	014625276277	15	
☒	EGMO	Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15	
☒	NETS	Low-Volume Data Storage on Network Ser...	662225425105	15	
☒	NET2	Medium-Volume Data Storage on Network ...	633104574174	15	
☒	NET3	High-Volume Data Storage on Network Ser...	415552224360	15	
☒	TWAA	T Wave Alternans	402260732567	15	
☒	ERG3	Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667	15	
☒	CWEB	CardioSoft Web (requires hardware key)		15	
☒	ARRY	Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15	
☒	2DWF	2D Waterfall Display	477746517656	15	
☒	BRWS	MUSE Browser	437106765241	15	
☒	RISK	Risk Factors and Scores	761515710116	15	
☒	ECGH	ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471	15	
☒	EXPD	Export Data as XML/Excel	211705624175	15	
☒	EPDF	Export Report as PDF	217065556657	15	
☒	EWRD	Export Report as WORD	714575364620	15	
☒	CDRW	Archive to External Media		15	

Print

Help

Фото 93.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 42. Программный ключ для активации программного обеспечения
 сохранения полного отчета ЭКГ на оптических или электронных носителях, или код
 активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
☒	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202		15
☒	RESM Rest ECG Measurement	676022547474		15
☒	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737		15
☒	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt...	717463343454		15
☒	ERGM Remote View	014625276277		15
☒	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710		15
☒	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser...	662225425105		15
☒	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network ...	633104574174		15
☒	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser...	415552224360		15
☒	TWAA T Wave Alternans	402260732567		15
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667		15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)			15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230		15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656		15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241		15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116		15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471		15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175		15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657		15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620		15
☒	CDRW Archive to External Media			15

Print

Help

Фото 94.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 43. Программный ключ для активации программного обеспечения истории ЭКГ на оптических или электронных носителях, или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667		15
	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)			15
	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230		15
	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656		15
	BRWS MUSE Browser	437106765241		15
	RISK Risk Factors and Scores	761515710116		15
	ECGH ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471		15
	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175		15
	EPDF Export Report as PDF	217065556657		15
	EWRD Export Report as WORD	714575364620		15
	CDRW Archive to External Media			15
	DSPC Screen Display Configuration	342243726061		15
	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013		15
	ITRD In-Test Trend	631744371607		15
	PRVT Previous Test Retrieval	376016243653		15
	XEMR EMR Interface	755767423644		15
	DICM DICOM Interface	756750374301		15
	ESPI Ergospirometry			15
	STHY ST/HR hysteresis	721547003466		15
	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277		15

Фото 95.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 44. Программный ключ для активации комбинированной опции
 табличного итогового отчета и тренда во время теста на оптических или электронных
 носителях, или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
☒	RESB	Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
☒	RESM	Rest ECG Measurement	676022547474	15
☒	RESI	12 SL ECG Interpretation	564577352737	15
☒	ERG2	Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt...	717463343454	15
☒	ERGM	Remote View	014625276277	15
☒	EGMO	Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
☒	NETS	Low-Volume Data Storage on Network Ser...	662225425105	15
☒	NET2	Medium-Volume Data Storage on Network ...	633104574174	15
☒	NET3	High-Volume Data Storage on Network Ser...	415552224360	15
☒	TWAA	T Wave Alternans	402260732567	15
☒	ERG3	Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667	15
☒	CWEB	CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY	Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF	2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS	MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK	Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH	ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471	15
☒	EXPD	Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF	Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD	Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW	Archive to External Media		15

Фото 96.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 45. Программный ключ для активации программного обеспечения
 изменения Т-зубца на оптических или электронных носителях, или код активации на
 бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DiCOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
☒	ERG3	Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667	15
☒	CWEB	CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY	Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF	2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS	MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK	Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH	ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471	15
☒	EXPD	Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF	Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD	Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW	Archive to External Media		15
☒	DSPC	Screen Display Configuration	342243726061	15
☒	ITBL	In-Test Tabular Summary	615204367013	15
☒	ITRD	In-Test Trend	631744371607	15
☒	PRVT	Previous Test Retrieval	376016243653	15
☒	XEMR	EMR Interface	755767423644	15
☒	DICM	DICOM Interface	756750374301	15
☒	ESPI	Ergospirometry		15
☒	STHY	ST/HR hysteresis	721547003466	15
☒	EXTI	Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Фото 97.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 46. Программный ключ для активации программного обеспечения
 восстановления предыдущего теста на оптических или электронных носителях, или код
 активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration	
☒	RESB	Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
☒	RESM	Rest ECG Measurement	676022547474	15
☒	RESI	12 SL ECG Interpretation	564577352737	15
☒	ERG2	Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt...	717463343454	15
☒	ERGM	Remote View	014625276277	15
☒	EGMO	Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
☒	NET5	Low-Volume Data Storage on Network Ser...	662225425105	15
☒	NET2	Medium-Volume Data Storage on Network	633104574174	15
☒	NET3	High-Volume Data Storage on Network Ser...	415552224360	15
☒	TWAA	T Wave Alternans	402260732567	15
☒	ERG3	Exercise Test Expert Mode (requires Exero...	247340452667	15
☒	CWEB	CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY	Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF	2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS	MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK	Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	EOGH	ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471	15
☒	EXPD	Export Data as XML/Excel	211706624175	15
☒	EPDF	Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD	Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDFW	Archive to External Media		15

Фото 98.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 47. Программный ключ для активации программного обеспечения
 тест с нагрузкой и экспертный режим теста с нагрузкой на оптических или электронных
 носителях, или код активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
✗	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202		15
✗	RESM Rest ECG Measurement	676022547474		15
✗	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737		15
✗	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt...	717463343454		15
✗	ERGM Remote View	014625276277		15
✗	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710		15
✗	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser...	662225425105		15
✗	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network ...	633104574174		15
✗	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser...	415552224360		15
✗	TWAA T Wave Alternans	402260732567		15
✗	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667		15
✗	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)			15
✗	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230		15
✗	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656		15
✗	BRWS MUSE Browser	437106765241		15
✗	RISK Risk Factors and Scores	761515710116		15
✗	ECGH ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471		15
✗	EXPD Export Data as XML/Excel	211706624175		15
✗	EPDF Export Report as PDF	217065556657		15
✗	EWRD Export Report as WORD	714575364620		15
✗	CDRW Archive to External Media			15

Фото 99.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 48. Программный ключ для активации программного обеспечения каскадного экрана в двумерном изображении на оптических или электронных носителях,
 ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU для активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
☒	RESB	Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
☒	RESM	Rest ECG Measurement	676022547474	15
☒	RESI	12 SL ECG Interpretation	564577352737	15
☒	ERG2	Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt...	717463343454	15
☒	ERGM	Remote View	014625276277	15
☒	EGMO	Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
☒	NETS	Low-Volume Data Storage on Network Ser...	662225425105	15
☒	NET2	Medium-Volume Data Storage on Network ...	633104574174	15
☒	NET3	High-Volume Data Storage on Network Ser...	415552224360	15
☒	TWAA	T Wave Alternans	402260732567	15
☒	ERG3	Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667	15
☒	CWEB	CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY	Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF	2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS	MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK	Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH	ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471	15
☒	EXPD	Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF	Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD	Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW	Archive to External Media		15

Фото 100.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 49. Программный ключ для активации программного обеспечения
 теста с нагрузкой на оптических или электронных носителях, или код активации на
 бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667		15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)			15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230		15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656		15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241		15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116		15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition moduleh...	727336473471		15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175		15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657		15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620		15
☒	CDRW Archive to External Media			15
☒	DSPC Screen Display Configuration	342243726061		15
☒	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013		15
☒	ITRD In-Test Trend	631744371607		15
☒	PRVT Previous Test Retrieval	376016243653		15
☒	XEMR EMR Interface	755767423644		15
☒	DICM DICOM Interface	756750374301		15
☒	ESPI Ergospirometry			15
☒	STHY ST/HR hysteresis	721547003466		15
☒	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277		15

Фото 101.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности:

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
☒	ERG3	Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667	15
☒	CWEB	CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY	Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF	2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS	MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK	Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	EOGH	ECG History (requires acquisition module)	727336473471	15
☒	EXPD	Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF	Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD	Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW	Archive to External Media		15
☒	DSPC	Screen Display Configuration	342243726061	15
☒	ITBL	In-Test Tabular Summary	615204367013	15
☒	ITRD	In-Test Trend	631744371607	15
☒	PRVT	Previous Test Retrieval	376016243653	15
☒	XEMR	EMR Interface	755767423644	15
☒	DICM	DICOM Interface	756750374301	15
☒	ESPI	Ergospirometry		15
☒	STHY	ST/HR hysteresis	721547003466	15
☒	EXTI	Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Фото 102.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 51. Программный ключ для активации программного обеспечения экспорта данных в форматах Excel или XML на оптических или электронных носителях,
 ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU для активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration	
	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667		15
	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)			15
	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230		15
	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656		15
	BRWS MUSE Browser	437106765241		15
	RISK Risk Factors and Scores	761515710116		15
	ECGH ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471		15
	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175		15
	EPDF Export Report as PDF	217065556657		15
	EWRD Export Report as WORD	714575364620		15
	CDRW Archive to External Media			15
	DSPC Screen Display Configuration	342243726061		15
	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013		15
	ITRD In-Test Trend	631744371607		15
	PRVT Previous Test Retrieval	376016243653		15
	XEMR EMR Interface	755767423644		15
	DICM DICOM Interface	756750374301		15
	ESPI Ergospirometry			15
	STHY ST/HR hysteresis	721547003466		15
	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277		15

Фото 103.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
Принадлежности: 52. Программный ключ для активации программного обеспечения
экспорта отчета как файла Word на оптических или электронных носителях, или код

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration	
☒	ERG3	Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667	15
☒	CWEB	CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY	Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF	2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS	MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK	Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH	ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471	15
☐	EXPD	Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF	Export Report as PDF	217065558657	15
☒	EWRD	Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW	Archive to External Media		15
☒	DSPC	Screen Display Configuration	342243726061	15
☒	ITBL	In-Test Tabular Summary	615204367013	15
☒	ITRD	In-Test Trend	631744371607	15
☒	PRVT	Previous Test Retrieval	376016243653	15
☒	XEMR	EMR Interface	755767423644	15
☐	DICM	DICOM Interface	756750374301	15
☒	ESPI	Ergospirometry		15
☒	STHY	ST/HR hysteresis	721547003466	15
☒	EXTI	Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277	15

Фото 104.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 53. Программный ключ для активации программного обеспечения
 экспорта отчета как файла PDF на оптических или электронных носителях, или код
 активации на бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DiCOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667		15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)			15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230		15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656		15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241		15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116		15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471		15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175		15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657		15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620		15
☒	CDRW Archive to External Media			15
☒	DSPC Screen Display Configuration	342243726061		15
☒	ITBL In-Test Tabular Summary	615204367013		15
☒	ITRD In-Test Trend	631744371607		15
☒	PRVT Previous Test Retrieval	376016243653		15
☒	XEMR EMR Interface	755767423644		15
☒	DICM DiCOM Interface	756750374301		15
☒	ESPI Ergospirometry			15
☒	STHY ST/HR hysteresis	721547003466		15
☒	EXTI Exercise Test Interpretation (XTI)	777115024277		15

Фото 105.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 54. Программный ключ для активации программного обеспечения
 браузер MUSE на оптических или электронных носителях, или код активации на
 бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
☒	RESB	Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202	15
☒	RESM	Rest ECG Measurement	676022547474	15
☒	RESI	12 SL ECG Interpretation	564577352737	15
☒	ERG2	Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt...	717463343454	15
☒	ERGM	Remote View	014625276277	15
☒	EGMO	Storage of Full Disclosure ECG	734344242710	15
☒	NETS	Low-Volume Data Storage on Network Ser...	662225425105	15
☒	NET2	Medium-Volume Data Storage on Network ...	633104574174	15
☒	NET3	High-Volume Data Storage on Network Ser...	415552224360	15
☒	TWAA	T Wave Alternans	402260732567	15
☒	ERG3	Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667	15
☒	CWEB	CardioSoft Web (requires hardware key)		15
☒	ARRY	Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230	15
☒	2DWF	2D Waterfall Display	477746517656	15
☒	BRWS	MUSE Browser	437106765241	15
☒	RISK	Risk Factors and Scores	761515710116	15
☒	ECGH	ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471	15
☒	EXPD	Export Data as XML/Excel	211705624175	15
☒	EPDF	Export Report as PDF	217065556657	15
☒	EWRD	Export Report as WORD	714575364620	15
☒	CDRW	Archive to External Media		15

Фото 106.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
Принадлежности: 55. Программный ключ для активации программного обеспечения
сохранения данных на сетевом сервере на оптических или электронных носителях, или

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

		Option Code	Expiration ...	
☒	RESB Rest ECG/Exercise Test Standard	737314536202		15
☒	RESM Rest ECG Measurement	676022547474		15
☒	RESI 12 SL ECG Interpretation	564577352737		15
☒	ERG2 Exercise Test AT (ST Measurement, Arrhyt...	717463343454		15
☒	ERGM Remote View	014625276277		15
☒	EGMO Storage of Full Disclosure ECG	734344242710		15
☒	NETS Low-Volume Data Storage on Network Ser...	662225425105		15
☒	NET2 Medium-Volume Data Storage on Network ...	633104574174		15
☒	NET3 High-Volume Data Storage on Network Ser...	415552224360		15
☒	TWAA T Wave Alternans	402260732567		15
☒	ERG3 Exercise Test Expert Mode (requires Exerci...	247340452667		15
☒	CWEB CardioSoft Web (requires hardware key)			15
☒	ARRY Arrhythmia Detection / Documentation	134677461230		15
☒	2DWF 2D Waterfall Display	477746517656		15
☒	BRWS MUSE Browser	437106765241		15
☒	RISK Risk Factors and Scores	761515710116		15
☒	ECGH ECG History (requires acquisition module/h...	727336473471		15
☒	EXPD Export Data as XML/Excel	211705624175		15
☒	EPDF Export Report as PDF	217065556657		15
☒	EWRD Export Report as WORD	714575364620		15
☒	CDRW Archive to External Media			15

Фото 107.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 56. Программный ключ для активации программного обеспечения удаленного просмотра на оптических или электронных носителях, или код активации на бумажном носителе.

Install CASE Application

The CASE application should be installed on all CASE workstations. Do not install it on the server.

CAUTIONS

- Install the application only after you configure the CardioSoft network ("Configure the Network" on page 3-23) and save the existing data ("Save Existing Data" on page 3-35).
- Install the application on **ONLY ONE** workstation at a time. Attempting to install it on more than one workstation at the same time may corrupt the installation on **ALL** workstations.

Choose to use either a UNC path or a mapped drive to access the CardioSoft server.

Network Installation using UNC:

1. Log in as local Admin.
2. To install the CASE V7.0 application, launch setup.exe in the directory *C:\Support Software\CASE V7.0\CASE*.
3. At the *Choose Program Files Destination* screen (default *D:\CASE*), click *Next*.
 - At the *Choose Database Destination* screen (default *D:\CASE*), select *Browse*.
 - Do not enter the UNC path directly but select *Network* and browse to the CardioSoft server.
 - Double-click the server name and enter *User Name* and *Password* of the *Network User*.
 - If the CASE system is part of a Domain, then enter *[Domain Name]\[Network User]*.
 - Now select the shared folder *cardio*.
 - Verify that the UNC path name of the shared folder *cardio* (e.g. *\\server\cardio*) is displayed in the *Path* edit box.
 - Click *Confirm*.

NOTE

If a network error message is shown, ensure that the server firewall does not block the incoming request.

4. Finish the installation and reboot the system as prompted.

NOTE

If Expert Mode was enabled at the beginning of the installation procedure, the Application Data directory can be selected on a **CITRIX** server. This directory contains CASE-related files, such as configuration and log files. By default, the Application Data directory is set to *D:\CASE*.

Network Installation using a mapped drive:

1. Log in as local Admin.
2. Map the next available drive letter (e.g. *F:*) to the *cardio* shared folder on the CardioSoft server.

Фото 108.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности:

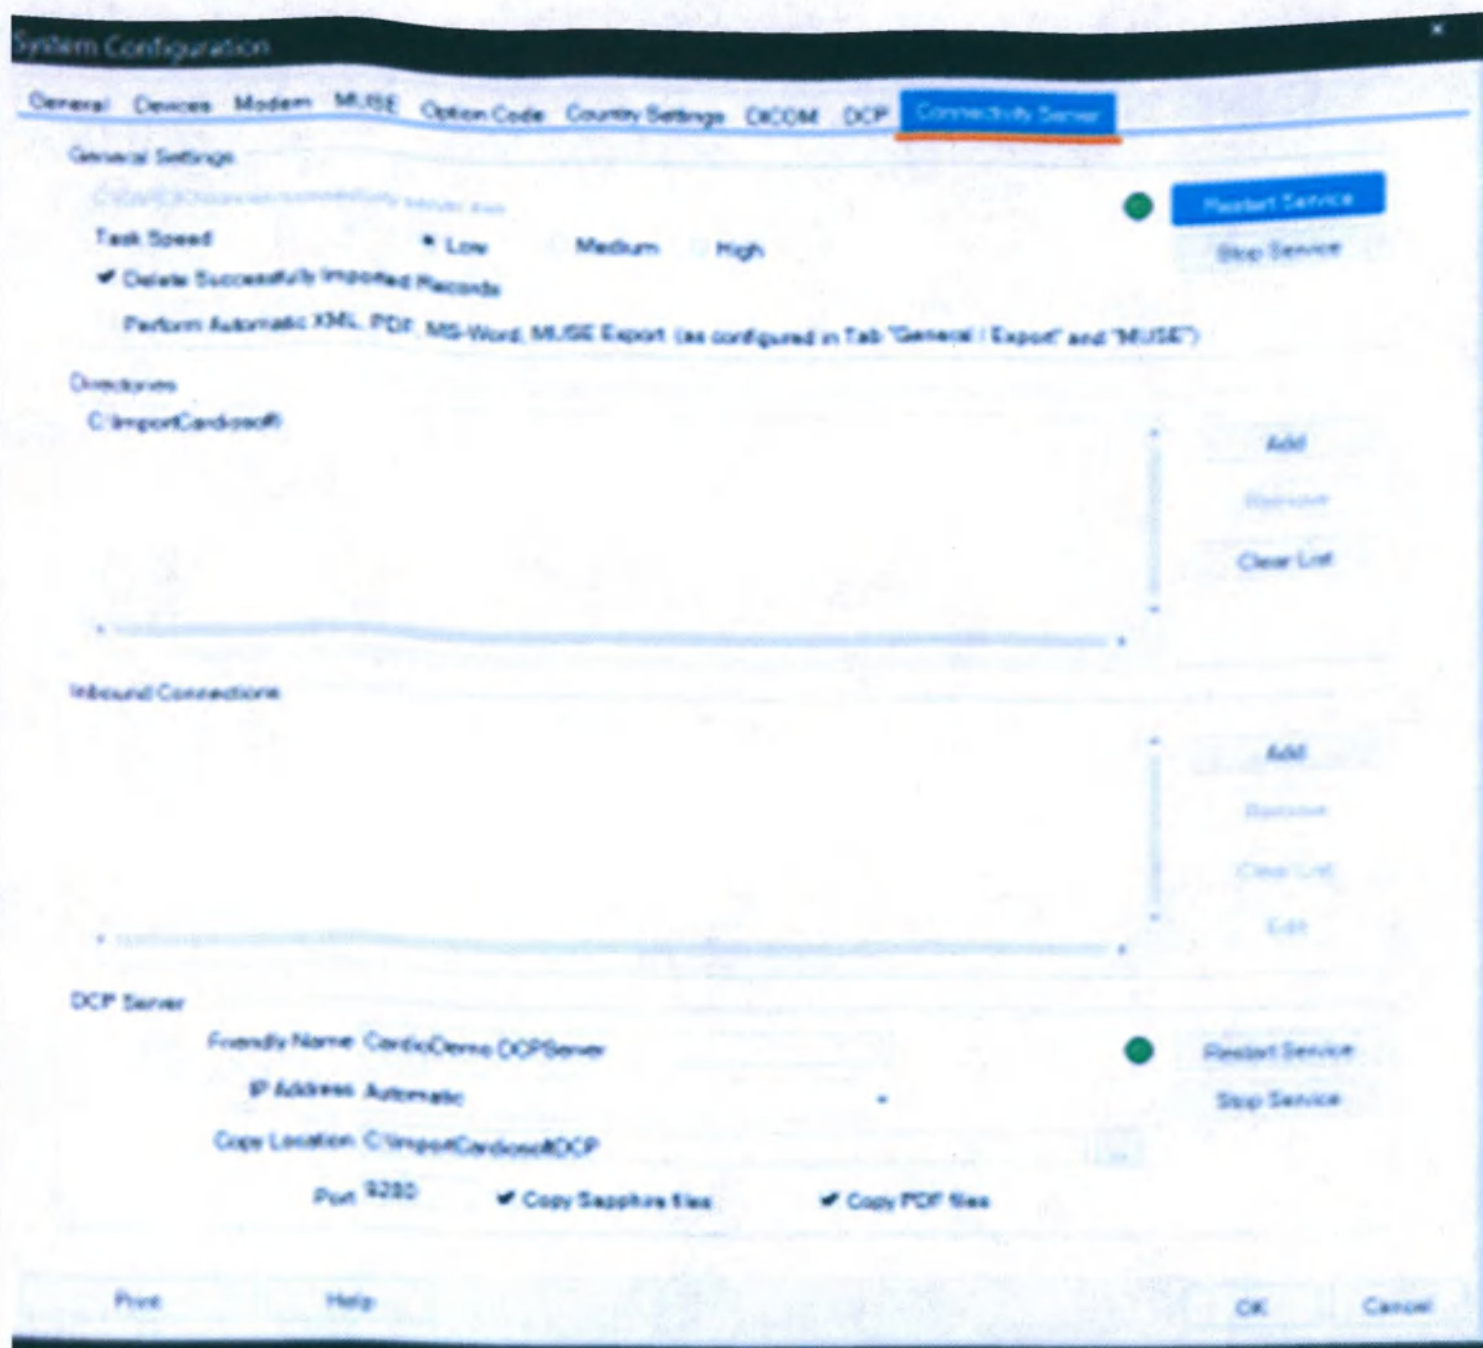


Фото 109.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 58. Программный ключ для активации программного обеспечения
 сервера соединений на оптических или электронных носителях, или код активации на
 бумажном носителе.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DICOM DCP Connectivity Server

			Option Code	Expiration ...	
X	CWEB	CardioSoft Web (requires hardware k...	123		123
X	APRY	Arrhythmia Detection / Documentation	123		123
X	2DWF	2D Waterfall Display	123		123
X	BRWS	MUSE Browser	123		123
X	RISK	Risk Factors and Scores	123		123
X	ECGH	ECG History (requires acquisition mo...	123		123
X	EXPO	Export Data as XML/Excel	123		123
X	EPOF	Export Report as PDF	123		123
X	EWRD	Export Report as WORD	123		123
X	CDRW	Archive to External Media	123		123
X	DSPC	Screen Display Configuration	123		123
X	ITBL	In-Test Tabular Summary	123		123
X	ITRD	In-Test Trend	123		123
X	PRVT	Previous Test Retrieval	123		123
X	XEMR	EMR Interface	123		123
X	FLX	Floating License for number of users	0	123	123
X	DICM	DICOM Interface	123		123
X	ESPI	Ergonomics	123		123
X	STHY	STHR hysteresis	123		123
X	EXTI	Exercise Test Interpretation (XTI)	123		123

Фото 110.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU тавающая лицензия (не более 50 шт.).

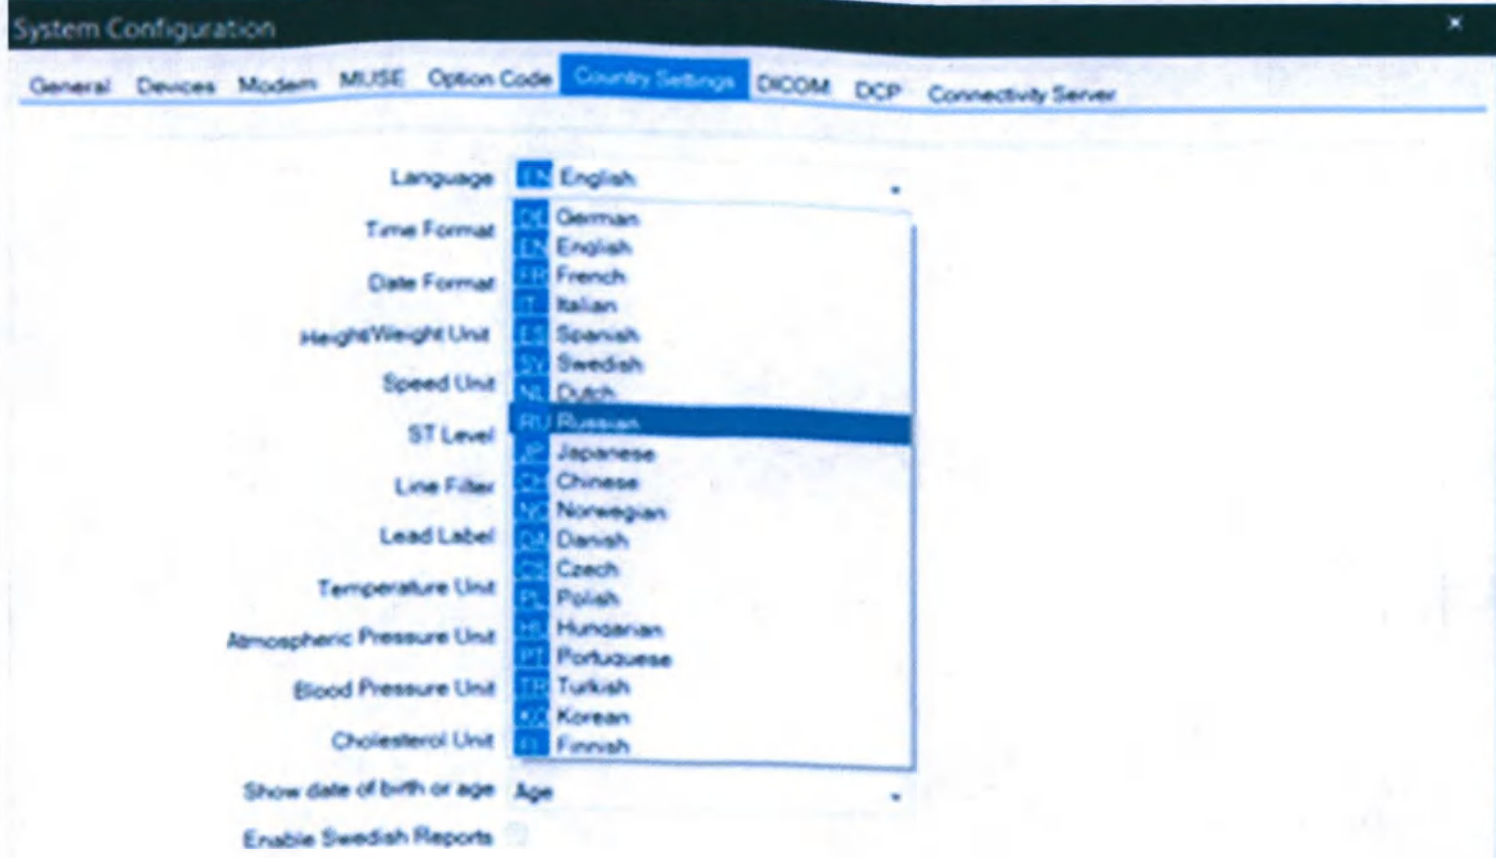


Фото 111.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
Принадлежности: 60. Программный пакет русскоязычного интерфейса на оптических

Upgrade Requirements

Following are the list of product codes that support CASE V6.73 Win 10 upgrade

- SNP- CASE Advantech V6.7
- SP2- CASE Advantech VCP V6.7

NOTE

To restore customer data post upgrade, refer to Restore Patient Data, System Configurations, and Custom Setups section.

Table 1: Installation Requirements

Item	Description
Administrator privileges	You will need domain administrator privileges on the server onto which the CASE server is being installed. You will need administrator privileges for any workstation onto which the CASE software is being installed. If you do not have administrator privileges, contact your system administrator.
CASE v6.73 Win 10 Upgrade Hardware	Hardware Disk Drive 21099326-005 Solid State Drive 21099326-002
Acquisition module	CASE V6.73 Win 10 supports CAM 14 acquisition module after upgrading.
Spirometer or Ambulatory Blood Pressure (ABP) monitor	Required for use with the optional devices, EasyOne and Torport V.
CASE software serial number	Serial number is same as labeled on the back panel.

Фото 112.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:

Принадлежности: 61. Программный ключ активации на оптических или электронных

000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU щии на бумажном носителе для установки обновлений.

System Configuration

General Devices Modem MUSE **Option Code** Country Settings DiCOM DCP Connectivity Server

			Option Code	Expiration ...	
	CWEB	CardioSoft Web (requires hardware k...	123		15
	ARRY	Arrhythmia Detection / Documentation	123		15
	2DWF	2D Waterfall Display	123		15
	BRWS	MUSE Browser	123		15
	RISK	Risk Factors and Scores	123		15
	ECGH	ECG History (requires acquisition mo...	123		15
	EXPD	Export Data as XML/Excel	123		15
	EPDF	Export Report as PDF	123		15
	EWRD	Export Report as WORD	123		15
	CDRW	Archive to External Media	123		15
	DSPC	Screen Display Configuration	123		15
	ITBL	In-Test Tabular Summary	123		15
	ITRD	In-Test Trend	123		15
	PRVT	Previous Test Retrieval	123		15
	XEMR	EMR Interface	123		15
	FLLX	Floating License for number of users	0 123		15
	DICM	DICOM Interface	123		15
	ESPI	Ergospirometry	123		15
	STHY	ST/HR hysteresis	123		15
	EXTI	Exercise Test Interpretation (XTI)	123		15

Фото 113.

Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями:
 Принадлежности: 62. Программный ключ для активации программного обеспечения
 интерфейс EMR на оптических или электронных носителях, или код активации на
 бумажном носителе.

ООО «Джии Хэлскеа»

Итого в настоящем документе

114 (сто сорок четыре) листа(-ов)

Директор деп. Регистрации и
сертификации Россия и СНГ

Харитонов А.П.

А.П. Харитонов
МП

