



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

« Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона ЛГ/ЛН на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 LH)»

производства «Сименс Хелскэа Диагностикс Продактс Лимитед» (Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited)

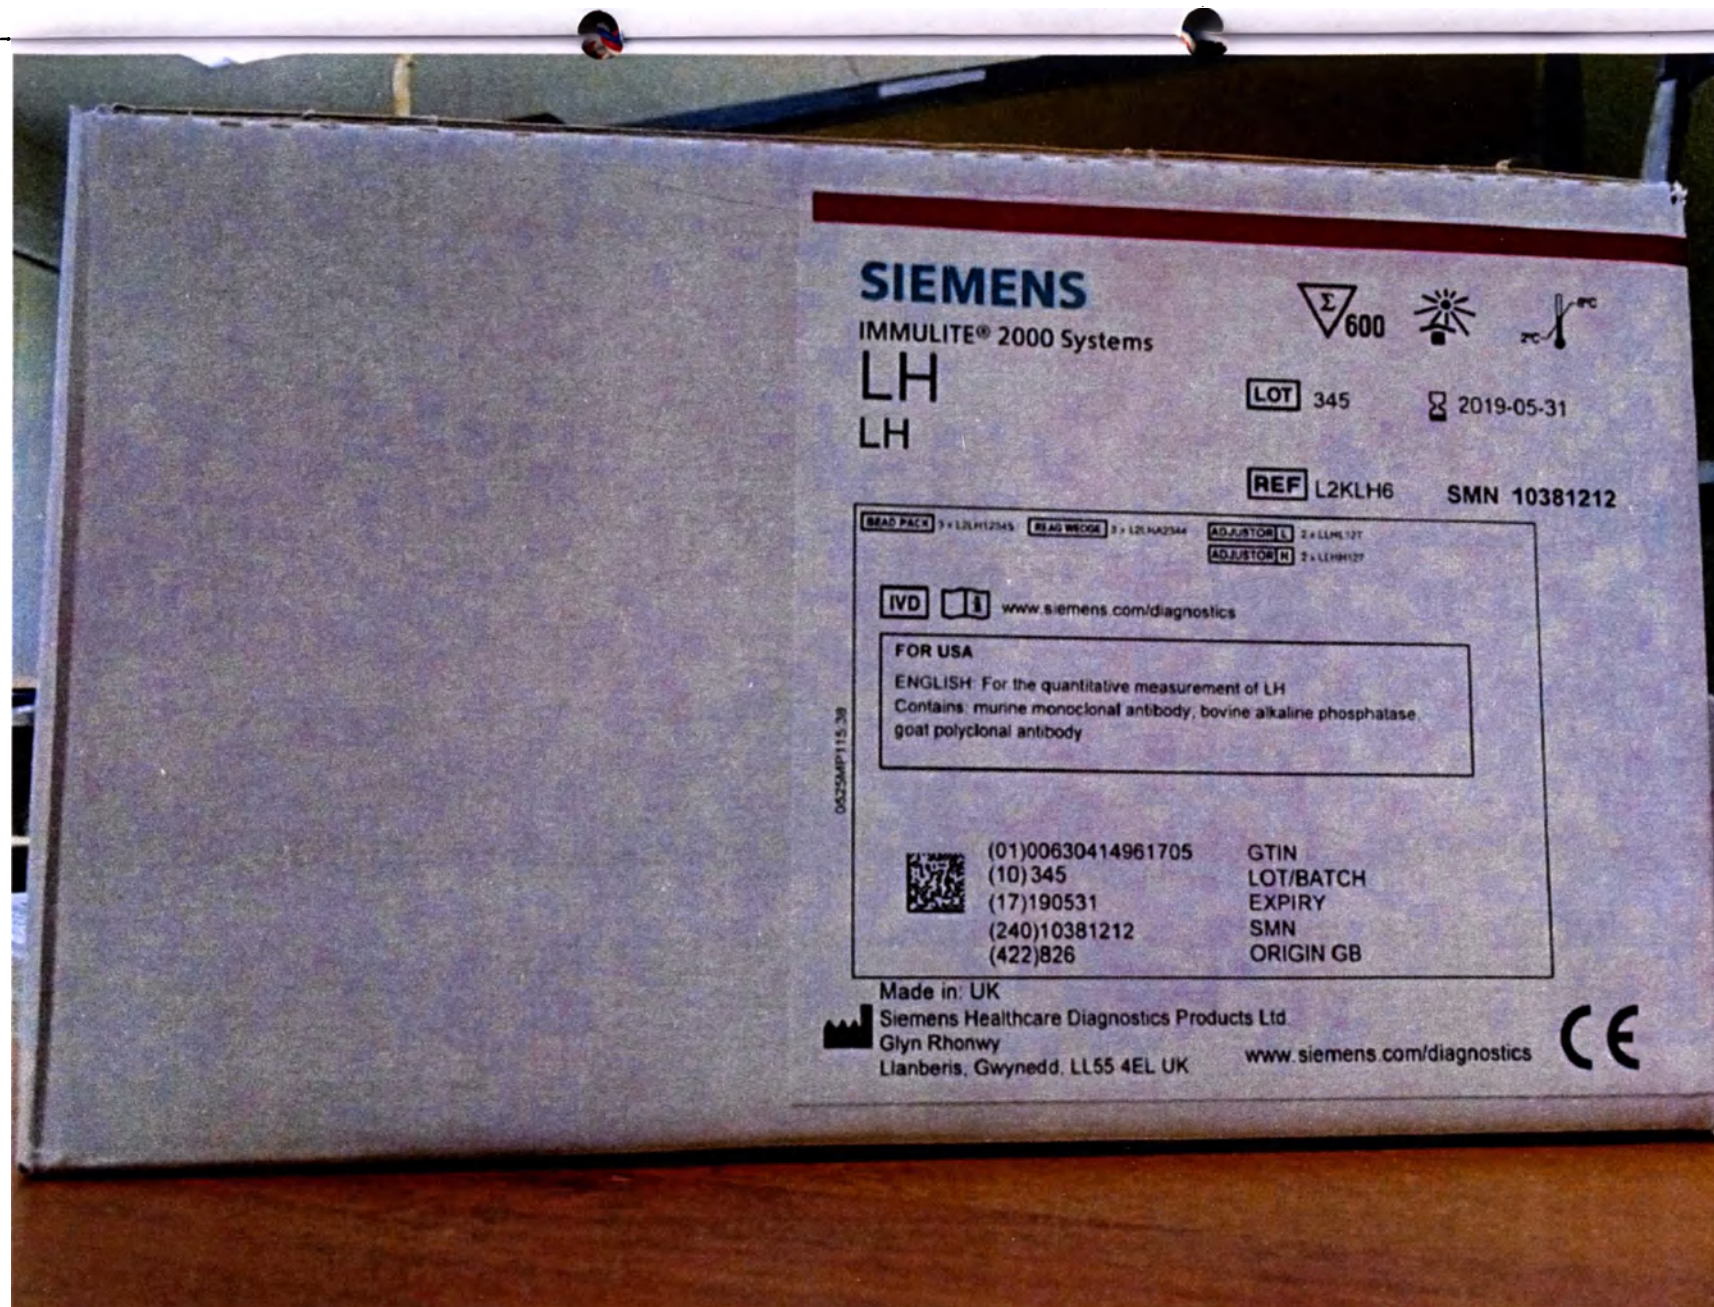


Рисунок 1. Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона ЛГ/LH на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 LH), (Картонная коробка)



Рисунок 2. Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона ЛГ/LH на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 LH), (Содержимое коробки)



Рисунок 3. Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона ЛГ/LH на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 LH), (Упаковка с шариками)

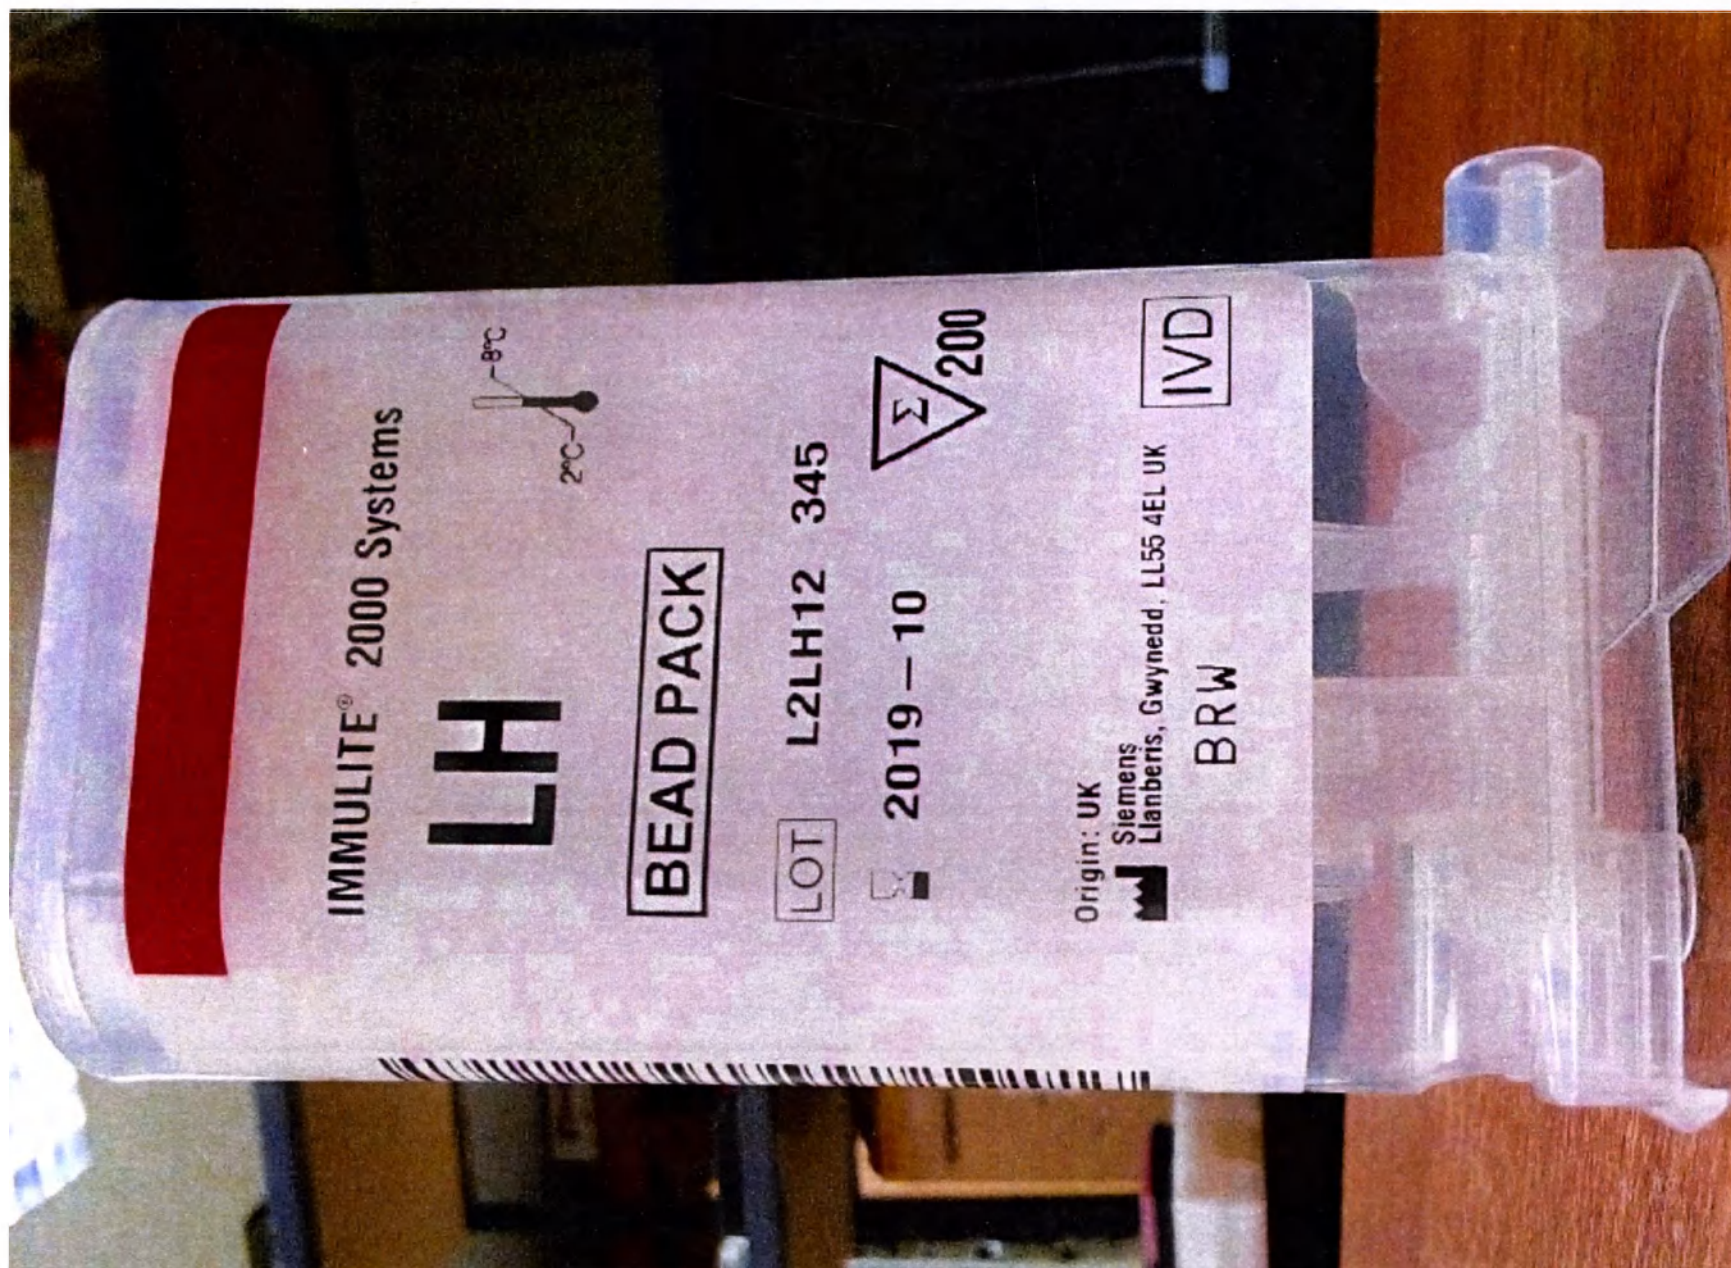


Рисунок 4. Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона ЛГ/LH на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 LH), - (Упаковка с шариками)



Рисунок 5. Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона ЛГ/LH на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 LH). (Содержимое упаковки с шариками)



Рисунок 6. Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона ЛГ/LH на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 LH), (Клин с реагентом))



Рисунок 7. Набор реагентов для количественного определения лютеинизирующего гормона ЛГ/LH на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 LH), (LH Adjustors (Калибраторы)), (LLHL, LLHH)



Всего прошито и пронумеровано
8 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»