

Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»



Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.




Фотографические изображения общего вида

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур Мульти-Иммуно Контроль» для контроля качества определения множественных показателей в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 205-65614693-2022

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, с низкой концентрацией



Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, с высокой концентрацией

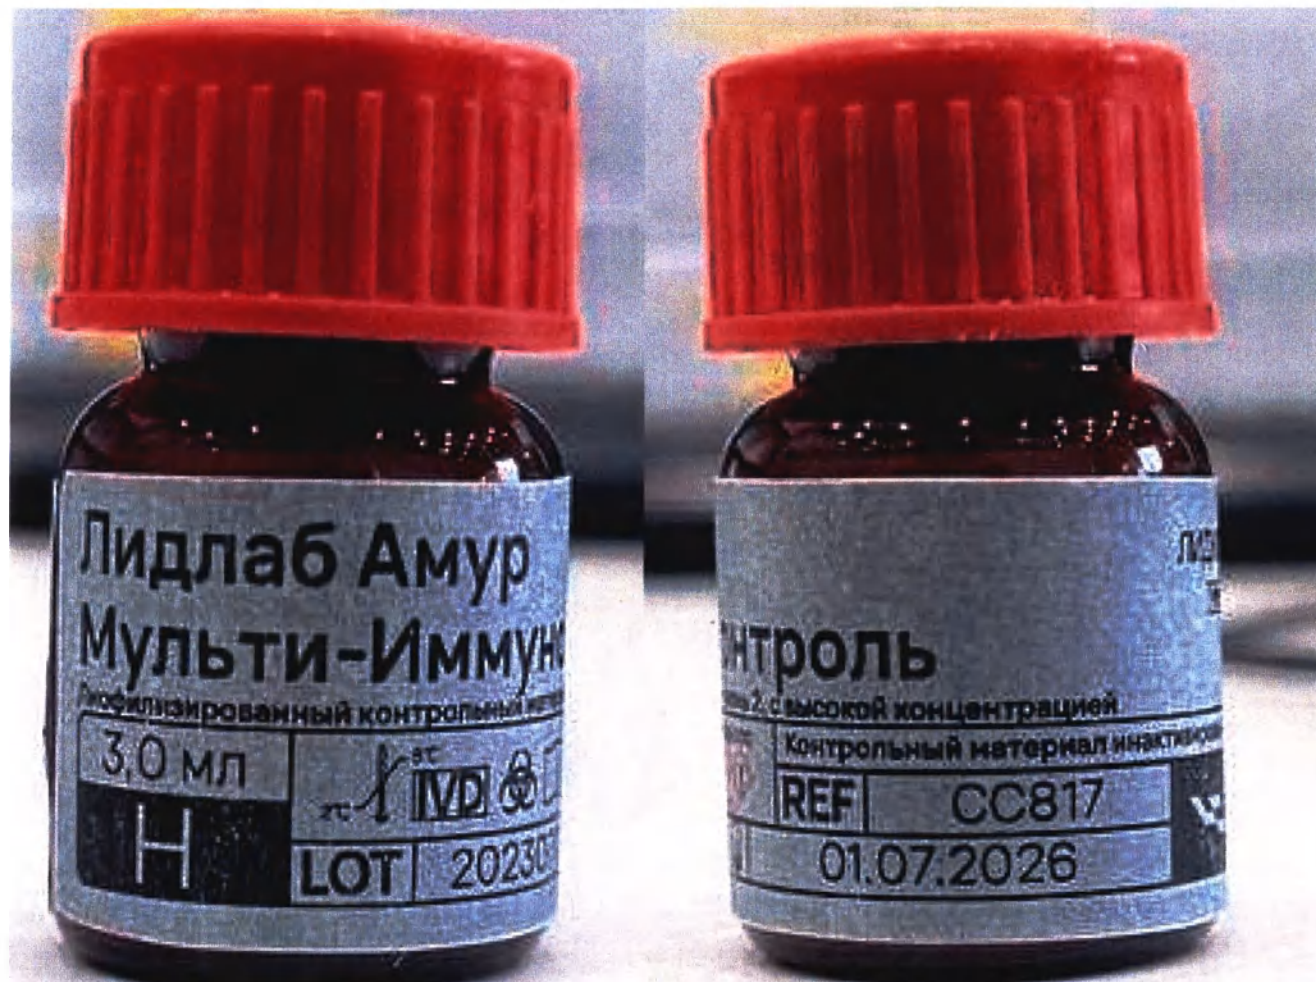

Потребительская упаковка Набора контрольных материалов

лидлаб



Лидлаб Амур
Мульти-Иммуно
Контроль

YNLO




LOT	20230701	01.07.2026	REF	CC817
-----	----------	------------	-----	-------

Состав изделия

1. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, с низкой концентрацией – 2 флакона;
2. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, с высокой концентрацией – 2 флакона;
3. Инструкция по применению – 1 шт.;
4. Аналитический паспорт – 1 шт.

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

лидкор

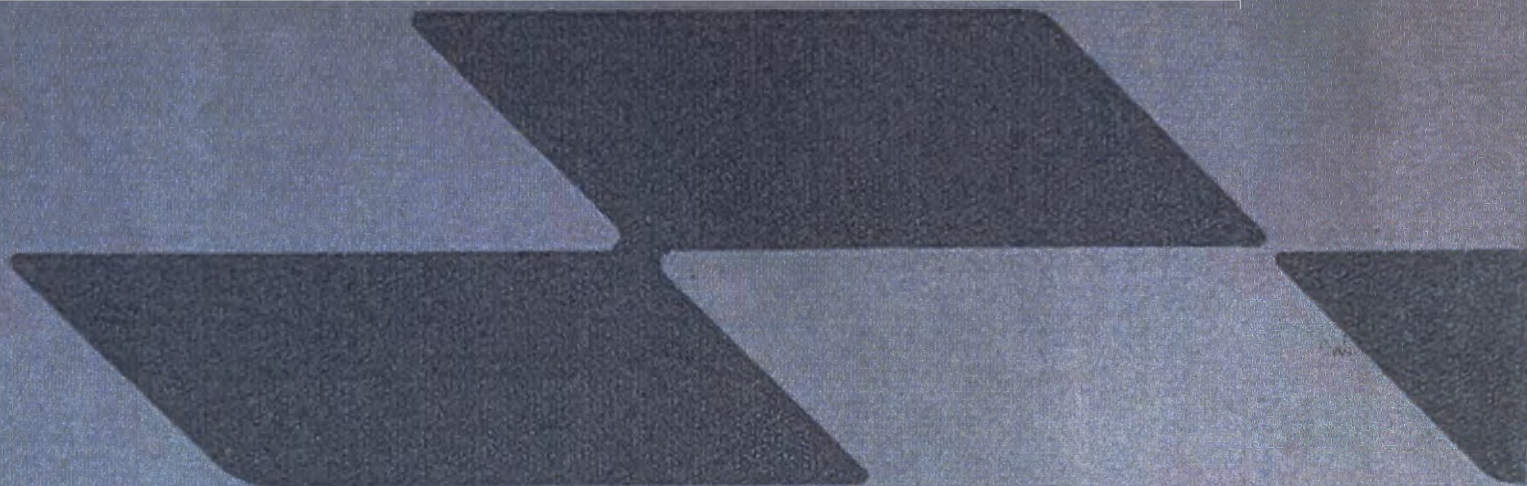

Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур Мульти-Иммуно Контроль» для контроля качества определения множественных показателей в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 205-65614693-2022.


Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН XXXXXX от XX.XX.202X

 Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Общий вид медицинского изделия

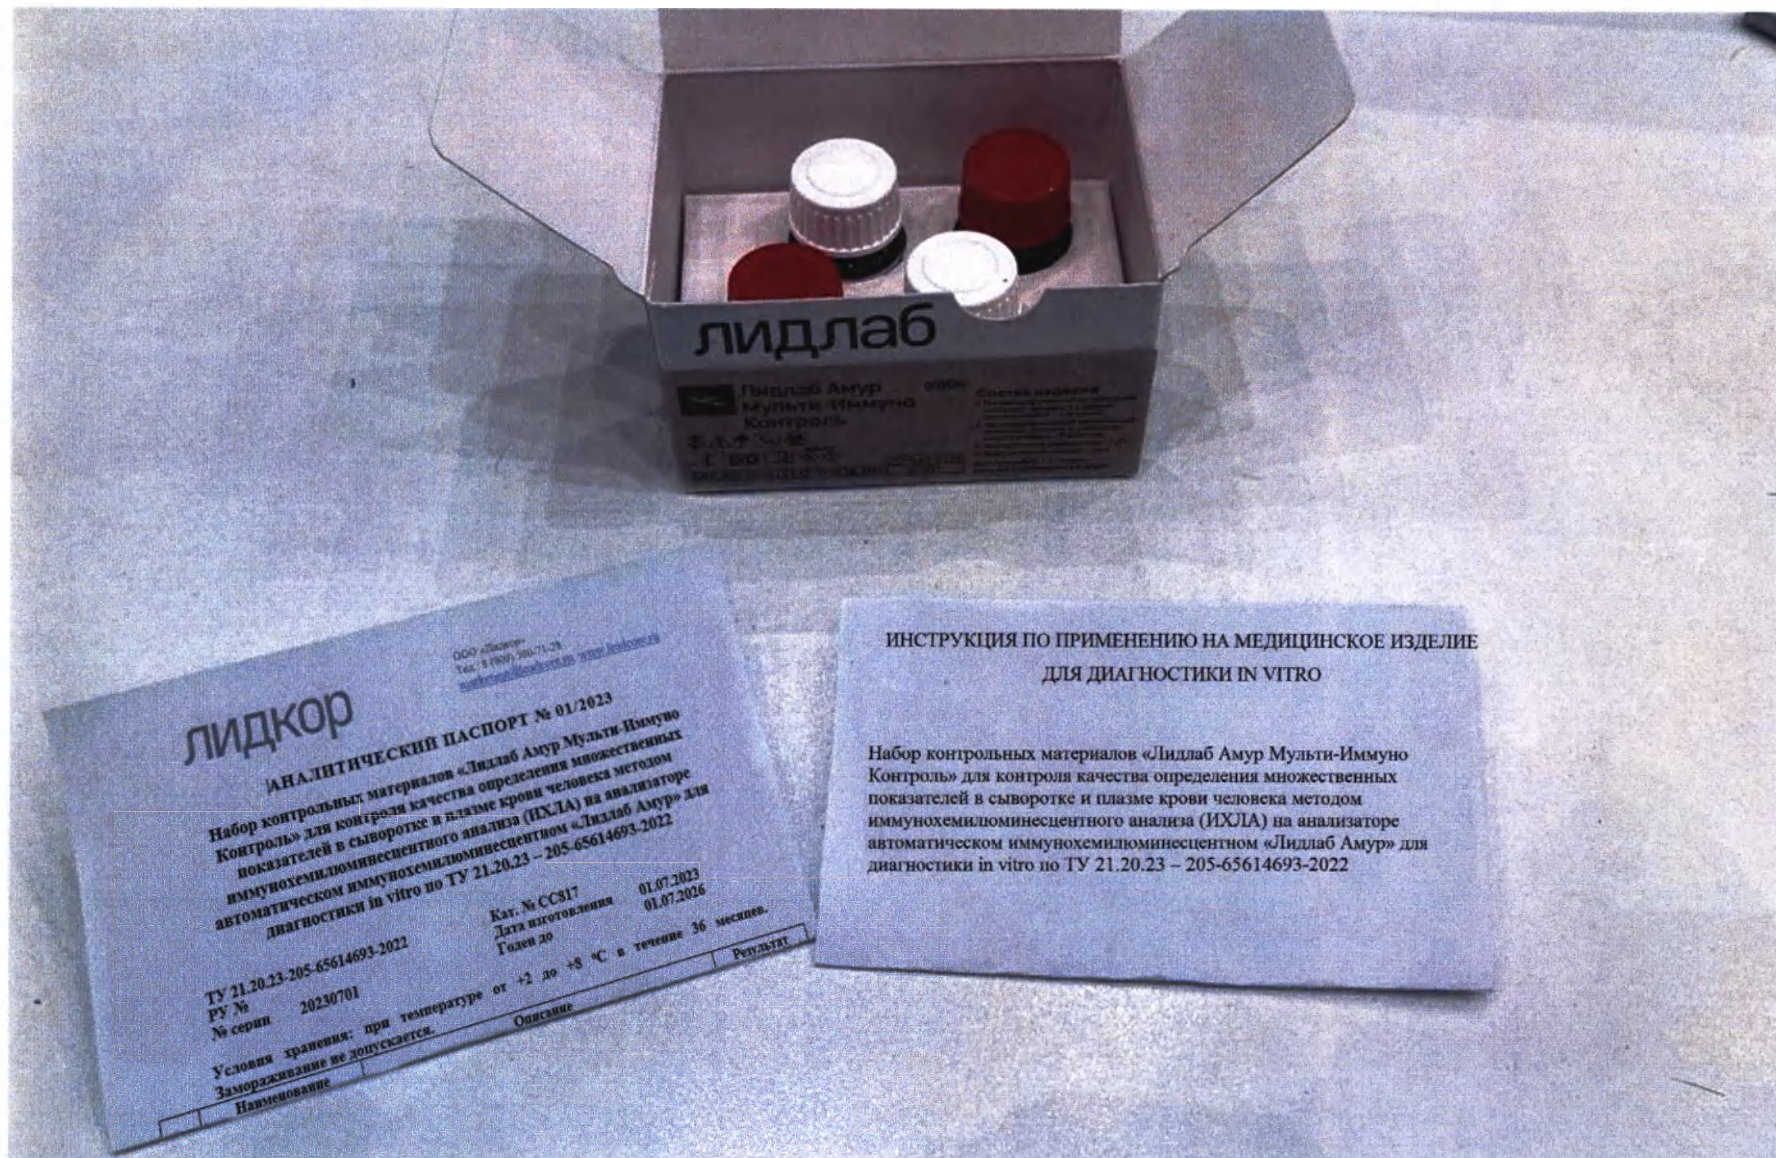

Транспортная упаковка

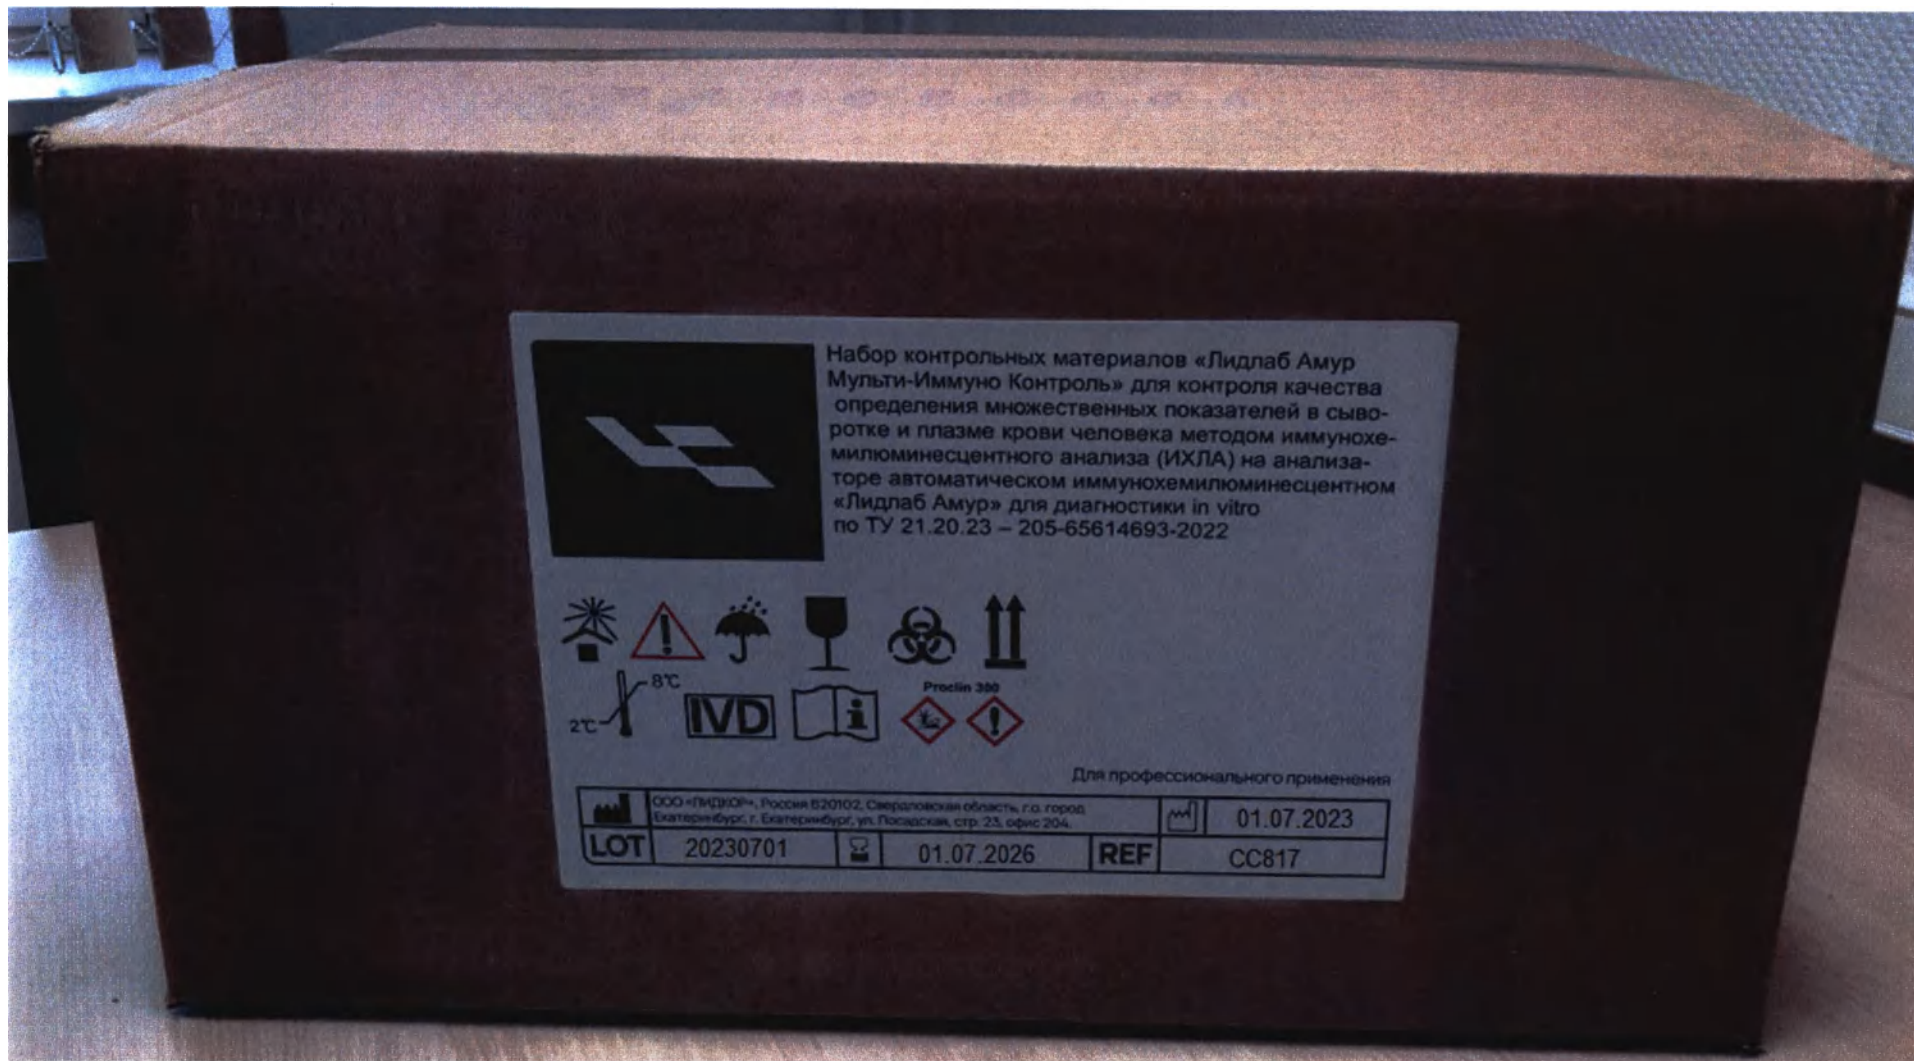

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
9 (Декабрь) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»
_____/Е. Ю. Гохгут/

Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.



Макет маркировки

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур Мульти-Иммуно Контроль» для контроля качества определения множественных показателей в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 205-65614693-2022

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур Мульти-Иммуно Контроль» для контроля качества определения множественных показателей в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 - 205-65614693-2022.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН XXXXXX от XX.XX.202X

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Мульти-Иммуно Контроль

YHLO



LOT	20230701	01.07.2026	REF	CC817
-----	----------	------------	-----	-------

Состав изделия

1. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, с низкой концентрацией – 2 флакона;
2. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, с высокой концентрацией – 2 флакона;
3. Инструкция по применению – 1 шт.;
4. Аналитический паспорт – 1 шт.

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Лидлаб Амур Мульти-Иммуно Контроль

лидкор
YHLO

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, с низкой концентрацией


3,0 мл	8°C	IVD	ProCin 300	Контрольный материал инактивирован
L	2°C	IVD	ProCin 300	REF CC817
LOT	20230701	01.07.2026		

Лидлаб Амур Мульти-Иммуно Контроль

лидкор
YHLO

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, с высокой концентрацией

3,0 мл	8°C	IVD	ProCin 300	Контрольный материал инактивирован
H	2°C	IVD	ProCin 300	REF CC817
LOT	20230701	01.07.2026		

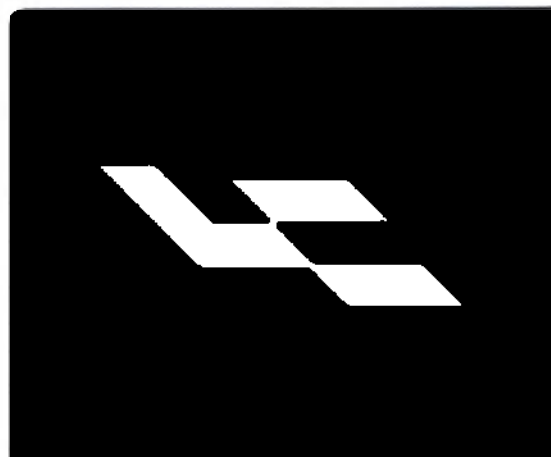

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур
Мульти-Иммуно Контроль» для контроля качества
определения множественных показателей в сыво-
ротке и плазме крови человека методом иммунохе-
милюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализа-
торе автоматическом иммунохемилюминесцентном
«Лидлаб Амур» для диагностики in vitro
по ТУ 21.20.23 – 205-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2026	REF	CC817

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

3 (*три*) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/