

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Комплекс рентгеновский диагностический
цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-
2022, в вариантах исполнения***

Производства

Общество с ограниченной ответственностью
«ДАЛИ Медикал»

143700, Московская область, г.о. Шаховская, рп
Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1

Подтверждено

Генеральный директор
ООО «ДАЛИ Медикал»

Янюк К.А.


подпись

10.06.2024 г.




М.П.


A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Янюк К.А.", written over the stamp and the "М.П." text.

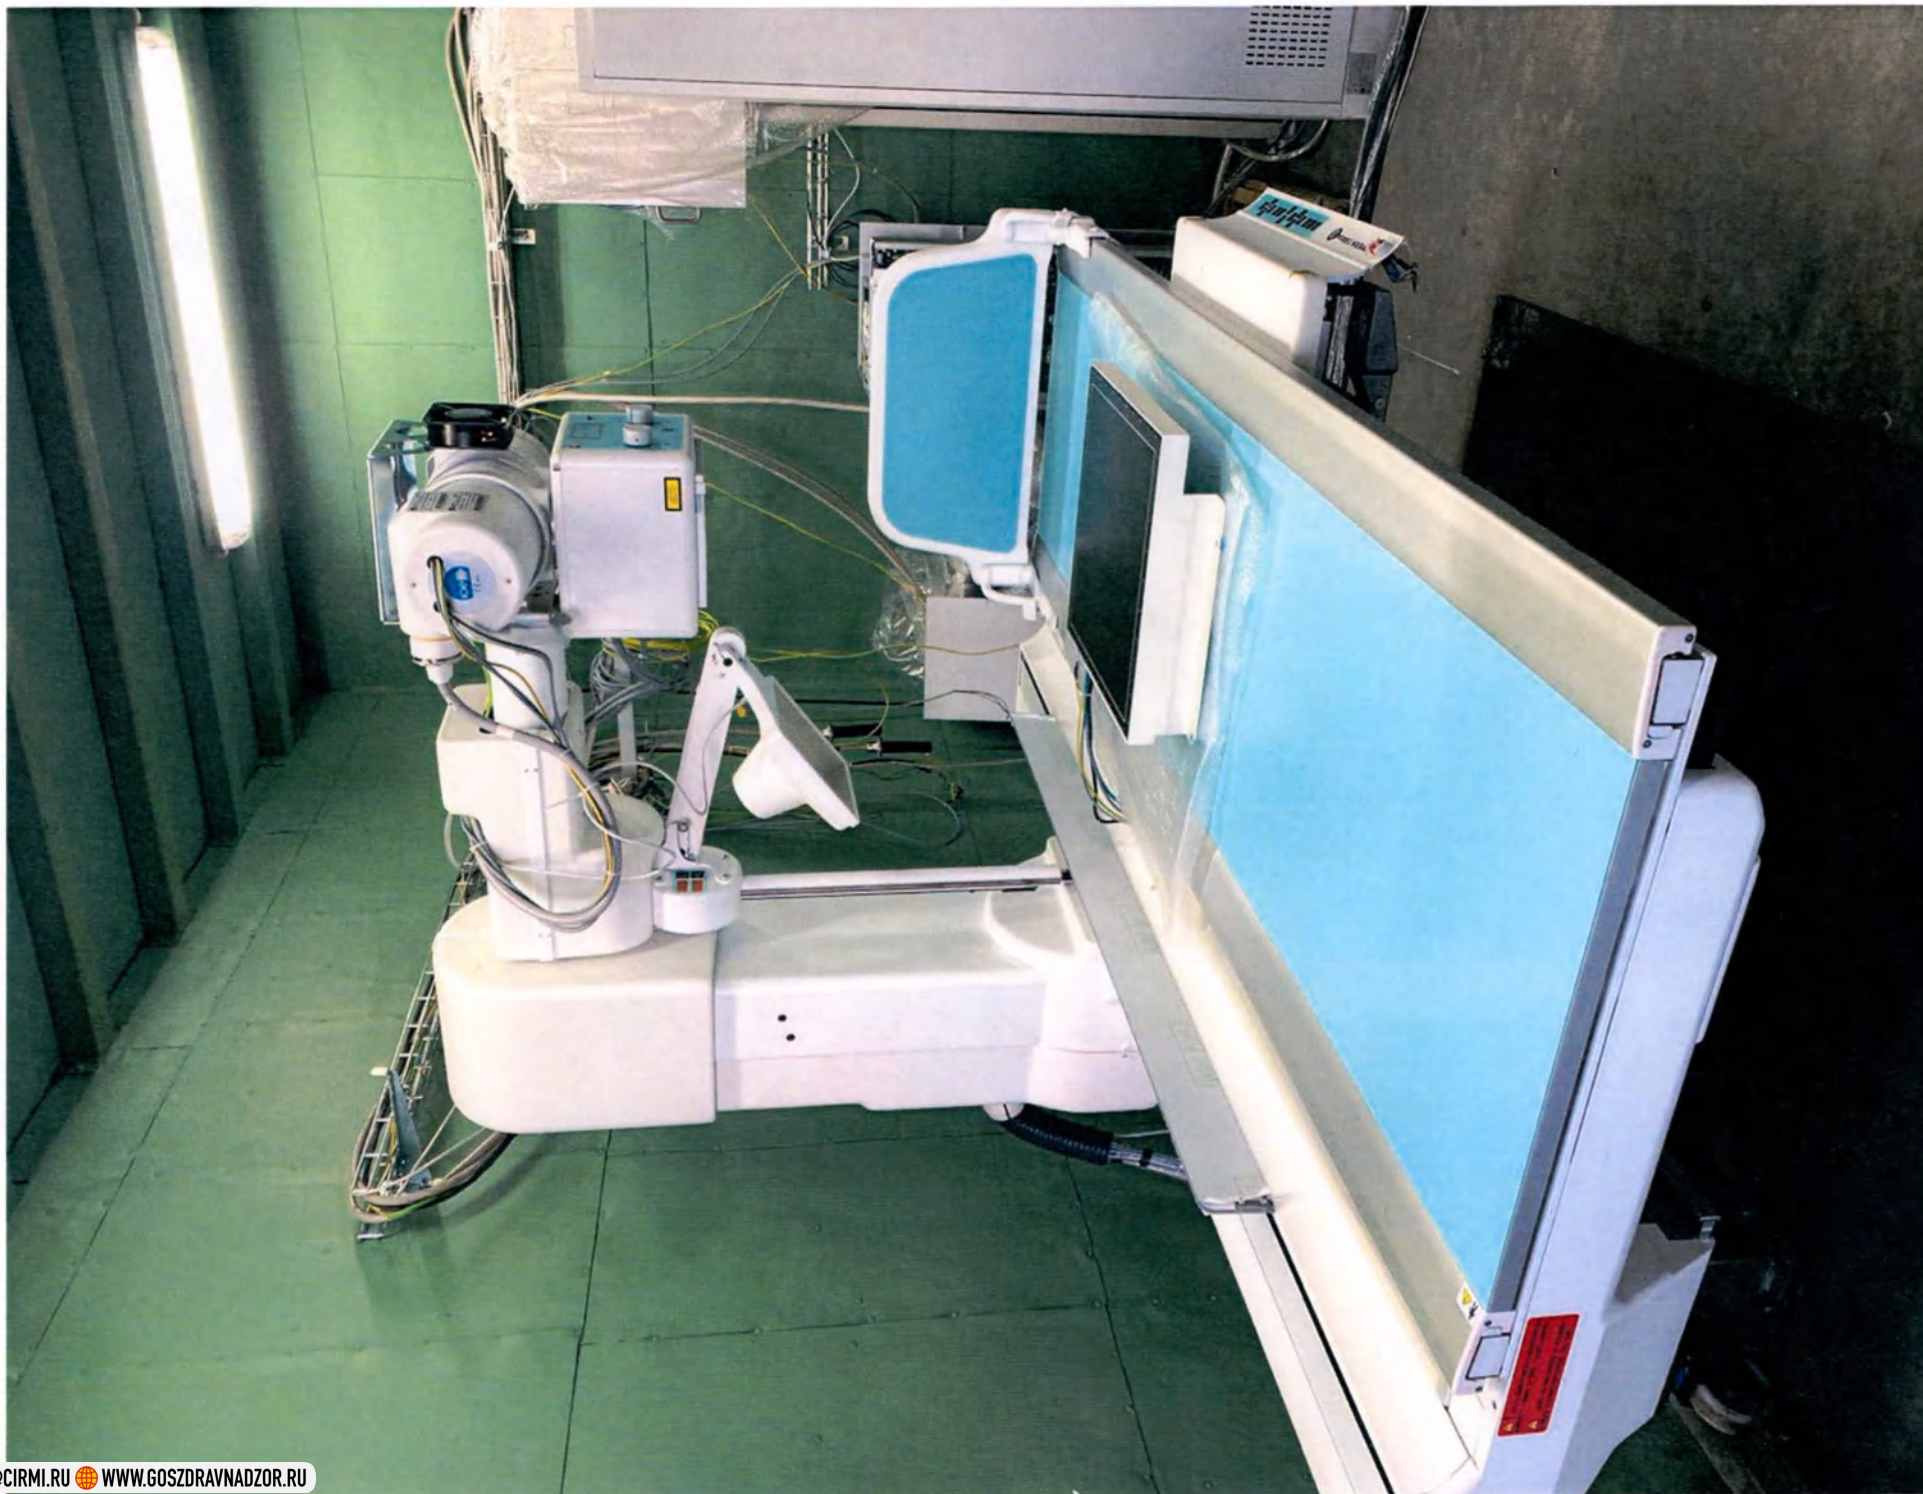


Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022, вариант исполнения 01

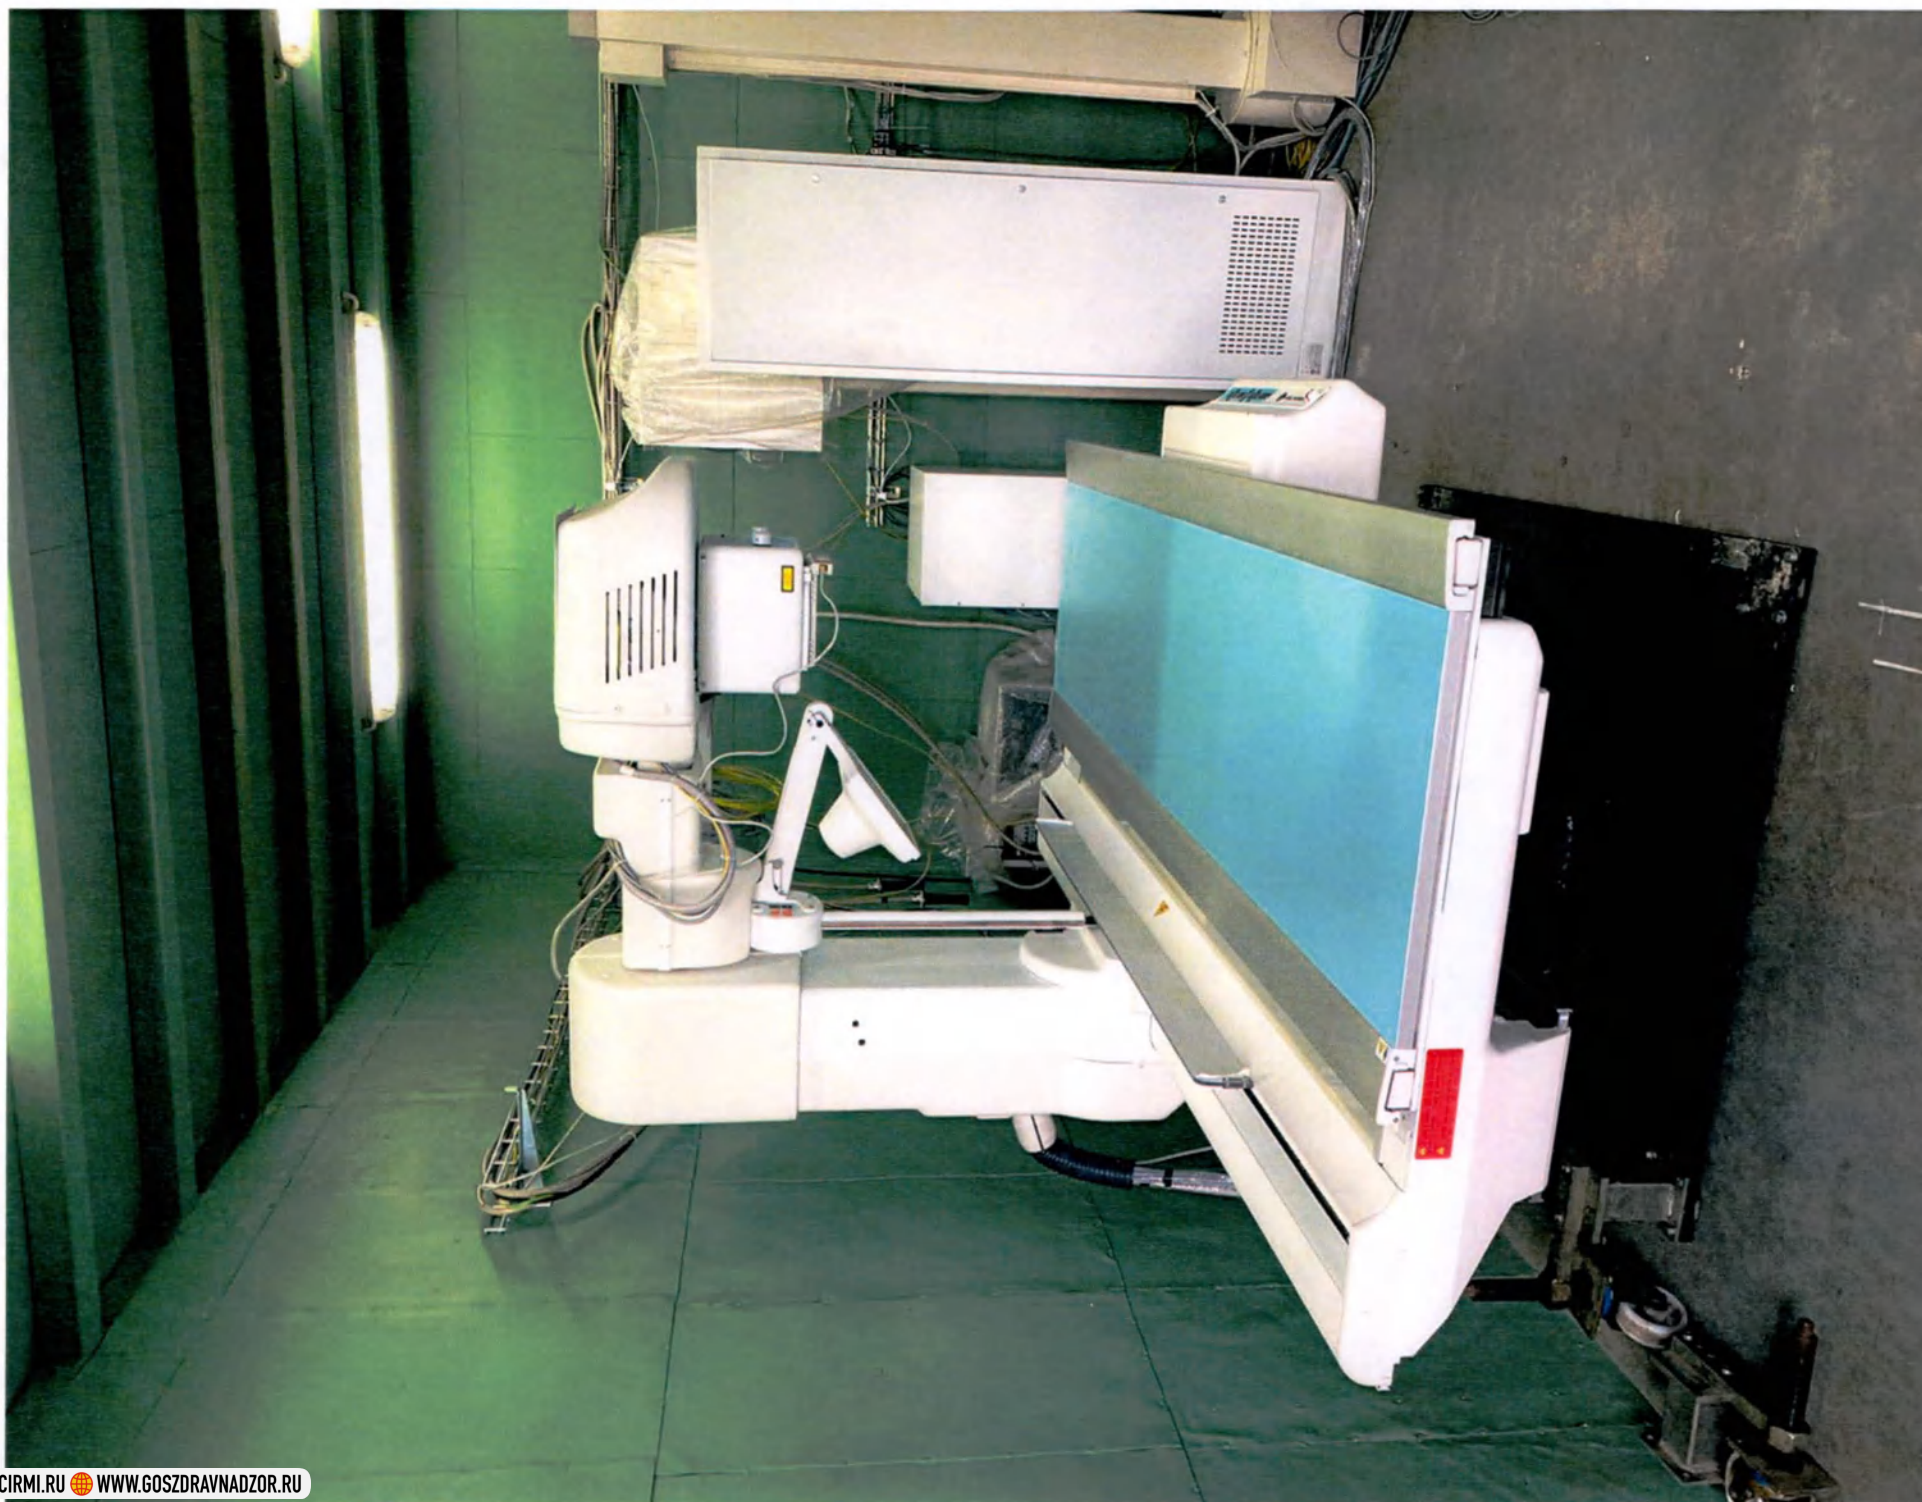




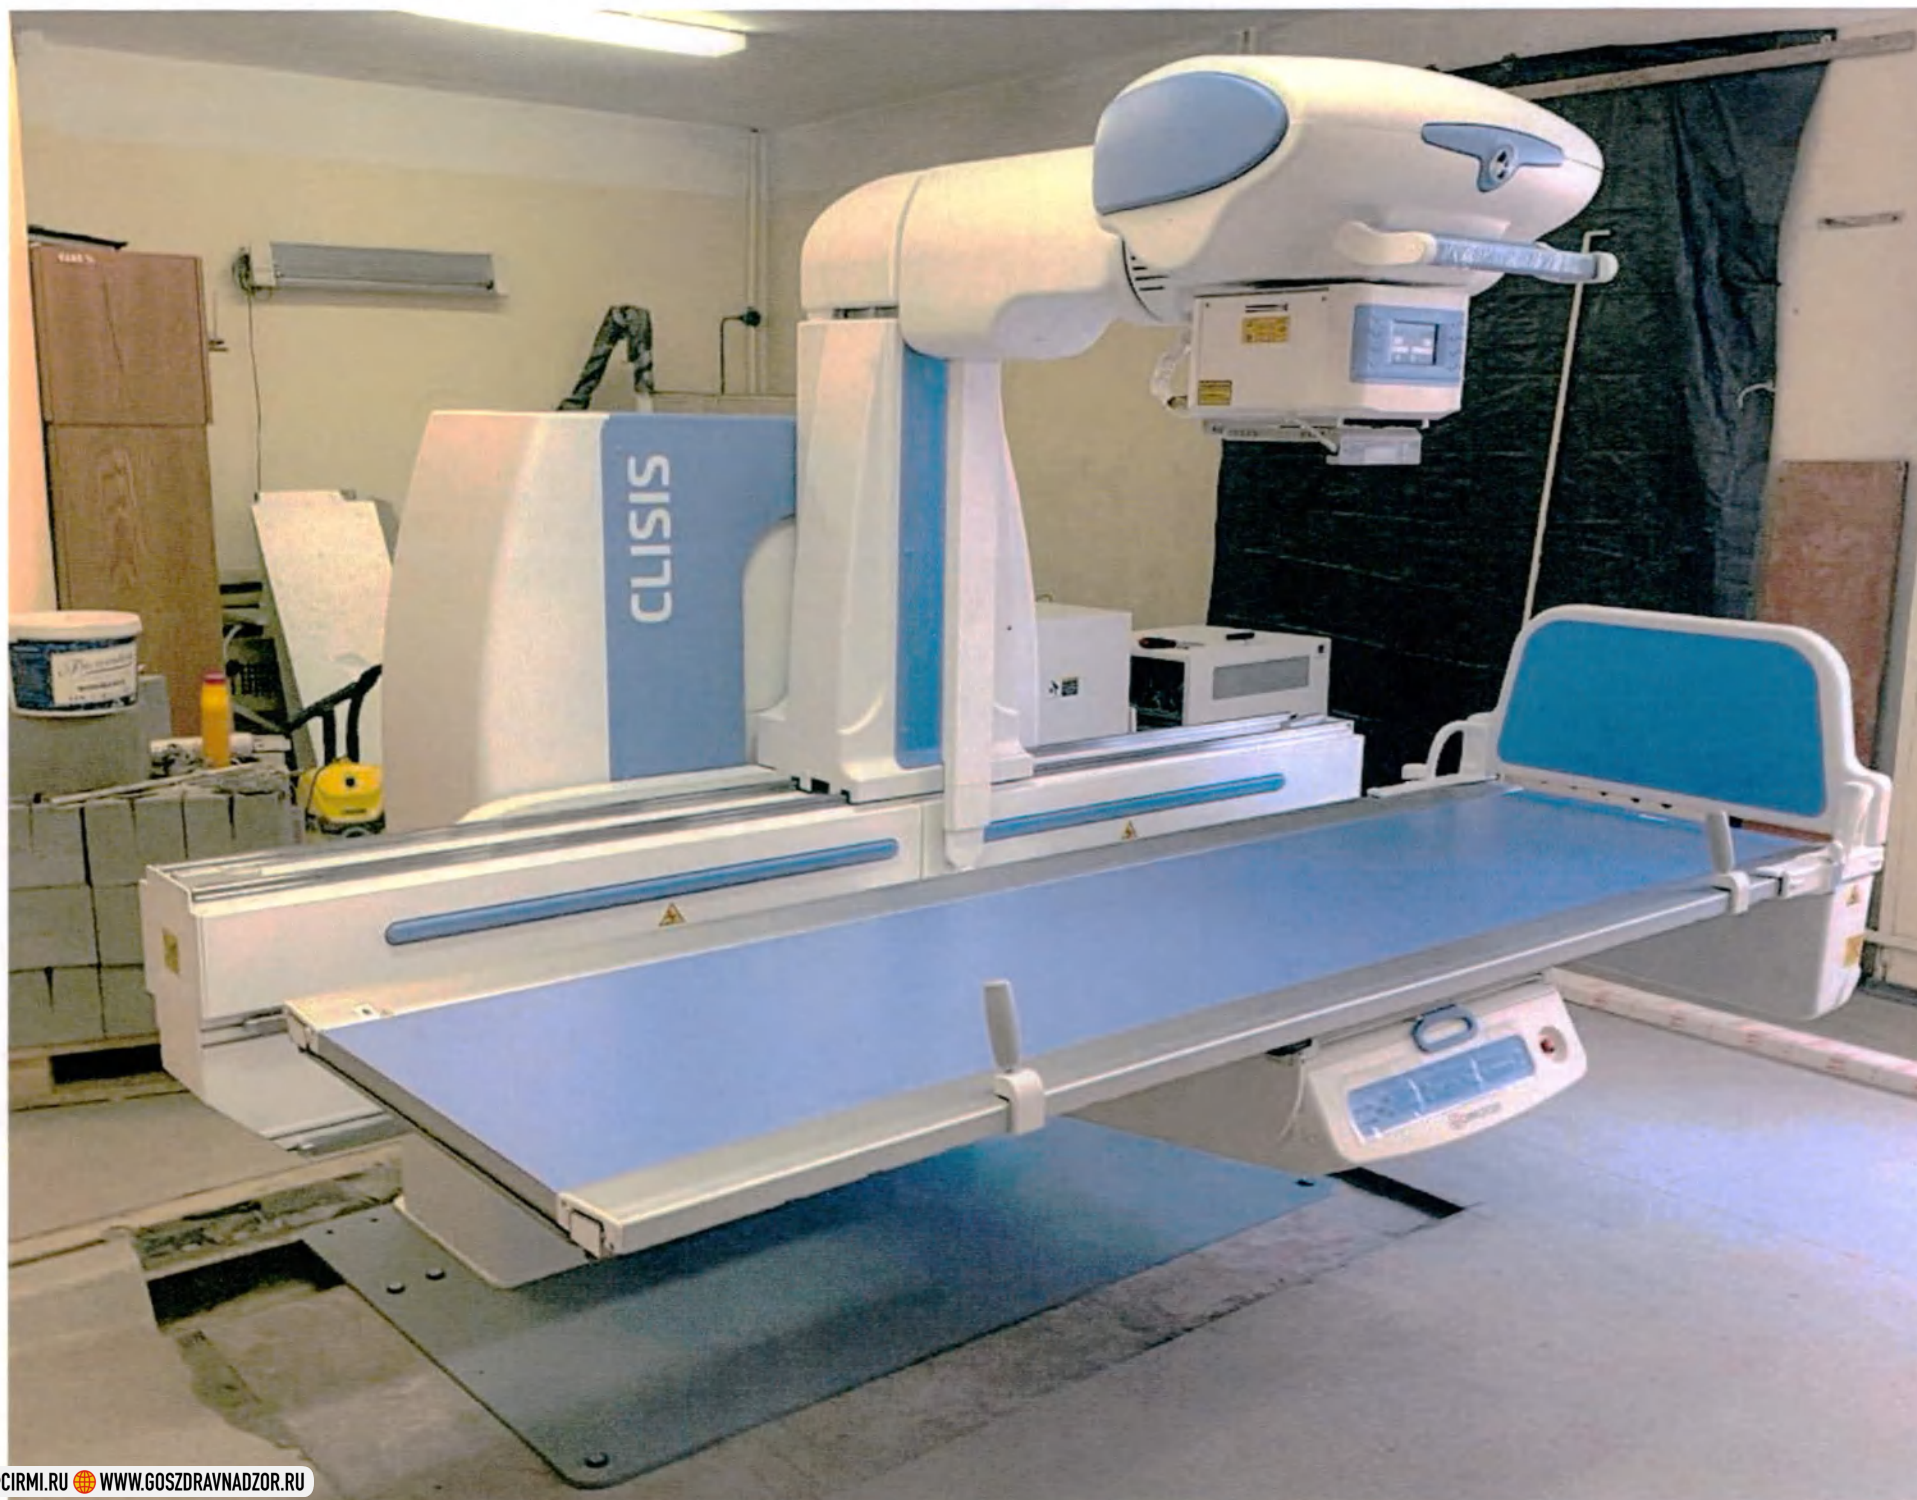

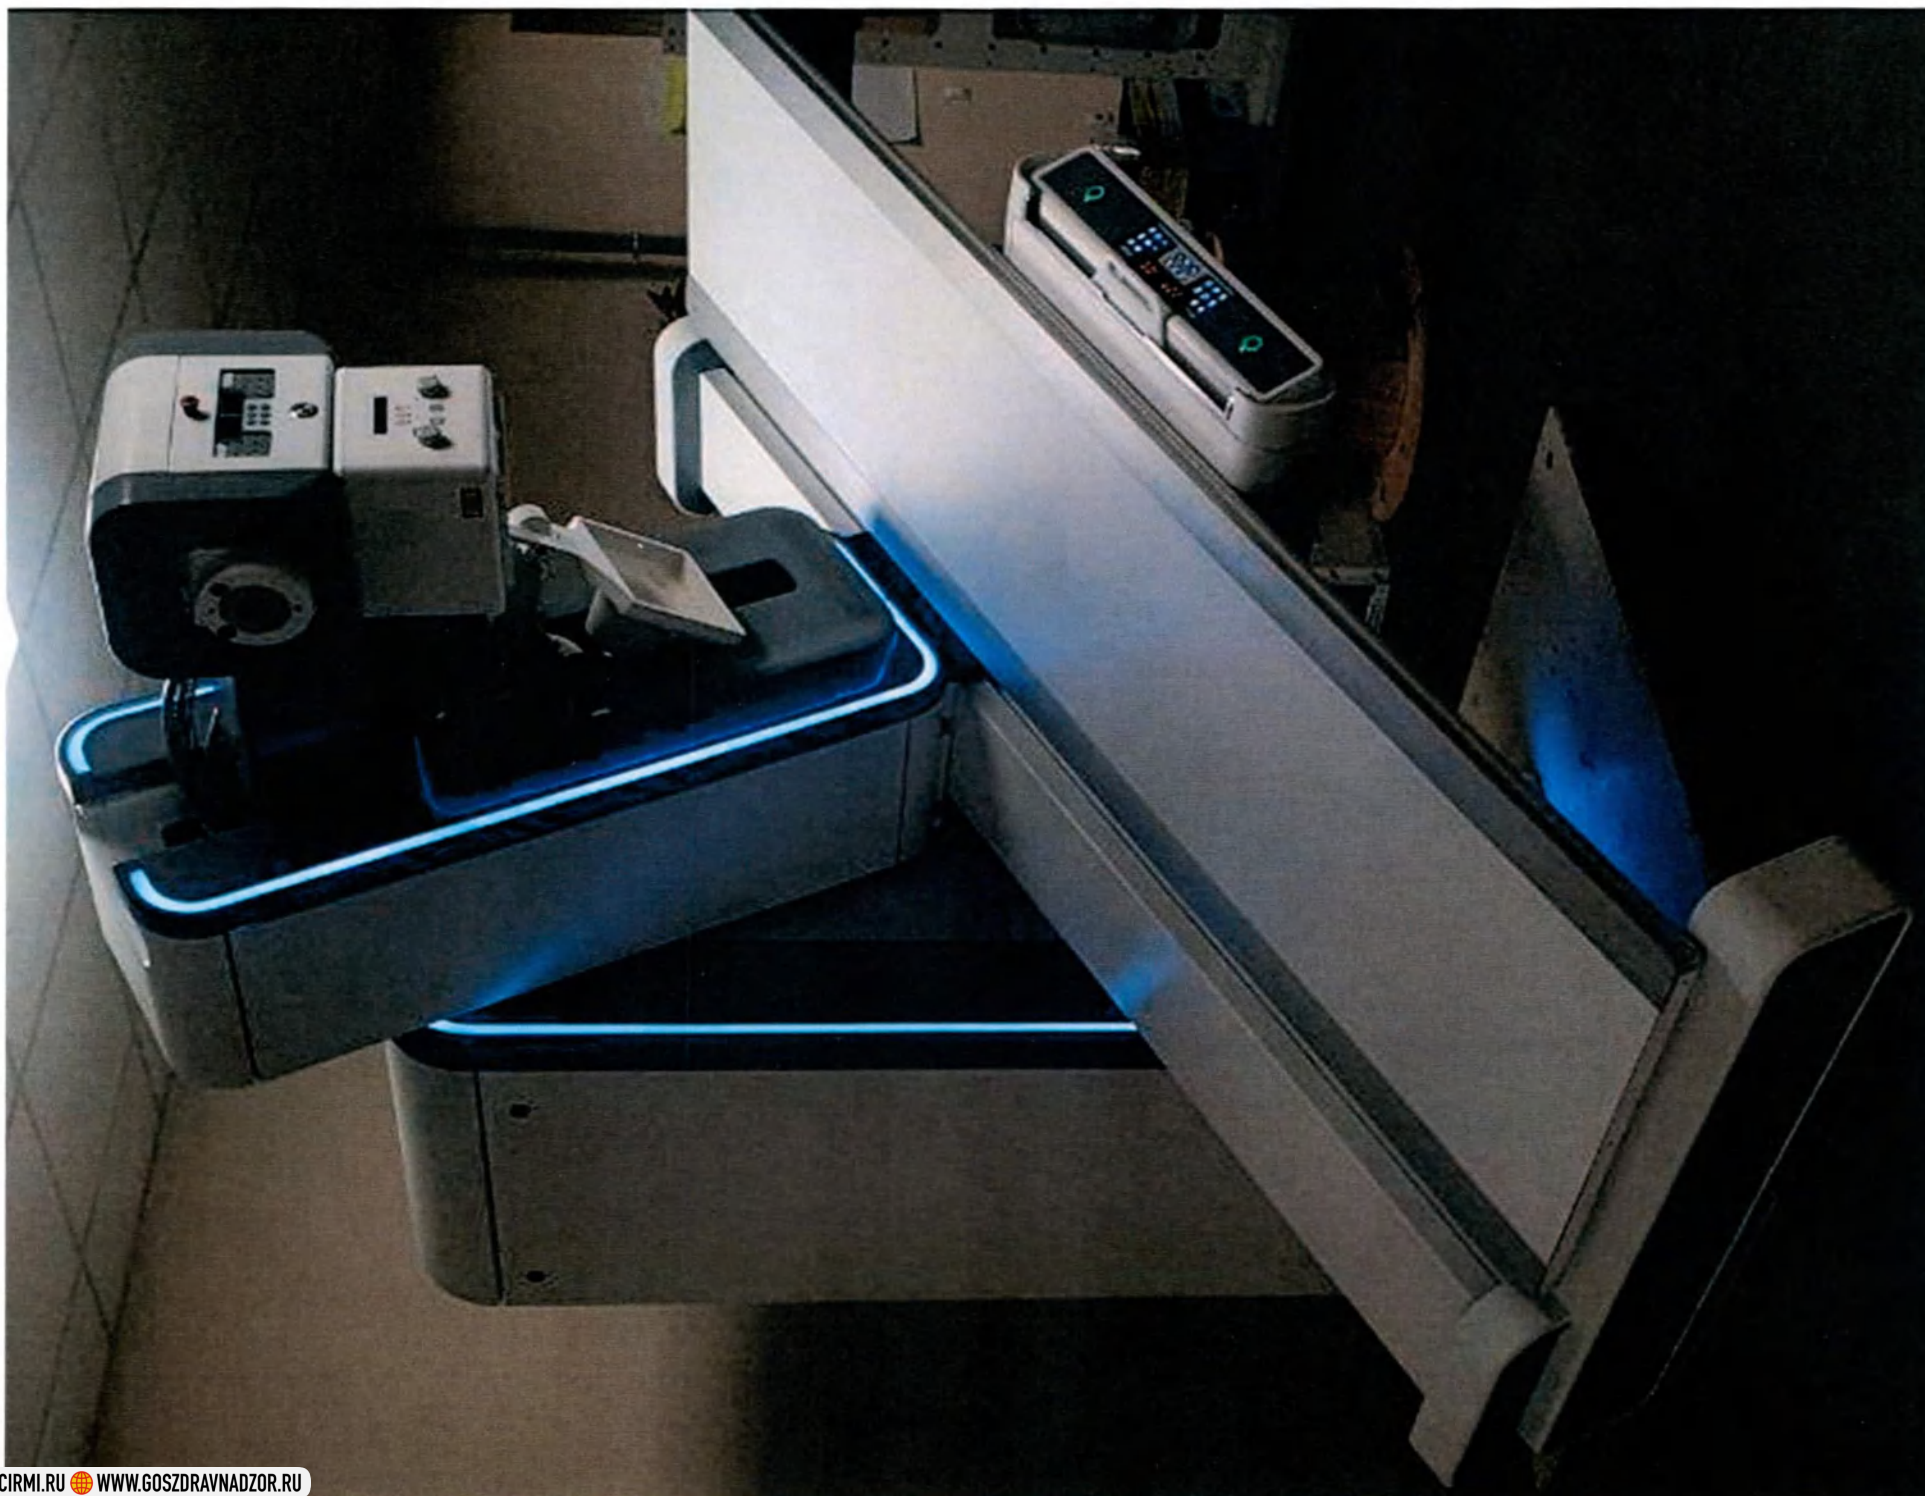

Телеуправляемый поворотный стол-штатив для рентгенологических исследований OPERA T30, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнение 01)

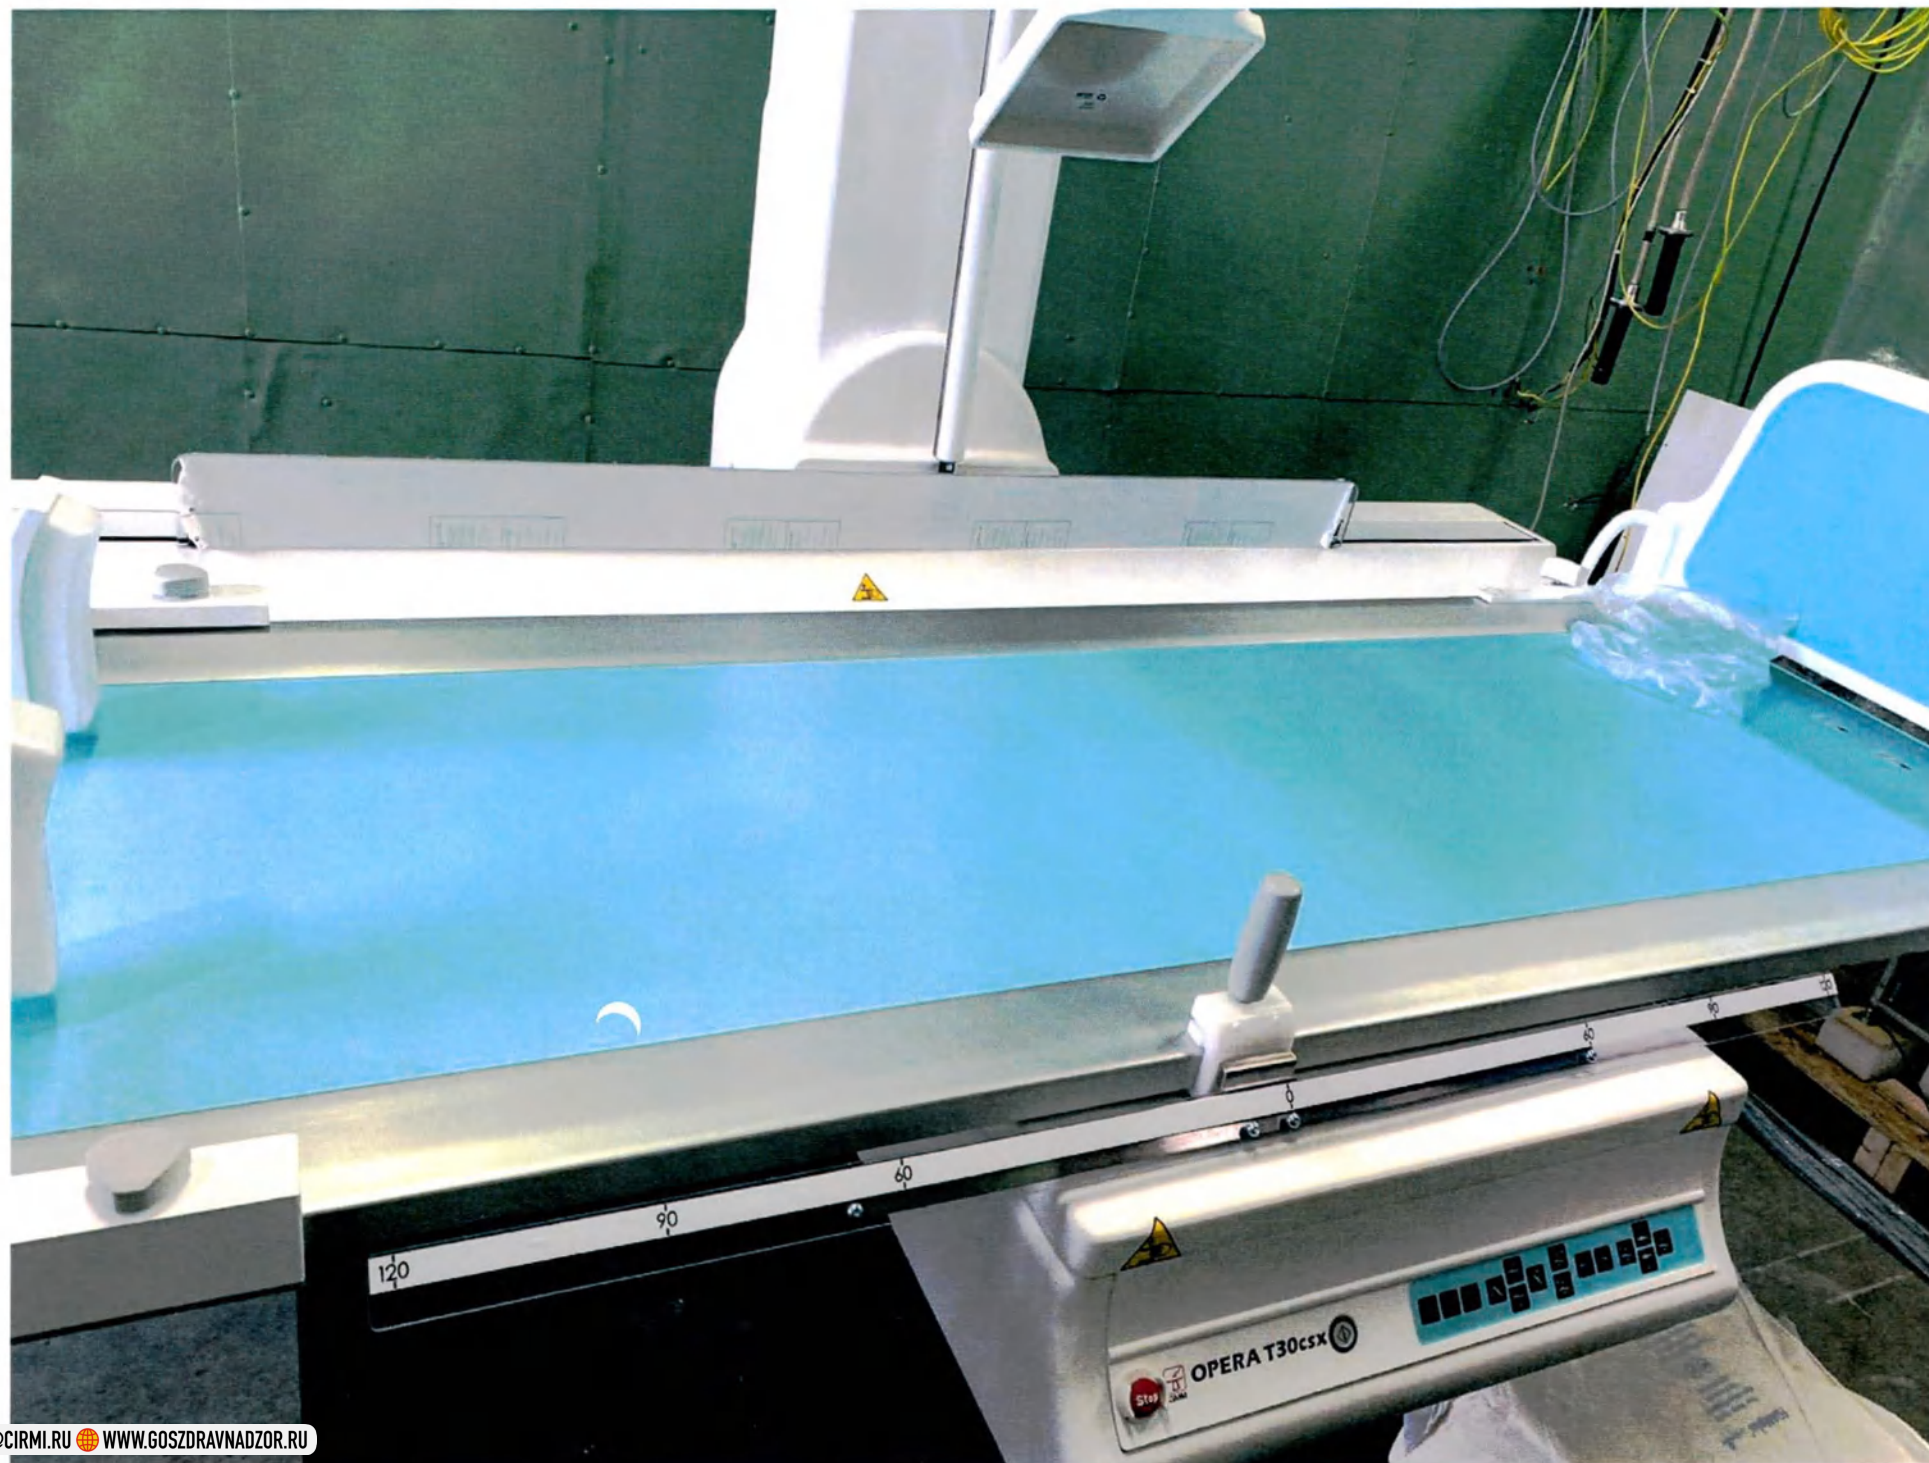

Телеуправляемый поворотный стол-штатив для рентгенологических исследований OPERA T90, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнение 01)



Телеуправляемый поворотный стол-штатив для рентгенологических исследований CLISIS Exel, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнение 02)







Пульт управления с педалью, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнения 01, 02)



Педаль к пульту управления, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнения 01, 02)




Устройство рентгеновское питающее VZW 2558, производства Communications & Power Industries Canada Inc, Канада
(исполнения 01, 02, 03)




Устройство рентгеновское питающее EPS 45-80 HIGH-VOLTAGE GENERATOR с принадлежностями, производства EMD Technologies, Канада (РУ № ФСЗ 2010/06234) (исполнения 01, 02, 03)



Комплекс программно-аппаратный получения и обработки рентгеновских изображений (АРМ лаборанта) D4000RF, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнение 01, 02, 03)

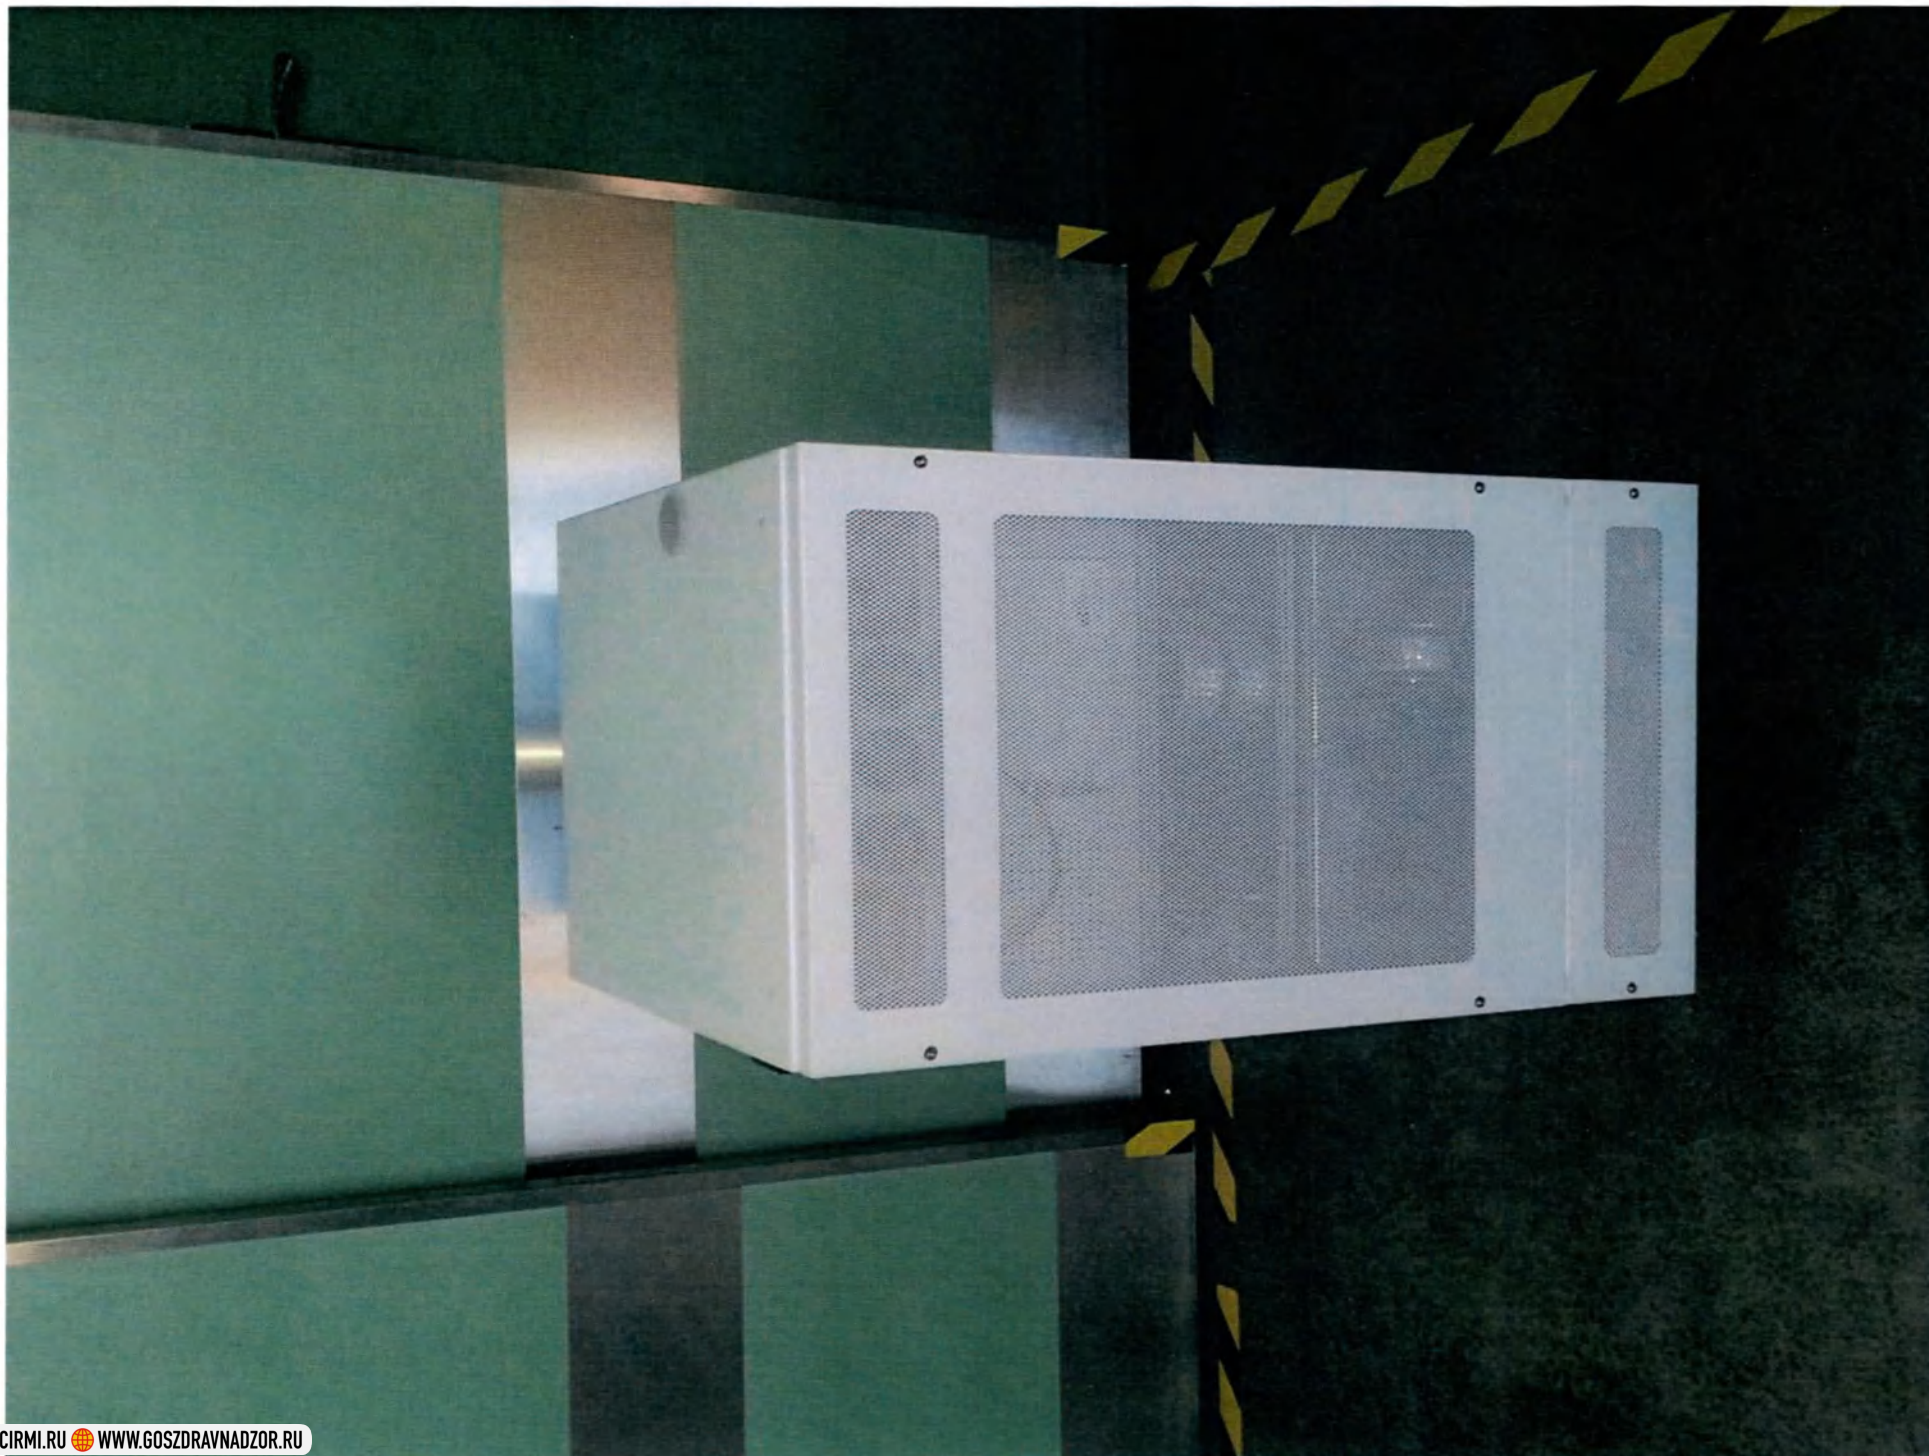


Комплекс программно-аппаратный получения и обработки рентгеновских изображений (АРМ лаборанта) D4000RF, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнение 01, 02, 03)

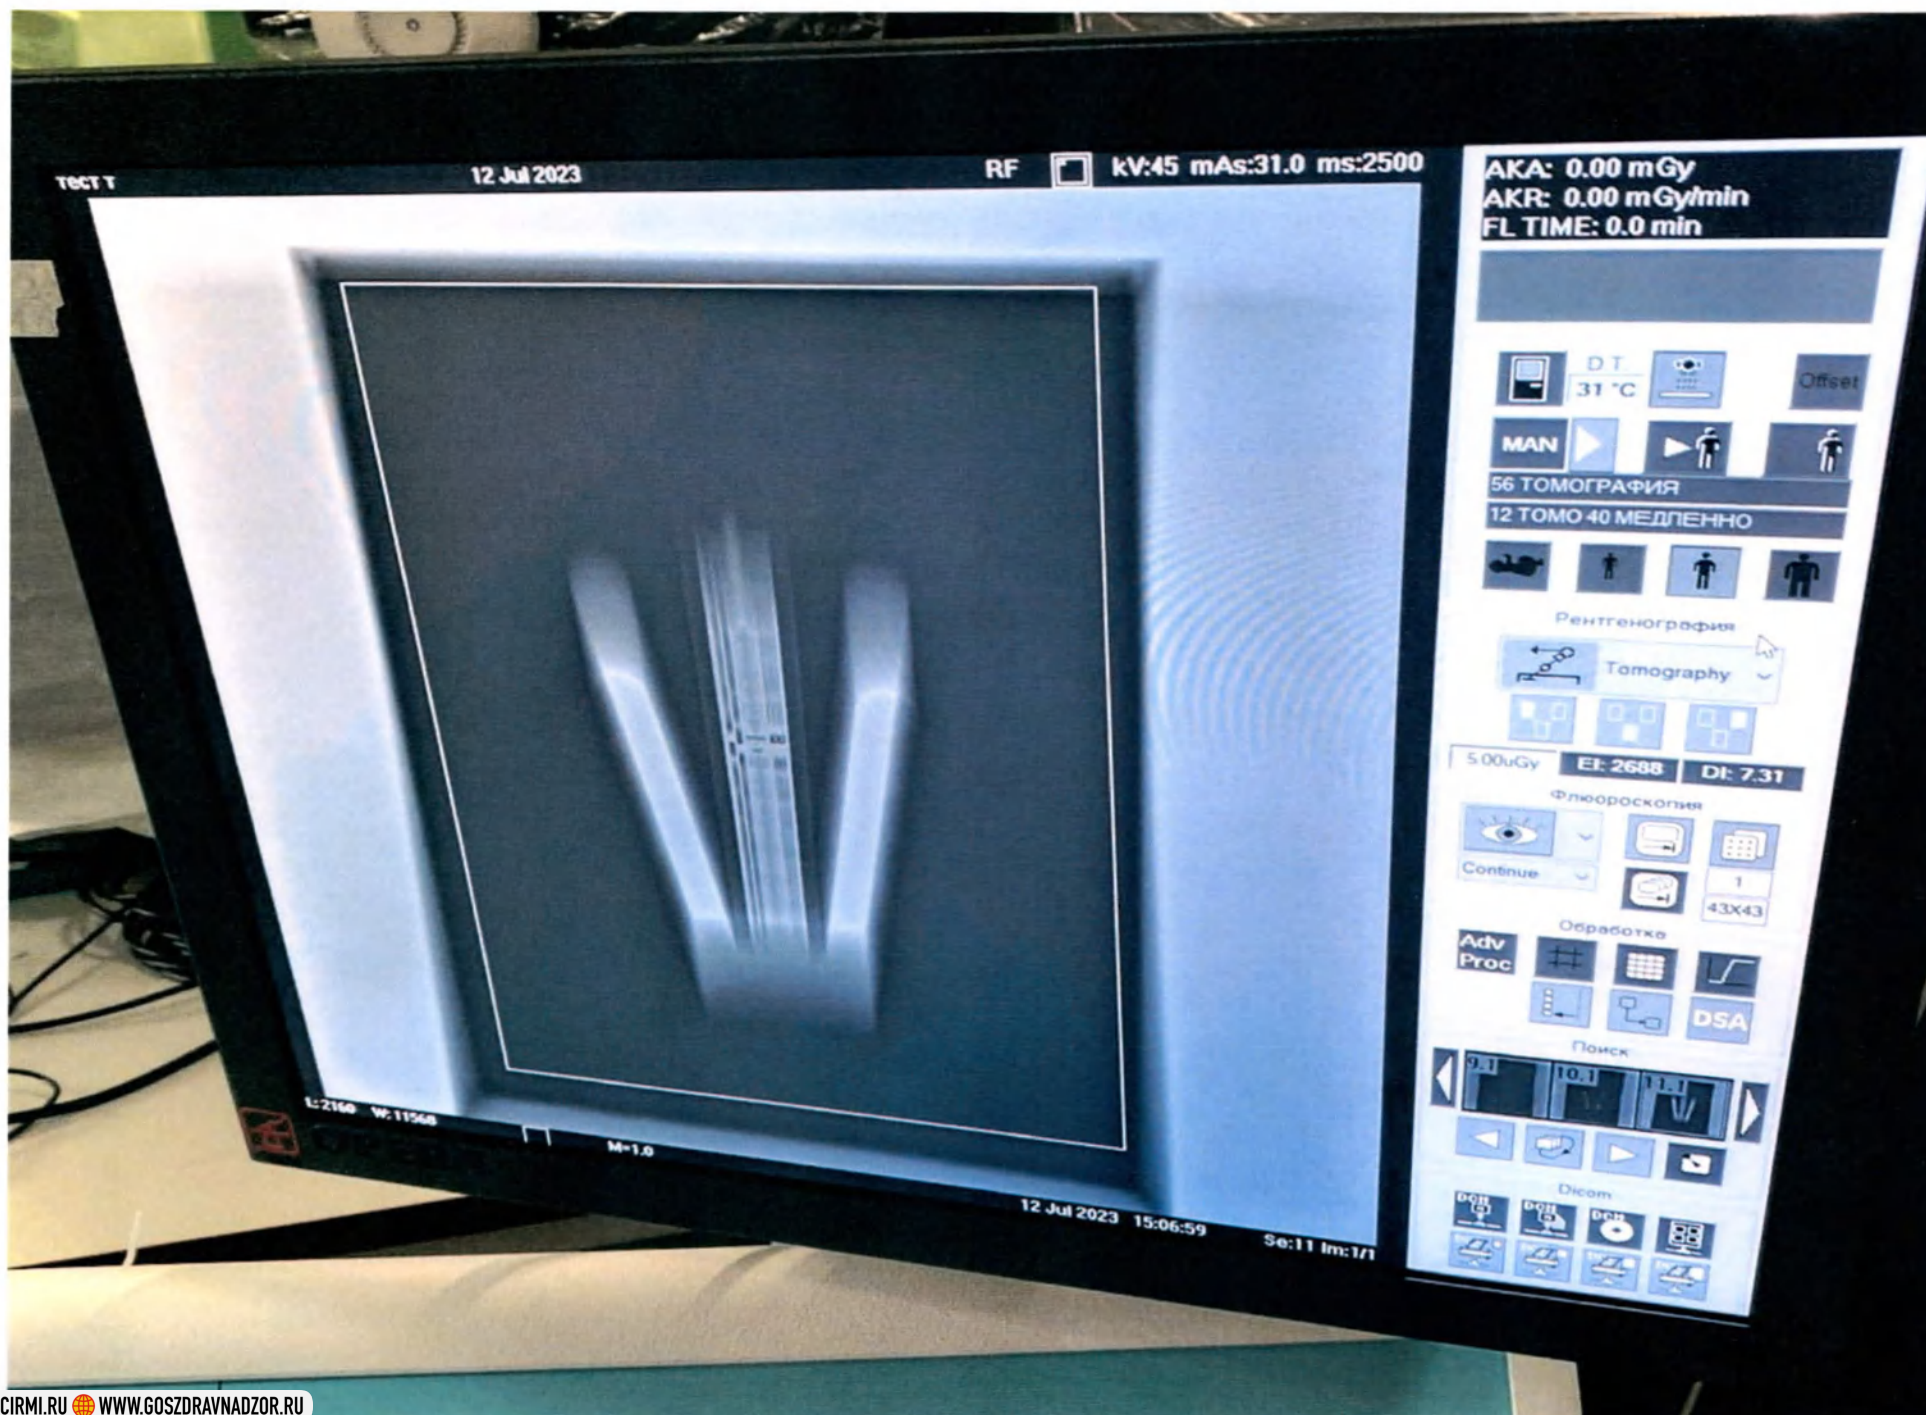


Комплекс программно-аппаратный получения и обработки рентгеновских изображений (АРМ лаборанта) Cloud RF, производства ООО «ДАЛИ Медикал», Россия (исполнения 01, 02, 03)




Комплекс программно-аппаратный получения и обработки рентгеновских изображений (АРМ лаборанта) Cloud RF, производства ООО «ДАЛИ Медикал», Россия (исполнения 01, 02, 03)

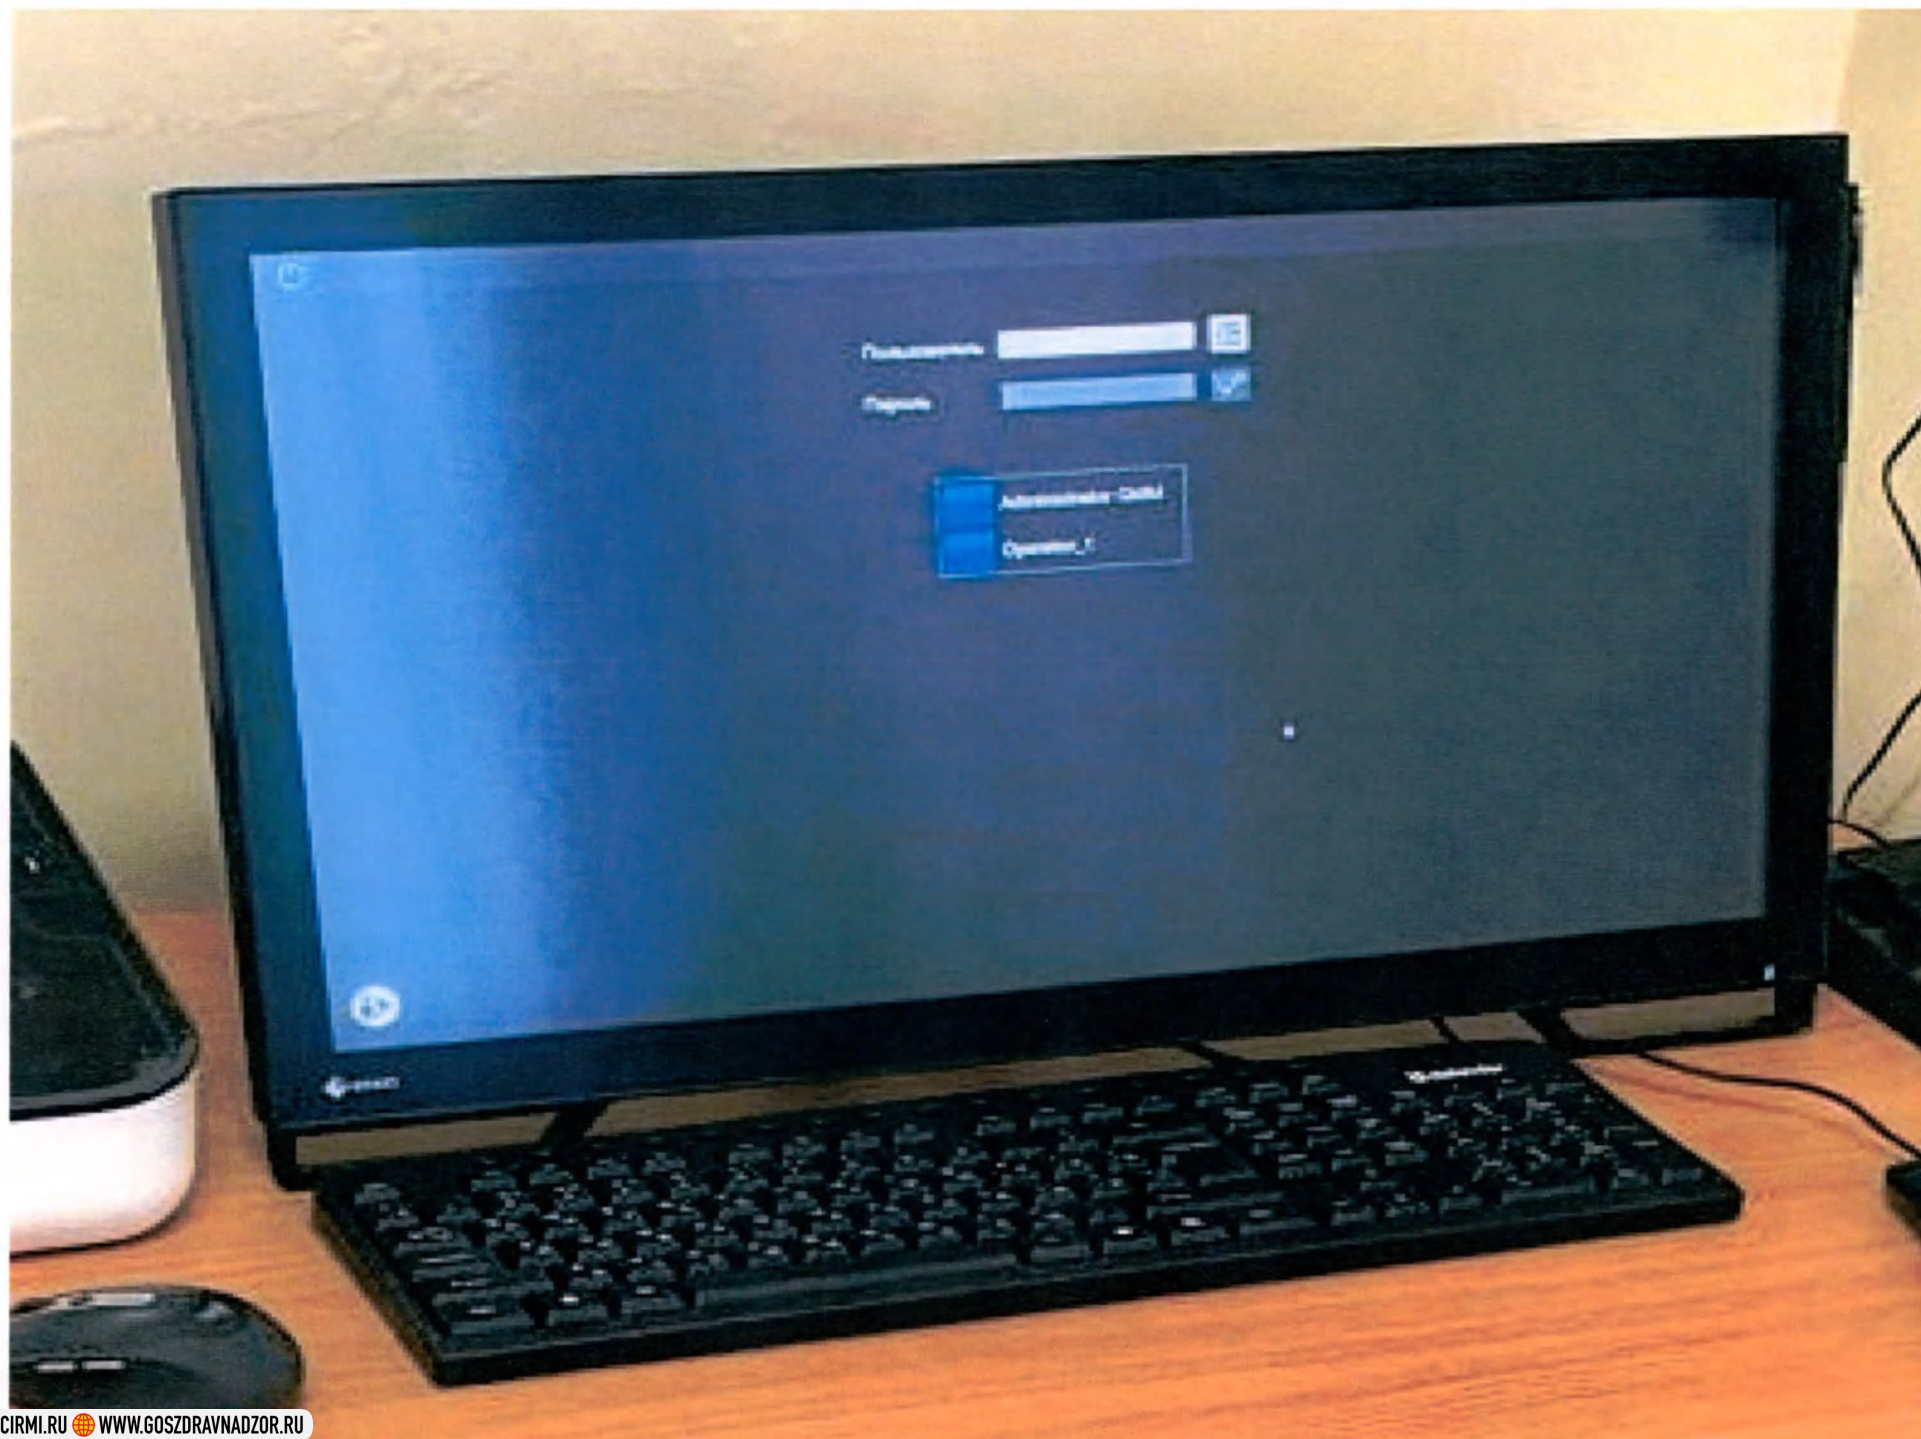


Цифровой приемник рентгеновского изображения PaxScan 4343 DXV, производства Varex Imaging Corporation, США
(исполнения 01, 02, 03)

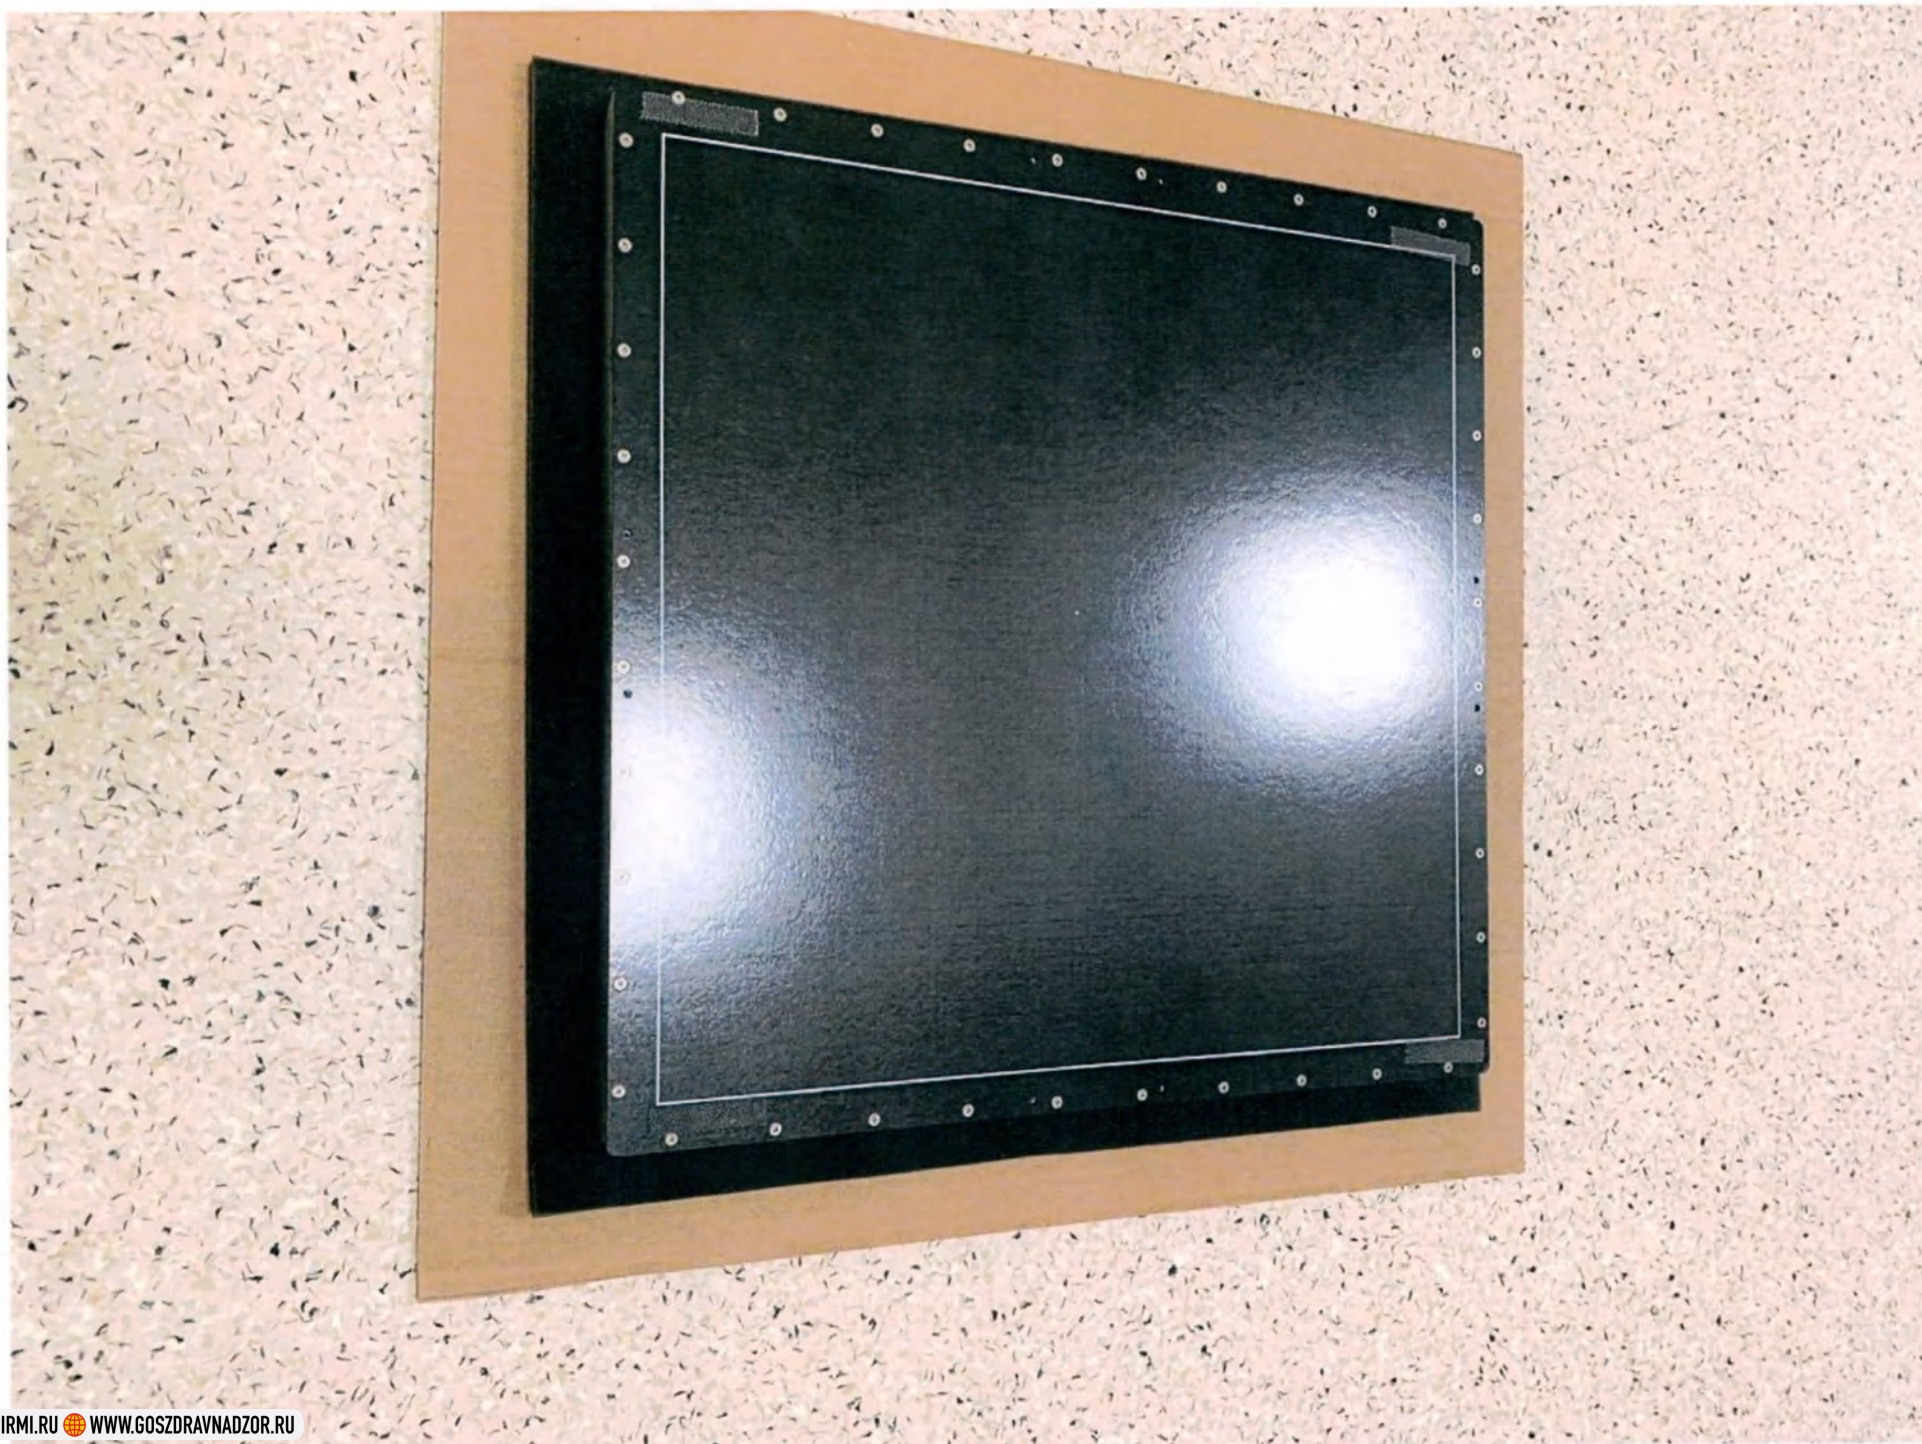

Цифровой приемник рентгеновского изображения Pixium RF 4343, производства Thales Electron Devices S.A., Франция
(исполнения 01, 02, 03)

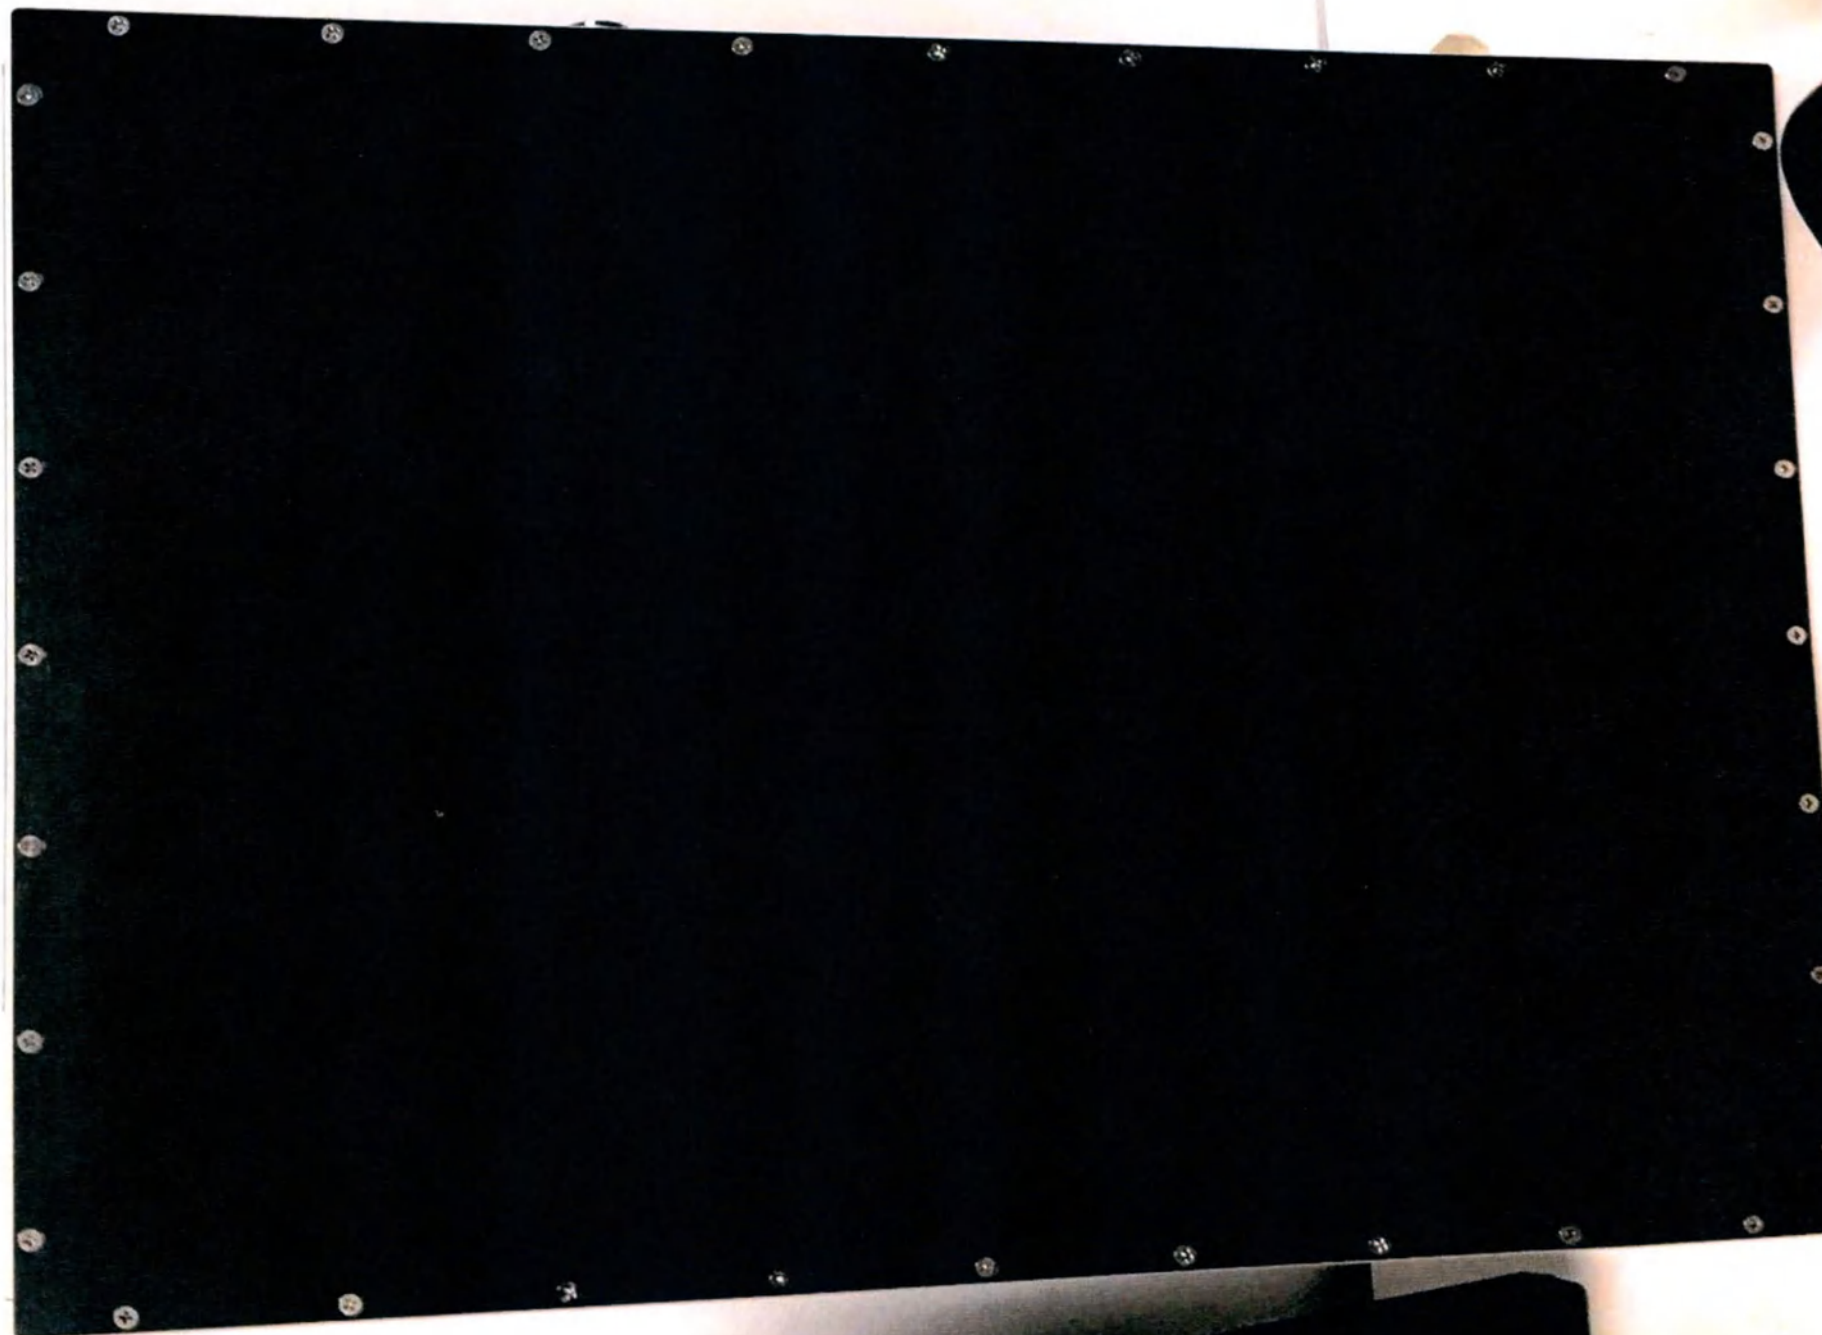

Цифровой приемник рентгеновского изображения Pixium 4343 FL, производства Thales Electron Devices S.A., Франция
(исполнения 01, 02, 03)

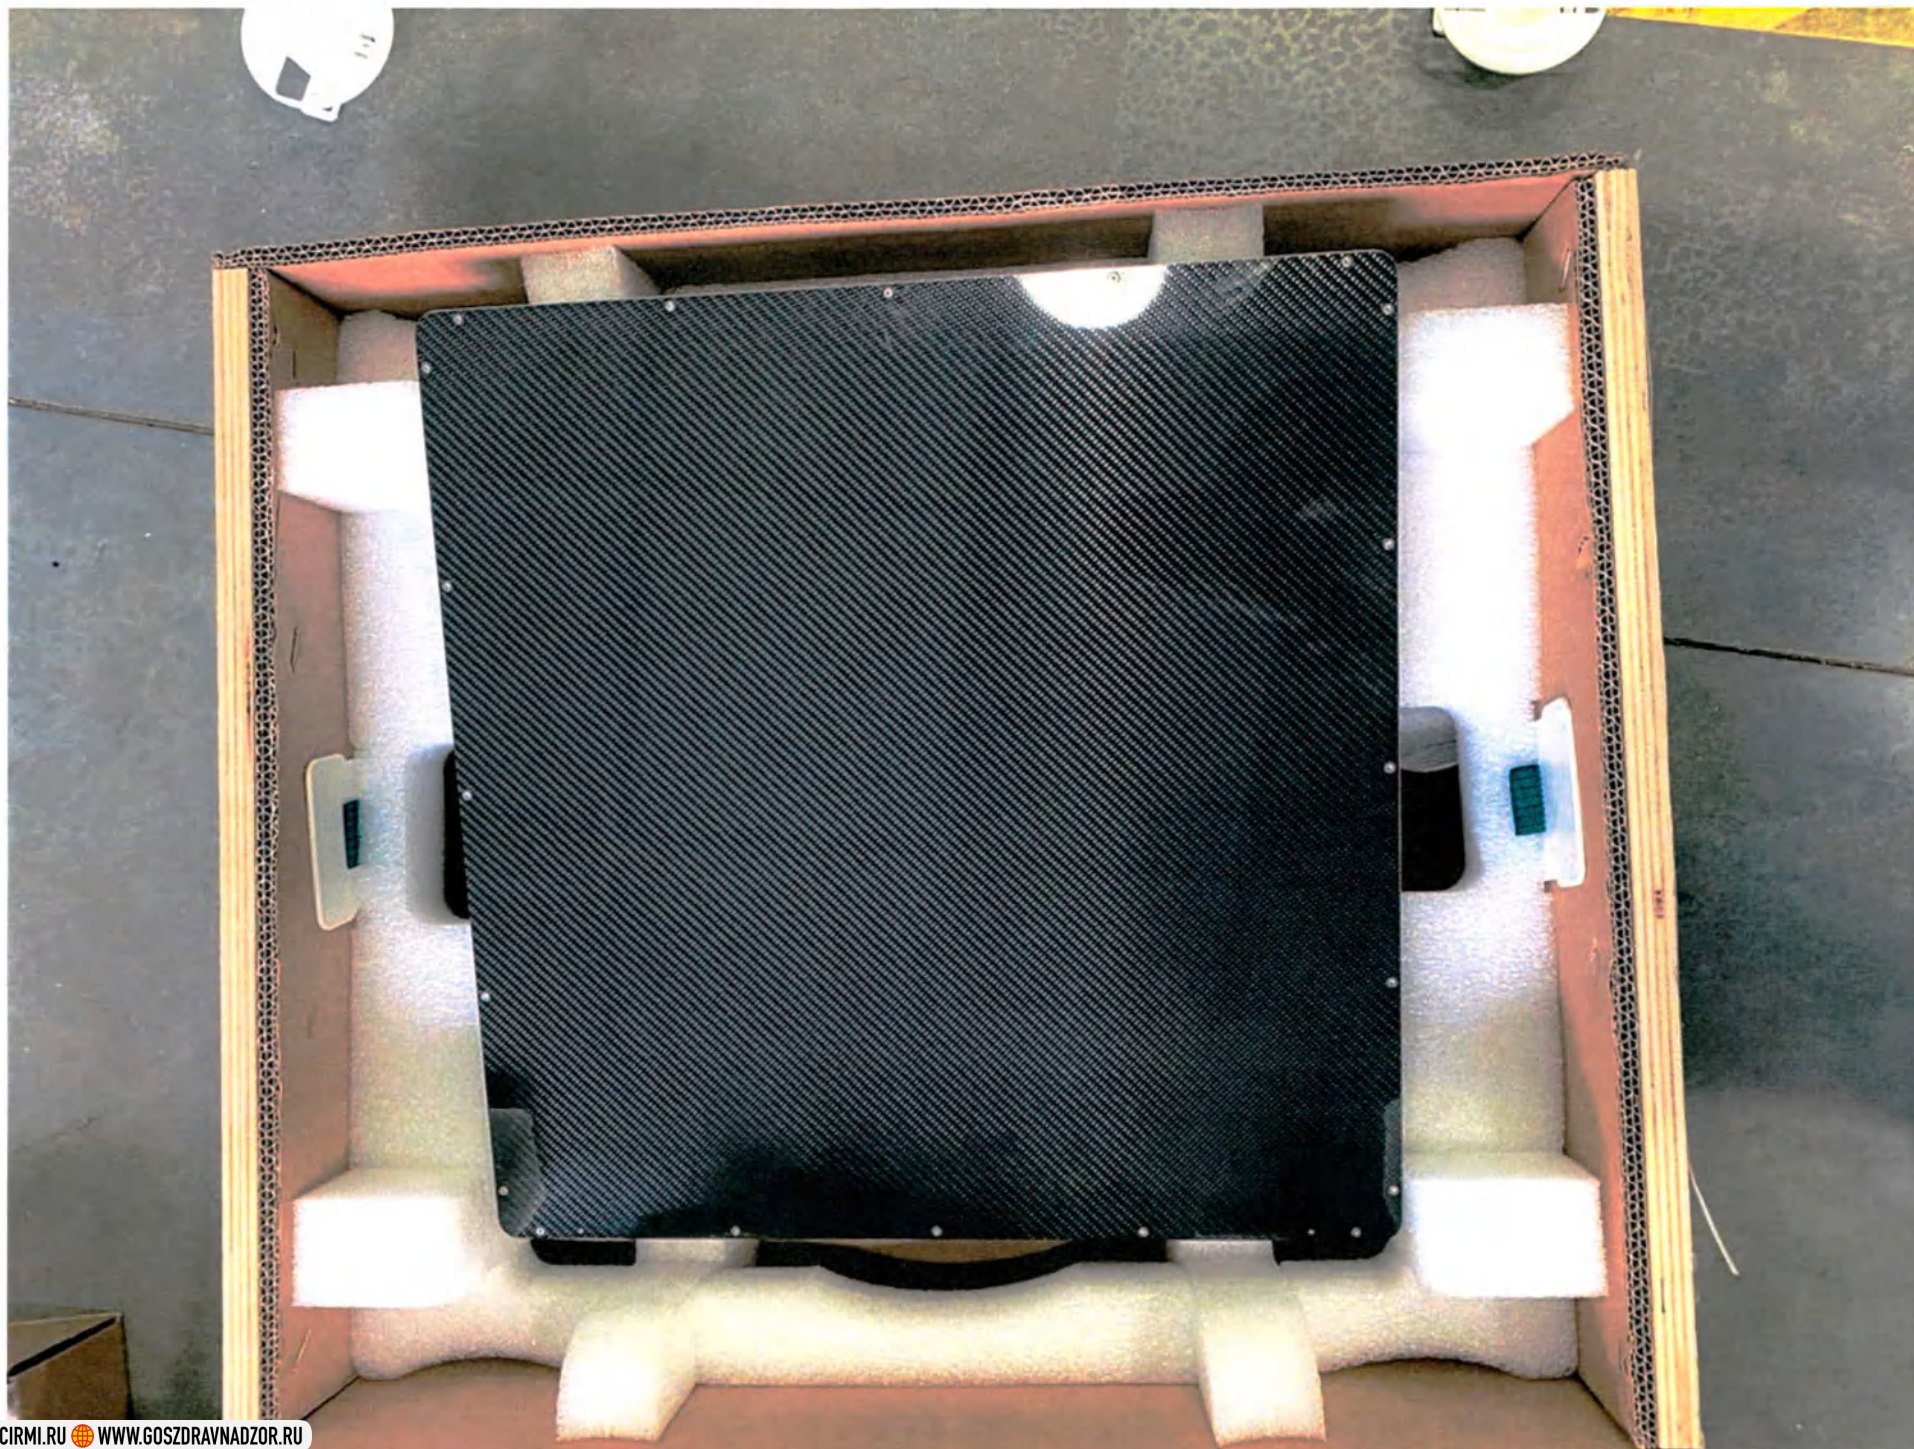

Рентгеновский излучатель RTM, производства IAE S.p.a. (исполнения 01, 02, 03)








Коллиматор серии Ralco R, модели R 225ACS DHHS, производства Ralco s.r.l., Италия (исполнение 01, 02, 03)



Коллиматор серии Ralco R, модели R 302, производства Ralco s.r.l., Италия (исполнения 01, 02, 03)

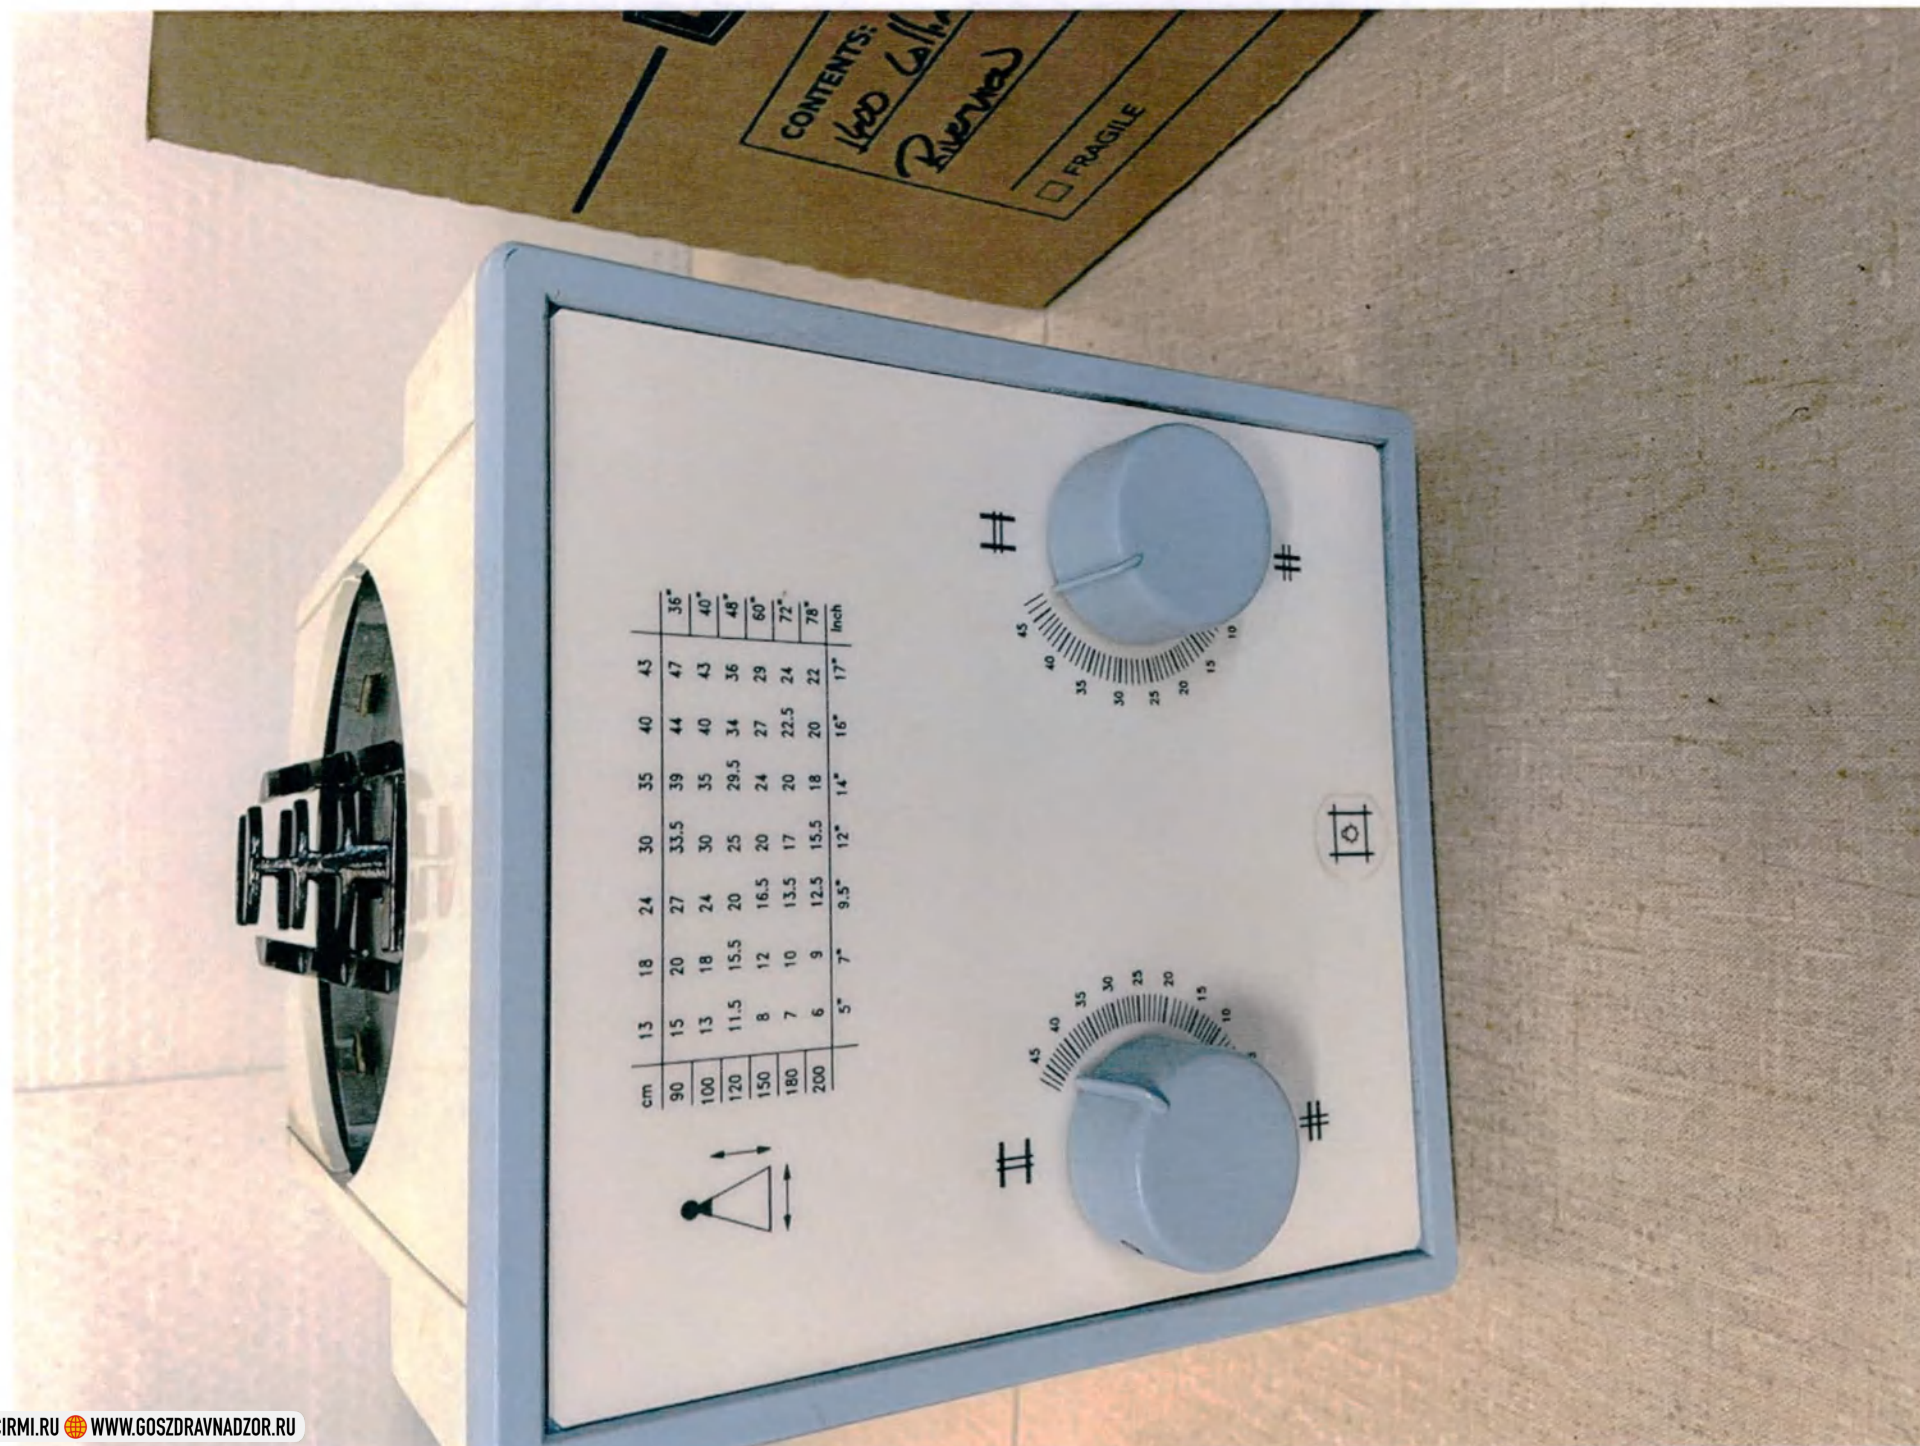


Коллиматор серии Ralco R, модели R 221, производства Ralco s.r.l., Италия (исполнения 01, 02, 03)



Коллиматор Optica 40, производства Varex Imaging Americas Corp., США или Varex Imaging Philippines Inc, Филиппины или Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды (исполнения 01, 02, 03)




Отсеивающая решетка JPI, производства Jungwon Precision Industries Healthcare Co, Ю. Корея (исполнения 01, 02, 03)

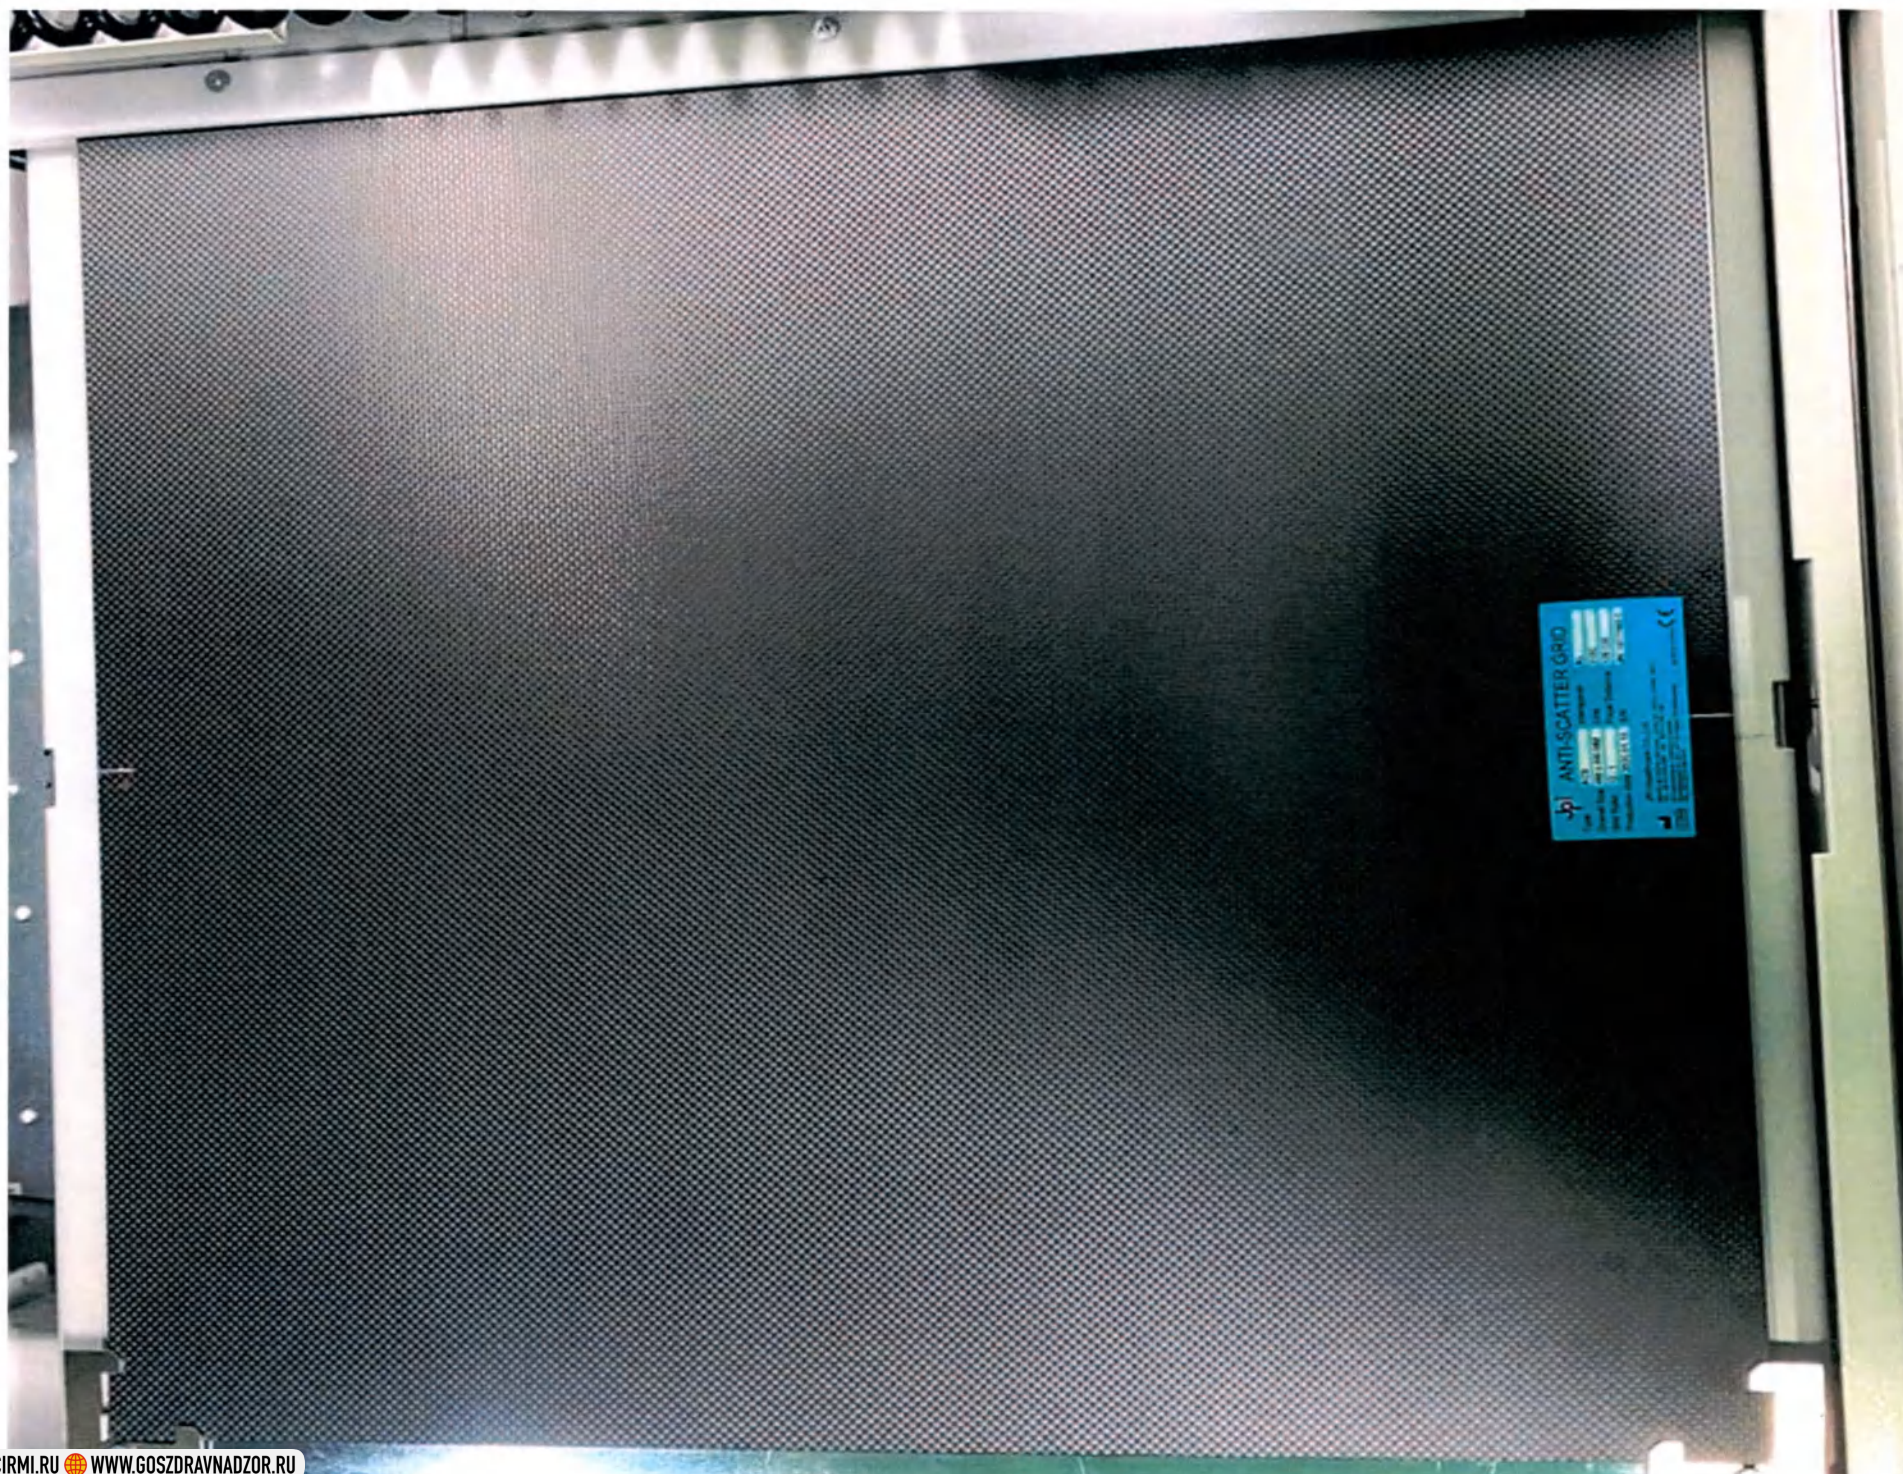


Отсеивающая решетка Soyee, производства Soyee Product Inc., Корея (исполнения 01, 02, 03)



Ионизационная камера серии SSMC, модели: 508, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды
(исполнения 01, 02, 03)

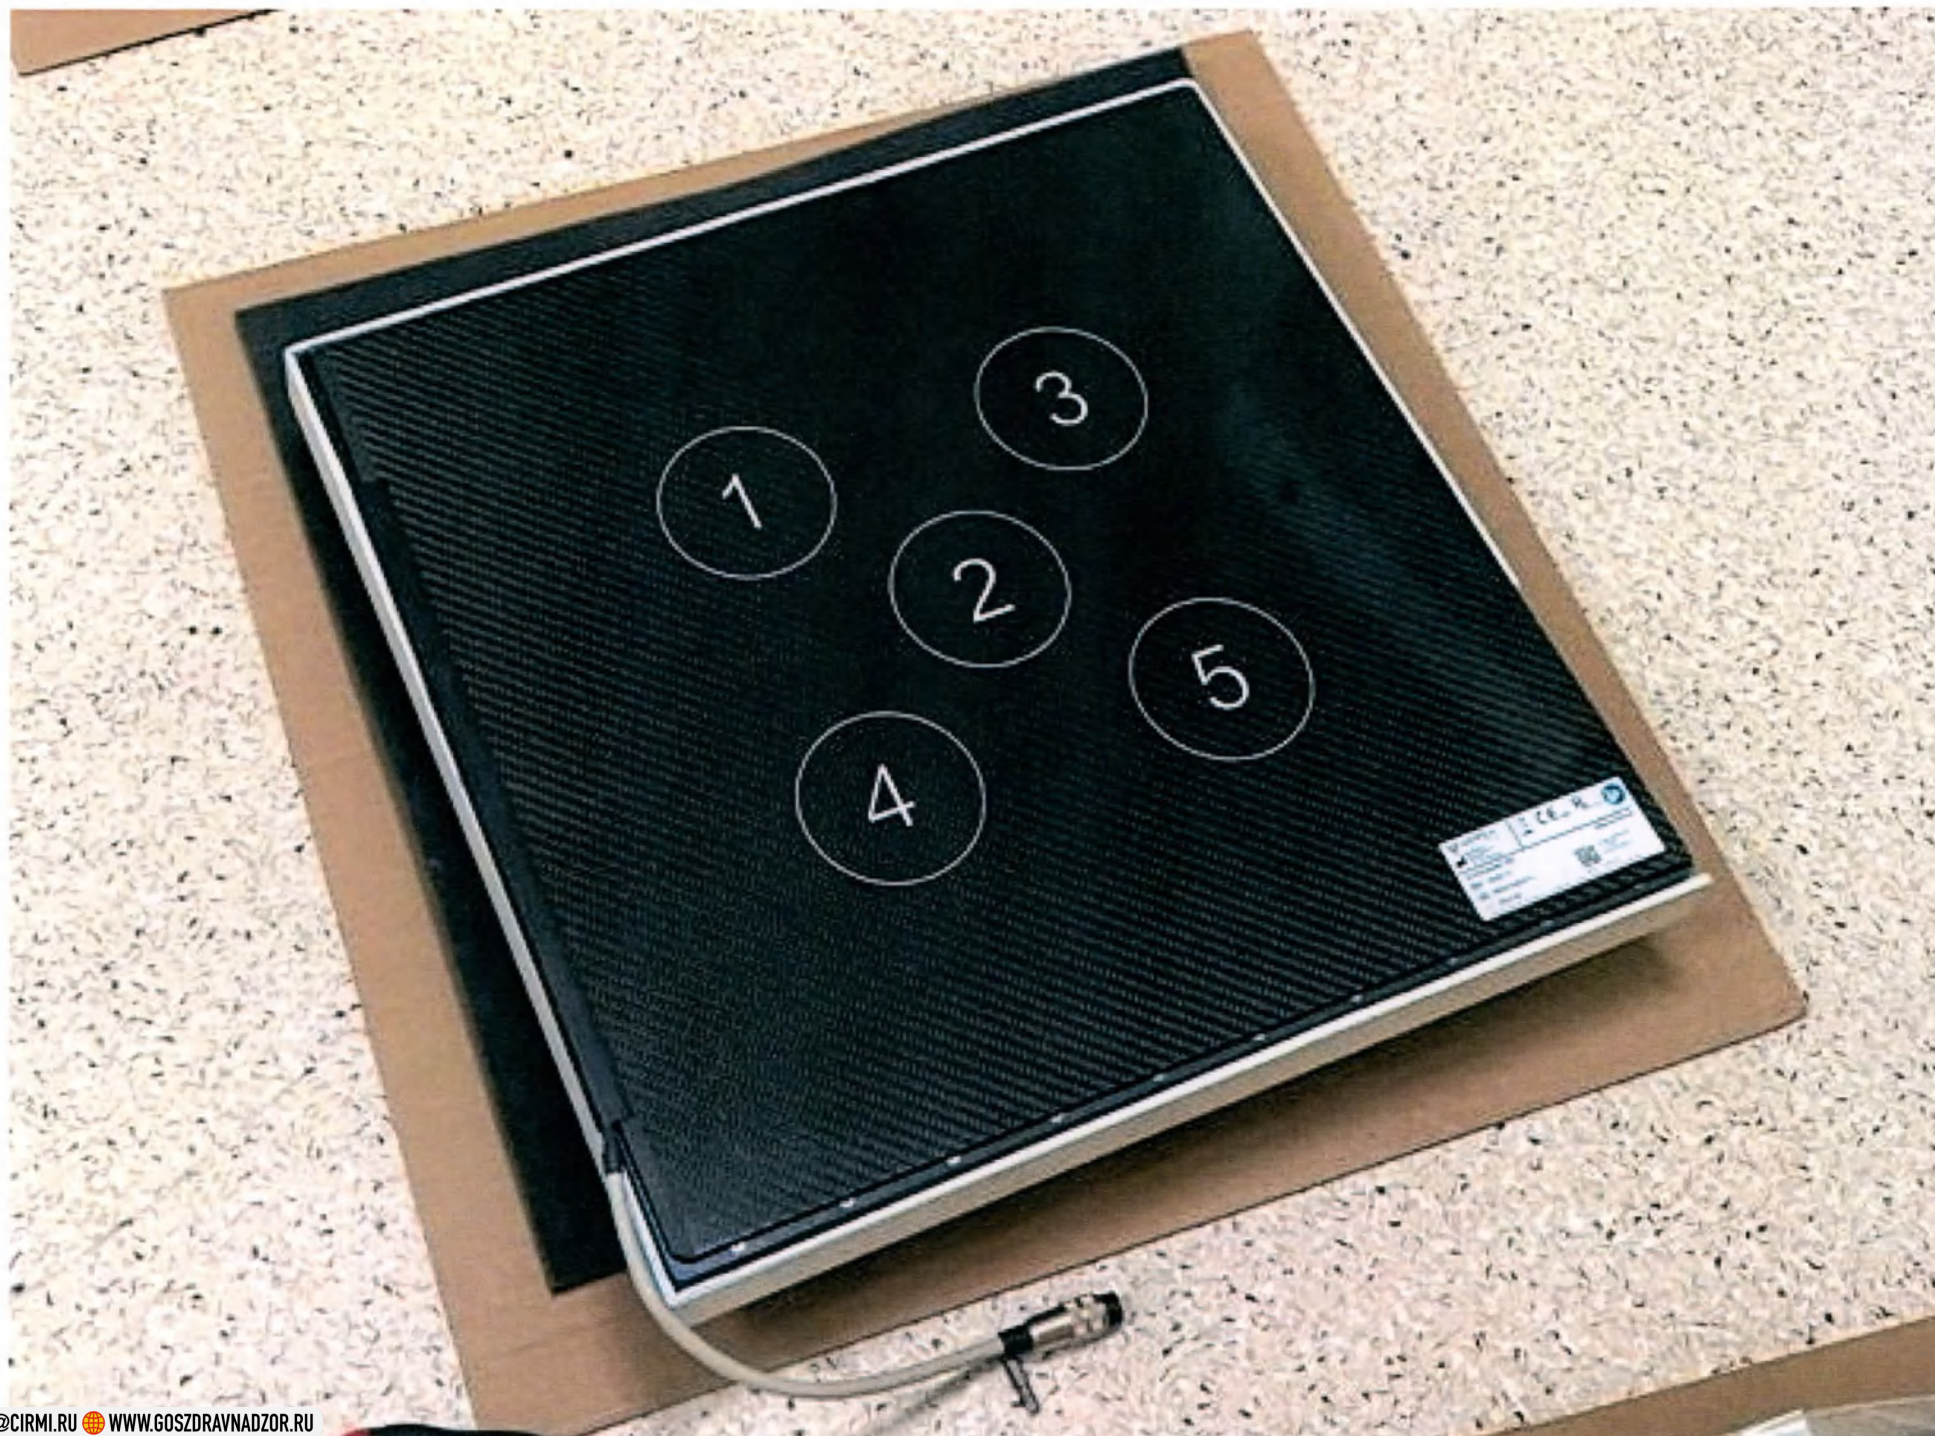

Ионизационная камера серии SSMC, модели: 601, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды
(исполнения 01, 02, 03)

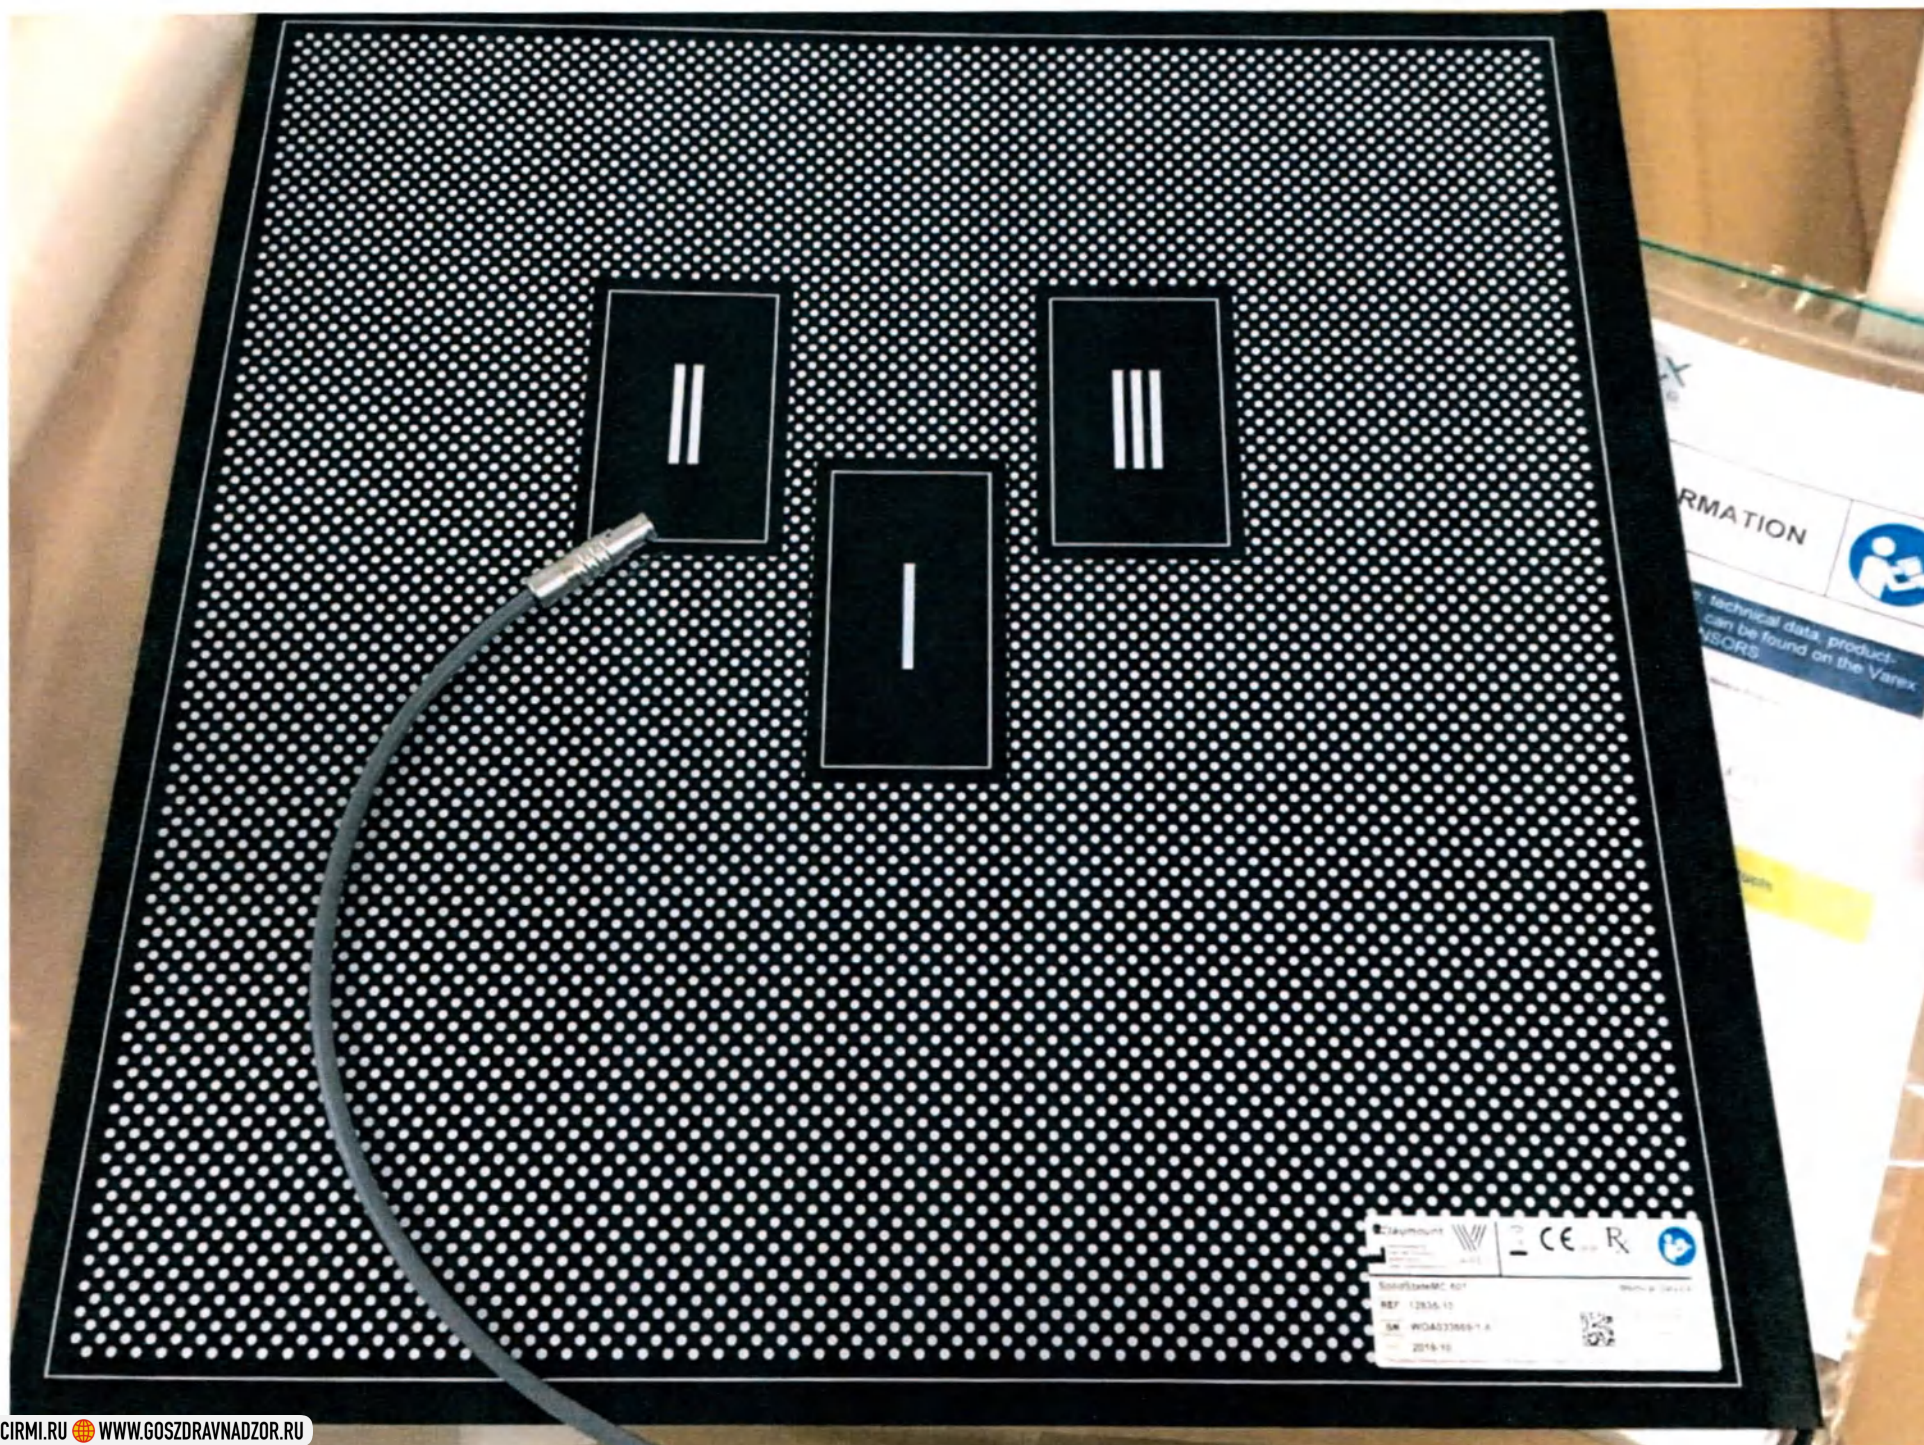


Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012: Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, производства ООО "НПП "ДОЗА", Россия (РУ № РЗН 2014/1562) (исполнения 01, 02, 03)




Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System, производства VacuTec Meßtechnik GmbH, Германия (РУ № ФСЗ 2012/11816) (исполнения 01, 02, 03)




Дозиметр KermaX Plus, производства IBA Dosimetry, GmbH, Германия (исполнения 01, 02, 03)

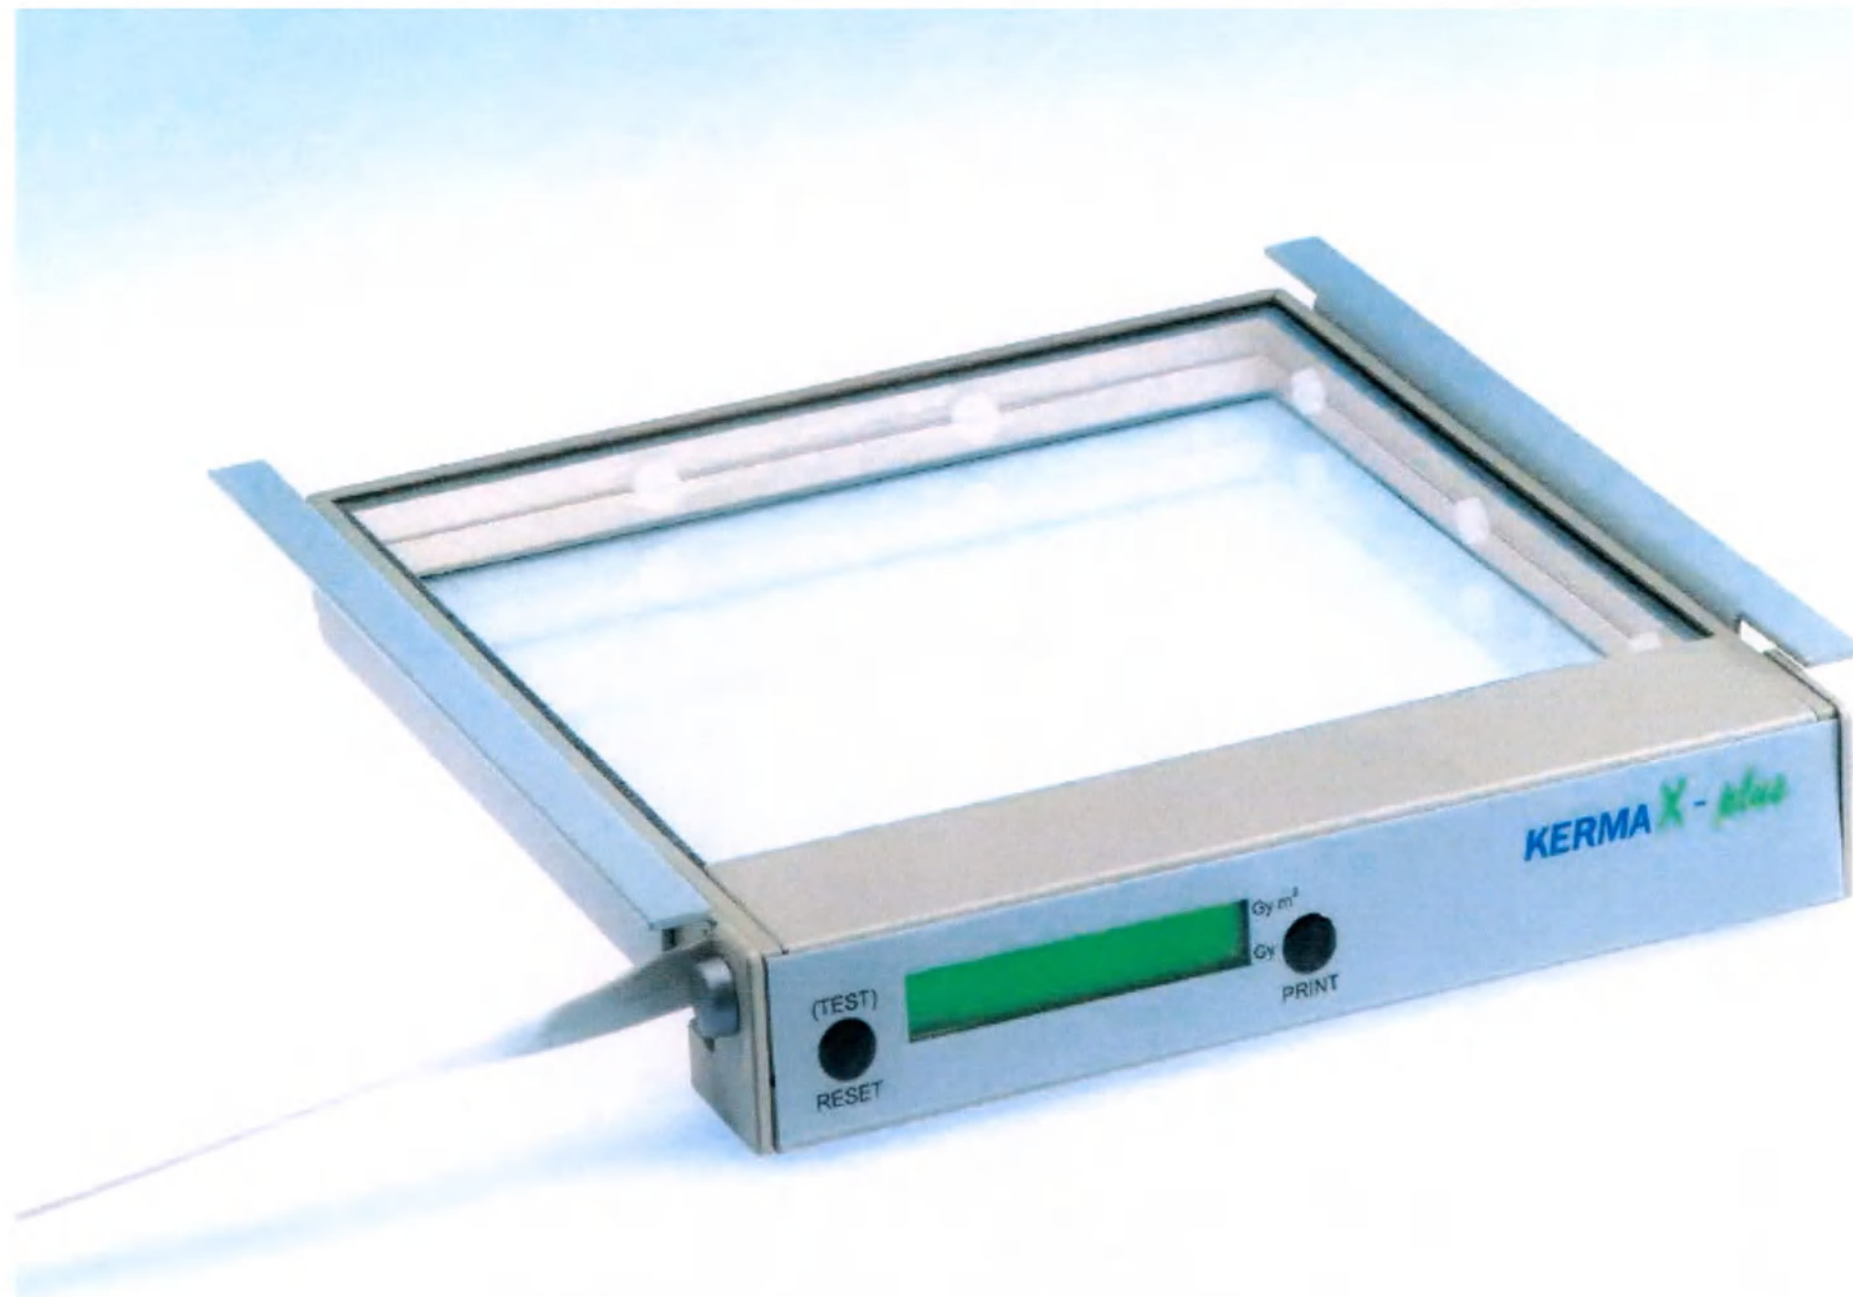

Плита-основание, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнения 01, 02) или ООО «ДАЛИ Медикал» (исполнение 01, 02, 03)

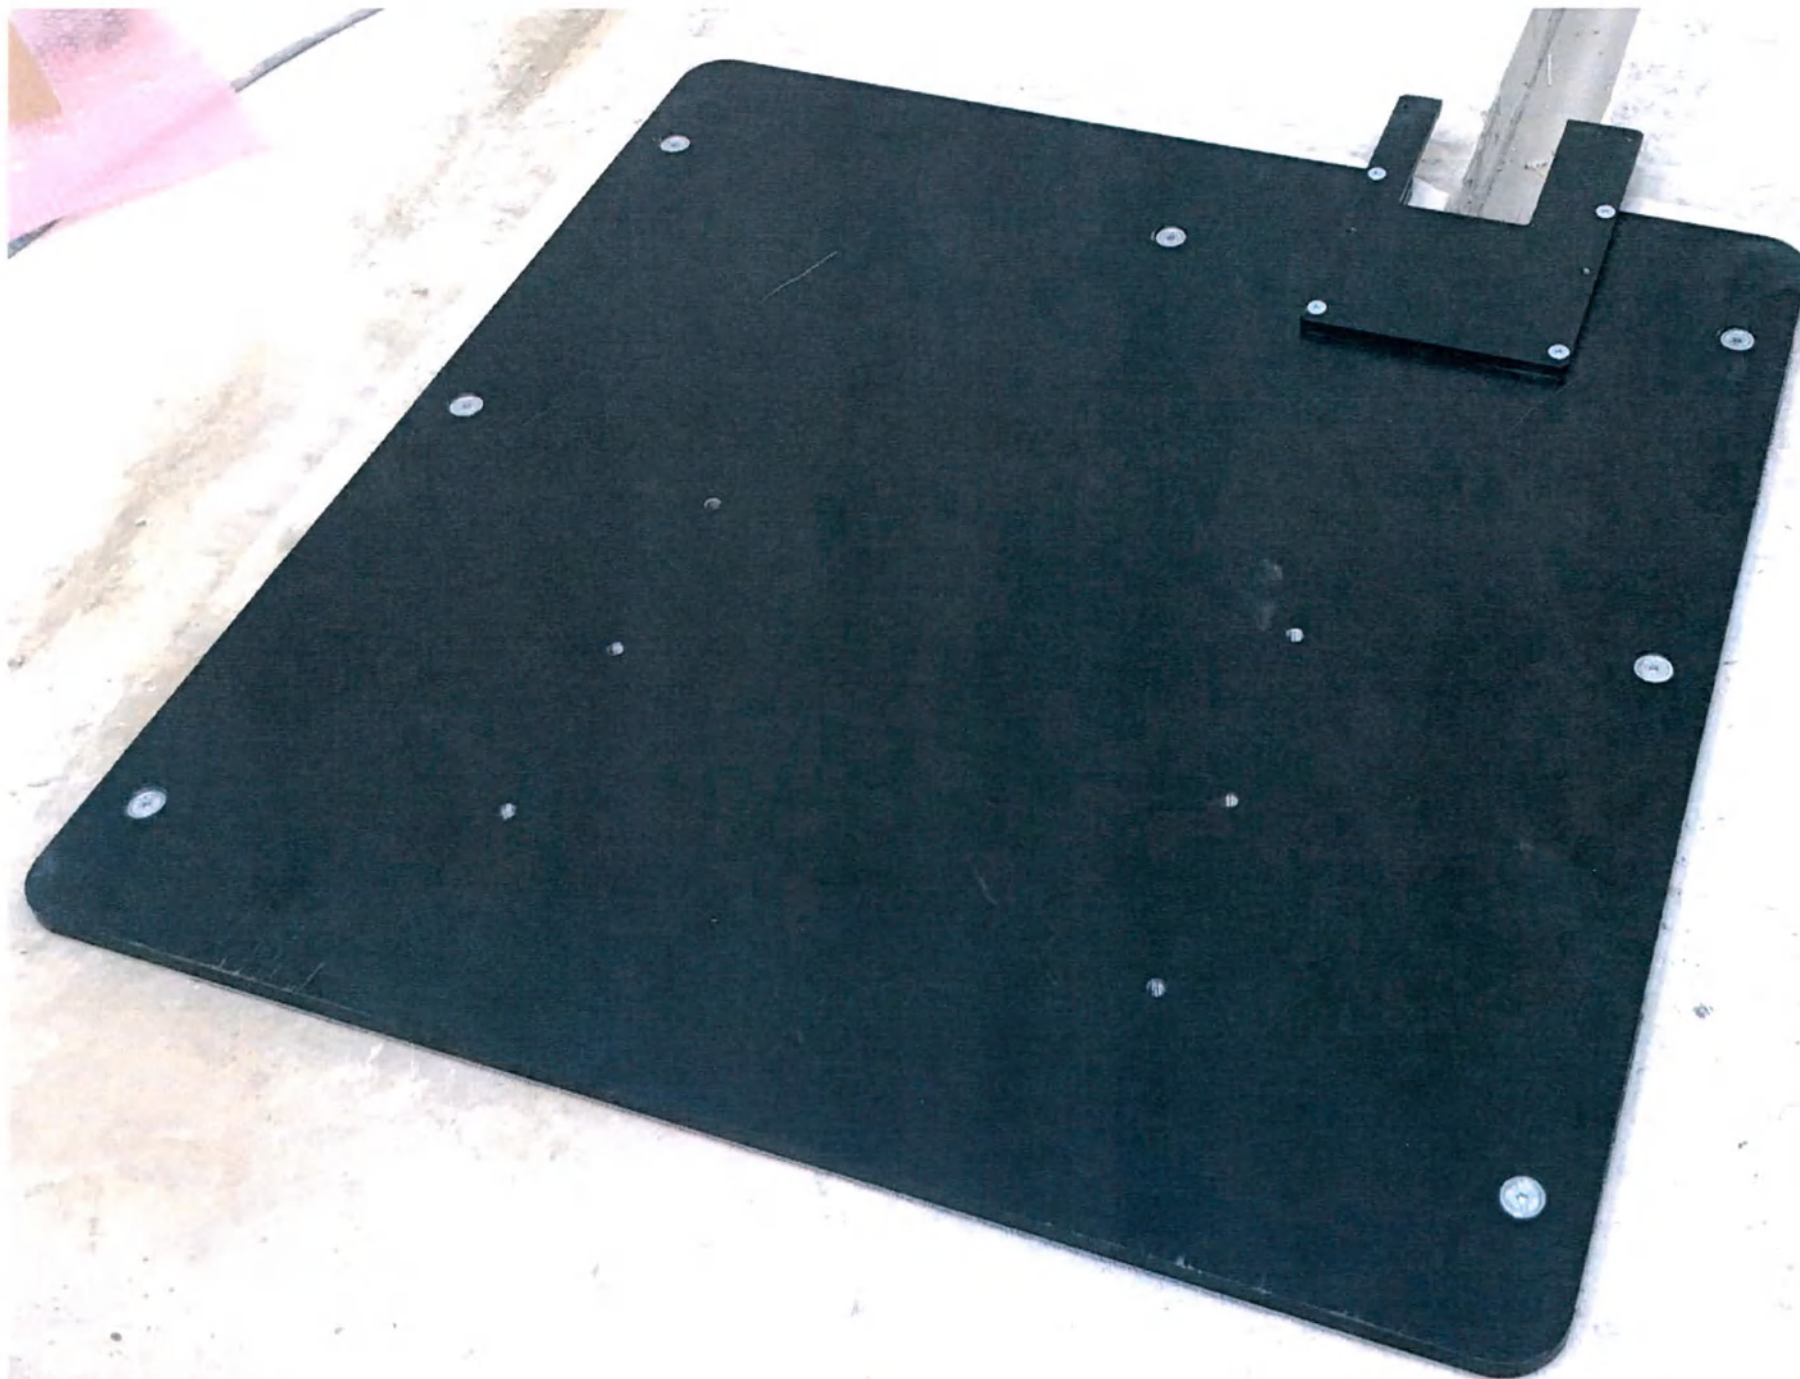

Плита-основание, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнения 01, 02) или ООО «ДАЛИ Медикал» (исполнение 01, 02, 03)

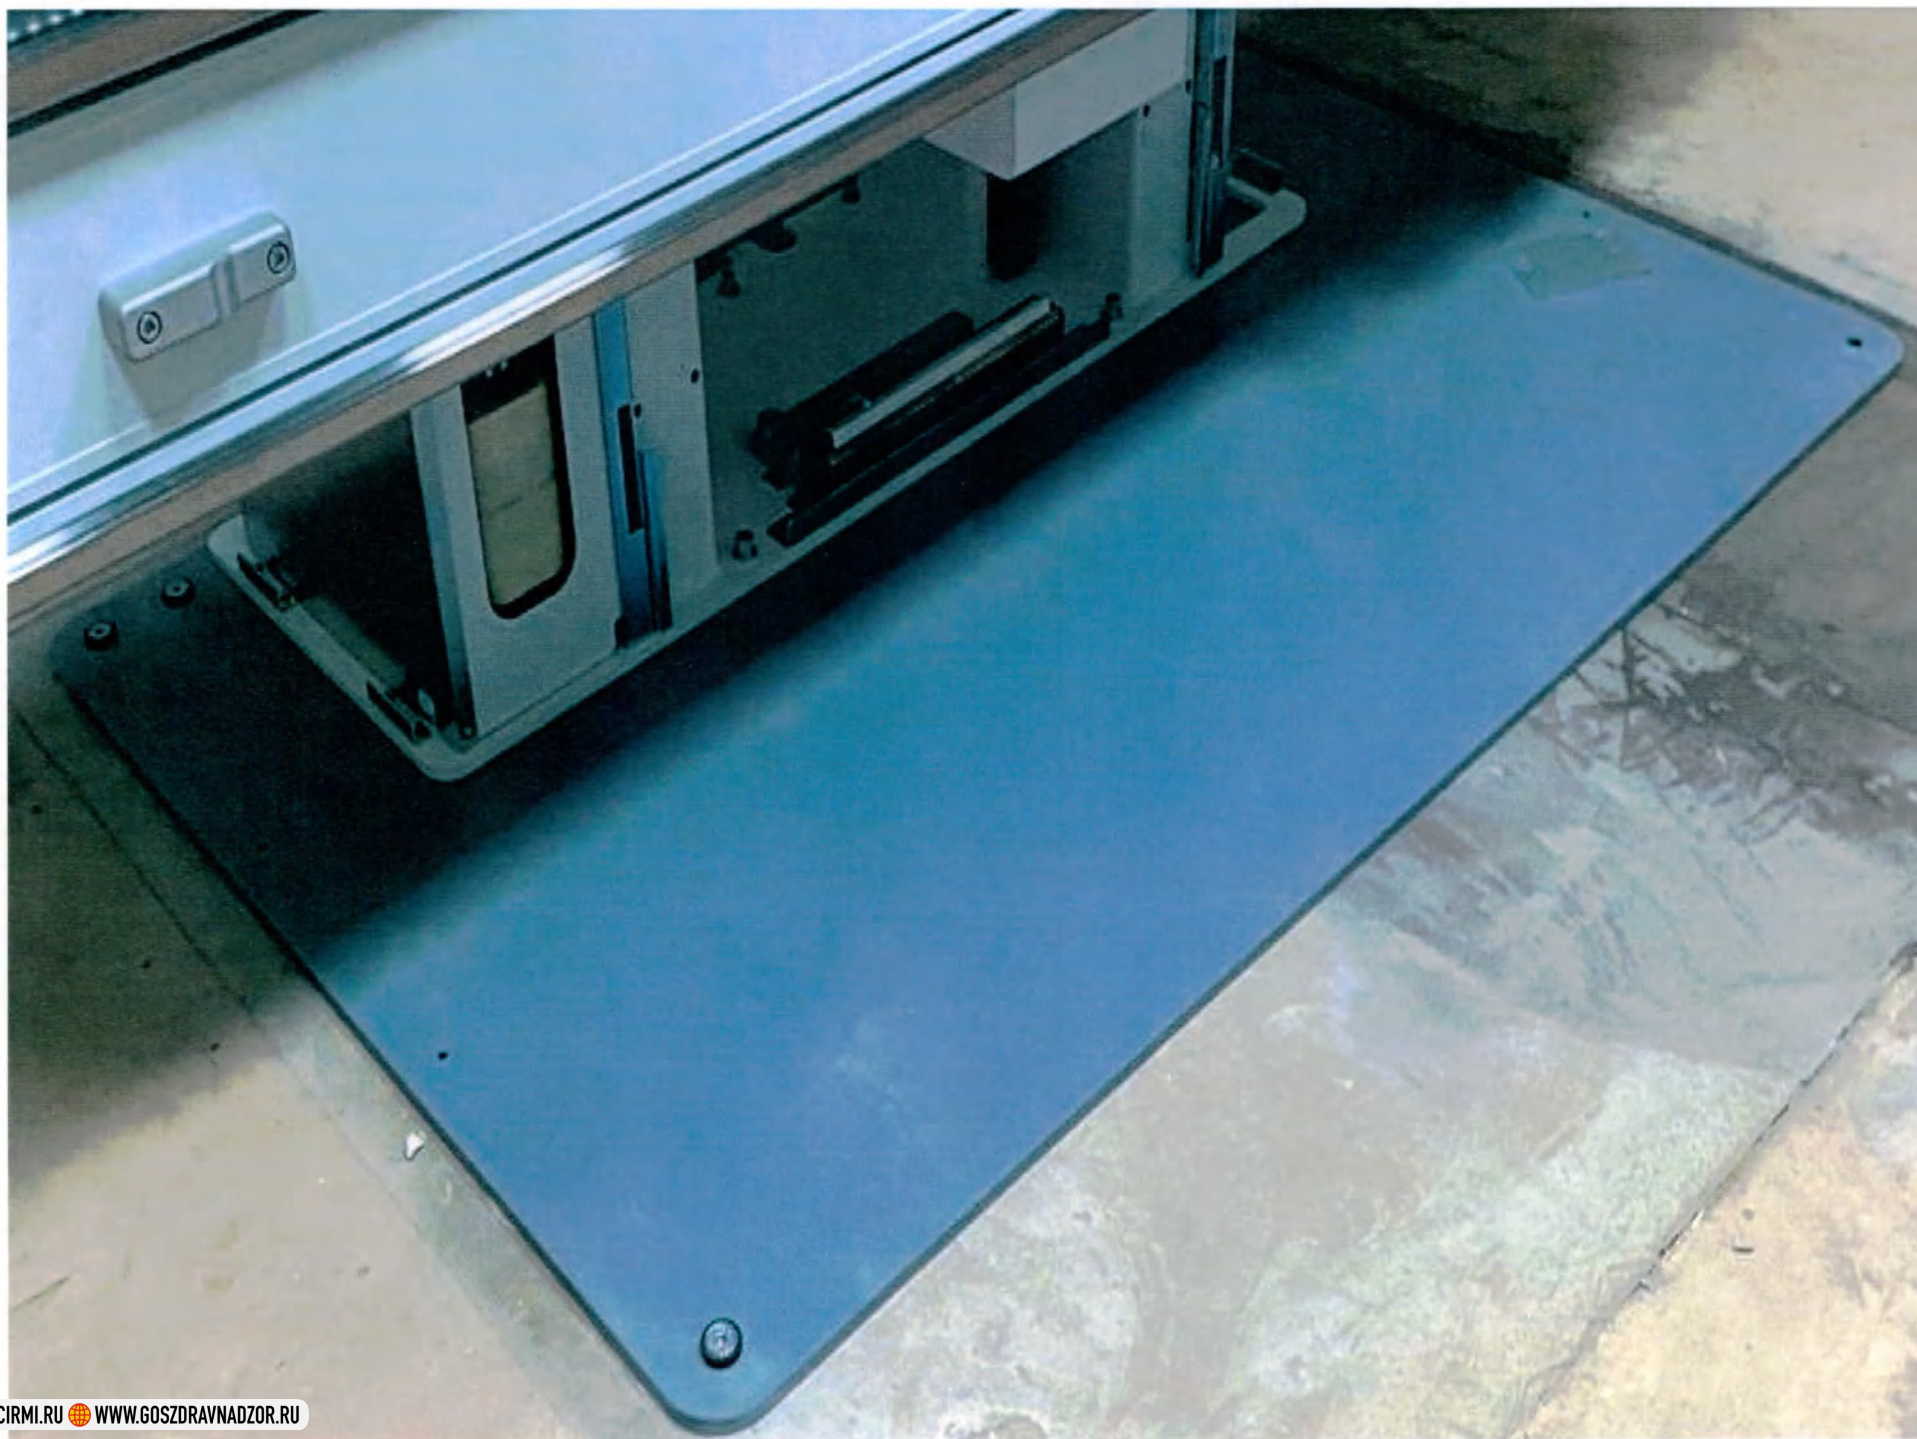

Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по ТУ 9440-001-98944313-2007, производства ООО «Мед-Рей», Россия (РУ № ФСР 2008/02715) (исполнения 01, 02, 03)



Программное обеспечение специализированное «АПК АрхиМед» по ТУ 62.01.29-002-98944313-2015, производства ООО «Мед-Рэй», Россия (РУ № РЗН 2019/8485) (исполнения 01, 02, 03)



Программное обеспечение специализированное «АПК АрхиМед» по ТУ 62.01.29-002-98944313-2015, производства ООО «Мед-Рэй», Россия (РУ № РЗН 2019/8485) (исполнения 01, 02, 03)



Ширмы рентгенозащитные: Ширмы рентгенозащитные по ТУ 9452-010-46782692-2001, производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», Россия (РУ № ФСР 2010/08184) (исполнения 01, 02, 03)




Ширмы рентгенозащитные: Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002, производства АО «ПОНИ», Россия (РУ № ФСР 2011/11811) (исполнения 01, 02, 03)




Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-"РЕНЕКС" по ТУ 9398-010-21009821-2004 , производства ЗАО «РЕНЕКС», Россия (ПУ № ФСР 2008/03184) (исполнения 01, 02, 03)



Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ - "Р-К" по ТУ 9452-007-46782692-2001, производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», Россия (РУ № ФСР 2010/08183) (исполнения 01, 02, 03)

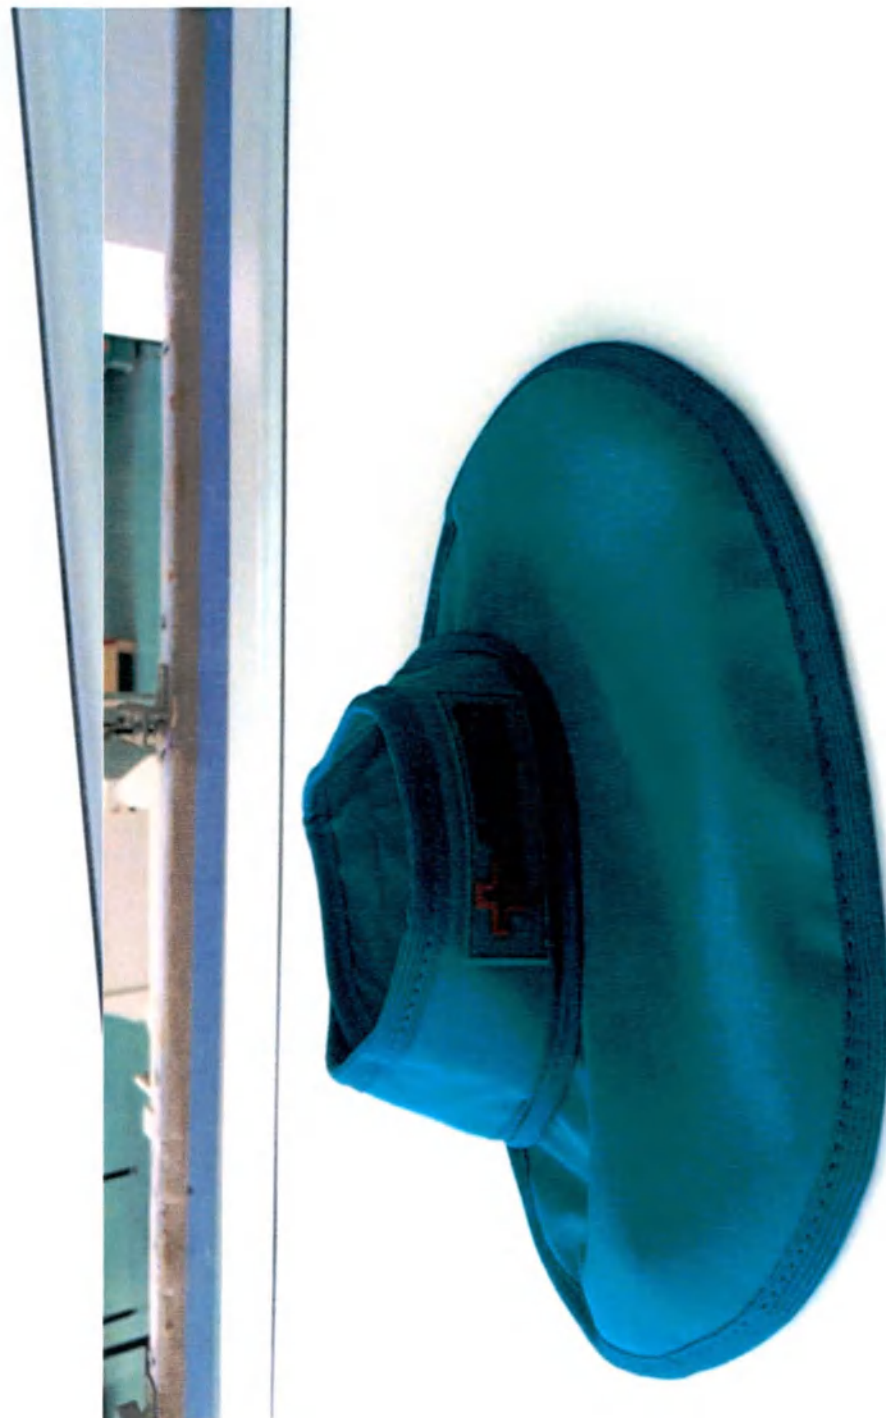


Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010, производства ИП Давлетов Д.Я., Россия (РУ № ФСР 2011/09994)
(исполнения 01, 02, 03)

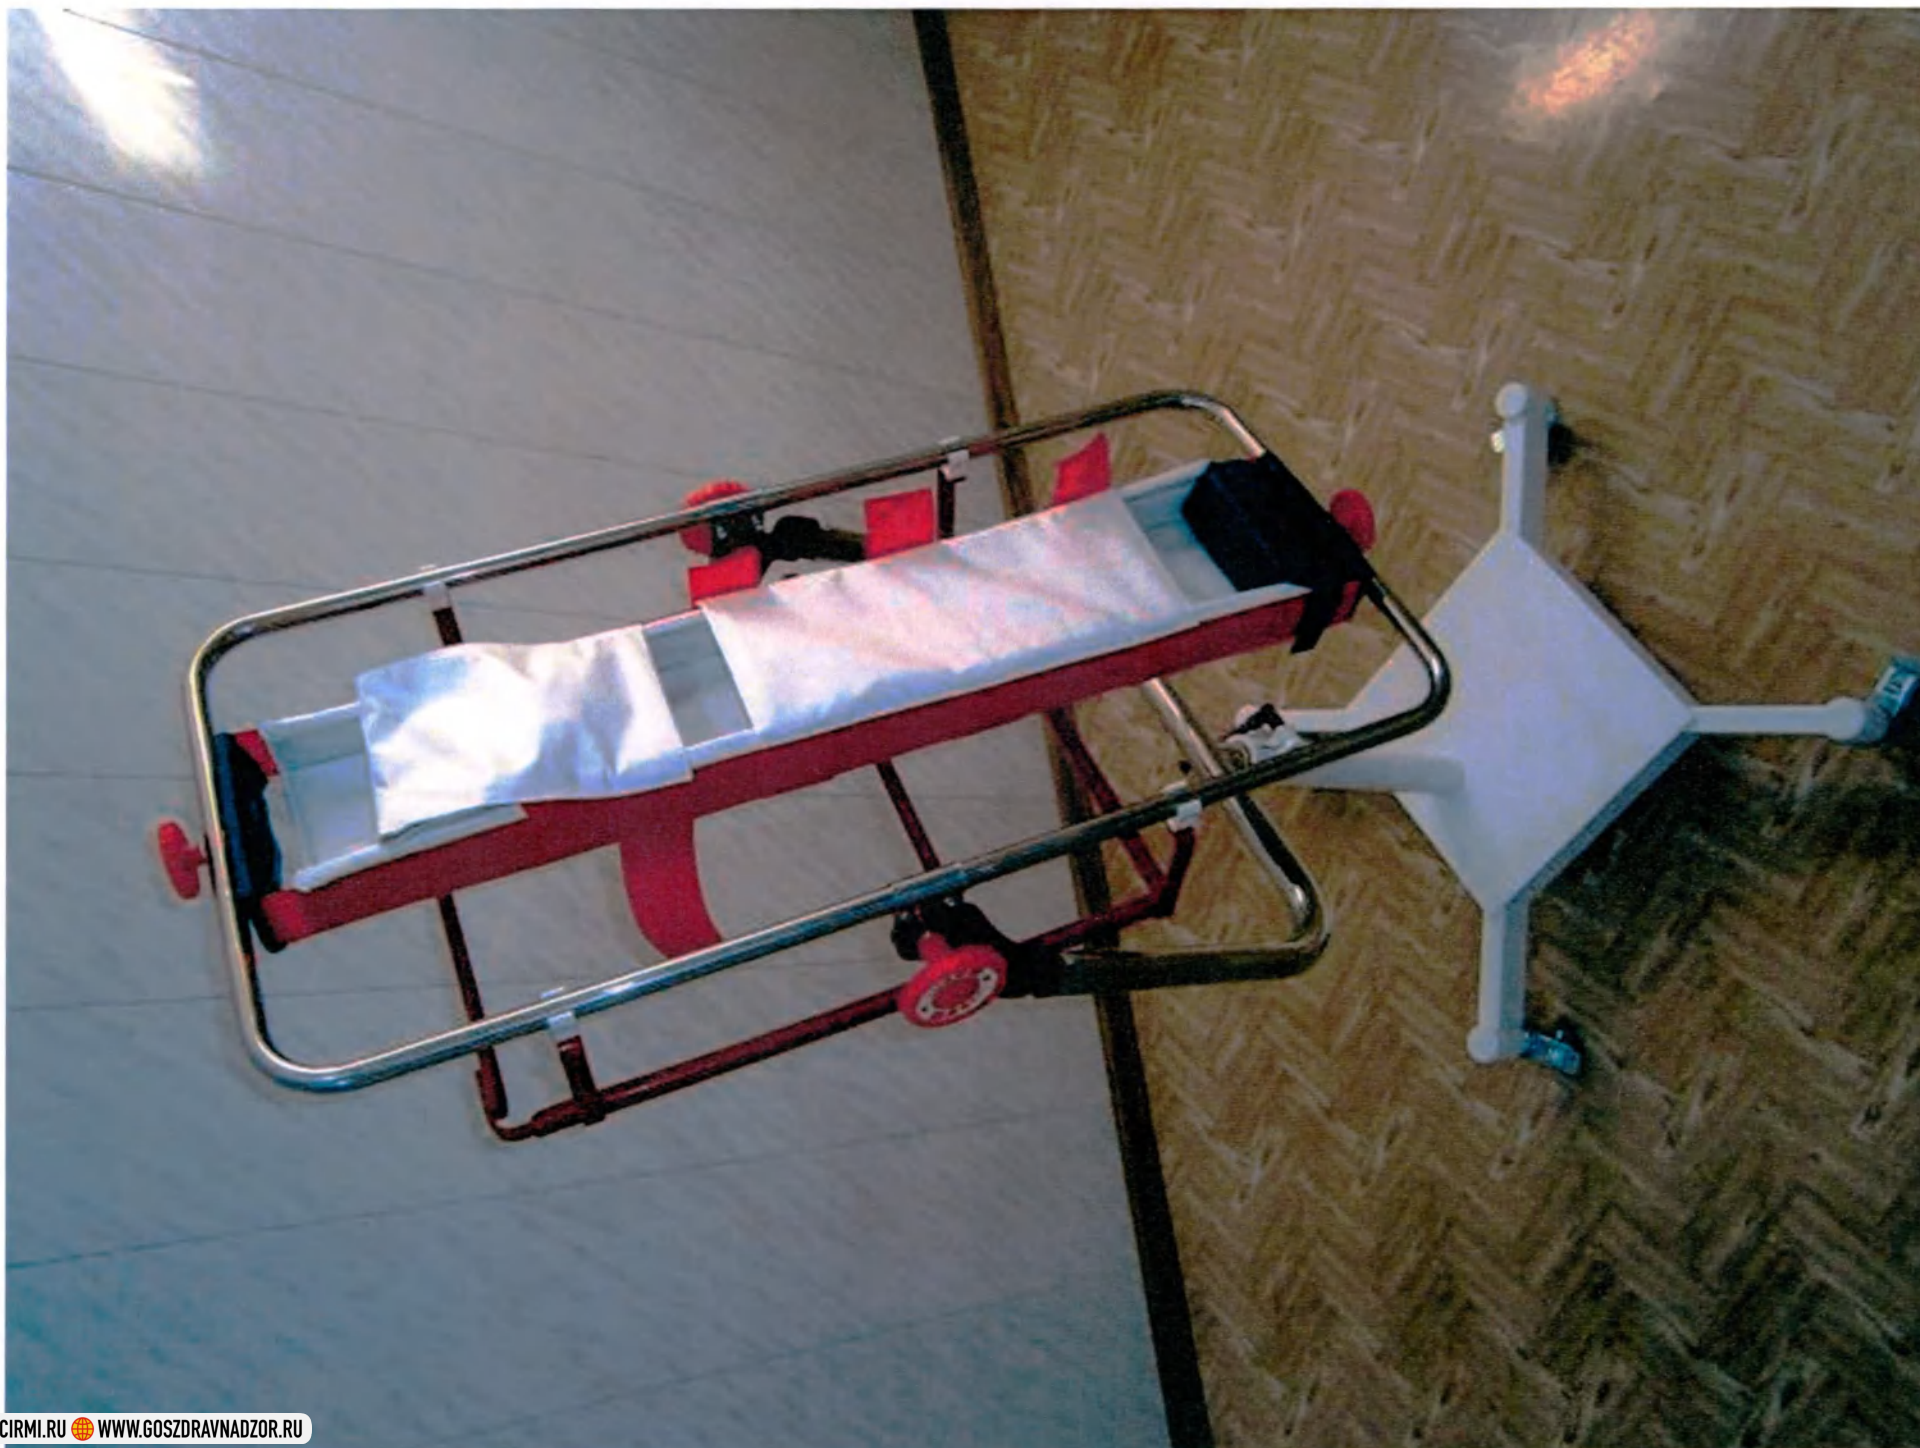


Негатоскоп "ИКСВЫЮ" по ТУ 9441-023-74487176-2011, производства ООО «ДИКСИОН», Россия (РУ ФСР 2011/11086)
(исполнения 01, 02, 03)




Негатоскопы "РЕНЕКС НЦП-1", "РЕНЕКС НЦП-2", "РЕНЕКС НЦП-4" по ТУ 9442-008-01416381-2002, ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия (РУФСР 2010/07792) (исполнения 01, 02, 03)

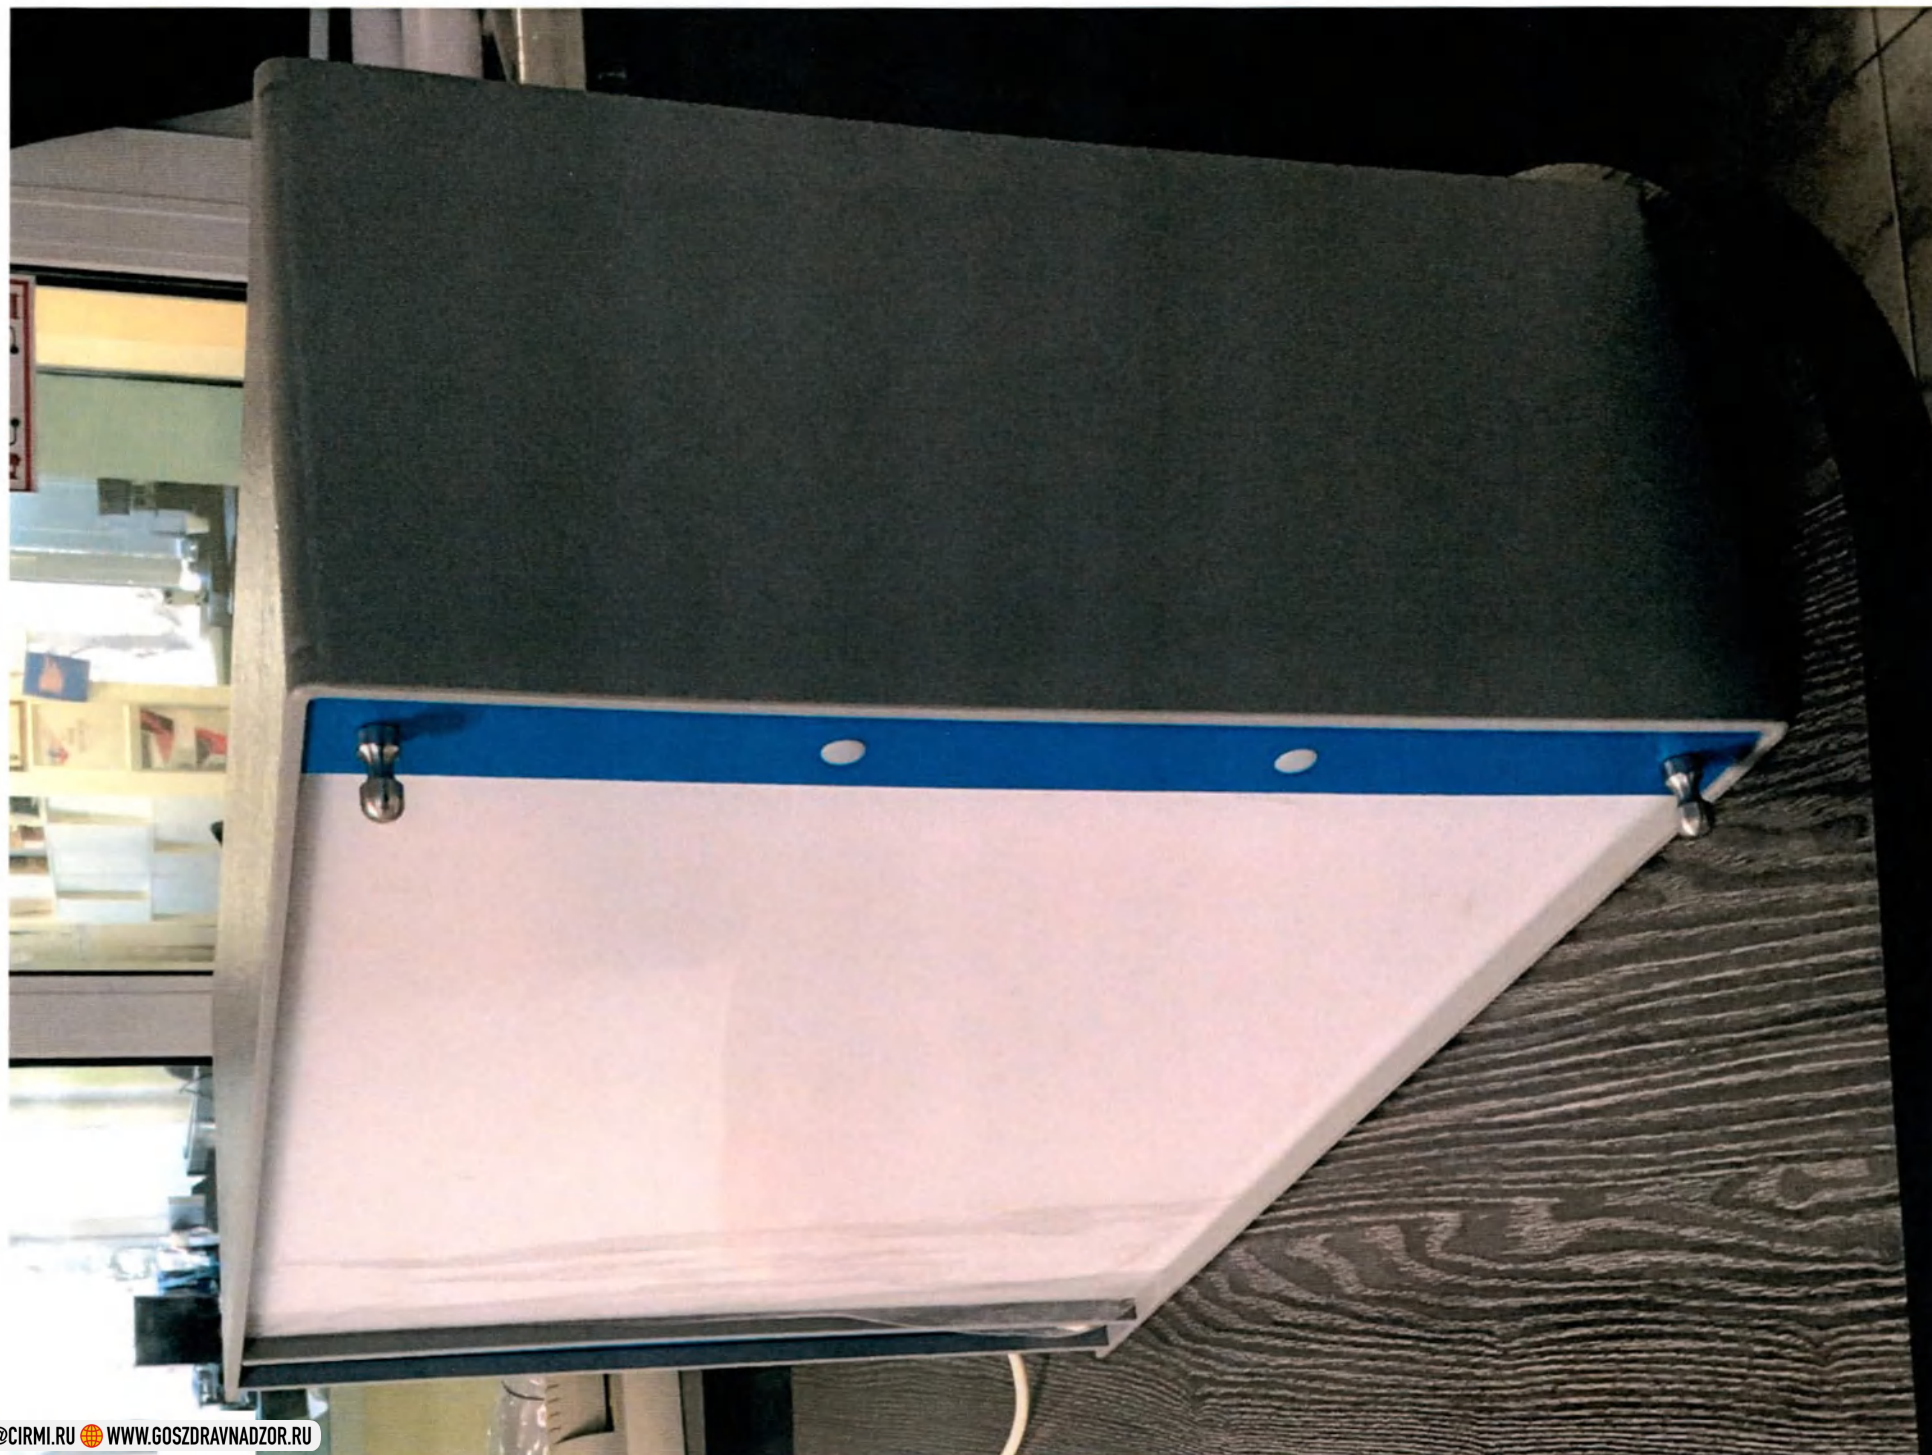


Негатоскопы диагностические светодиодные по ТУ 32.50.50-014-17459079-2019 в следующих исполнениях НС1-02, НС2-02, НС2-03, производства АО «ПОНИ» (РУ № РЗН 2020/9942) (исполнения 01, 02, 03)

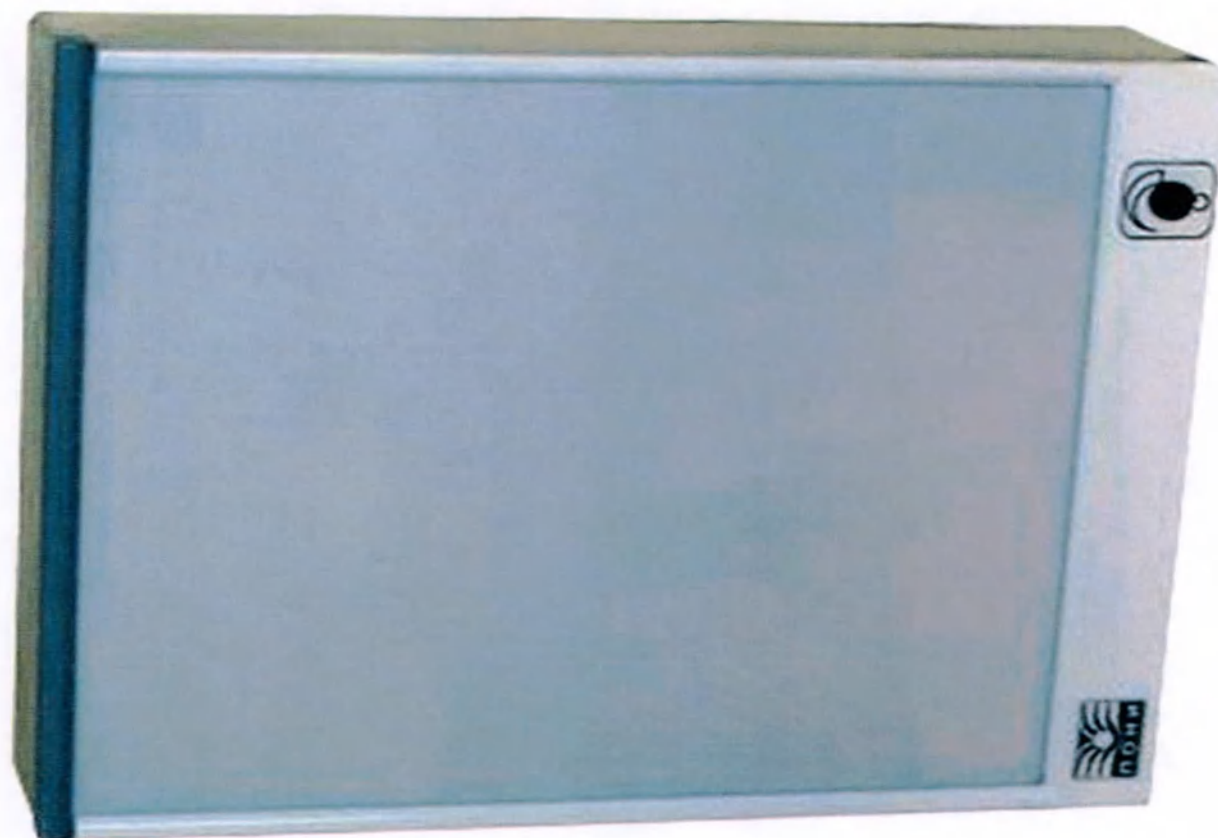

Переносной цифровой приемник рентгеновского изображения Pixium 3543 EZ, производства Thales Electron Devices S.A., Франция (исполнения 01, 02, 03)

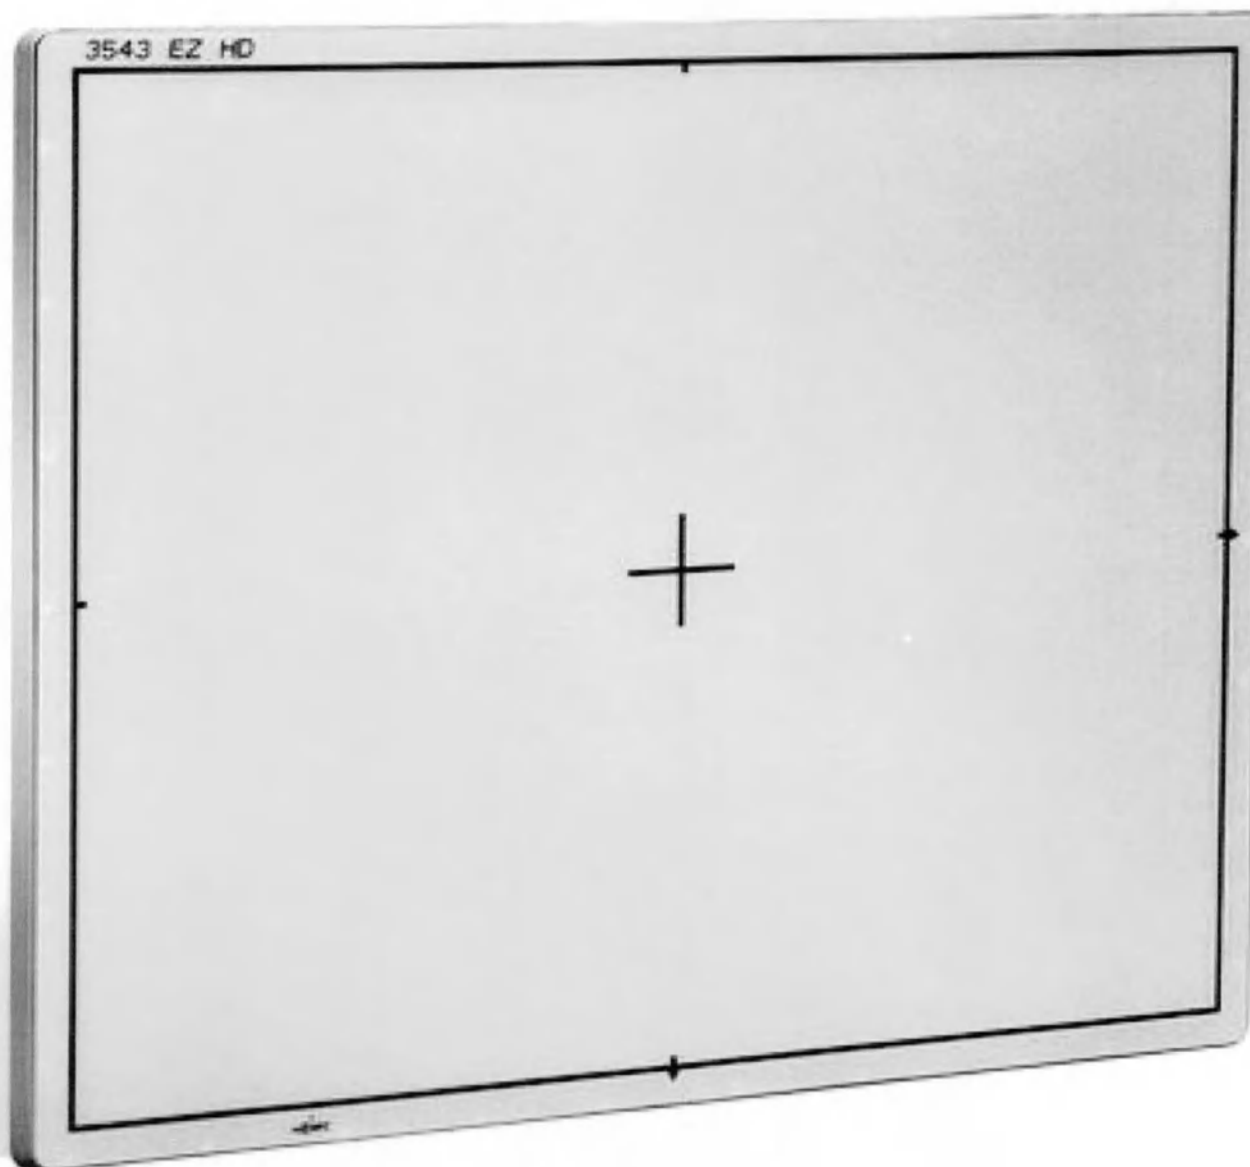

Переносной цифровой приемник рентгеновского изображения FDXA3543RPW, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd., Япония (исполнения 01, 02, 03)

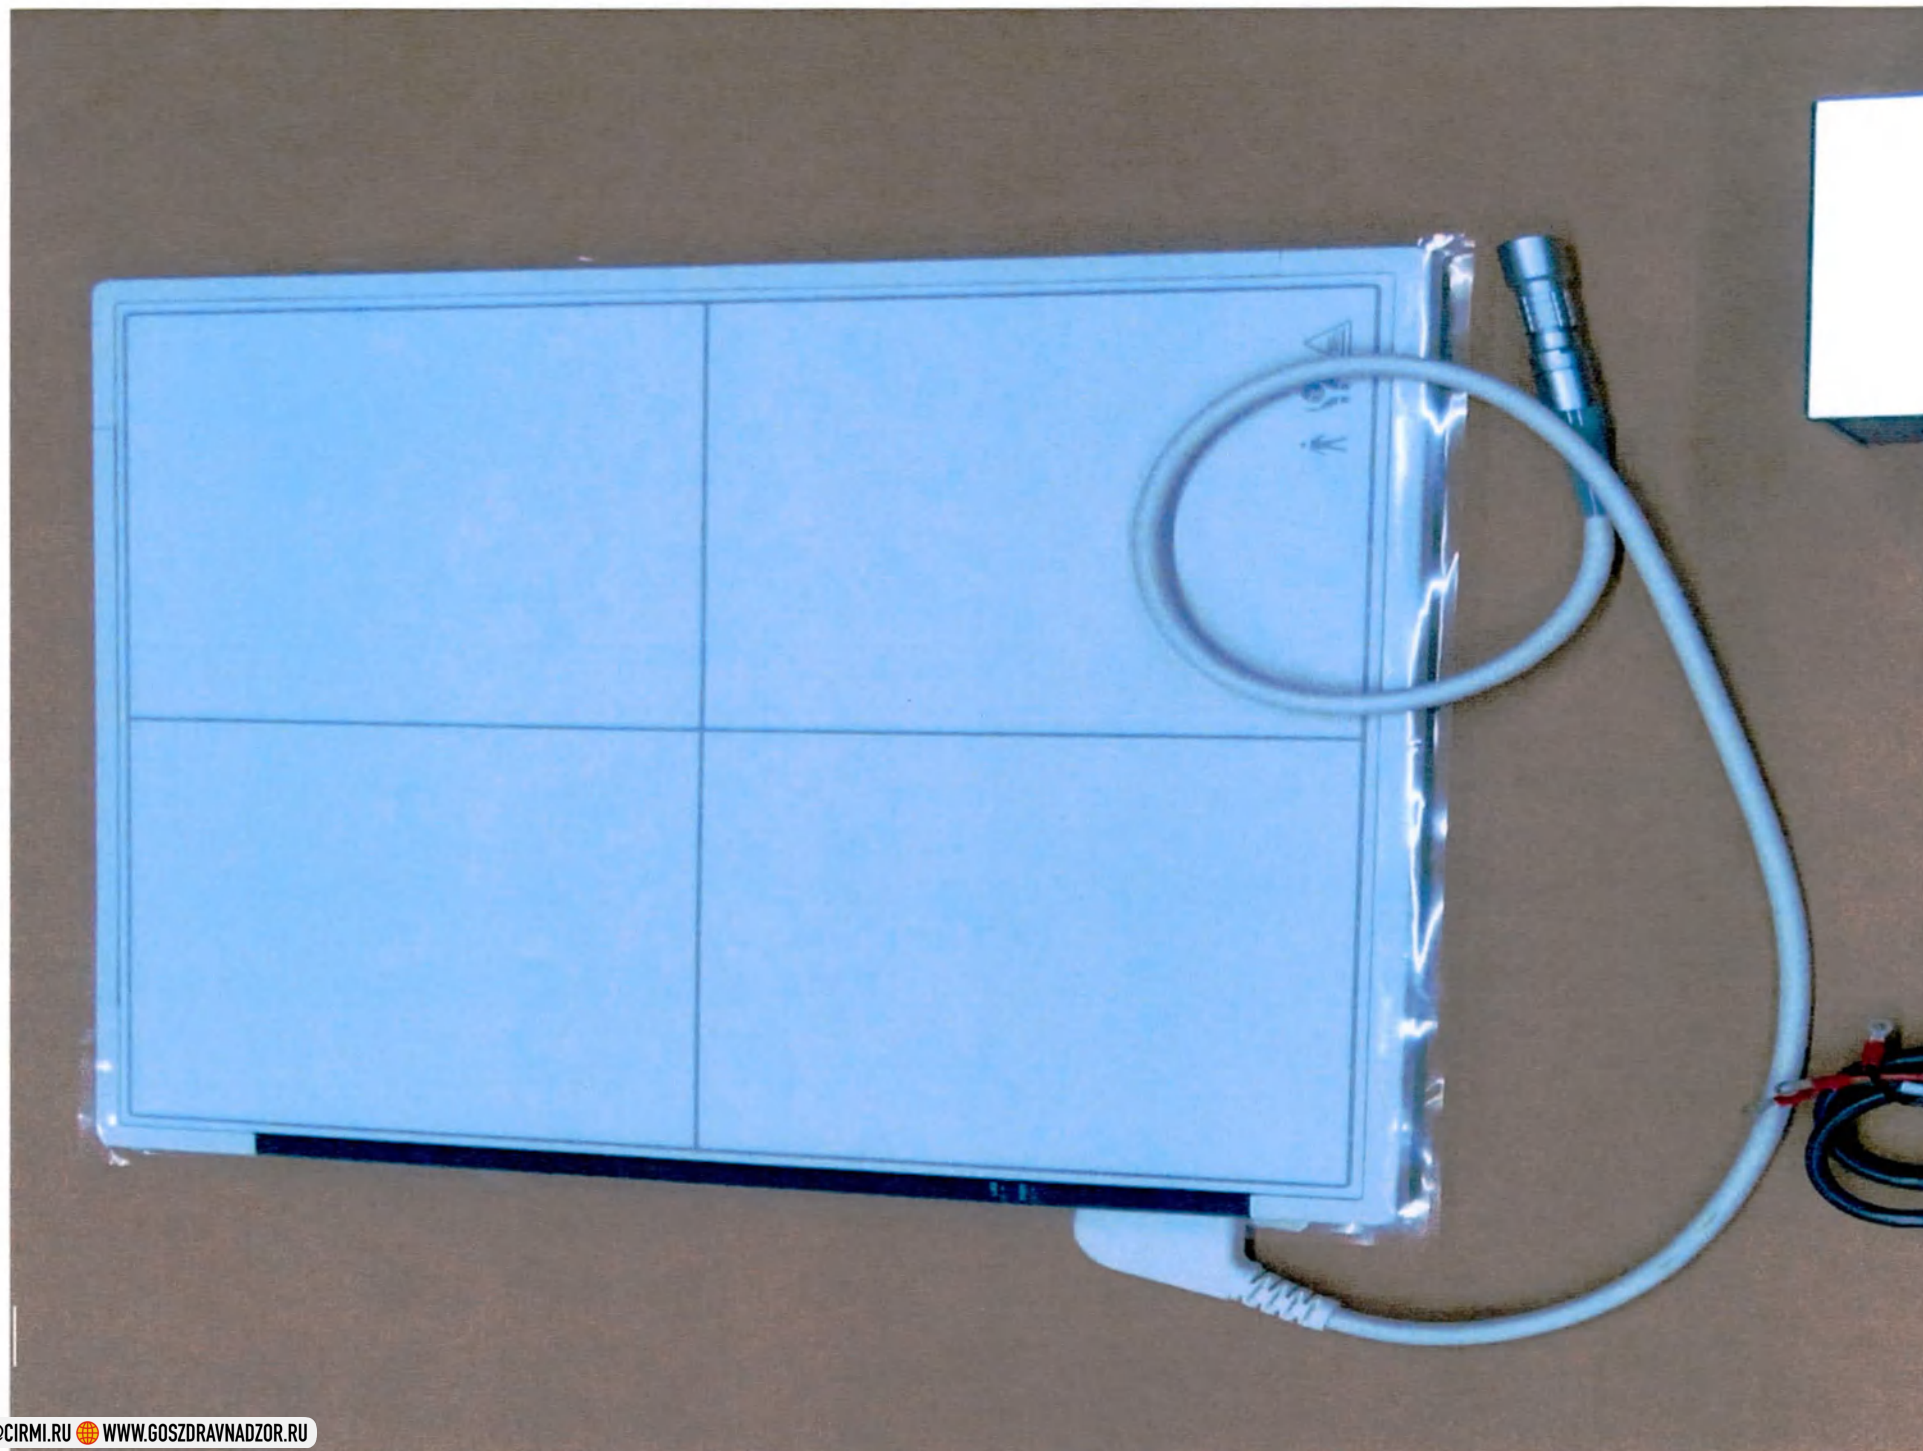


Двойная педаль управления, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнения 01, 02)



Двойная педаль управления, производства ООО «Севкавrentген-Д», Россия (исполнение 03)





Опора под ноги, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнения 01, 02)

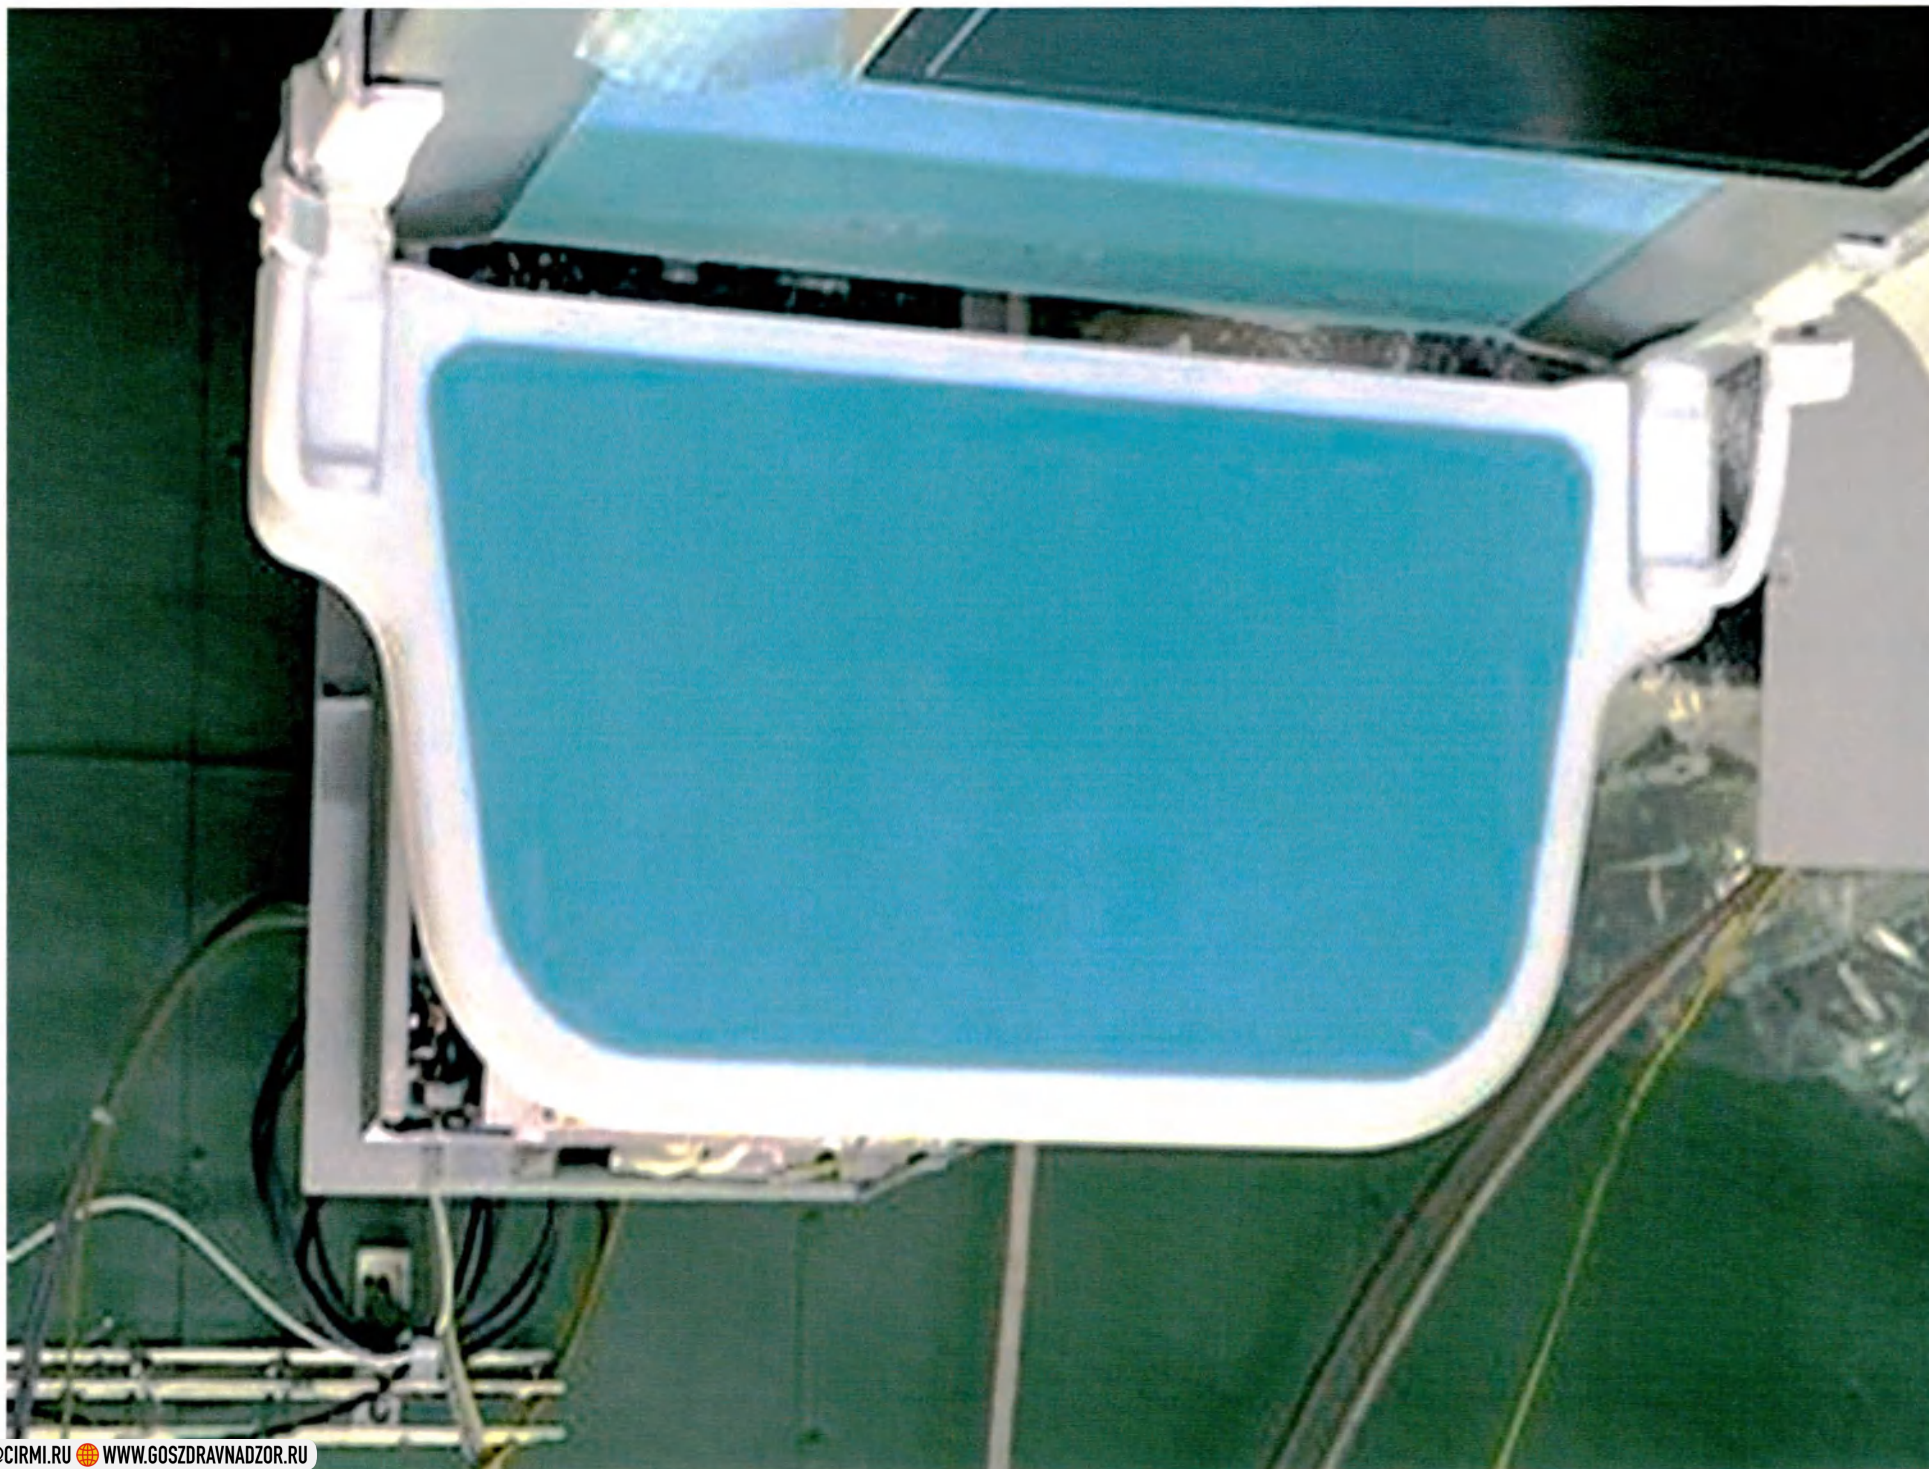


Опора под ноги, производства ООО «Севкавентген-Д», Россия (исполнение 03)




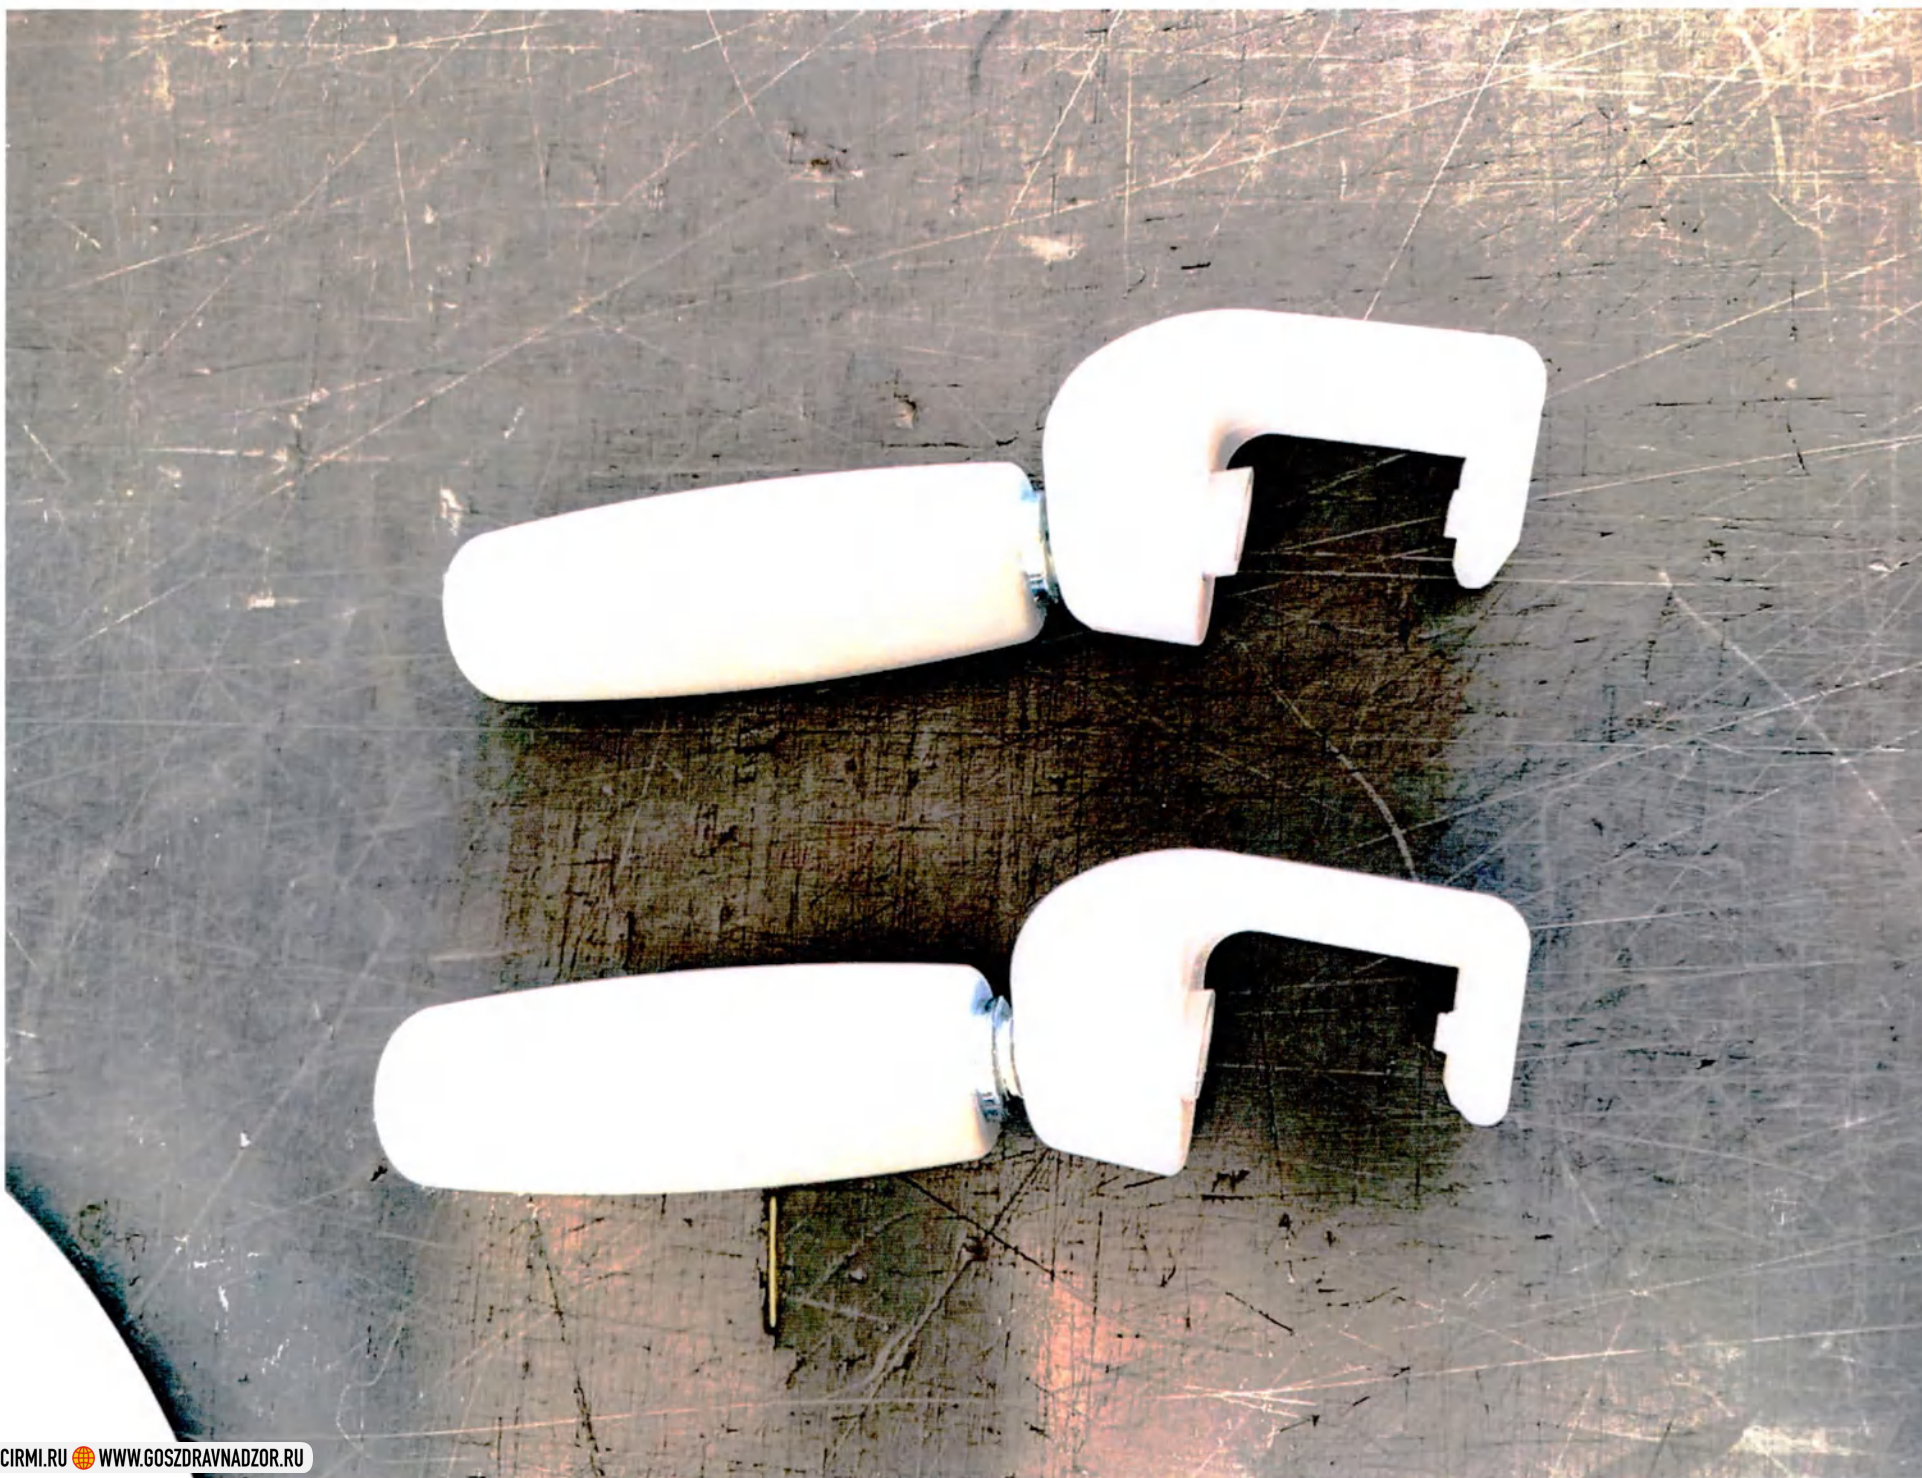

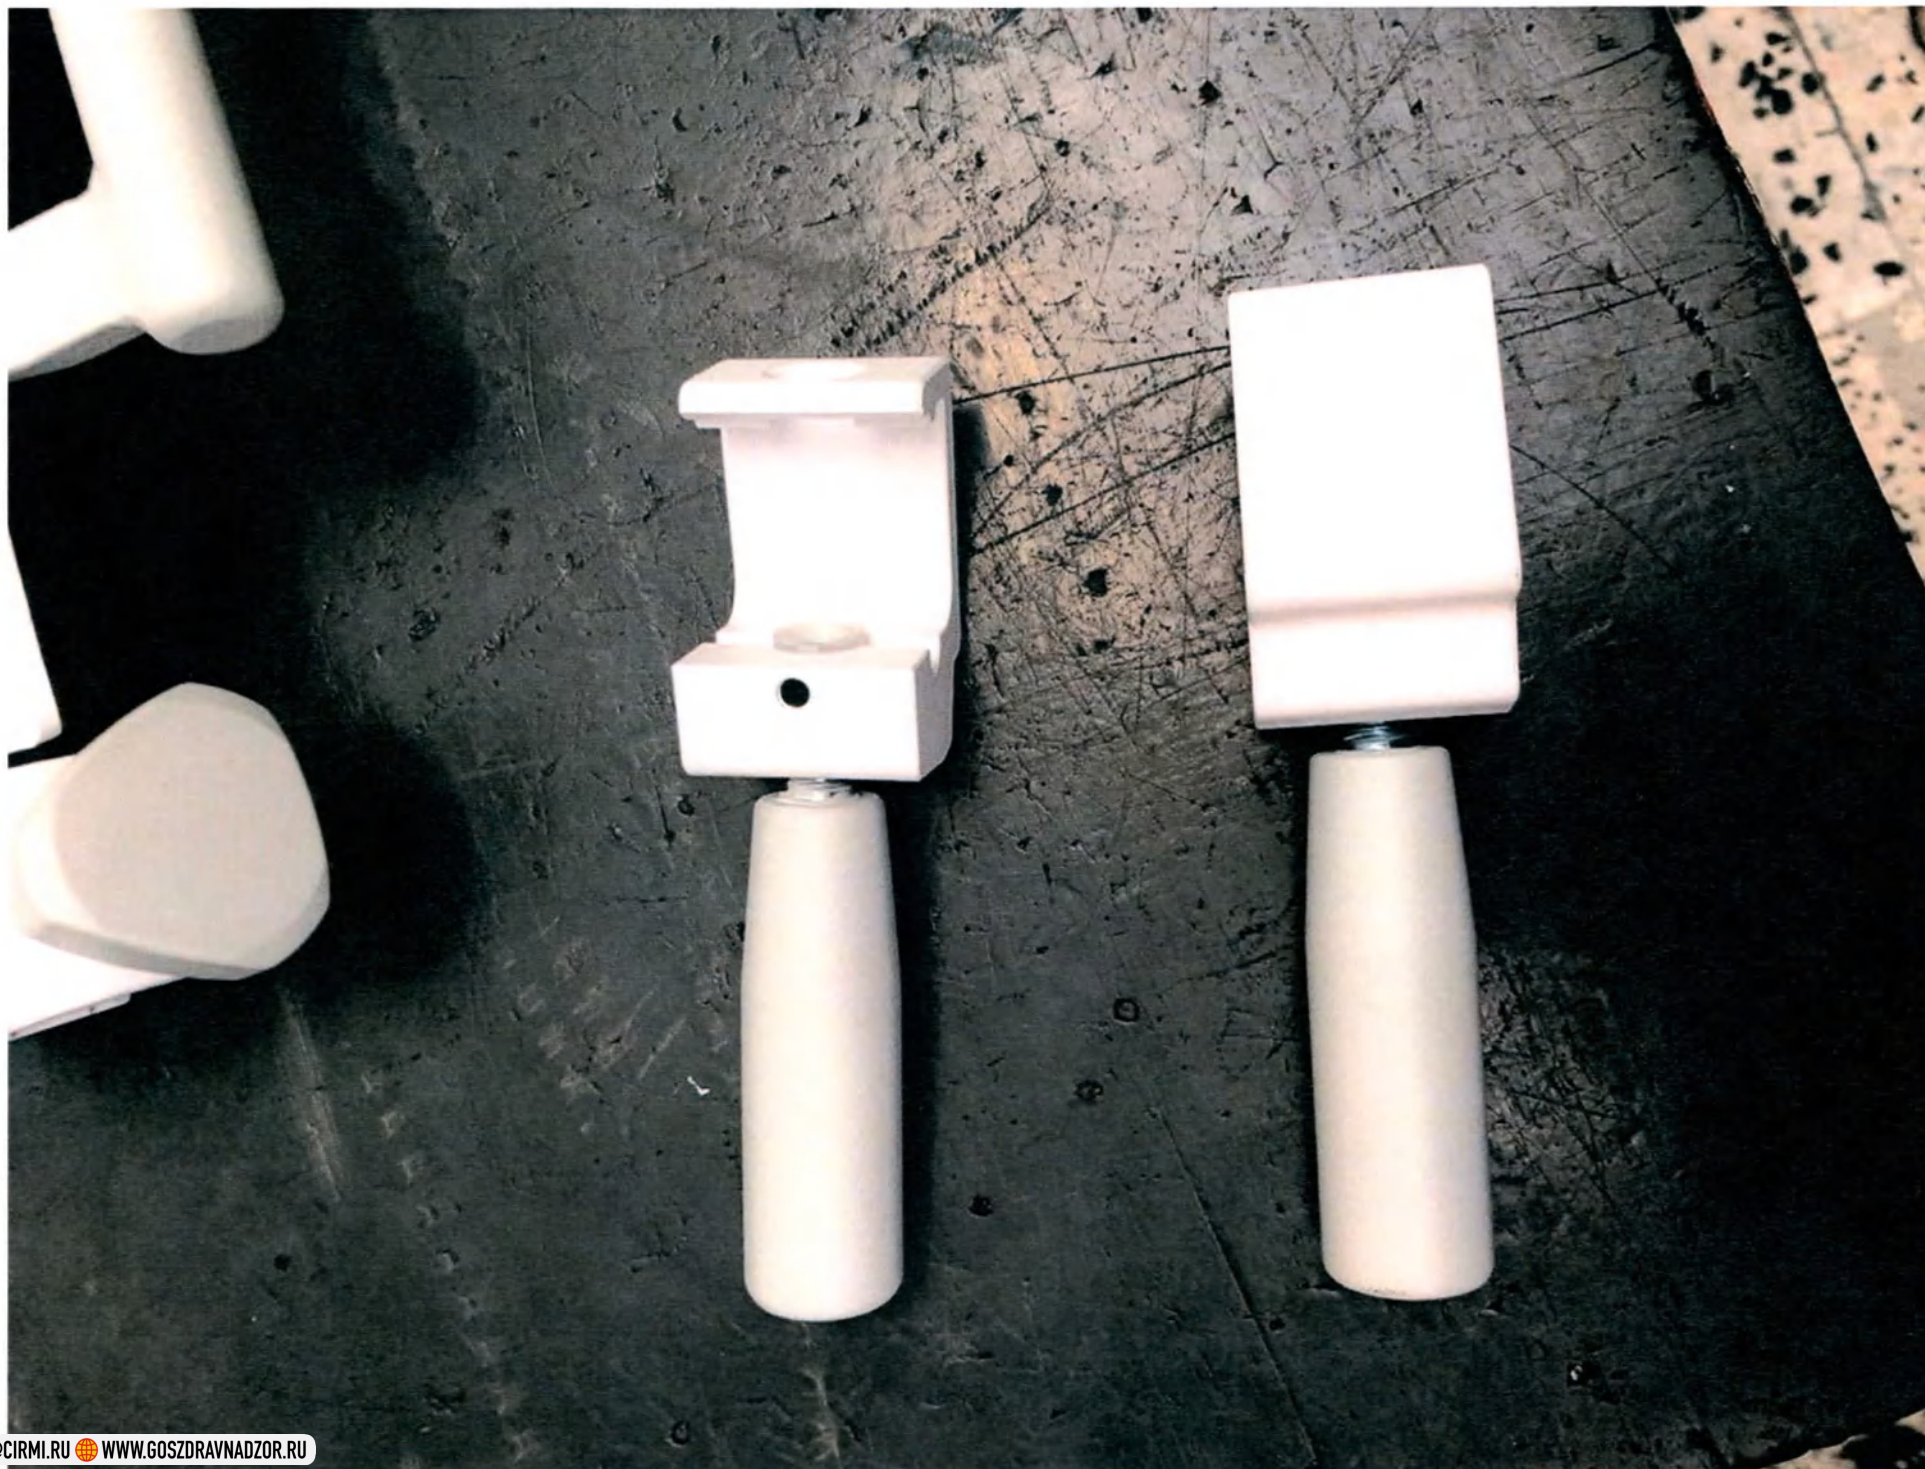


Опоры под плечи, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнения 01, 02)

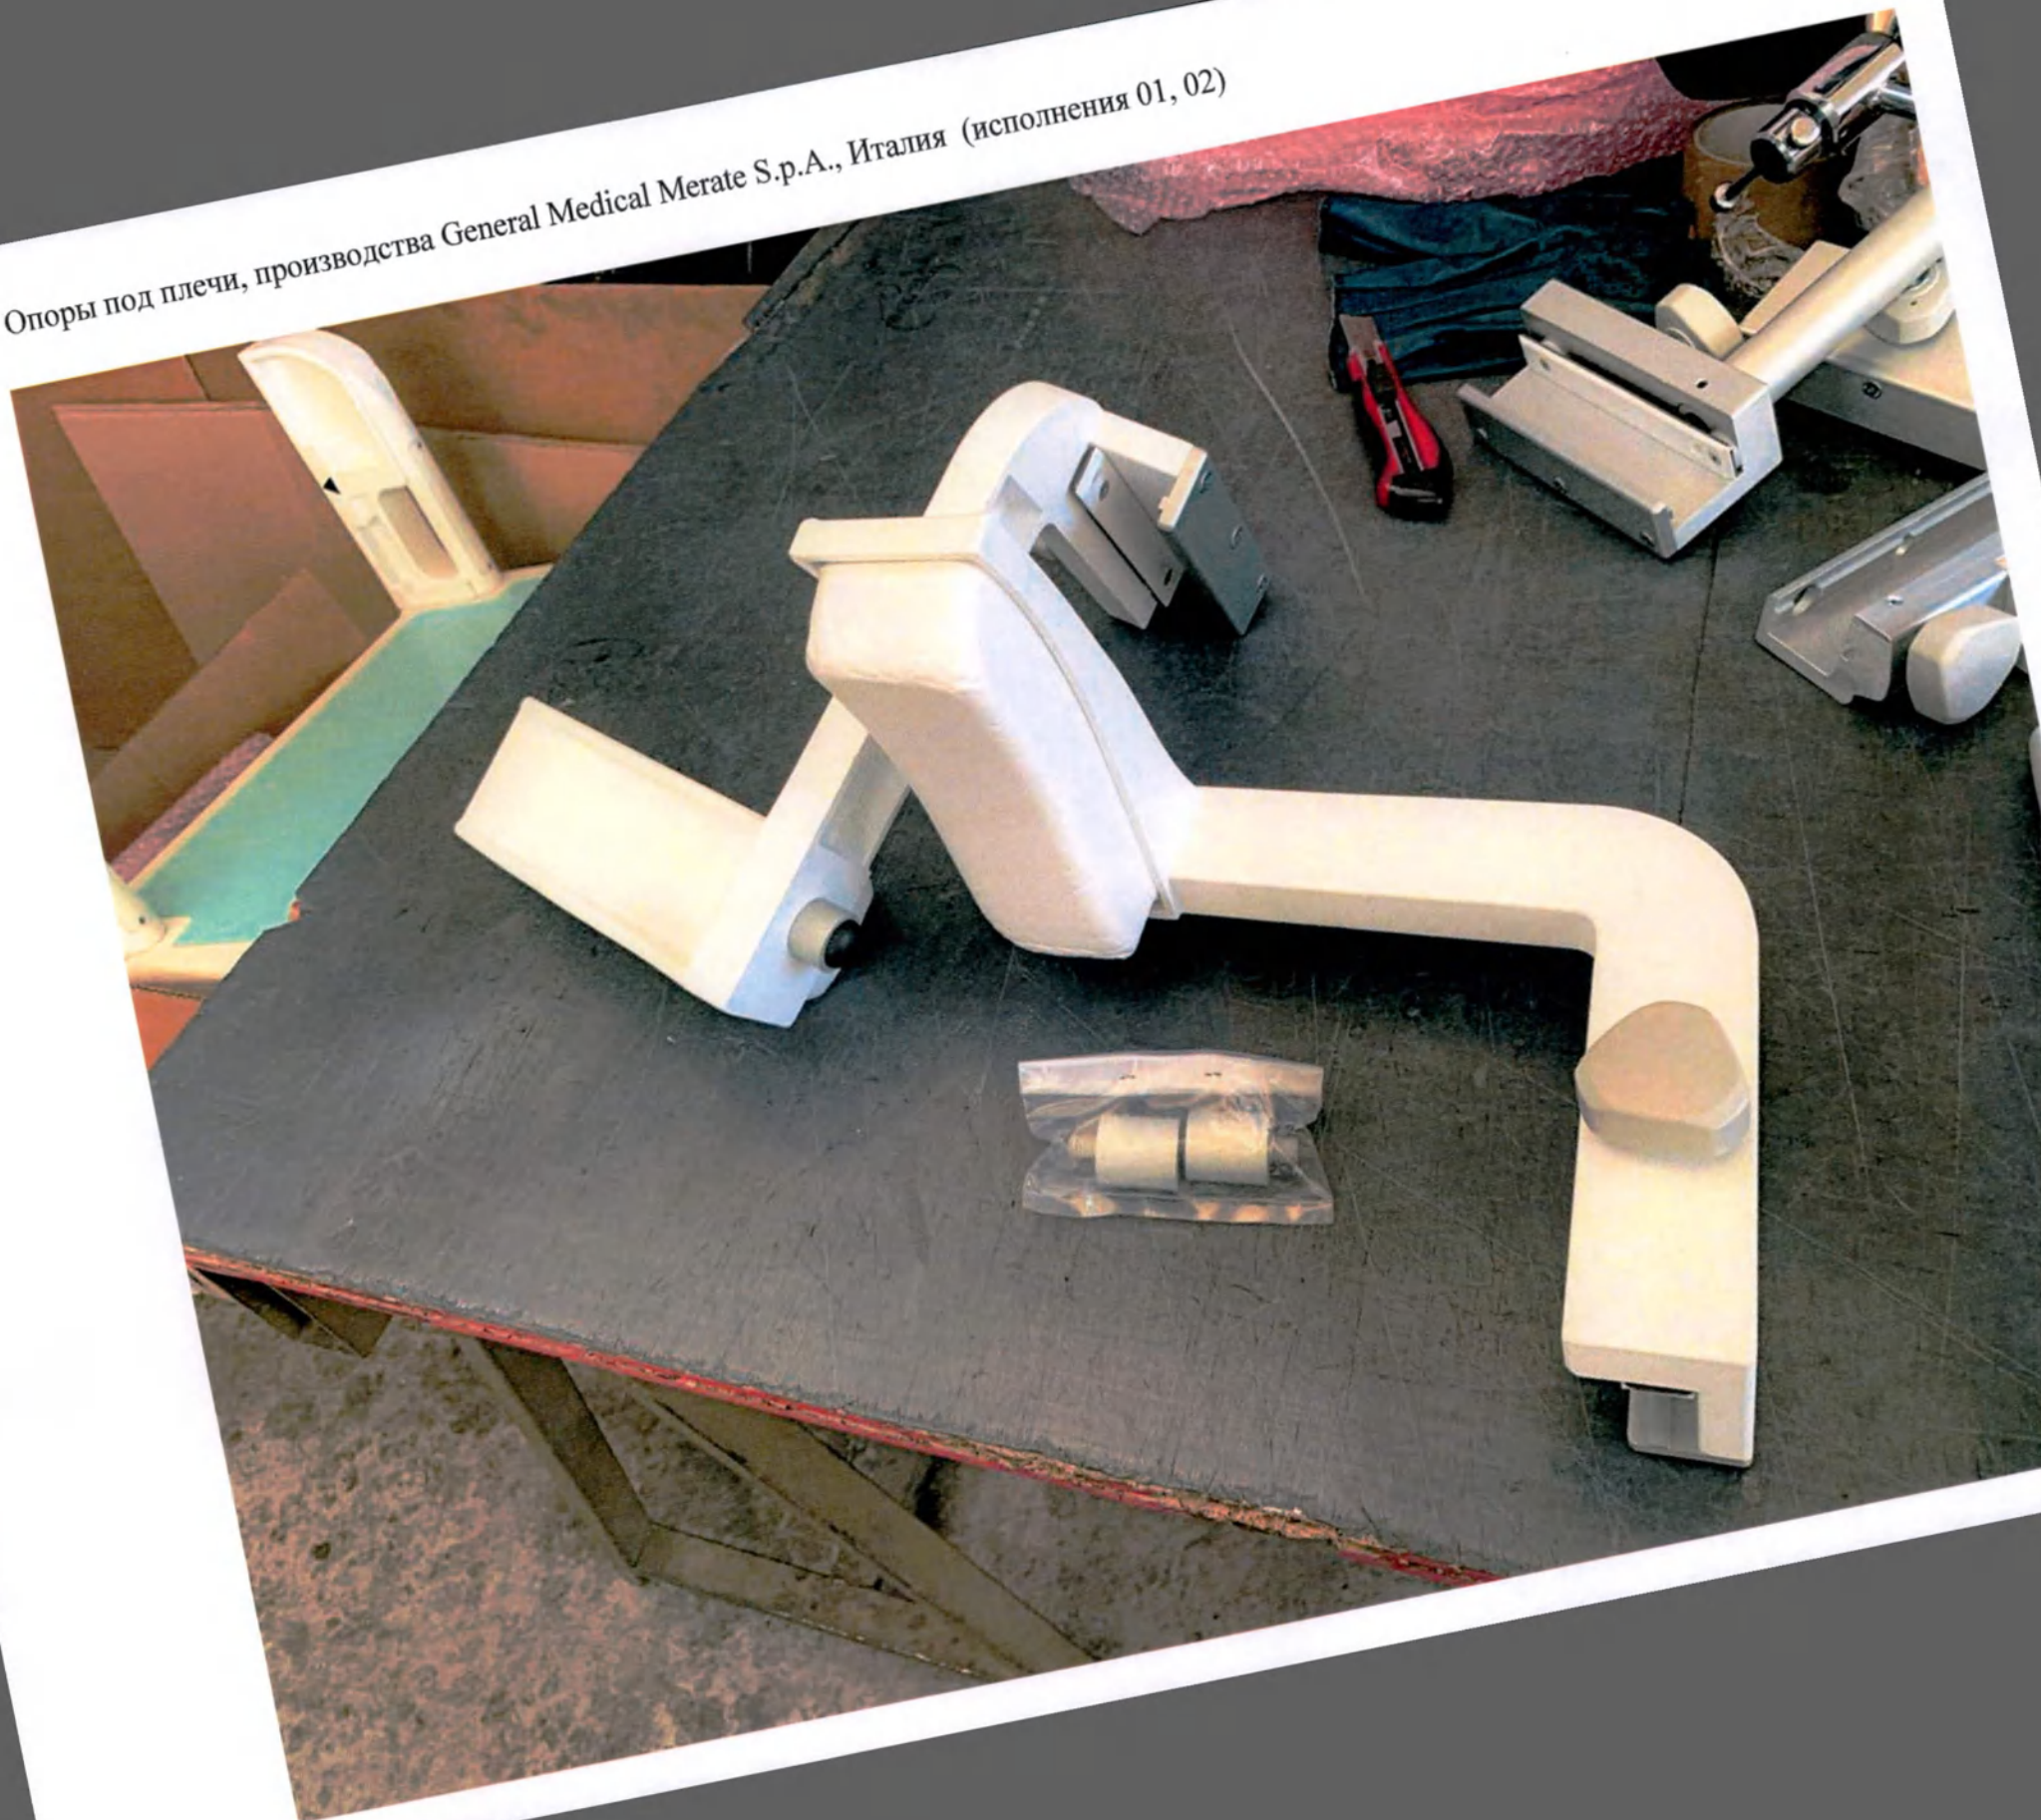


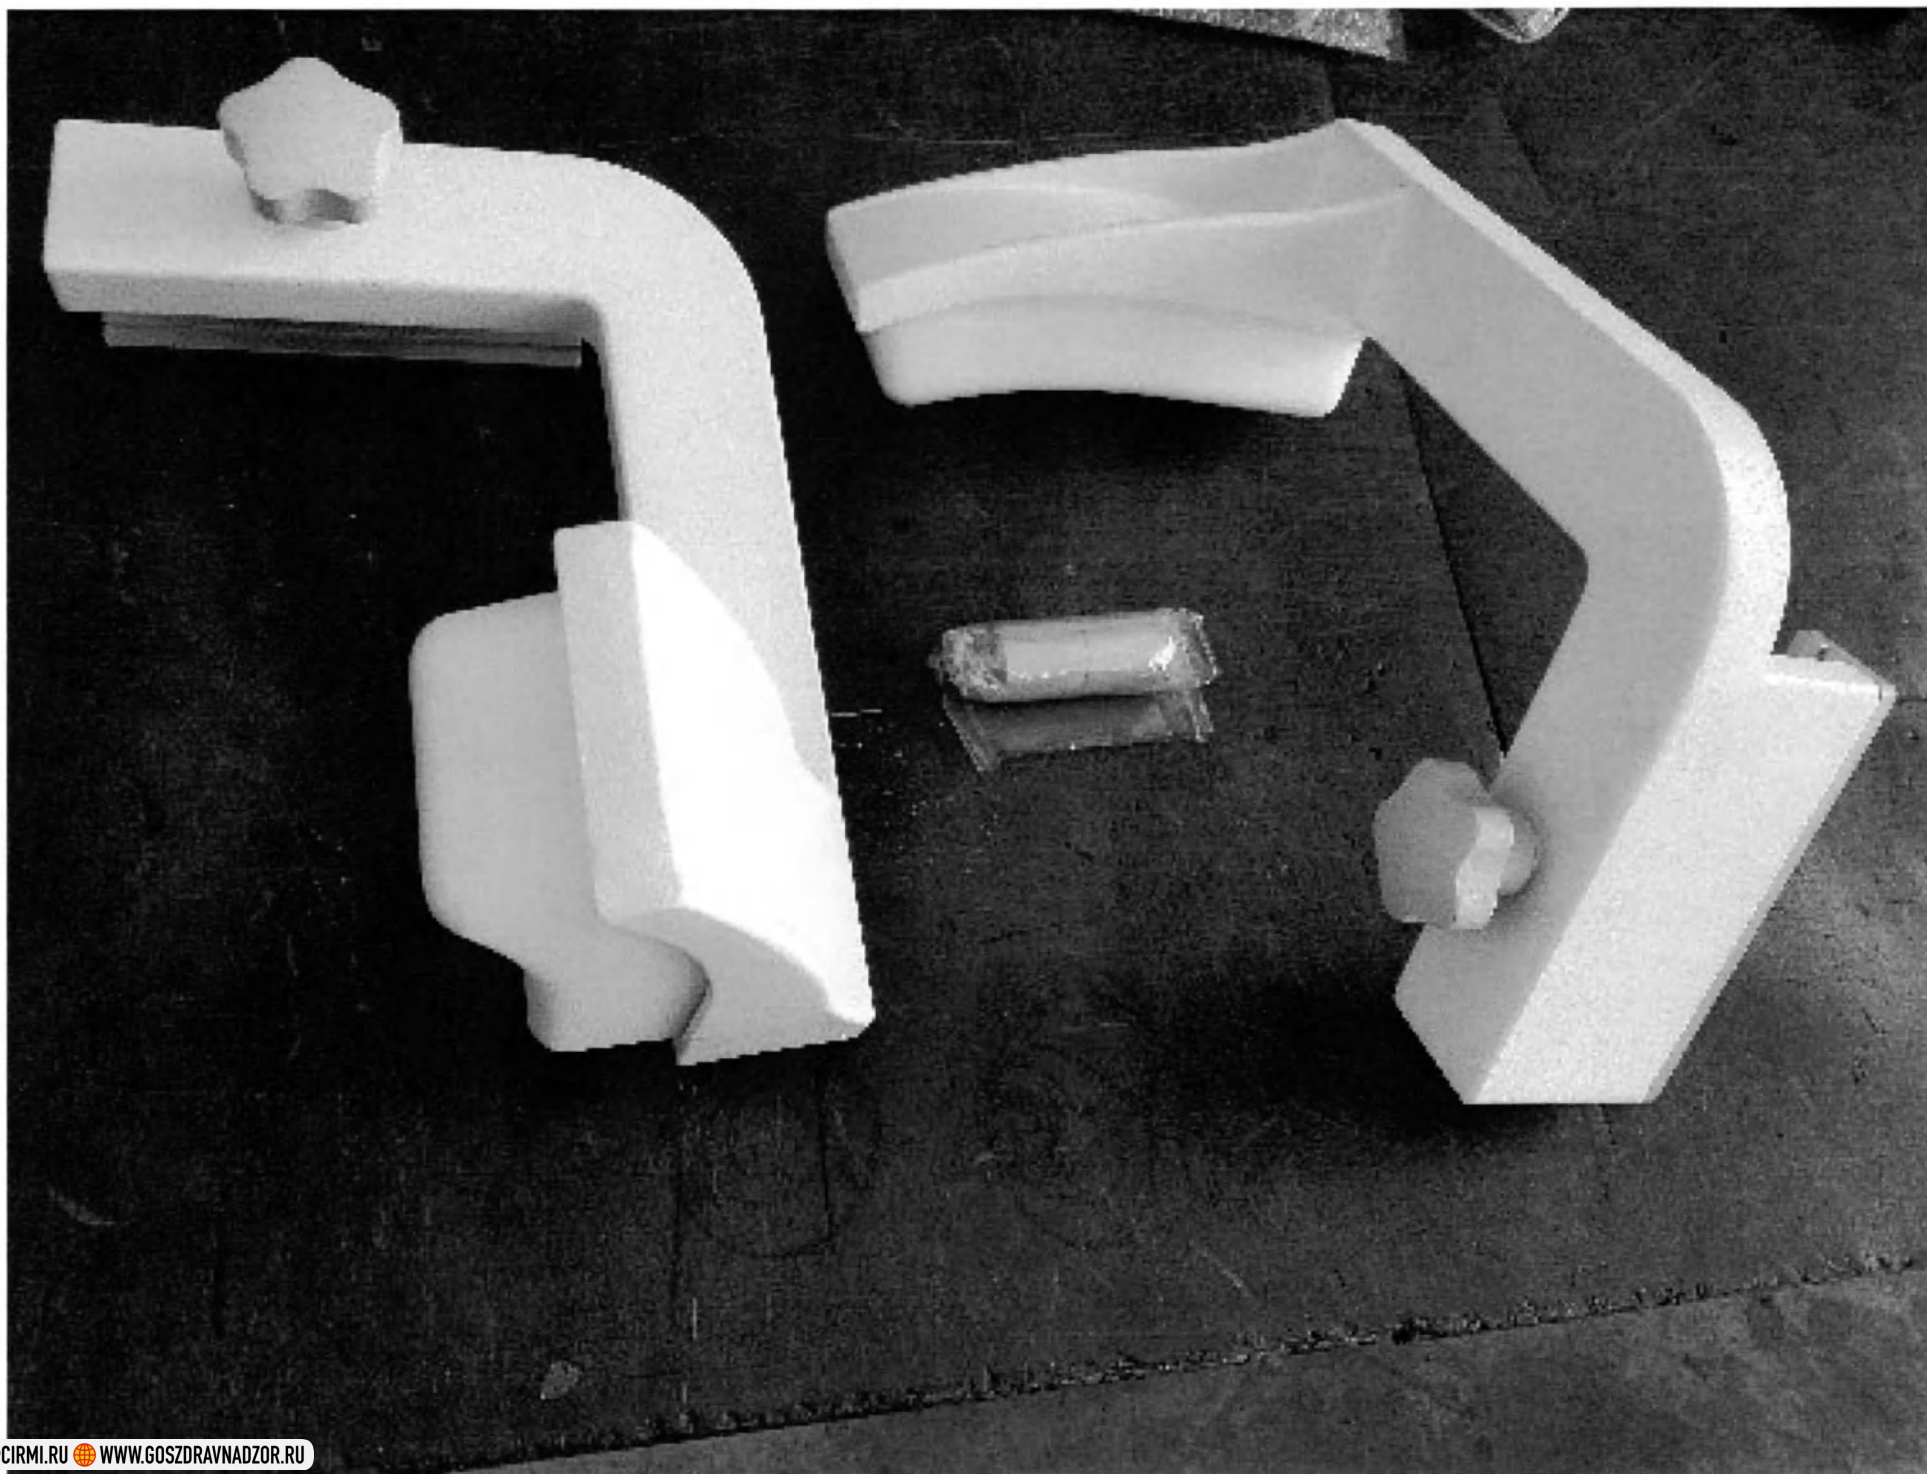

Упоры под колени, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнения 01, 02) или ООО «Севкавментген-Д», Россия (исполнение 03)

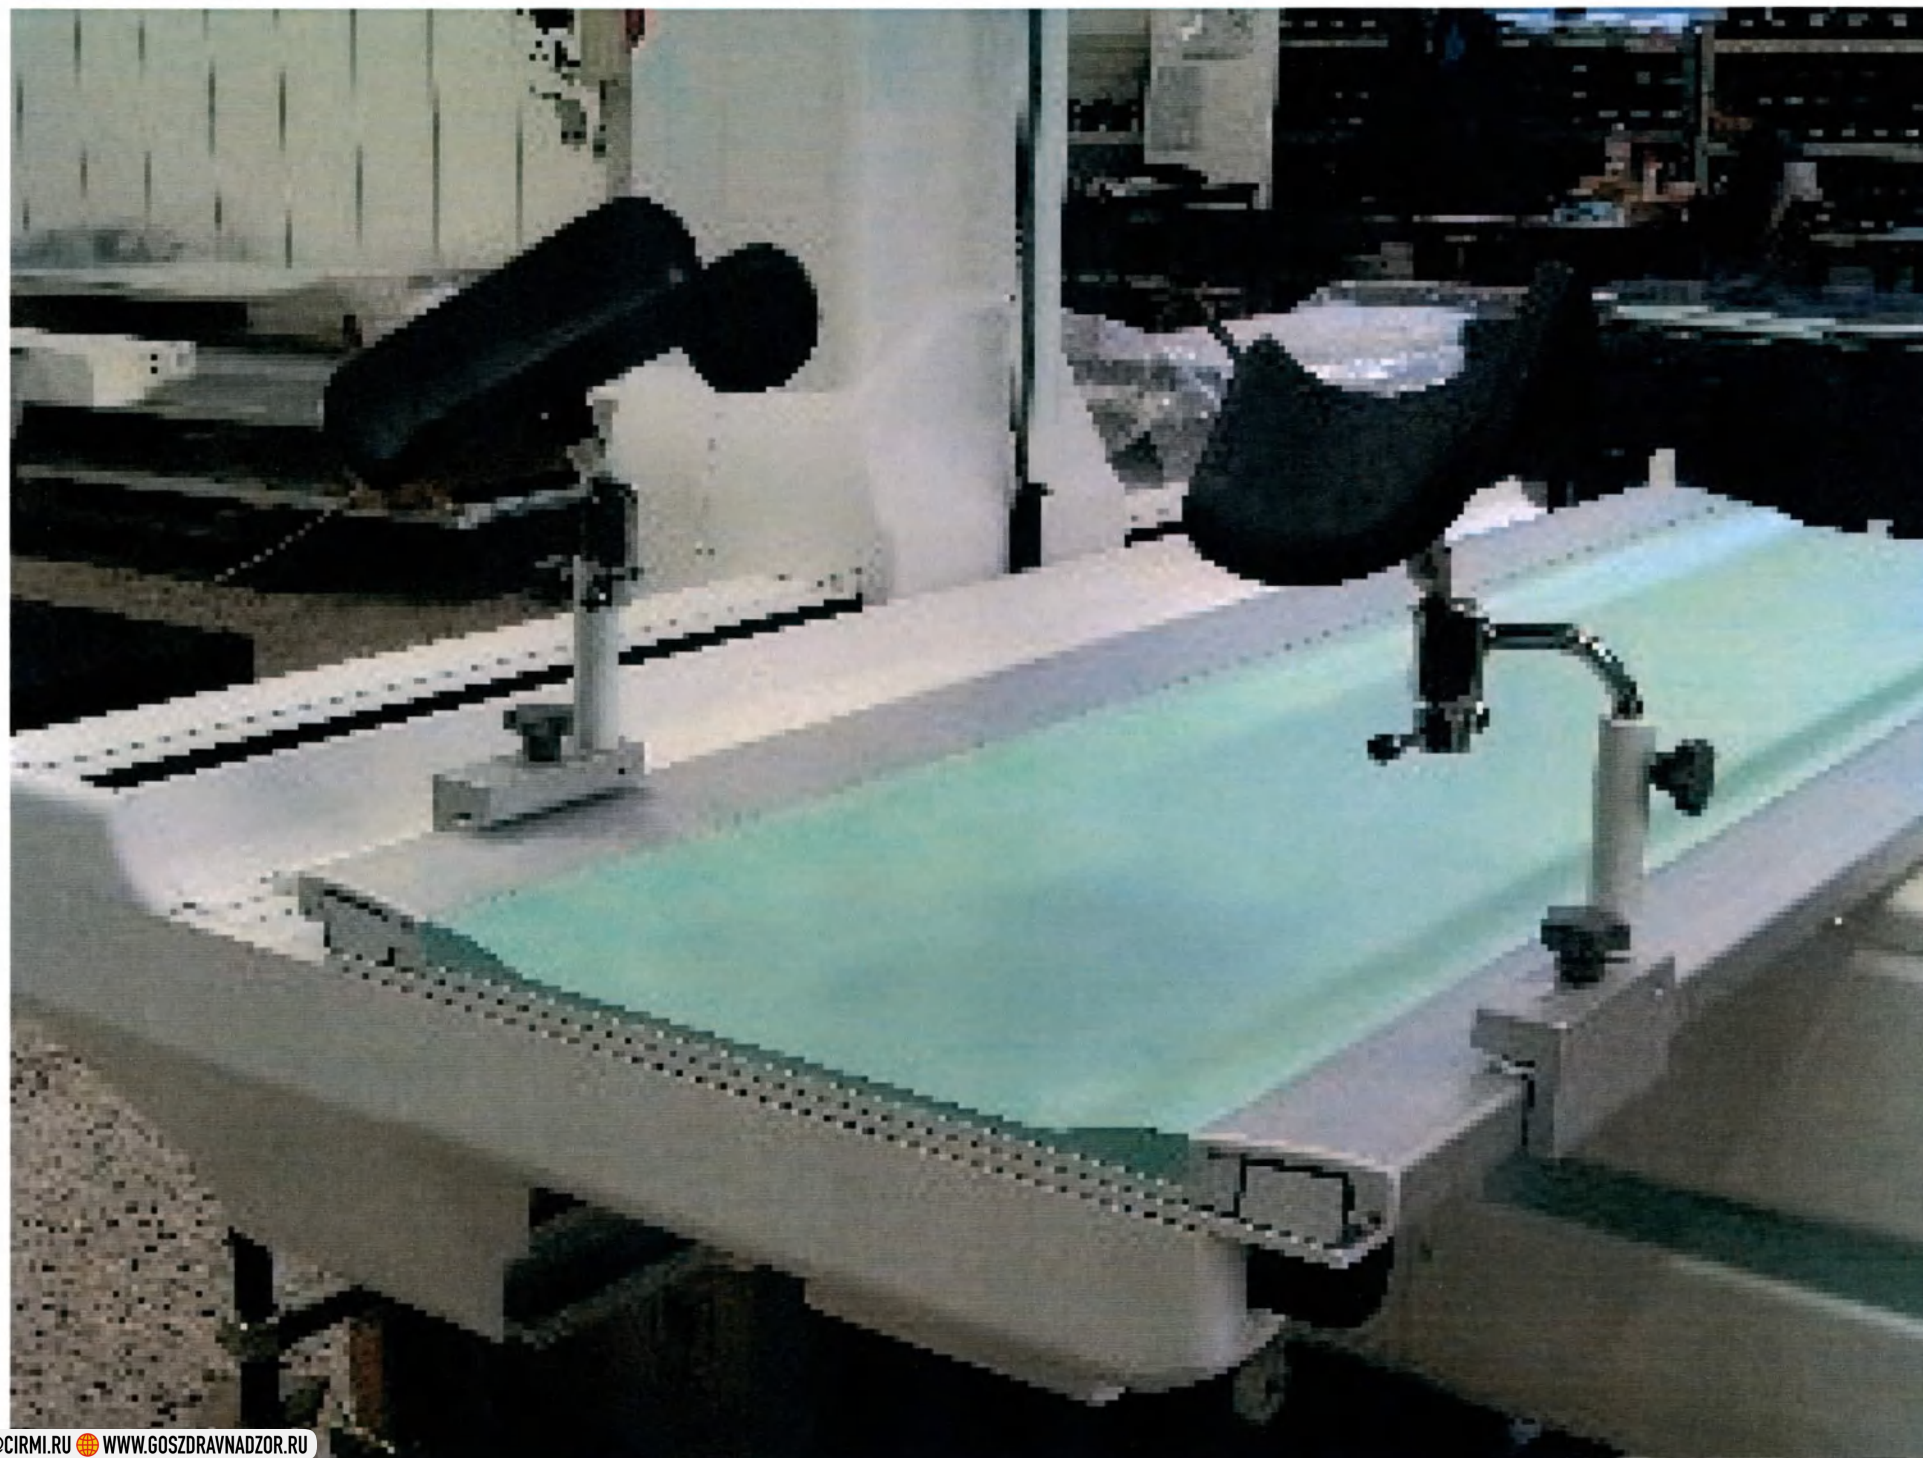


Прижимающая лента, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнения 01, 02)

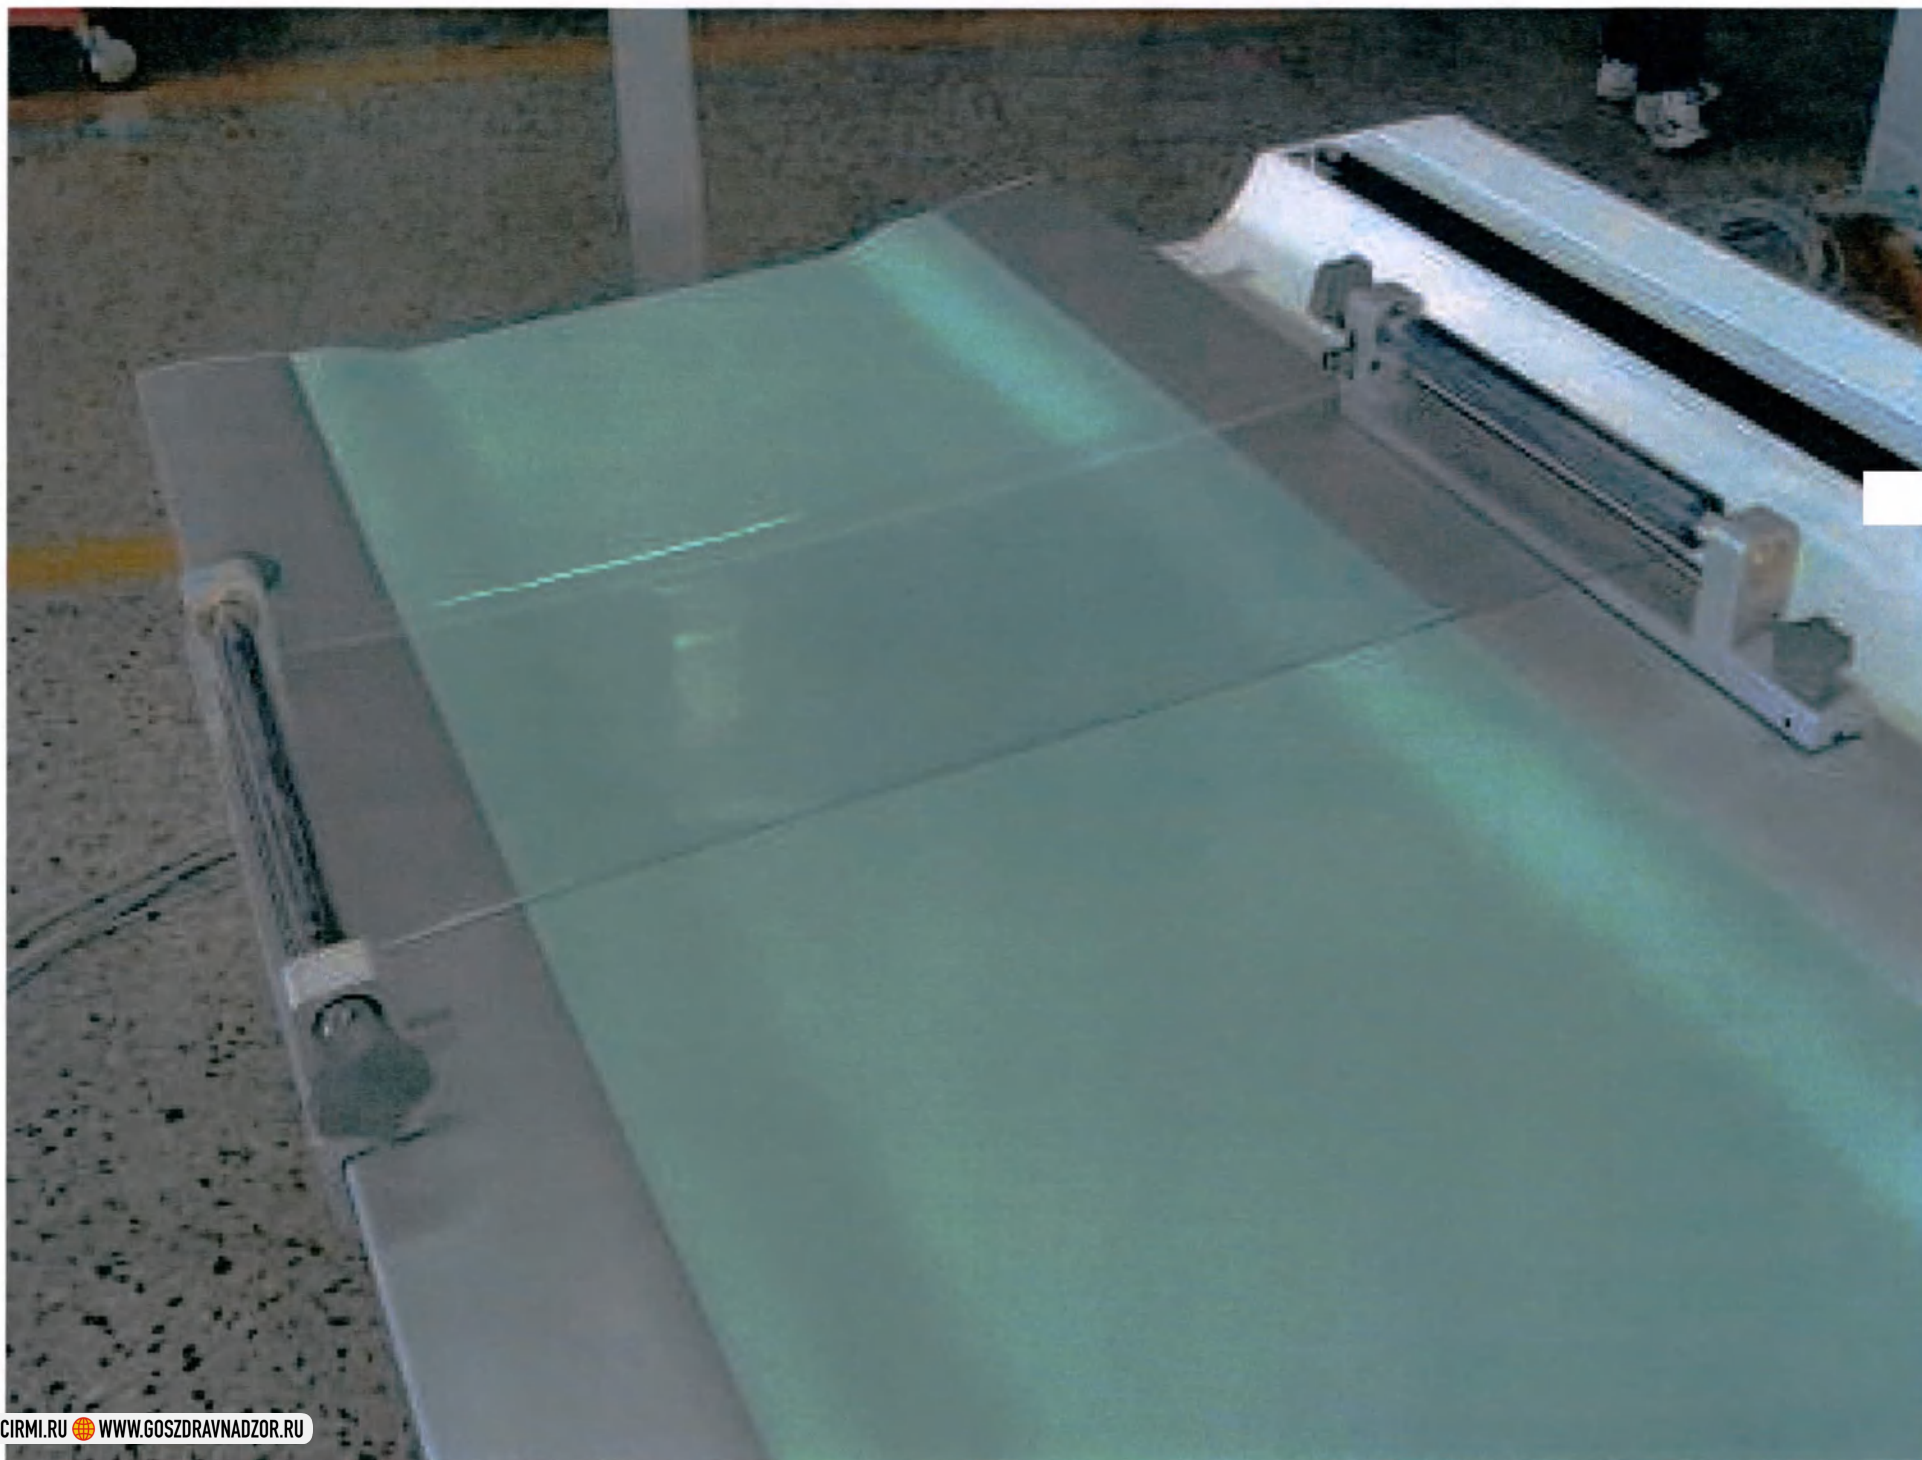


Прижимающая лента, производства ООО «Севкав рентген-Д», Россия (исполнение 03)




Линейка для функции СШИВАНИЕ, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнения 01, 02)

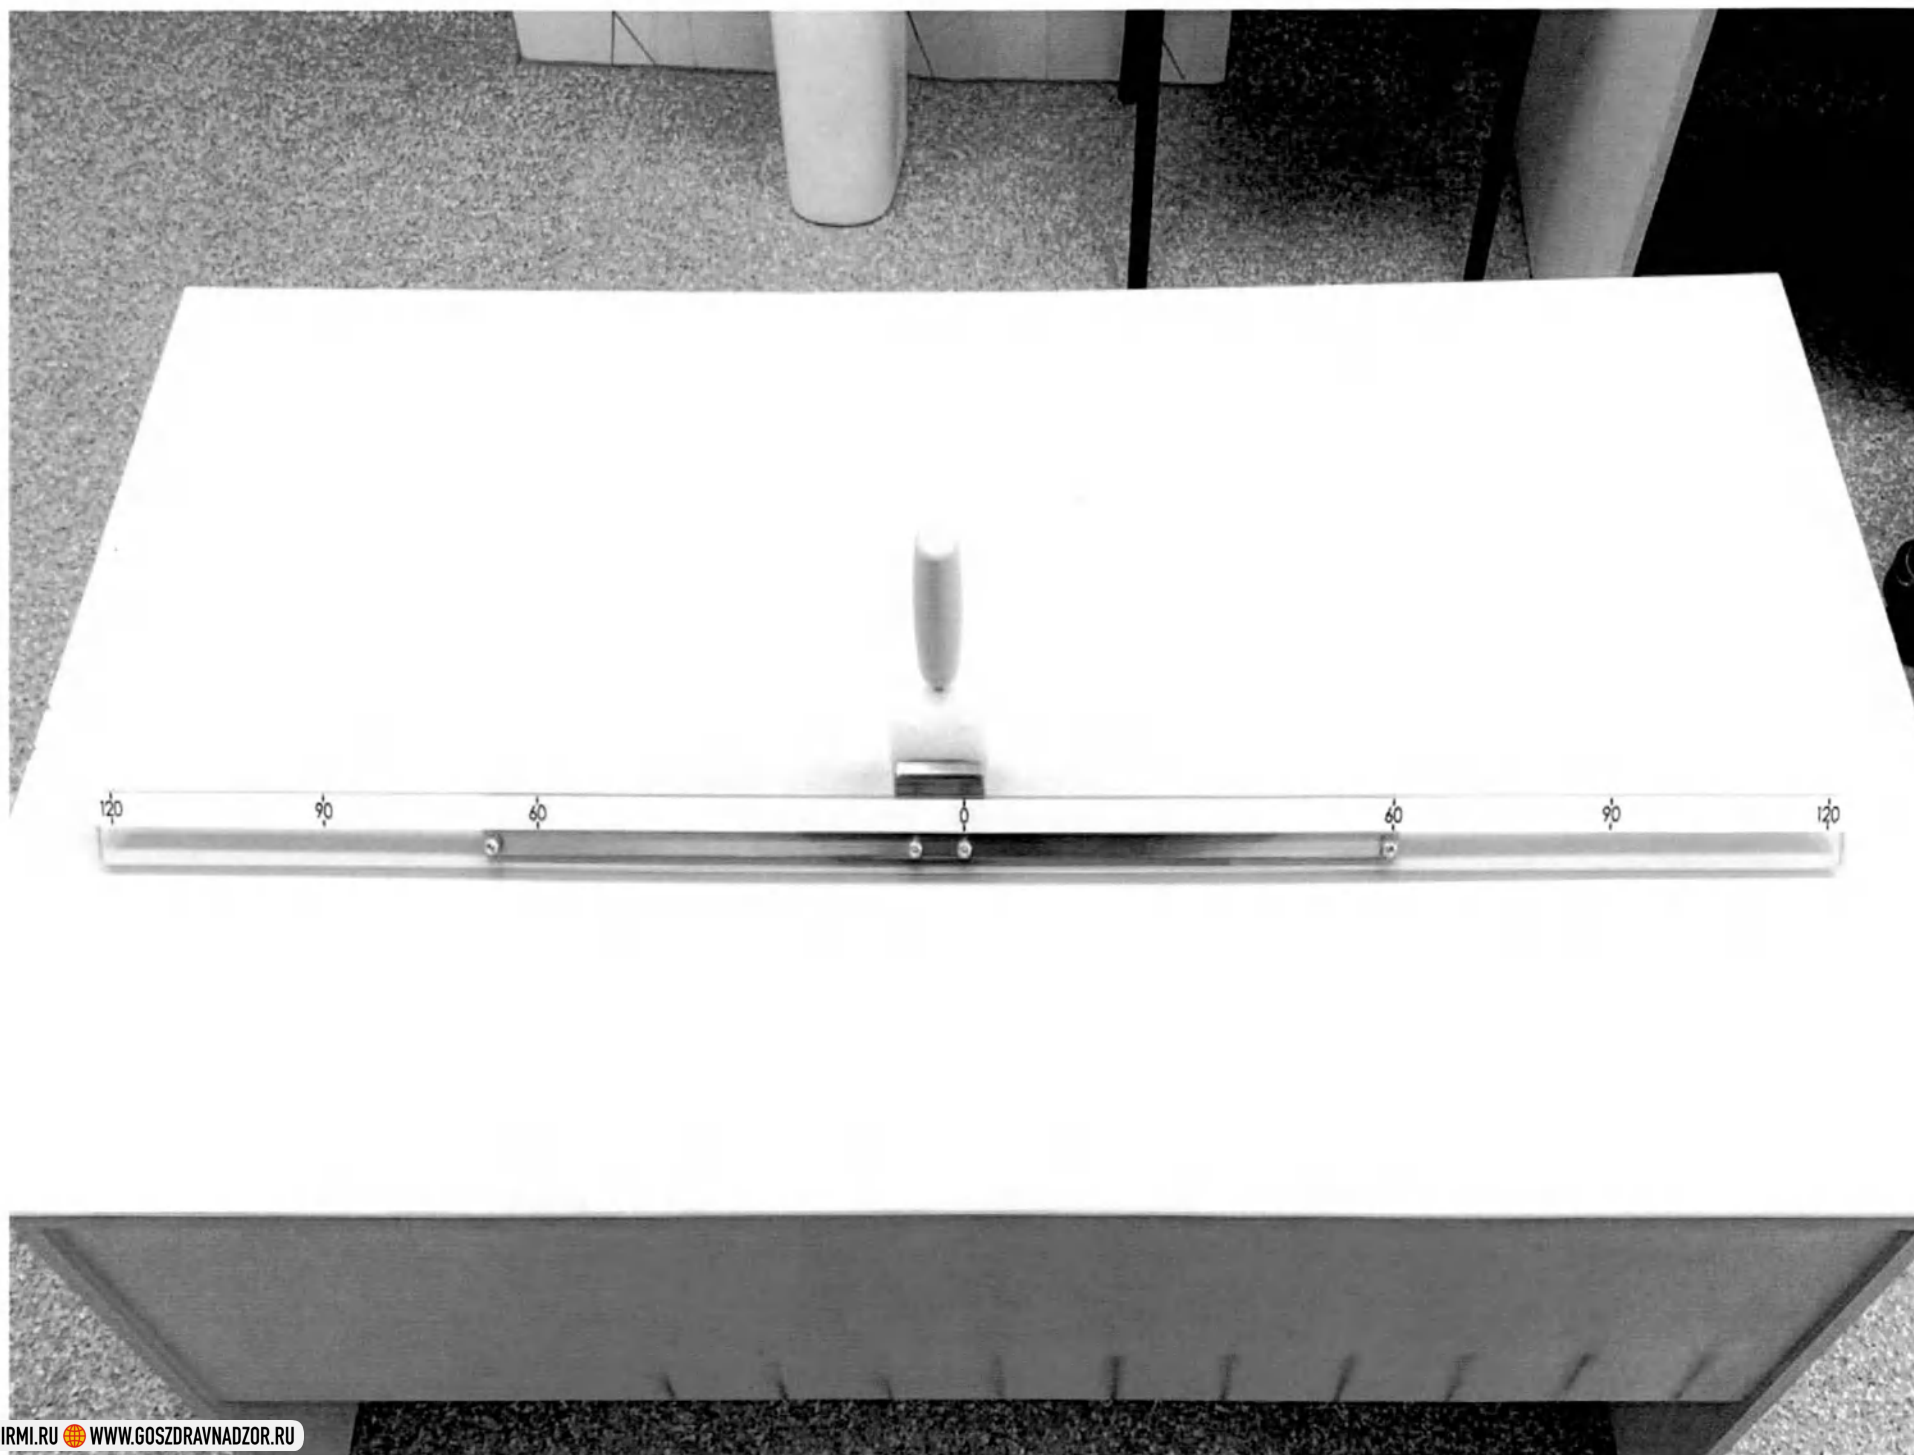


Линейка для функции СПИВАНИЕ, производства ООО «Севкавrentген-Д», Россия (исполнение 03)

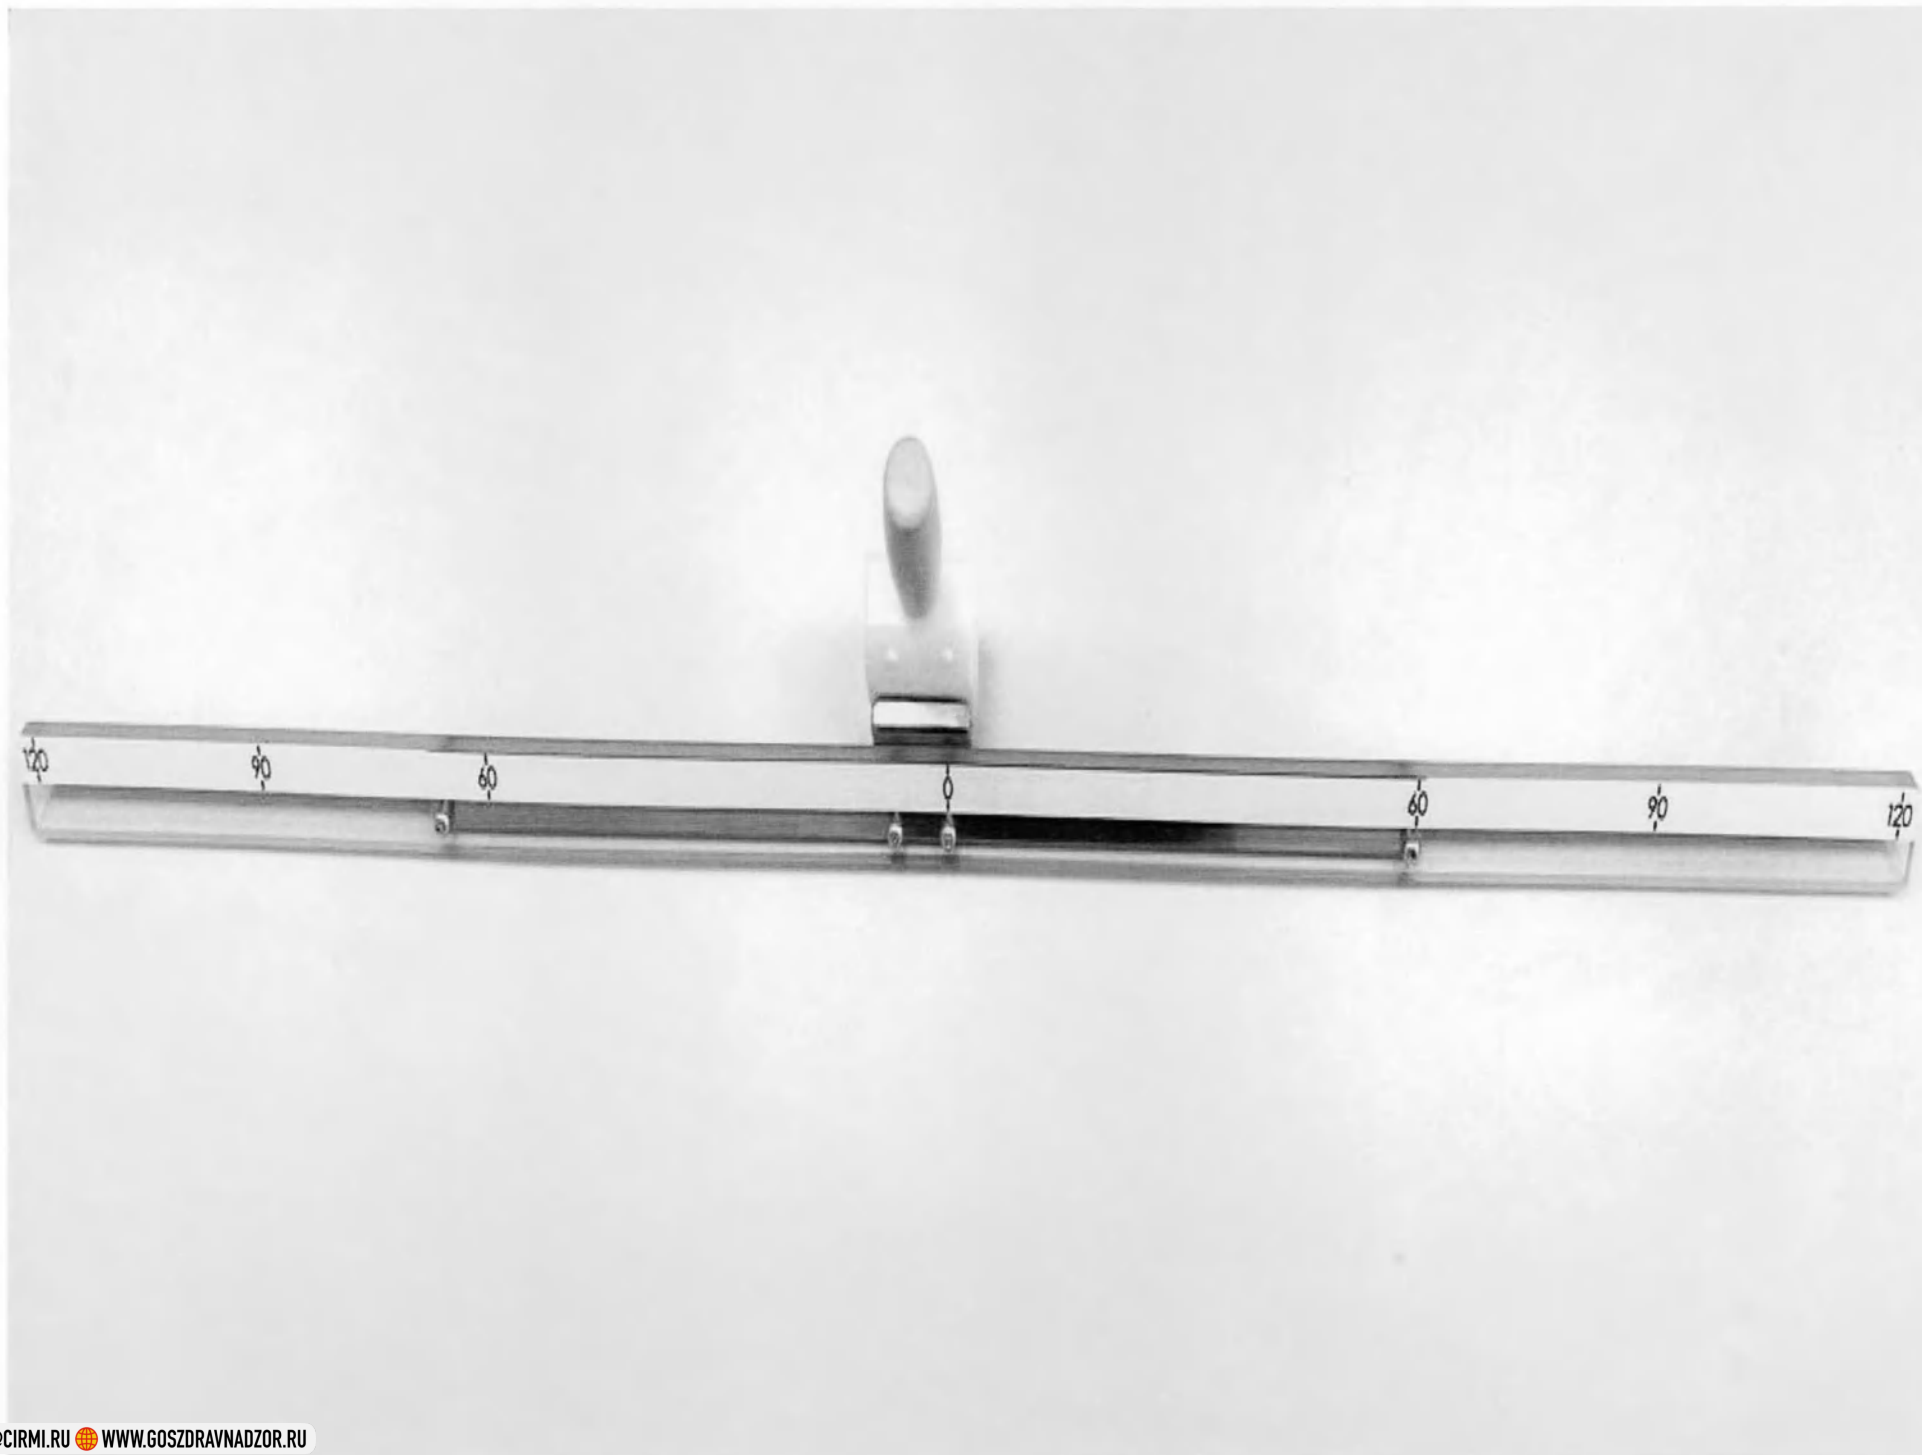

Подставка для жидкости, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнения 01, 02)

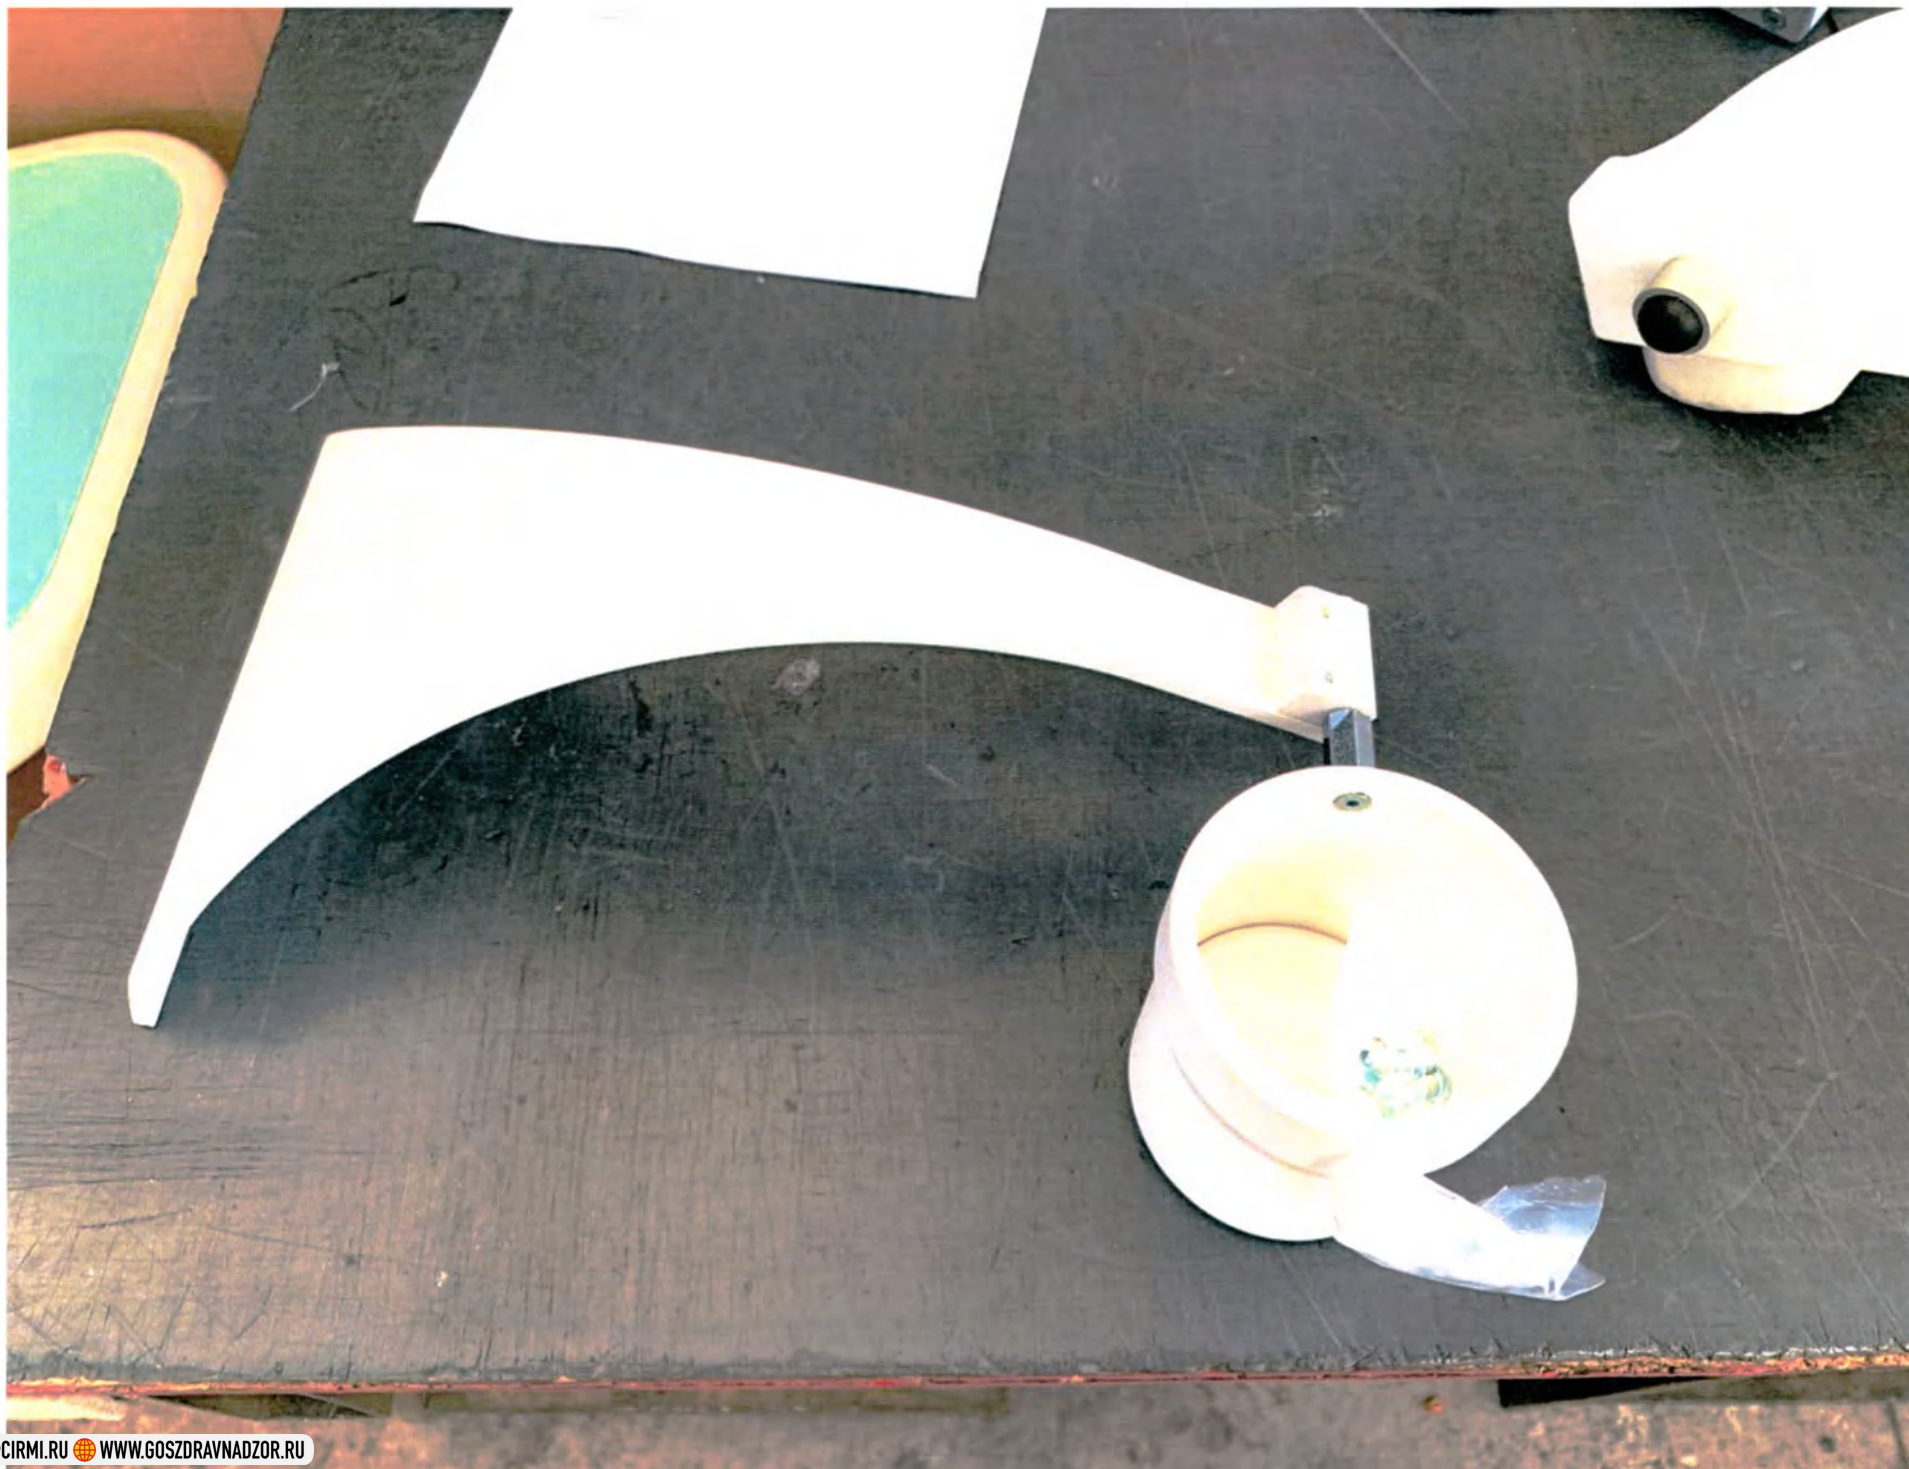

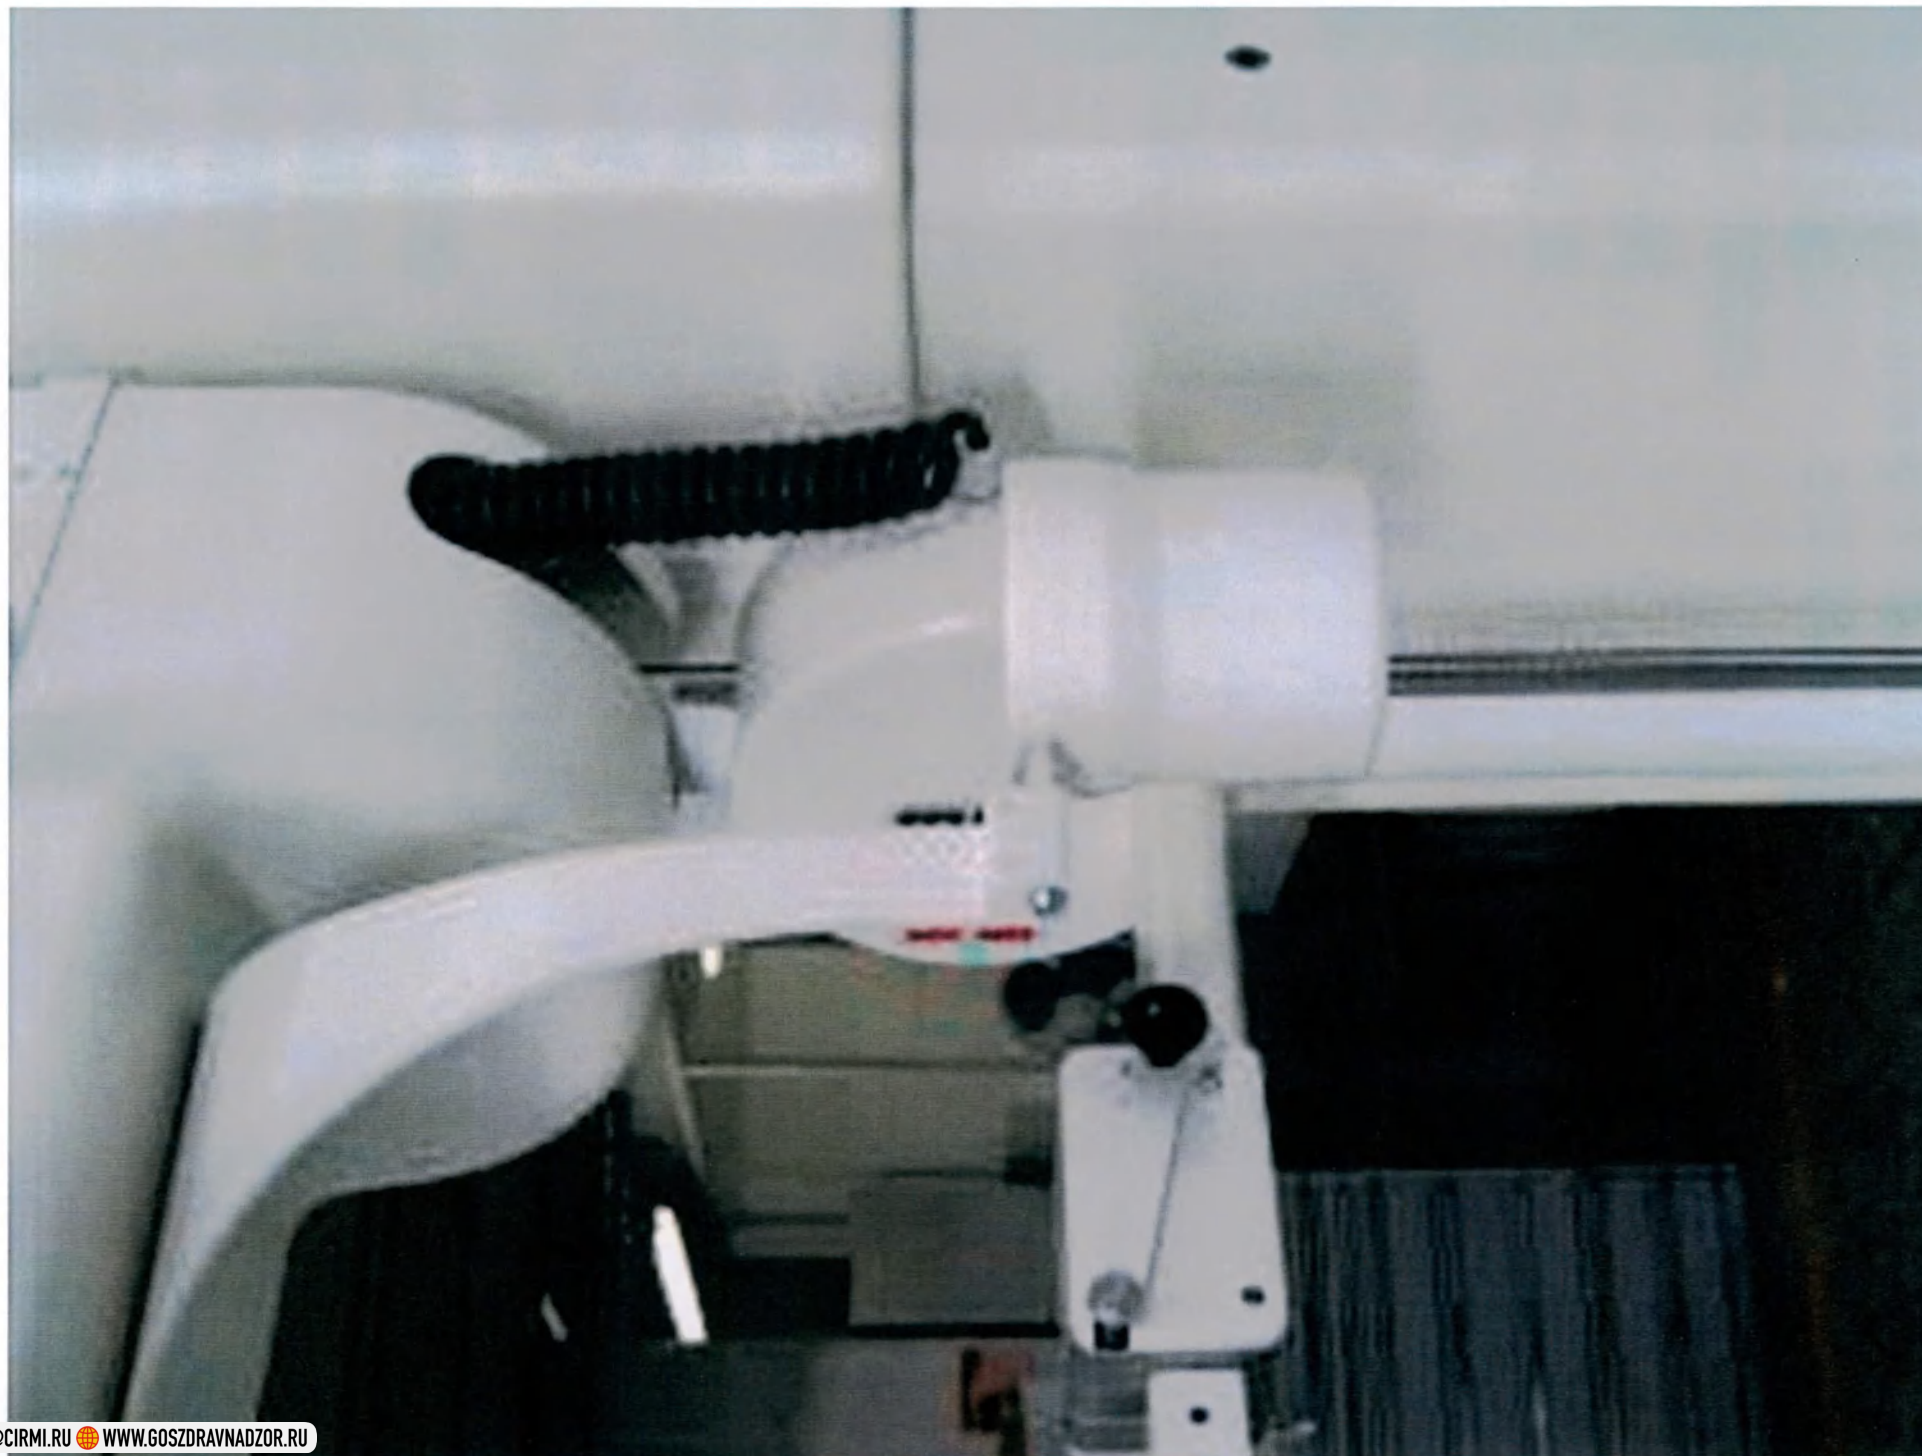


Ступенька для пациента, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнения 01, 02)



Ступенька для пациента производства ООО «Севкавментген-Д», Россия (исполнение 01, 02, 03)




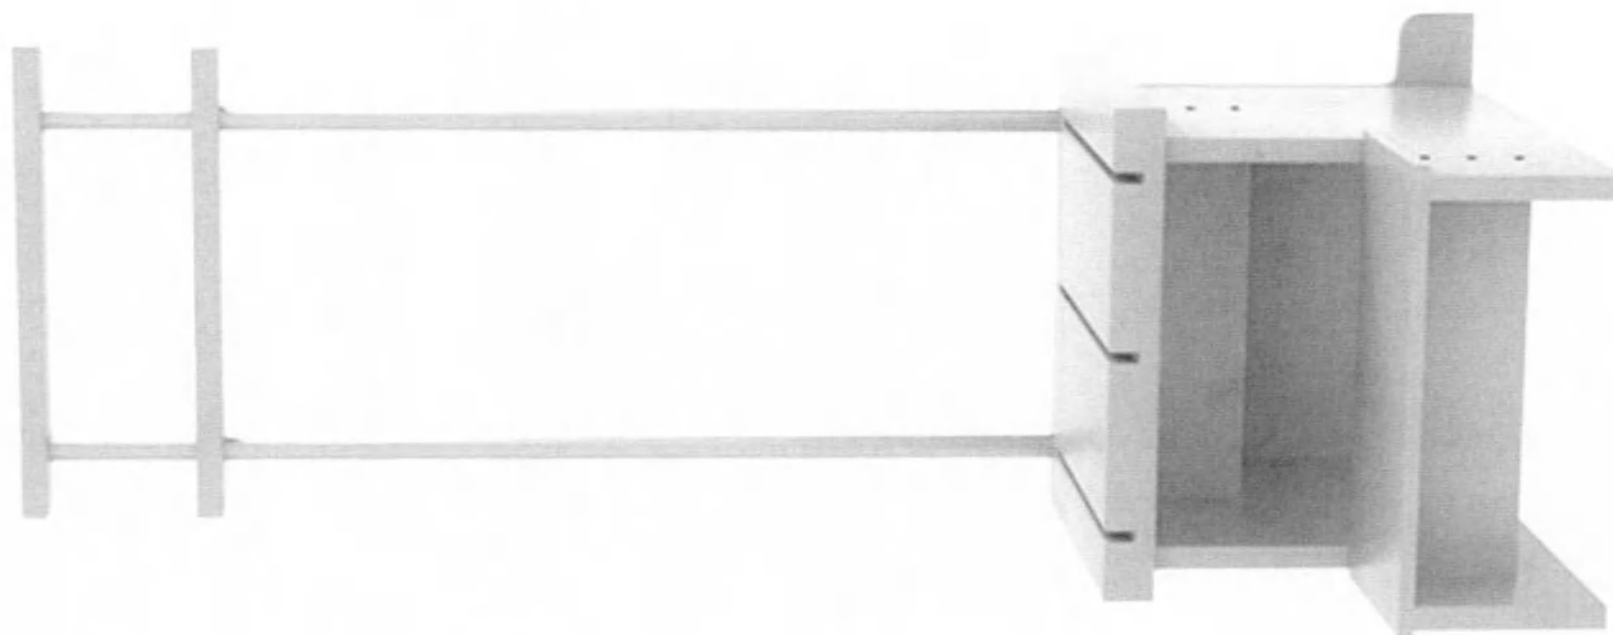

Тележка для монитора, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнение 01, 02)




Тележка для монитора, производства ООО «Севкавментген-Д», Россия (исполнение 03)

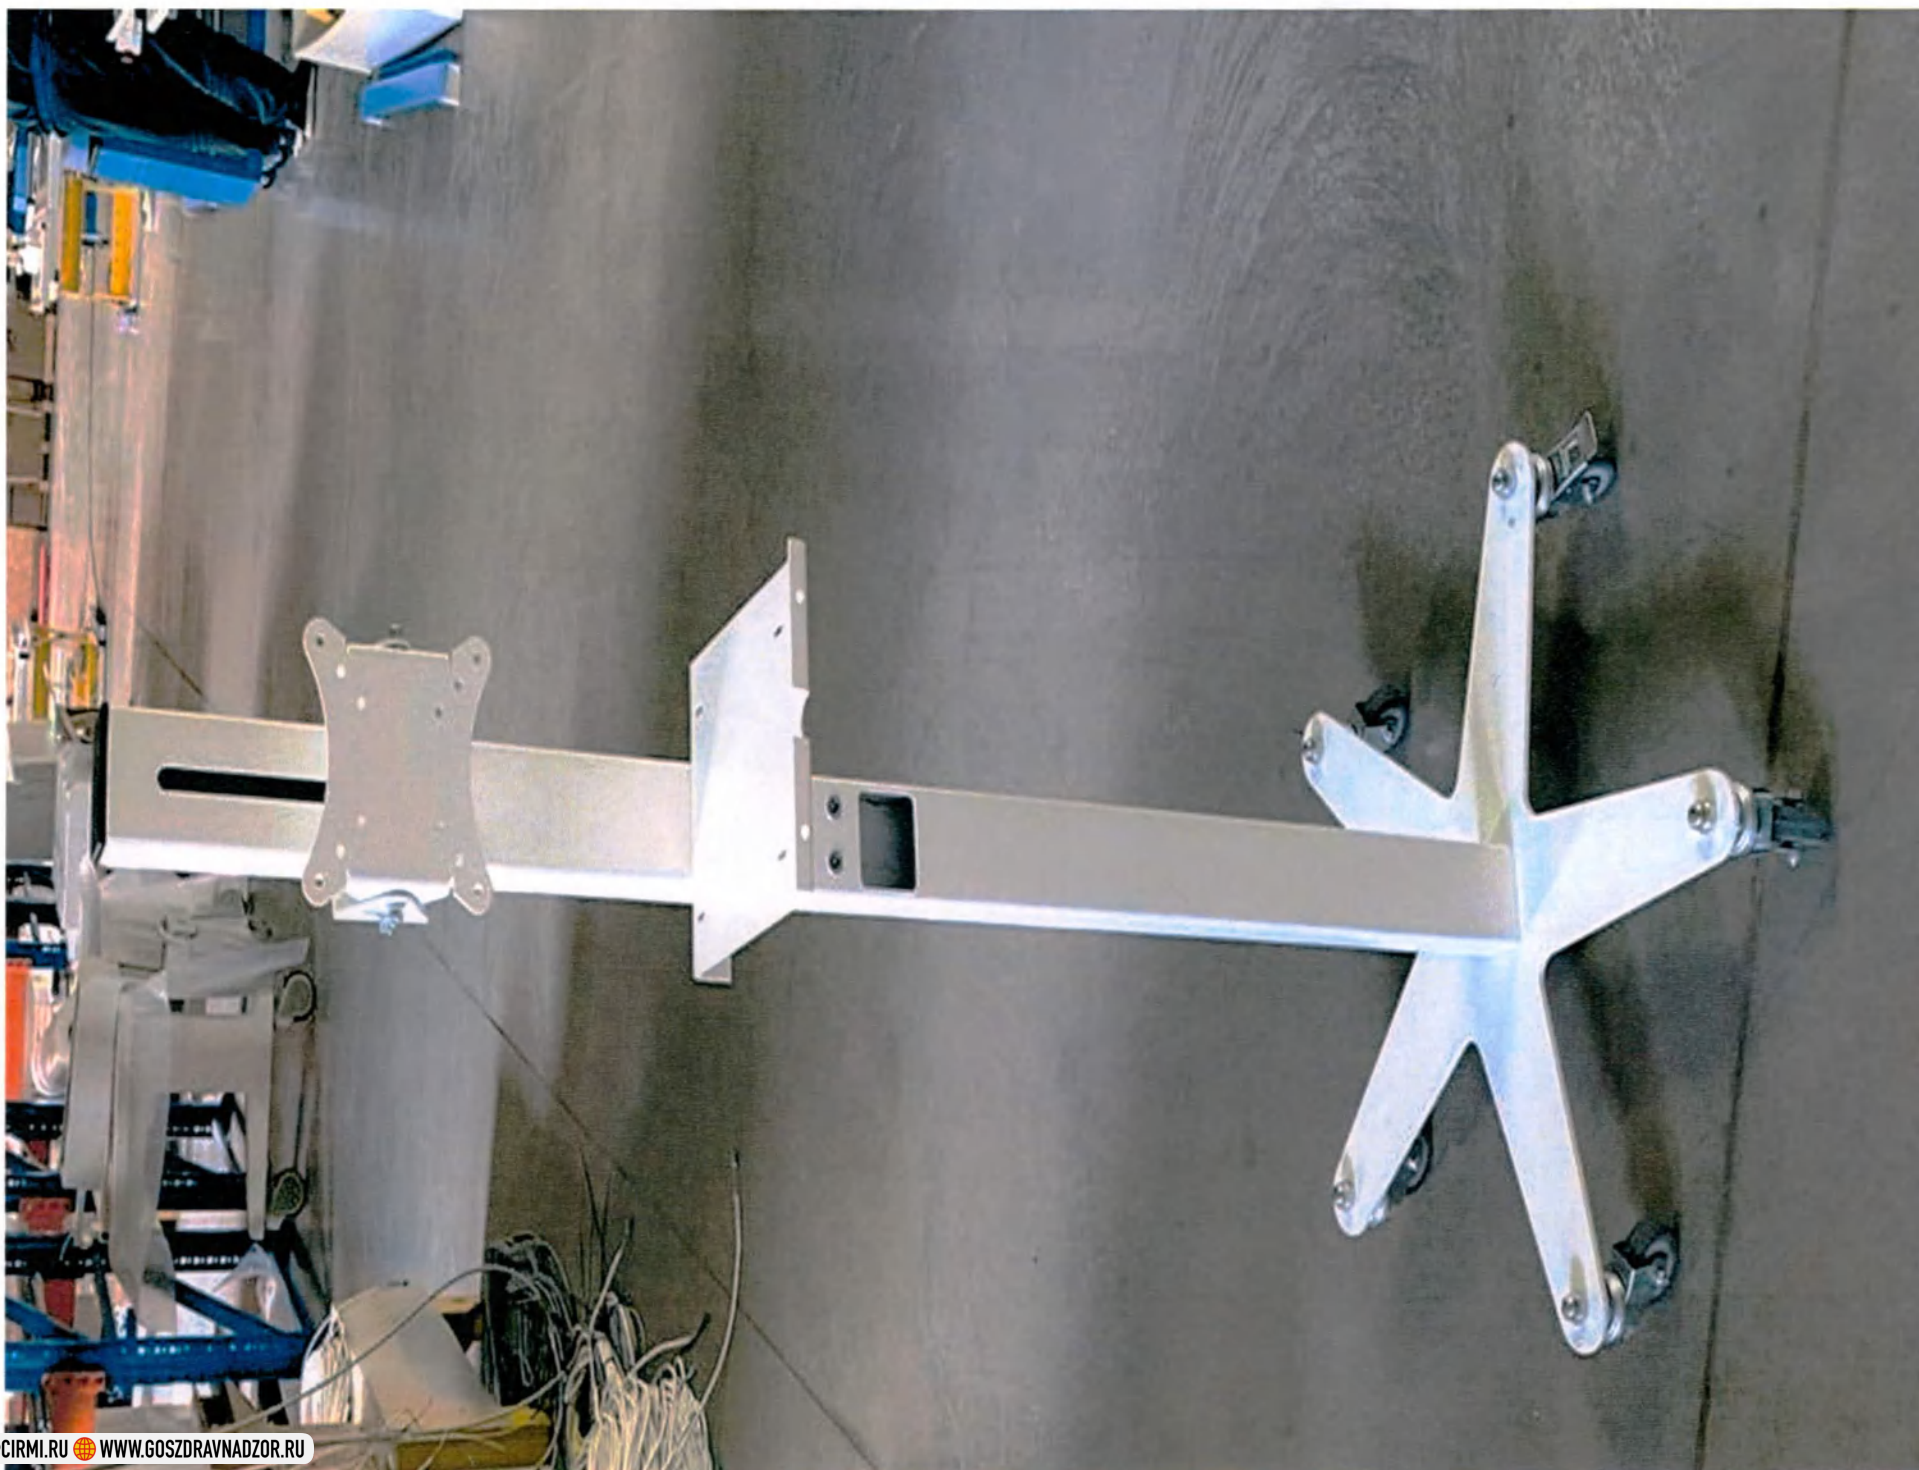

Монитор высокого разрешения медицинский серии Beacon, производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd., Китай (исполнения 01, 02, 03)



Монитор высокого разрешения медицинский серии JUSHA, производства Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd., Китай
(исполнения 01, 02, 03)

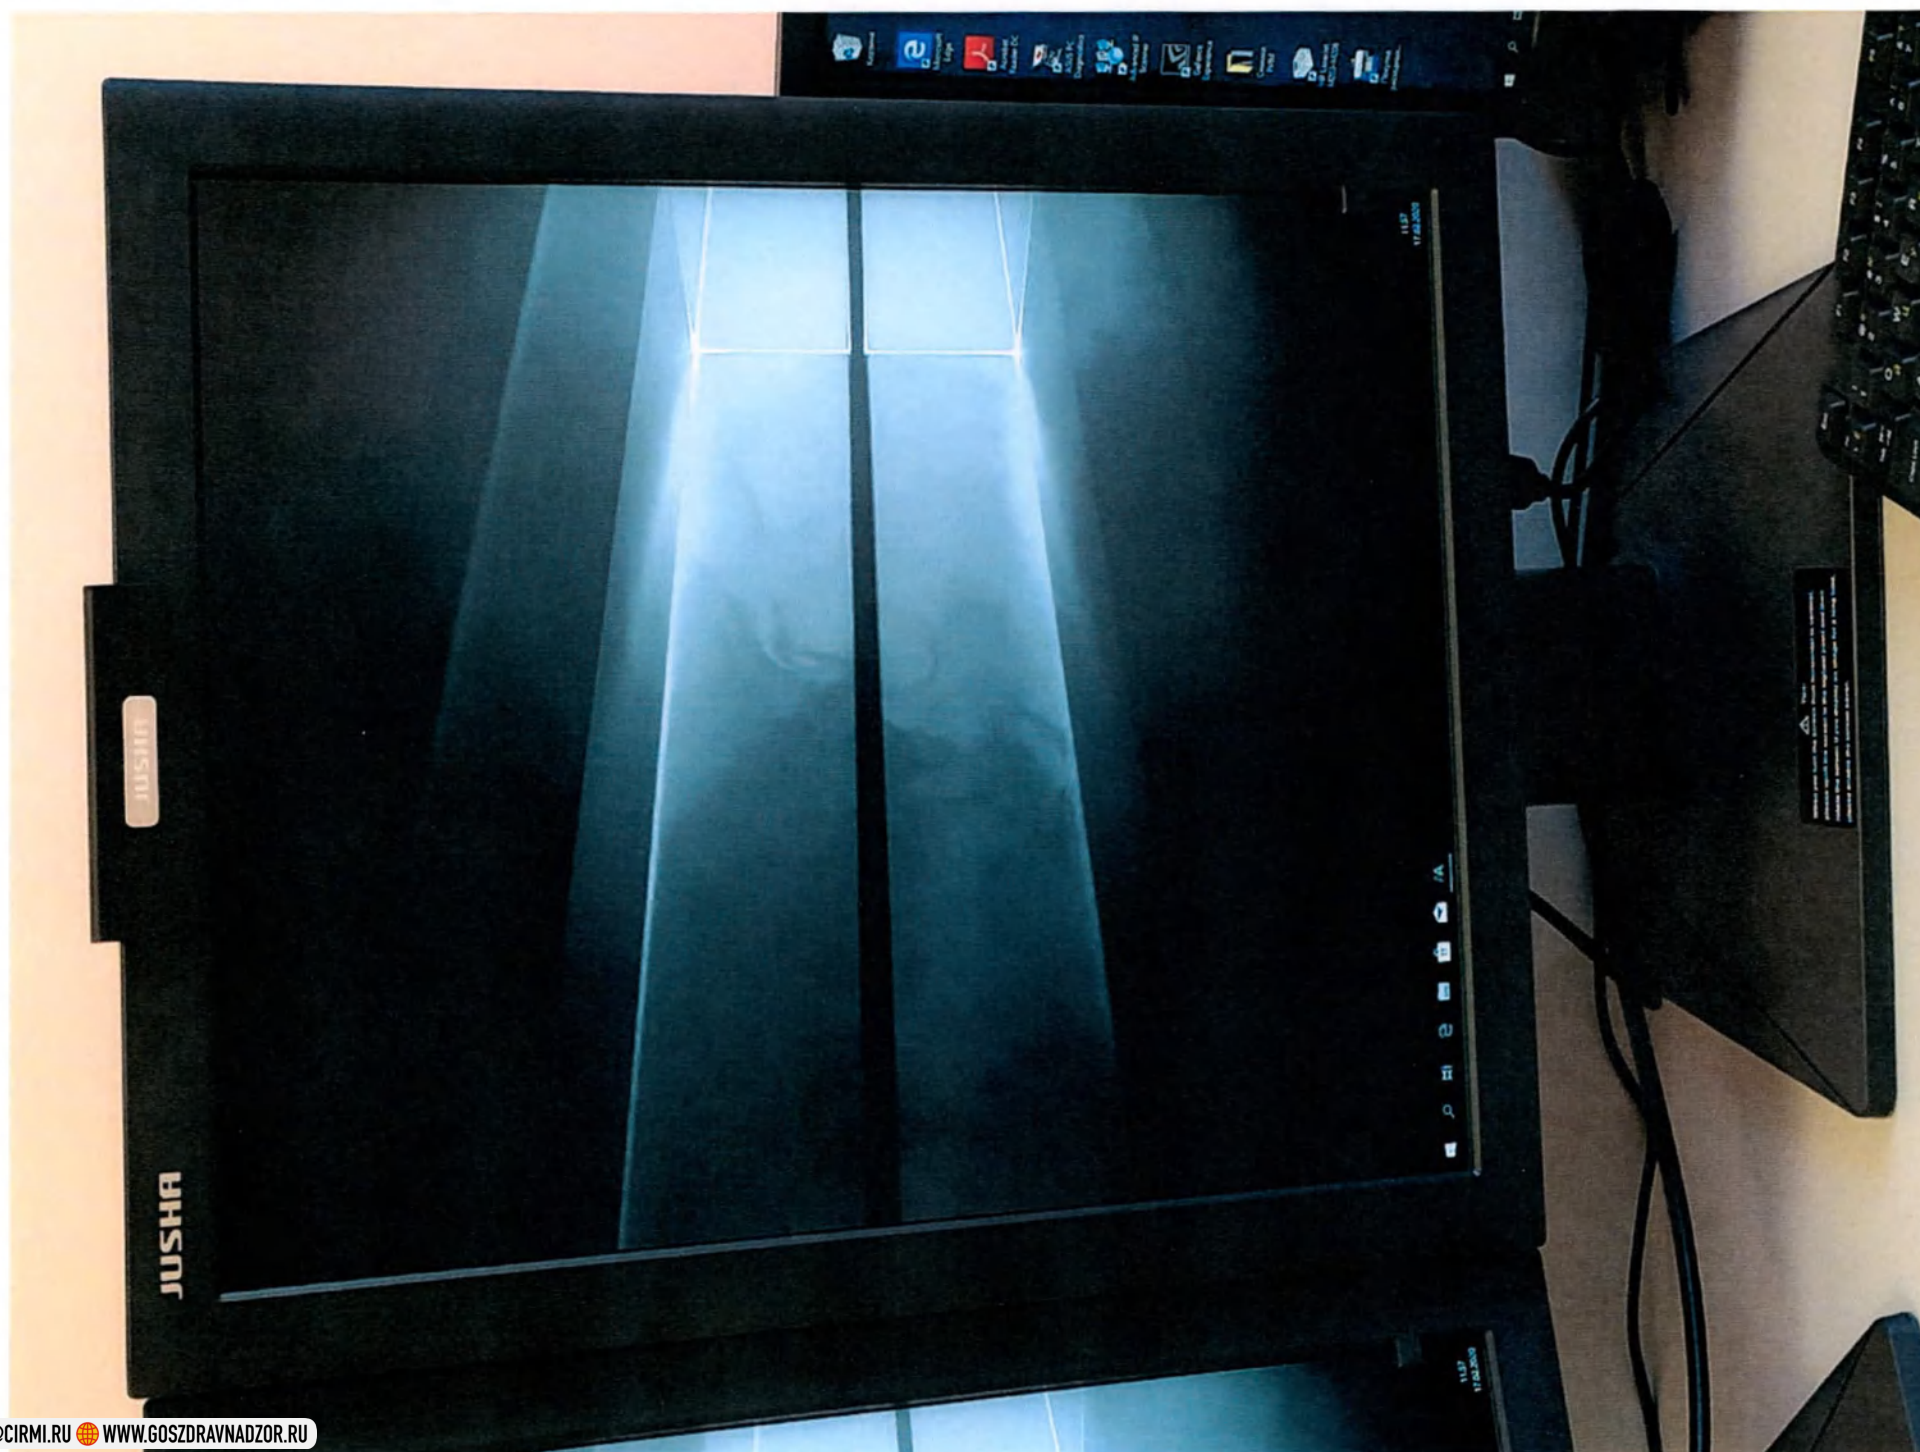

Переговорное устройство т.м. "STELBERRY", серия S, производства ООО "Современные технологии", Россия (исполнения 01, 02, 03)



Камера лазерная мультимедийная медицинская DRYPRO, модель 873 (Laser Imager DRYPRO Model 873) с принадлежностями, производства Konica Minolta Inc., Япония (ПУ № ФСЗ 2008/03309) (исполнения 01, 02, 03)



Камера лазерная мультимедийная медицинская DRYPRO, модель 832 (Laser Imager DRYPRO, Model 832) с принадлежностями, производства Konica Minolta Inc., Япония (РУ № ФСЗ 2007/00692) (исполнение 01, 02, 03)



Камера лазерная мультиматная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями, производства Konica Minolta Inc., Япония (ПУ № ФСЗ 2012/12920) (исполнения 01, 02, 03)



Камера лазерная мультиформатная DRYVIEW 5700 Laser Imaging System для печати медицинских изображений, с принадлежностями, производства Carestream Health, Inc., США (ПУ ФСЗ 2011/10352) (исполнения 01, 02, 03)



Камера мультиматная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями, производства Агфа Н.В.", Бельгия (ПУ № ФСЗ 2008/01838) (исполнения 01, 02, 03)



Камера мультиматная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями, производства Агфа Н.В.", Бельгия (РУ № ФСЗ 2008/02792) (исполнения 01, 02, 03)



Стабилизатор напряжения (Стабилизатор переменного напряжения трехфазный с товарным знаком "ШТИЛЬ", производства ЗАО "Тэнси-техно", Россия (исполнения 01, 02, 03))



Программная опция ТОМОСИНТЕЗ, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнения 01, 02) или производства ООО «Севкав рентген-Д», Россия (исполнение 03)

gmm test DOB ### Age ### A# ID

Ожидание связи со столом и генератором ...

ОШИБКА 00-02-00021 - СУБЪЕКТ ДИ
Прервана связь со столом!

KV 55 mAs 1.0 0.100

AK [mGy] 0.000
AK r [mGy/min] 0.000

KV 0 mA 0.0 min 0.0 ACC 0.0 INT 0.0

43x43

Reconstruction Parameters

Load profile: ToraceShiftAdd

Reconstructed Planes

First (mm) Last (mm) 150 Step (mm) 10

Mechanical Setup: <none>

Processing

Reconstruction ended OK

Saving progress 100%

Processing total progress 100%

Process Abort

Advanced Cancel OK

Tomosynthesis

0mm 10mm 20mm 30mm 40mm 50mm

60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm

120mm 130mm 140mm 150mm

Auto +

RF TEST dose

CR TEST AK - DOSE

RF Hand AP

RF

PIXEL VIEW


Cobb

Series 1/2 Frame 1/5

uGym2 0,0 kv 70 mAs 1,7 ms 7 Time Lap 0,000 EI 0,00 DI 0,000

CLOSE SEND

Программная опция СШИВАНИЕ, производства General Medical Merate S.p.A., Италия (исполнения 01, 02) или производства ООО «Севкав рентген-Д», Россия (исполнение 03)

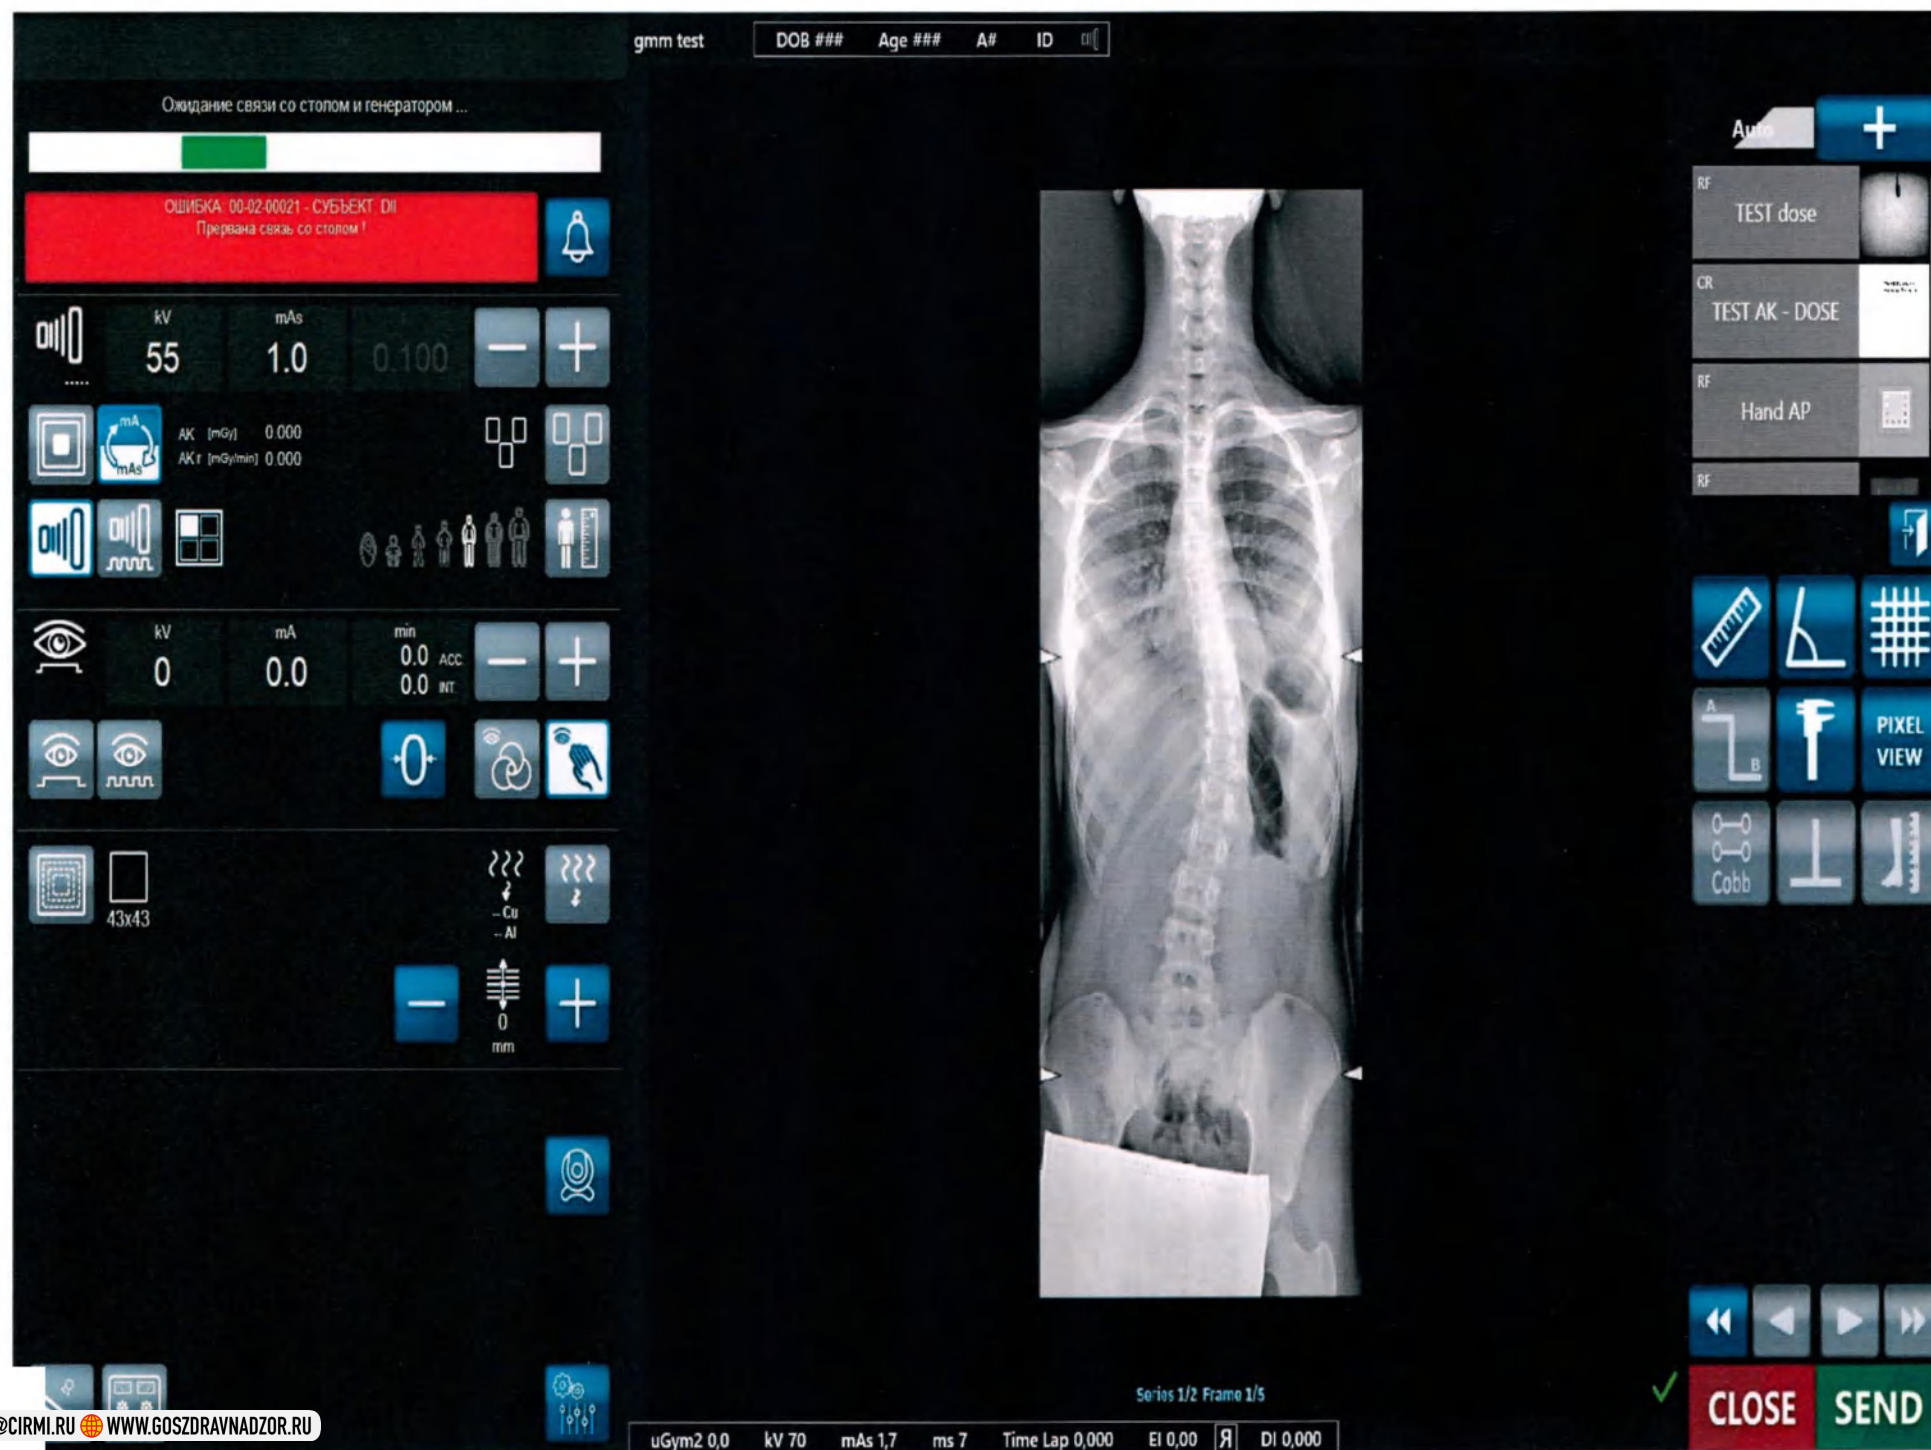




Общество с ограниченной
ответственностью
«ДАЛИ Медикал»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ДАЛИ Медикал»
_____ К.А.Янюк
«___» _____ 2024 г.

**КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦИФРОВОЙ «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022**

Вариант исполнения 01

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕНА.941211.005-01РЭ**

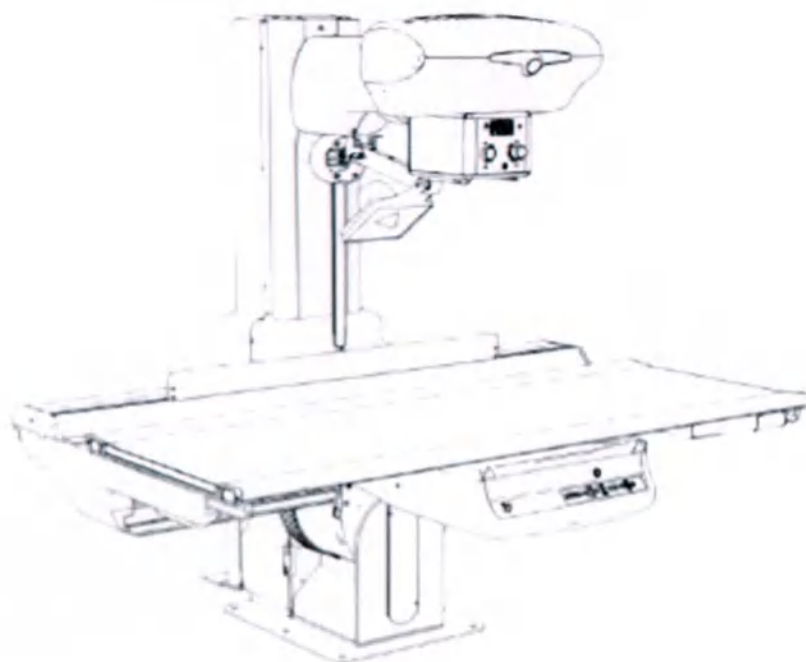

2024 год




**Общество с ограниченной
ответственностью
«ДАЛИ Медикал»**

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ДАЛИ Медикал»
_____ К.А. Янюк
« ____ » _____ 2024 г.

**КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦИФРОВОЙ «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022**

Вариант исполнения 02

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕНА.941211.005-02РЭ**

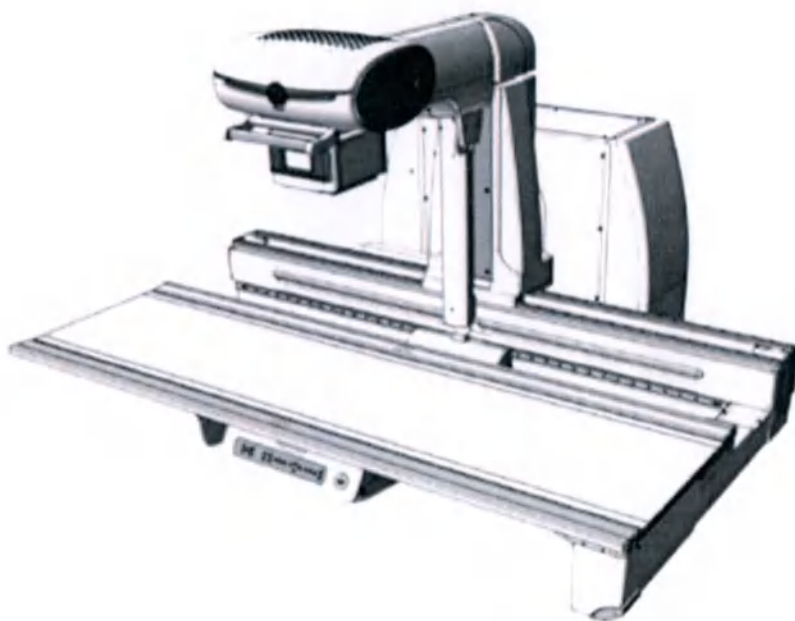

2024 год




Общество с ограниченной
ответственностью
«ДАЛИ Медикал»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ДАЛИ Медикал»
_____ К.А. Янюк
«__» _____ 2024 г.

**КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦИФРОВОЙ «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022**

Вариант исполнения 03

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕНА.941211.005-03РЭ**

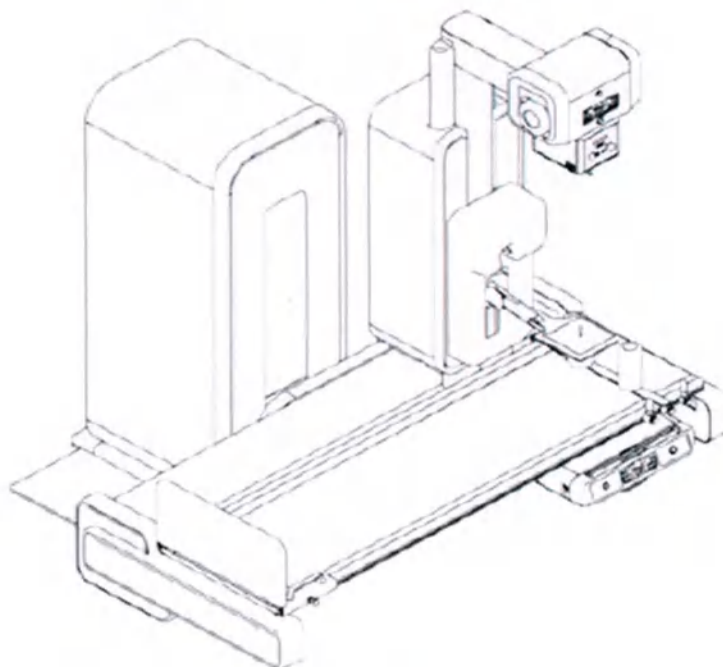

2024 год

ДАЛИ

МЕДИКАЛ

Общество с ограниченной ответственностью
«ДАЛИ Медикал»

Телефон/факс: 8(495)215-09-15
Email: info@dali-medical.com

Код ОКПД2 26.60.11.113

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ДАЛИ Медикал»

_____ К.А. Янюк

«10» июня 2024 г.

**КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022
Вариант исполнения 01**

**ПАСПОРТ
ДЕНА.941211.005-01ПС**

2024 г.

ООО «ДАЛИ Медикал». 143700, Московская область, г.о. Шаховская,
р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1.

ДАЛИ
МЕДИКАЛ

Общество с ограниченной ответственностью
«ДАЛИ Медикал»

Телефон/факс: 8(495)215-09-15
Email: info@dali-medical.com

Код ОКПД2 26.60.11.113

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ДАЛИ Медикал»
_____ К.А. Янюк
«10» июня 2024 г.

**КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ «ЕВО»**
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022
Вариант исполнения 02

**ПАСПОРТ
ДЕНА.941211.005-02ПС**

2024 г.

ООО «ДАЛИ Медикал». 143700, Московская область, г.о. Шаховская,
р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1.

ДАЛИ

МЕДИКАЛ

Общество с ограниченной ответственностью
«ДАЛИ Медикал»

Телефон/факс: 8(495)215-09-15

Email: info@dali-medical.com

Код ОКПД2 26.60.11.113

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ДАЛИ Медикал»

_____ К.А. Янюк

«10» июня 2024 г.

КОМПЛЕКС РЕНТГЕНОВСКИЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022
Вариант исполнения 03

ПАСПОРТ
ДЕНА.941211.005-03ПС

2024 г.

ООО «ДАЛИ Медикал». 143700, Московская область, г.о. Шаховская,
р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1.

Пример потребительской упаковки телеуправляемого поворотного стола-штатива для рентгенологических исследований



Пример потребительской упаковки Стола штатива поворотного телеуправляемого



Пример потребительской упаковки устройства рентгеновского питающего



Пример потребительской упаковки Комплекса аппаратно-программного (АРМ лаборанта)



Пример потребительской упаковки плиты-основания



Пример потребительской упаковки рентгеновского излучателя



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

96 (девятисот шест) листов

Ген директор

ООО «ДАЛИ Медикал»



Янюк К.А.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «ДАЛИ Медикал»
Янюк К.А.

«10» июня 2024 г.

**Комплекс рентгеновский диагностический
цифровой «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022,
в вариантах исполнения
МАКЕТЫ МАРКИРОВОК**

2023г.

1. Макет маркировки для МИ

Макеты маркировок на медицинское изделие «Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022, в вариантах исполнения » (далее – «МИ», «медицинское изделие») и его составные части.

Макеты маркировок МИ и его составных частей носят демонстрационный характер, в связи с этим некоторые технические значения и наименования моделей/вариантов исполнения содержат условное обозначение «Х». При распечатывании финальной маркировки для нанесения на МИ и/или его составные части, «Х» заменяется на конкретные значения, соответствующие данному МИ и/или составной части.

Вариант исполнения 0Х

Макет маркировки «Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022, вариант исполнения 0Х»

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0Х РУ № XXXXXXXXXX от дд.мм.гггг	
	Заводской номер Дата изготовления	XXXXXXXXXX ГГГГ.ММ
	3~380В XXXXA	Сеть 50±1Гц Х,ХХ Ом
		

2 Макет маркировки для составных частей

Во избежание разукомплектования выбранной конфигурации МИ путём несанкционированной замены составных частей МИ, влияющих на качество, эффективность и безопасность МИ, на корпус таких составных частей наносится маркировка ООО «ДАЛИ Медикал», обеспечивающая их идентификацию.

2.1 Телеуправляемый поворотный стол-штатив для рентгенологических исследований

2.1.1 Телеуправляемый поворотный стол-штатив для рентгенологических исследований OPERA T90 или OPERA T30, производства General Medical Merate S.p.A., Италия

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Телеуправляемый поворотный стол-штатив для рентгенологических исследований OPERA TXX Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия	
		

Применяемость: вариант исполнения 01

2.1.2 Телеуправляемый поворотный стол-штатив для рентгенологических исследований CLISIS Exel, производства General Medical Merate S.p.A., Италия

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Телеуправляемый поворотный стол-штатив для рентгенологических исследований CLISIS Exel Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия	
		

Применяемость: вариант исполнения 02

2.1.3 Устройства штативные рентгеновские медицинские по ТУ 9452-005-86112671-2012:
 Стол штатив поворотный телеуправляемый КОСМОС, в исполнении КОСМОС-Д,
 производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Устройства штативные рентгеновские медицинские по ТУ 9452-005-86112671-2012: Стол штатив поворотный телеуправляемый КОСМОС, в исполнении КОСМОС-Д Производитель: ООО "Севкаврентген-Д", Россия	
		

Применяемость: вариант исполнения 03

2.2 Пульт управления с педалью

2.2.1 Пульт управления с педалью, производства General Medical Merate S.p.A., Италия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Пульт управления с педалью Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия	
		

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02

2.3 Устройство рентгеновское питающее

2.3.1 Устройство рентгеновское питающее VZW2558, производства Communication & Power Industries Inc, Канада

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX	
	Устройство рентгеновское питающее VZW2558 Производитель: Communication & Power Industries Inc, Канада	
	Сеть 3 ~380В / 50Гц При рентгенографии XXXA (кратковременно) Мощность XX кВт (кратковременно)	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.3.2 Устройство рентгеновское питающее EPS 45-80 HIGH-VOLTAGE GENERATOR с принадлежностями, производства EMD Technologies, Канада

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX	
	Устройство рентгеновское питающее EPS 45-80 HIGH VOLTAGE GENERATOR с принадлежностями Производитель: EMD Technologies, Канада	
	Сеть 3 ~380В / 50Гц При рентгенографии XXXA (кратковременно) Мощность XX кВт (кратковременно)	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.4 Комплекс программно-аппаратный получения и обработки рентгеновских изображений (АРМ лаборанта)

2.4.1 Комплекс программно-аппаратный получения и обработки рентгеновских изображений (АРМ лаборанта) D4000RF, производства General Medical Merate S.p.A., Италия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Комплекс программно-аппаратный получения и обработки рентгеновских изображений (АРМ лаборанта) D4000RF Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия	
		

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.4.2 Комплекс программно-аппаратный получения и обработки рентгеновских изображений (АРМ лаборанта) Cloud RF, производства ООО «ДАЛИ Медикал», Россия

  	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Комплекс программно-аппаратный получения и обработки рентгеновских изображений (АРМ лаборанта) Cloud RF Производитель: ООО "ДАЛИ Медикал", Россия	
Серийный номер Дата изготовления		XXXXXX ГГГГ.ММ

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.5 Цифровой приемник рентгеновского изображения

2.5.1 Цифровой приемник рентгеновского изображения PaxScan 4343 DXV, производства Varex Imaging Corporation, США

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Цифровой приемник рентгеновского изображения PaxScan 4343 DXV Производитель: Varex Imaging Corporation, США	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.5.2 Цифровой приемник рентгеновского изображения Pixium RF 4343, производства Thales Electron Devices S.A., Франция

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Цифровой приемник рентгеновского изображения Pixium RF 4343 Производитель: Thales Electron Devices S.A., Франция	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.5.3 Цифровой приемник рентгеновского изображения Pixium 4343 FL, производства Thales Electron Devices S.A., Франция

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Цифровой приемник рентгеновского изображения Pixium 4343 FL Производитель: Thales Electron Devices S.A., Франция	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.6 Рентгеновский излучатель

В виду конструктивных особенностей рентгеновских излучателей и размещения оригинальной маркировки производителя в труднодоступном и скрытом от глаз пользователя месте, ООО «ДАЛИ Медикал» дублирует все характеристики и обозначения рентгеновских излучателей на русско-язычном варианте маркировки.

Маркировка размещается на защитно-декоративном кожухе излучателя.

Просим обратить внимание, что обозначение полярности кабельных разъёмов представлено в виде отдельно клеящихся маркировок с нанесёнными на них символами «+» и «-». Каждый символ располагается у своего разъёма рентгеновского излучателя.

2.6.1 Рентгеновский излучатель RTM, производства IAE S.p.a. Италия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Рентгеновский излучатель RTM Производитель: I.A.E. S.p.A., Италия	

☐ 0,X мм	☐ X,X мм	150 кВ
Внутренняя фильтрация	X,X мм Al	
Фильтрация кожуха	X,X мм Al	
Дополнительная фильтрация	X,X мм Al	
Общая фильтрация	X,X мм Al	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.6.2 Рентгеновский излучатель RTC, производства IAE S.p.a. Италия



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВ0»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXXX

Рентгеновский излучатель RTC
Производитель: I.A.E. S.p.A., Италия

☐ 0,X мм	☐ X,X мм	150 кВ
Внутренняя фильтрация		X,X мм Al
Фильтрация кожуха		X,X мм Al
Дополнительная фильтрация		X,X мм Al
Общая фильтрация		X,X мм Al

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.6.3 Рентгеновский излучатель G292, производства Varex Imaging Corporation, США



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВ0»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXXX

Рентгеновский излучатель G292
Производитель: Varex Imaging Corporation, США

☐ 0,X мм	☐ X,X мм	150 кВ
Внутренняя фильтрация		X,X мм Al
Фильтрация кожуха		X,X мм Al
Дополнительная фильтрация		X,X мм Al
Общая фильтрация		X,X мм Al

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.7 Коллиматор

2.7.1 Коллиматор серии Ralco R, модели R 225ACS DHHS или R 302 или R 221, производства Ralco s.r.l., Италия

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX	
	Коллиматор серии Ralco R, модель R XXX Производитель: Ralco s.r.l., Италия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.7.2 Коллиматор Optica 40, производства Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Americas Corp., США

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX	
	Коллиматор Optica 40 Производитель: Varex Imaging Philippines Inc., Филиппины	



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022
вариант исполнения: 0Х
Заводской номер № XXXXXXXXX

Коллиматор Optica 40
Производитель: Varex Imaging Americas Corp., США



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022
вариант исполнения: 0Х
Заводской номер № XXXXXXXXX

Коллиматор Optica 40
Производитель: Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.8 Отсеивающая решётка

2.8.1 Отсеивающая решетка JPI, производства Jungwon Precision Industries Healthcare Co, Ю. Корея

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Отсеивающая решетка JPI Производитель: Jungwon Precision Industries Healthcare Co., Ю.Корея	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.8.2 Отсеивающая решетка Soyee, производства Soyee Product Inc., Корея

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Отсеивающая решетка Soyee Производитель: Soyee Product Inc., Корея	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.9 Ионизационная камера

Ионизационная камера серии SSMC, модели: 508 или 601, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды

 	 ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX
	Ионизационная камера SSMC, модель XXX Производитель: Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.10 Дозиметр

2.10.1 Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012: Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М, производства ООО НПП "Доза", Россия

 	 ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX
	Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012: Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1М Производитель: ООО НПП «ДОЗА», Россия

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.10.2 Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System, производства VacuTec Meßtechnik GmbH, Германия

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	ДАЛИ МЕДИКАЛ
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX	
	Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDap System Производитель: VacuTec Meßtechnik GmbH, Германия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.10.3 Дозиметр KermaX Plus, производства IBA Dosimetry, GmbH, Германия

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	ДАЛИ МЕДИКАЛ
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX	
	Дозиметр KermaX Plus Производитель: IBA Dosimetry GmbH, Германия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.11 Плита-основание

2.11.1 Плита-основание, производства General Medical Merate S.p.A., Италия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Плита-основание Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02

2.11.2 Плита-основание, производства ООО «ДАЛИ Медикал», Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Плита-основание Производитель: ООО "ДАЛИ Медикал", Россия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.12 Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований

Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед», ТУ 9440-001-98944313-2007, производства ООО «Мед-Рей», Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований "АрхиМед" по ТУ 9440-001-98944313-2007 Производитель: ООО «Мед-Рей», Россия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.13 Ширмы рентгенозащитные

2.13.1 Ширмы рентгенозащитные по ТУ 9452-010-46782692-2001, производства ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Ширмы рентгенозащитные: Ширмы рентгенозащитные по ТУ 9452-010-46782692-2001 Производитель: ООО "СПЕЦМЕДПРИБОР", Россия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.13.2 Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002, производства АО «ПОНИ», Россия

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
Ширмы рентгенозащитные: Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002 Производитель: АО "ПОНИ", Россия		

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.14 Крепление детское универсальное

Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010, производства ИП Давлетов Д.Я., Россия

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010 Производитель: ИП Давлетов Д.Я.		

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.15 Негатоскоп

2.15.1 Негатоскоп "ИКСВЬЮ" по ТУ 9441-023-74487176-2011, производства ООО «ДИКСИОН», Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Негатоскоп "ИКСВЬЮ" по ТУ 9441-023-74487176-2011 Производитель: ООО «ДИКСИОН», Россия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.15.2 Негатоскопы "РЕНЕКС НЦП-1", "РЕНЕКС НЦП-2", "РЕНЕКС НЦП-4" по ТУ 9442-008-01416381-2002, ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Негатоскоп РЕНЕКС НЦП-Х по ТУ 9442-008-01416381-2002 Производитель: ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.15.3 Негатоскопы диагностические светодиодные по ТУ 32.50.50-014-17459079-2019 в следующих исполнениях НС1-02, НС2-02, НС2-03, производства АО «ПОНИ»

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Негатоскопы диагностические светодиодные по ТУ 32.50.50-014-17459079-2019 в следующем исполнении: НСХ-0X Производитель: АО «ПОНИ», Россия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.16 Переносной цифровой приемник рентгеновского изображения

2.16.1 Переносной цифровой приемник рентгеновского изображения Pixium 3543 EZ, производства Thales Electron Devices S.A., Франция

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Переносной цифровой приемник рентгеновского изображения Pixium 3543 EZ Производитель: Thales Electron Devices S.A., Франция	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.16.2 Переносной цифровой приемник рентгеновского изображения FDXA3543RPW,
производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd., Япония



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXXX

Переносной цифровой приемник рентгеновского изображения
FDXA3543RPW
Производитель: Canon Electron Tubes Devices Co., Ltd., Япония

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.17 Двойная педаль управления

2.17.1 Двойная педаль управления, производства General Medical Merate S.p.A., Италия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0Х Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Двойная педаль управления Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02

2.17.2 Двойная педаль управления, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0Х Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Двойная педаль управления Производитель: ООО "Севкаврентген-Д", Россия	

Применяемость: вариант исполнения 03

2.18 Опора под ноги

2.18.1 Опора под ноги, производства General Medical Merate S.p.A., Италия

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Опора под ноги Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02

2.18.2 Опора под ноги, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Опора под ноги Производитель: ООО "Севкаврентген-Д", Россия	

Применяемость: вариант исполнения 03

2.19 Опоры для рук

2.19.1 Опоры для рук, производства General Medical Merate S.p.A., Италия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	ДАЛИ МЕДИКАЛ
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0Х Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Опоры для рук Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02

2.19.2 Опора для рук, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	ДАЛИ МЕДИКАЛ
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0Х Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Опоры для рук Производитель: ООО "Севкаврентген-Д", Россия	

Применяемость: вариант исполнения 03

2.20 Опоры под плечи

2.20.1 Опоры под плечи, производства General Medical Merate S.p.A., Италия



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXXX

Опоры под плечи
Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02

2.20.2 Опоры под плечи, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXXX

Опоры под плечи
Производитель: ООО "Севкаврентген-Д", Россия

Применяемость: вариант исполнения 03

2.21 Упоры под колени

2.21.1 Упоры под колени, производства General Medical Merate S.p.A., Италия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Упоры под колени Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02

2.21.2 Упоры под колени, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Упоры под колени Производитель: ООО "Севкаврентген-Д", Россия	

Применяемость: вариант исполнения 03

2.22 Прижимающая лента

2.22.1 Прижимающая лента, производства General Medical Merate S.p.A., Италия



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Прижимающая лента
Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02

2.22.2 Прижимающая лента, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXX

Прижимающая лента
Производитель: ООО "Севкаврентген-Д", Россия

Применяемость: вариант исполнения 03

2.23 Линейка для функции СШИВАНИЕ

2.23.1 Линейка для функции СШИВАНИЕ, производства General Medical Merate S.p.A., Италия



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXXX

Линейка для функции СШИВАНИЕ
Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02

2.22.2 Линейка для функции СШИВАНИЕ, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия



ООО "ДАЛИ Медикал"
Российская Федерация, 143700, МО,
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,
ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1
тел. 8(495)215-09-15
info@dali-medical.com



Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО»
по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022
вариант исполнения: 0X
Заводской номер № XXXXXXXXX

Линейка для функции СШИВАНИЕ
Производитель: ООО "Севкаврентген-Д", Россия

Применяемость: вариант исполнения 03

2.23 Подставка для жидкости

2.23.1 Подставка для жидкости, производства General Medical Merate S.p.A., Италия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Подставка для жидкости Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02

2.23.2 Подставка для жидкости, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Подставка для жидкости Производитель: ООО "Севкаврентген-Д", Россия	

Применяемость: вариант исполнения 03

2.24 Ступенька для пациента

2.24.1 Ступенька для пациента, производства General Medical Merate S.p.A., Италия

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
Ступенька для пациента Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия		

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02

2.24.2 Ступенька для пациента, производства ООО «Севкаврентген-Д», Россия

	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
Ступенька для пациента Производитель: ООО "Севкаврентген-Д", Россия		

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.24.3 Ступенька для пациента, производства ООО «ПМП «Протон», Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Ступенька для пациента Производитель: ООО "ПМП «Протон», Россия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.25 Тележка для монитора

2.25.1 Тележка для монитора, производства General Medical Merate S.p.A., Италия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Тележка для монитора Производитель: General Medical Merate S.p.A., Италия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02

2.25.2 Тележка для монитора, производства ООО «Севкав рентген-Д», Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Тележка для монитора Производитель: ООО "Севкав рентген-Д", Россия	

Применяемость: вариант исполнения 03

2.26 Монитор высокого разрешения медицинский

2.26.1 Монитор высокого разрешения медицинский серии Beacon, производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd., Китай

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Монитор высокого разрешения медицинский серии Beacon Производитель: Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd., Китай	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.26.2 Монитор высокого разрешения медицинский серии JUSHA, производства Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd., Китай

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Монитор высокого разрешения медицинский серии JUSHA Производитель: Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd., Китай	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.27 Переговорное устройство

2.27.1 Переговорное устройство т.м. "STELBERRY", серия S, производства ООО "Современные технологии", Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Переговорное устройство т.м. «STELBERRY», серия S Производитель: ООО «Современные технологии», Россия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.27.2 Переговорное устройство Digital Duplex , производства ГК «КОМКОМ», Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское , д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Переговорное устройство Digital Duplex Производитель: ГК «КОМКОМ», Россия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.28 Медицинская лазерная мультимедийная камера

2.28.1 Камера лазерная мультимедийная медицинская DRYPRO, модель 873 (Laser Imager DRYPRO Model 873) с принадлежностями, производства Konica Minolta Inc., Япония

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское , д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Камера лазерная мультимедийная медицинская DRYPRO, модель 873 (Laser Imager DRYPRO Model 873) с принадлежностями Производитель: Konica Minolta Inc., Япония	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.28.2 Камера лазерная мультиформатная медицинская DRYPRO, модель 832 (Laser Imager DRYPRO Model 832) с принадлежностями, производства Konica Minolta Inc., Япония

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Камера лазерная мультиформатная медицинская DRYPRO, модель 832 (Laser Imager DRYPRO Model 832) с принадлежностями Производитель: Konica Minolta Inc., Япония	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.28.3 Камера лазерная мультиформатная DRYPRO SIGMA с принадлежностями, производства Konica Minolta Inc., Япония

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д. 1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Камера лазерная мультиформатная, модель DRYPRO SIGMA с принадлежностями Производитель: Konica Minolta Inc., Япония	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.28.4 Камера лазерная мультимедийная DRYVIEW 5700 Laser Imaging System для печати медицинских изображений, с принадлежностями, производства Carestream Health, Inc., США

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX
	Камера лазерная мультимедийная DRYVIEW 5700 Laser Imaging System для печати медицинских изображений, с принадлежностями Производитель: Carestream Health Inc., США

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.29 Камера мультимедийная термографическая

2.29.1 Камера мультимедийная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями, производства Агфа Н.В.", Бельгия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXX
	Камера мультимедийная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями Производитель: "Агфа Н.В.", Бельгия

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.29.2 Камера мультимедийная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями, производства Агфа Н.В.", Бельгия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Камера мультимедийная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями Производитель: "Агфа Н.В.", Бельгия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

2.21 Стабилизатор напряжения

2.21.1 Стабилизатор переменного напряжения трехфазный с товарным знаком "ШТИЛЬ", производства ЗАО "Тэнси-техно", Россия

 	ООО "ДАЛИ Медикал" Российская Федерация, 143700, МО, г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, ш. Рижское, д.1Д, помещ. 1 тел. 8(495)215-09-15 info@dali-medical.com	
	Комплекс рентгеновский диагностический цифровой «ЕВО» по ТУ 26.60.11-005-34910593-2022 вариант исполнения: 0X Заводской номер № XXXXXXXXX	
	Стабилизатор напряжения (Стабилизатор переменного напряжения трехфазный) с товарным знаком "ШТИЛЬ" Производитель: ЗАО "Тэнси-техно", Россия	

Применяемость: вариант исполнения 01, вариант исполнения 02, вариант исполнения 03

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

36 (тридцать шесть) листов

Ген директор

ООО «ДАЛИ Медикал»




Янюк К.А.