



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента регистрации и сертификации

Россия и СНГ



ООО «ДжиИ Хэлскеа»

А.П. Харитонов

2024 г

Фотографические изображения

«Система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии / компьютерной томографии StarGuide с принадлежностями»

Производства:

«ДжиИ Медикал Системз Израиль, Фанкшинл Имэджинг», Израиль / GE Medical Systems Israel, Functional Imaging



Рис. 1. Гантри ОФЭКТ (не менее 1 шт.).



Рис. 2. Гантри ОФЭКТ (не менее 1 шт.).

GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD.
West Area of Building No.3, No.1 Yongchang North Road,
Beijing Economic and Technological Development Area,
BEIJING 100176 CHINA

GANTRY

REF MODEL: 5432539-65

SN SERIAL: 751259HM3

 **MANUFACTURED: JANUARY 2023**

**COMPLIES WITH RADIATION PERFORMANCE STANDARDS,
21 CFR SUBCHAPTER J.**

Рис. 3. Гантри ОФЭКТ. Маркировка на изделии

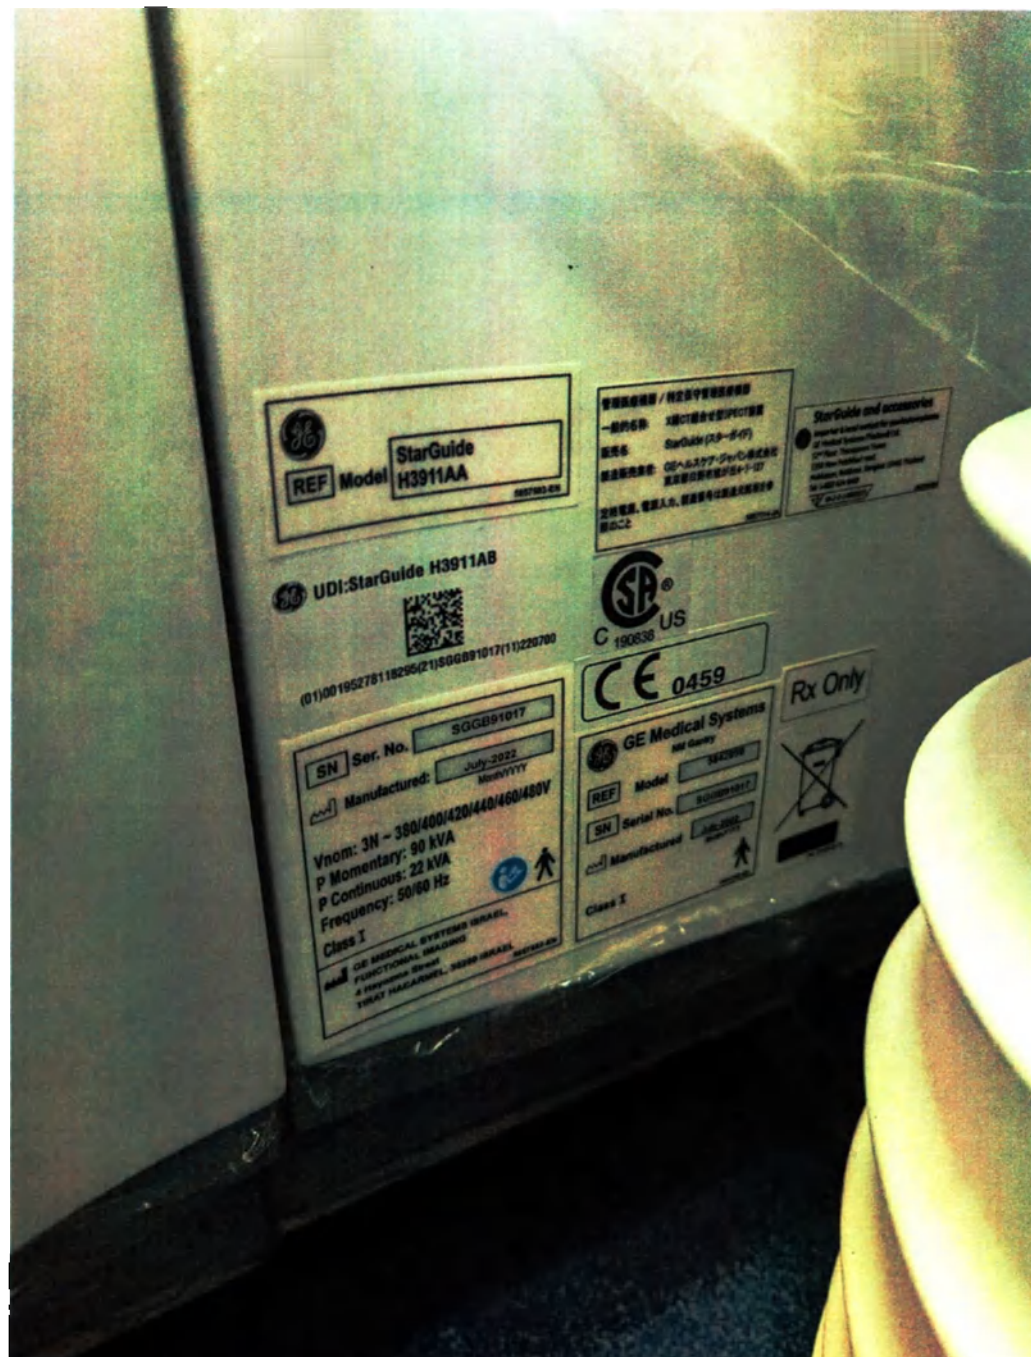


Рис. 4. Гантри ОФЭКТ. Маркировка на изделии

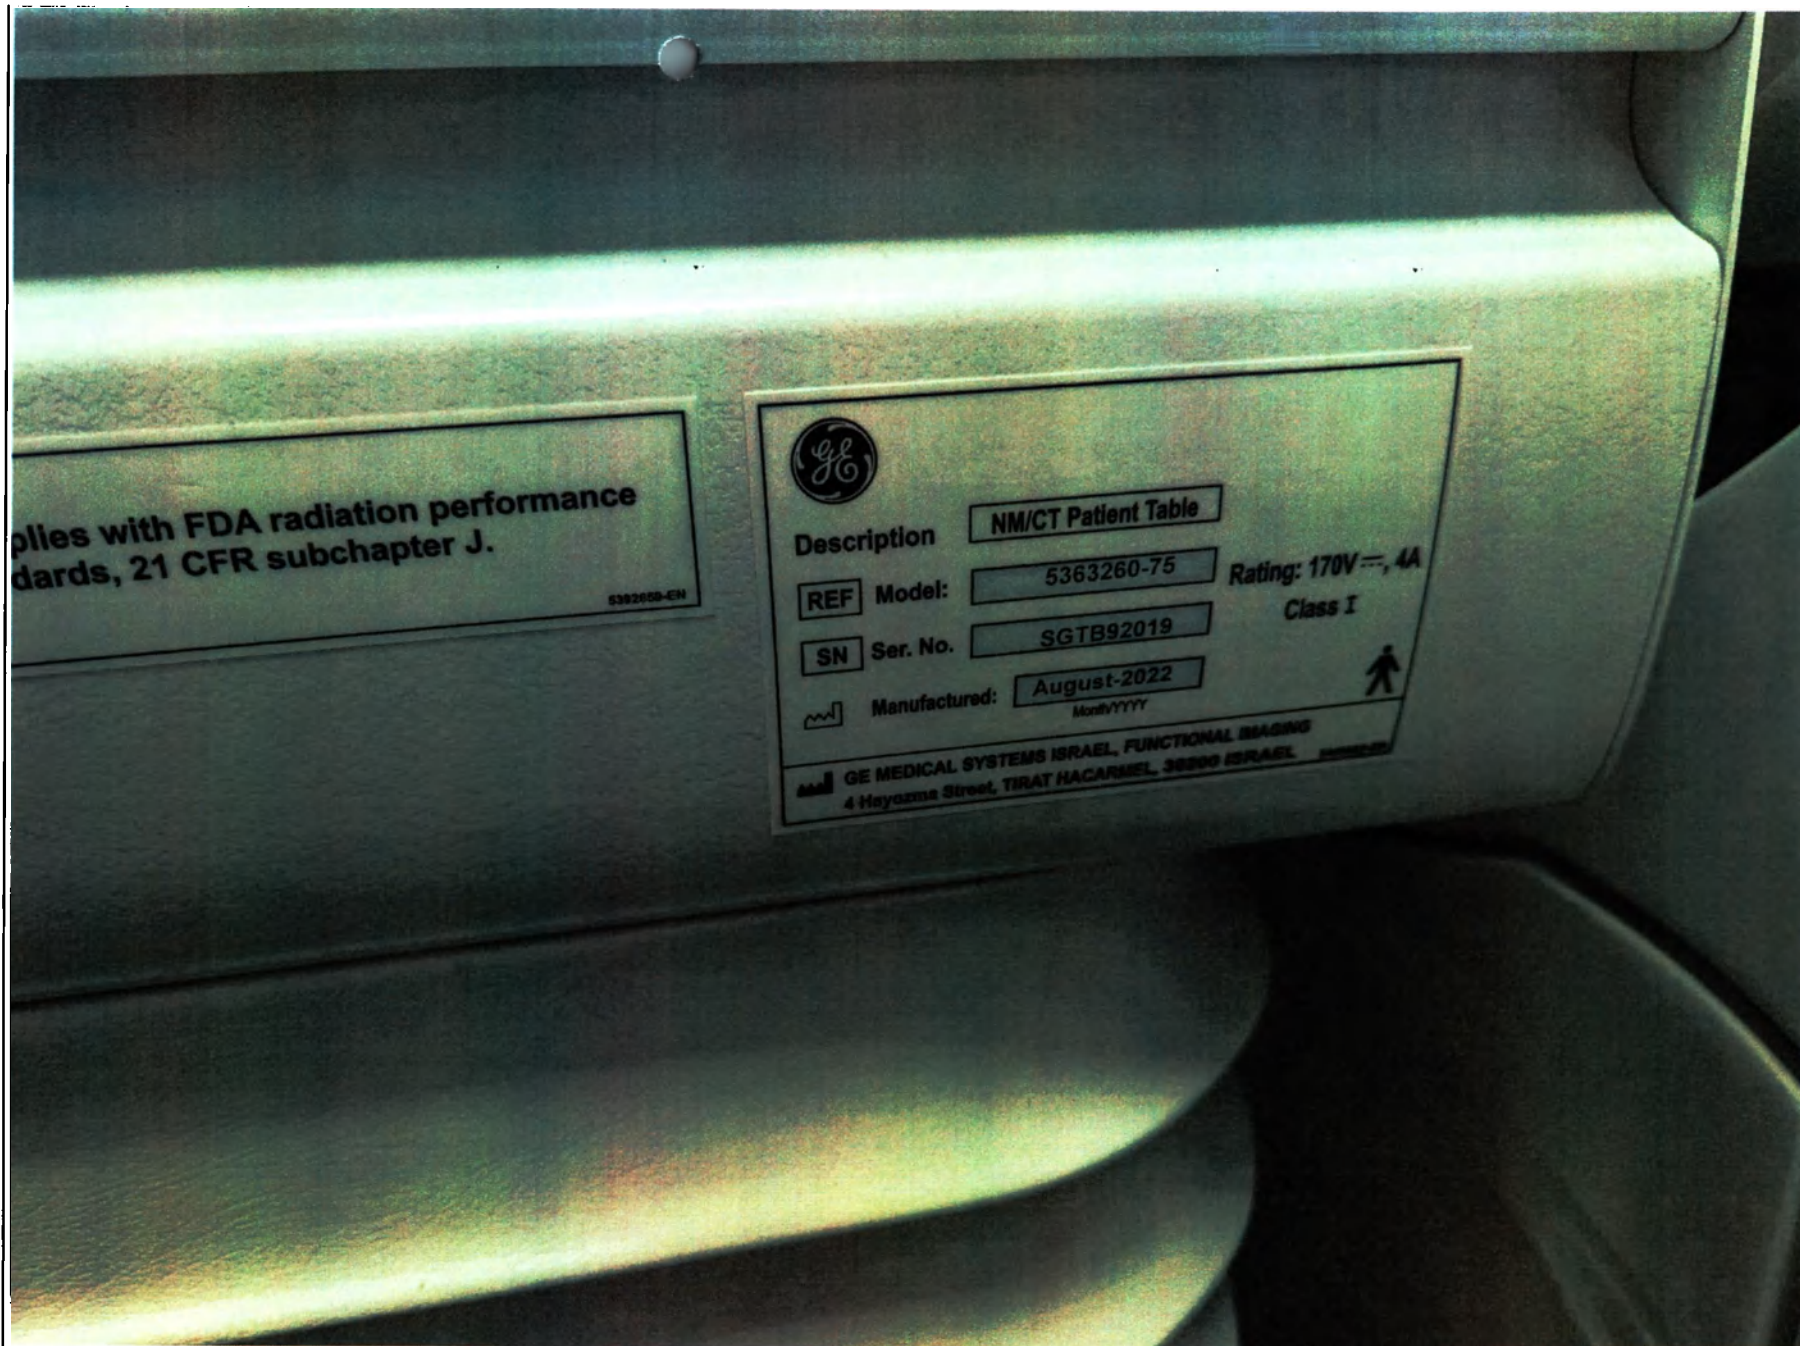


Рис. 5. Гантри ОФЭКТ. Маркировка на изделии

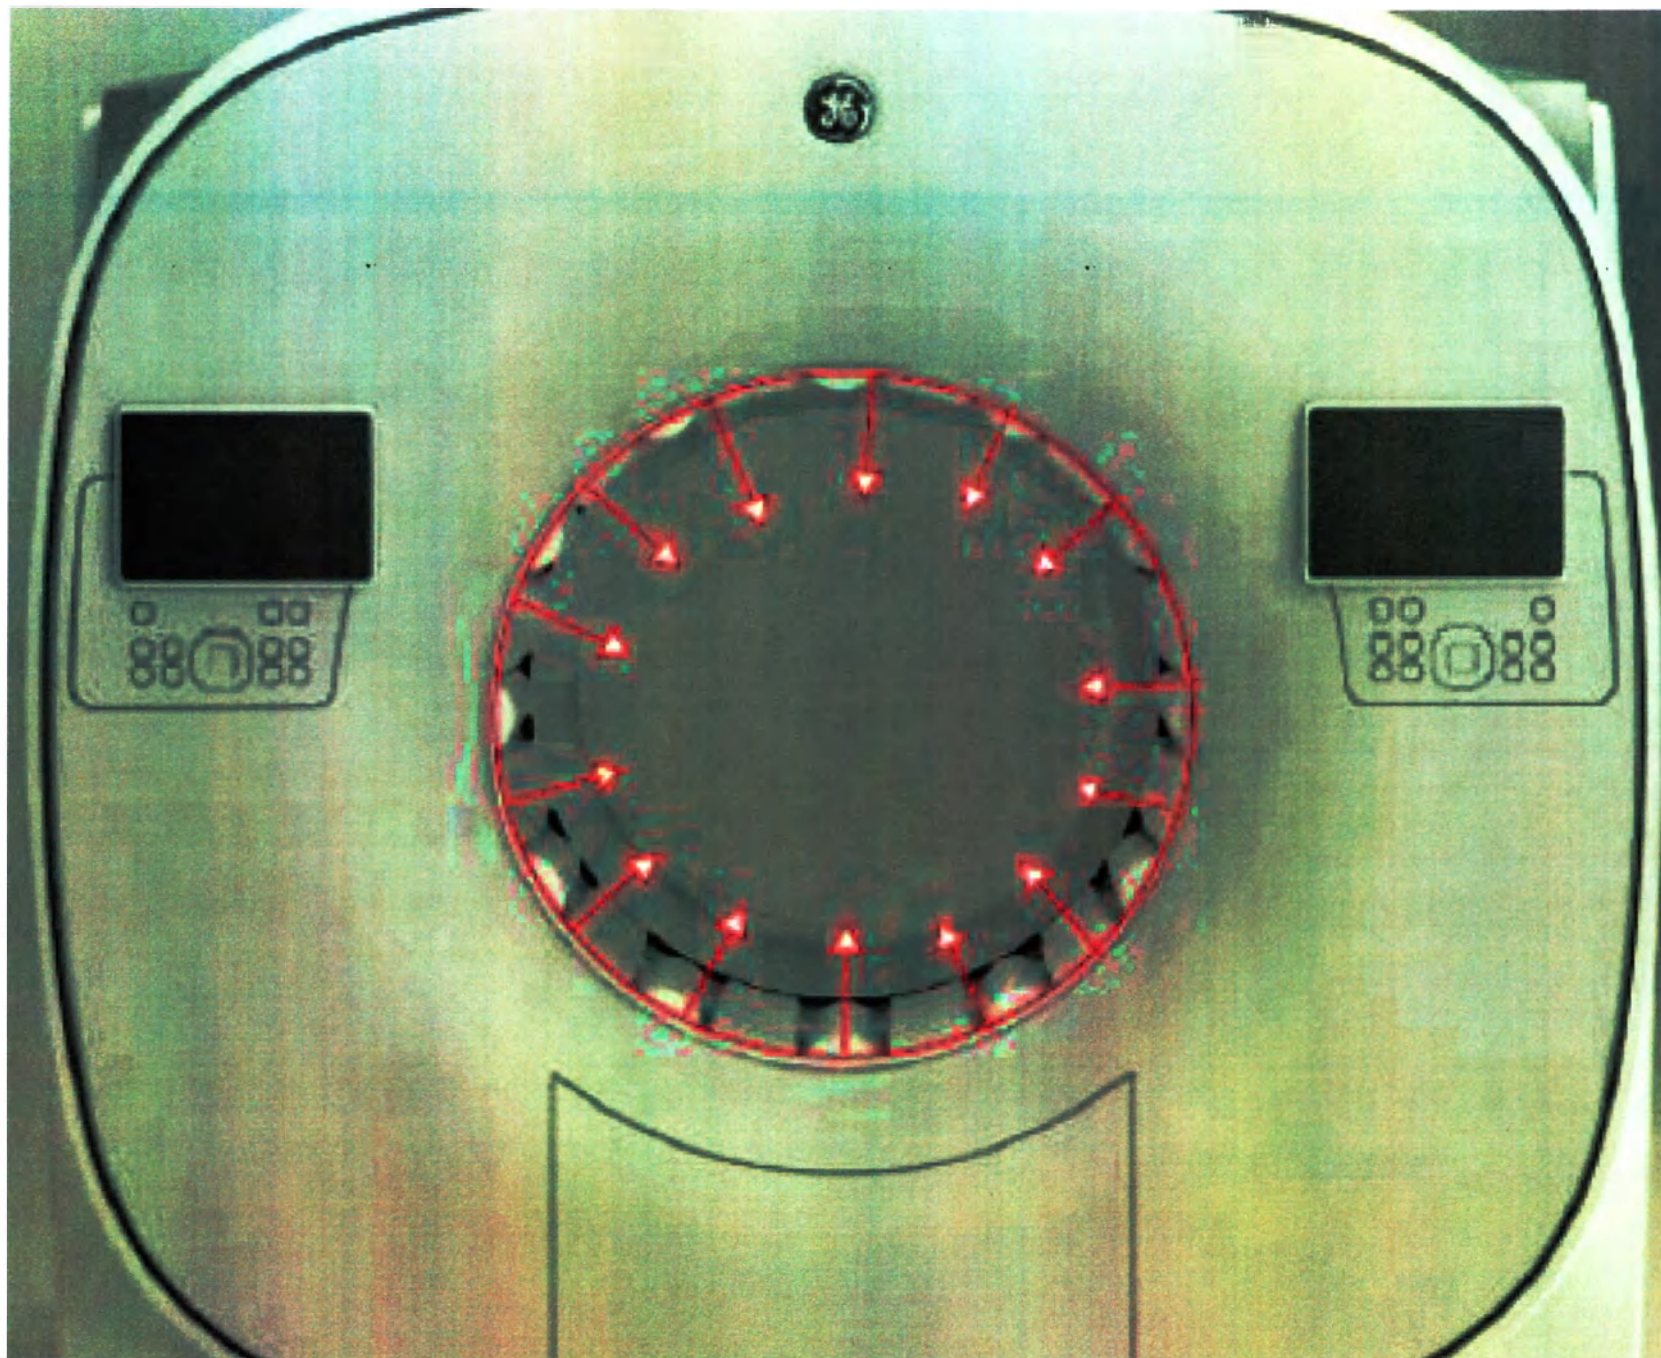


Рис. 6. Модули и детекторы ОФЭКТ на основе CdZnTe (не более 20 шт.).

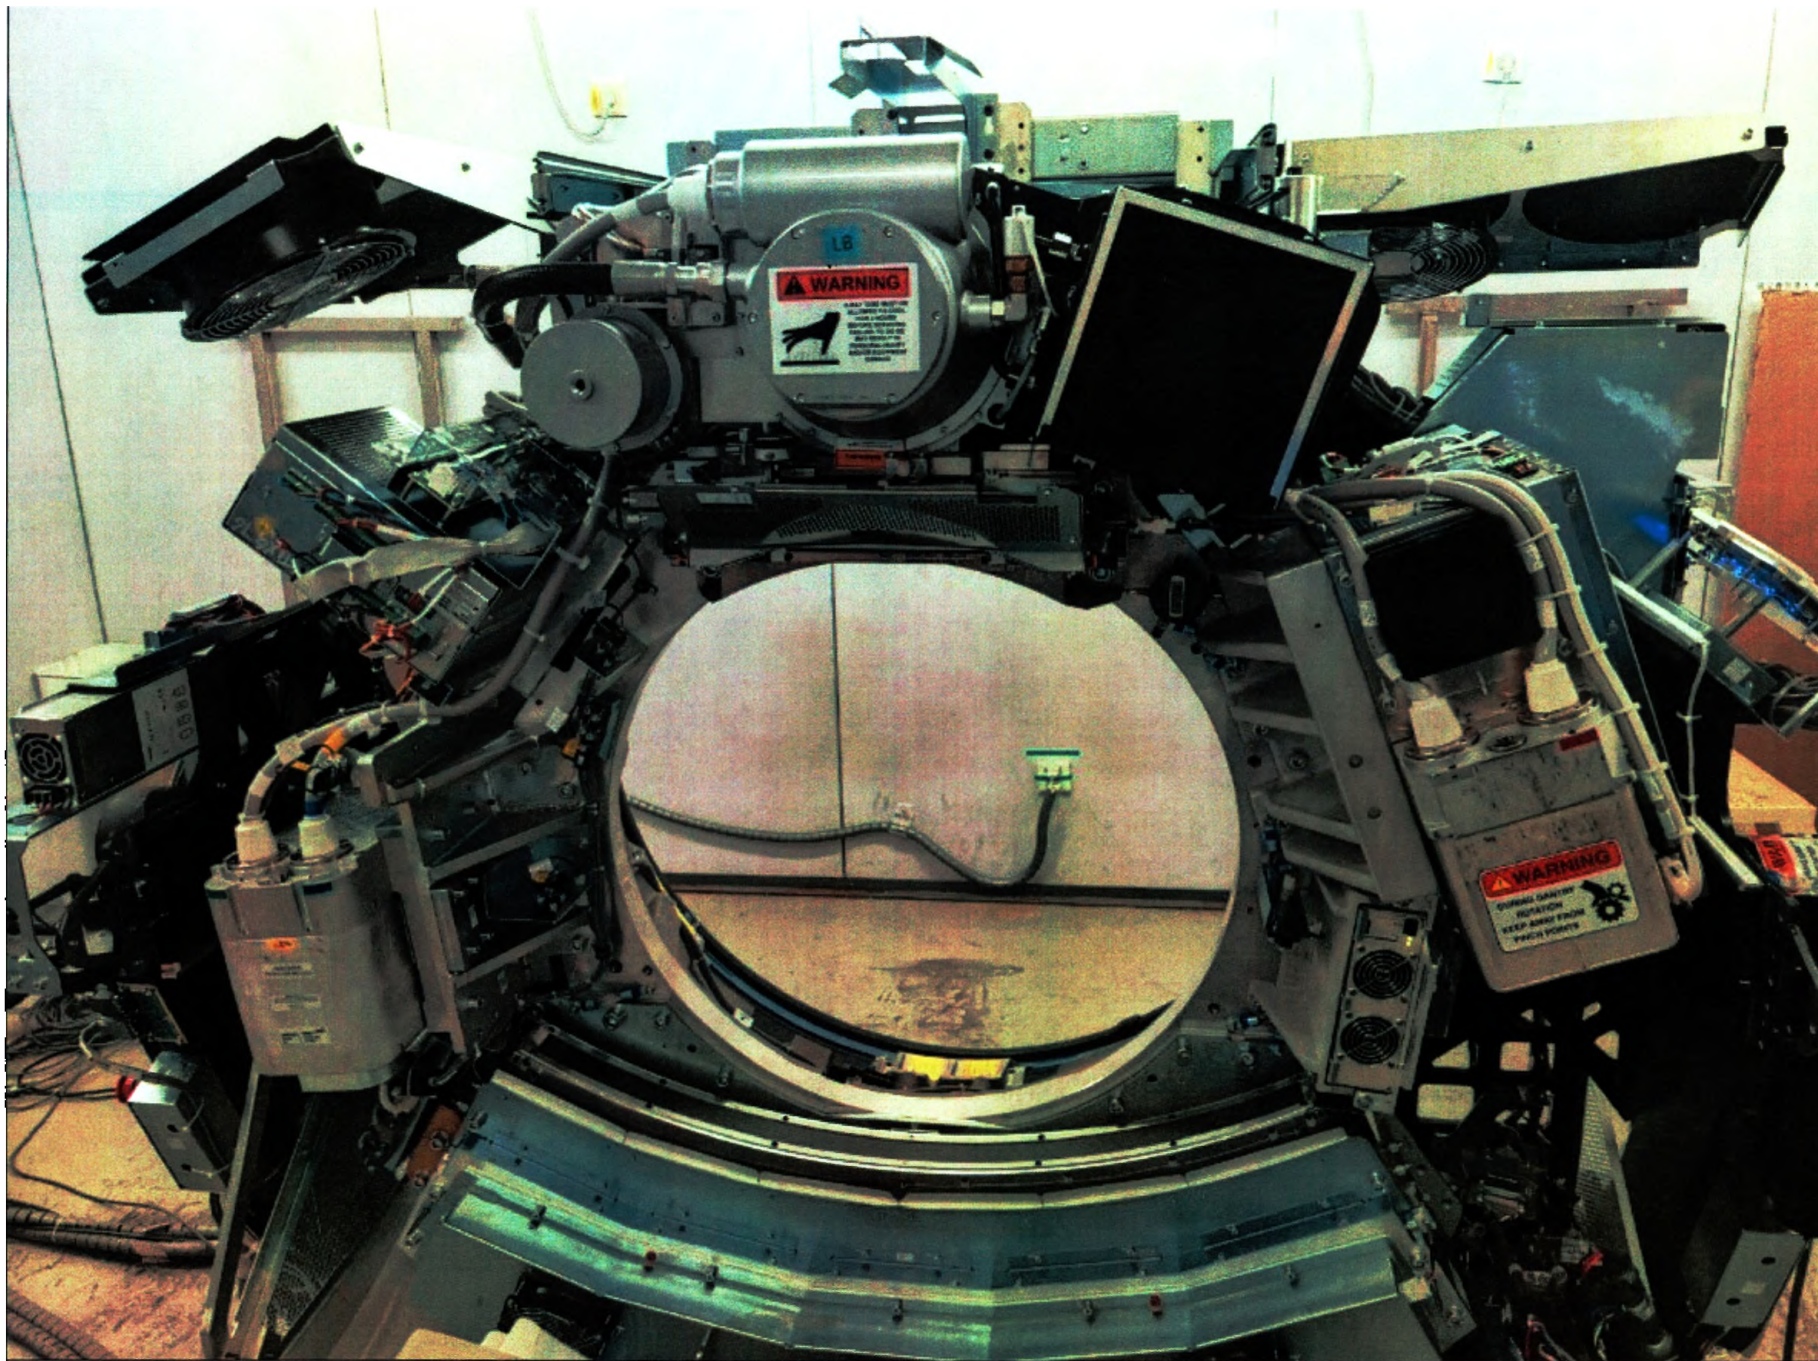


Рис. 7. КТ-подсистема Optima CT 540 (1 шт.).

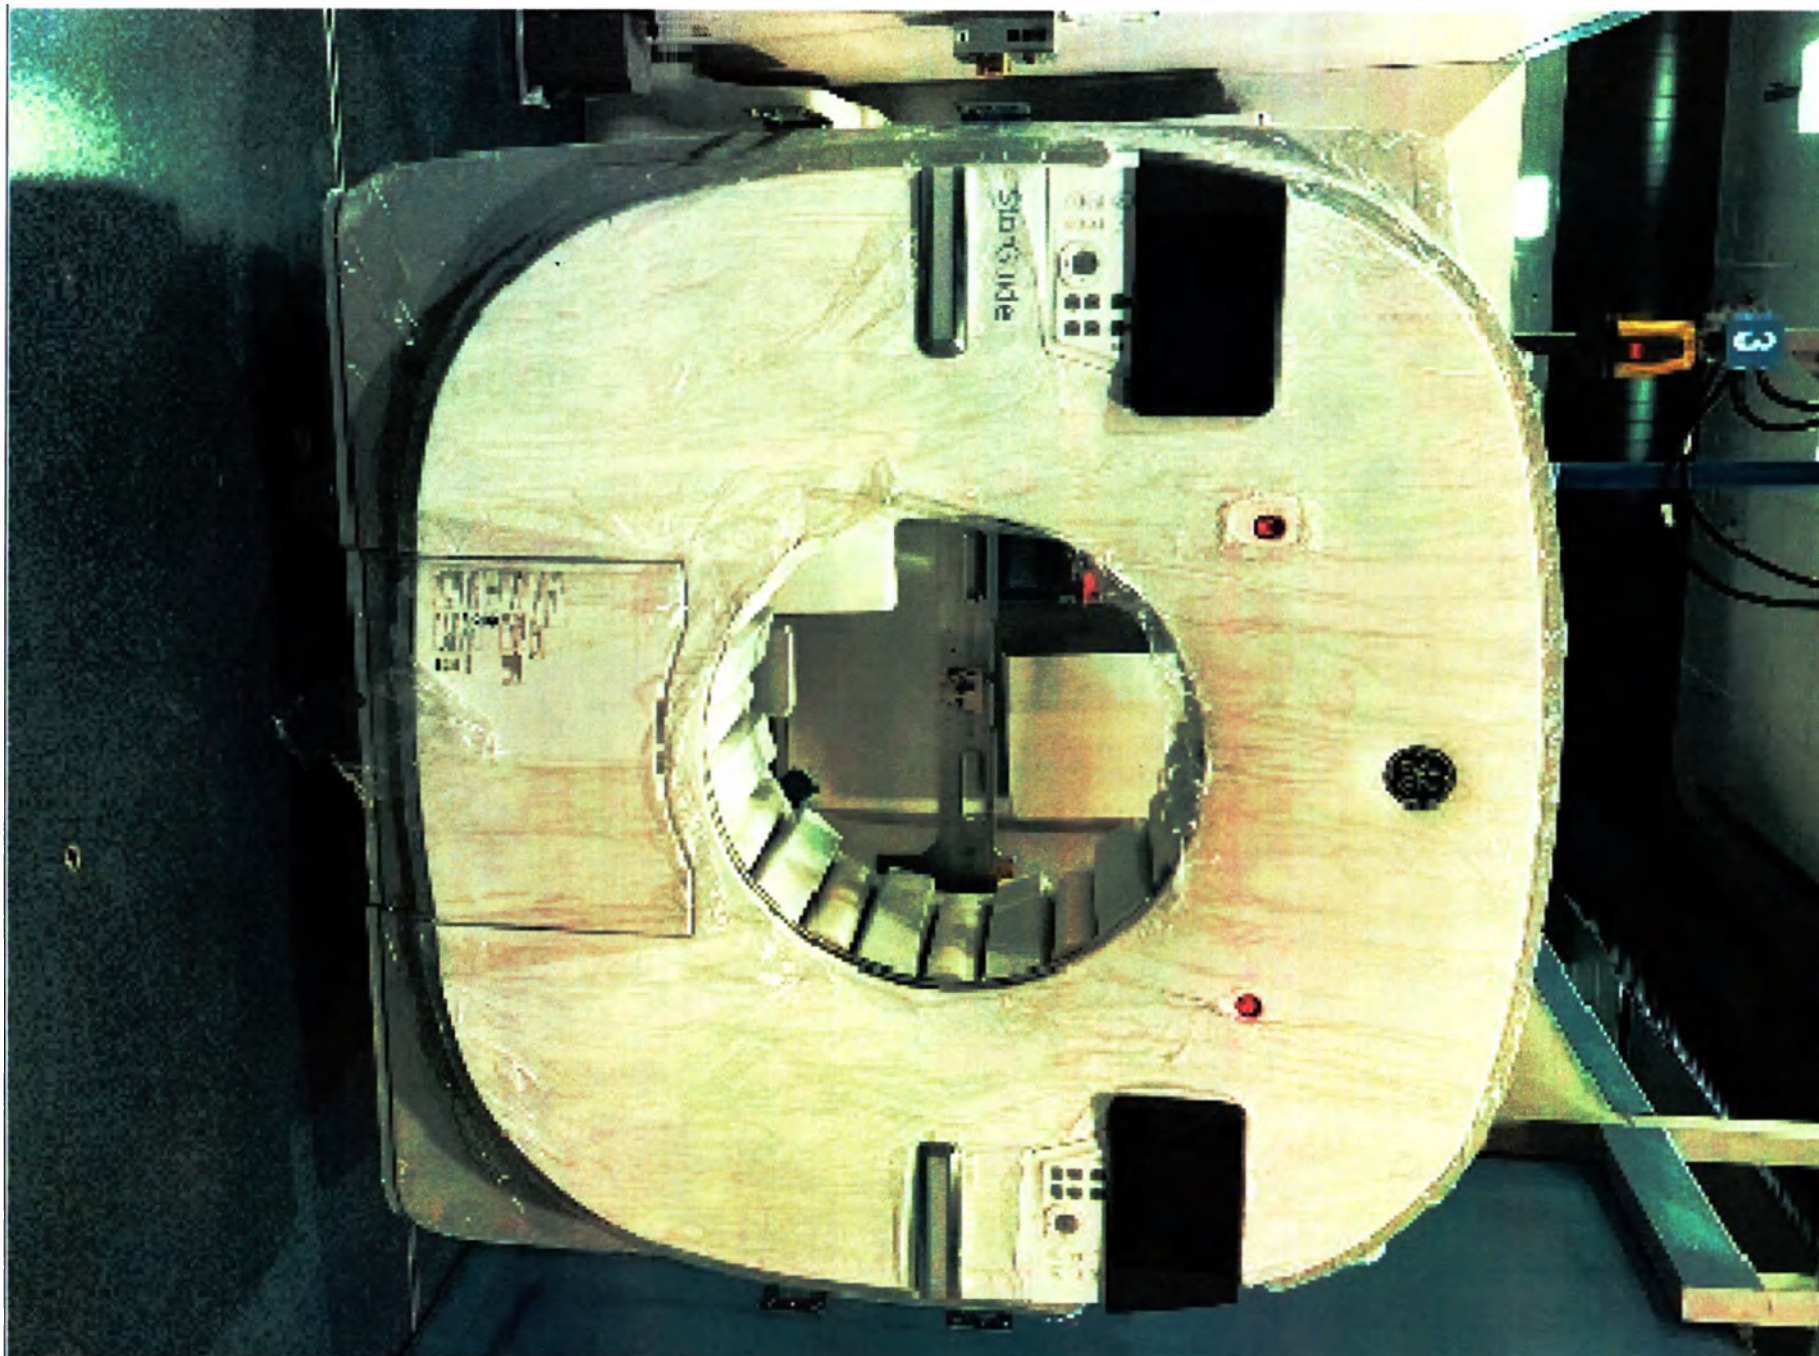


Рис. 8. КТ-подсистема Optima CT 540 (1 шт.).

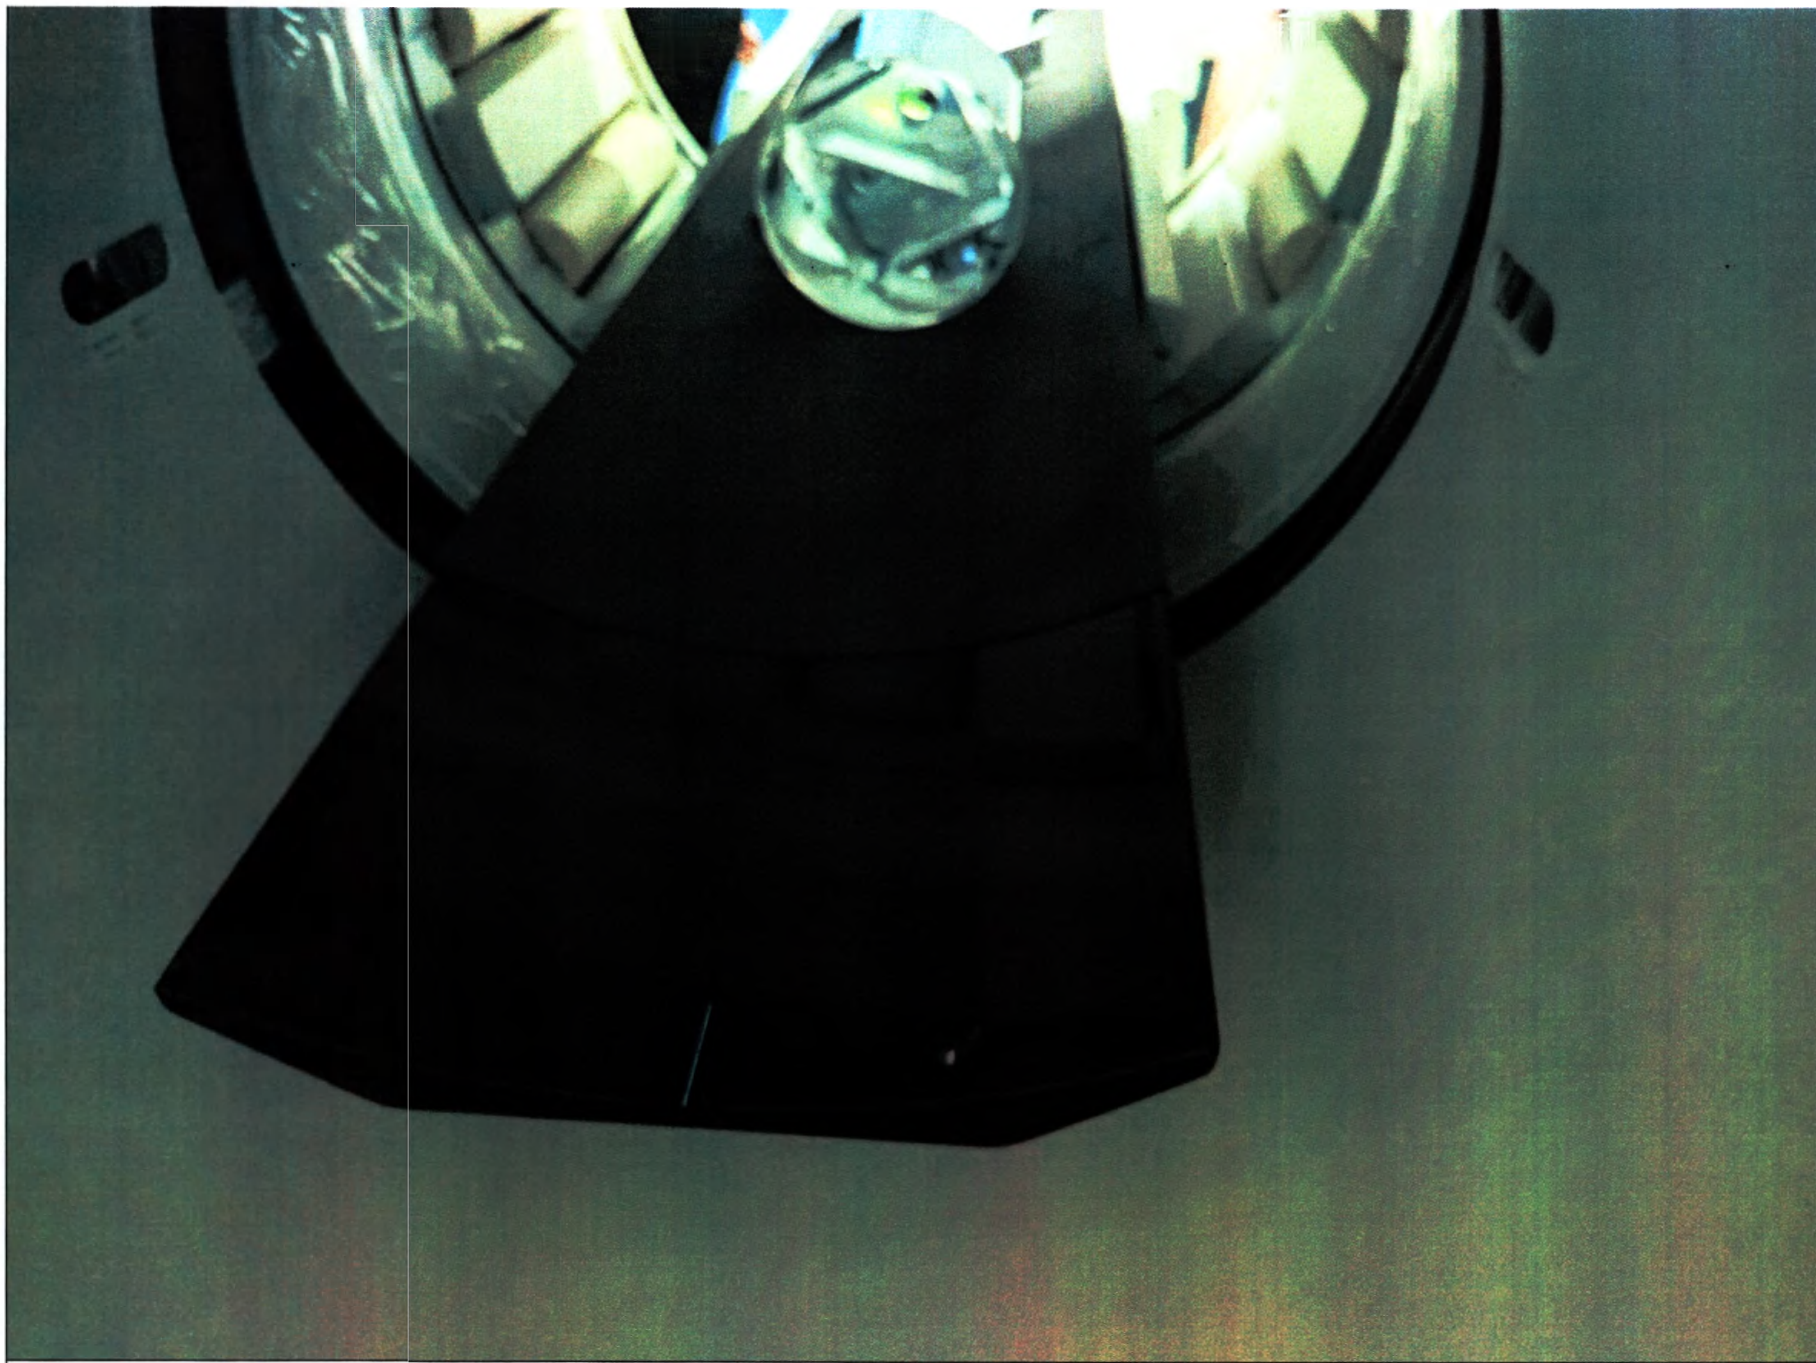


Рис. 9. Стол для пациента (1 шт.).



Рис. 10. Блок распределения питания (не более 4 шт.).



Рис. 11. Блок распределения питания для КТ-подсистемы (не более 3 шт.).

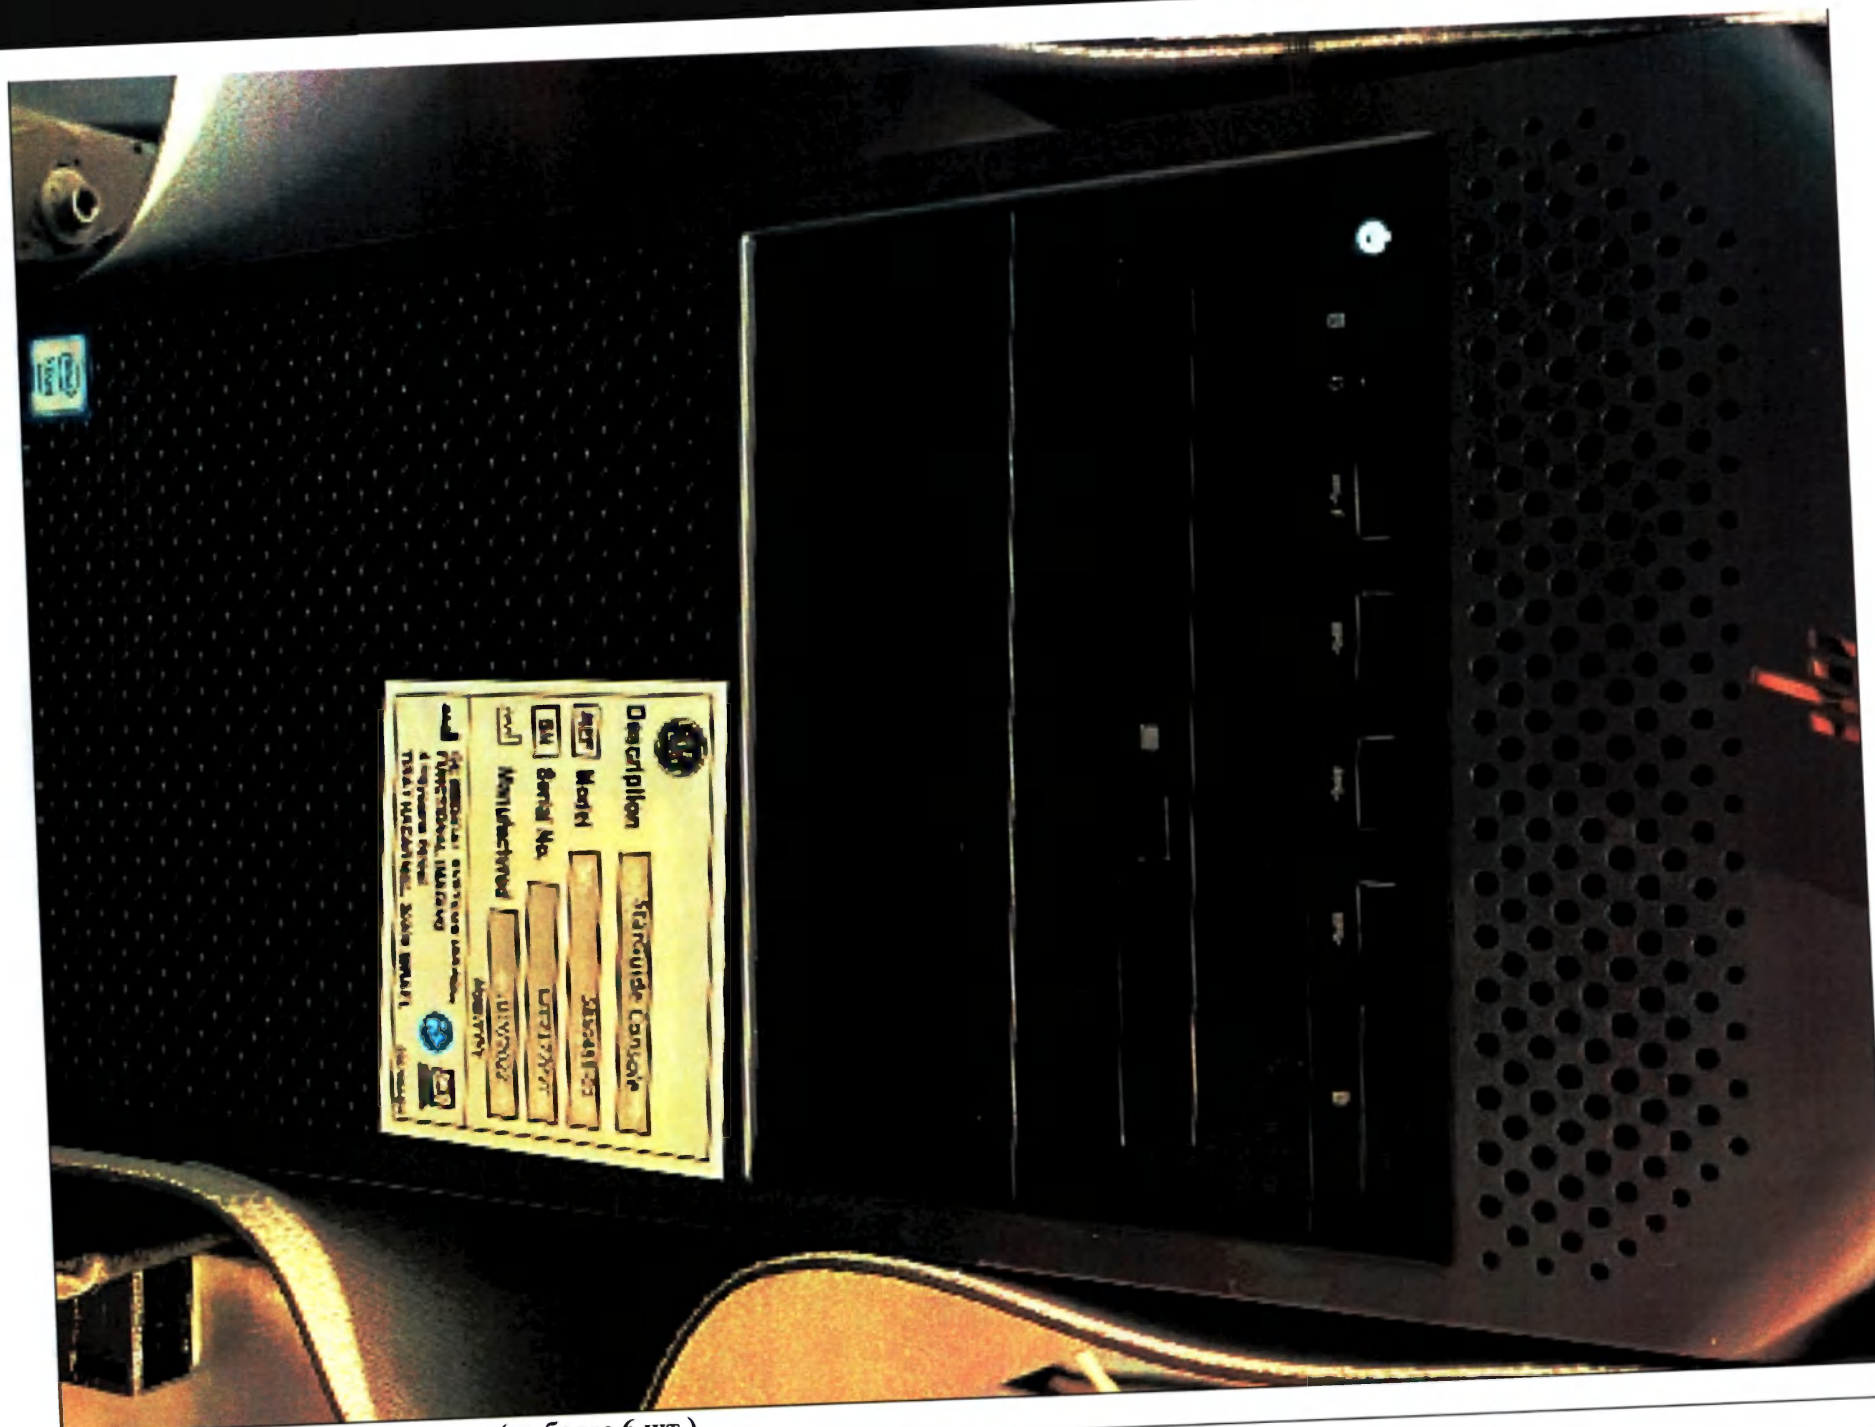


Рис. 12. Пульт управления (не более 6 шт.).

Система StarGuide

Руководство оператора



5850487-1RU
Редакция 5
© 2021 г. General Electric Company
Все права защищены.

Общие сведения о документации. Все права защищены General Electric Company. Собственность GE. Воспроизведение или распространение запрещено.

Рис. 13. Руководства пользователя (не более 40 шт.).



Рис. 14. Монитор пульта управления (не более 6 шт.).



Рис. 15. Дисплей для управления системой (не более 6 шт.).



Рис. 16. Дисплей для управления системой (не более 6 шт.).



Рис. 17. Кабели питания (не более 8 шт.).



Рис. 18. Кабели соединительные (не более 10 шт.).

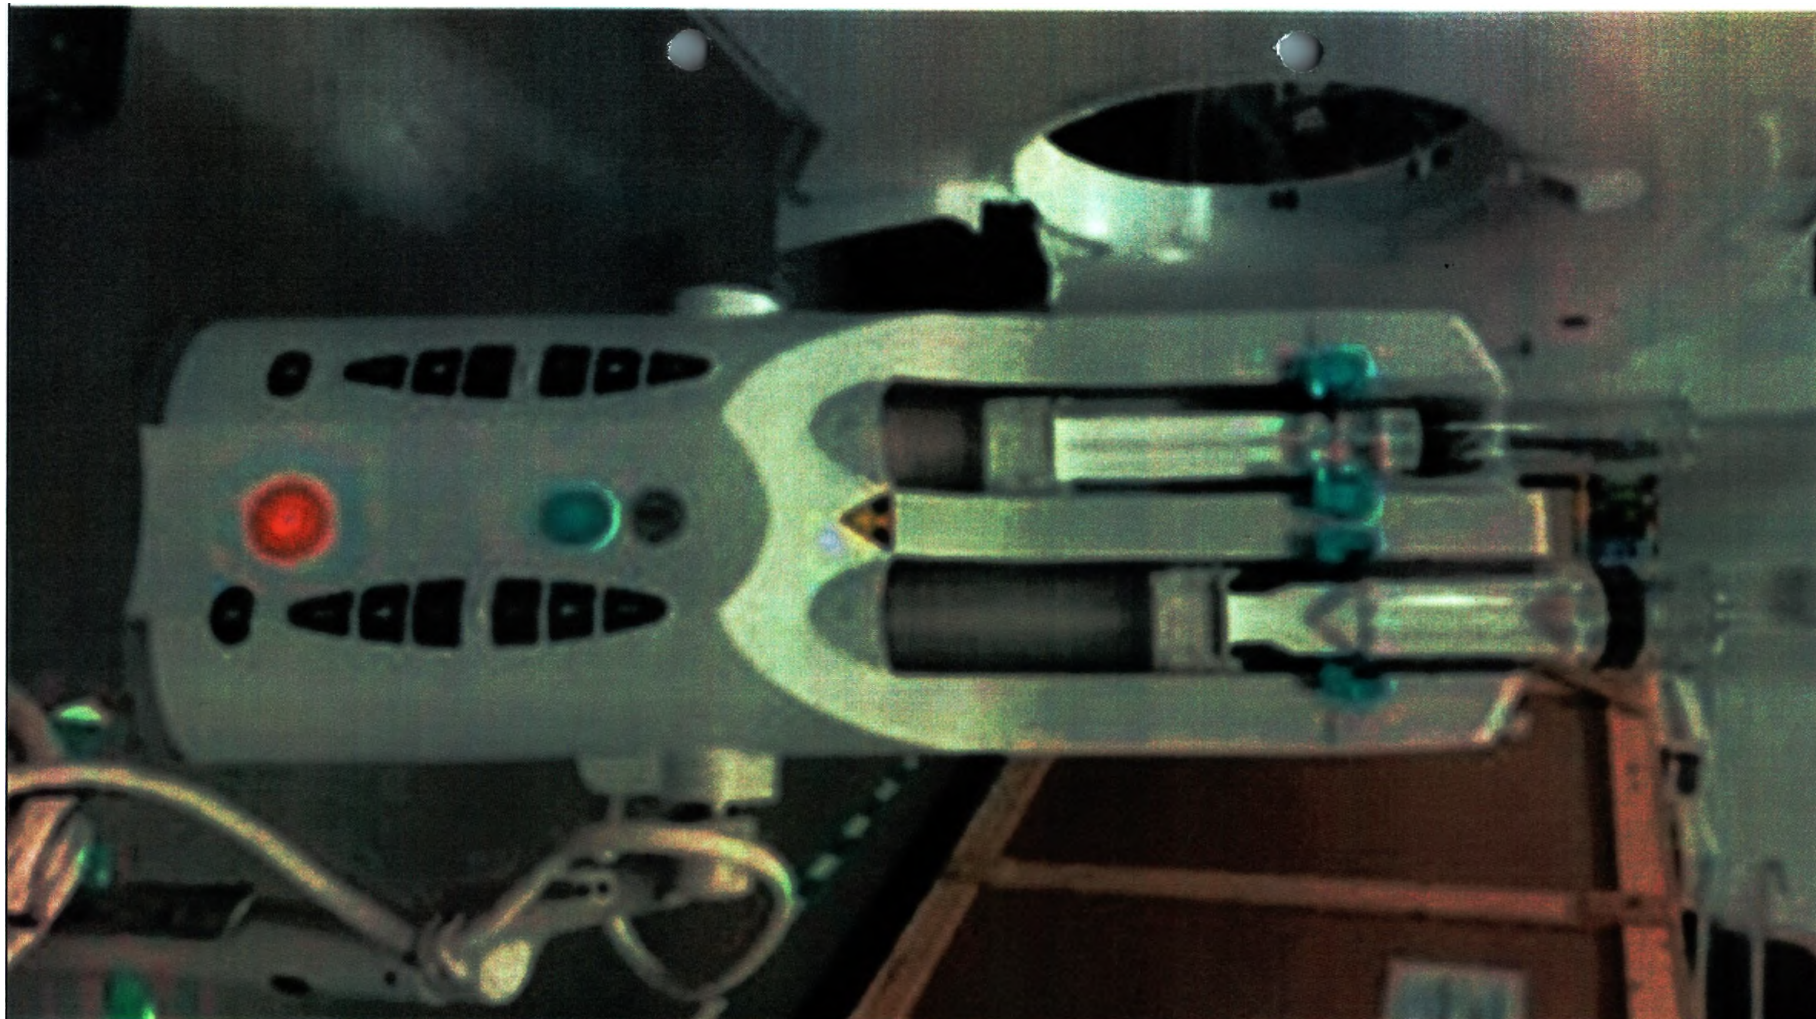


Рис. 19. Инъектор контрастного вещества MEDRAD (не более 10 шт.)



Рис. 20. Инъектор контрастного вещества MEDRAD (не более 10 шт.)



Рис. 21. Инъектор контрастного вещества MEDRAD (не более 10 шт.)



Рис. 22. Мониторы кардиосинхронизации IVY 7600 (не более 4 шт.)



Рис. 23. Мониторы кардиосинхронизации IVY 7600 (не более 4 шт.)

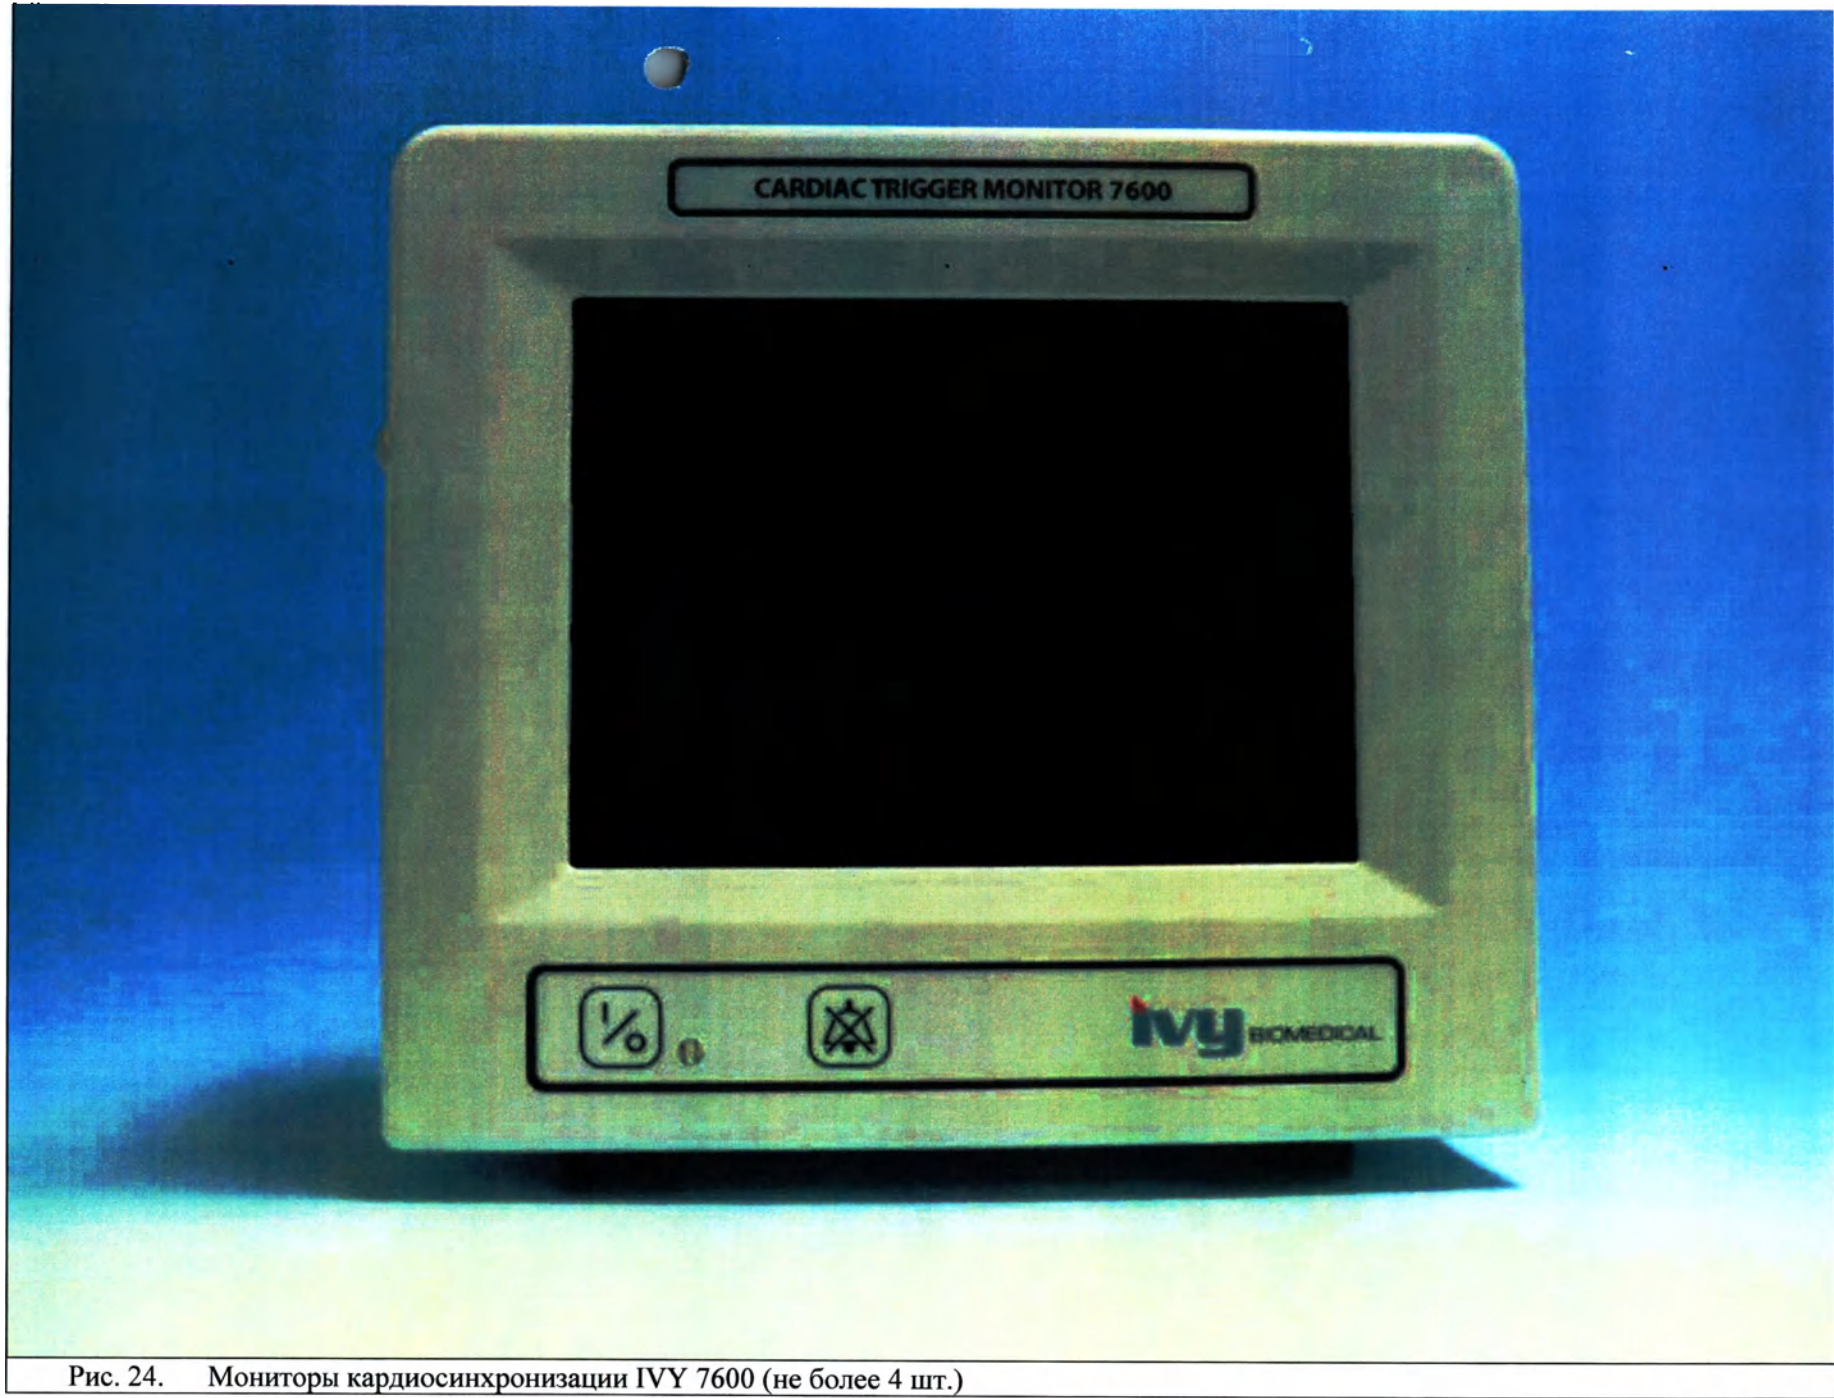


Рис. 24. Мониторы кардиосинхронизации IVY 7600 (не более 4 шт.)



Рис. 25. Кабели для монитора кардиосинхронизации (не более 6 шт.).



Рис. 26. Стресс-система



Рис. 27. Принадлежности для введения контрастных препаратов (не более 20 шт.), в составе:– Шприц 190 мл. с трубкой быстрого наполнения,– Трубки удлинительные для системы инъекционной,– Шприц стерильный одноразовый.



Рис. 28. Принадлежности для введения контрастных препаратов (не более 20 шт.), в составе:– Шприц 190 мл. с трубкой быстрого наполнения,– Трубки удлинительные для системы инъекционной,– Шприц стерильный одноразовый.

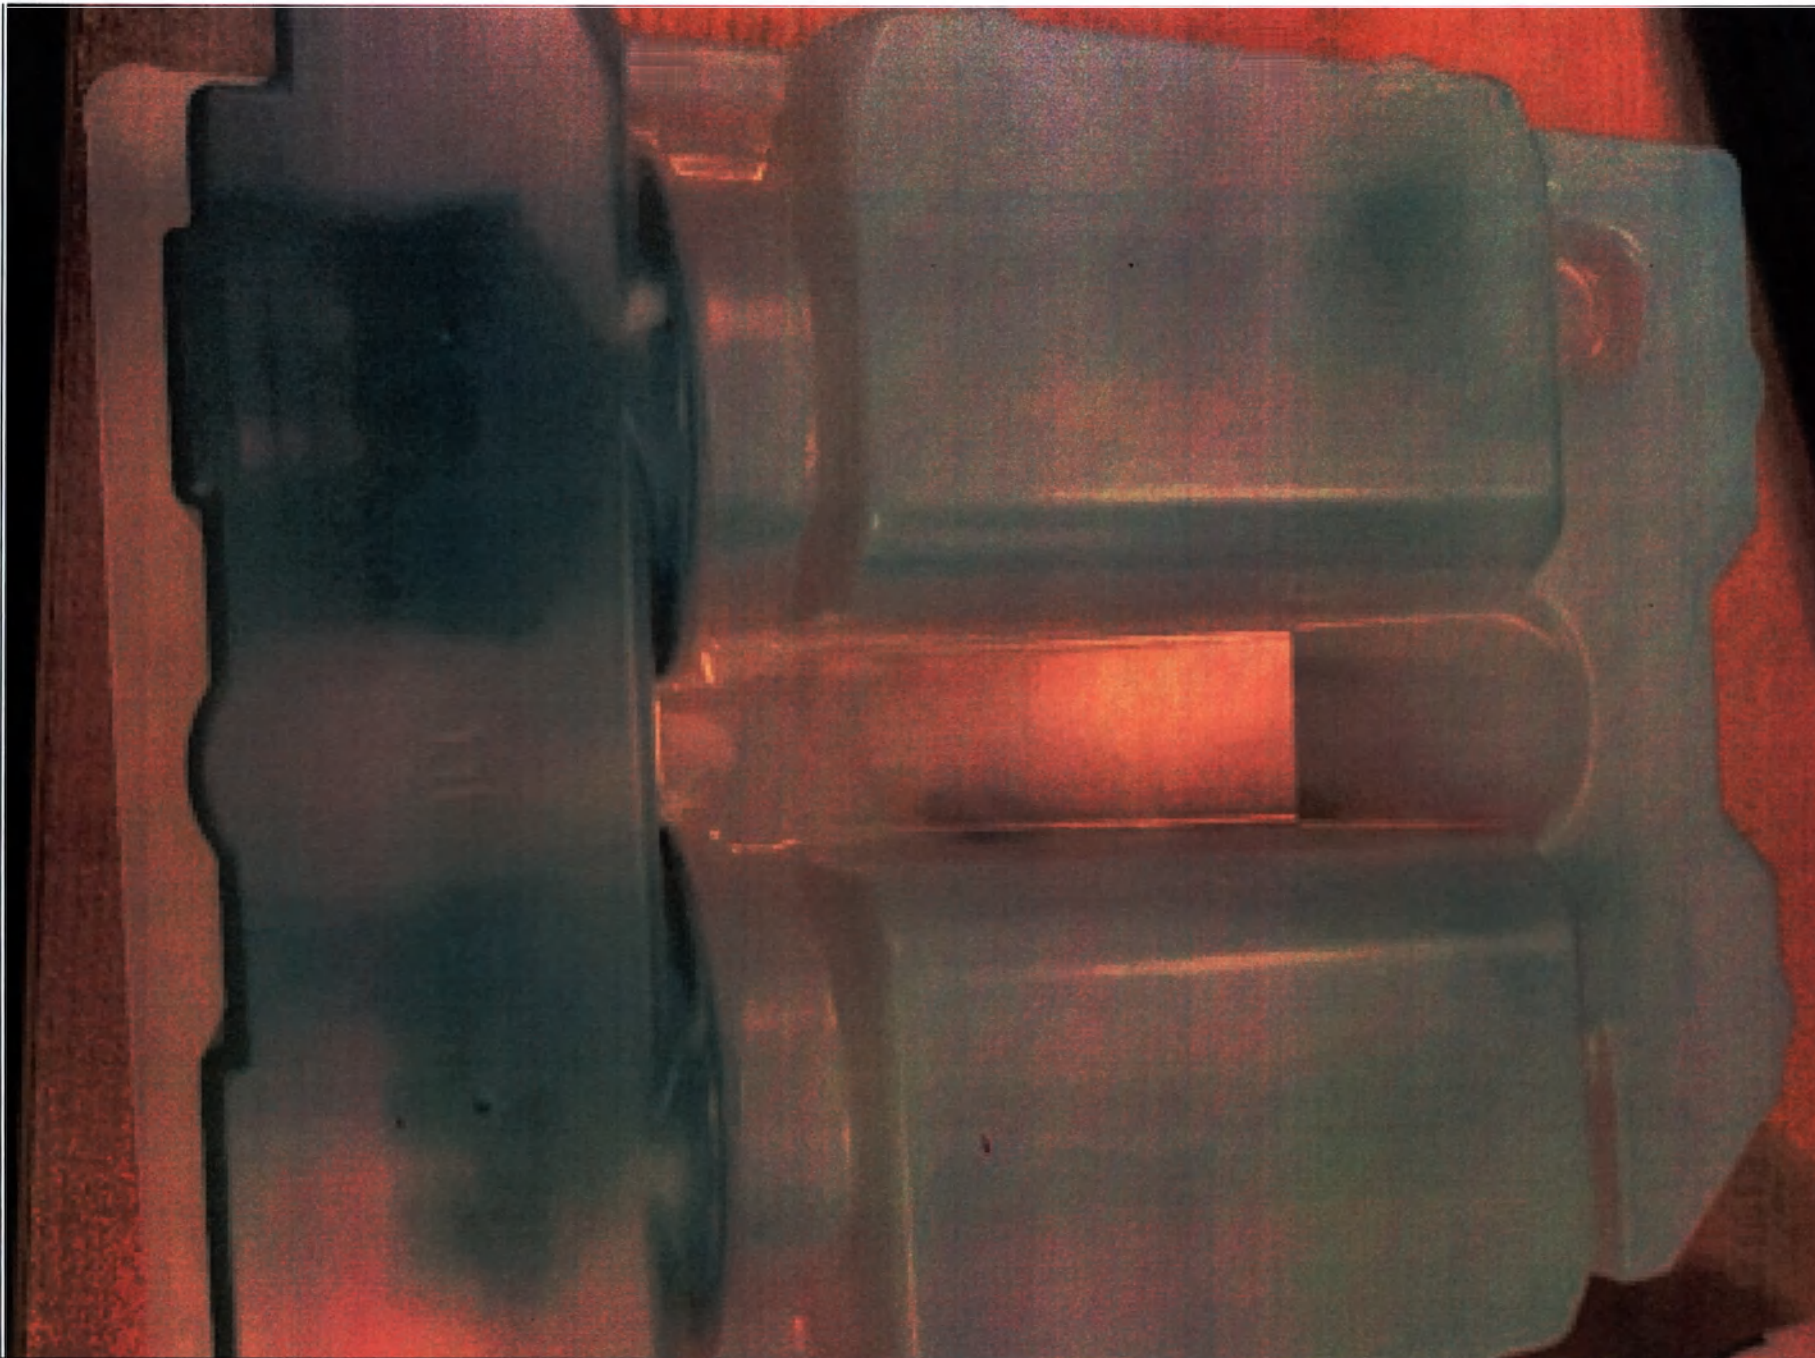


Рис. 29. Принадлежности для введения контрастных препаратов (не более 20 шт.), в составе:– Шприц 190 мл. с трубкой быстрого наполнения,– Трубки удлинительные для системы инъекционной,– Шприц стерильный одноразовый.



Рис. 30. Принадлежности: Блок реконструкции (не более 5 шт.).

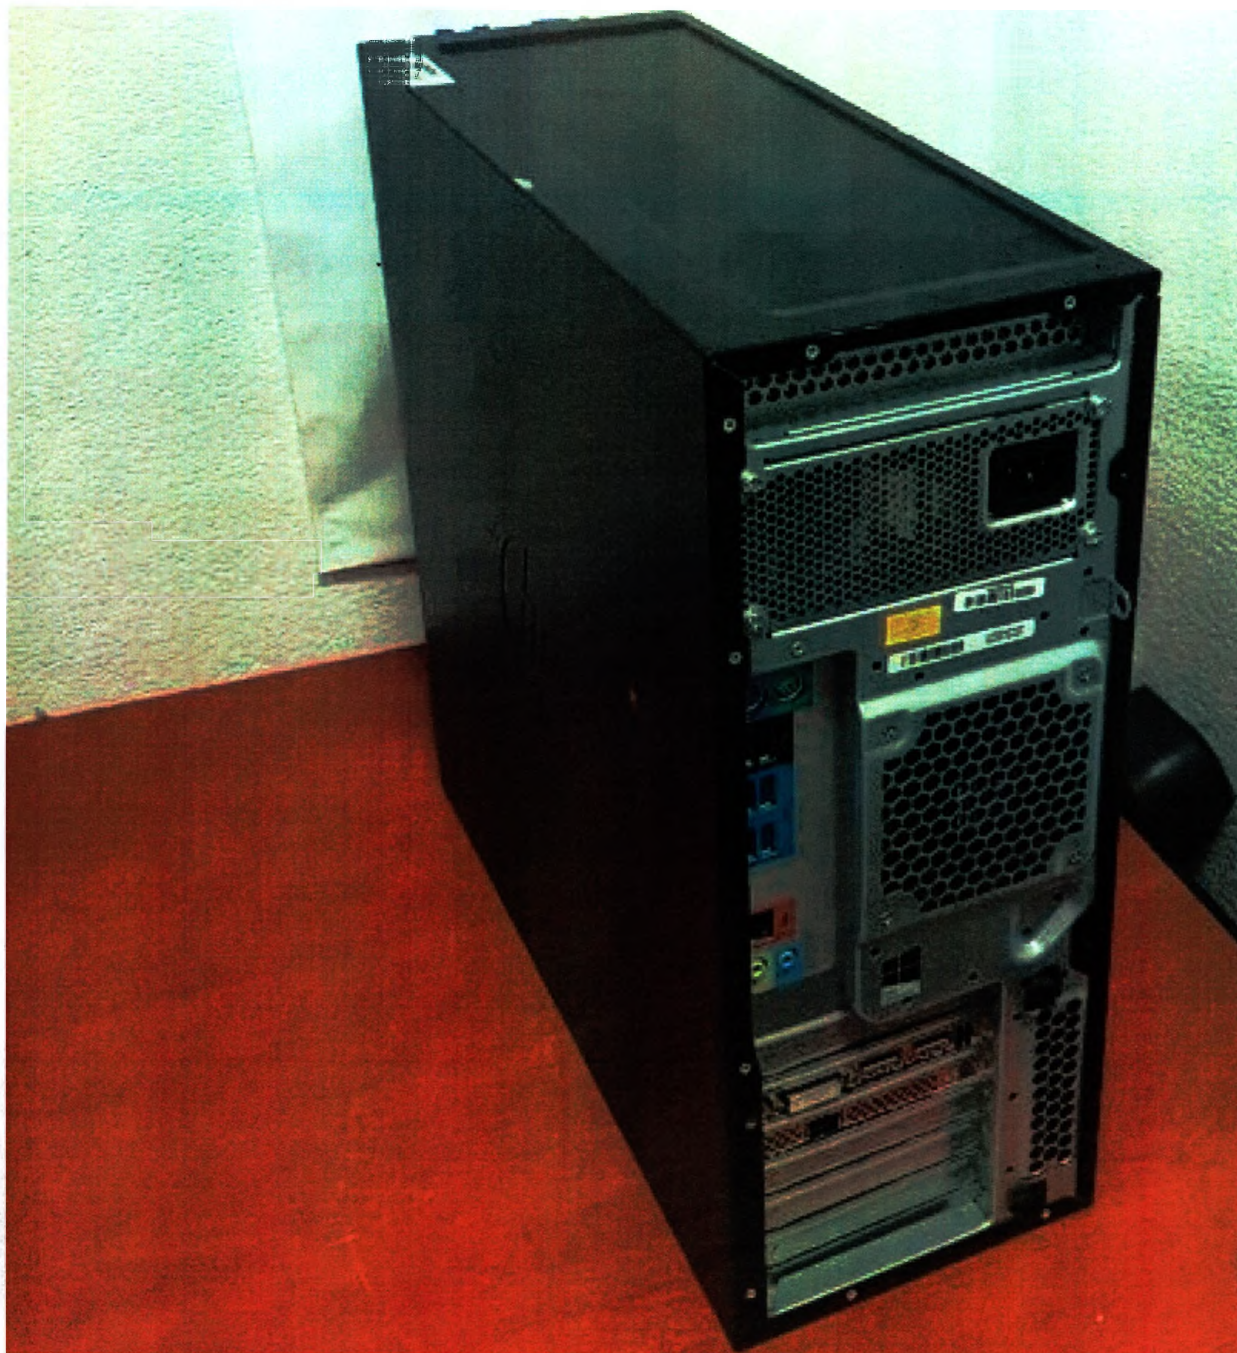


Рис. 31. Блок реконструкции (не более 5 шт.).



Рис. 32. Консоль оператора дополнительная (не более 7 шт.).



Рис. 33. Дополнительный монитор для консоли оператора (не более 7 шт.).



Рис. 34. Панель деки стола удлинительная (не более 5 шт.).

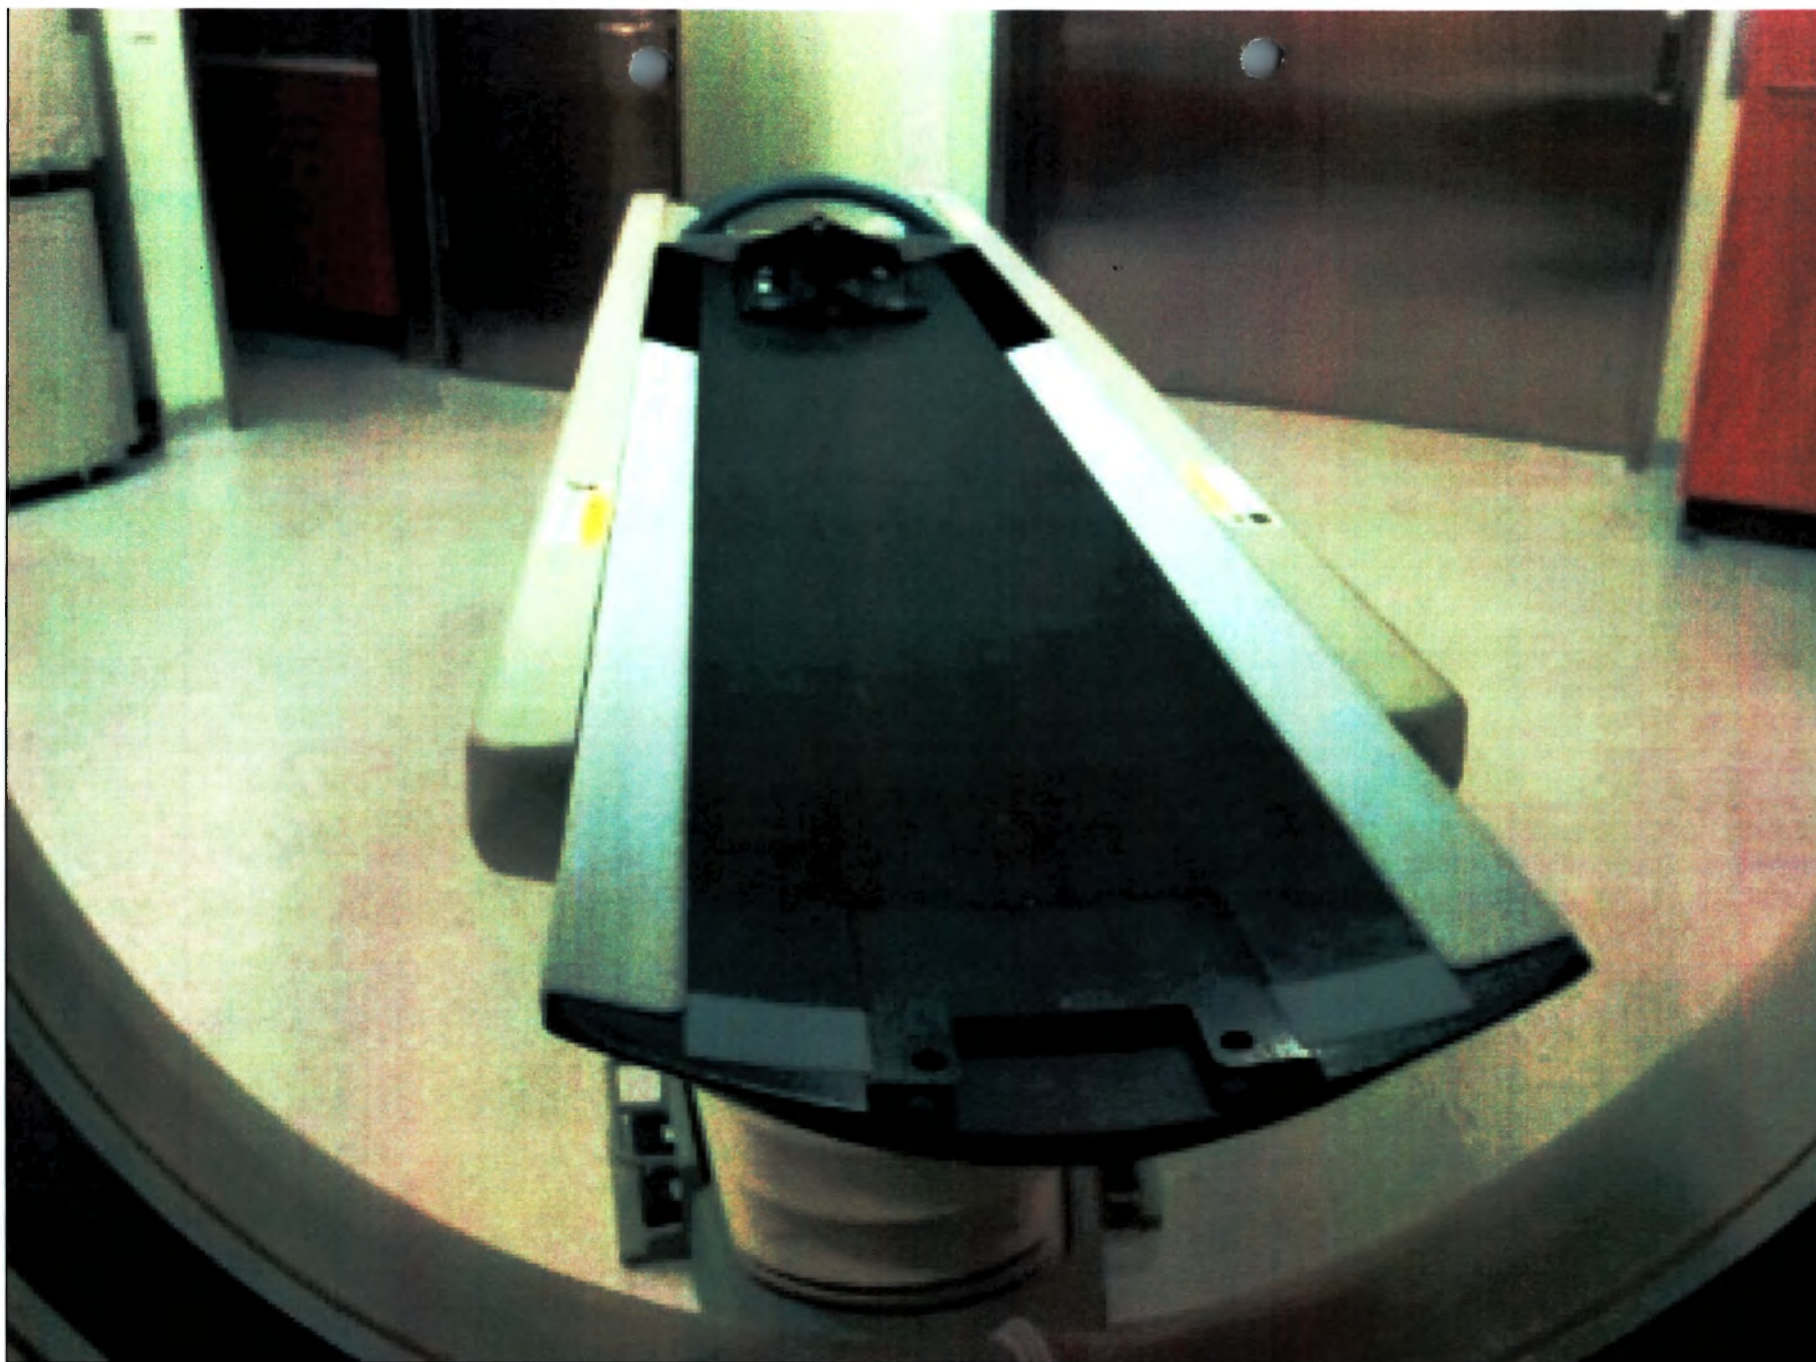


Рис. 35. Деки плоские (не более 2 шт.).



Рис. 36. Линейка боковая. (не более 2 шт.).



Рис. 37. Держатели для головы (не более 5 шт.).



Рис. 38. Держатели для головы (не более 5 шт.).



Рис. 39. Опоры для рук пациента (не более 5 шт.).



Рис. 40. Фиксаторы для рук (не более 5 шт.).

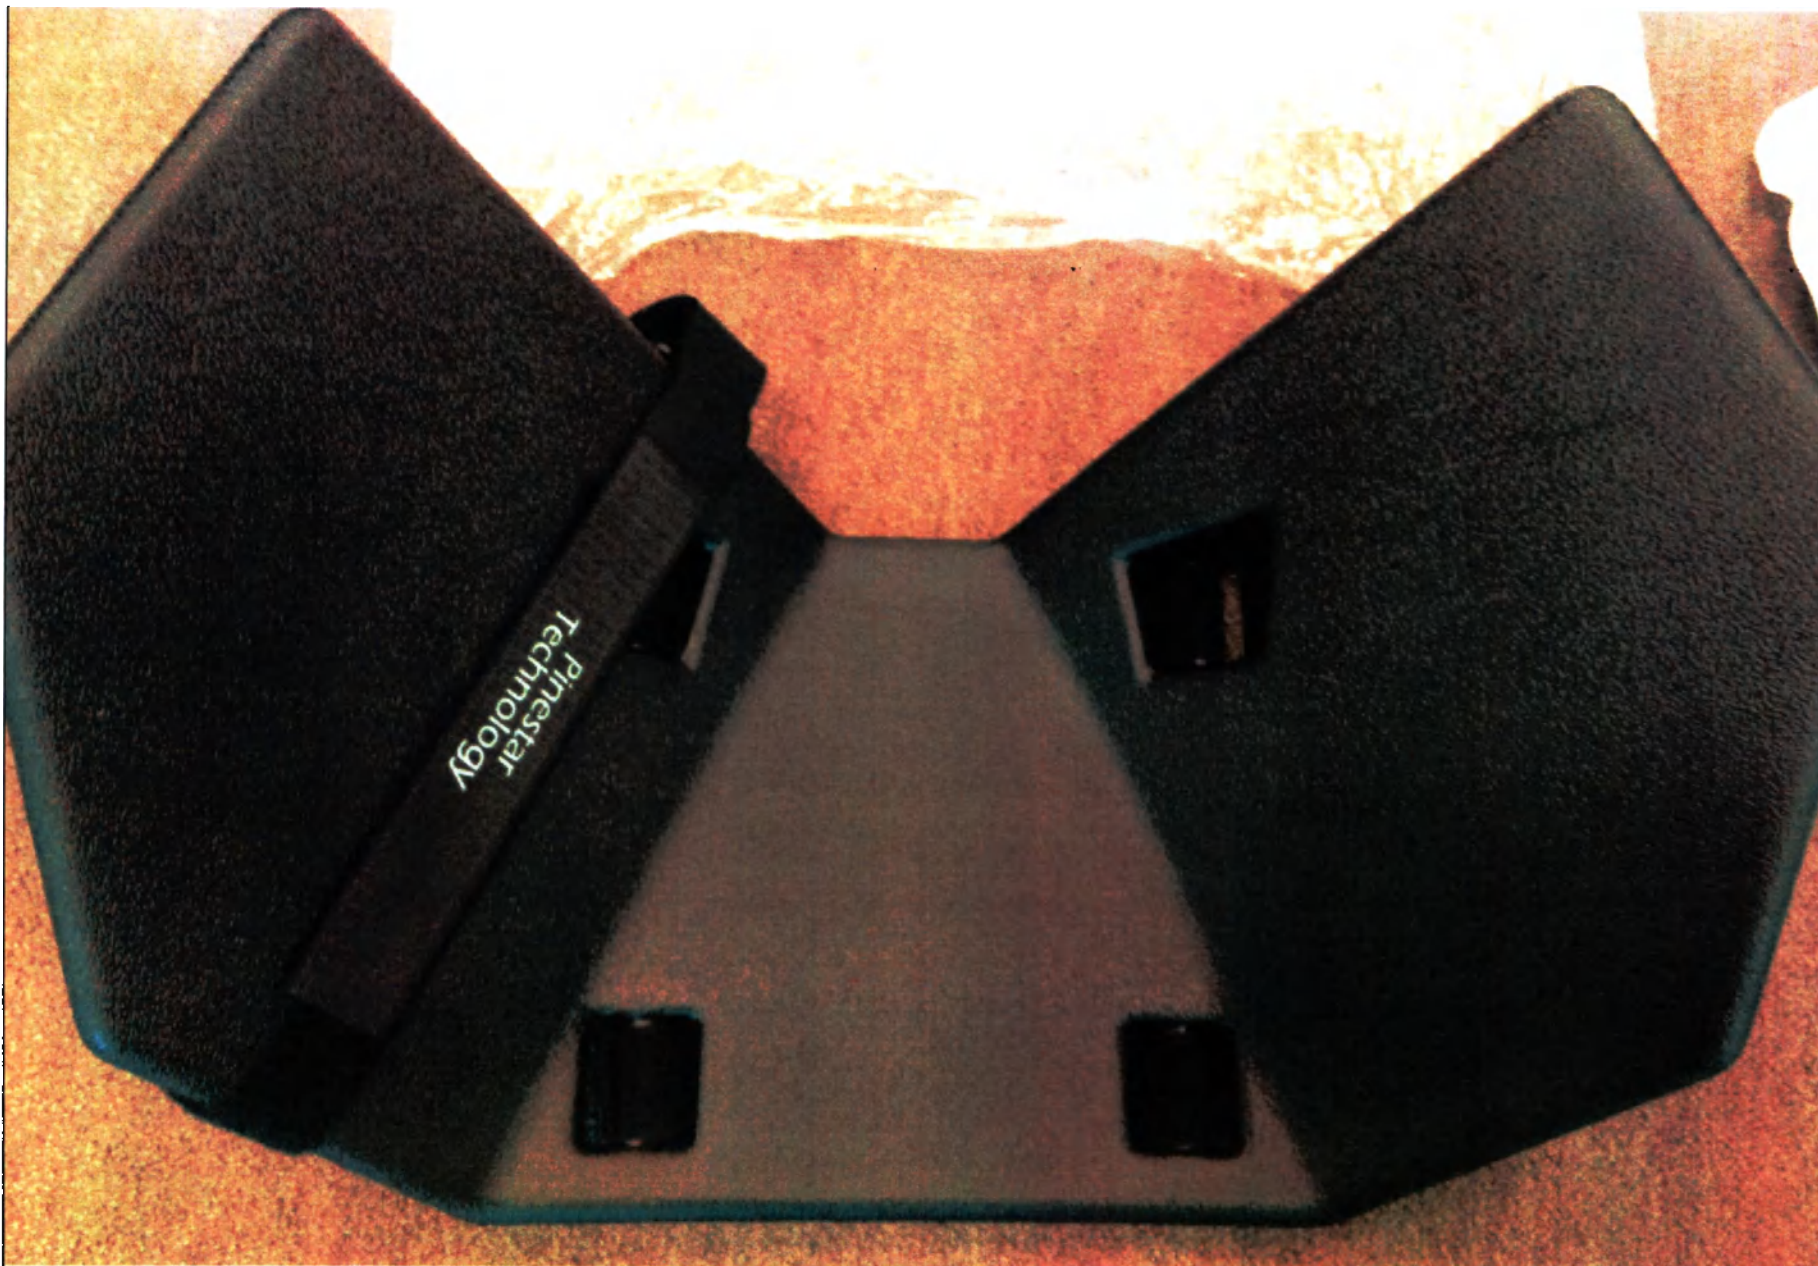


Рис. 41. Фиксаторы для рук (не более 5 шт.).

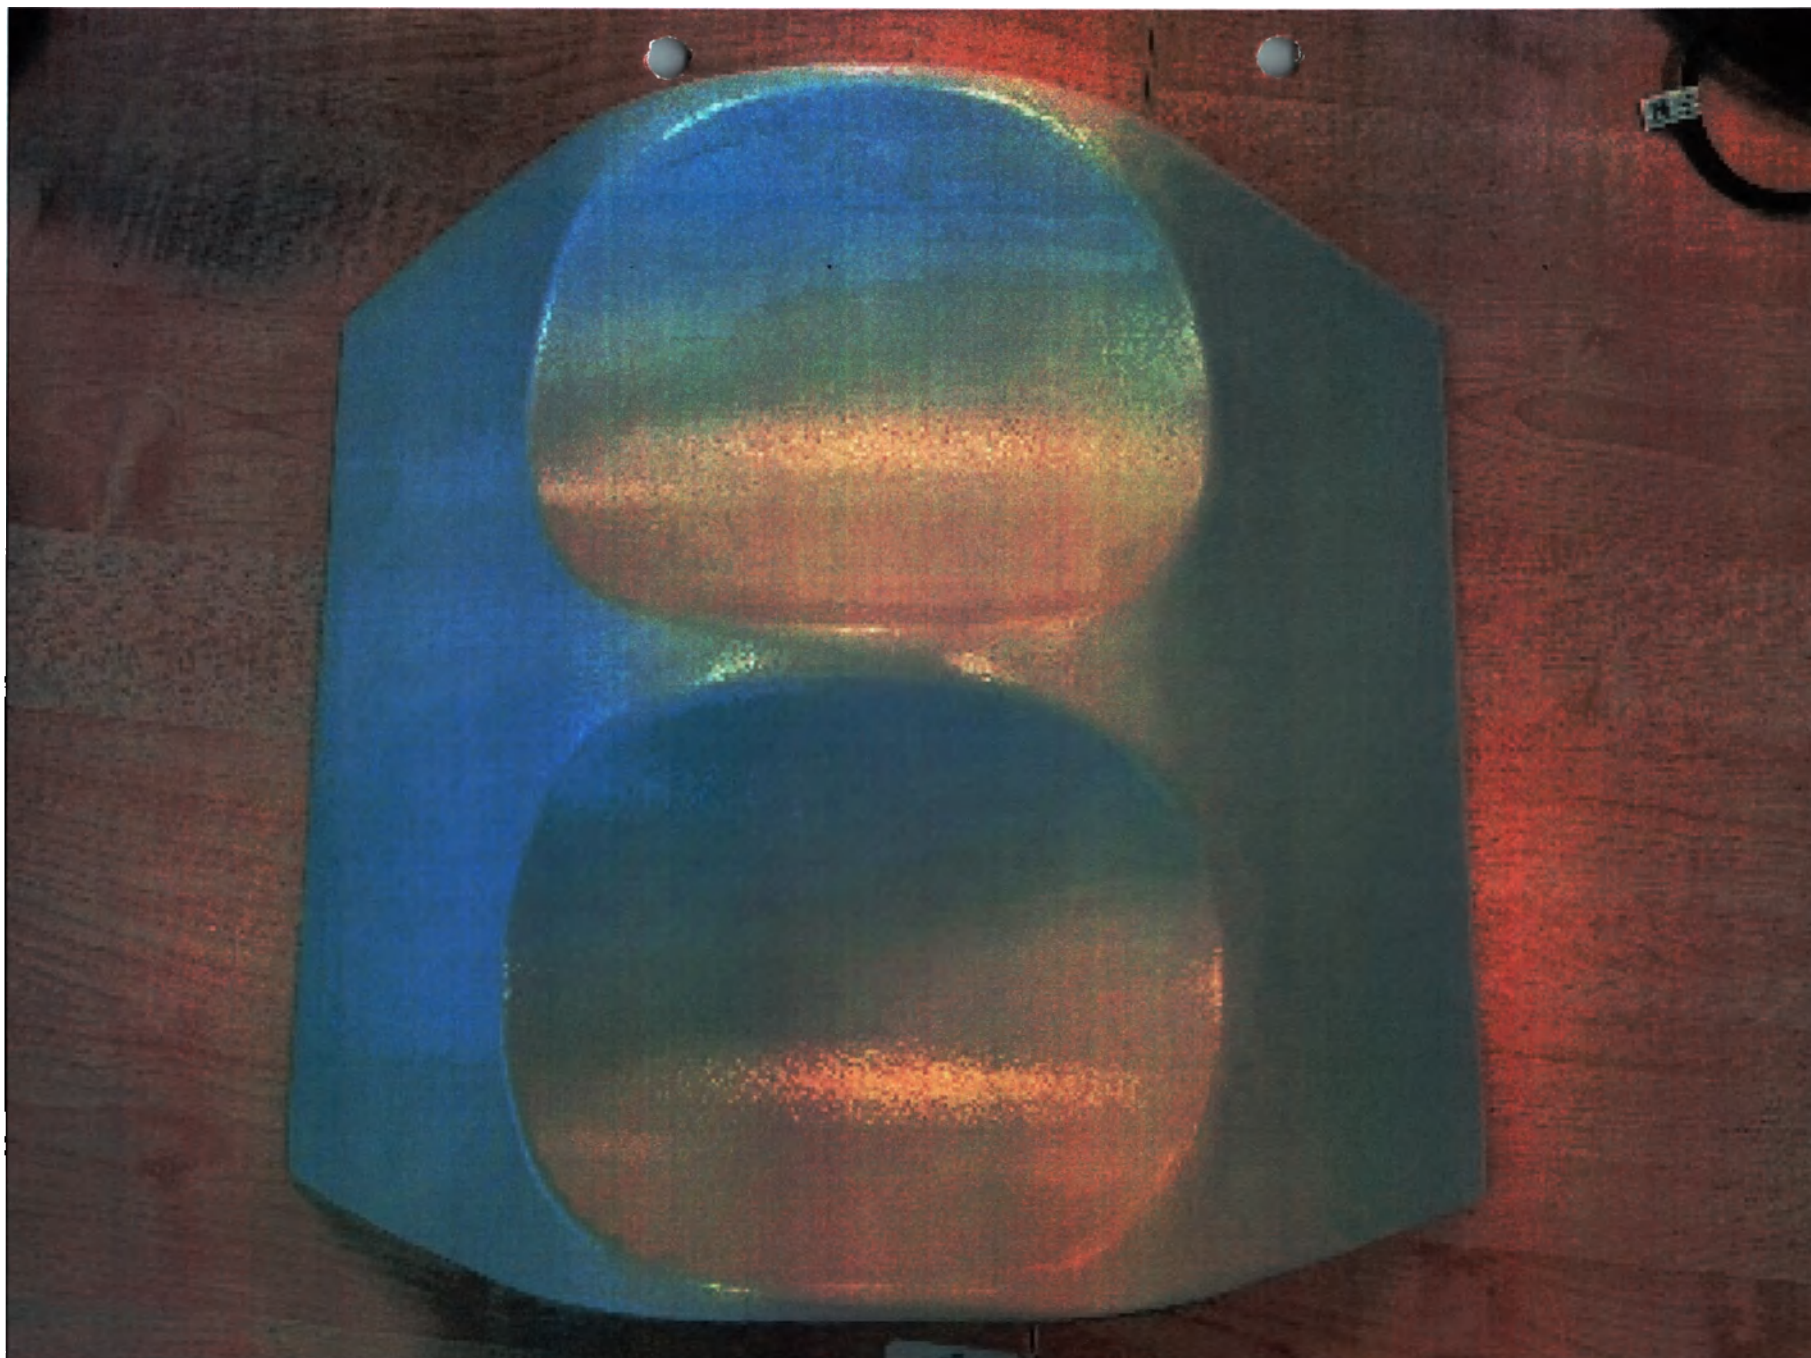


Рис. 42. Опоры для ног пациента (не более 5 шт.).

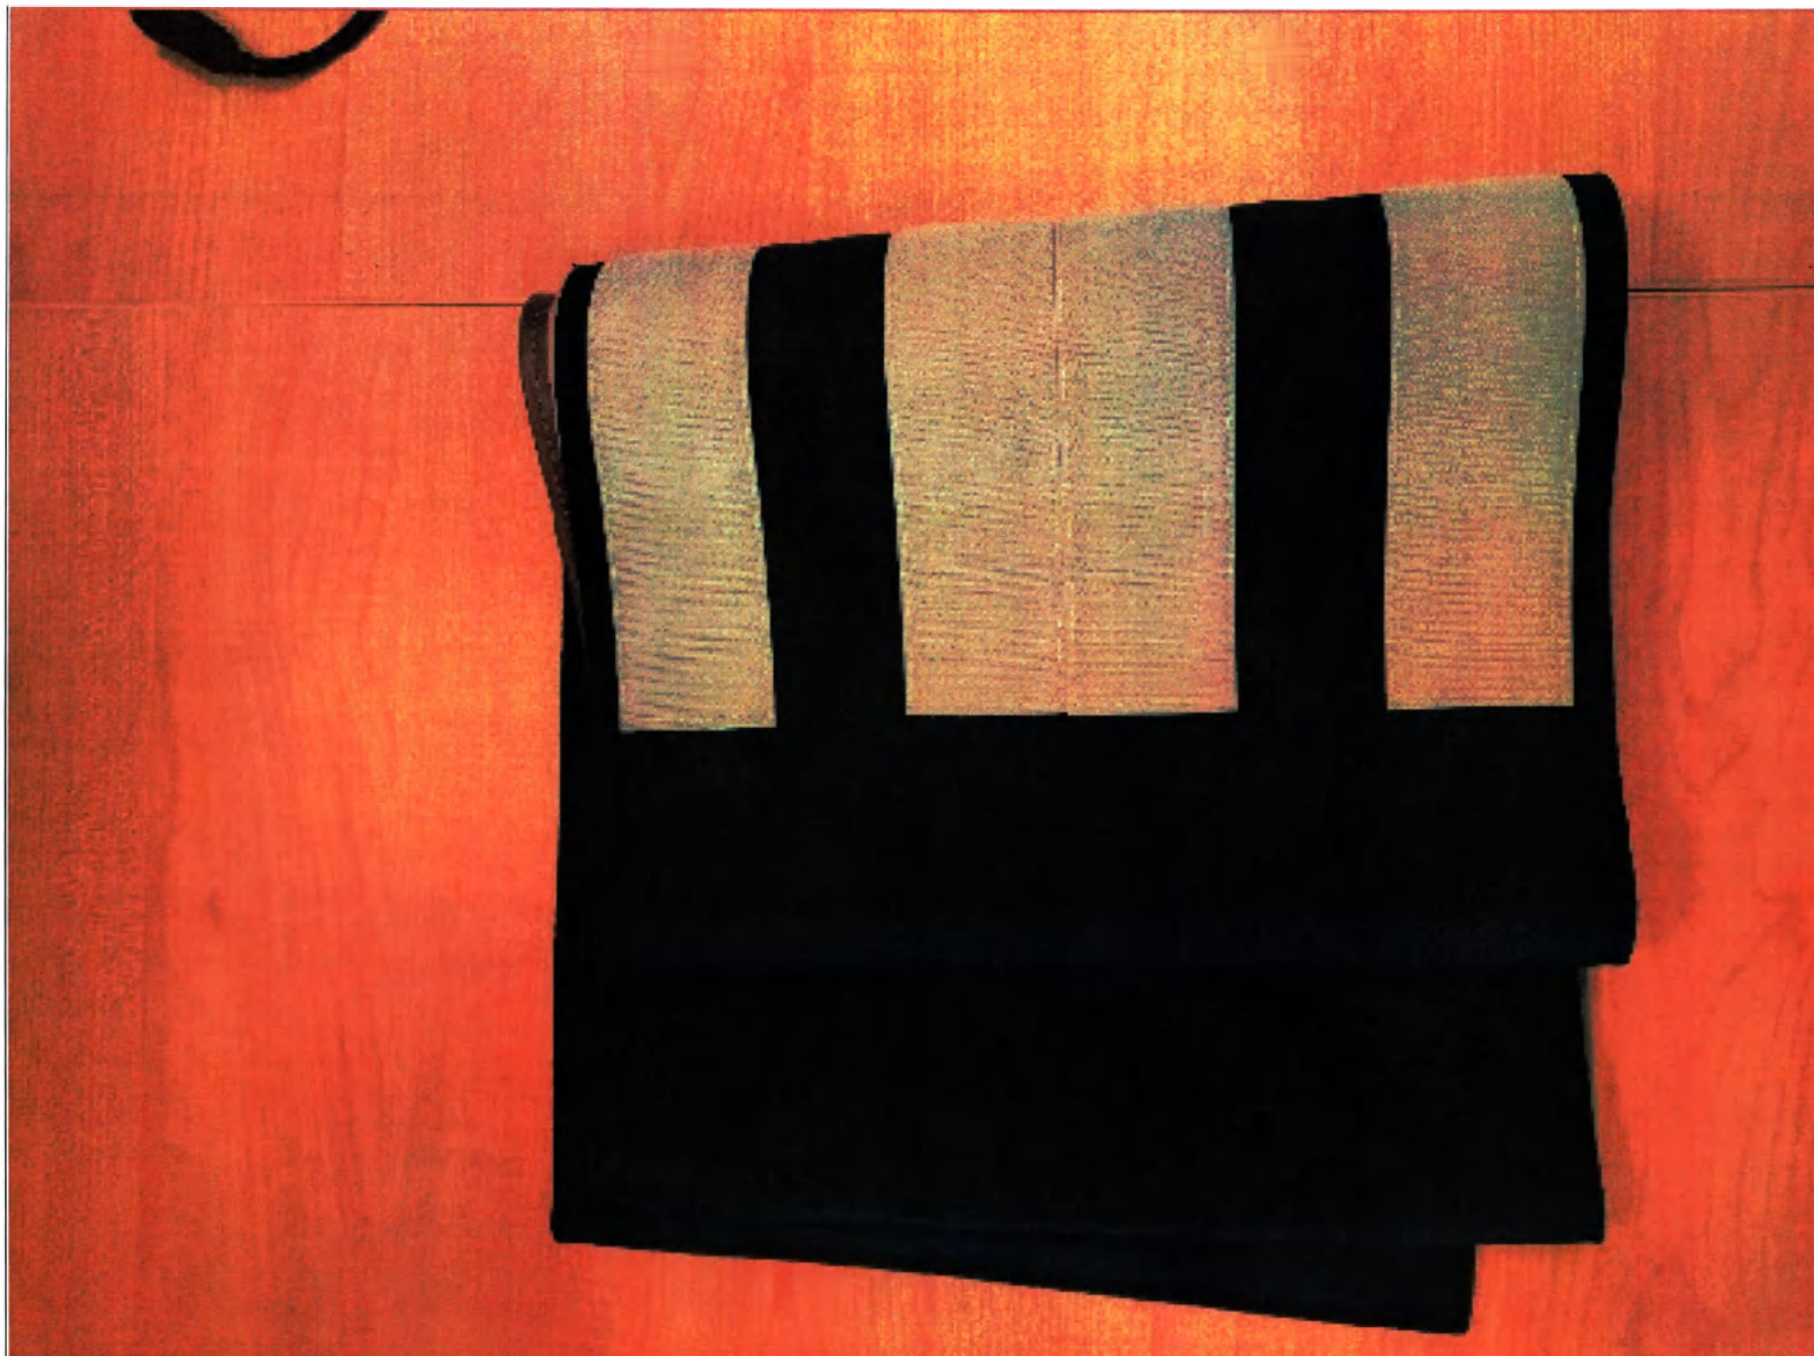


Рис. 43. Приспособления для фиксации пациентов (не более 20 шт.), варианты исполнения: Приспособления для фиксации пациентов 134 x 13 см, Приспособления для фиксации пациентов 134 x 7,5 см, Приспособления для фиксации пациентов 228,6 x 30 см, Приспособления для фиксации пациентов 228,6 x 13 см

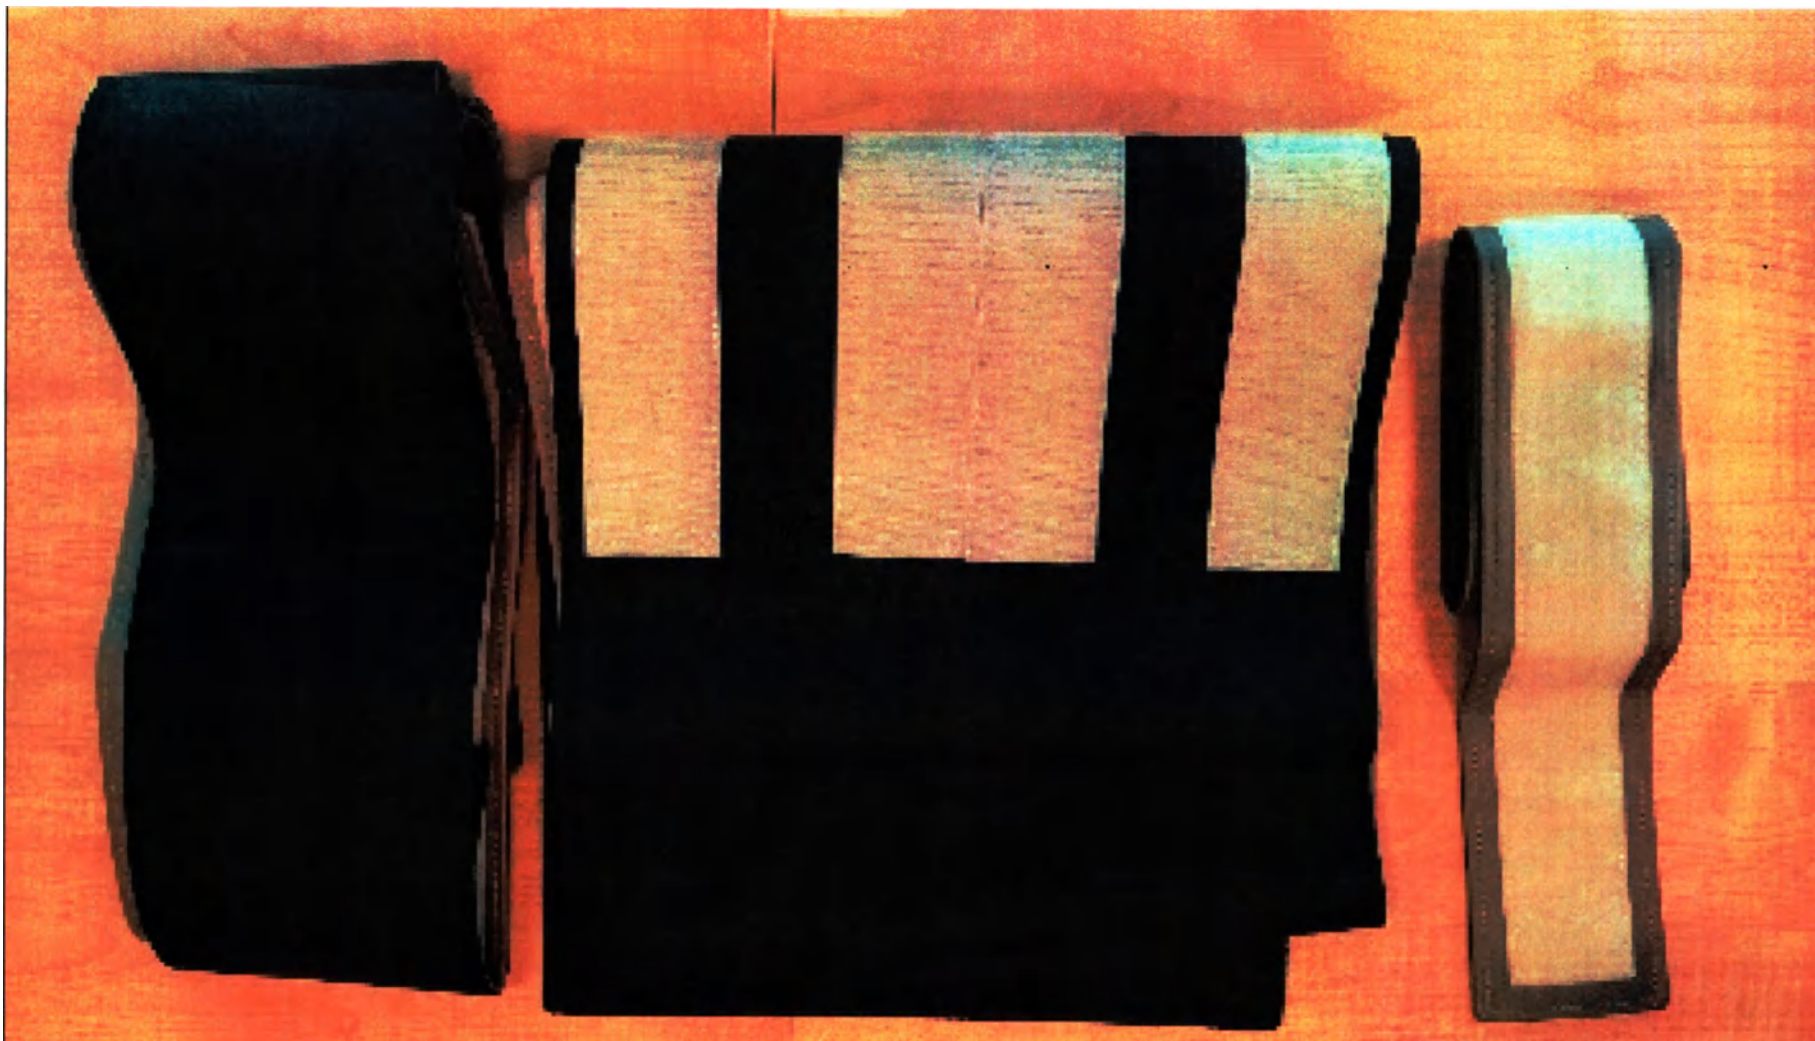


Рис. 44. Приспособления для фиксации пациентов (не более 20 шт.), варианты исполнения: Приспособления для фиксации пациентов 134 x 13 см, Приспособления для фиксации пациентов 134 x 7,5 см, Приспособления для фиксации пациентов 228,6 x 30 см, Приспособления для фиксации пациентов 228,6 x 13 см

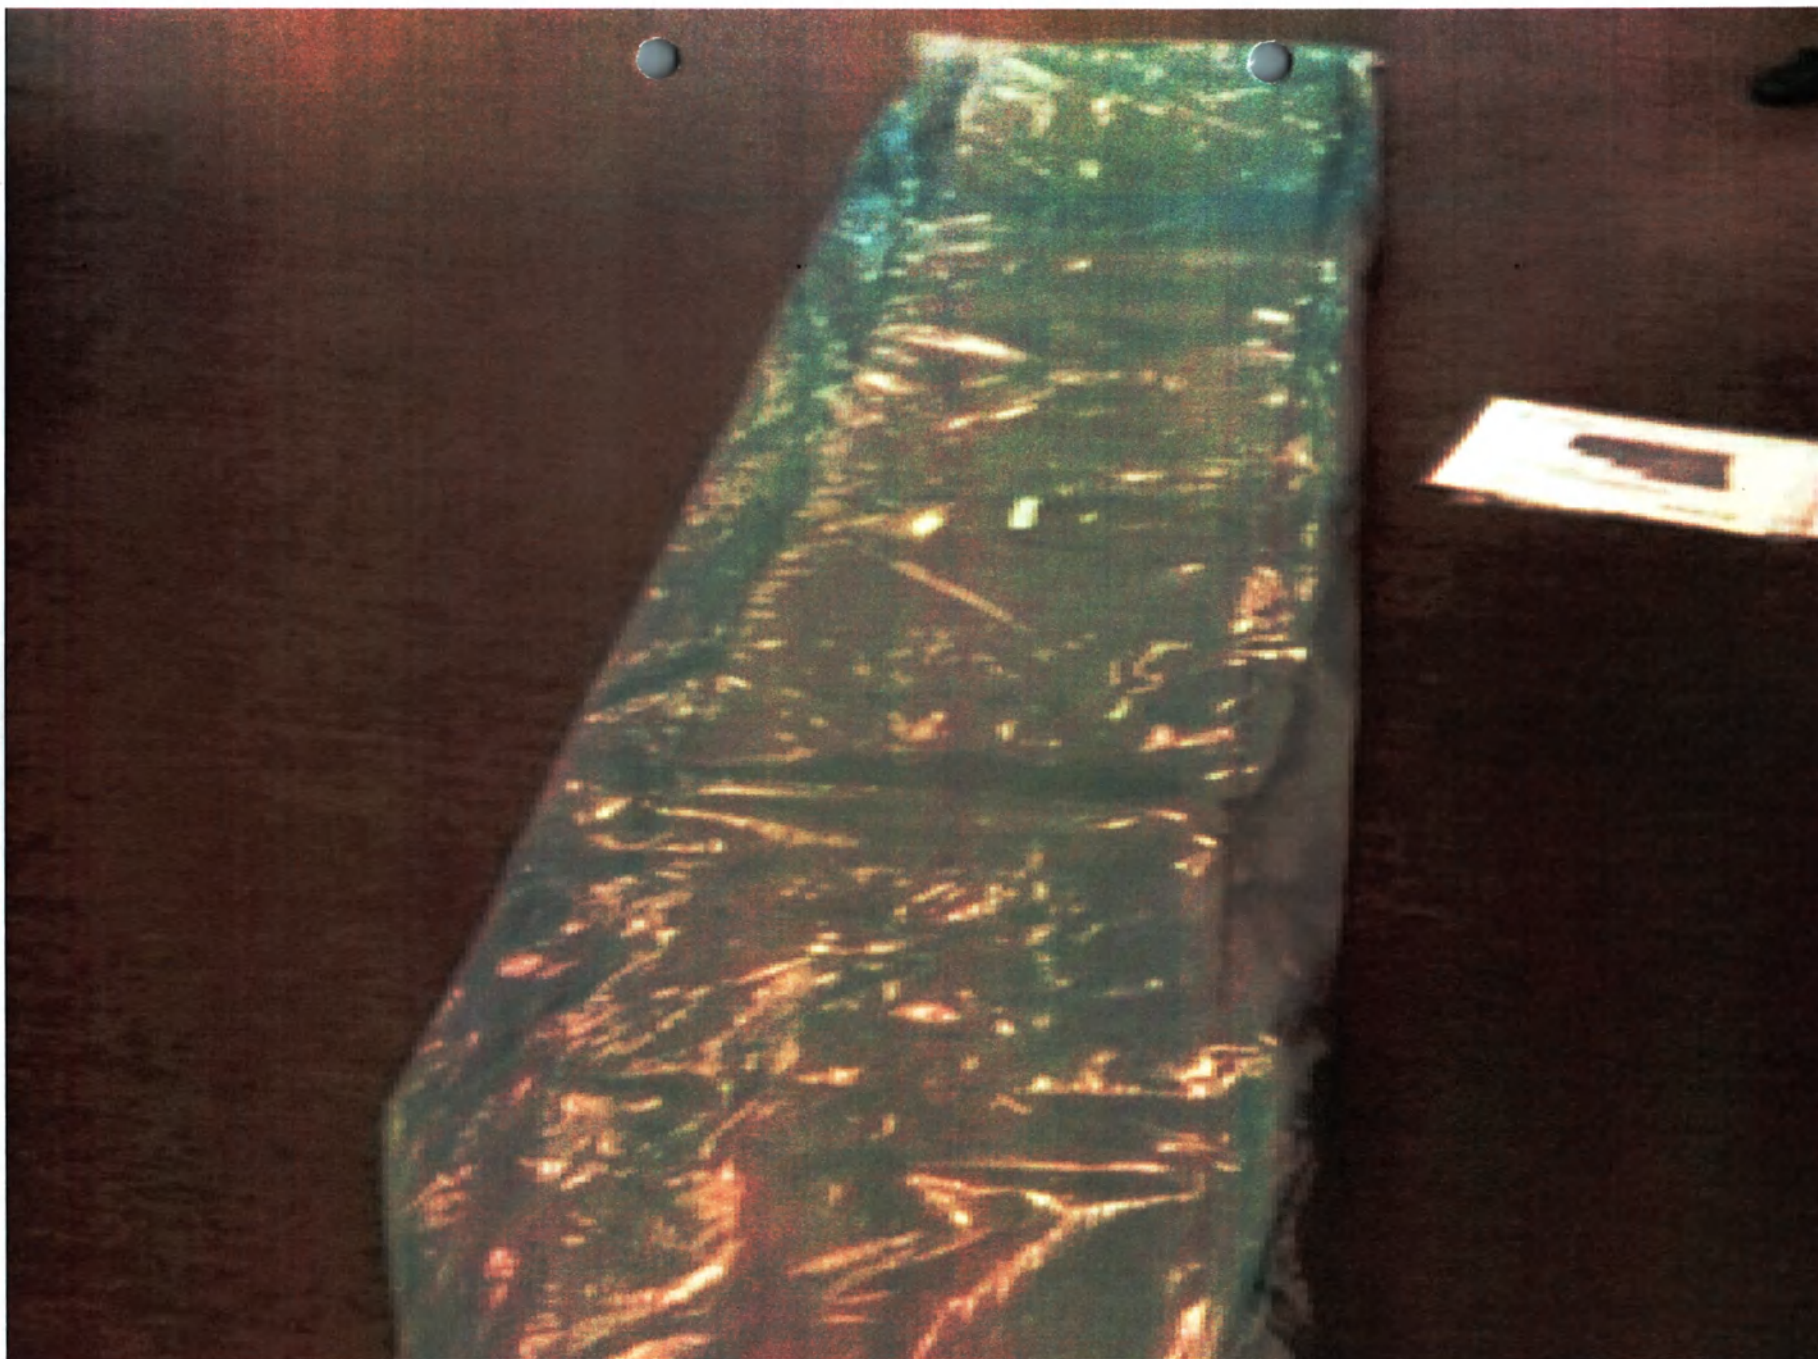


Рис. 45. Матрас (не более 5 шт.).

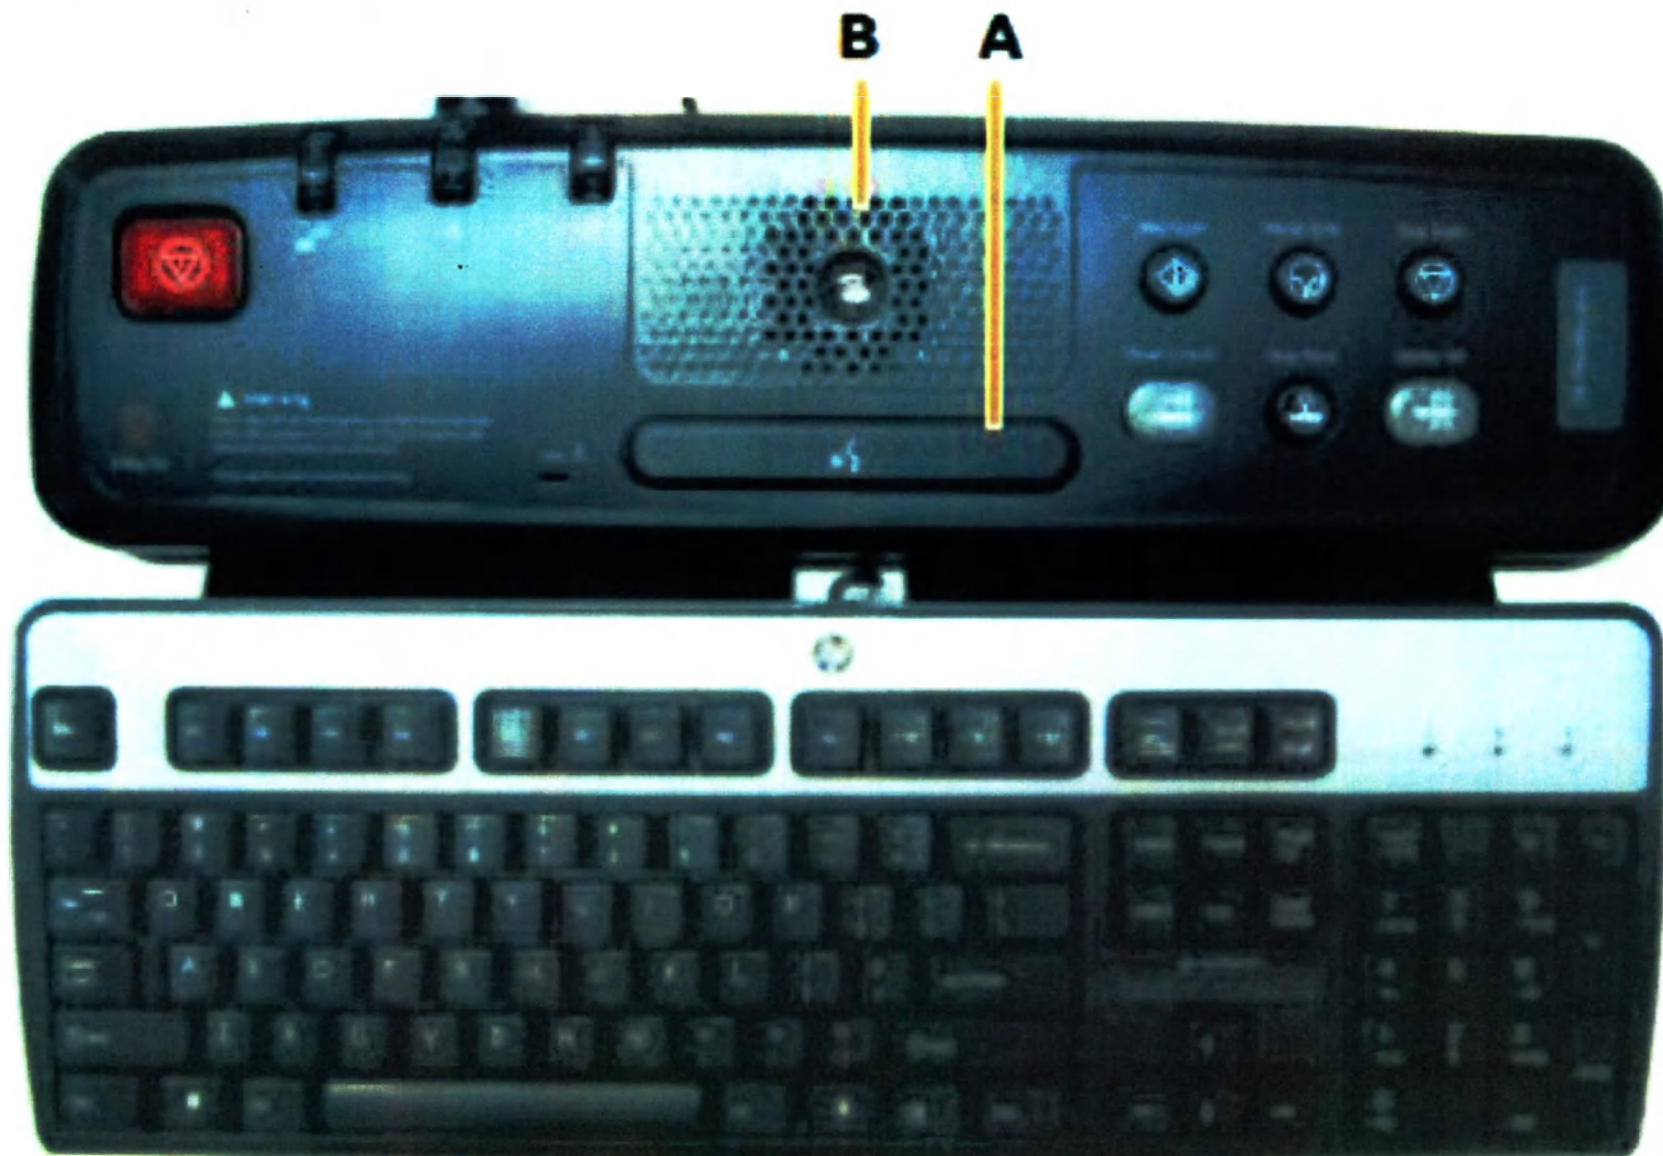


Рис. 46. Клавиатуры пульта управления (не более 4 шт.).



Рис. 47. Тележка транспортировочная для гантри (не более 8 шт.).



Рис. 48. Тележка транспортировочная для гантри (не более 8 шт.).

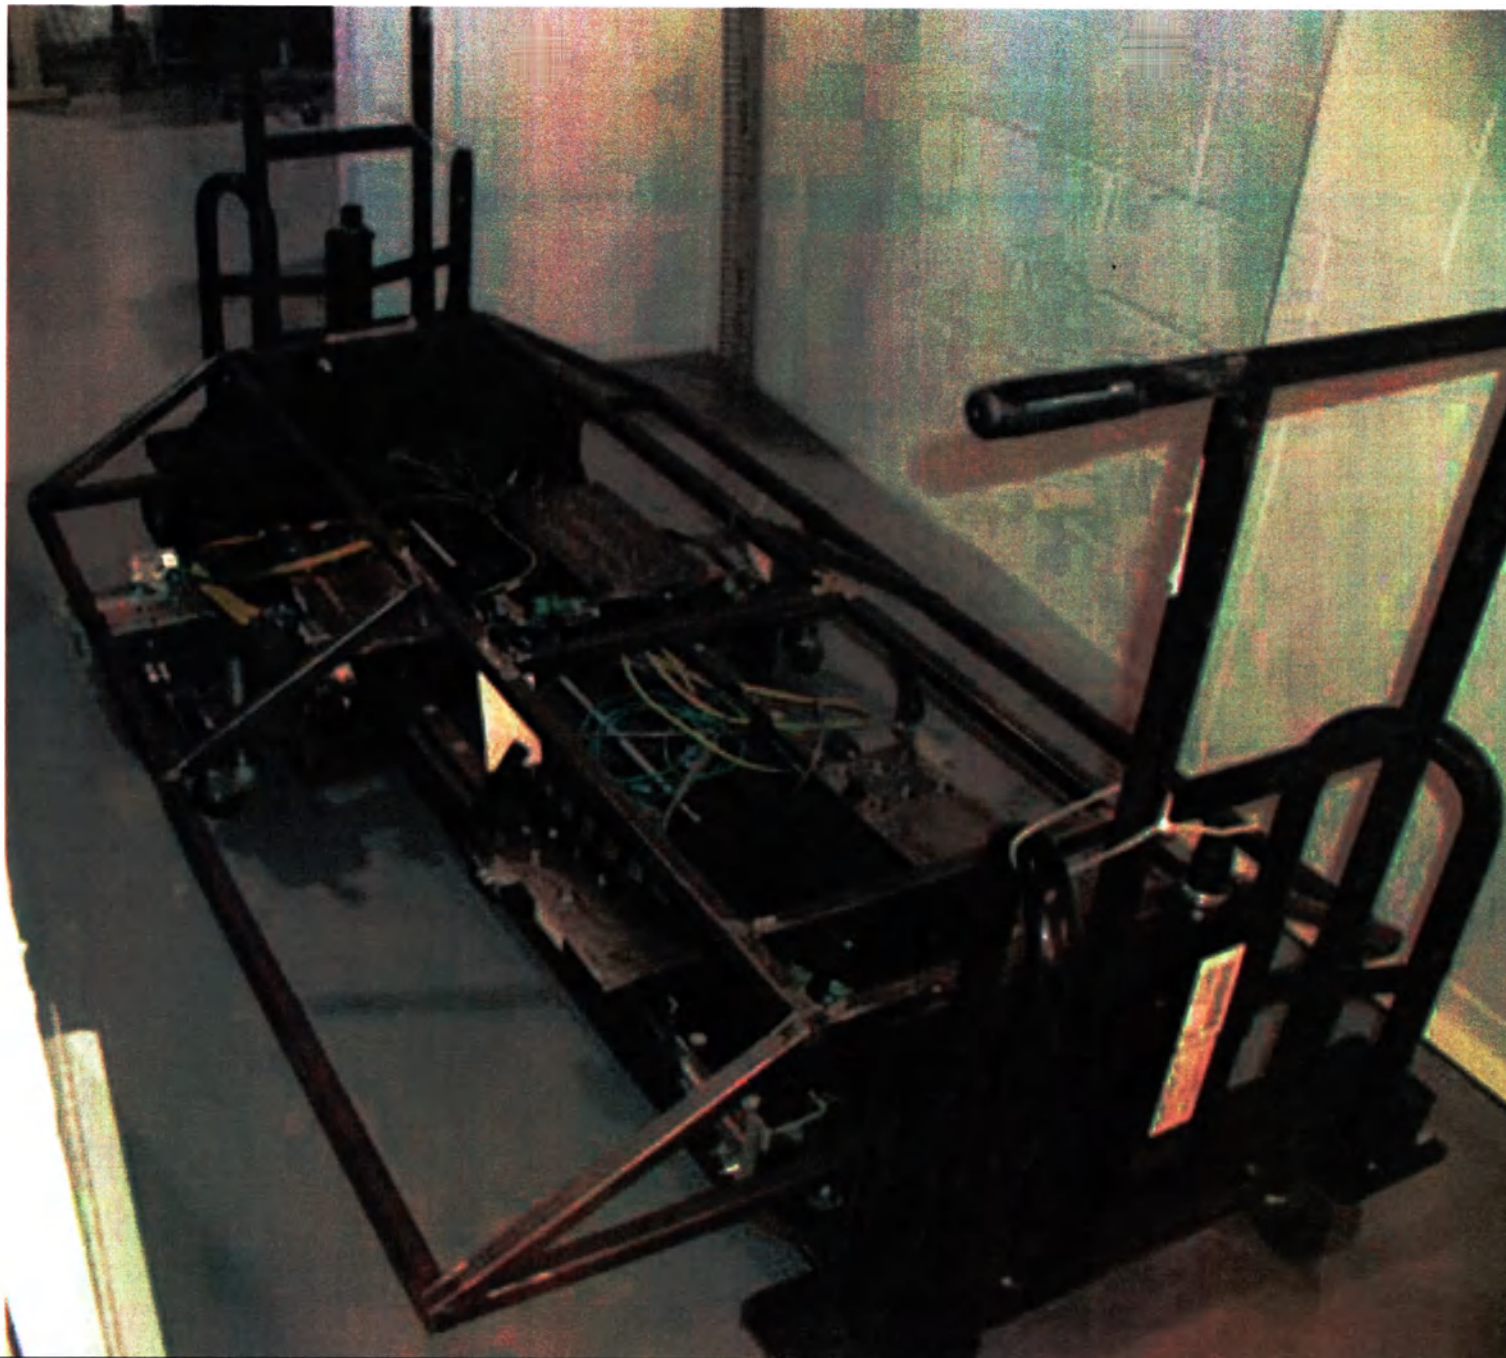


Рис. 49. Тележка транспортировочная для гантри (не более 8 шт.).



Рис. 50. Инструмент для монтажа и сервисного обслуживания (не более 4 шт.).

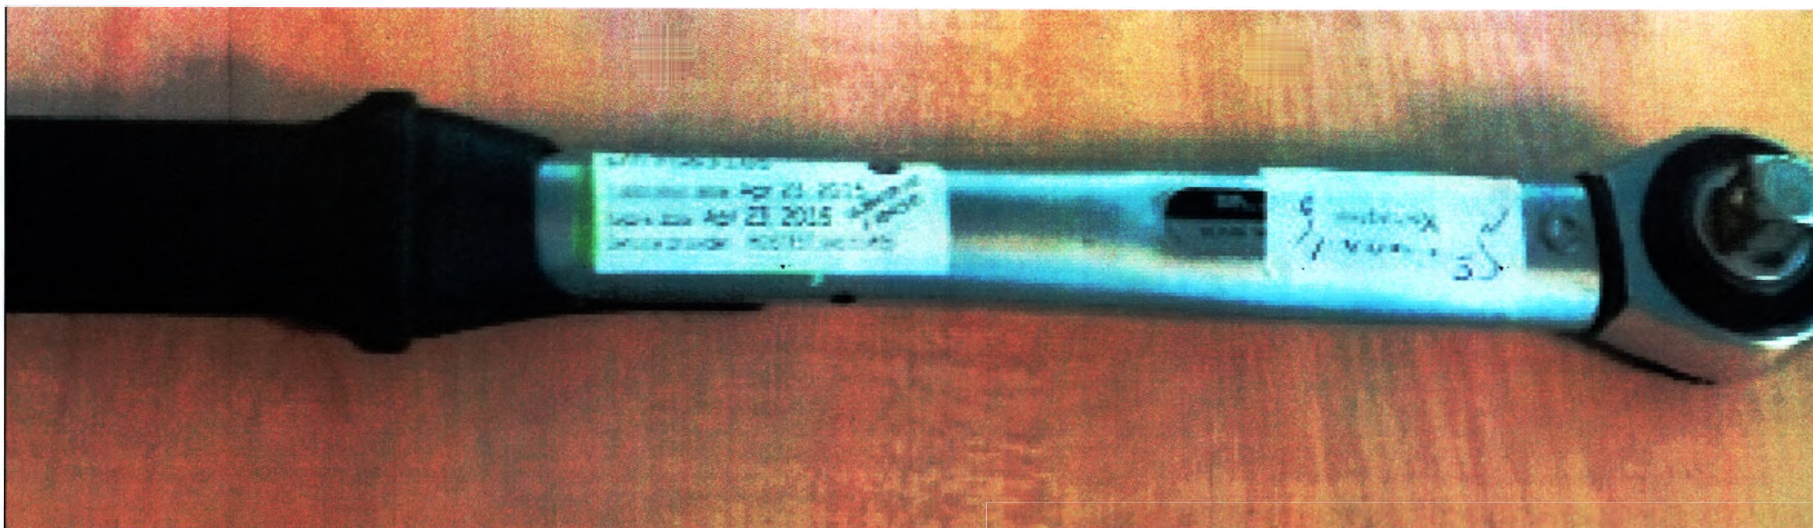


Рис. 51. Инструмент для монтажа и сервисного обслуживания (не более 4 шт.).

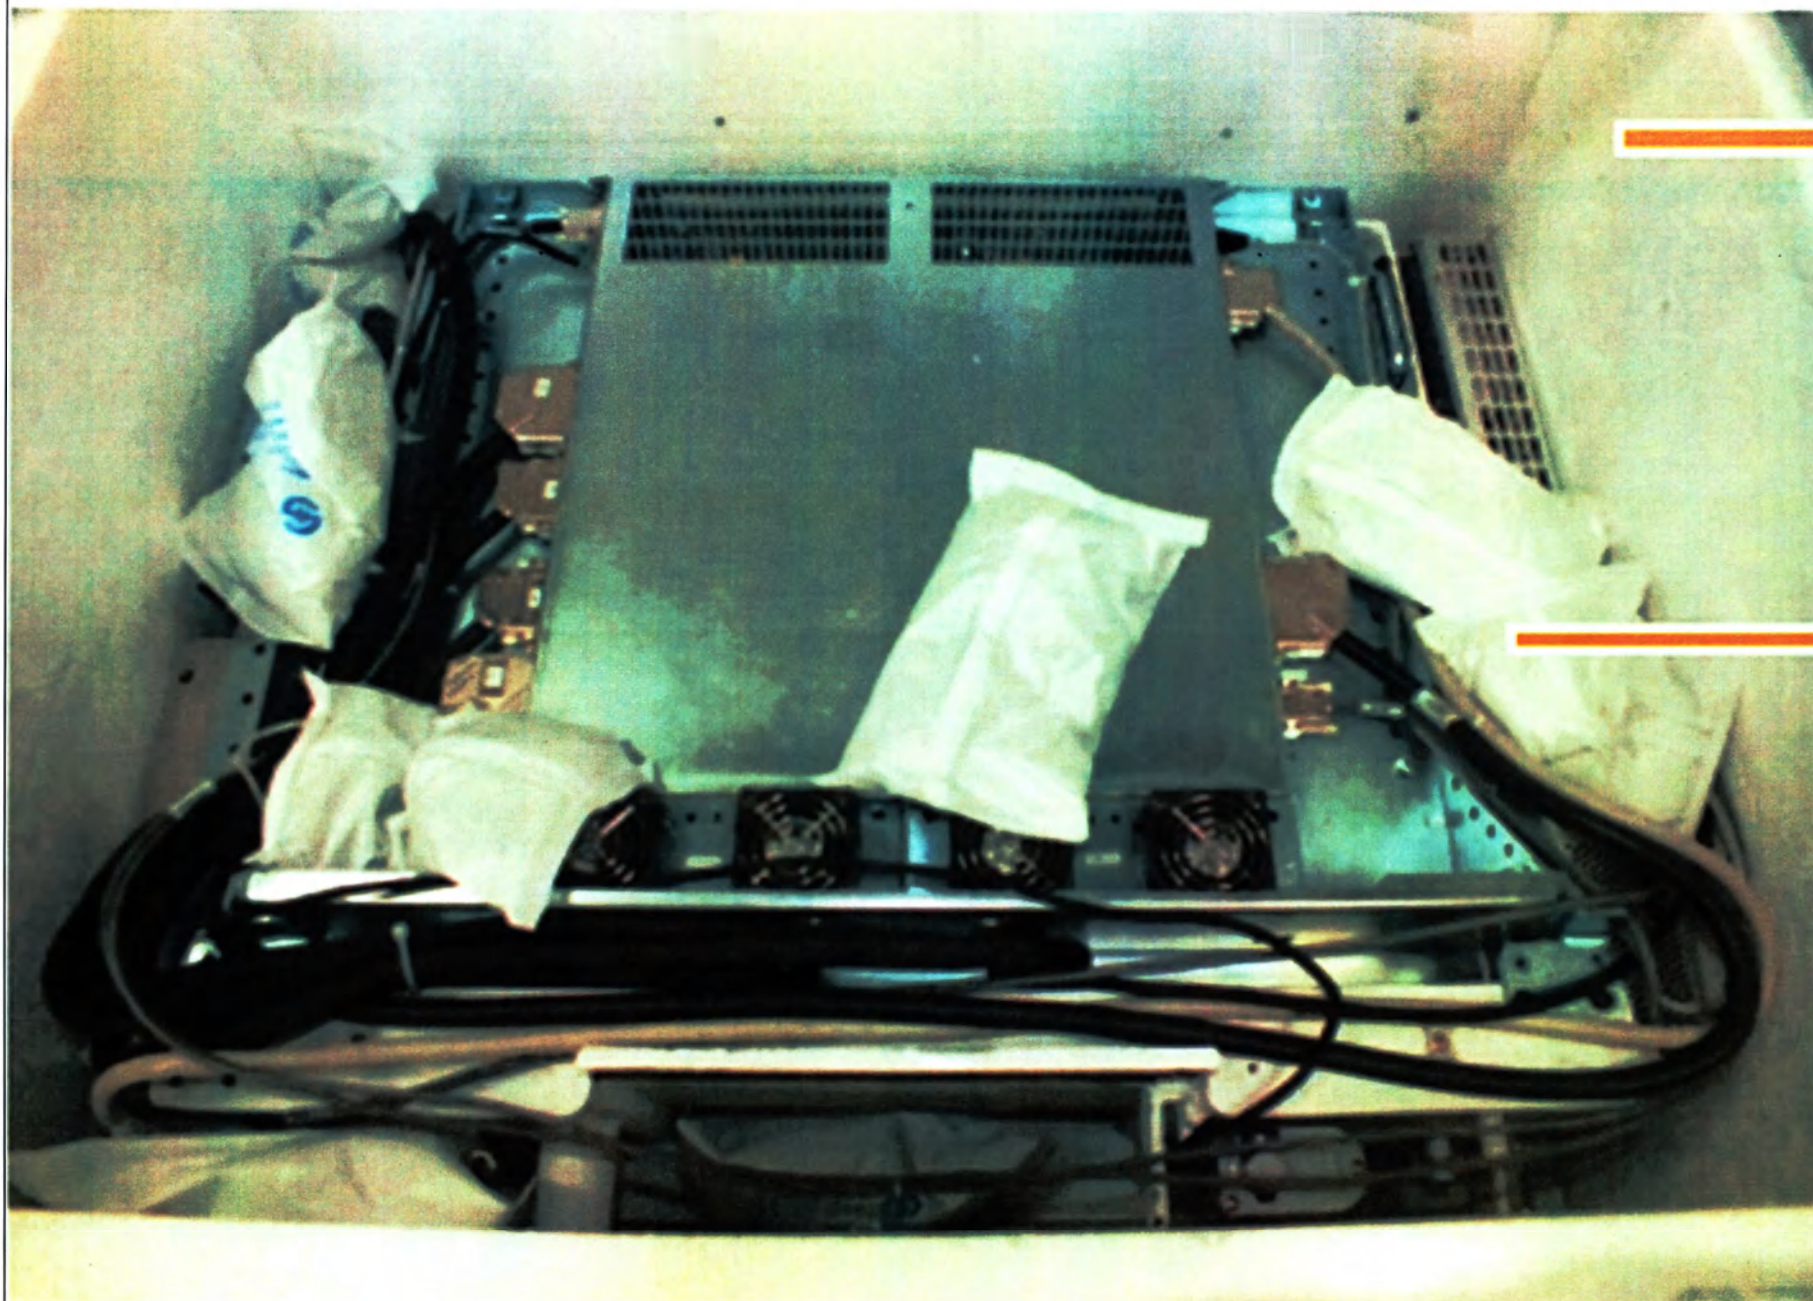


Рис. 52. Устройство для демонтажа детекторов.



Рис. 53. Крышки декоративные (не более 10 шт.).

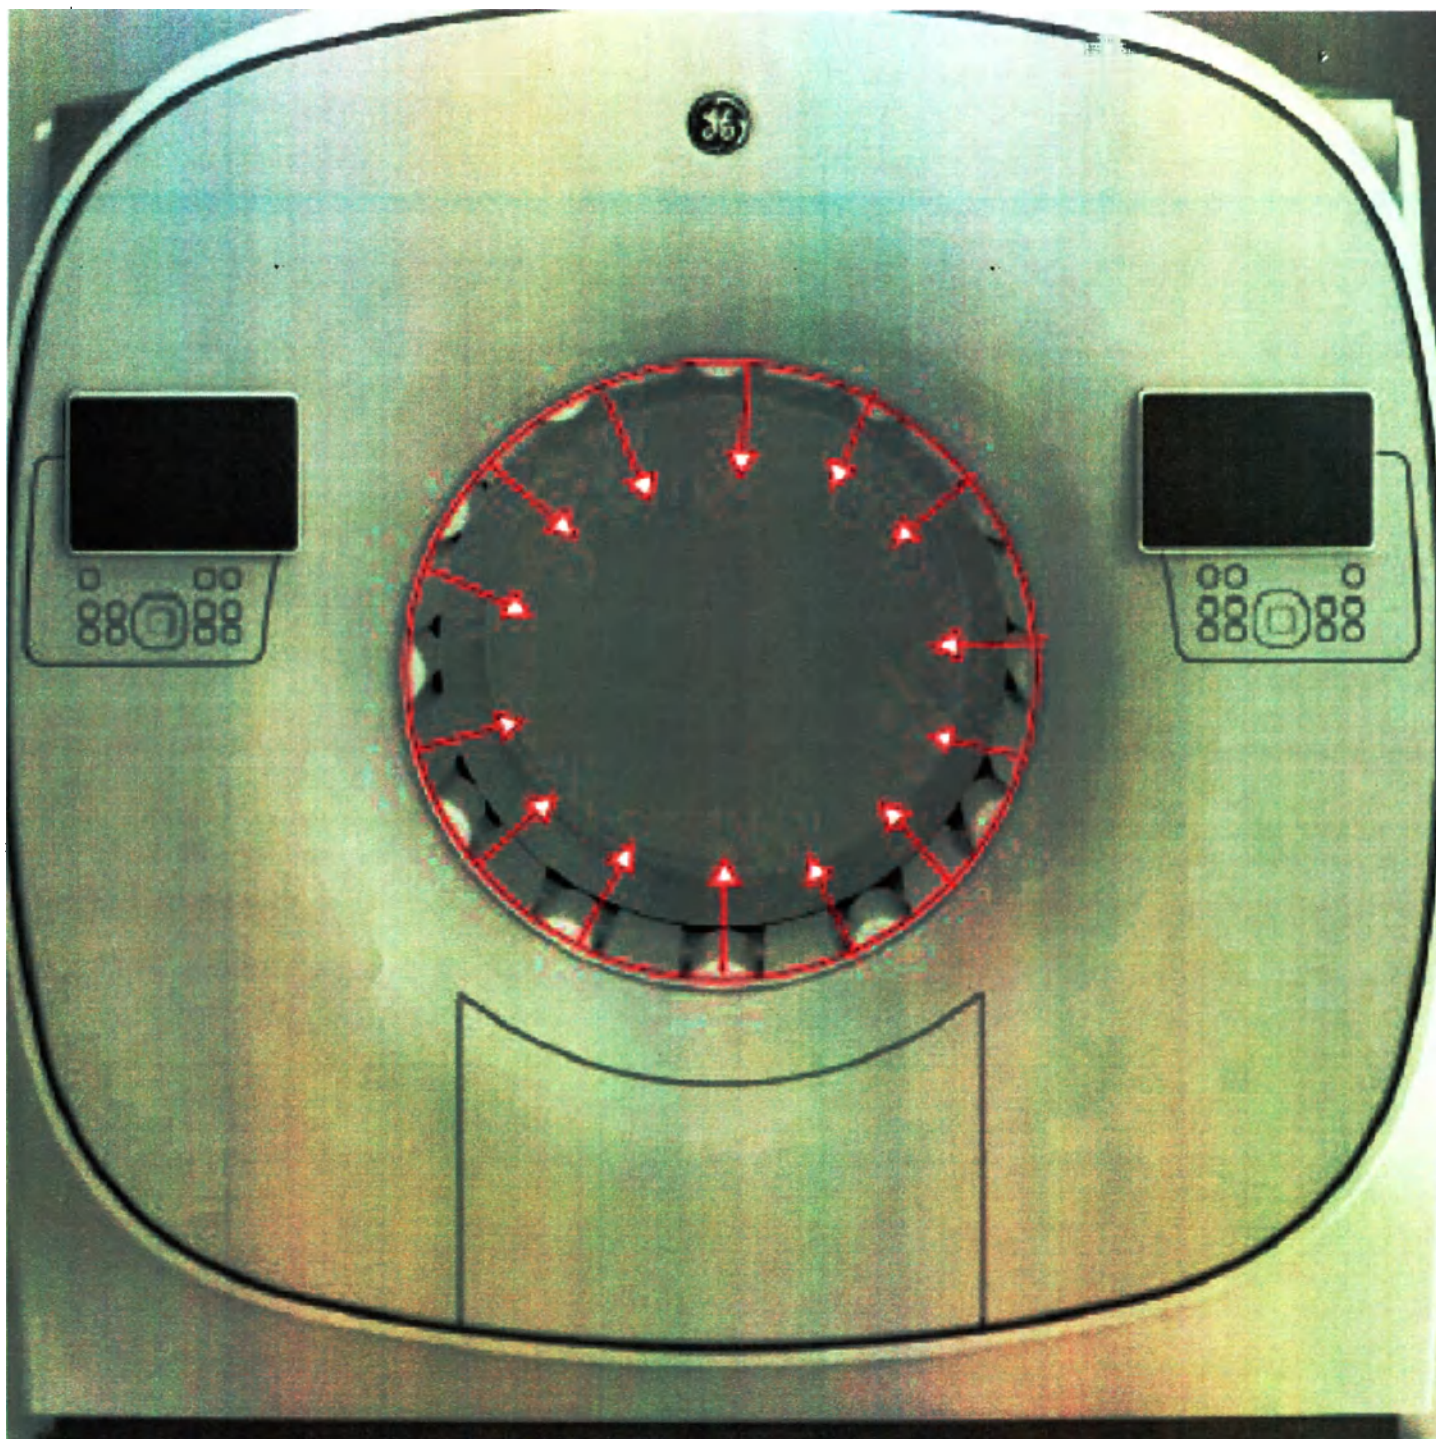


Рис. 54. Крышки декоративные (не более 10 шт.).



Рис. 55. Наклейки для комнаты сканирования (не более 30 шт.).



Рис. 56. Наклейки для комнаты сканирования (не более 30 шт.).

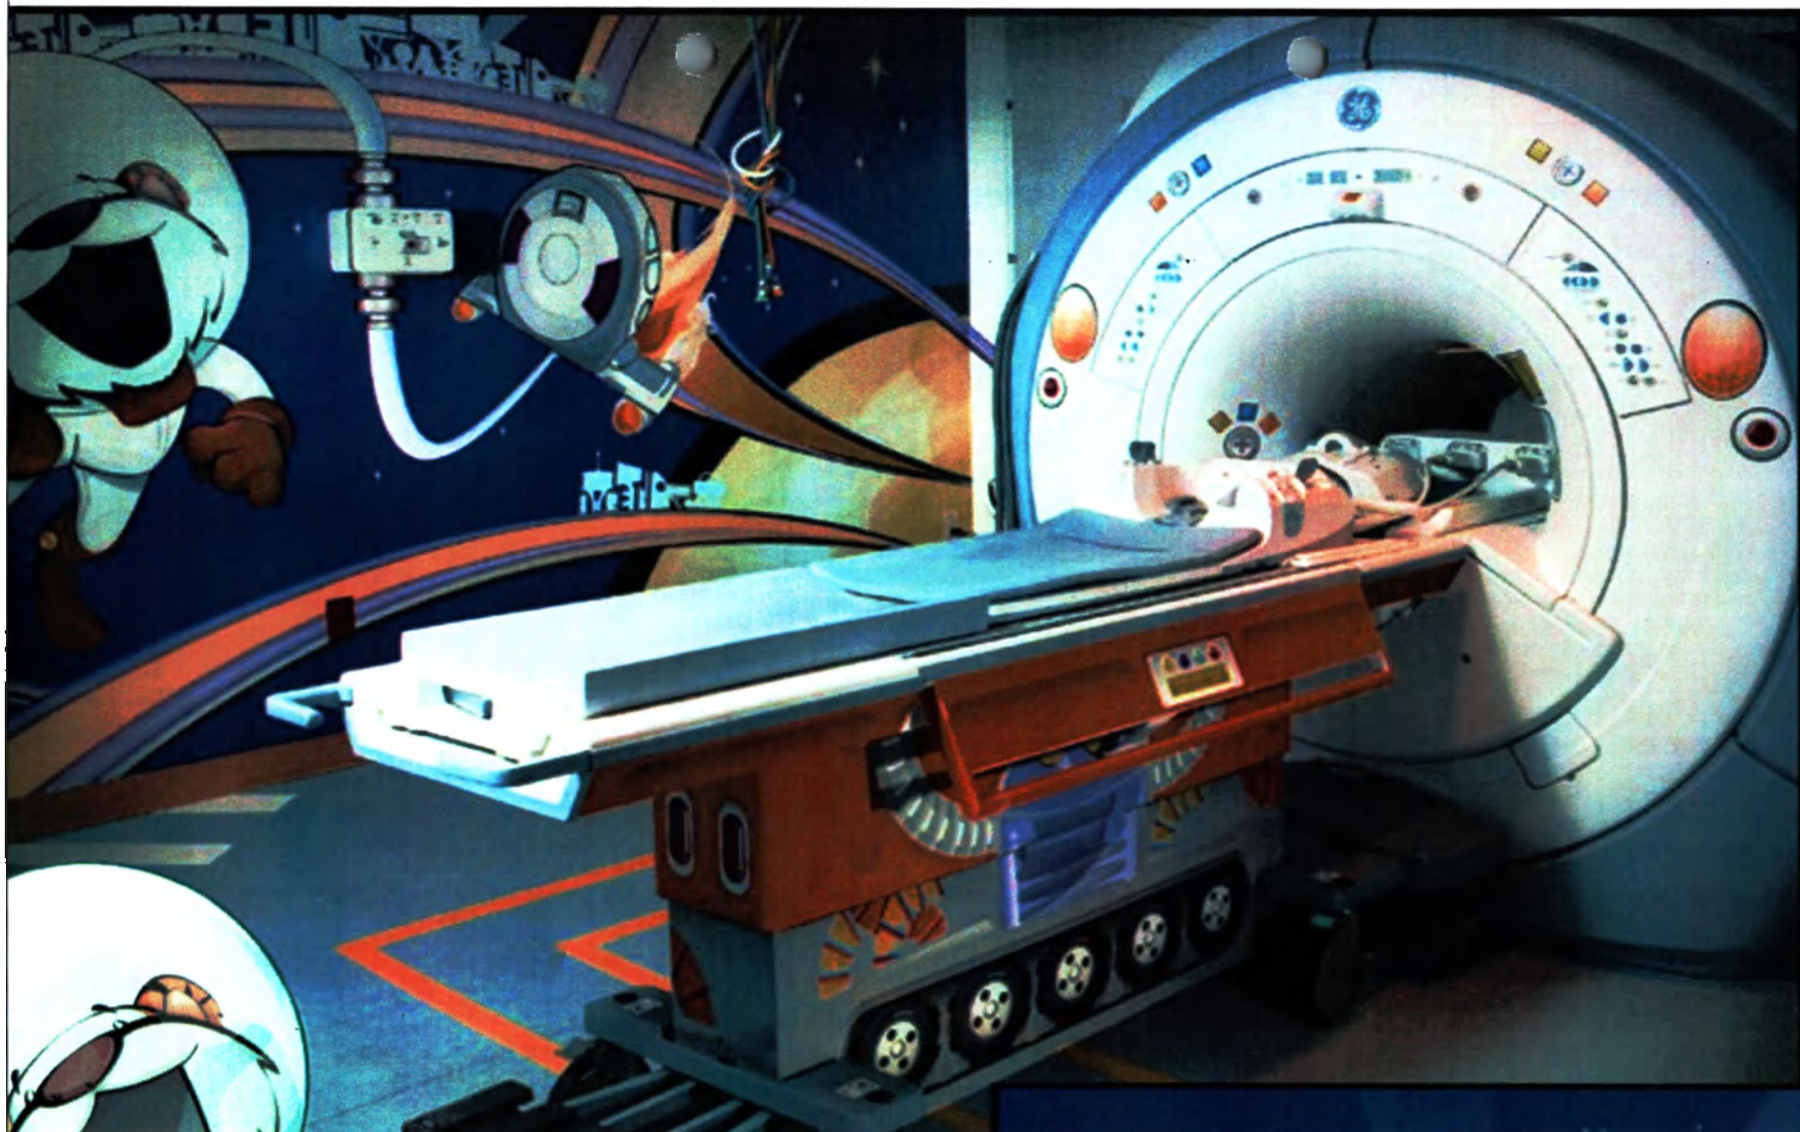


Рис. 57. Наклейки для комнаты сканирования (не более 30 шт.).

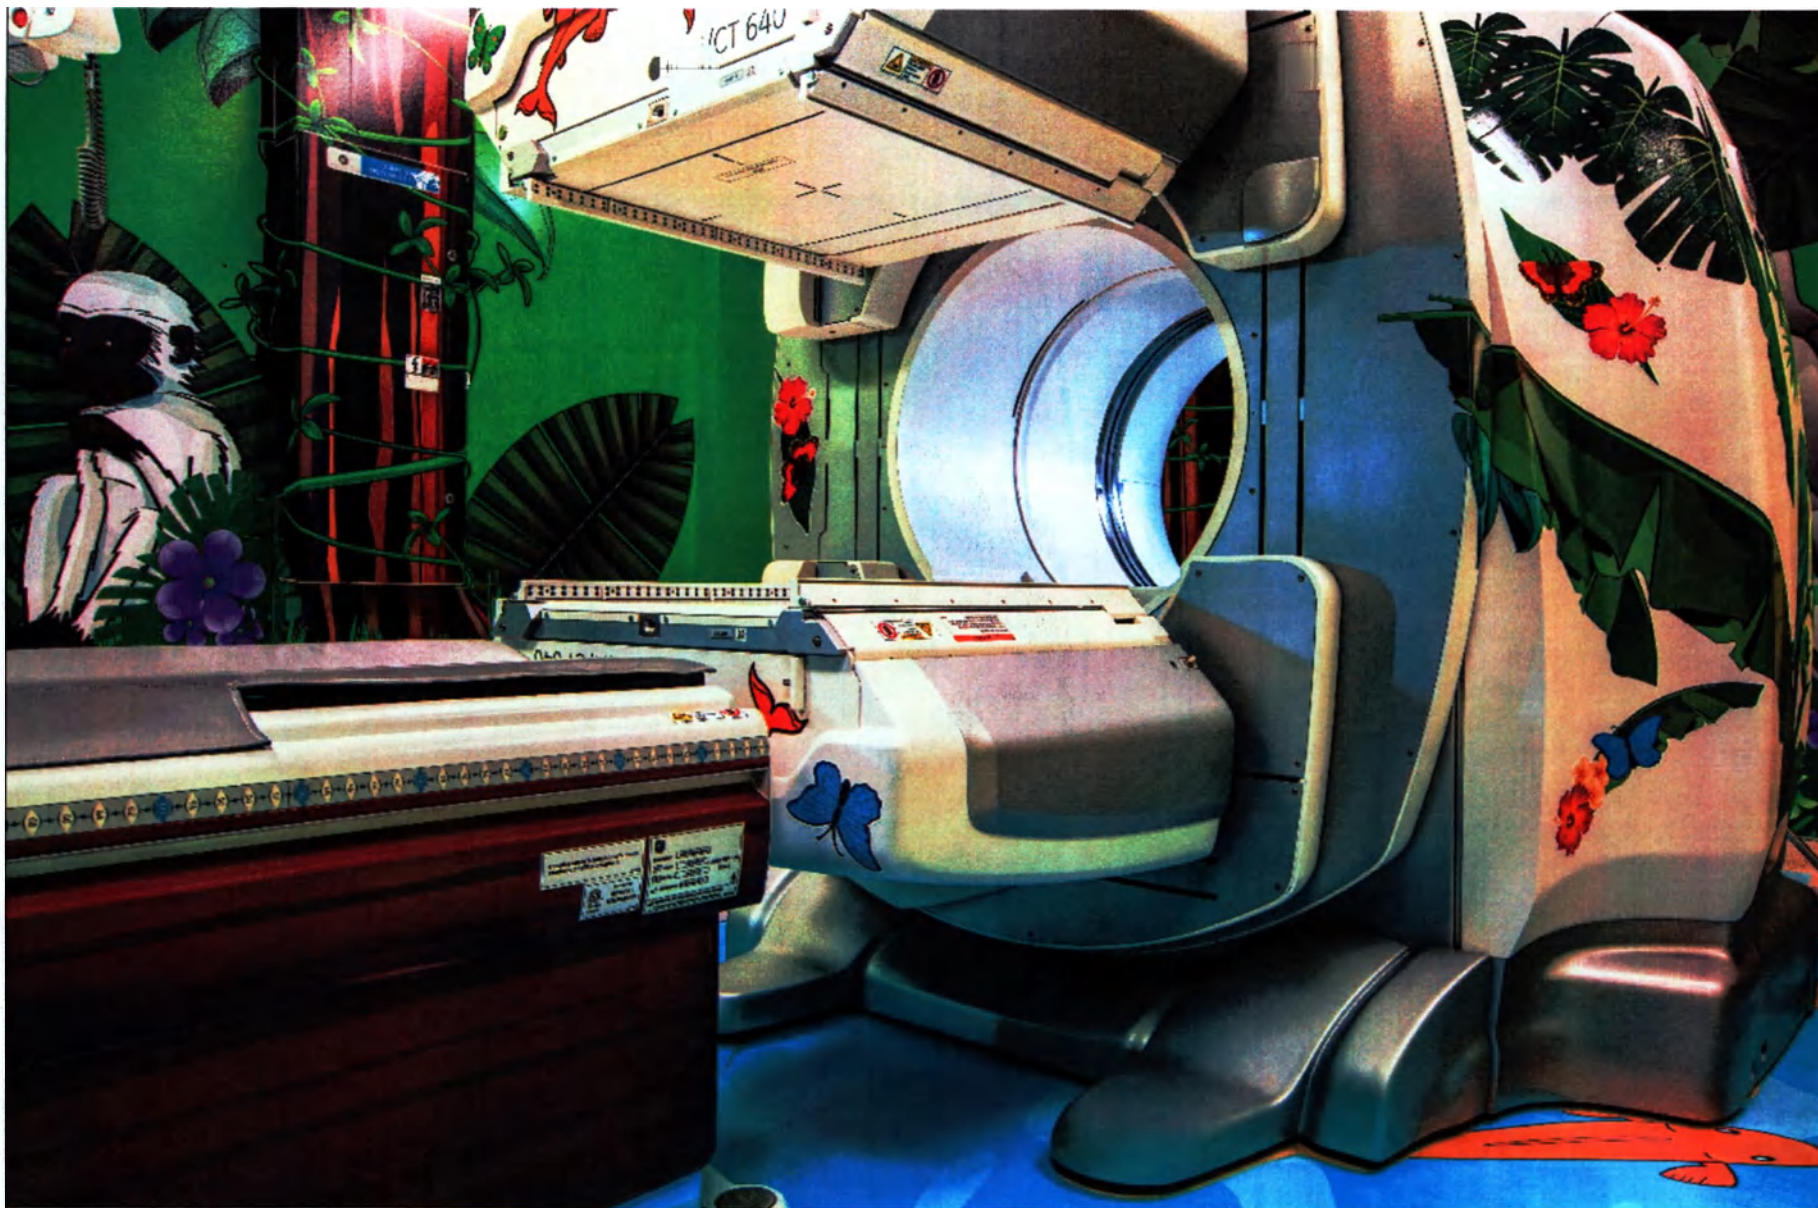


Рис. 58. Наклейки для комнаты сканирования (не более 30 шт.).

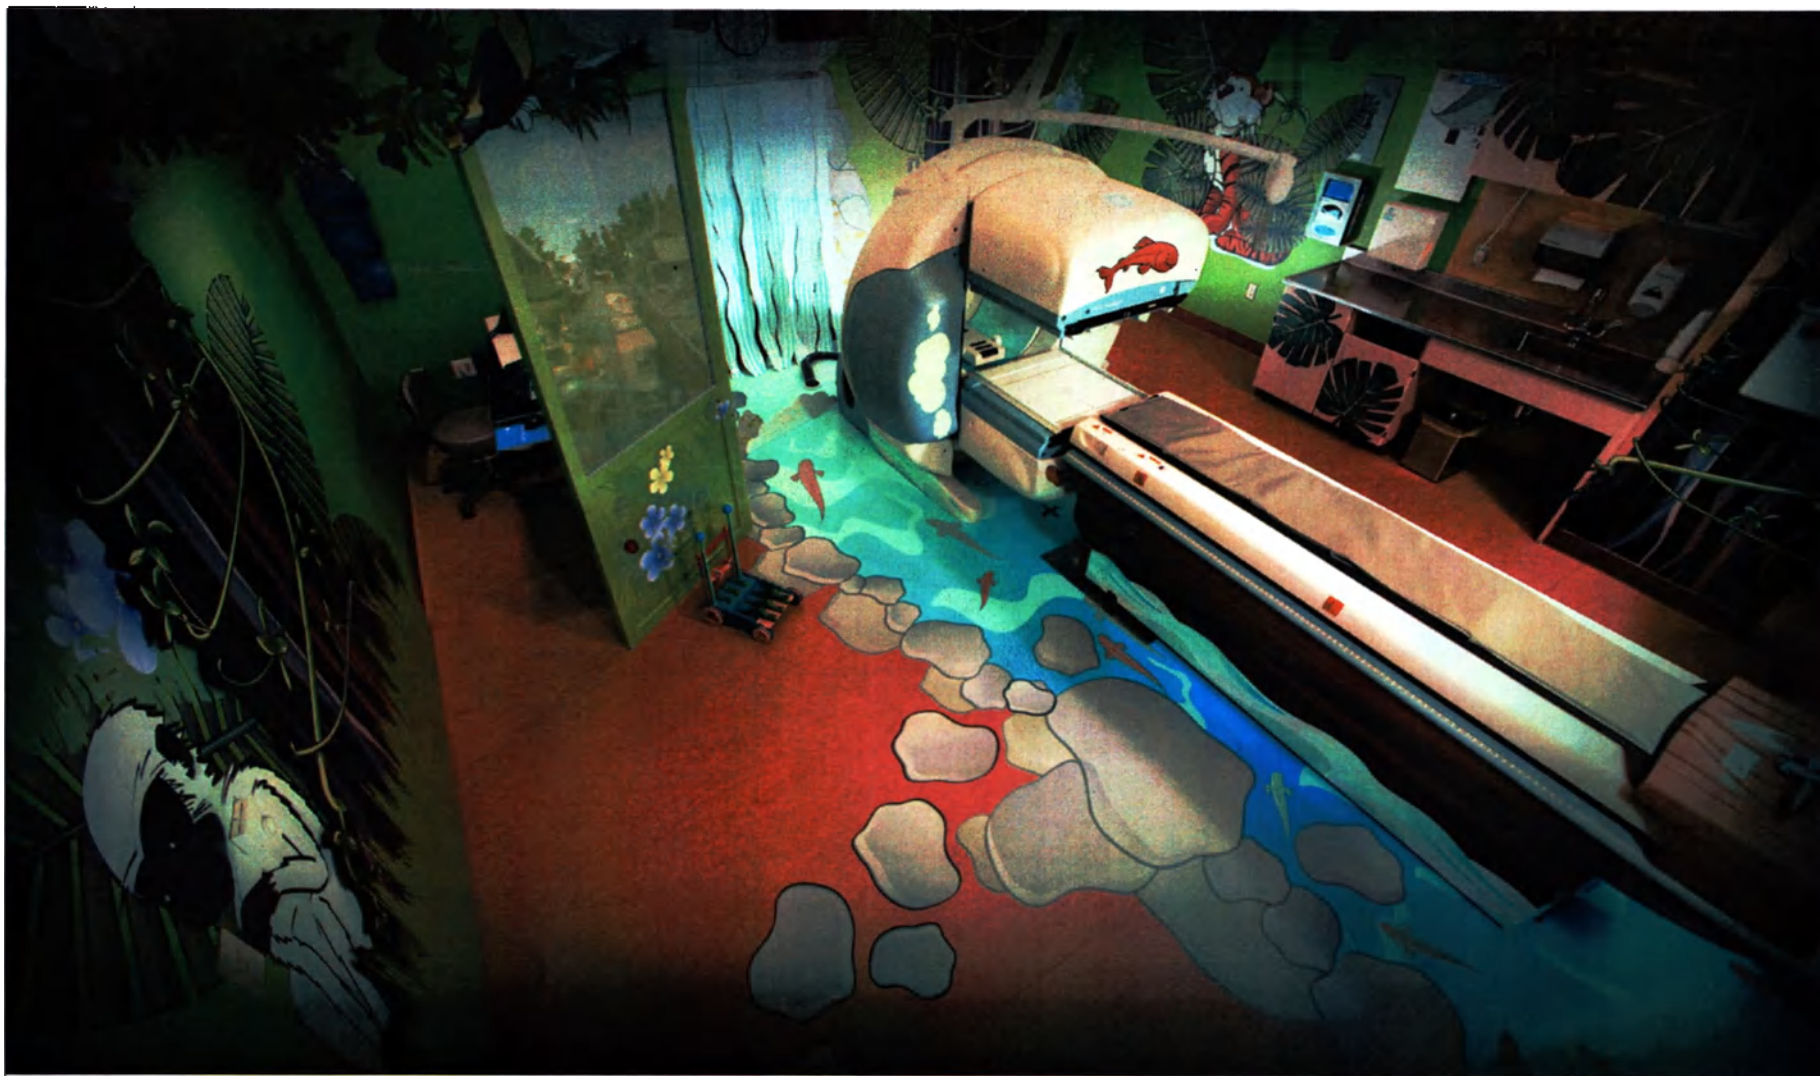


Рис. 59. Наклейки для комнаты сканирования (не более 30 шт.).



Рис. 60. Источники бесперебойного питания (не более 15 шт.), вариант исполнения: Eaton 9PX6K

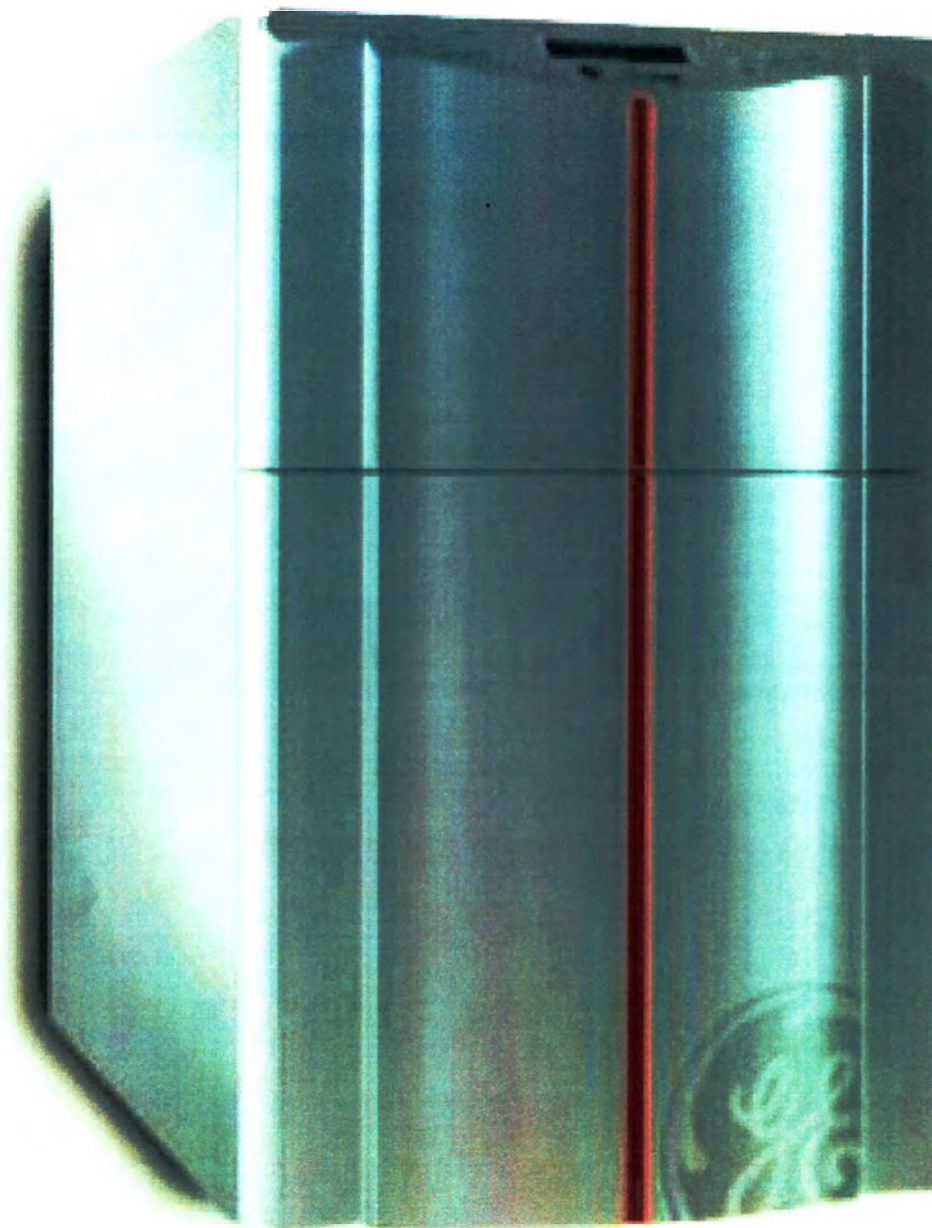


Рис. 61. Источники бесперебойного питания (не более 15 шт.), вариант исполнения: ABB LP6 11



Рис. 62. Источники бесперебойного питания (не более 15 шт.), вариант исполнения: Liebert GXT4



Рис. 63. Источники бесперебойного питания (не более 15 шт.), вариант исполнения: Eaton 9355-15-14GE

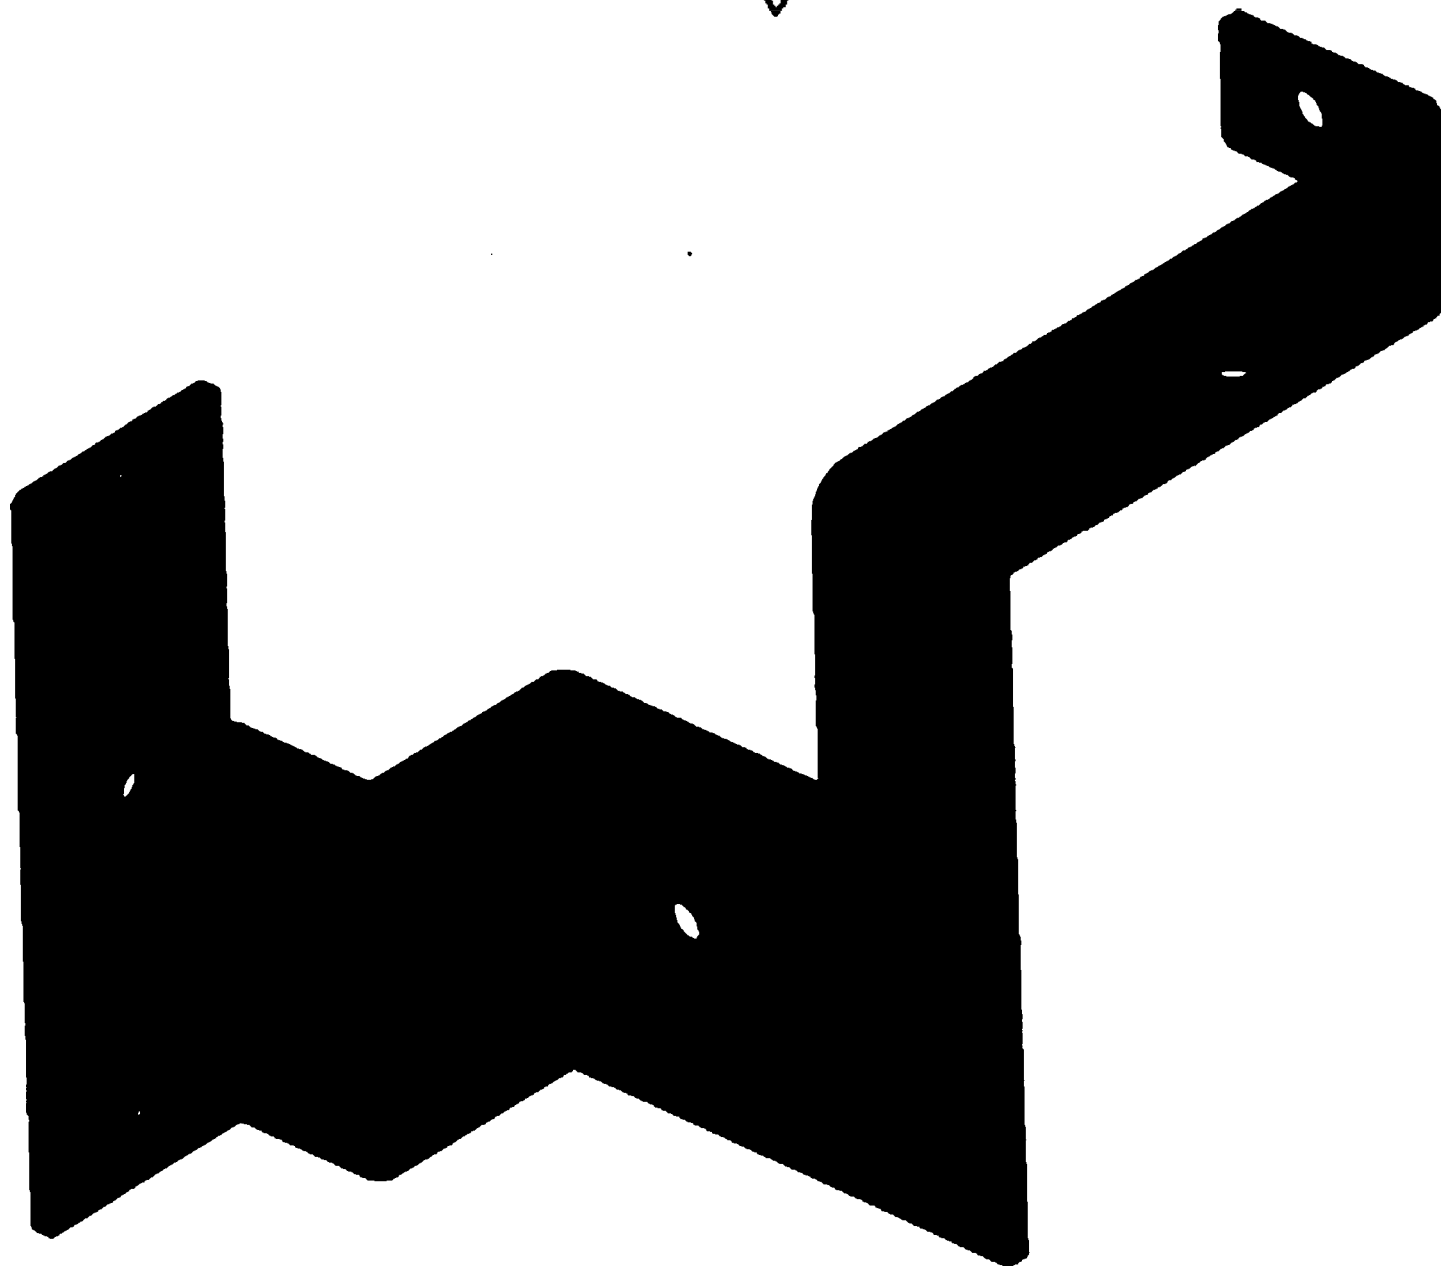


Рис. 64. Крепления для источника бесперебойного питания (не более 10 шт.).



Рис. 65. Щит питания распределительный. (1 шт.).

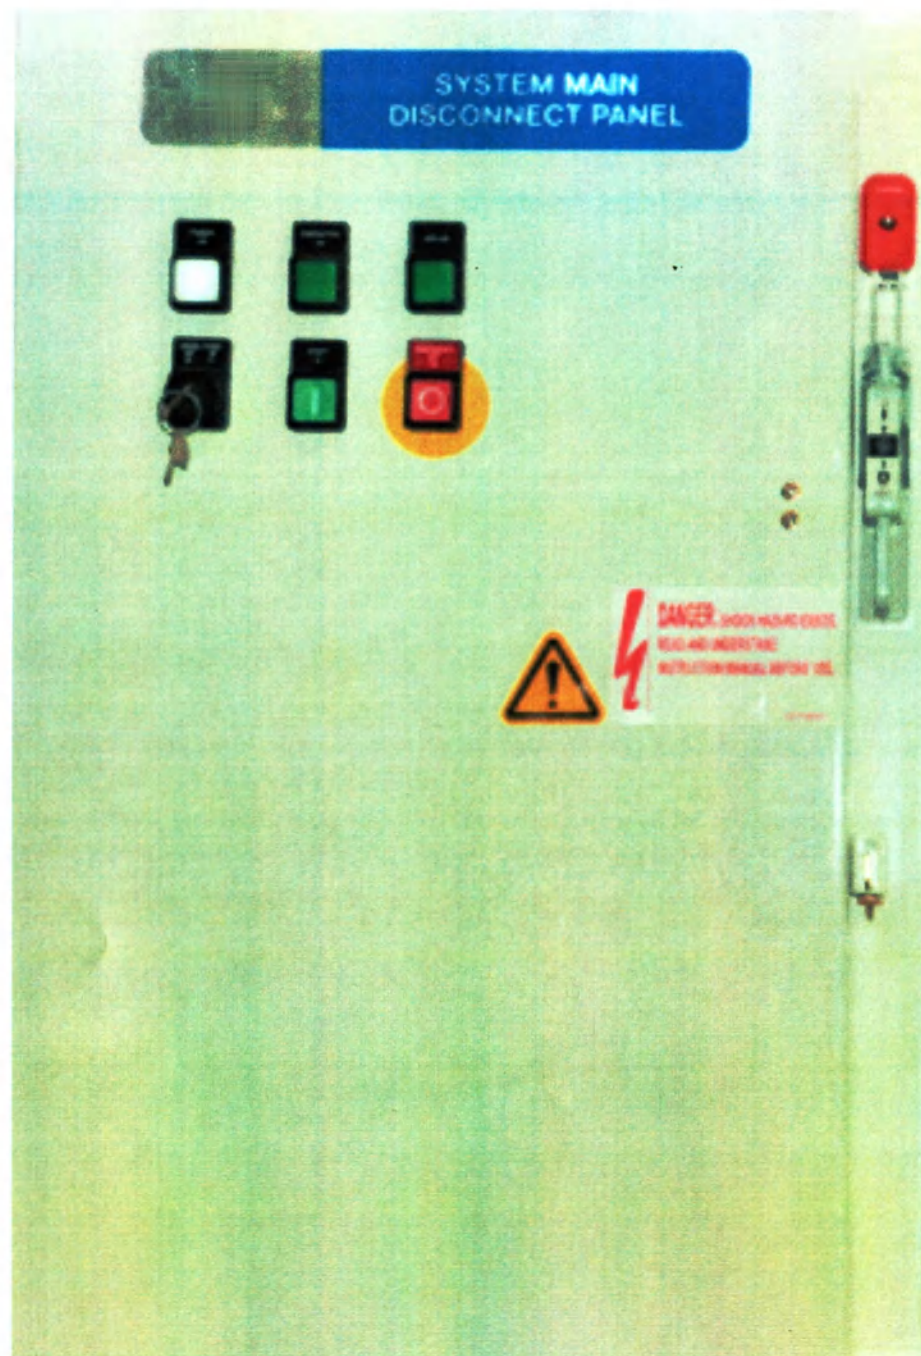


Рис. 66. Щит питания распределительный. (1 шт.).



Рис. 67. Щит питания распределительный. (1 шт.).



Рис. 68. Щит питания распределительный. (1 шт.).



Рис. 69. Станция рабочая Xeleris (не более 4 шт.).

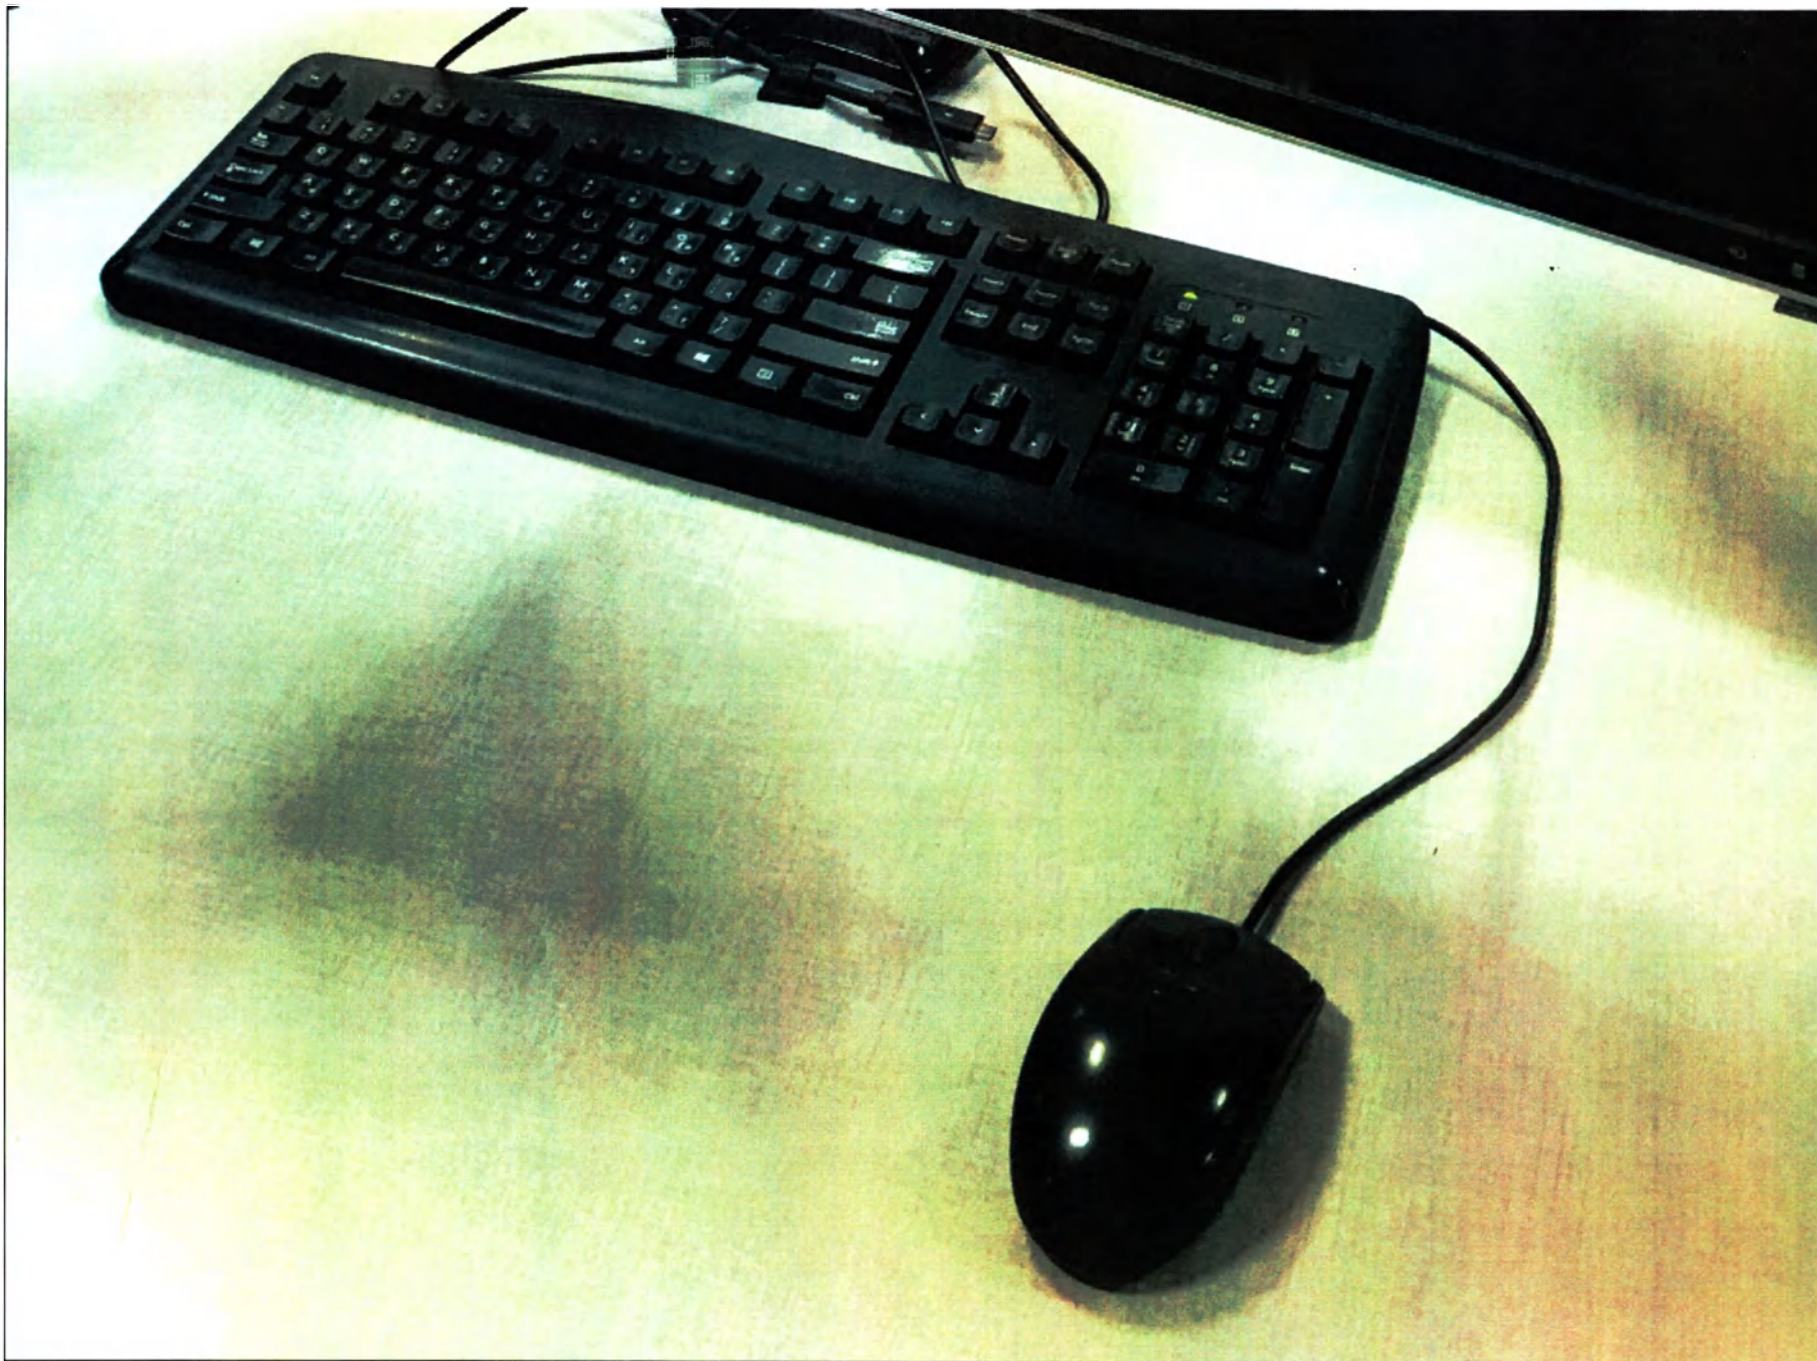


Рис. 70. Станция рабочие Xeleris (не более 4 шт.).

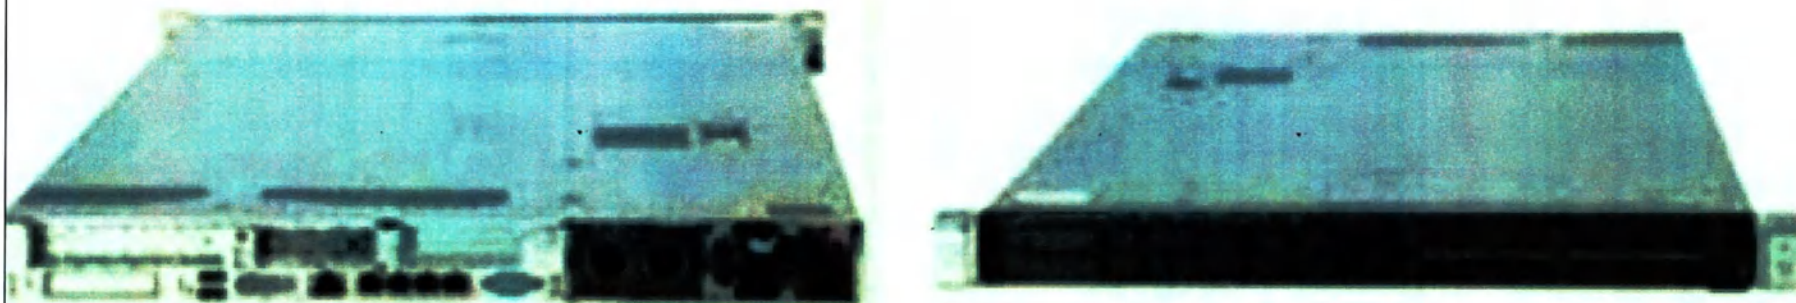


Рис. 71. Сервер для рабочей станции Xeleris (не более 10 шт.).



Рис. 72. Документы для станции рабочей (не более 30 шт.).



Рис. 73. Мониторы для рабочей станции (не более 8 шт.).

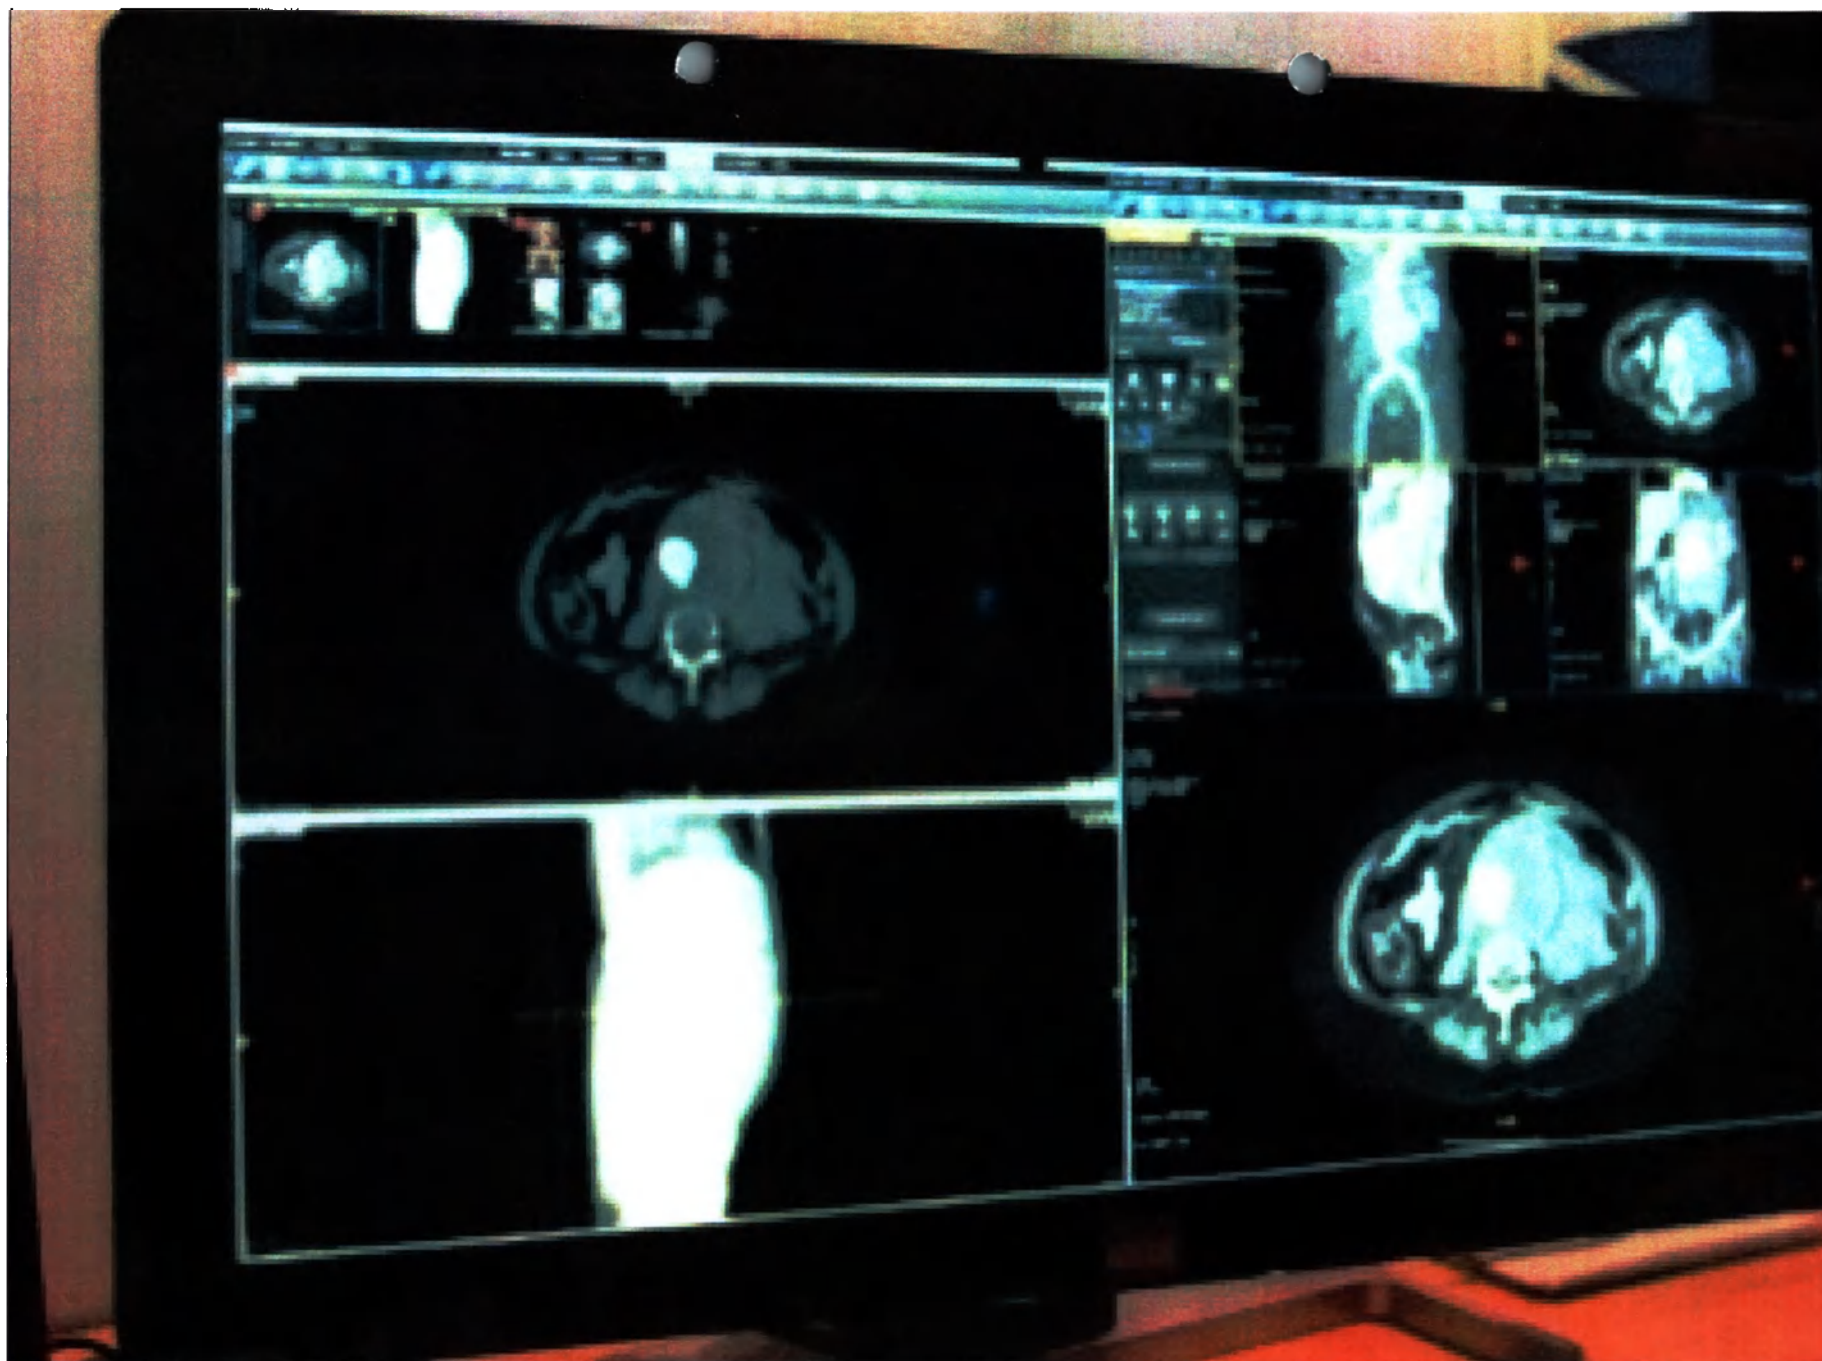


Рис. 74. Мониторы для рабочей станции (не более 8 шт.).



Рис. 75. Кабели для рабочей станции (не более 4 шт.).



Рис. 76. Кабели для рабочей станции (не более 4 шт.).



Рис. 77. Источники бесперебойного питания для рабочей станции (не более 4 шт.).



Рис. 78. Наклейки для клавиатуры (не более 4 шт.).

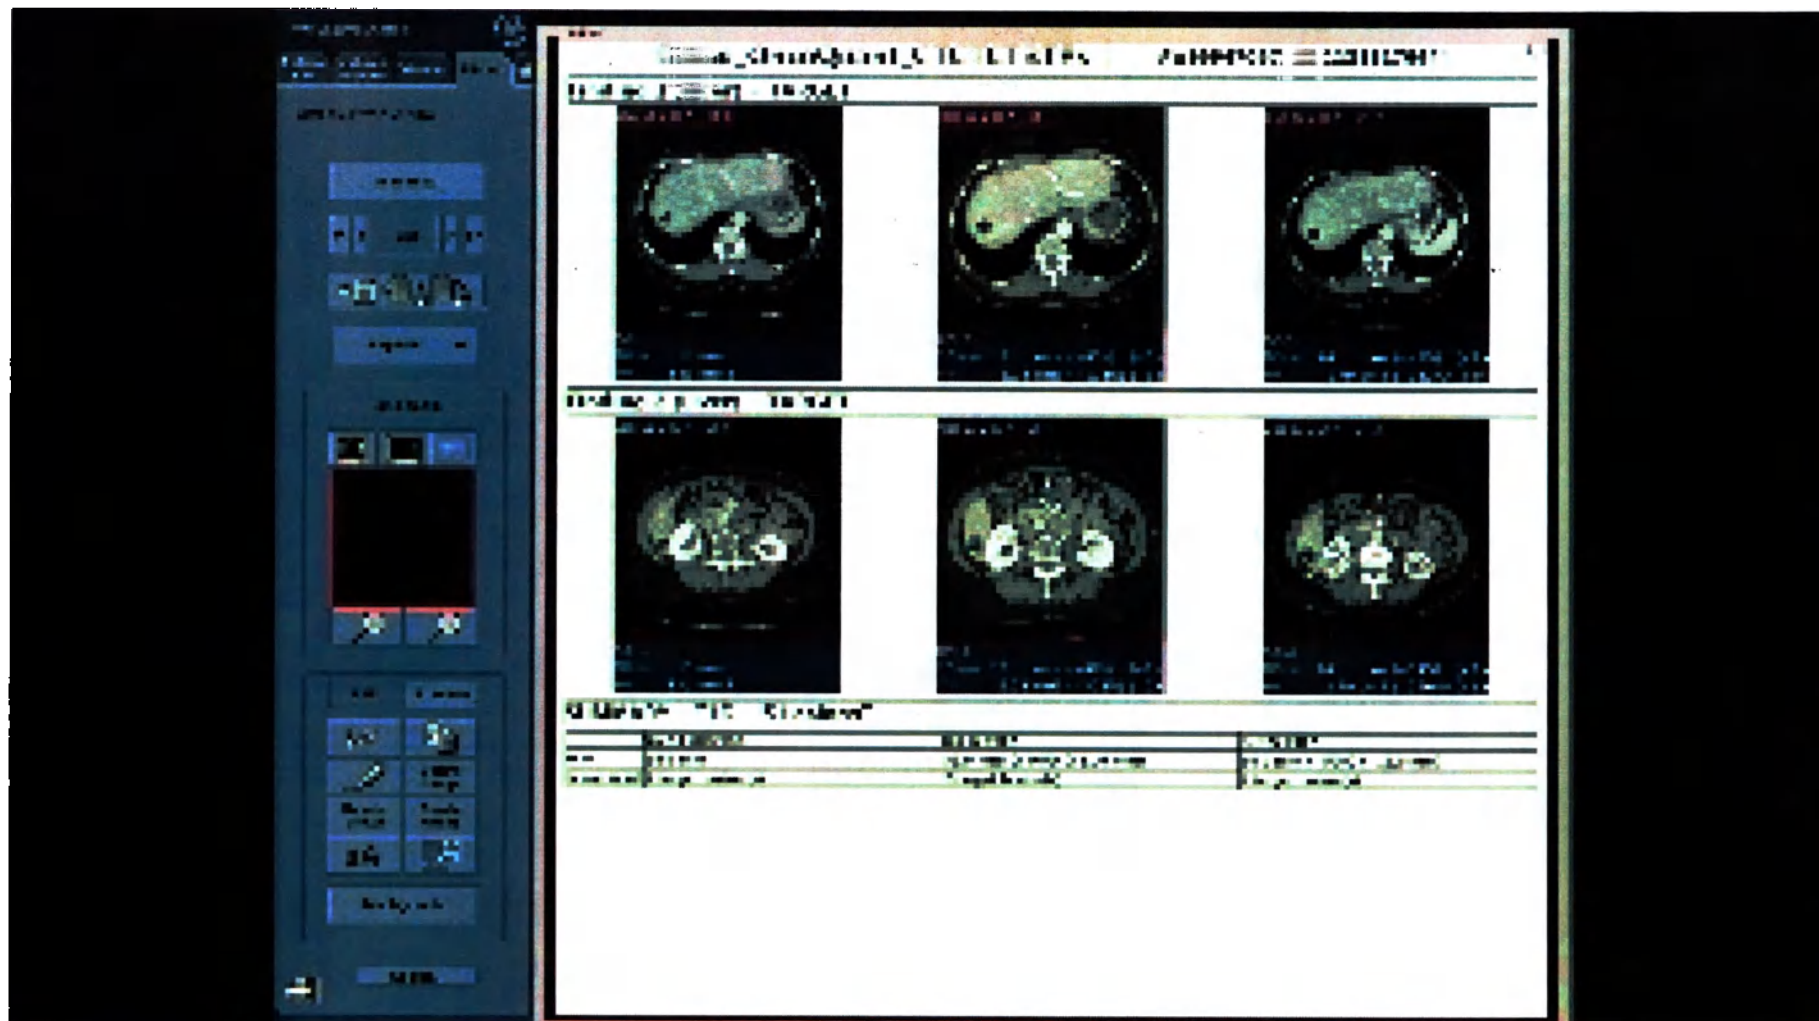


Рис. 79. Программные пакеты для ОФЭКТ-исследований (не более 20 шт.).

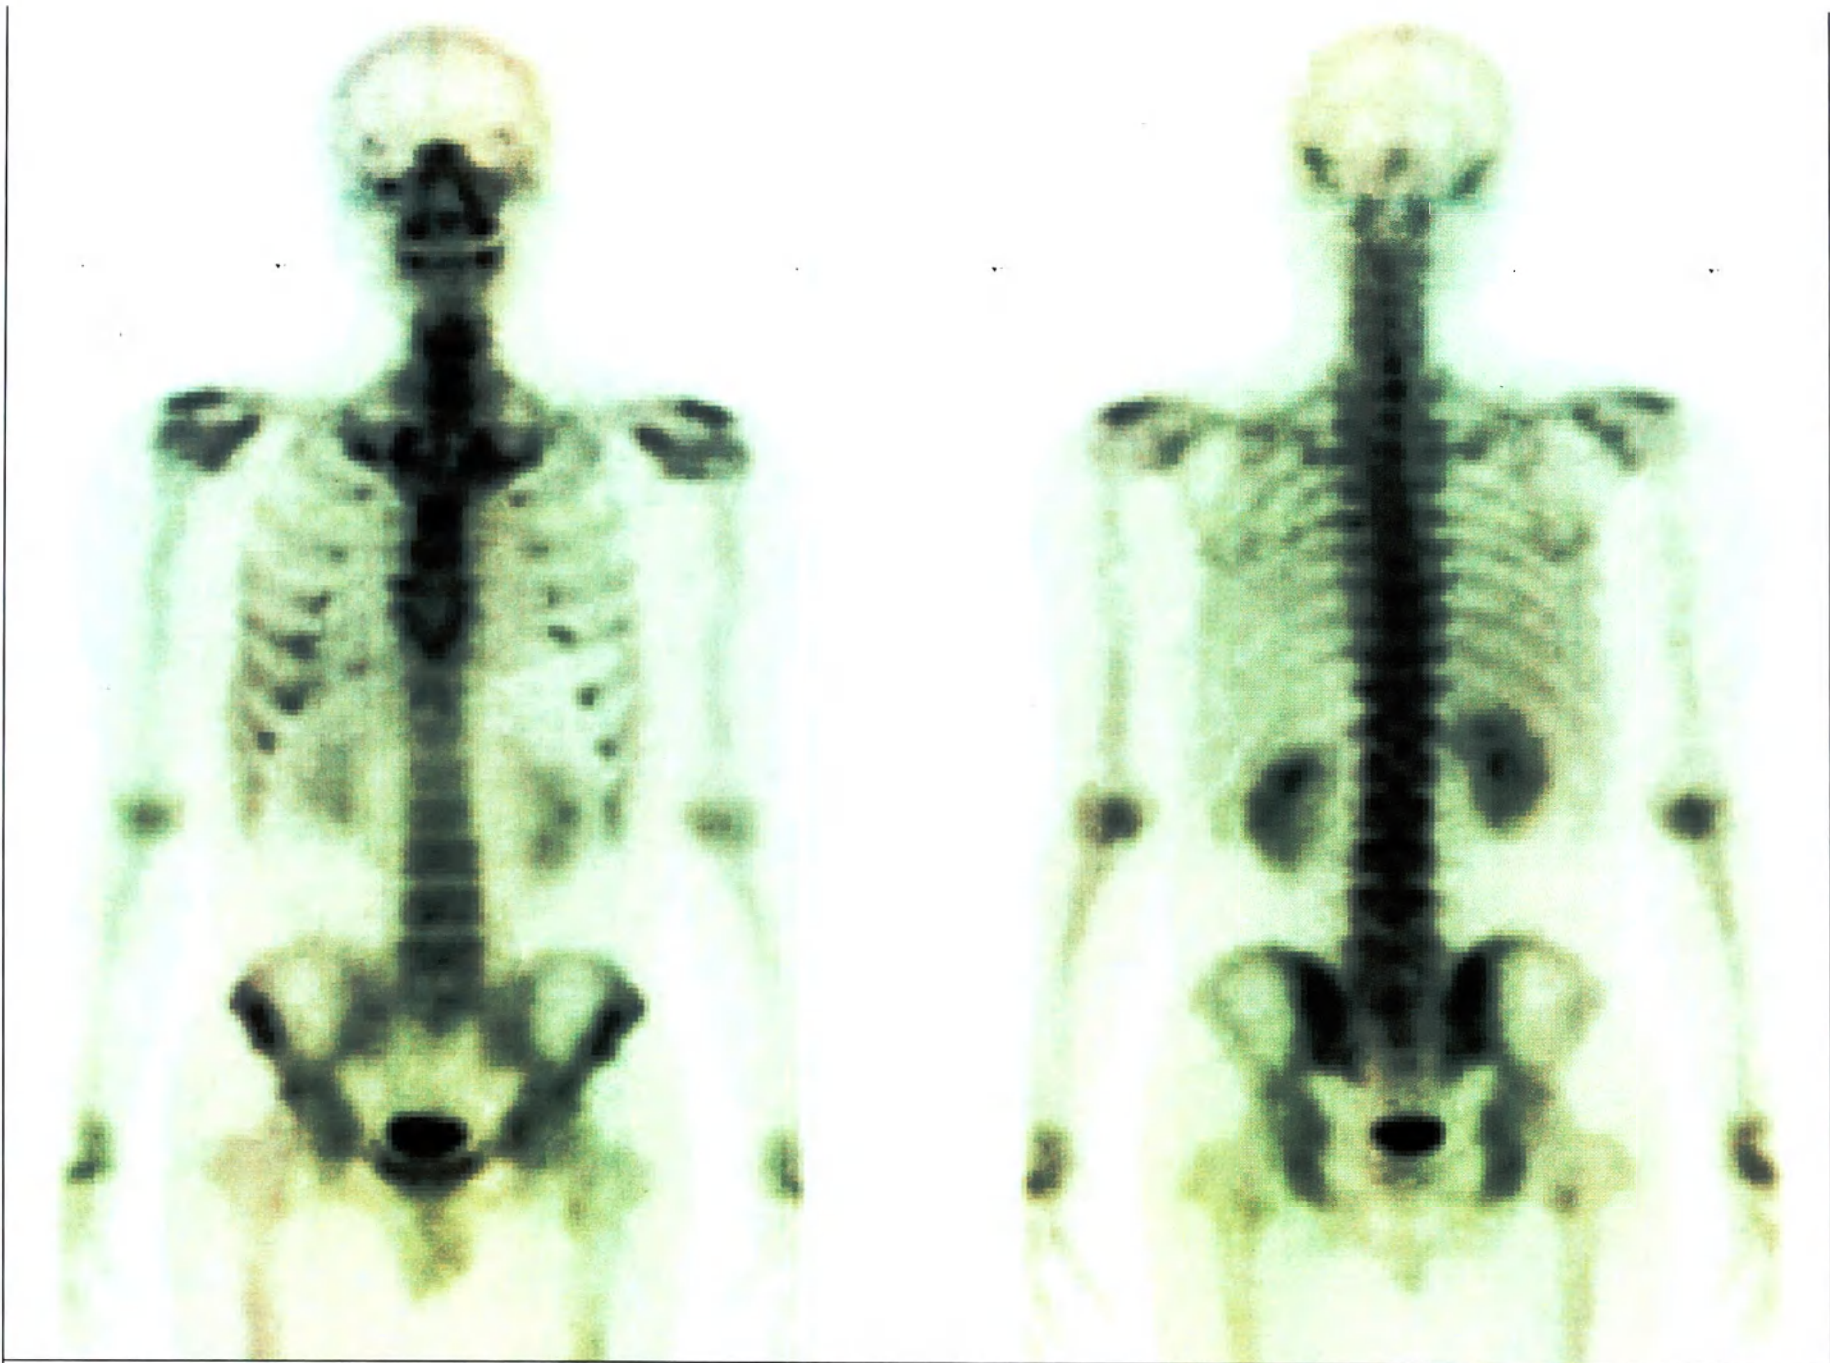


Рис. 81. Программные пакеты для ОФЭКТ-исследований (не более 20 шт.).

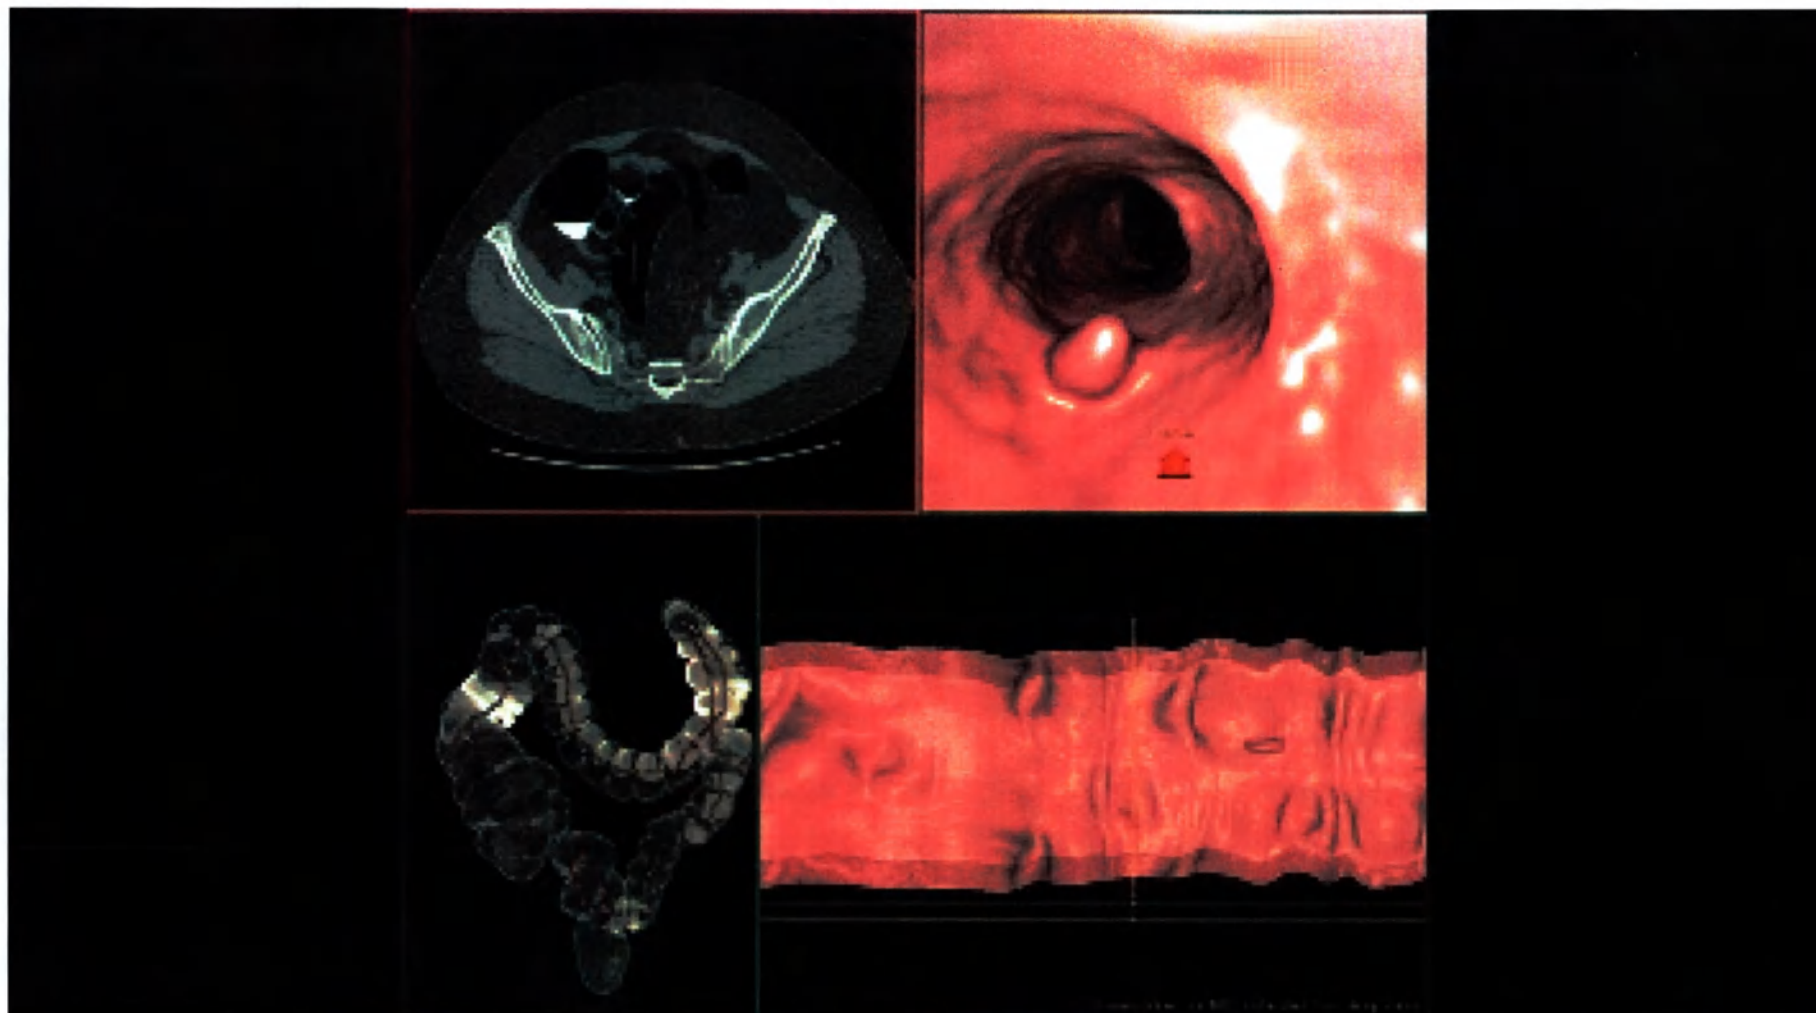


Рис. 82. Программные пакеты для КТ-исследований (не более 30 шт.).



Рис. 83. Программные пакеты для КТ-исследований (не более 30 шт.).

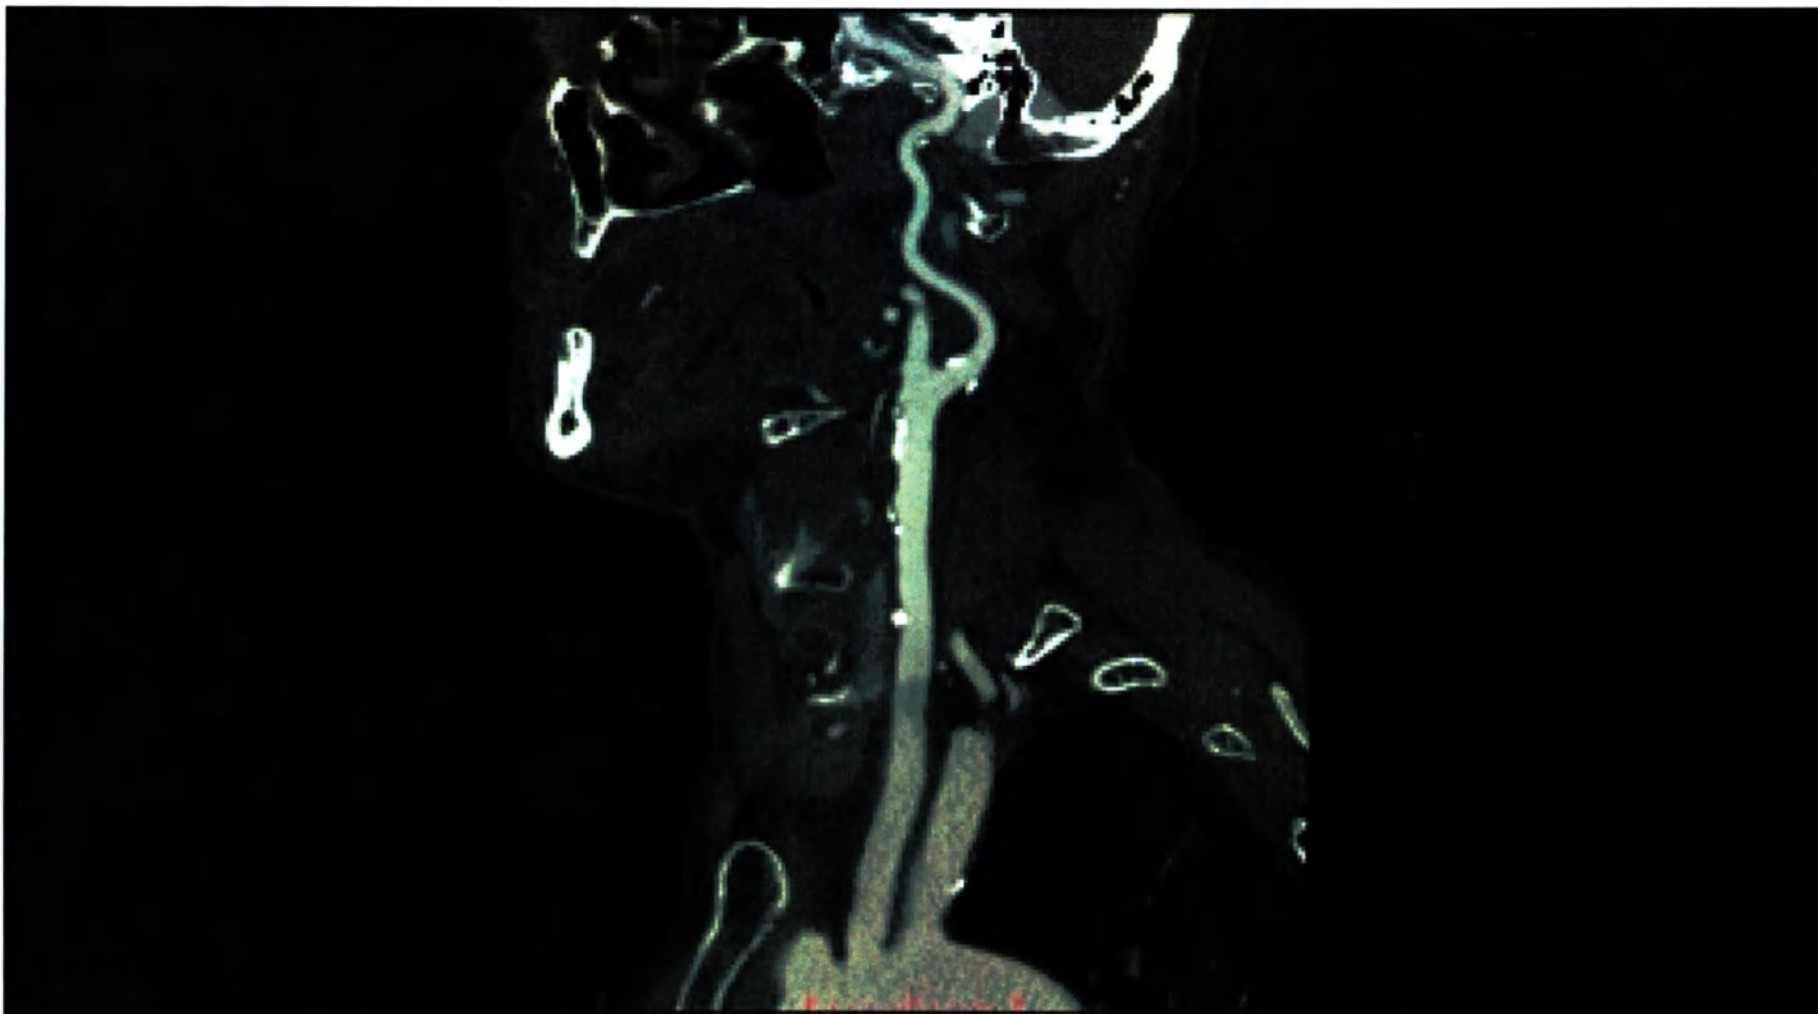


Рис. 84. Программные пакеты для КТ-исследований (не более 30 шт.).



Рис. 85. Программные пакеты для КТ-исследований (не более 30 шт.).

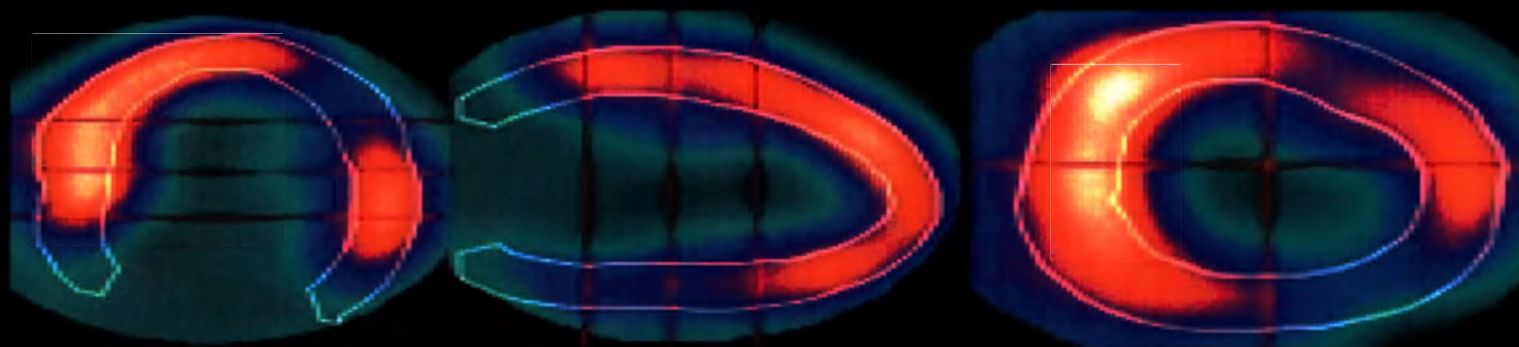


Рис. 86. Программные пакеты для кардиологических исследований (не более 40 шт.).

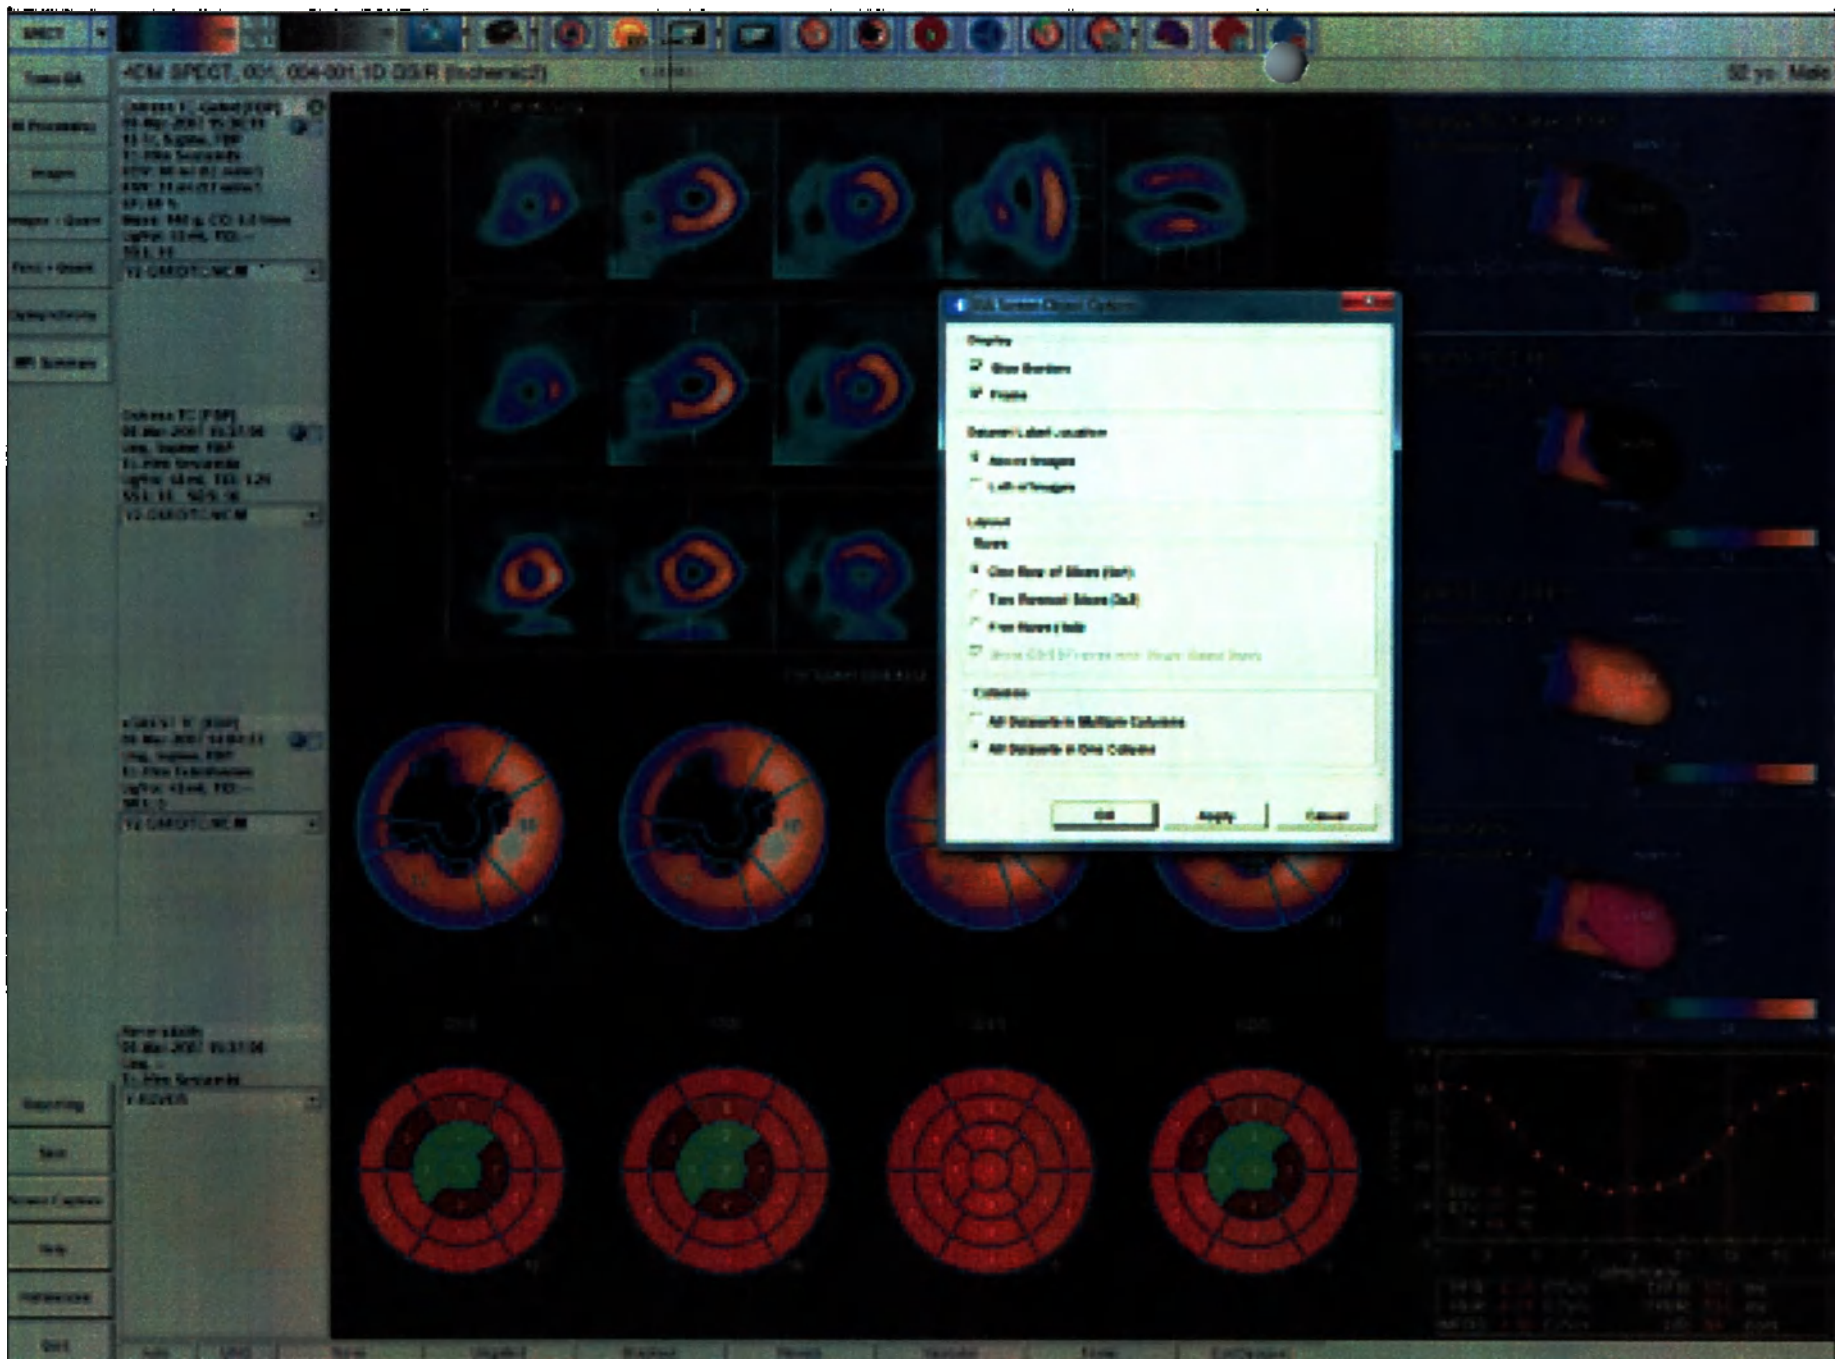


Рис. 87. Программные пакеты для кардиологических исследований (не более 40 шт.).

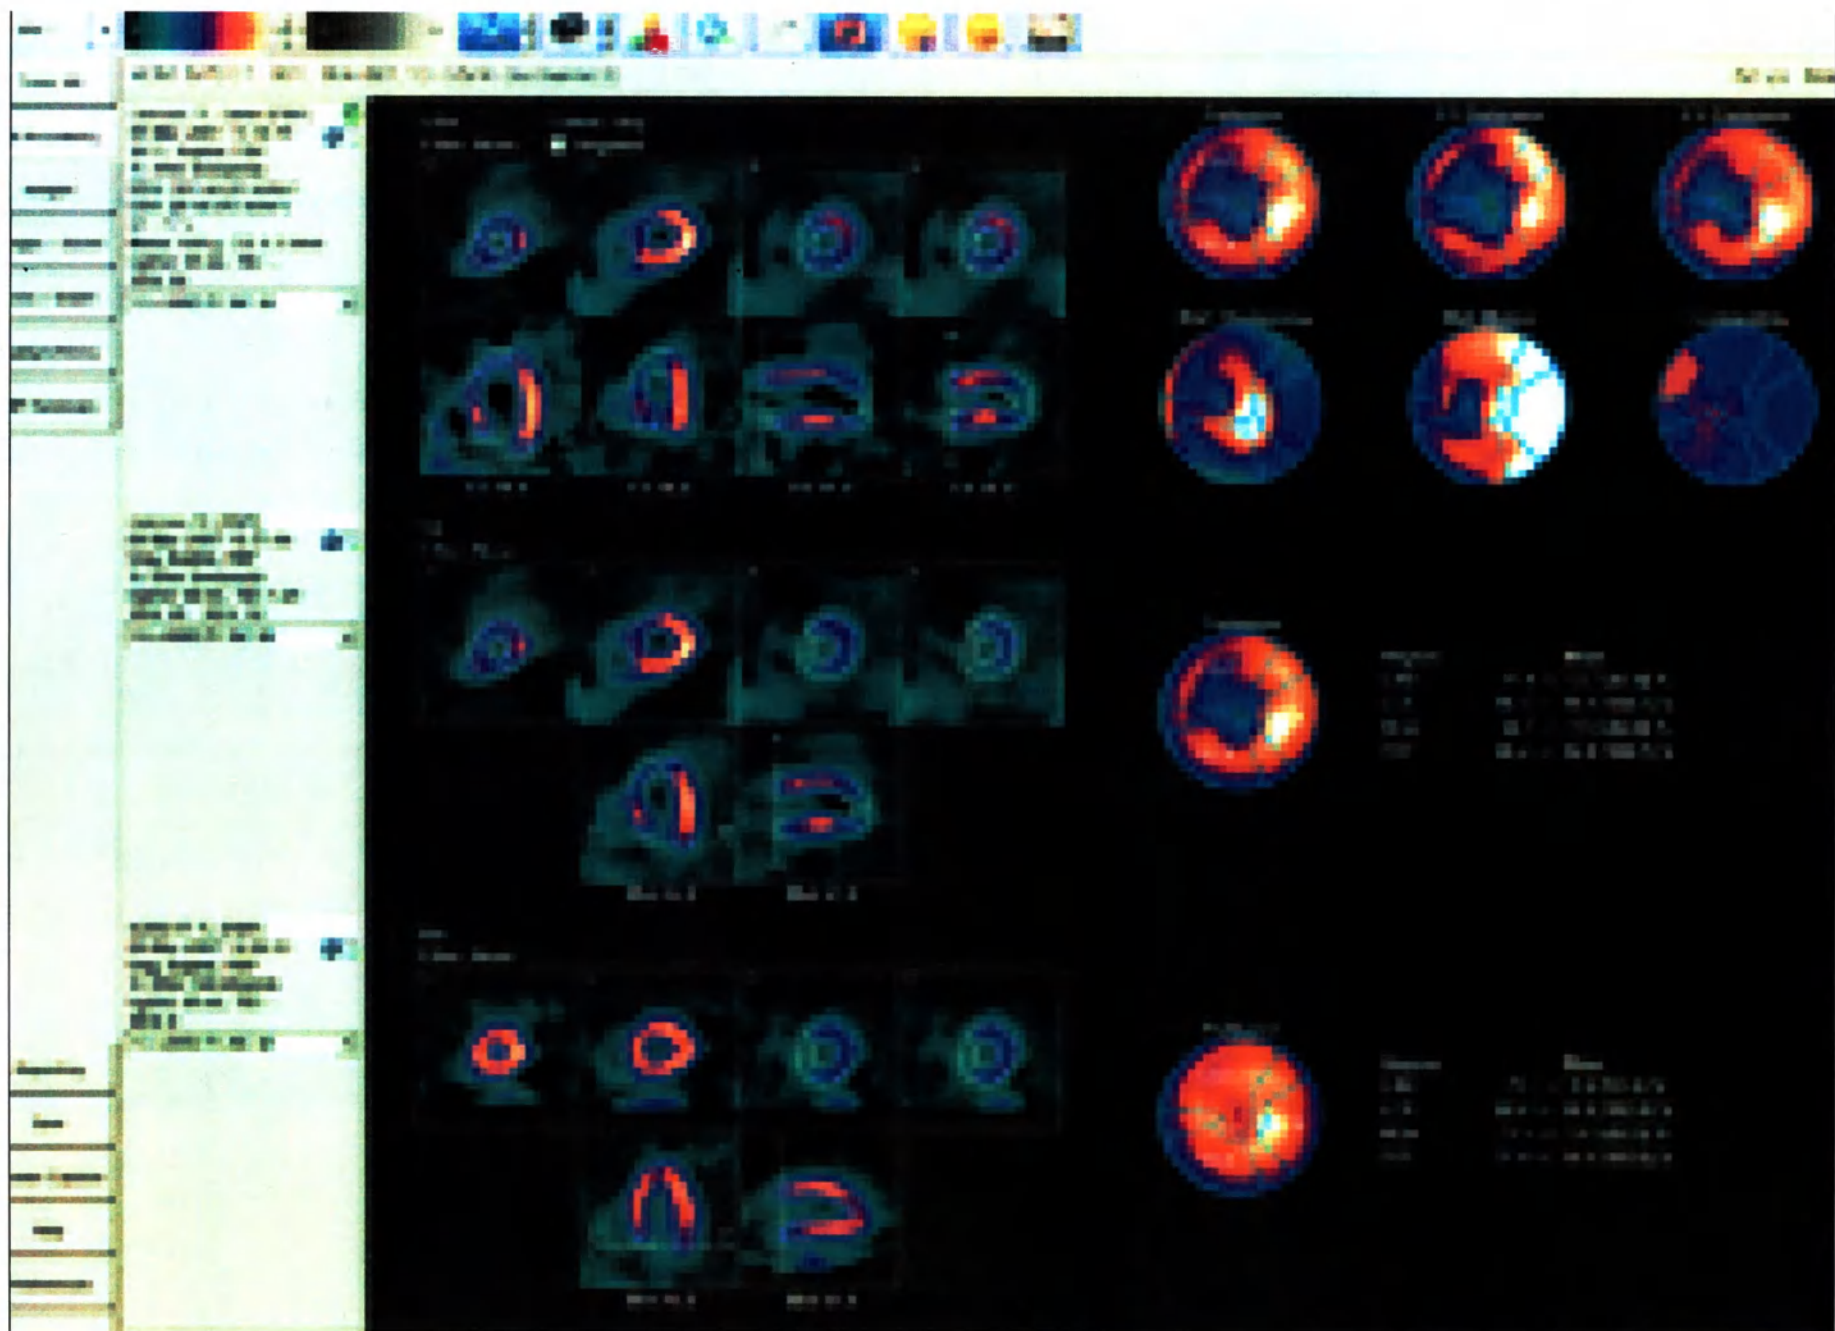


Рис. 88. Программные пакеты для кардиологических исследований (не более 40 шт.).



Рис. 89. Программные пакеты для кардиологических исследований (не более 40 шт.).

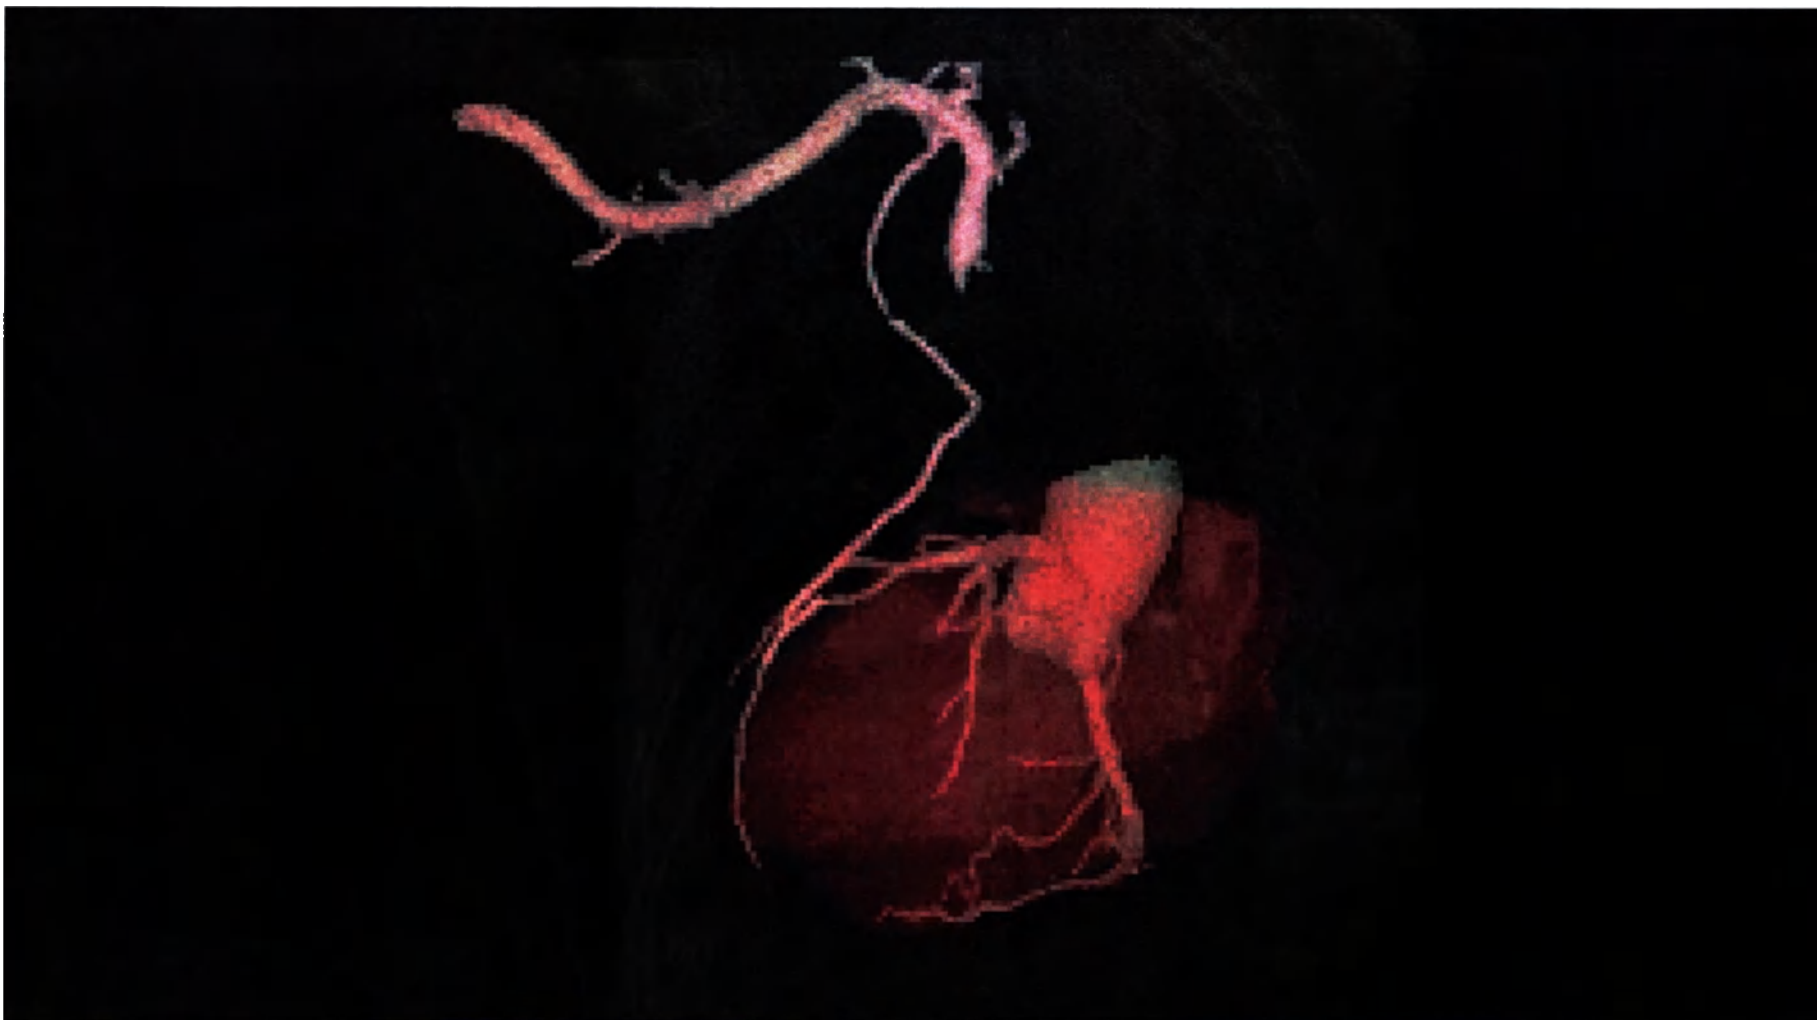


Рис. 90. Программные пакеты для кардиологических исследований (не более 40 шт.).

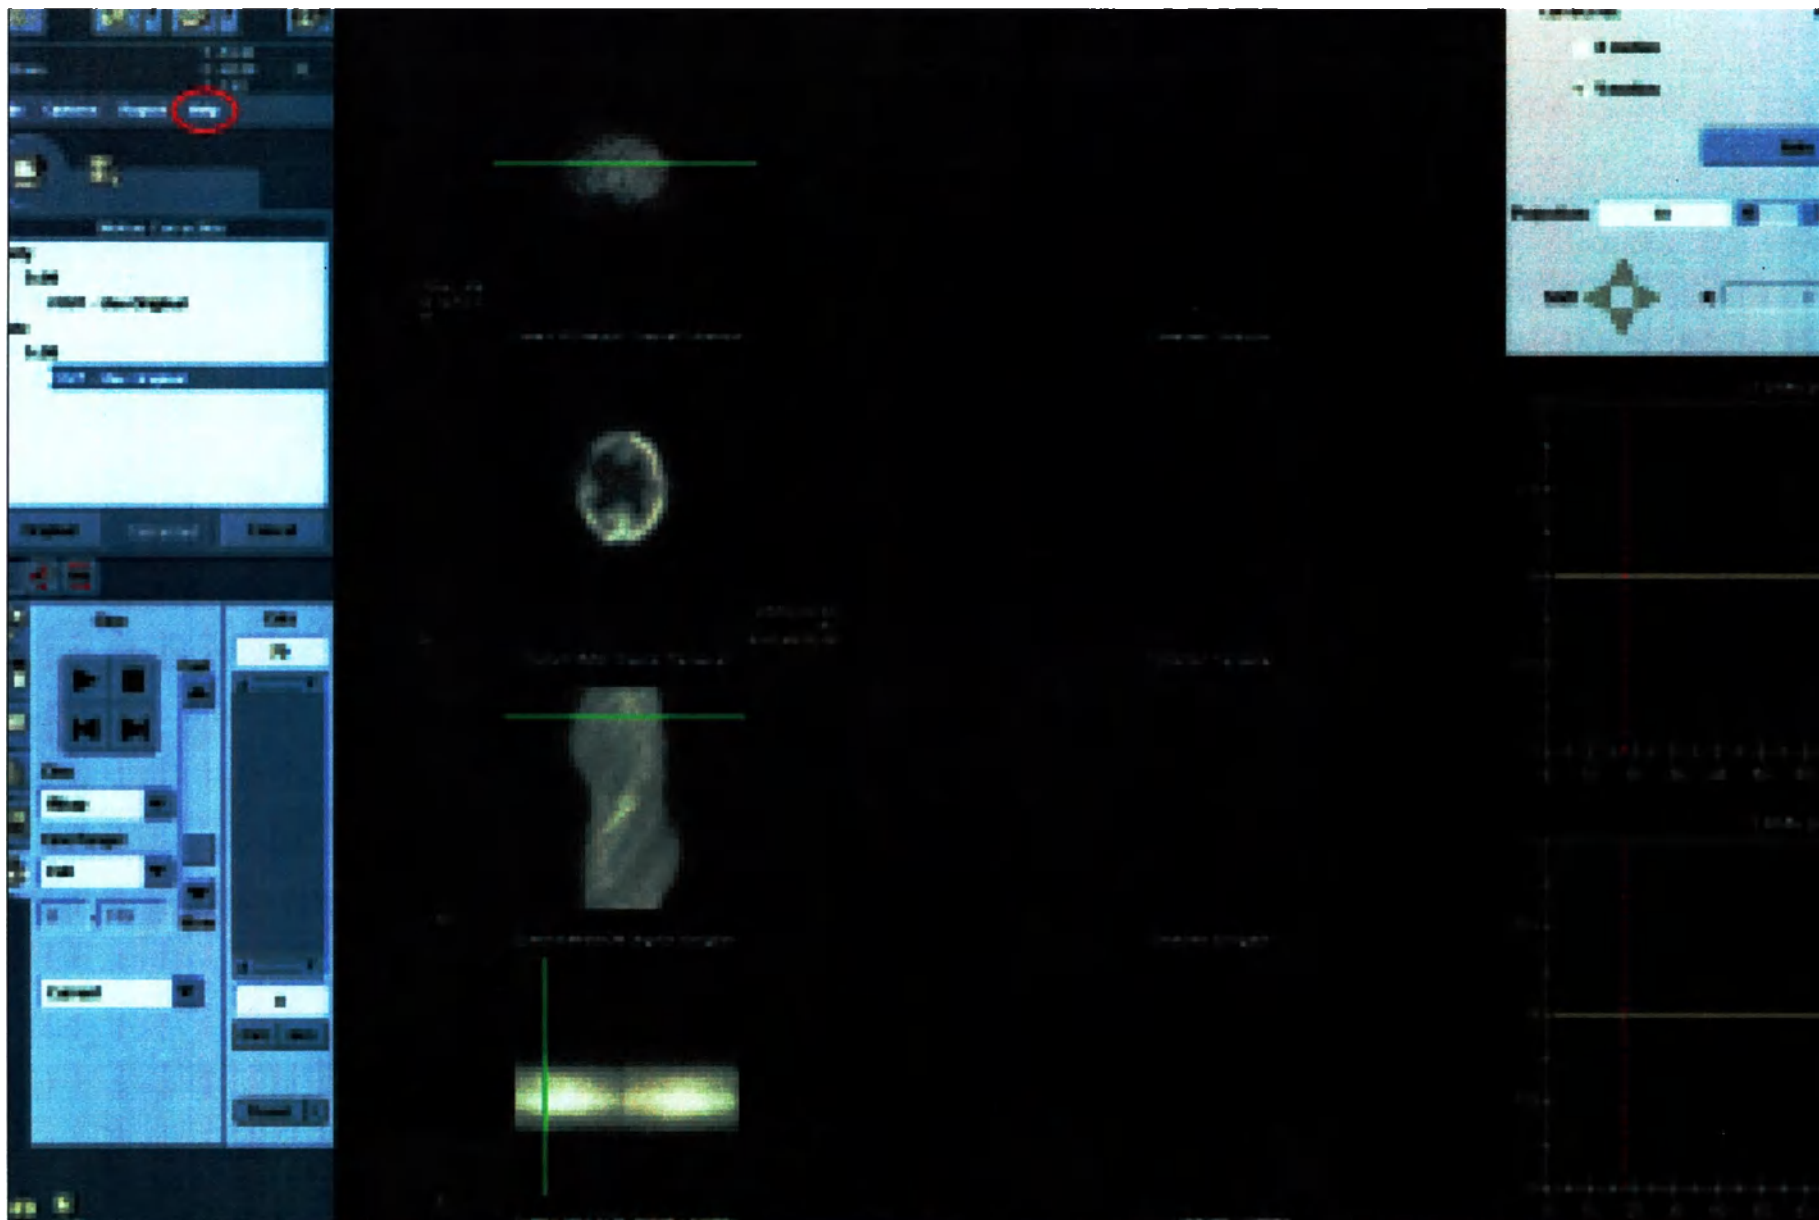


Рис. 92. Программные пакеты для неврологических исследований (не более 10 шт.).

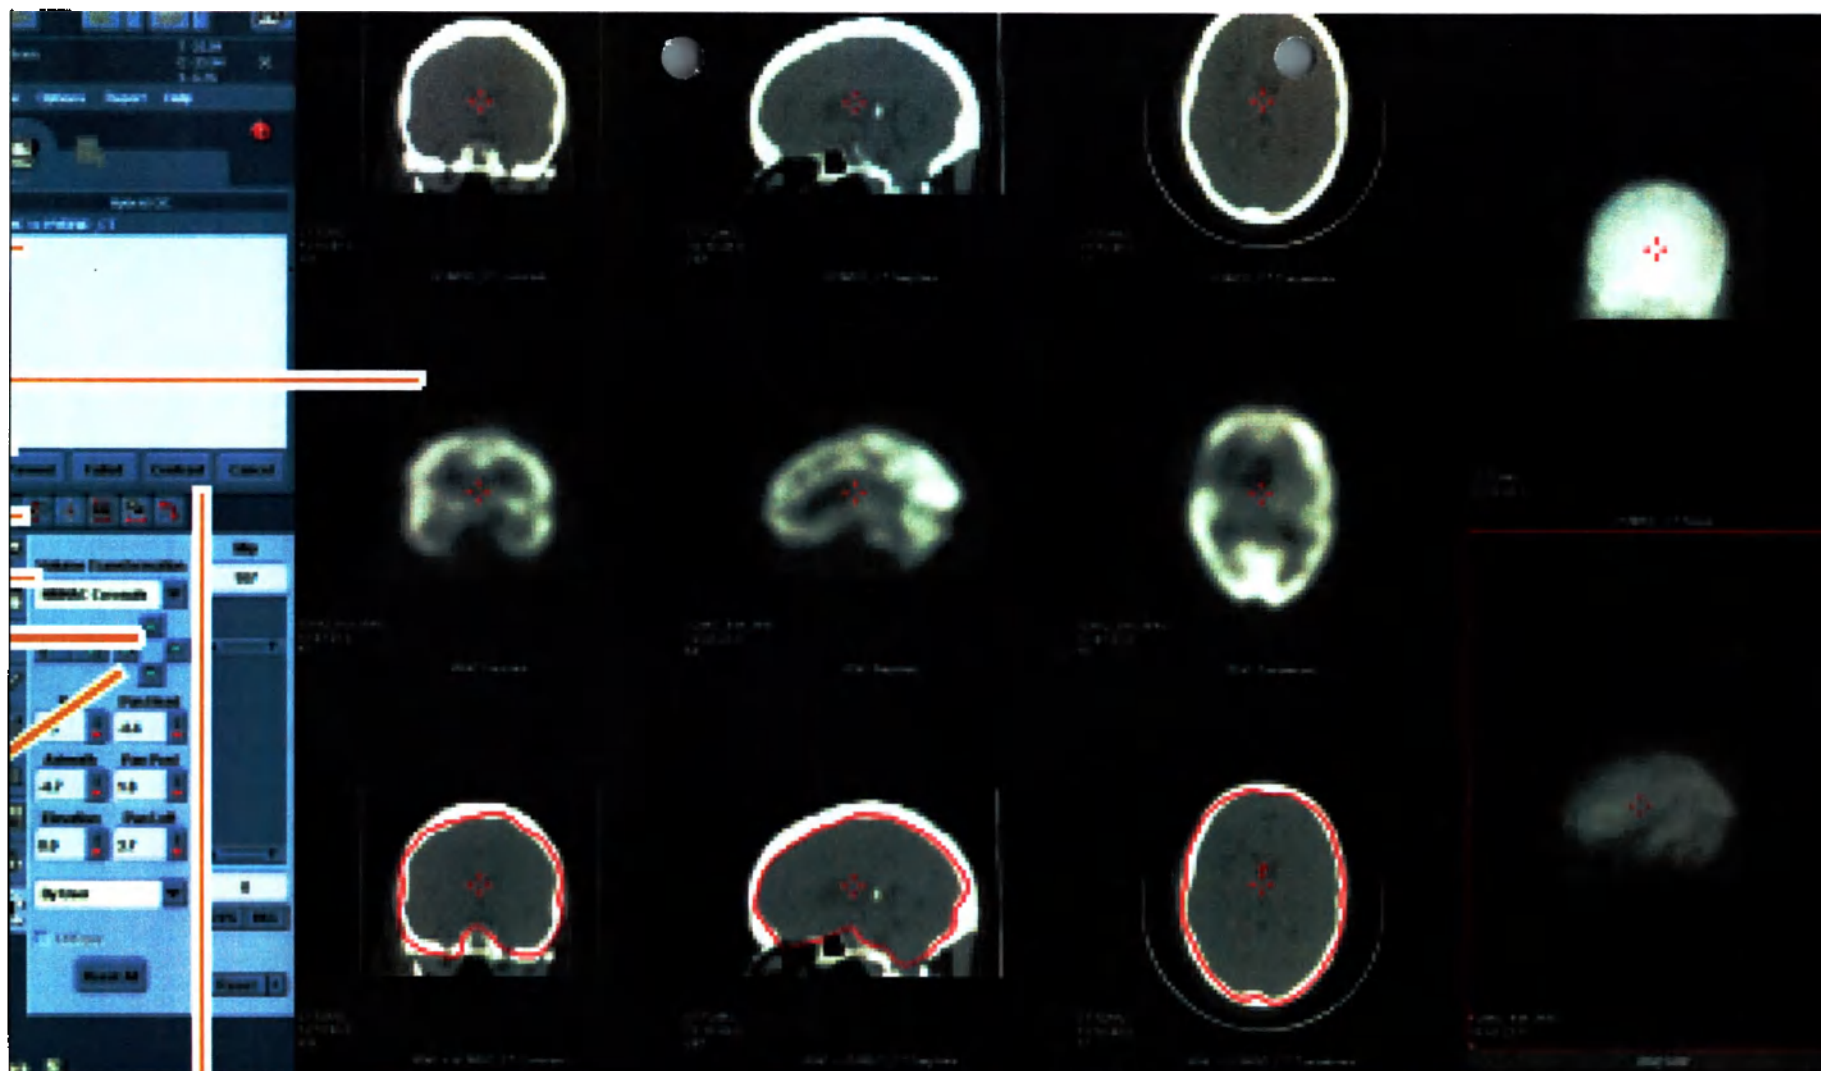


Рис. 93. Программные пакеты для неврологических исследований (не более 10 шт.).

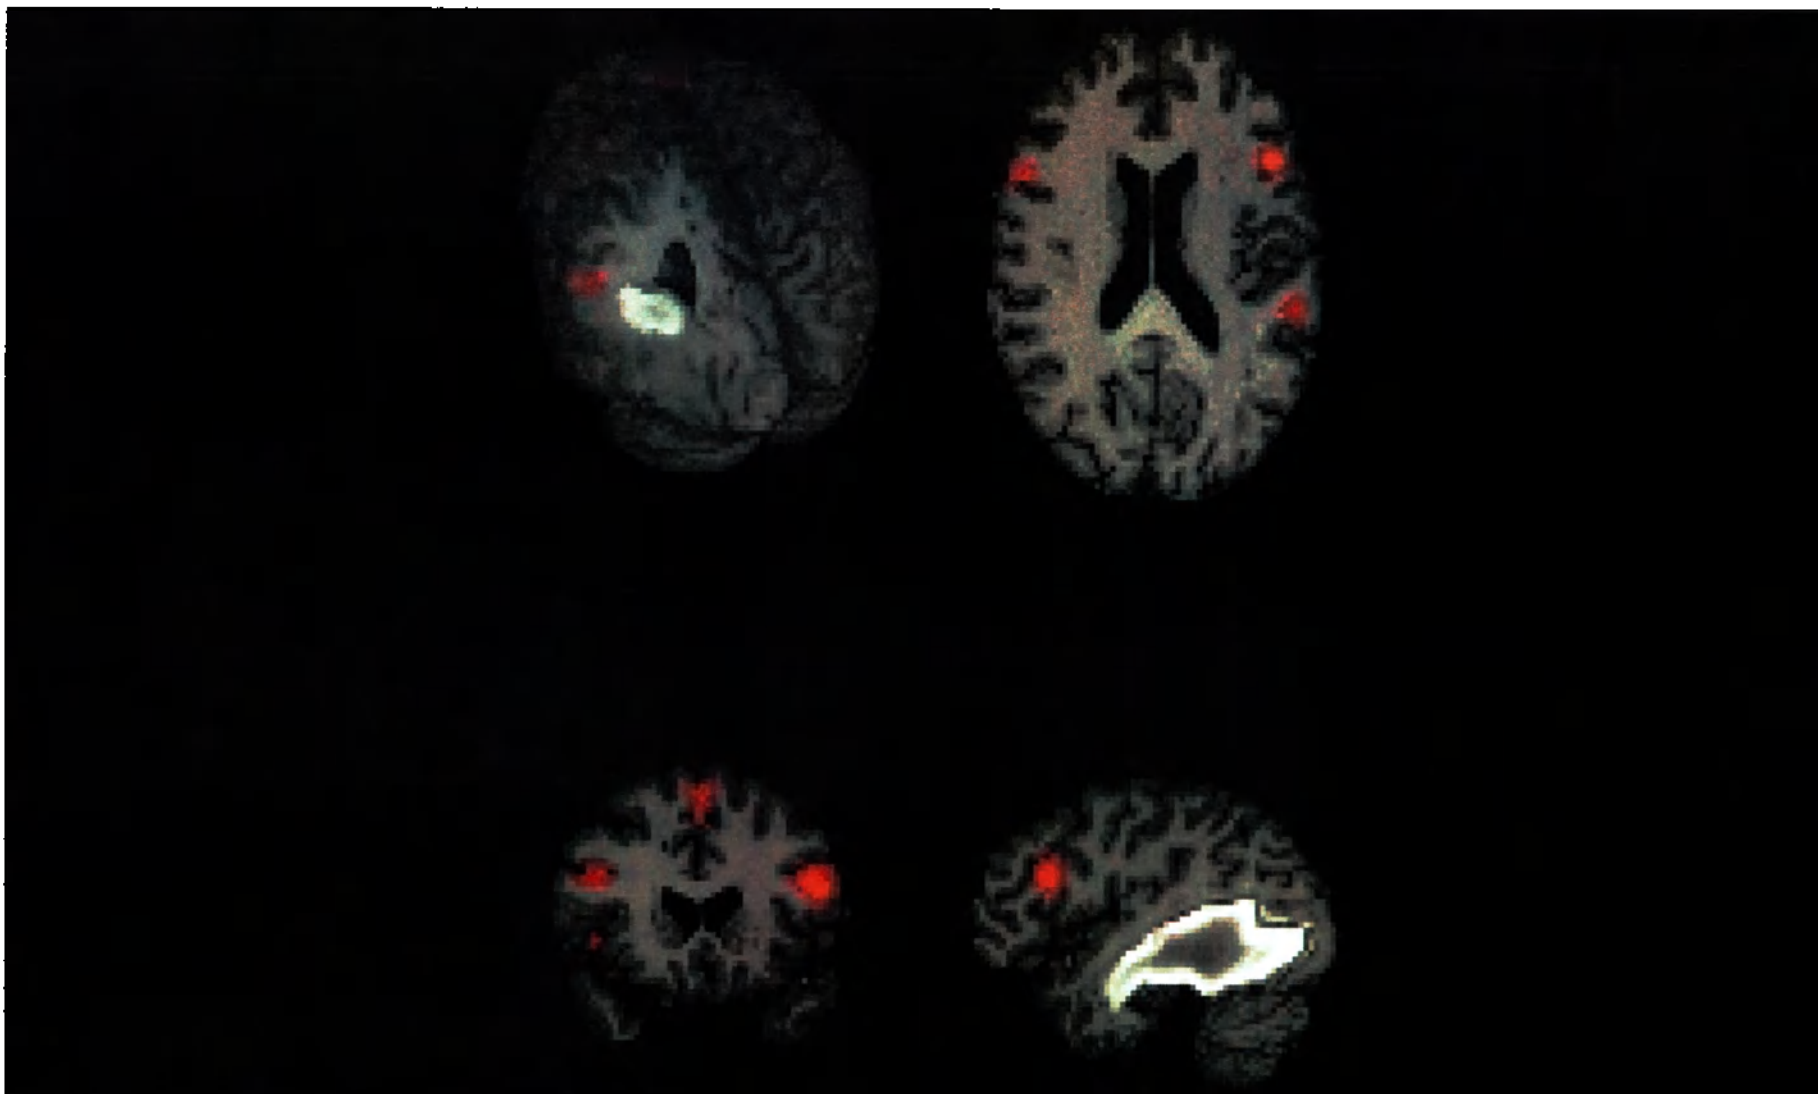


Рис. 94. Программные пакеты для неврологических исследований (не более 10 шт.).

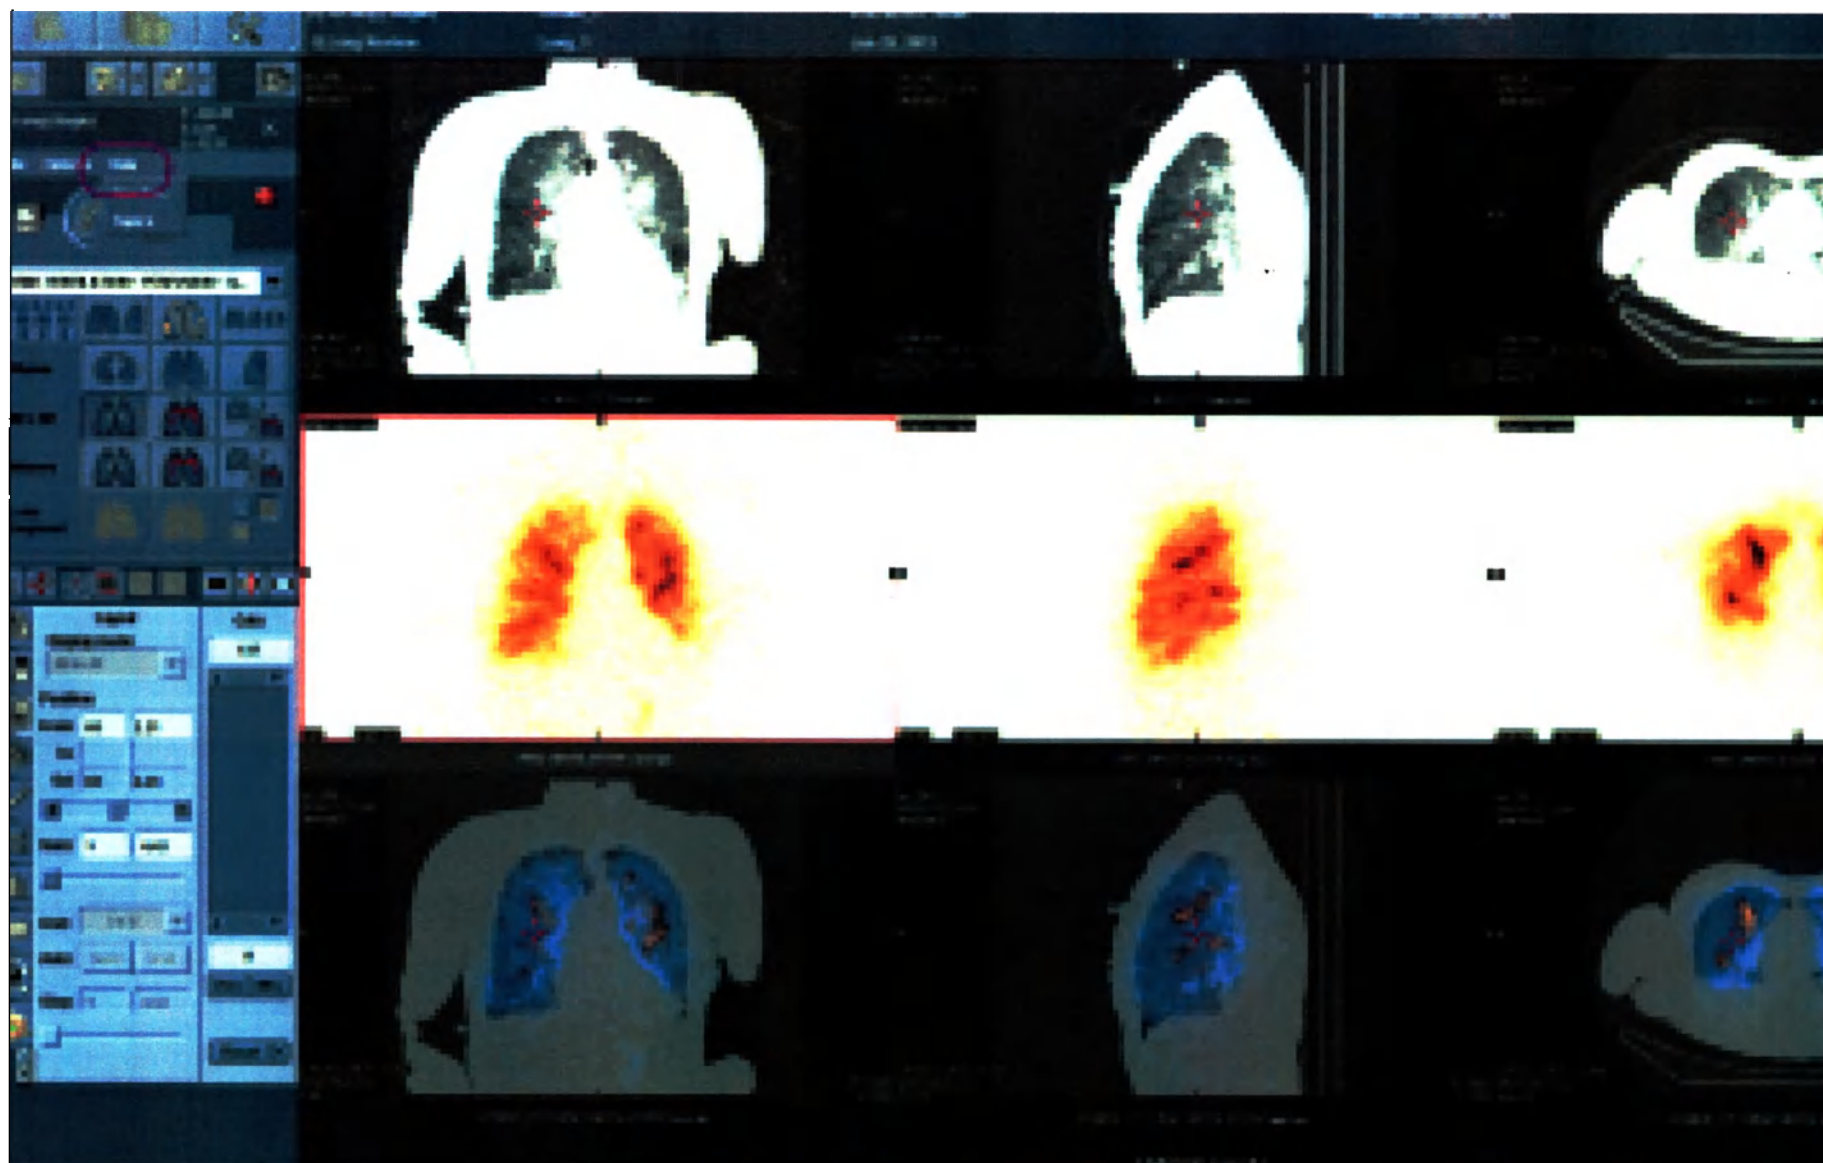


Рис. 95. Программные пакеты для исследований легких (не более 10 шт.).

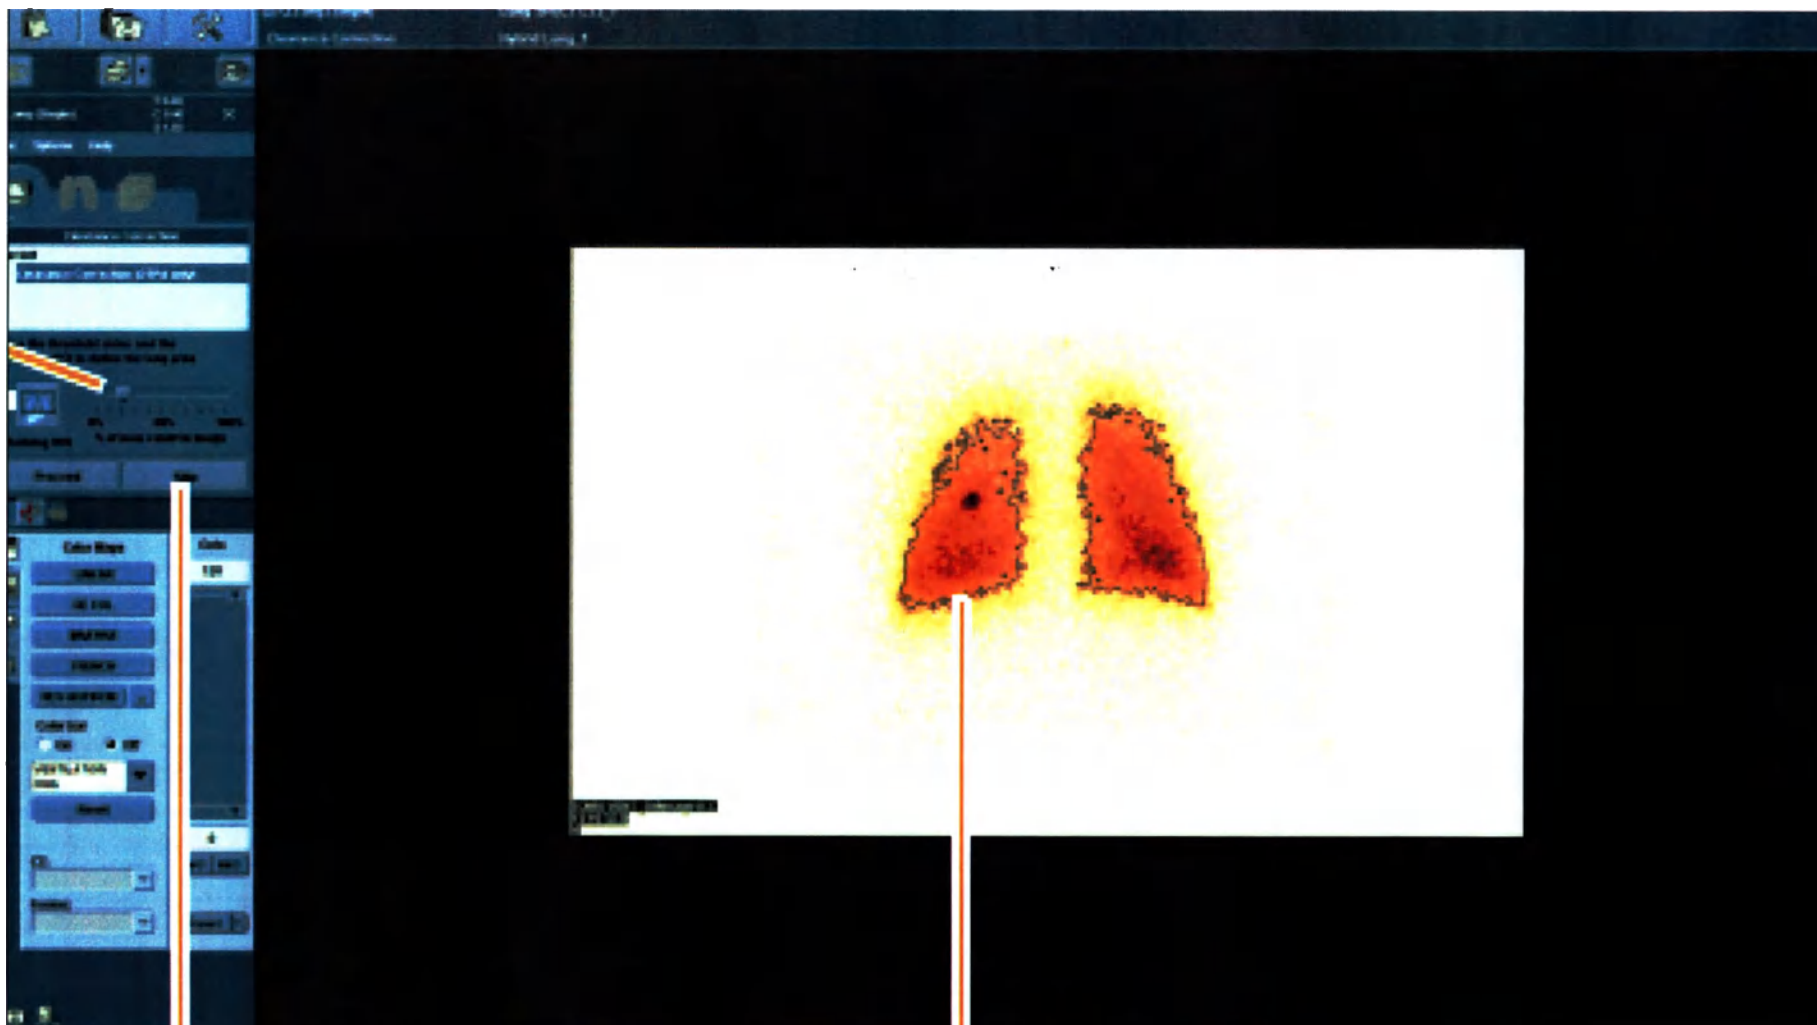


Рис. 96. Программные пакеты для исследований легких (не более 10 шт.).

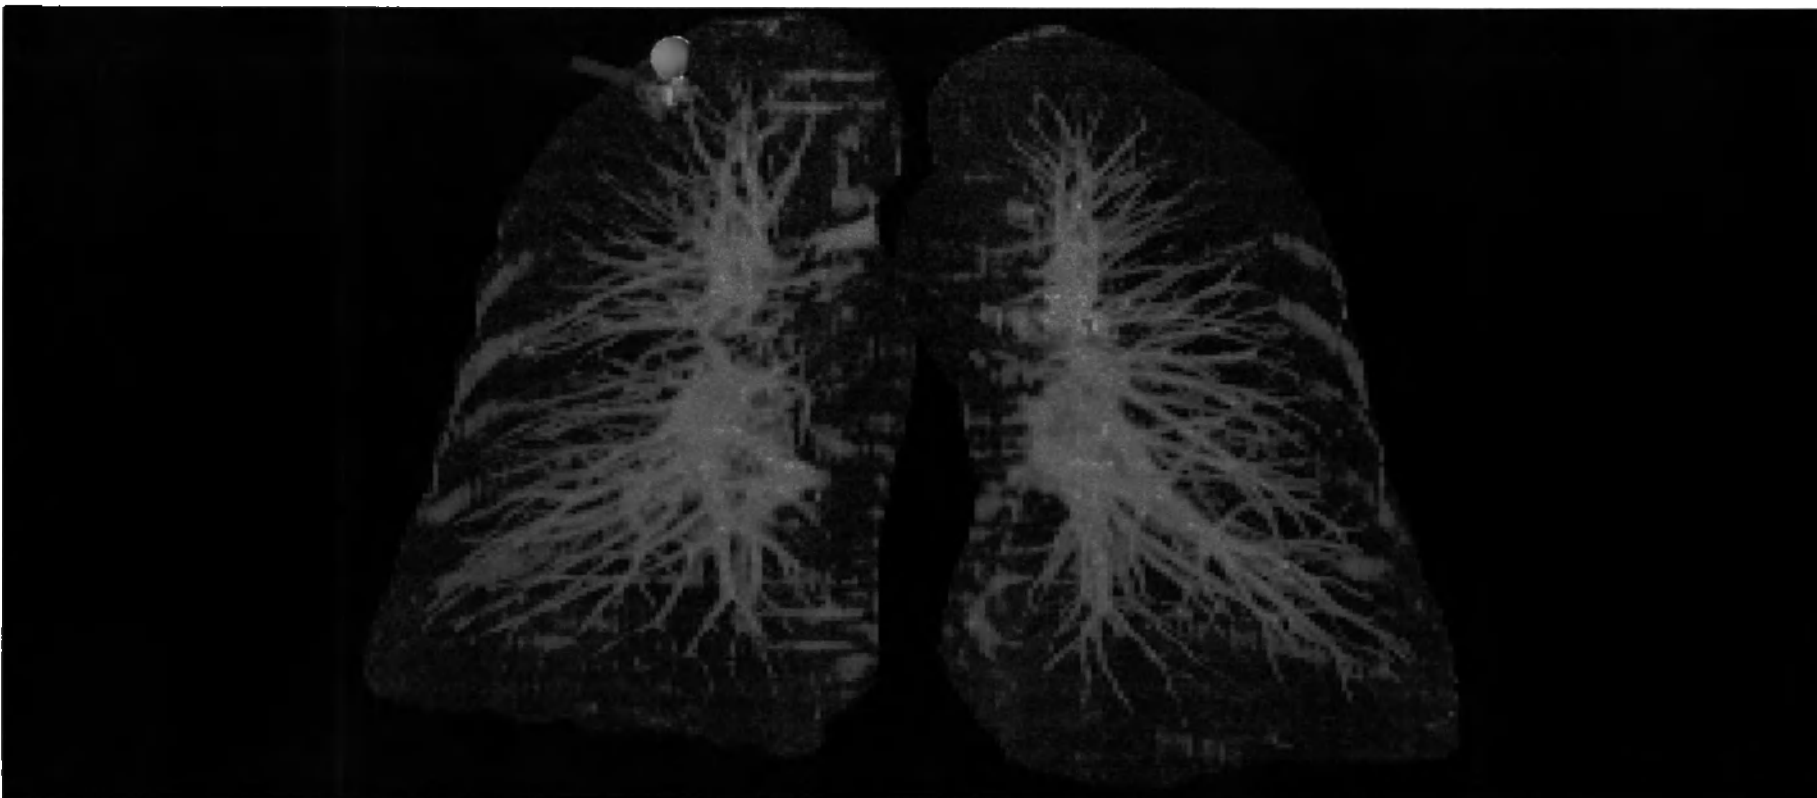


Рис. 97. Программные пакеты для исследований легких (не более 10 шт.).

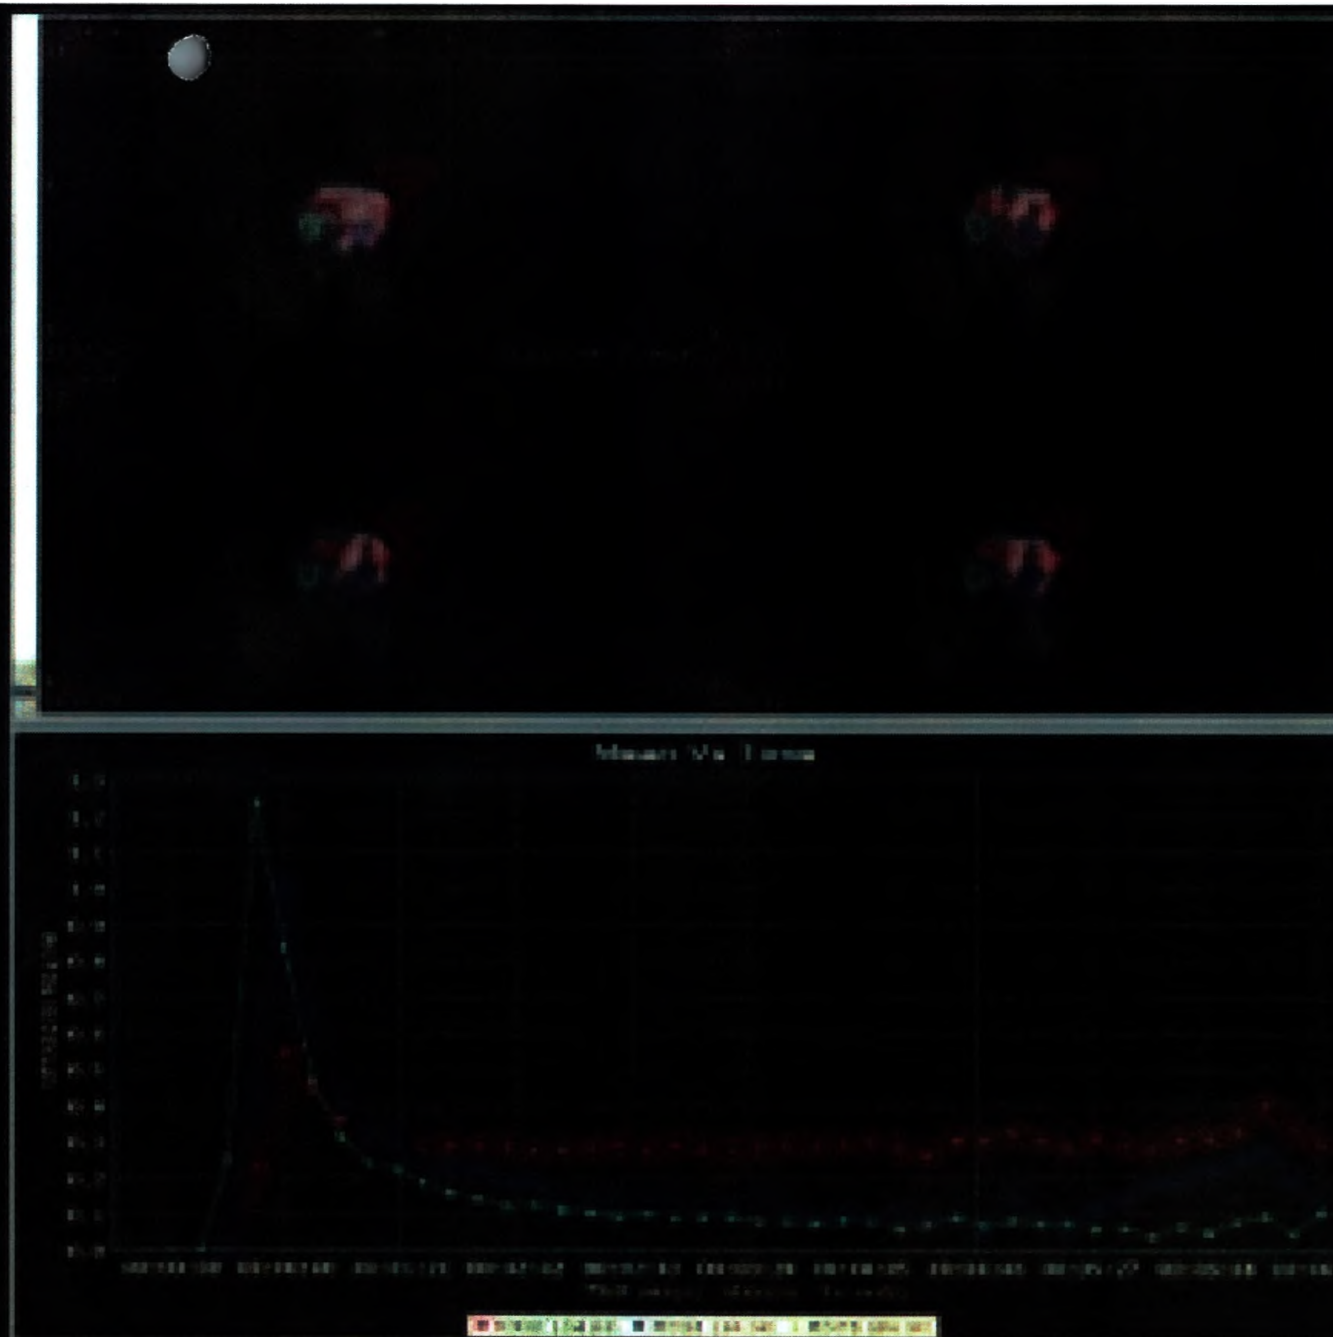


Рис. 98. Программные пакеты для исследований почек (не более 4 шт.).

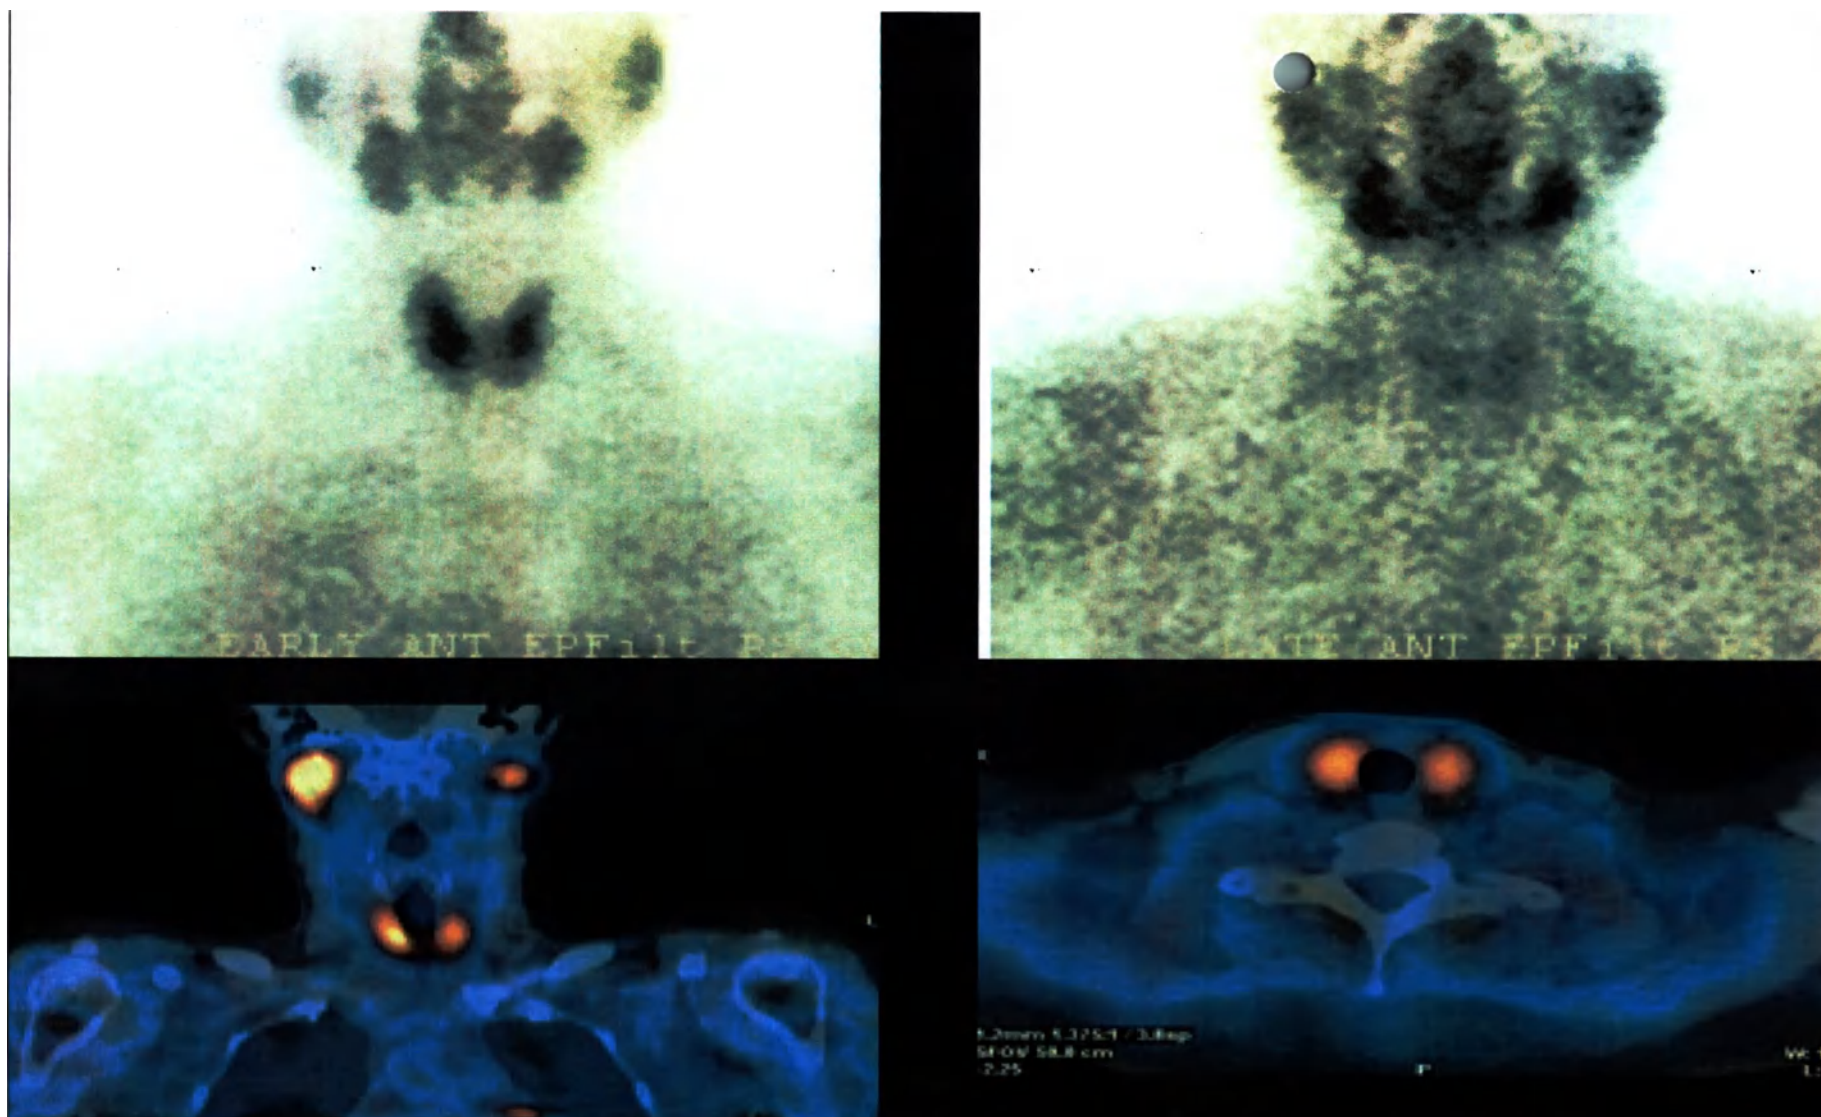


Рис. 99. Программные пакеты для исследований щитовидной железы (не более 4 шт.).



Рис. 100. Программные пакеты для исследований печени (не более 10 шт.).

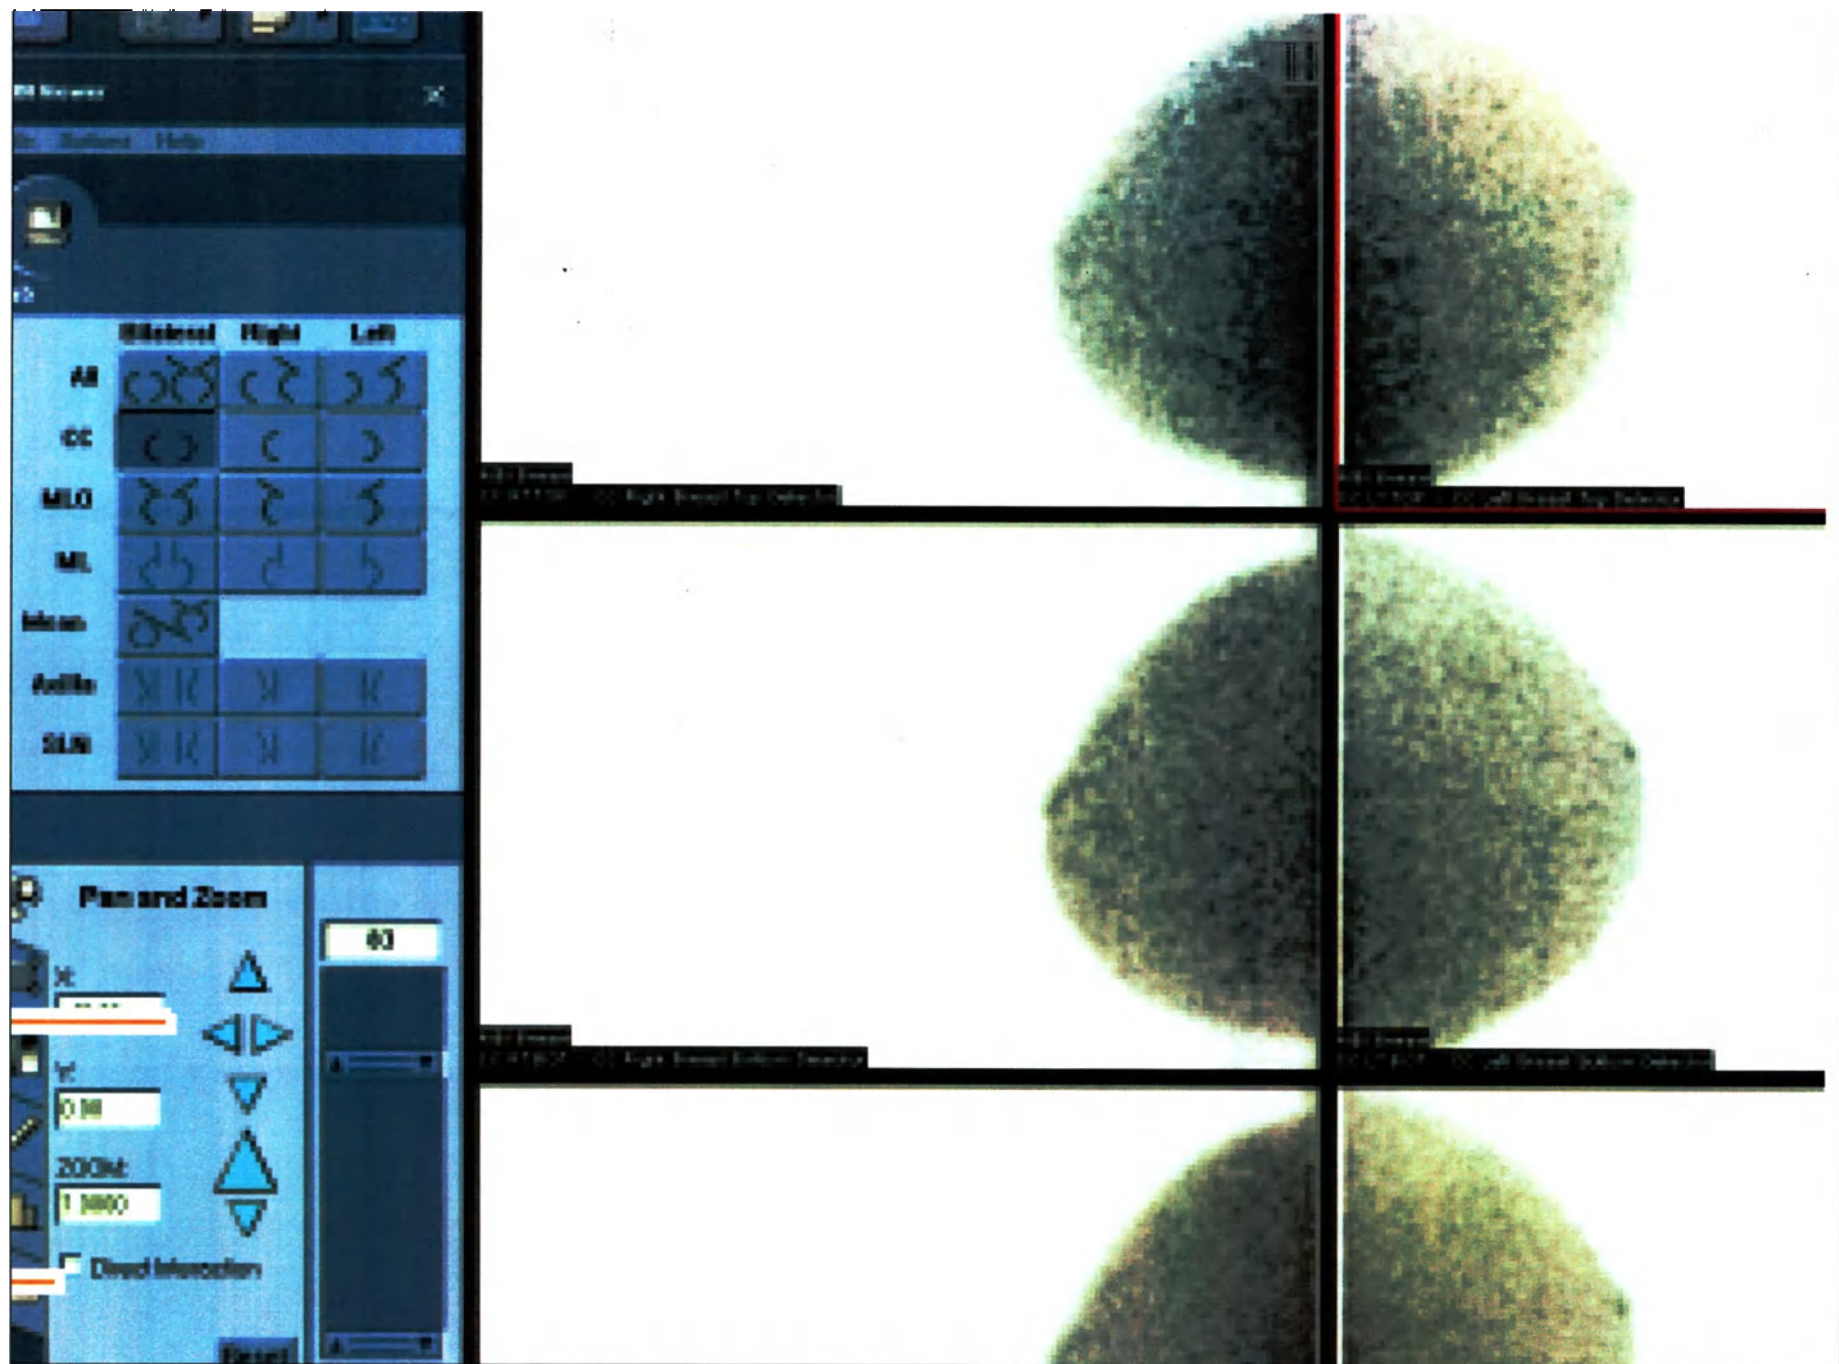


Рис. 101. Программные пакеты для исследований молочной железы (не более 4 шт.).

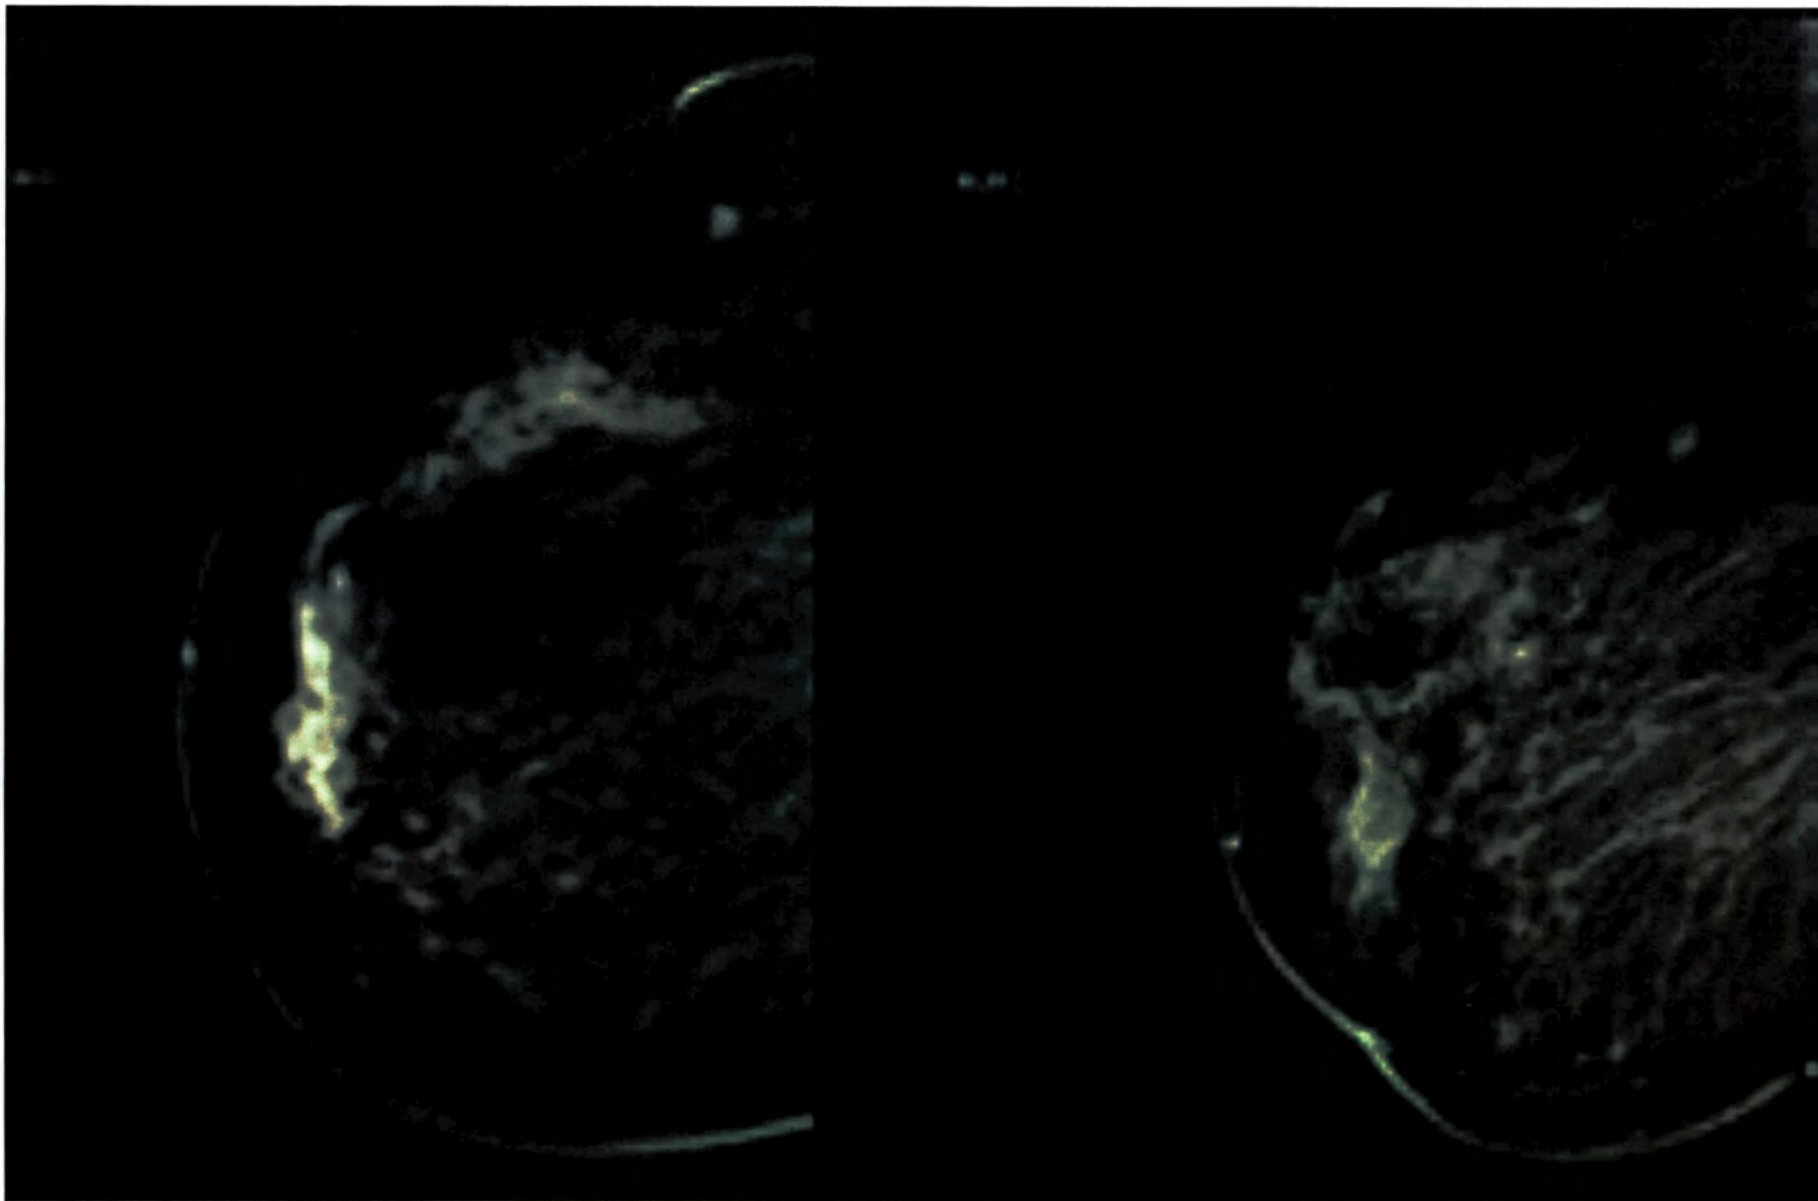


Рис. 102. Программные пакеты для исследований молочной железы (не более 4 шт.).



Рис. 103. Программные пакеты для исследований костей (не более 10 шт.).

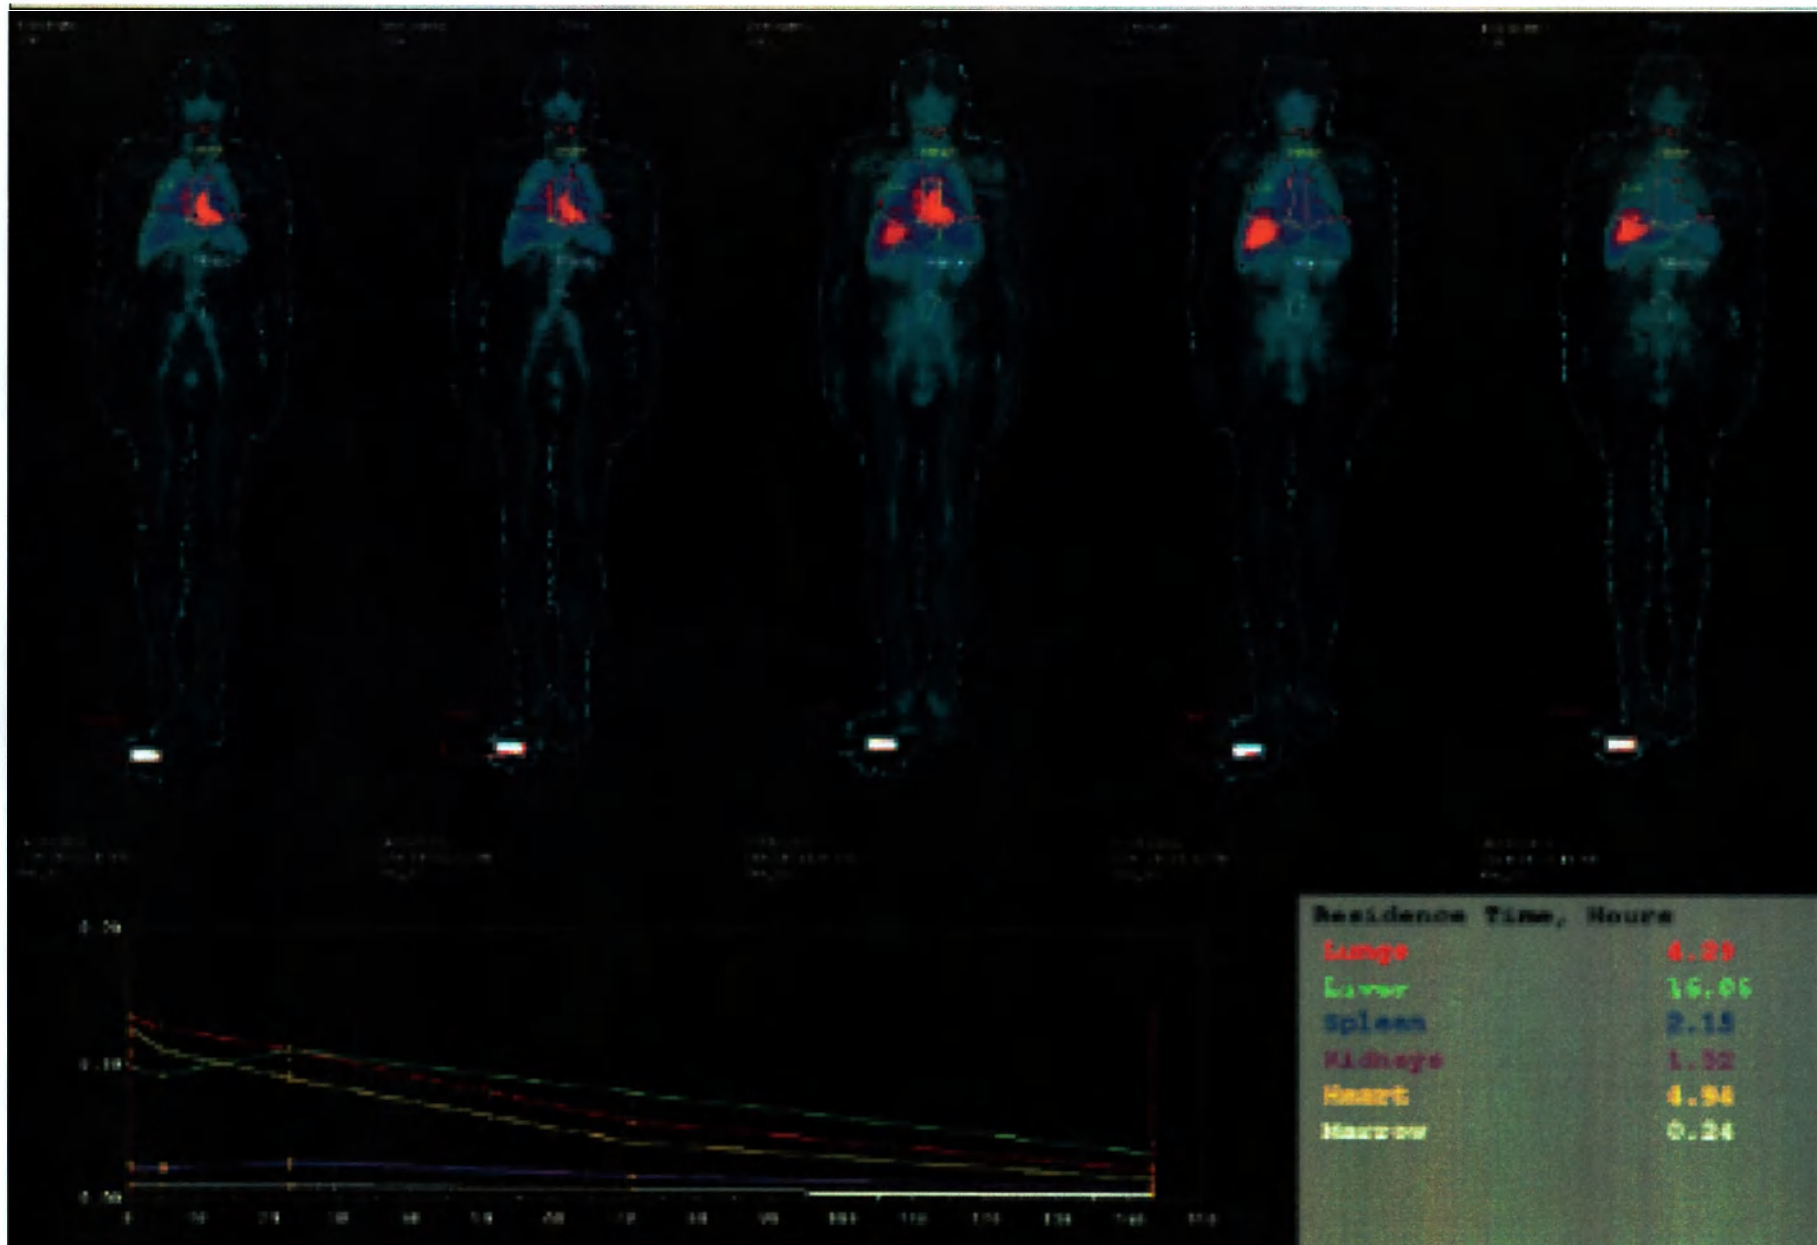


Рис. 104. Программные пакеты для количественной оценки (не более 10 шт.).

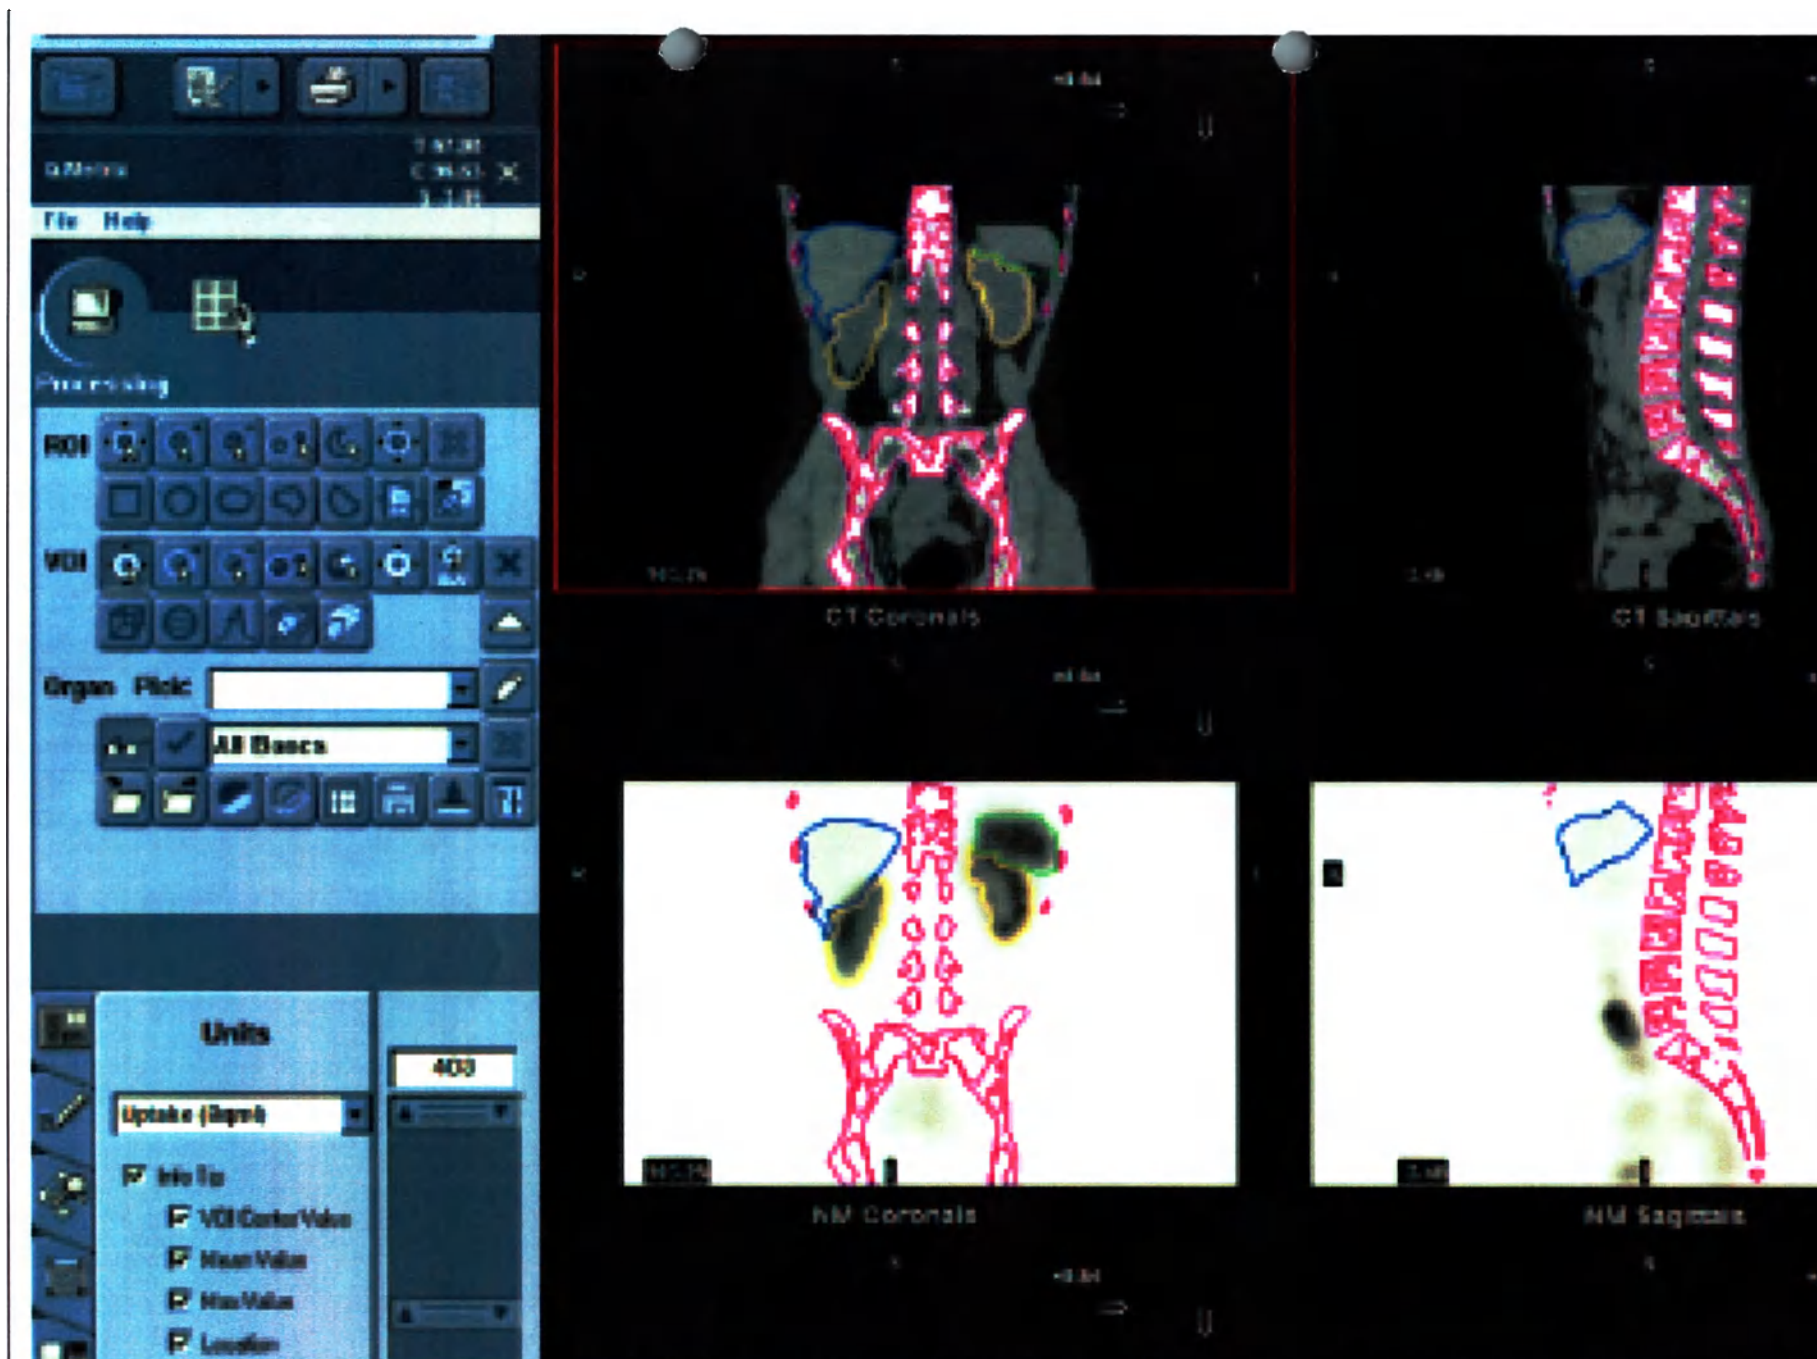


Рис. 105. Программные пакеты для количественной оценки (не более 10 шт.).

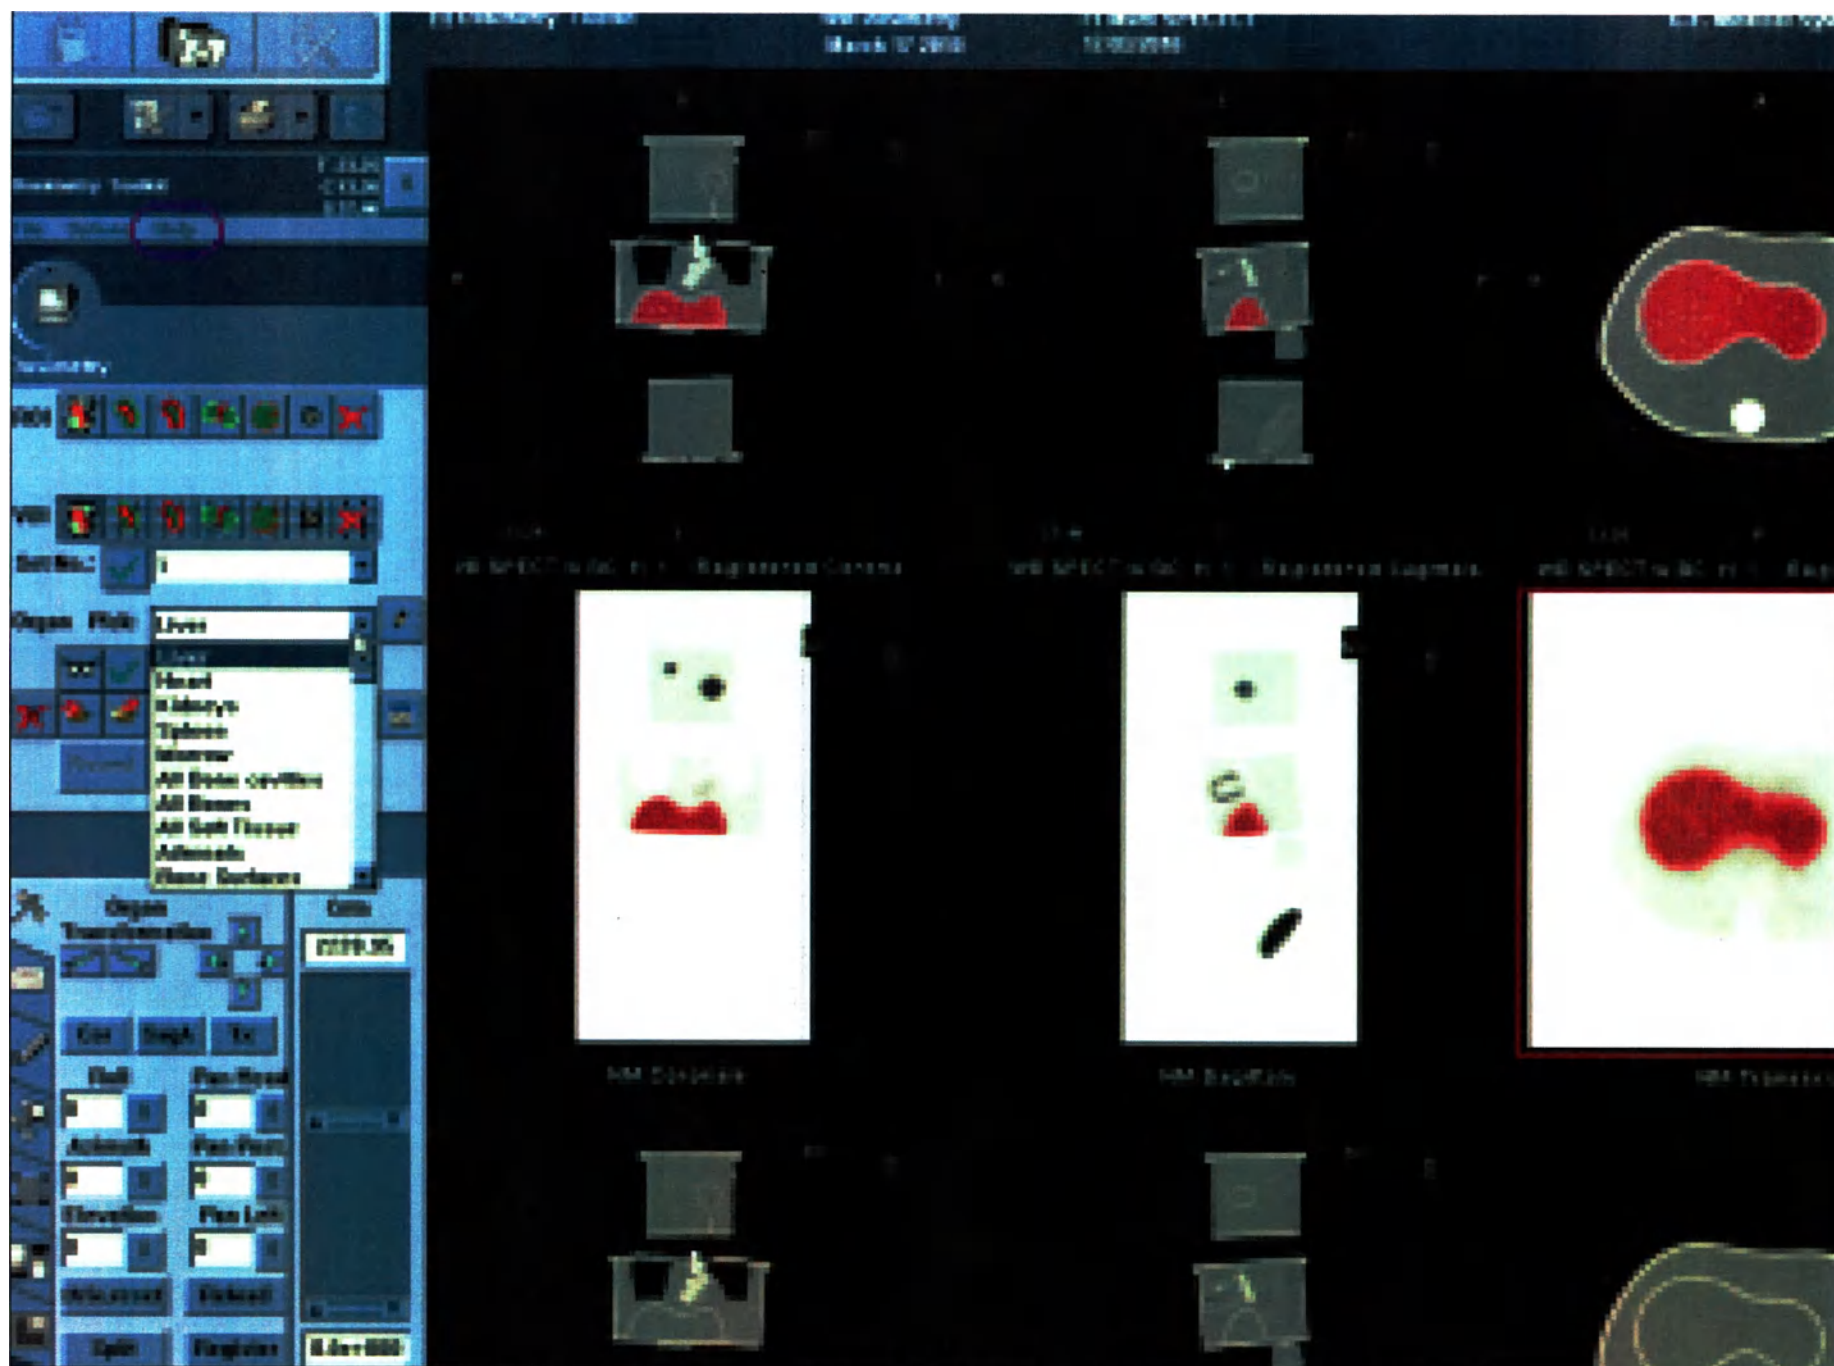


Рис. 106. Программные пакеты для планирования терапии (не более 20 шт.).

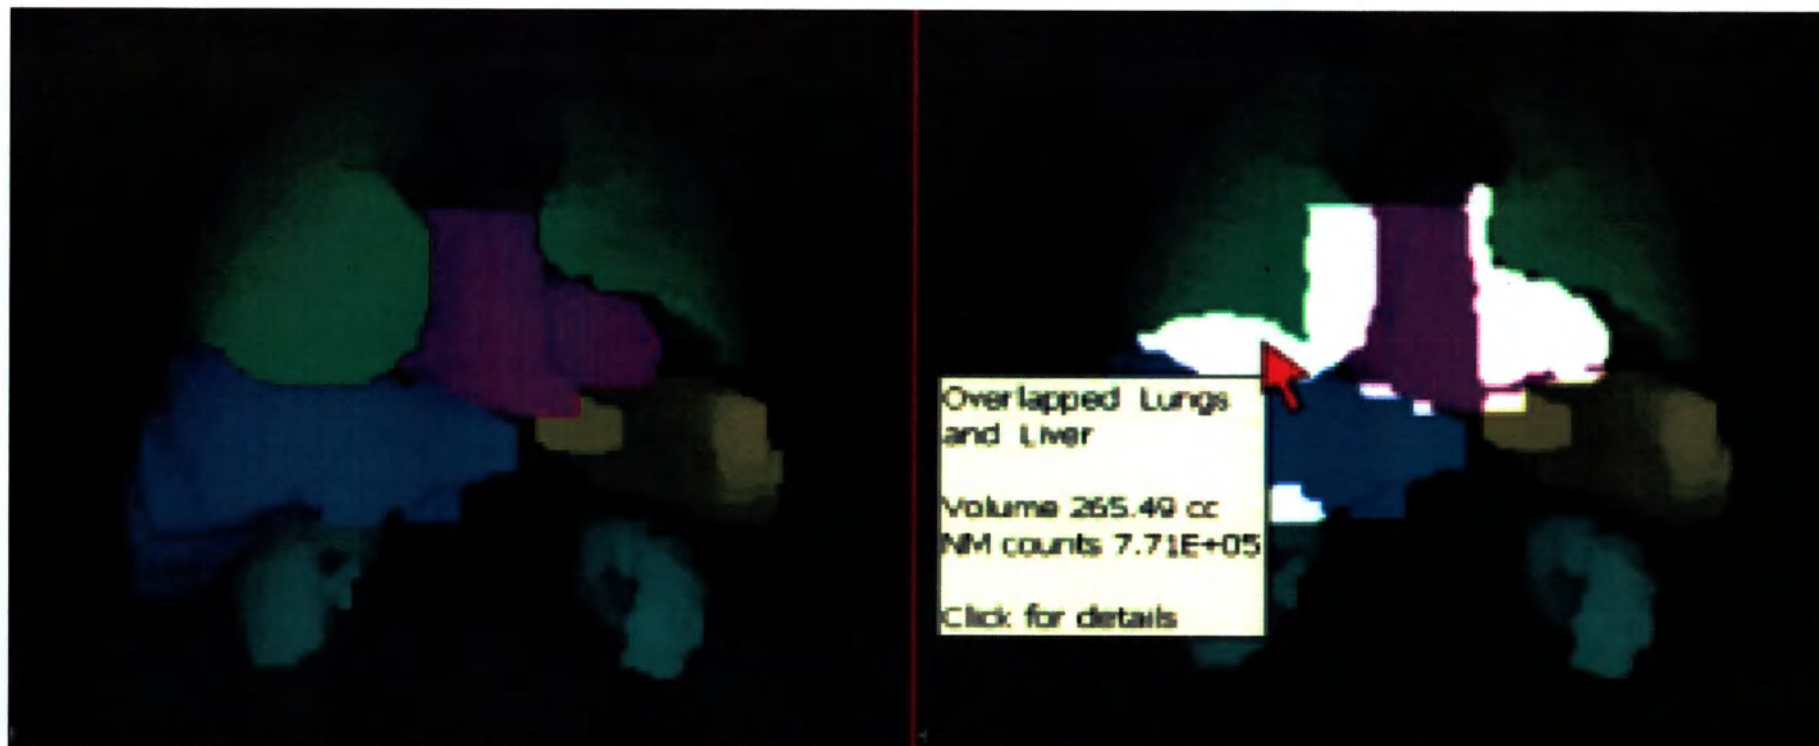


Рис. 107. Программные пакеты для планирования терапии (не более 20 шт.).



Рис. 108. Фантом для визуального контроля качества и проверки функции совмещения (не более 5 шт.).



Рис. 109. Фантом для коррекции количественной оценки (не более 5 шт.).

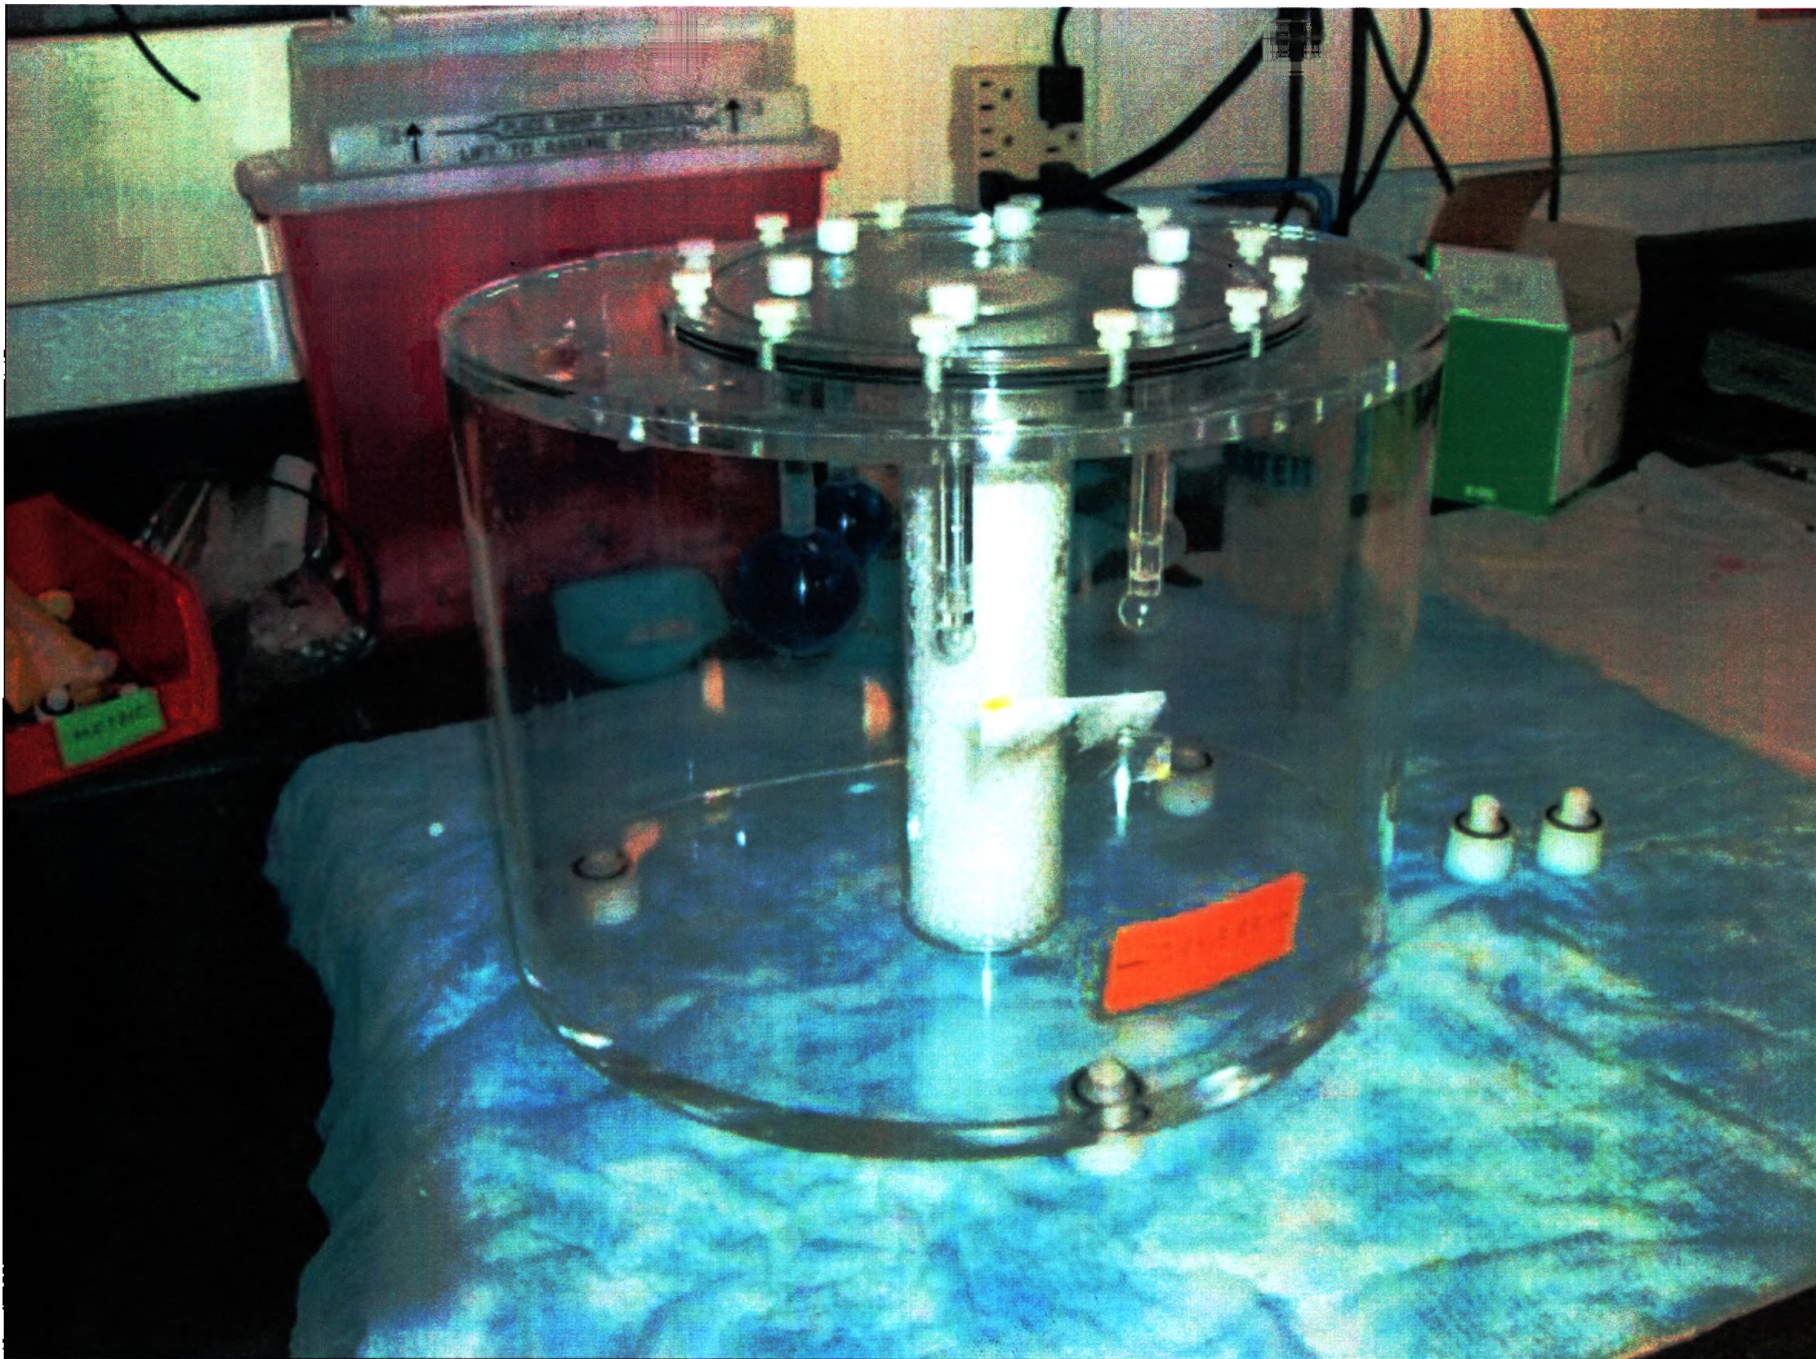


Рис. 110. Фантом для калибровки КТ подсистемы (не более 5 шт.).

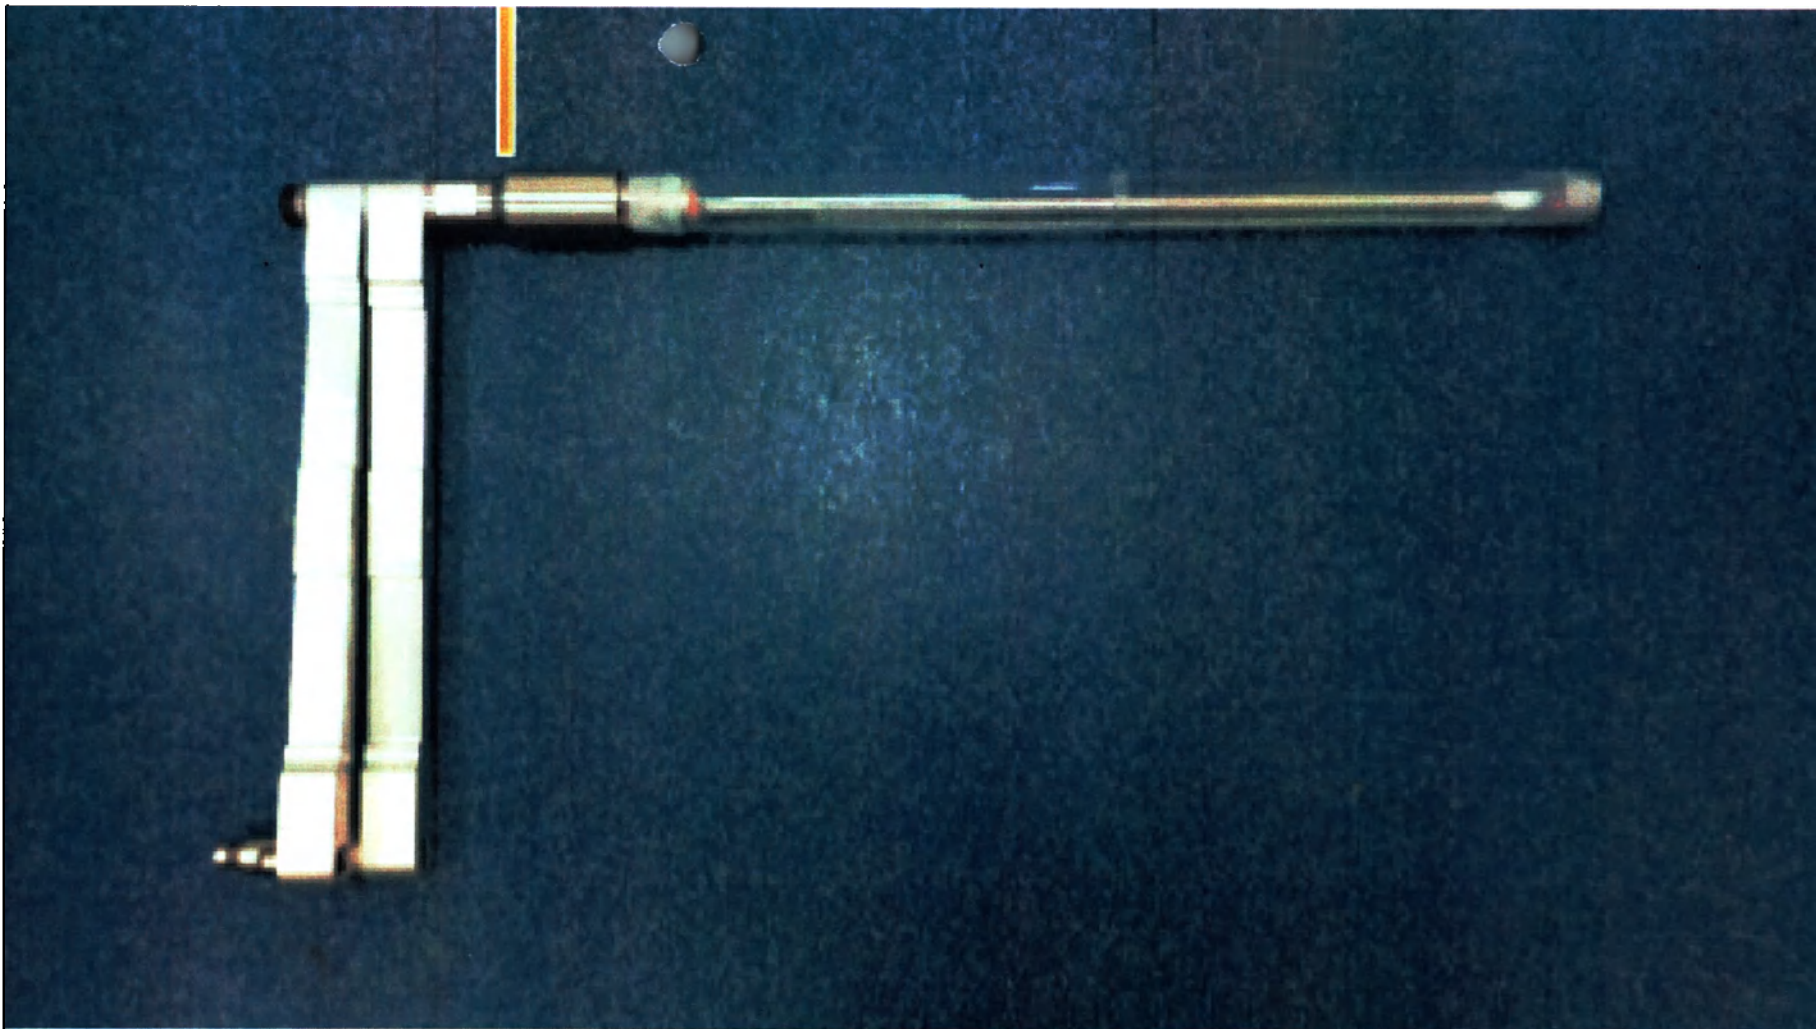


Рис. 111. Источник для контроля качества (не более 4 шт.).



Рис. 112. Держатель для источника точечного (не более 4 шт.).



Рис. 113. Держатель для источника калибровочного (не более 4 шт.).



Рис. 114. Стекло защитное просвинцованное. (не более 5 шт.), варианты исполнения: - размер 1200*800 - размер 1200*1000 - размер 1800*1000



Рис. 115. Стекло защитное просвинцованное. (не более 5 шт.), варианты исполнения: - размер 1200*800 - размер 1200*1000 - размер 1800*1000

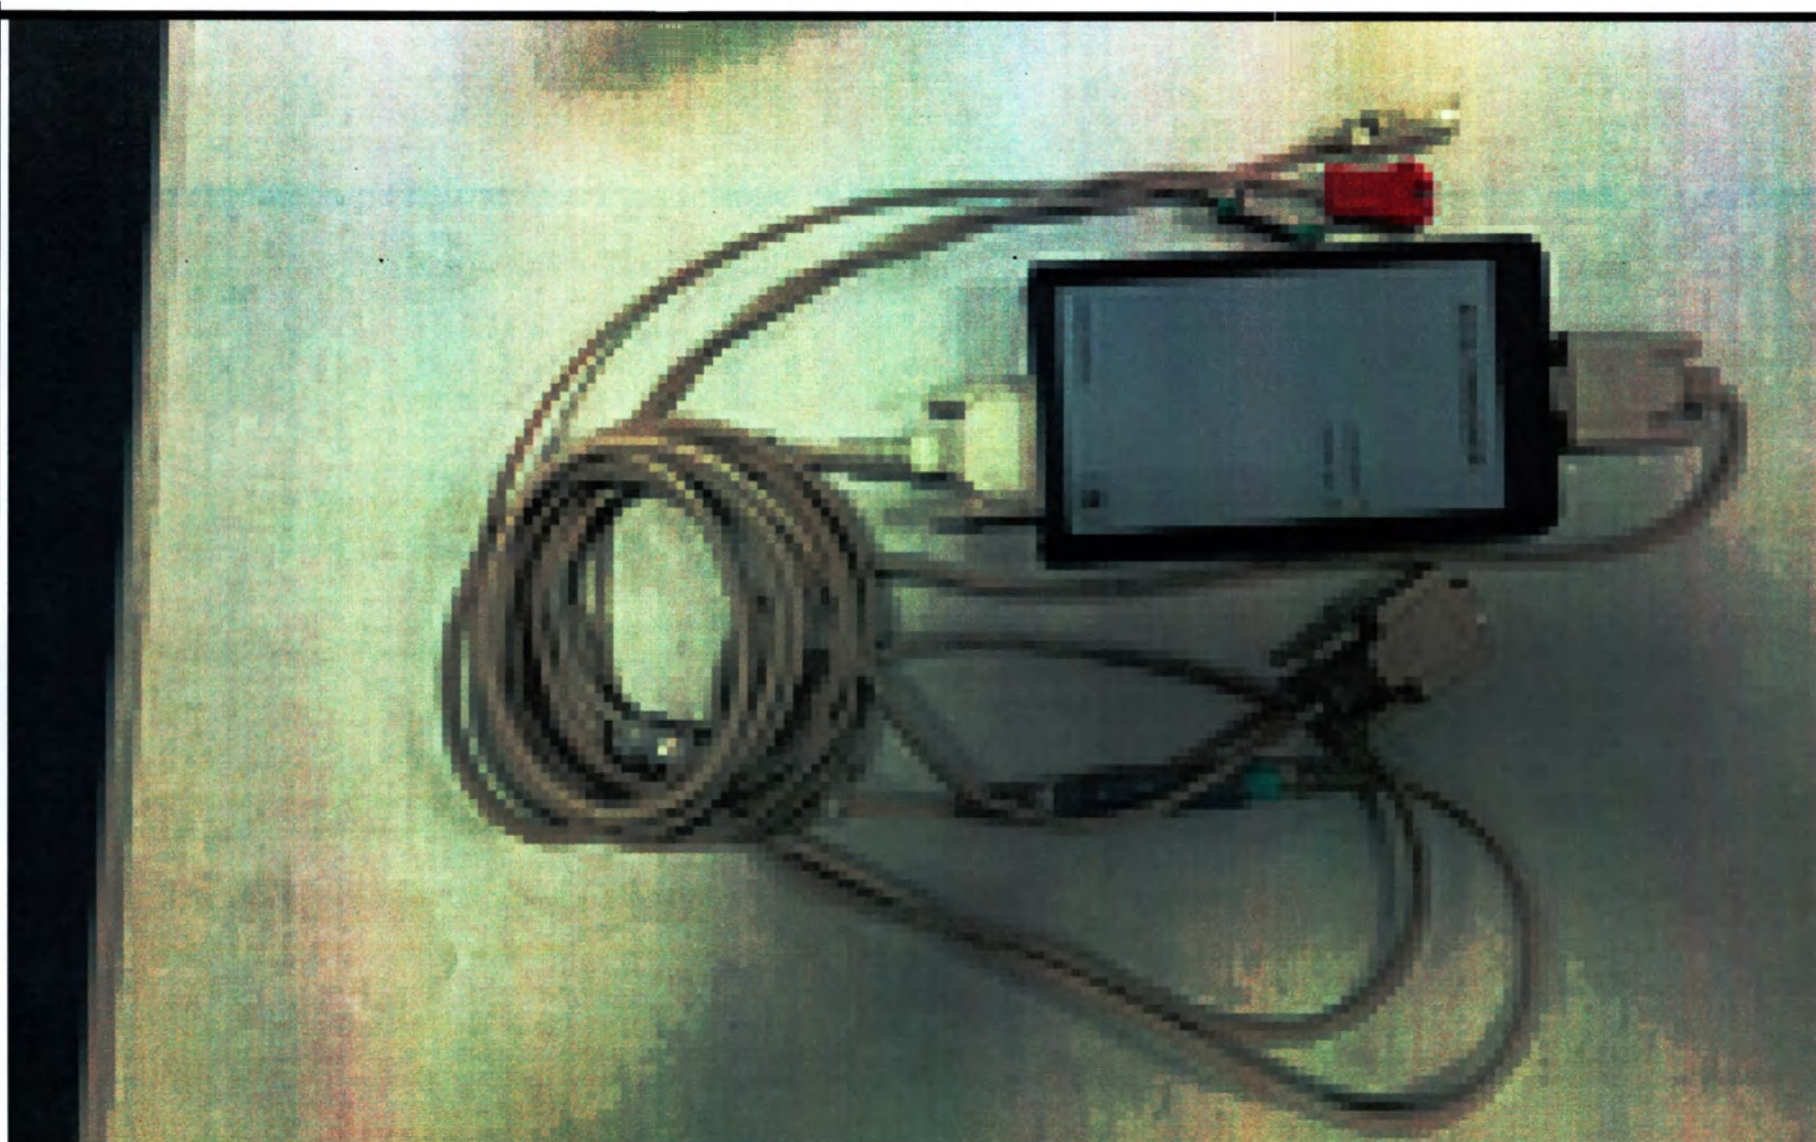


Рис. 116. Устройство получения ЭКГ сигналов, встроенное в стол пациента (не более 6 шт.).

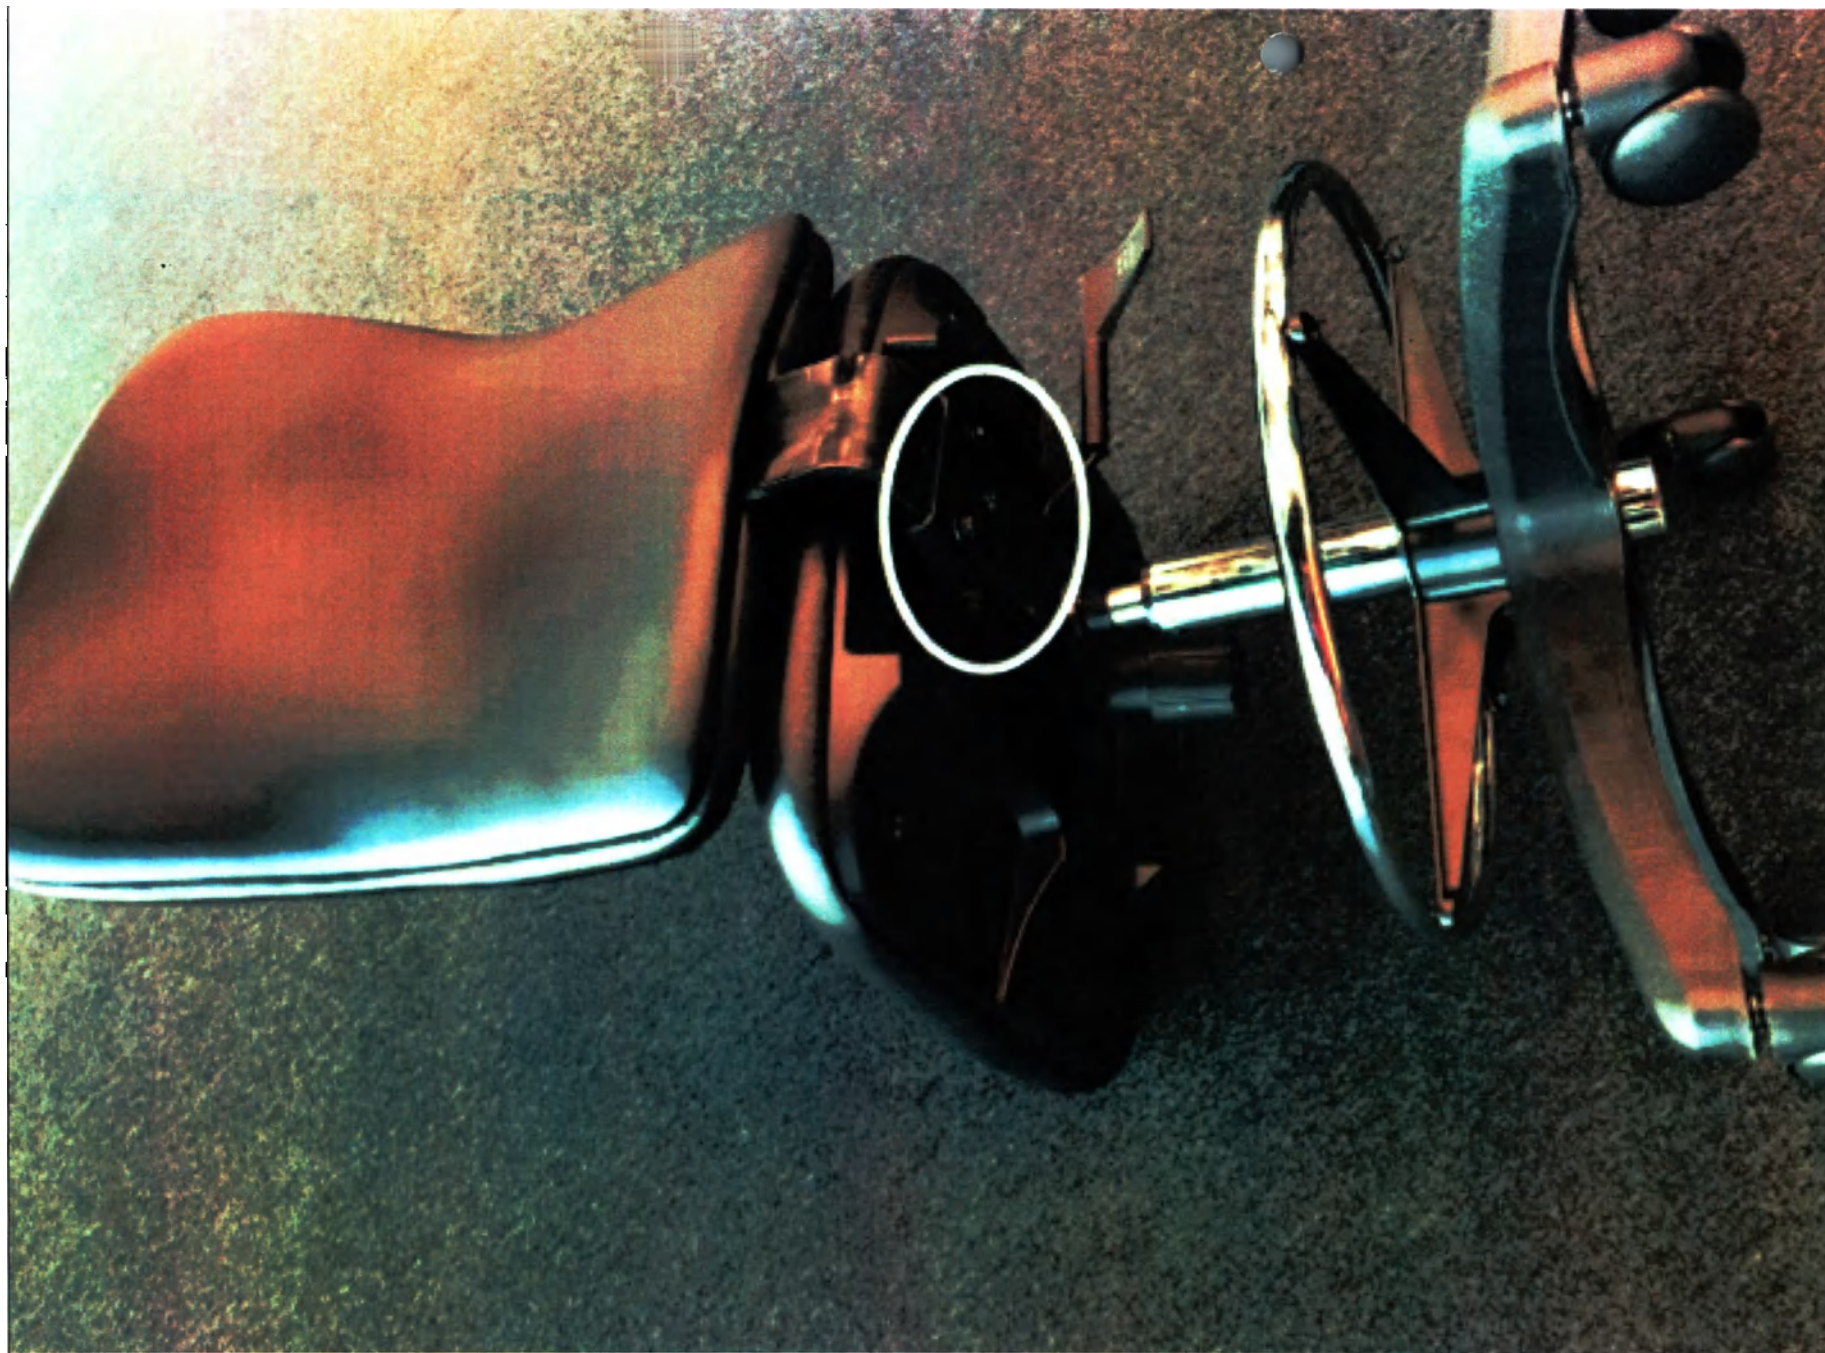


Рис. 119. Стул оператора (не более 10 шт.).

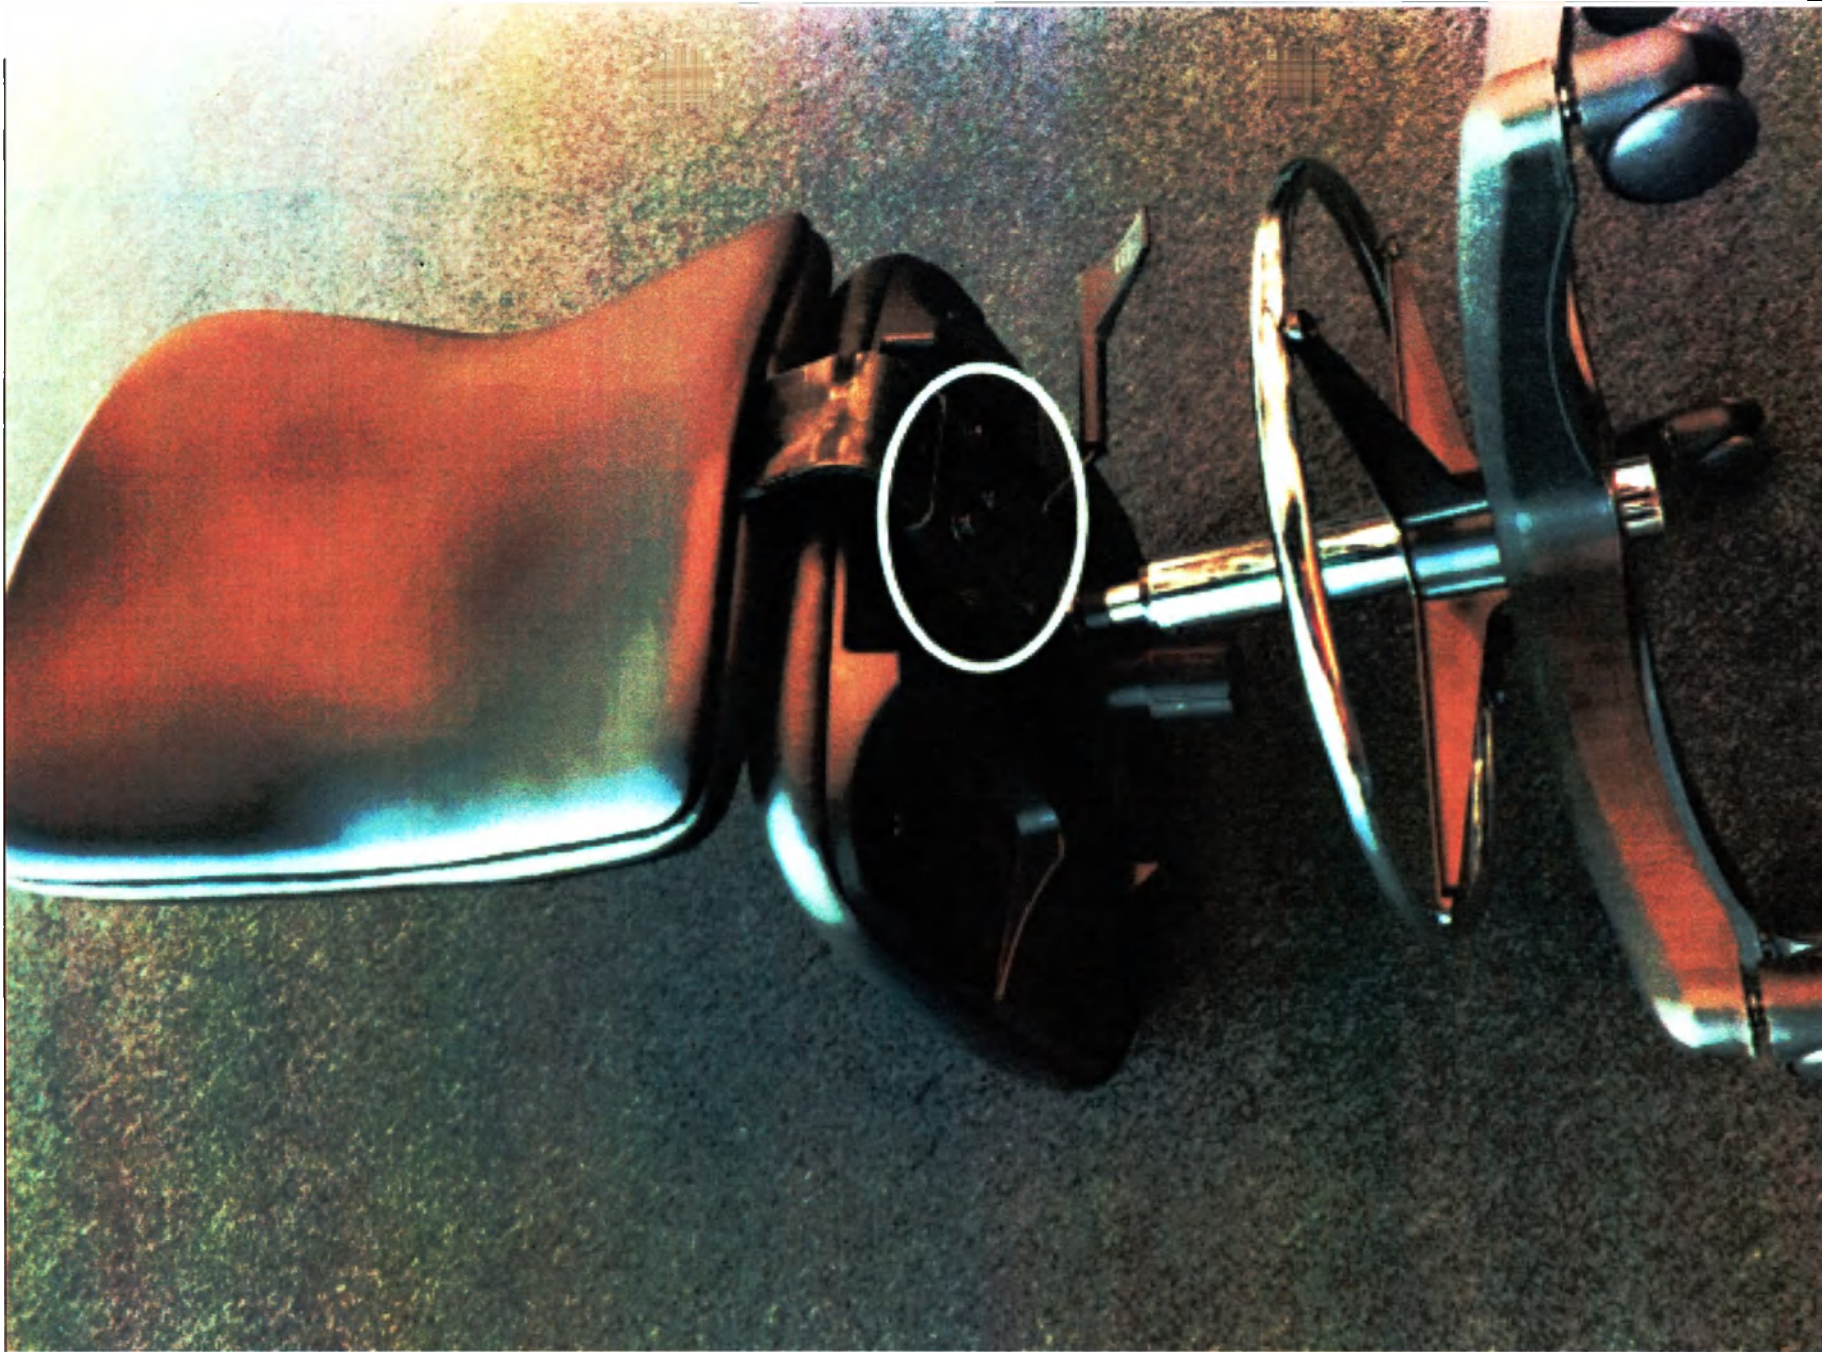


Рис. 119. Стул оператора (не более 10 шт.).

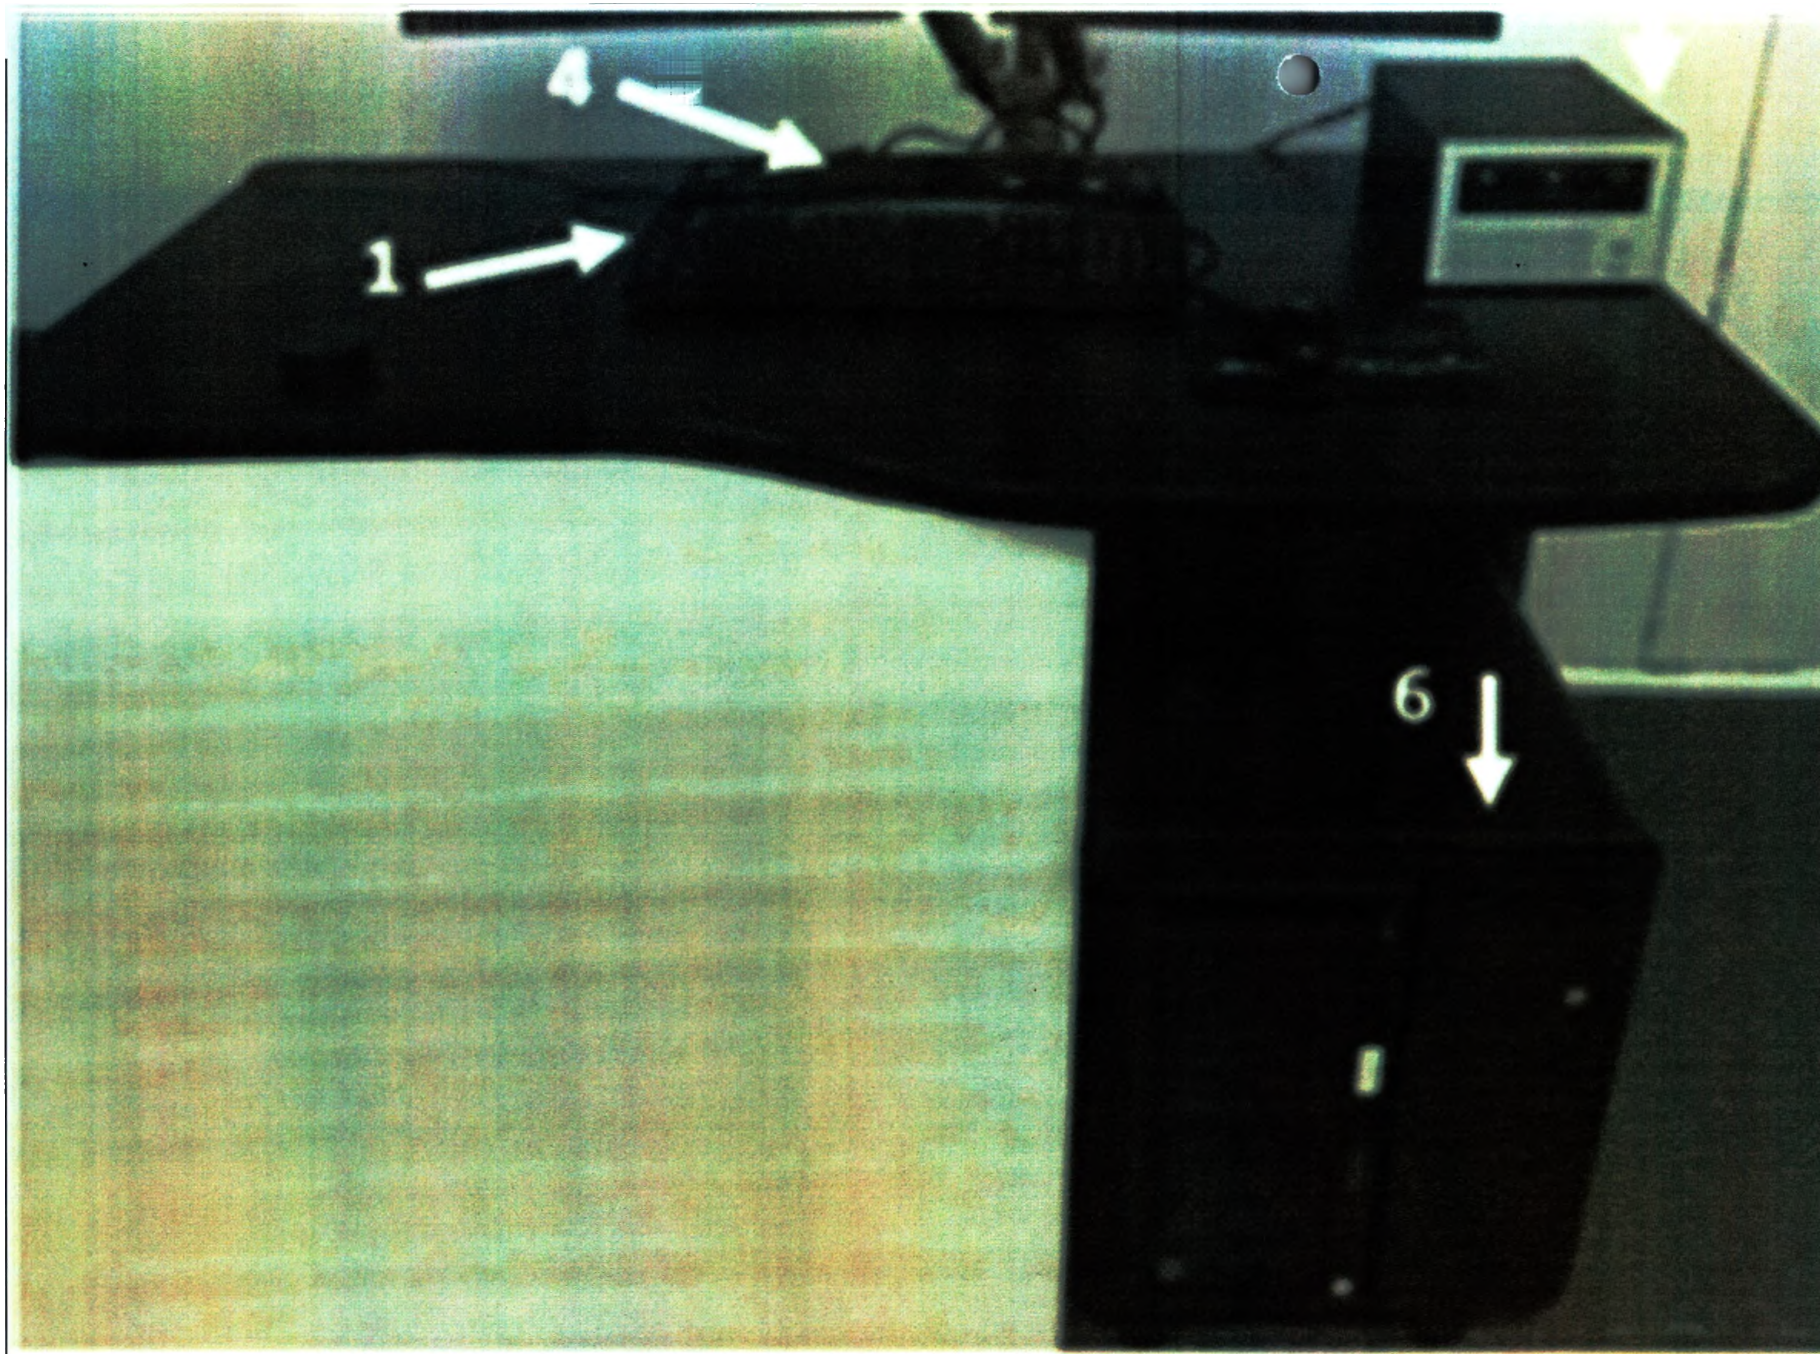


Рис. 120. Стол оператора (не более 10 кг.).



Рис. 121. Станция рабочая мультимодальная (не более 4 шт.).



Рис. 122. Станция рабочая мультимодальная (не более 4 шт.).



Рис. 123. Станция рабочая мультимодальная (не более 4 шт.).

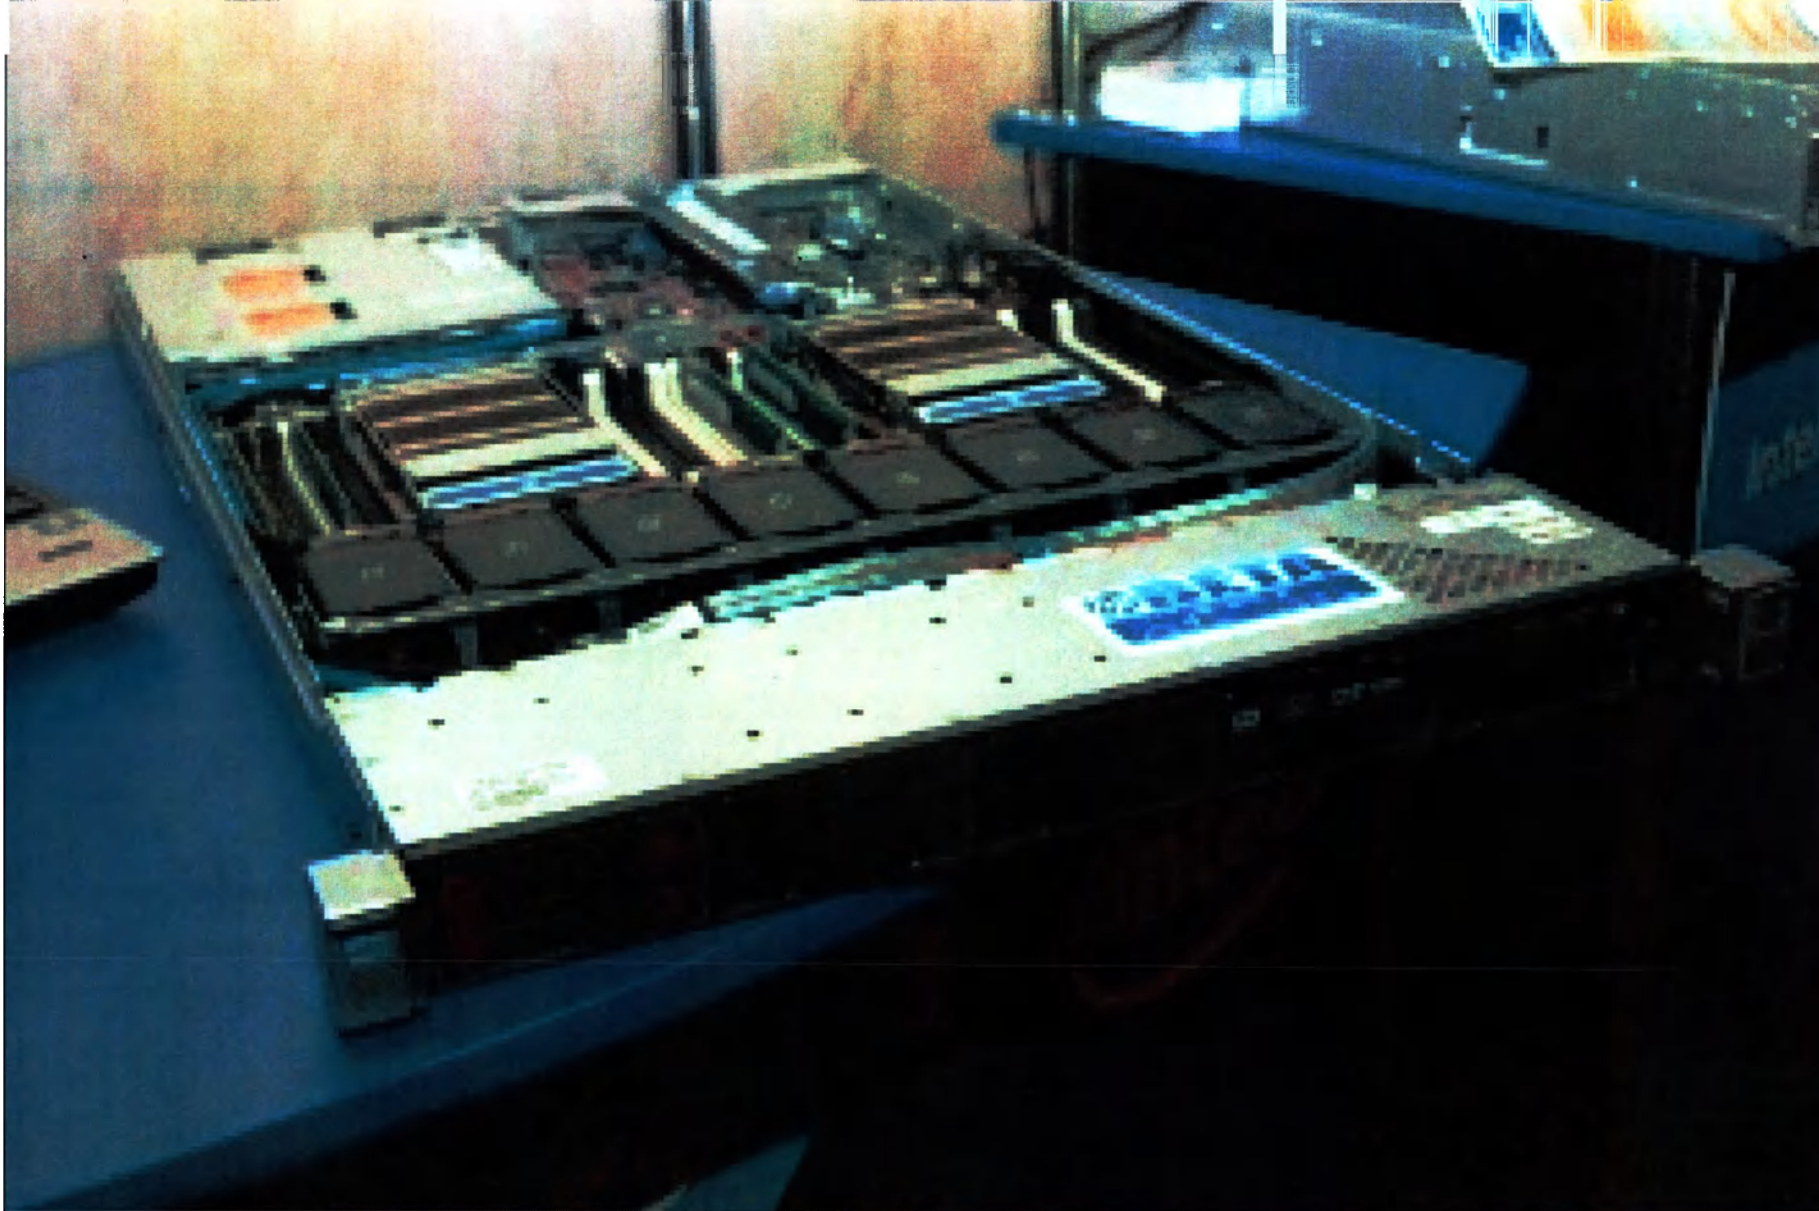


Рис. 124. Сервер для рабочей станции мультимодальной (не более 6 шт.).



Рис. 125. Базовые программные пакеты для рабочей станции мультимодальной (не более 20 шт.).



Рис. 126. Программные пакеты для обновления мультимодальной рабочей станции (не более 6 шт.).

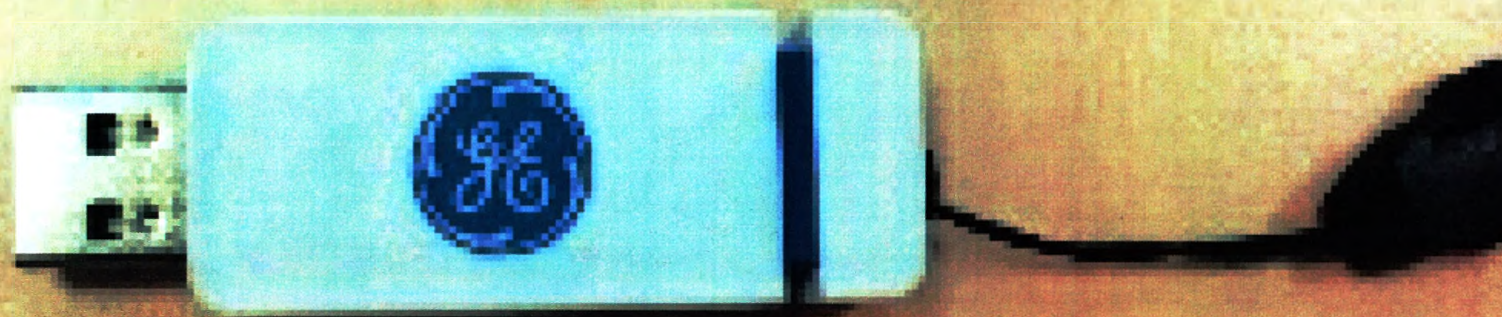


Рис. 127. Программные пакеты для обновления сервера мультимодальной рабочей станции (не более 10 шт.).



Рис. 128. Кабели для станции рабочей мультимодальной (не более 4 шт.).



Рис. 129. Кабели для станции рабочей мультимодальной (не более 4 шт.).

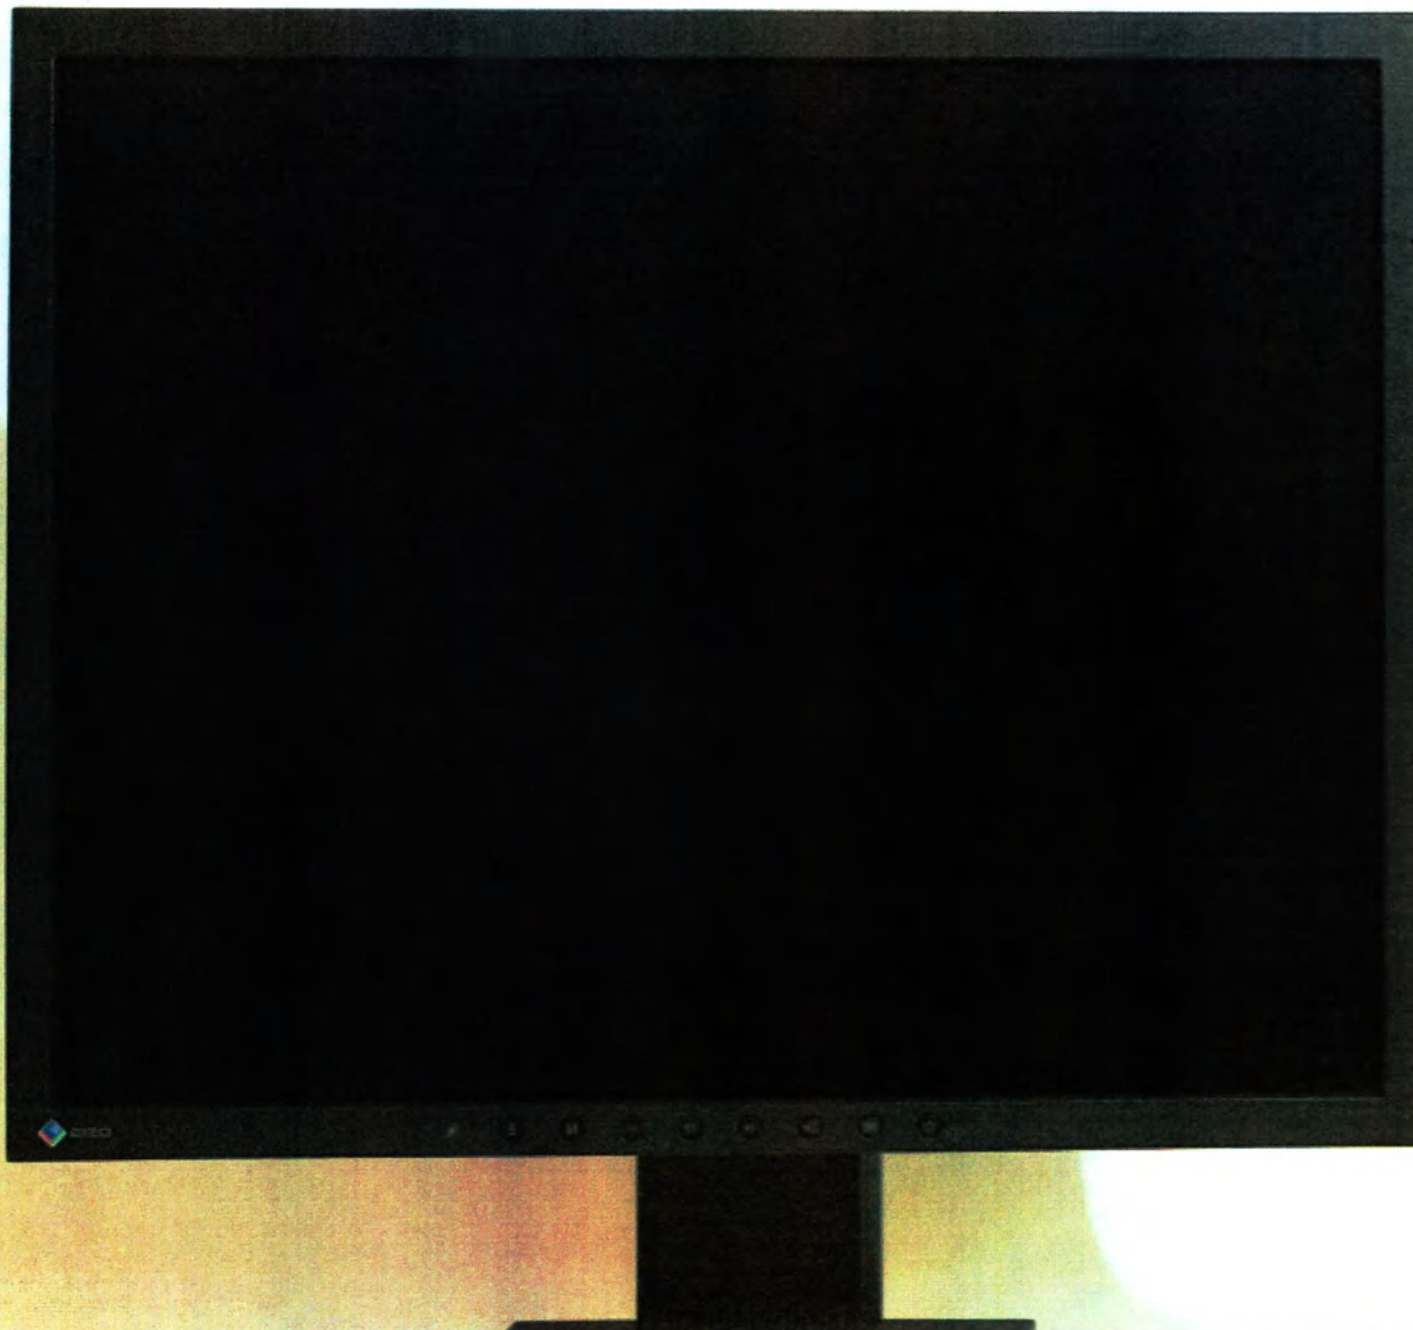


Рис. 130. Мониторы для станции рабочей мультимодальной (не более 4 шт.).

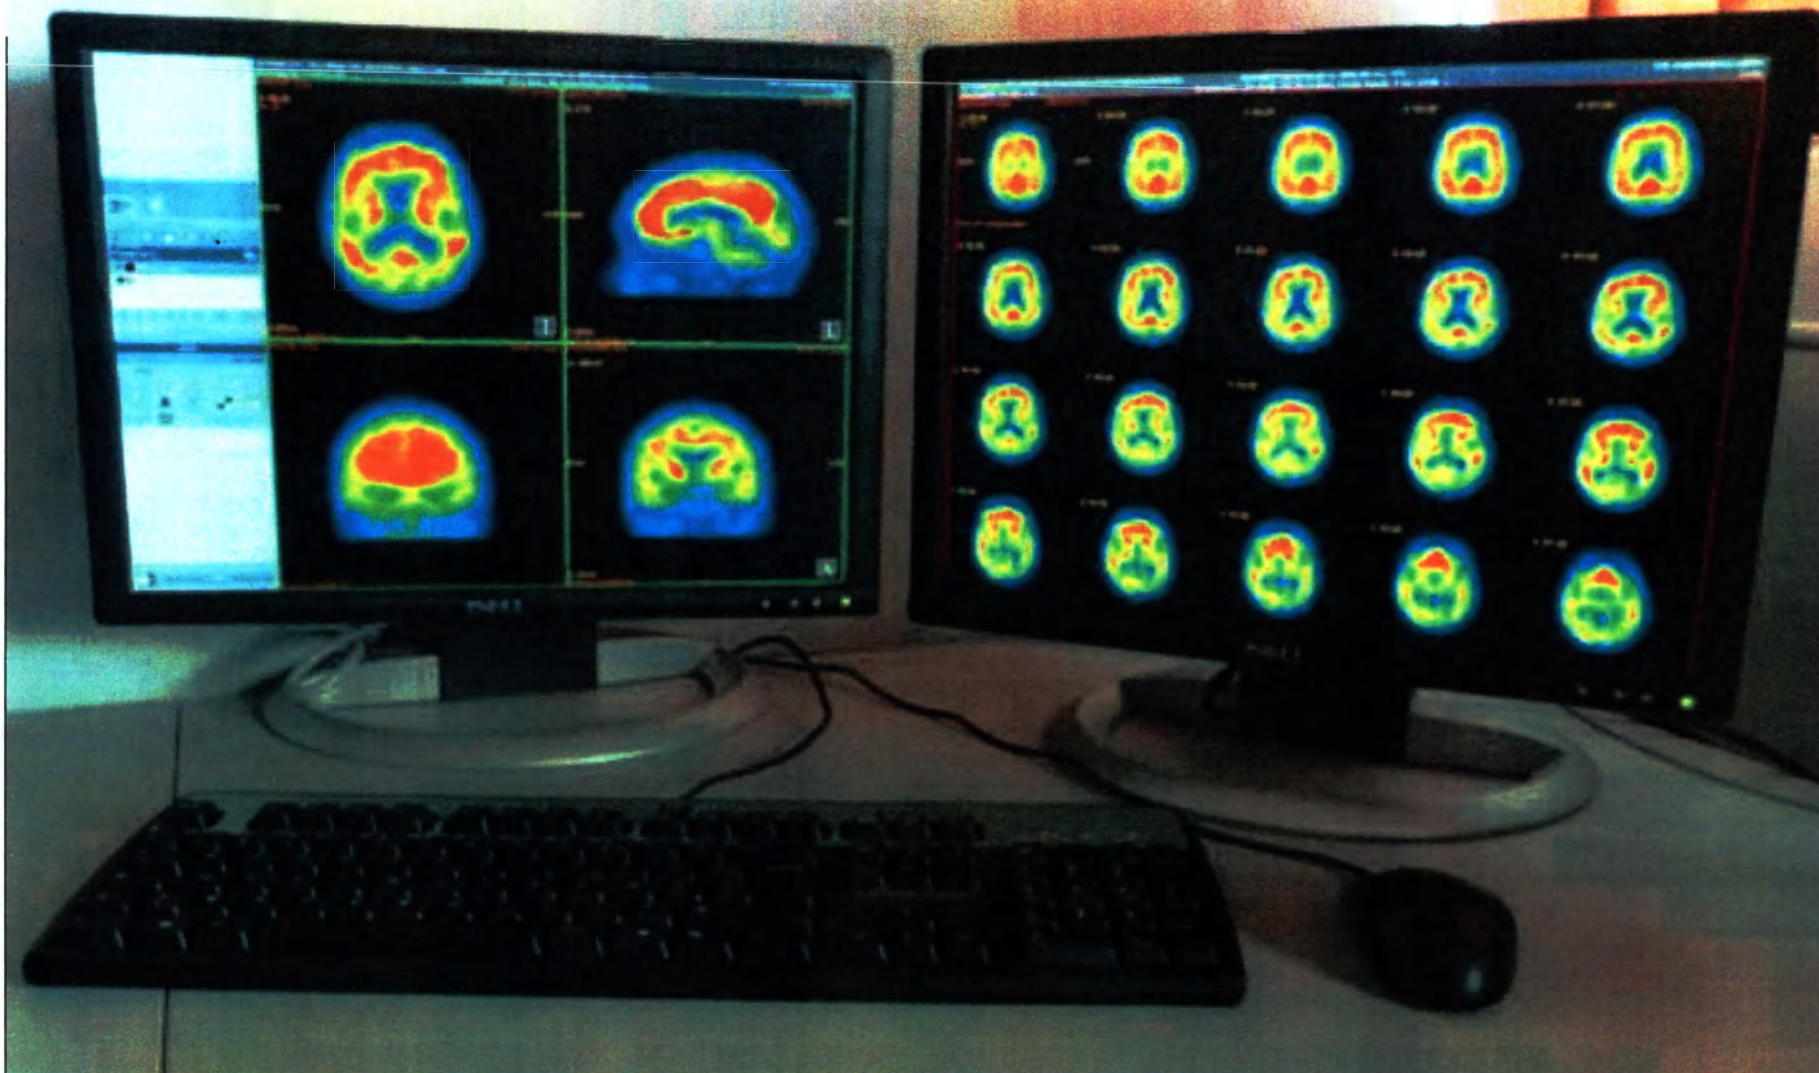


Рис. 131. Мониторы для станции рабочей мультимодальной (не более 4 шт.).

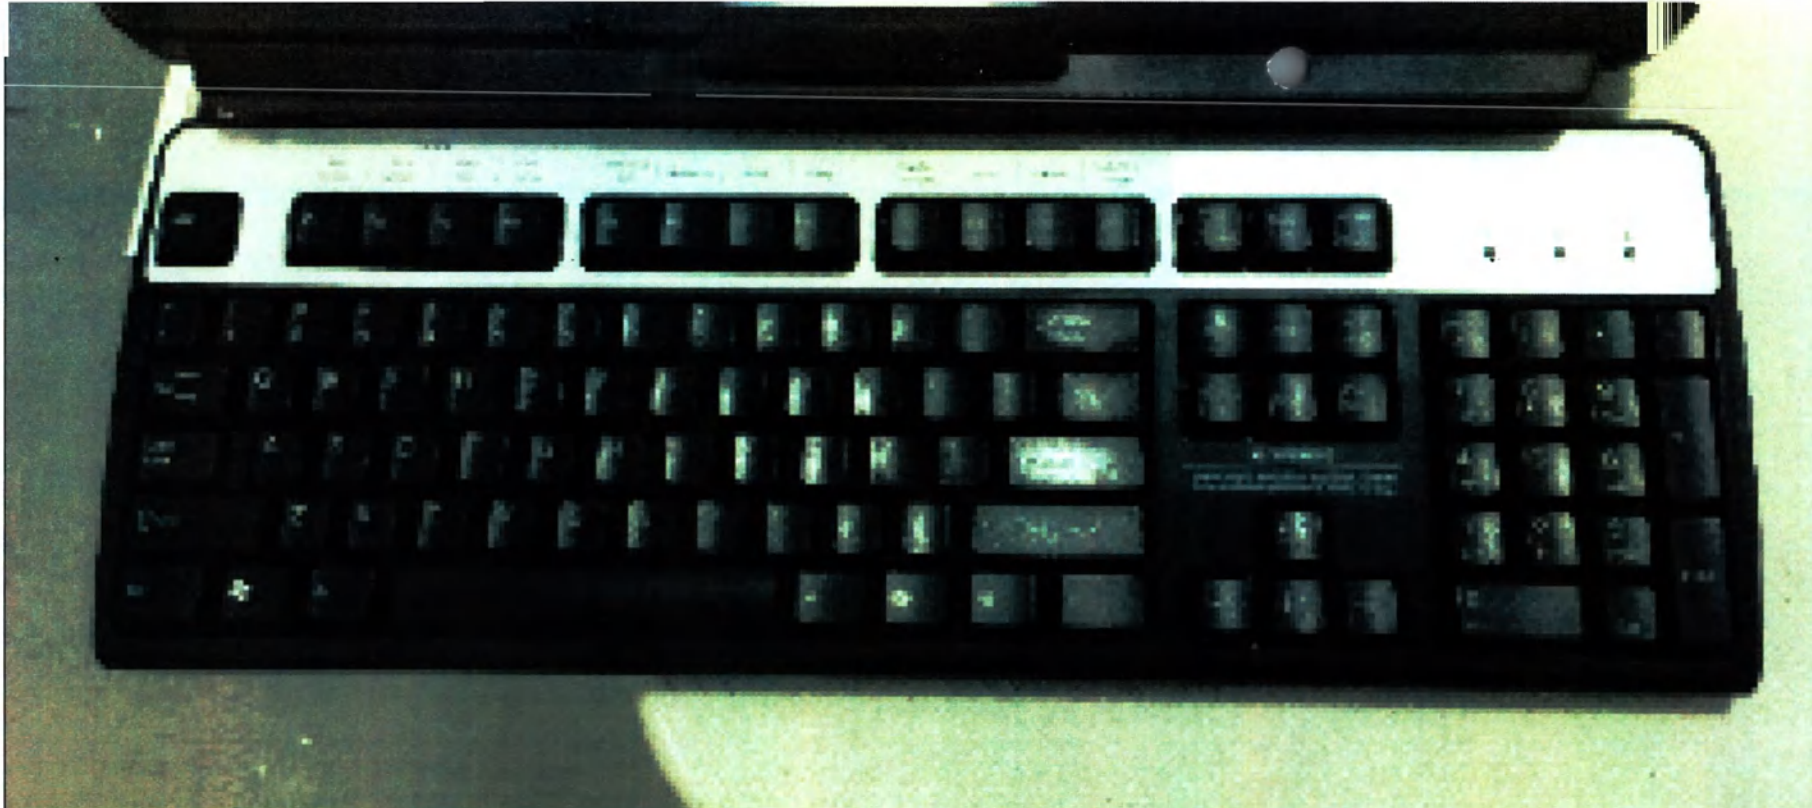


Рис. 132. Устройства управления для станции рабочей мультимодальной (не более 4 шт.), в составе:- клавиатура - мышь

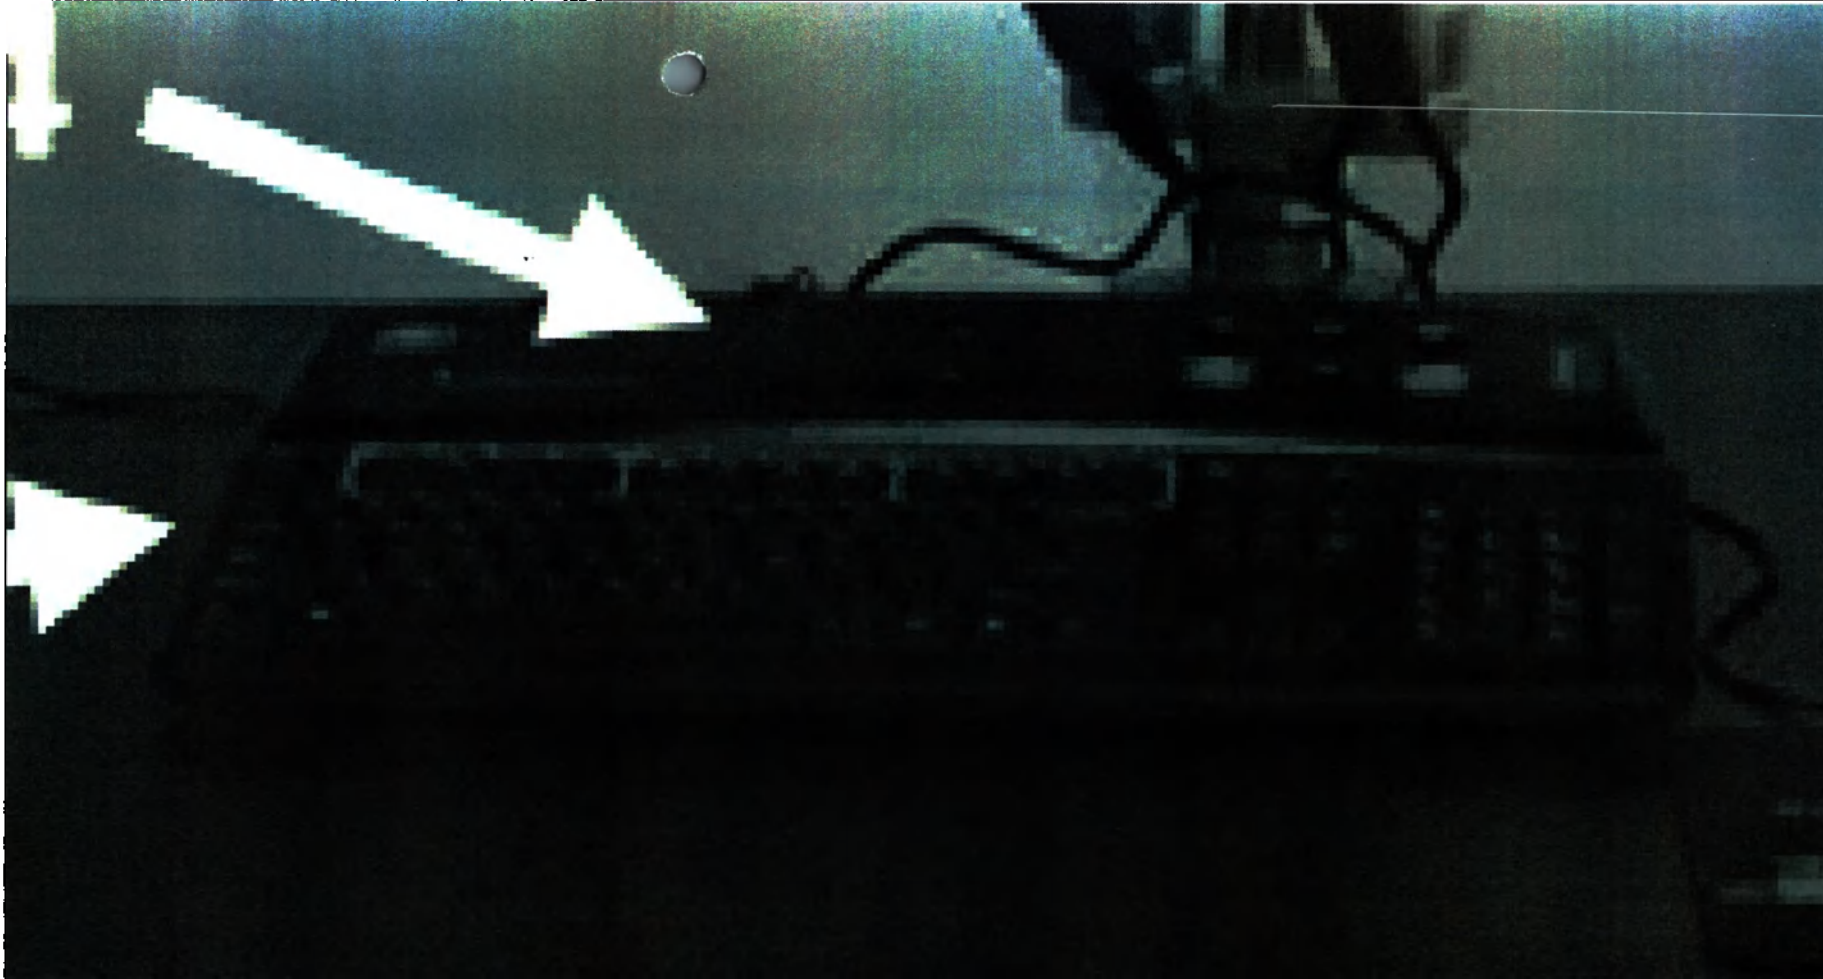


Рис. 133. Устройства управления для станции рабочей мультимодальной (не более 4 шт.), в составе:- клавиатура - мышь



Рис. 134. Устройства управления для станции рабочей мультимодальной (не более 4 шт.), в составе:- клавиатура - мышь

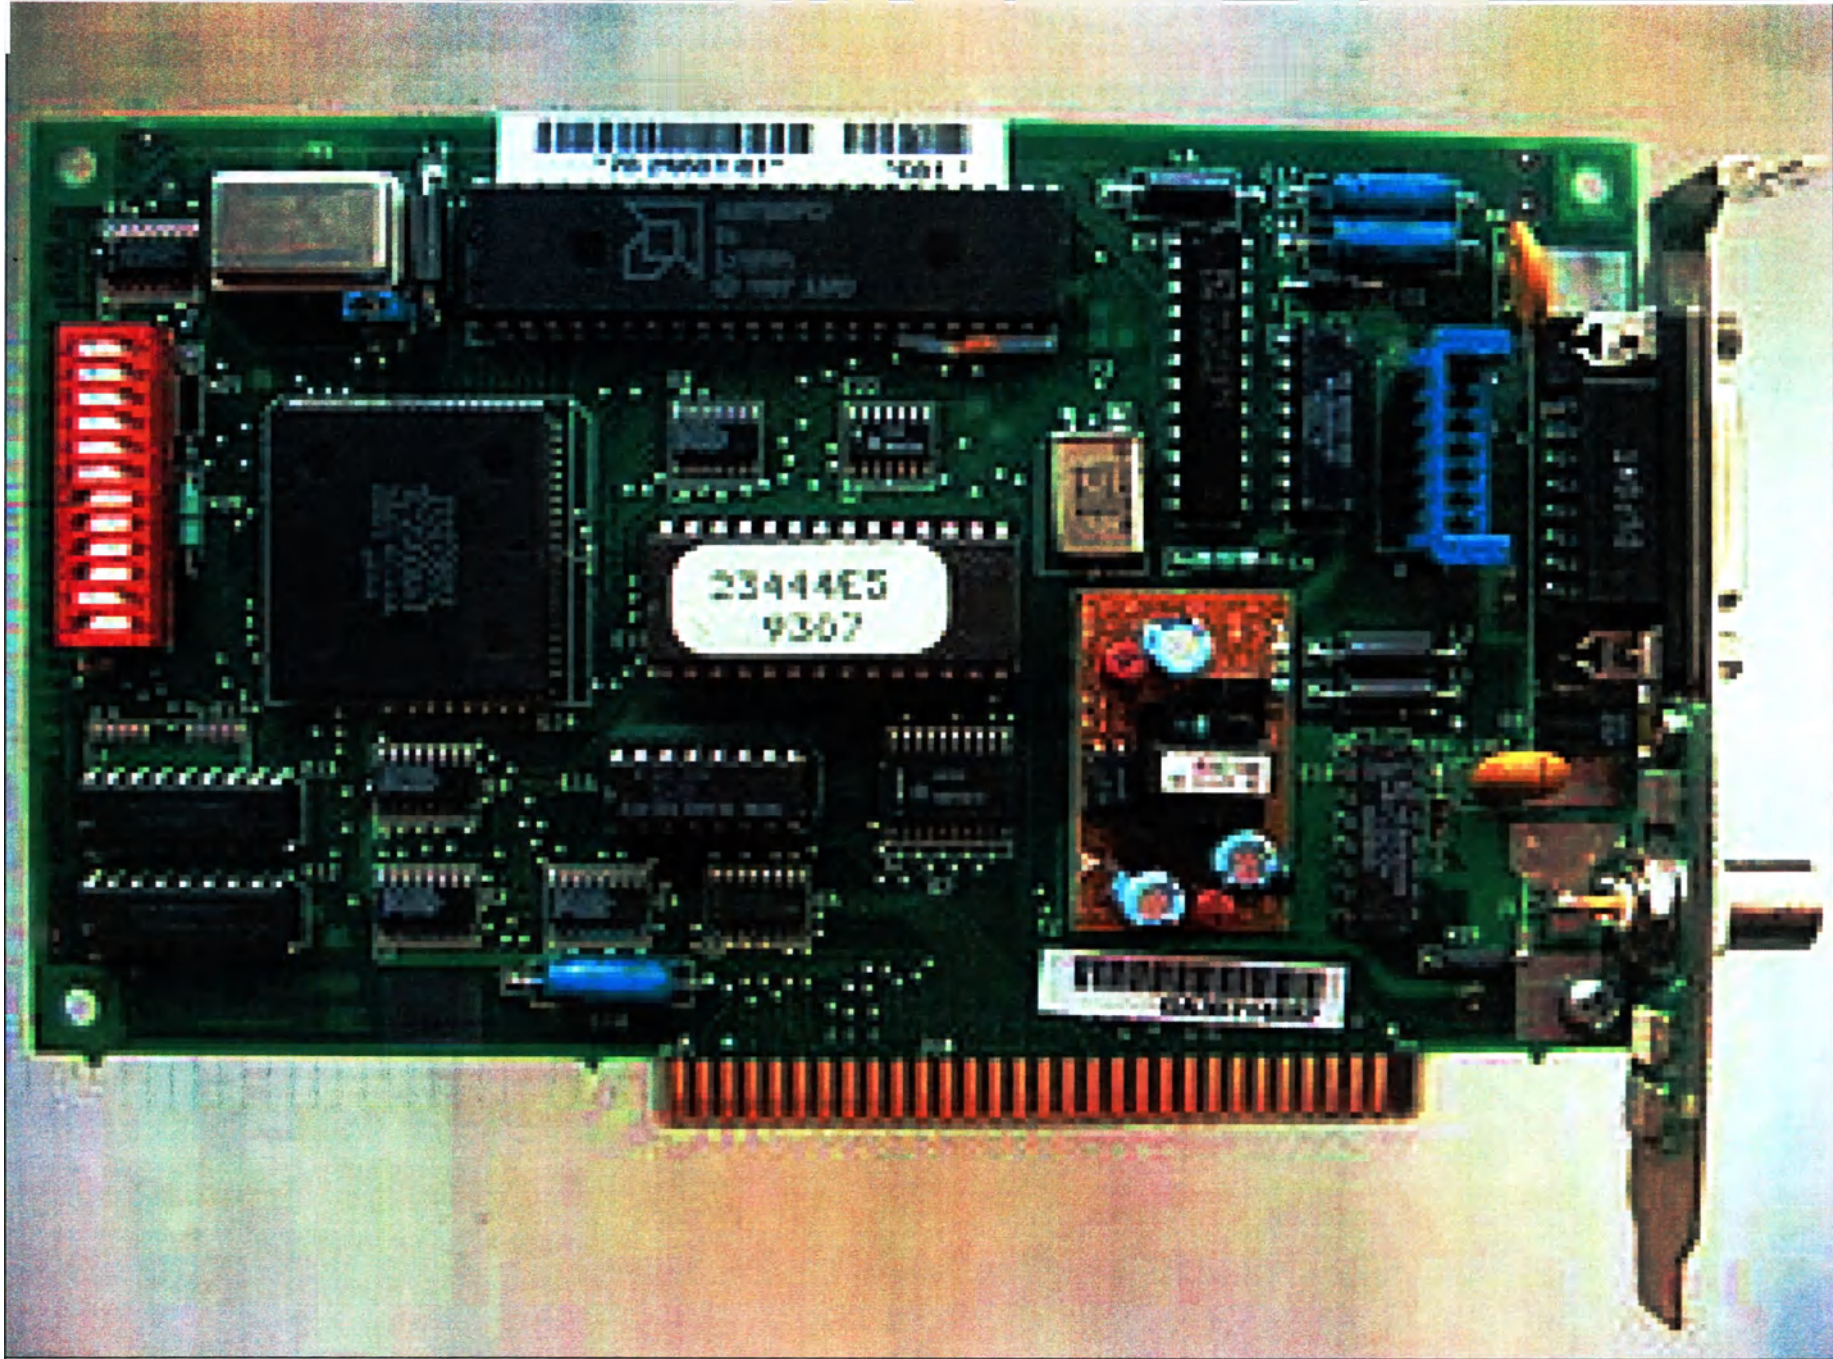


Рис. 135. Платы сетевые (не более 4 шт.).



Рис. 136. Модули памяти (не более 5 шт.).



Рис. 137. Принтеры для печати изображений Drystar 5503 Dicom Imager (не более 5 шт.).



Рис. 138. Пленка для принтера для печати изображений (не более 5 шт.).



Рис. 139. Программные пакеты для модернизации (не более 40 шт.).



Рис. 140. Программные пакеты для консоли управления (не более 40 шт.).



Рис. 141. Считыватель штрих-кода



Рис. 142. Система видео наблюдения за пациентом

SN

Сер.
номер



Изготовлено:



Месяц/ГГГГ

Ном. напряжение:

3N ~ 380/400/420/440/460/480 В

Мгновенная мощность: 90 кВ·А

Длительная мощность: 22 кВ·А

Частота: 50/60 Гц

Класс I



**GE MEDICAL SYSTEMS ISRAEL,
FUNCTIONAL IMAGING**

4 Hayozma Street

TIRAT HACARMEL, 30200 ISRAEL (ИЗРАИЛЬ)

5857582-RU

Рис. 143. Макет русскоязычной маркировки. Основная маркировка системы (паспортная табличка)



Описание



REF

Модель



SN

**Серийный
номер**



Изготовлено



Месяц/ГГГГ



**GE MEDICAL SYSTEMS ISRAEL,
FUNCTIONAL IMAGING**

4 Hayozma Street

TIRAT HACARMEL, 30200 ISRAEL (Израиль)



5857584-RU

Рис. 144. Макет русскоязычной маркировки. Пульты управления и консоли оператора



REF

Модель



SN

**Серийный
номер**



Изготовлено



Месяц/ГГГГ



**GE MEDICAL SYSTEMS, ISRAEL
FUNCTIONAL IMAGING**

4 Hayozma Street

TIRAT HACARMEL, 30200 ISRAEL (Израиль)



5779827-RU

Рис. 145. Макет русскоязычной маркировки. Принадлежности

147 — листа(ов)

