

DIACONT



ООО «Диаконт» ИНН 7714792851, г. Москва, 125284, ул. Беговая дом 13, кв. 90, Тел. +7(495)971-1944,
tru.com

e-mail: diacont@diacontru.com www.diacontru.com

Фотографические изображения медицинского изделия Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Concept

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДИАКОНТ»



Шишко П.И.

« 30 » 09 2024 г.

**Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Concept,
вариант исполнения:**

- I. 1. Глюкометр Diacont Concept - 1 шт.
2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Concept - 10 шт/уп.
3. Устройство автоматическое для прокалывания пальца - 1 шт.
4. Ланцеты стерильные -10 шт/уп.
5. Контрольный раствор нормальной концентрации - 1 шт.
6. Батарейка CR2032 - 1 шт.
7. Футляр - 1шт.
8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.






Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови марки «Diascont» Concept – 10 шт/уп. (ракурс 1)



Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови марки «Diasoft» Concept – 10 шт/уп. (ракурс 2)

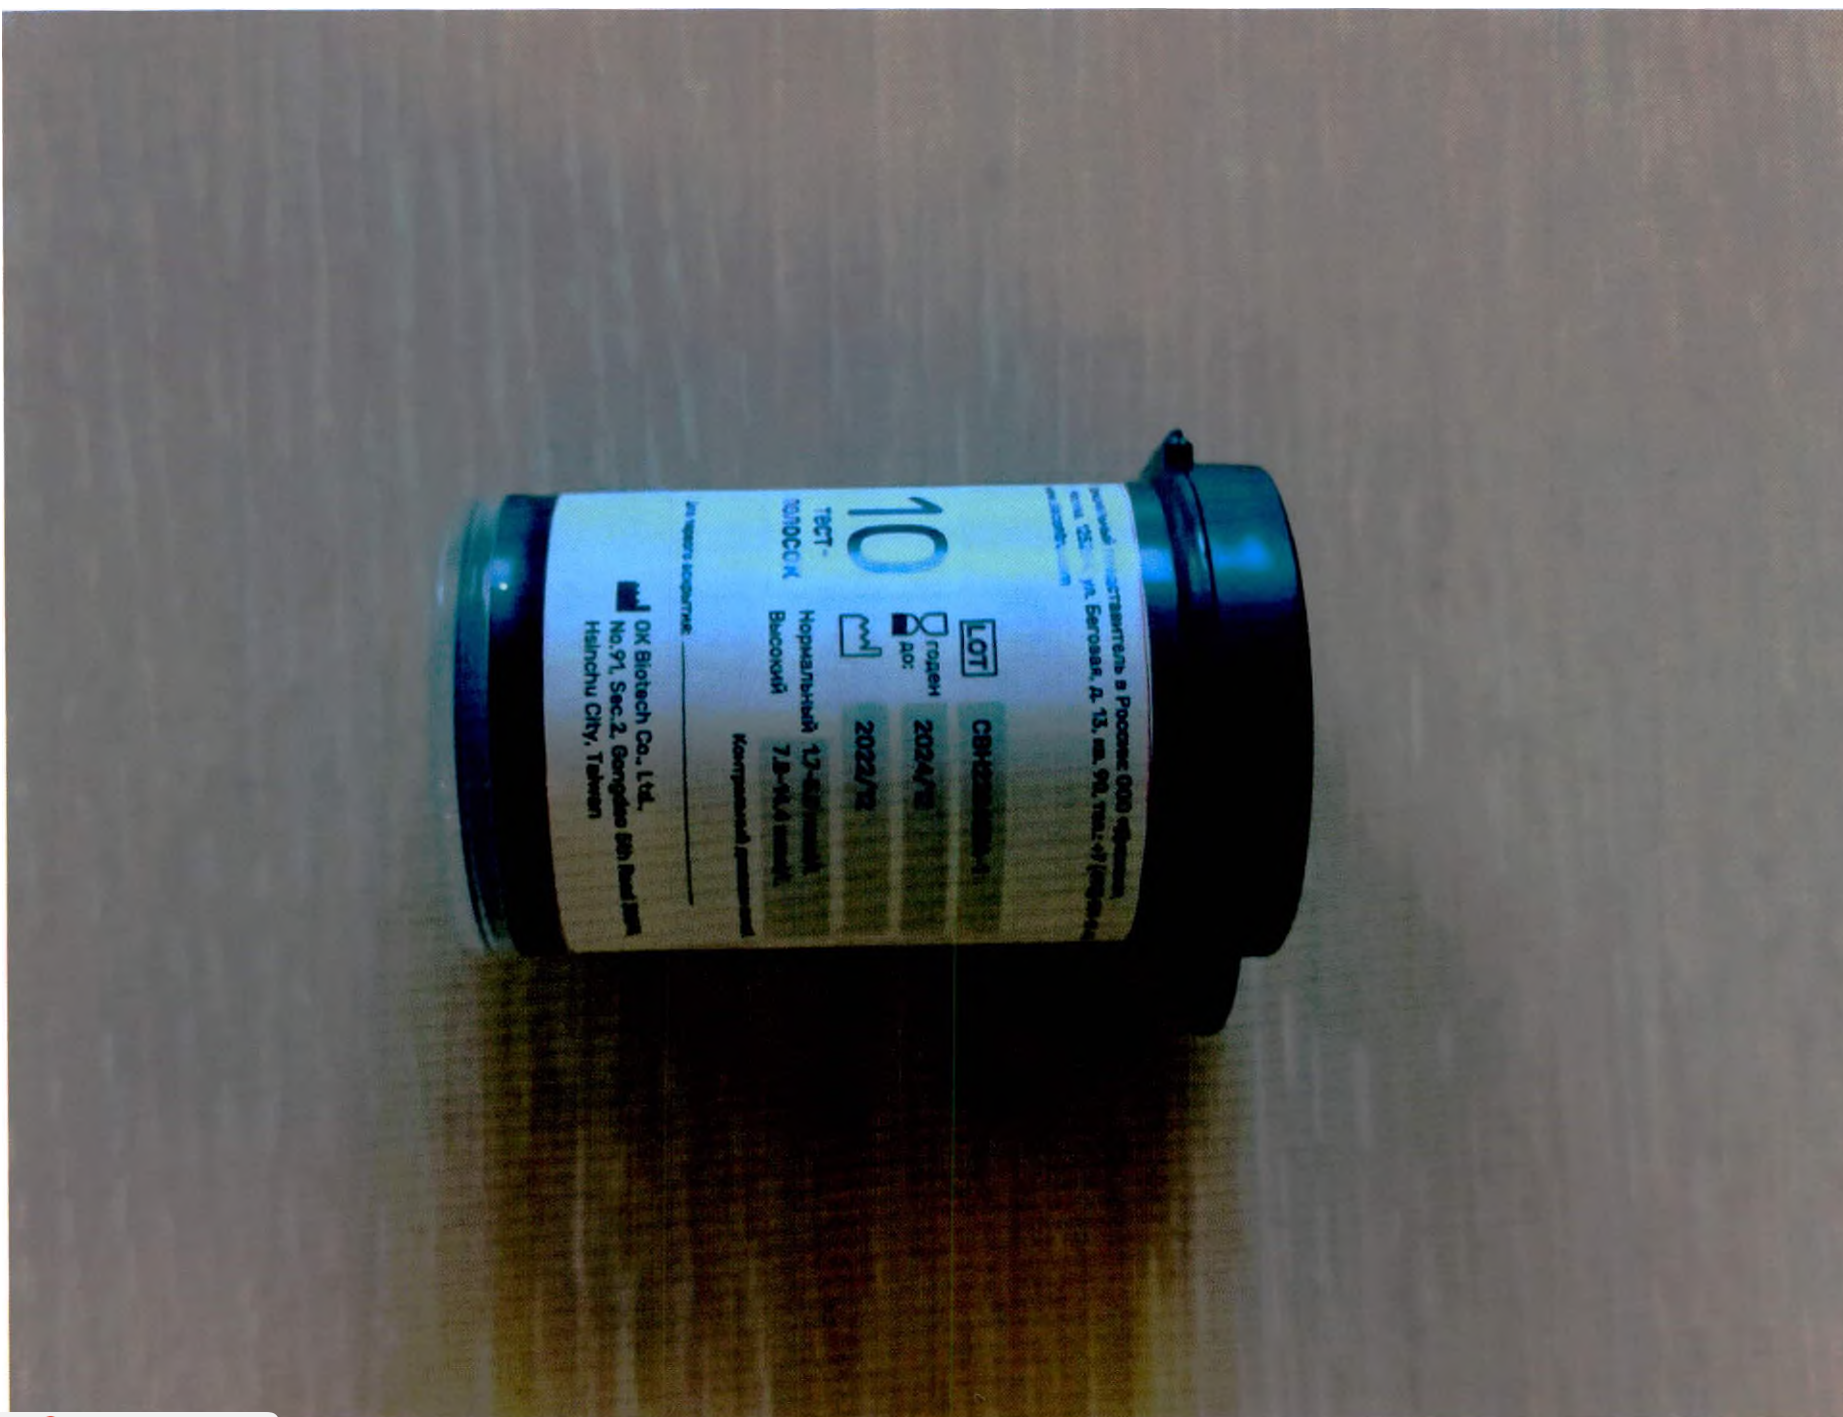



Устройство автоматическое для прокалывания пальца



Ланцеты стерильные – 10 шт/уп. (ракурс 1)




Ланцеты стерильные – 10 шт/уп. (ракурс 2) с маркировкой



Контрольный раствор нормальной концентрации



Батарейка CR2032

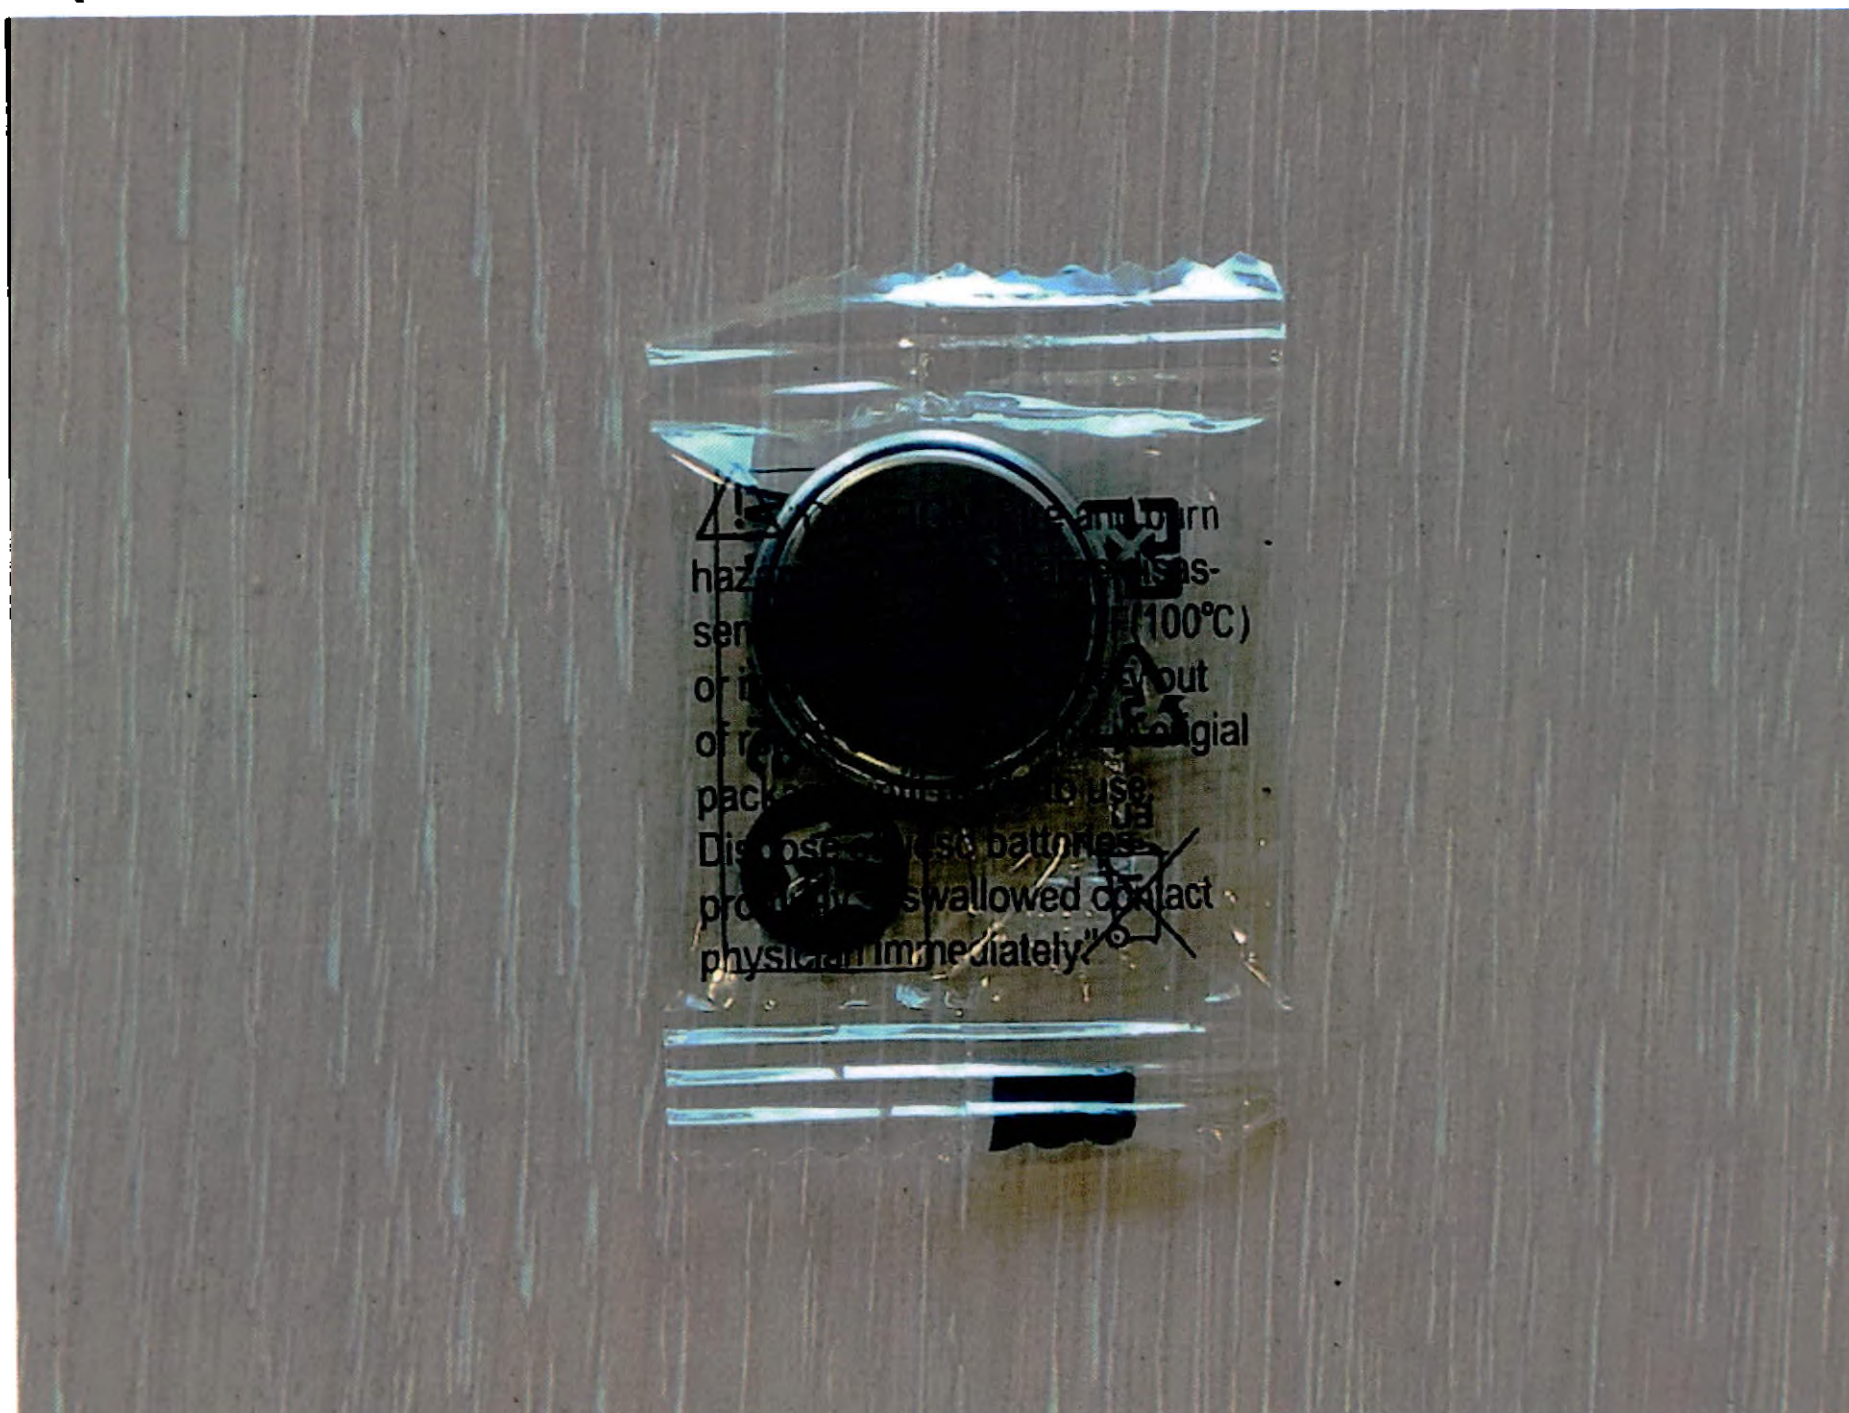

Футляр



Система контроля уровня глюкозы в крови марки «DIACONT» Concept в составе:

1. Глюкометр «Diacont» Concept – 1 шт.
2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Concept – 10 шт./уп.
3. Устройство автоматическое для прокалывания пальца – 1 шт.
4. Ланцеты стерильные – 10 шт./уп.
5. Контрольный раствор нормальной концентрации – 1 шт.
6. Батарея CR2032 – 1 шт.
7. Футляр – 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации – 1 шт.




IVD Для IN VITRO диагностики

ВНИМАНИЕ

- Для систематически правильного измерения уровня глюкозы в капле крови.
- Выхватывая и протыкая ланцетом палец, прибор должен использоваться.
- Глюкометр «Diacont» Concept работает с тест-полосками «Diacont» Concept.
- Поддержание глюкометра не требуется.
- Не используйте тест-полоски после истечения срока годности.
- Не используйте тест-полоски повторно, не храните их в контейнере или под прямыми лучами солнца.
- Убедитесь, что температура от +4 °C до +40 °C и влажность 10-90%.

Регистрационное удостоверение
№ ПРМ 2004/22204 от 08.08.2004



Распространитель:
«СМ Биотек» №, Ин-т, Ташкент,
СМ Биотек, Ltd, 1st Fl, Sec 2,
Darylko St, 101/102, Tashkent City, Tajikistan

Место производства:
CM Diagnostics Ltd, 1st Fl, Sec 2,
Darylko St, 101/102, Tashkent City, Tajikistan

Импортирует и продвигает в России:
ООО «Диагност»
Россия, г. Москва, ул. Ботаника,
д. 13, к. 40, тел. +7 (495) 971 19-44



Diacont[®] Concept

По вопросам работы глюкометра обращайтесь
в сервисный центр по номерам телефонов горячей линии Diacont:
в (800) 775-05-41 (звонок бесплатный по России)
+7 (495) 971-19-44 для Москвы и Московской области.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ МАРКИ «DIACONT» CONCEPT



Concept

ПАМЯТЬ 500 ИЗМЕРЕНИЙ
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЗА 7, 14, 30, 60 И 90 ДНЕЙ
БЕЗ КОДИРОВАНИЯ
СВЯЗЬ С КОМПЬЮТЕРОМ
ЧЕРЕЗ МИКРО USB-ПОРТ
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР
ПОРТА ТЕСТ-ПОЛОСКИ
РЕЗУЛЬТАТ ЗА 5 СЕКУНД

REF 30-20-4770-0003





XX.XXXX Глюкометр «Diacont» Concept.



годен
до:

XX.XXXX Тест-полоски к системе
контроля уровня глюкозы
в крови марки «Diacont» Concept.

XX.XXXX Контрольный раствор нормаль-
ной концентрации.

XX.XXXX Ланцеты стерильные – 10 шт./уп.

SN

Серийный
номер


XXXXXXXXXX

LOT

XXXXXXXXXX-X Тест-полоски к системе
контроля уровня глюкозы
в крови марки «Diacont»
Concept.

XXXXXXXXXX-X Контрольный раствор
нормальной концентрации.

X XXXX Ланцеты стерильные –
10 шт./уп.

Diacont		(применять только) НОРМАЛЬНЫЙ 4 mL	
Концепт			
Контрольный раствор нормальной концентрации для глюкометра «Diacont» Concept		Дата вскрытия: Использовать в течение 90 дней после первого вскрытия.	
Не употреблять внутрь.			
IVD  CE0123		LOT:	
ООО «Ведмедь-Тех» Научно-исследовательский центр «Ведмедь-Тех» ООО, г. Ижевск		Годен до: 	
 +30 °C -4 °C			

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Concept

Прибор для измерения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови



OK Biotech Co., Ltd., No.91, Sec.2, Gongdao 5th Road, 30070,
Hsinchu City, Taiwan. Официальный представитель

производителя в России: ООО «Диаконт», г. Москва, 125284,
ул. Беговая, д. 13, кв. 90. Тел.: 8 (800) 775-05-41.

IVD



Батарейка: CR2032 3V

+4°C +30°C



CE
0123

SN

XXXXXX

10-62-4763-0020
V1-MAY19



XX/XXXX

Макет маркировки флакона для Тест-полосок к системе контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Concept – 10 шт/уп.



**СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ
МАРКИ «DIACONT» CONCEPT**



■ OK Biotech Co., Ltd.,
No.91, Sec.2, Gongdao 5th Road 30070,
Hainchu City, Taiwan

Место производства:
OK Biotech Co., Ltd.,
No.91, Sec.2, Gongdao 5th Road 30070,
Hainchu City, Taiwan

**Уполномоченный представитель
в России:**


ООО «Диаконт», Москва 125284,
ул.Беговая д.13, кв.90
тел. 8(800)775-0541

Регистрационное удостоверение № _____
от _____ г.

**Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diascont» Concept,
вариант исполнения:**

- II. 1. Глюкометр Diascont Concept - 1 шт.**
- 2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови марки «Diascont» Concept - 10 шт/уп.**
- 3. Устройство автоматическое для прокалывания пальца - 1 шт.**
- 4. Ланцеты стерильные -10 шт/уп.**
- 5. Контрольный раствор высокой концентрации - 1 шт.**
- 6. Батарейка CR2032 - 1 шт.**
- 7. Футляр - 1шт.**
- 8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.**

Общий вид комплекта поставки

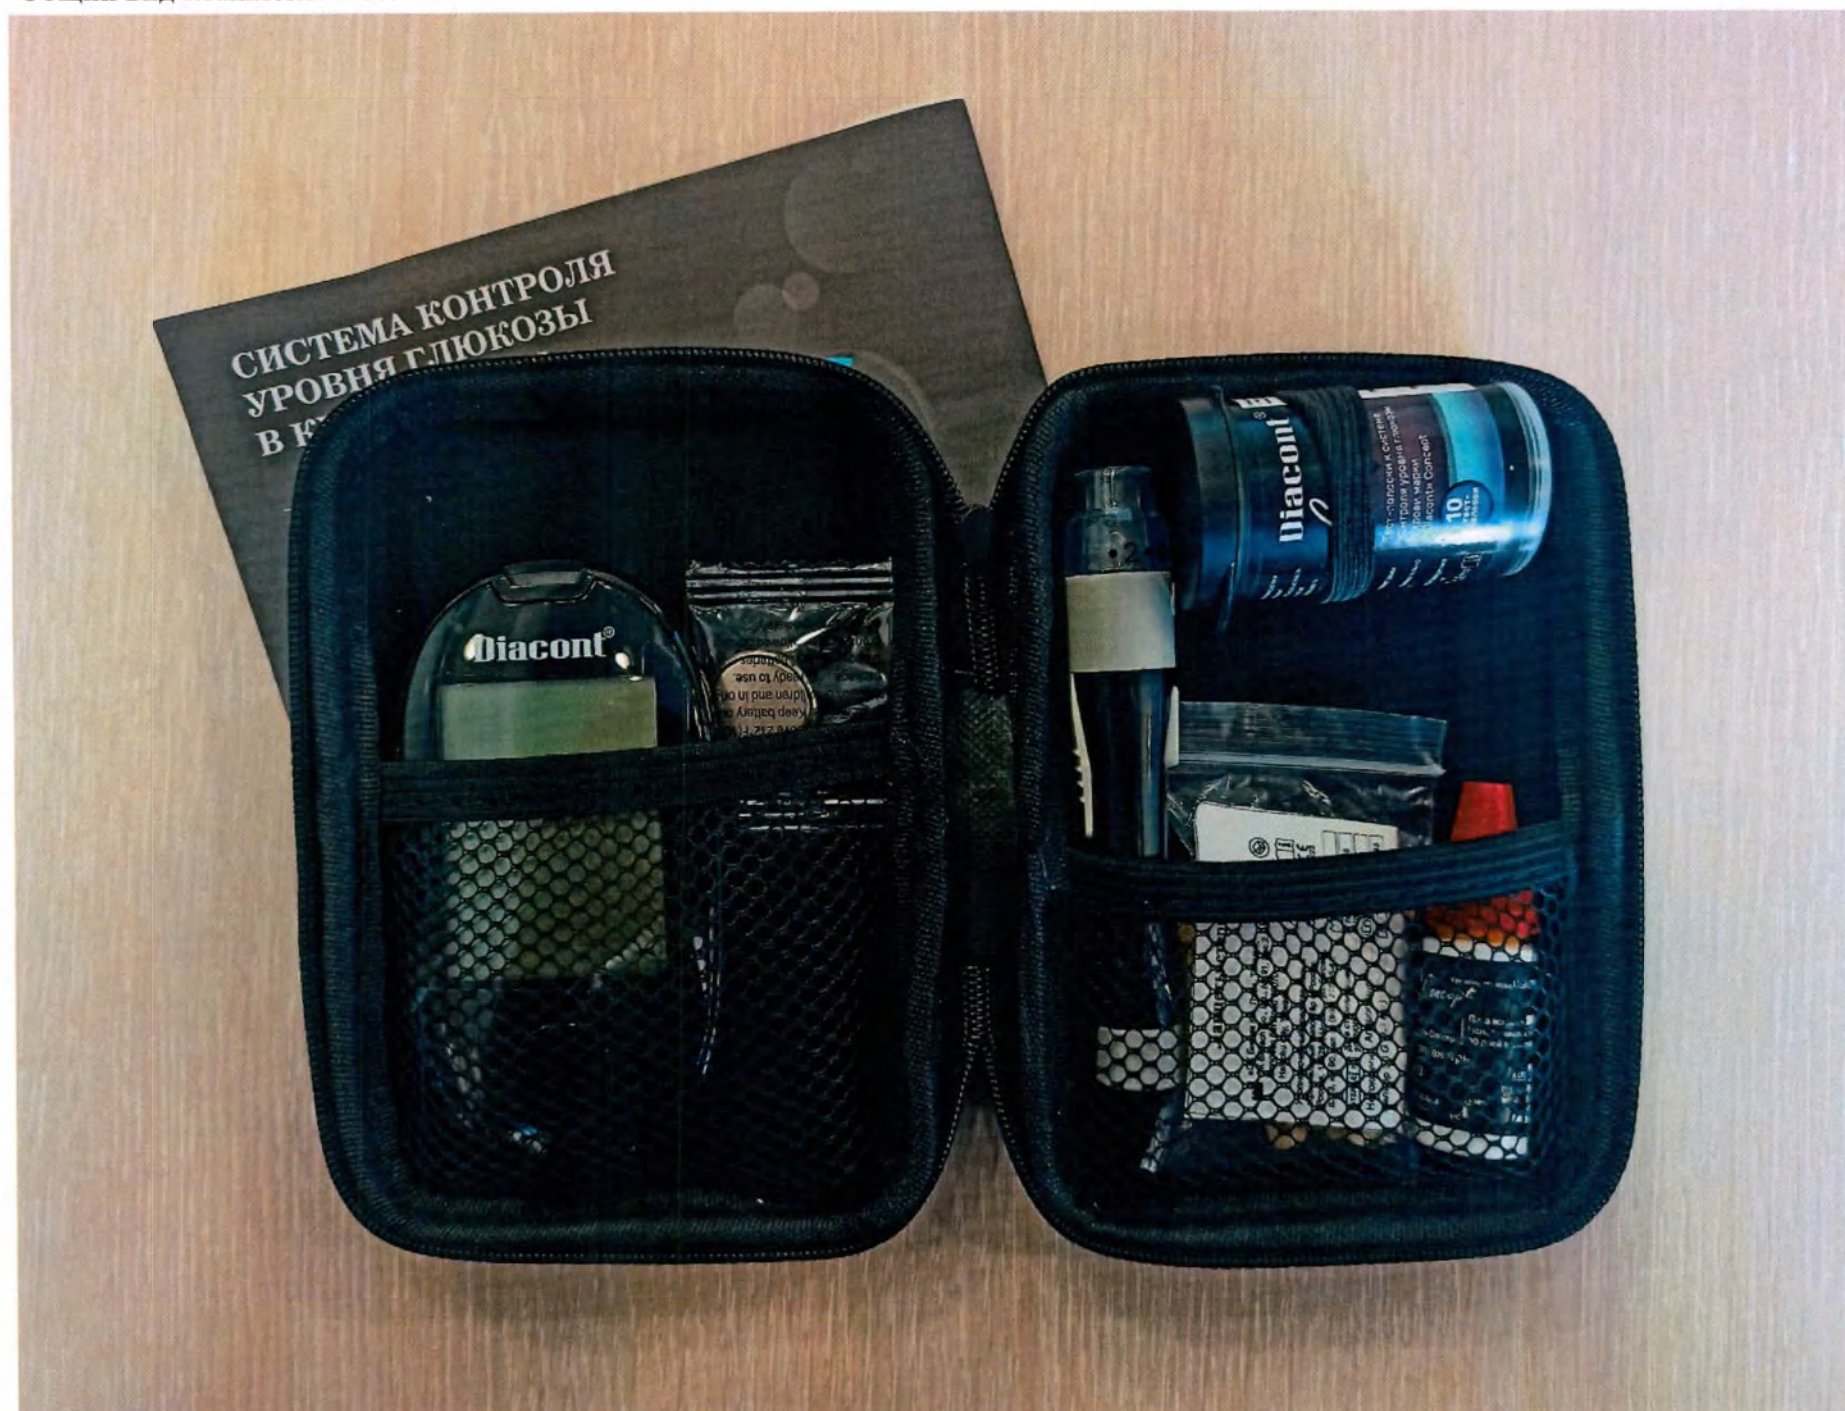

Глюкометр Diacont Concept – (ракурс 1)



Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови марки «Diascont» Concept – 10 шт/уп. (ракурс 1)



Общий вид Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Concept



Устройство автоматическое для прокалывания пальца



Ланцеты стерильные – 10 шт/уп. (ракурс 1)



Ланцеты стерильные – 10 шт/уп. (ракурс 2)



Контрольный раствор высокой концентрации

Батарейка CR2032




Футляр



Система контроля уровня глюкозы в крови марки «DIACONT» Concept в составе:

1. Глюкометр «Diacont» Concept – 1 шт.
2. Тест-полоски к системе контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Concept – 10 шт./уп.
3. Устройство автоматическое для прокалывания пальца – 1 шт.
4. Ланцеты стерильные – 10 шт./уп.
5. Контрольный раствор высокой концентрации – 1 шт.
6. Батарейка CR2032 – 1 шт.
7. Футляр – 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

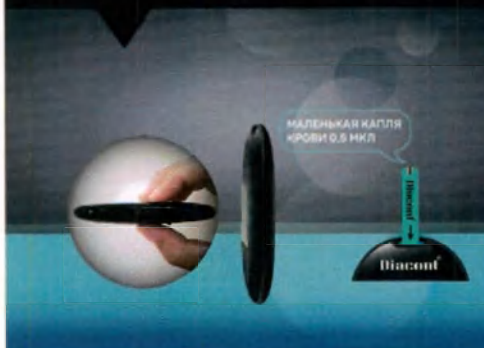


IVD Для IN VITRO диагностики

ВНИМАНИЕ

- Для систематически точных результатов измерения уровня глюкозы в капле крови.
- Всегда соблюдайте правила гигиены и правила использования.
- Глюкометр «Diacont» Concept работает с тест-полосками «Diacont» Concept.
- Калибровка глюкометра не требуется.
- Не используйте тест-полоски после истечения их срока годности.
- Не используйте тест-полоски, которые не соответствуют требованиям производителя.
- Храните систему при температуре от +5°C до +30°C и влажности от 10-90%.

Регистрационный номер: RU.01.2024/22749 от 10.01.2024



Производитель:
«Diacont» ООО, Россия, Татарстан,
ОБ. Восточный, Уфа, М-11, Сек. 2,
Gongdao 1st Road 305/10, Huzhou City, Tianjin

Место производства:
OK Medical Co., Ltd. No. 11, Sec. 2,
Gongdao 1st Road 305/10, Huzhou City, Tianjin

Импортер/производитель:
«Diacont» ООО, Россия, Татарстан,
Республика Татарстан, Уфа, М-11, Сек. 2,
д. 10, кв. 10, тел. +7 (855) 971-19-44



Diacont[®] Concept

По вопросам работы глюкометра обращайтесь
в сервисный центр по номерам телефонов горячей линии Diacont:
8 (800) 775-05-41 (звонок бесплатный по России),
+7 (495) 971-19-44 для Москвы и Московской области.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ МАРКИ «DIACONT» CONCEPT



Concept

ПАМЯТЬ 500 ИЗМЕРЕНИЙ
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЗА 7, 14, 30, 60 И 90 ДНЕЙ
БЕЗ КОДИРОВАНИЯ
СВЯЗЬ С КОМПЬЮТЕРОМ
ЧЕРЕЗ МИКРО USB-ПОРТ
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР
ПОРТА ТЕСТ-ПОЛОСКИ
РЕЗУЛЬТАТ ЗА 5 СЕКУНД

REF 30-20-4770-0003



4 712803 563861



XX.XXXX Глюкометр «Diacont» Concept.



годен
до:

XX.XXXX Тест-полоски к системе
контроля уровня глюкозы
в крови марки «Diacont» Concept.

XX.XXXX Контрольный раствор высокой
концентрации.

XX.XXXX Ланцеты стерильные – 10 шт./уп.



Серийный
номер

XXXXXXXXXX



XXXXXXXXXX-X Тест-полоски к системе
контроля уровня глюкозы
в крови марки «Diacont»
Concept.

XXXXXXXXXX-X Контрольный раствор
высокой концентрации.

X XXXX Ланцеты стерильные –
10 шт./уп.

Diacont		КОНТРОЛЬНЫЙ РАСТВОР ВЫСОКИЙ 4 mL	
Консерт			
Контрольный раствор высокой концентрации для глюкометра «Diacont» Консерт		Дата вскрытия Использовать в течение 90 дней после первого вскрытия.	
Не употреблять внутрь.			
IVD  CE0123		LOT	
ООО «В.В.С.», г. Москва N 10/03/2014, г. 03.03.2014 10.03.2014, г. 03.03.2014		Годен до 	
 +30 °C  +4 °C			

Система контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Concept

Прибор для измерения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови


 OK Biotech Co., Ltd., No.91, Sec.2, Gongdao 5th Road, 30070,
Hsinchu City, Taiwan. Официальный представитель
производителя в России: ООО «Диаконт», г. Москва, 125284,
ул. Беговая, д. 13, кв. 90. Тел.: 8 (800) 775-05-41.

IVD



Батарейка: CR2032 3V

+4°C  +30°C

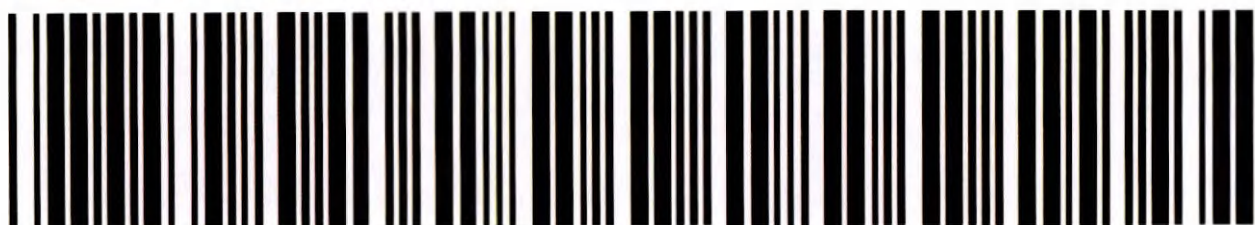


CE
0123

SN

XXXXXX

10-62-4763-0020
V1-MAY19



XX/XXXX

Макет маркировки флакона для Тест-полосок к системе контроля уровня глюкозы в крови марки «Diacont» Concept – 10 шт/уп.



**СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ
МАРКИ «DIACONT» CONCEPT**



■ OK Biotech Co., Ltd.,
No.91, Sec.2, Gongdao 5th Road 30070,
Hainchu City, Taiwan

Место производства:
OK Biotech Co., Ltd.,
No.91, Sec.2, Gongdao 5th Road 30070,
Hainchu City, Taiwan

**Уполномоченный представитель
в России:**

ООО «Диаконт», Москва 125284,
ул.Беговая д.13, кв.90
тел. 8(800)775-0541

Регистрационное удостоверение № _____
от _____ г.

ВСЕГО ПРОШИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
37 ЛИСТА/ОВ/