

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО НПО «Деост»



Паклин Е.Л.


## **Фотографические изображения**

**«Система саморасширяющегося периферического стента NiTiDES,  
выделяющего Сиролимус, с покрытием iCarbofilm, в вариантах  
исполнения»**


Производитель: CID S.p.A. («СИД С.п.А.»), Италия

Strada per Crescentino, 13040 Saluggia (VC), Italy


Система саморасширяющегося периферического стента NiTiDES, выделяющего Сиролимус, с покрытием iCarbofilm, Эффективная длина катетера 85см; Диаметр и длина стента: 6,0х20мм;

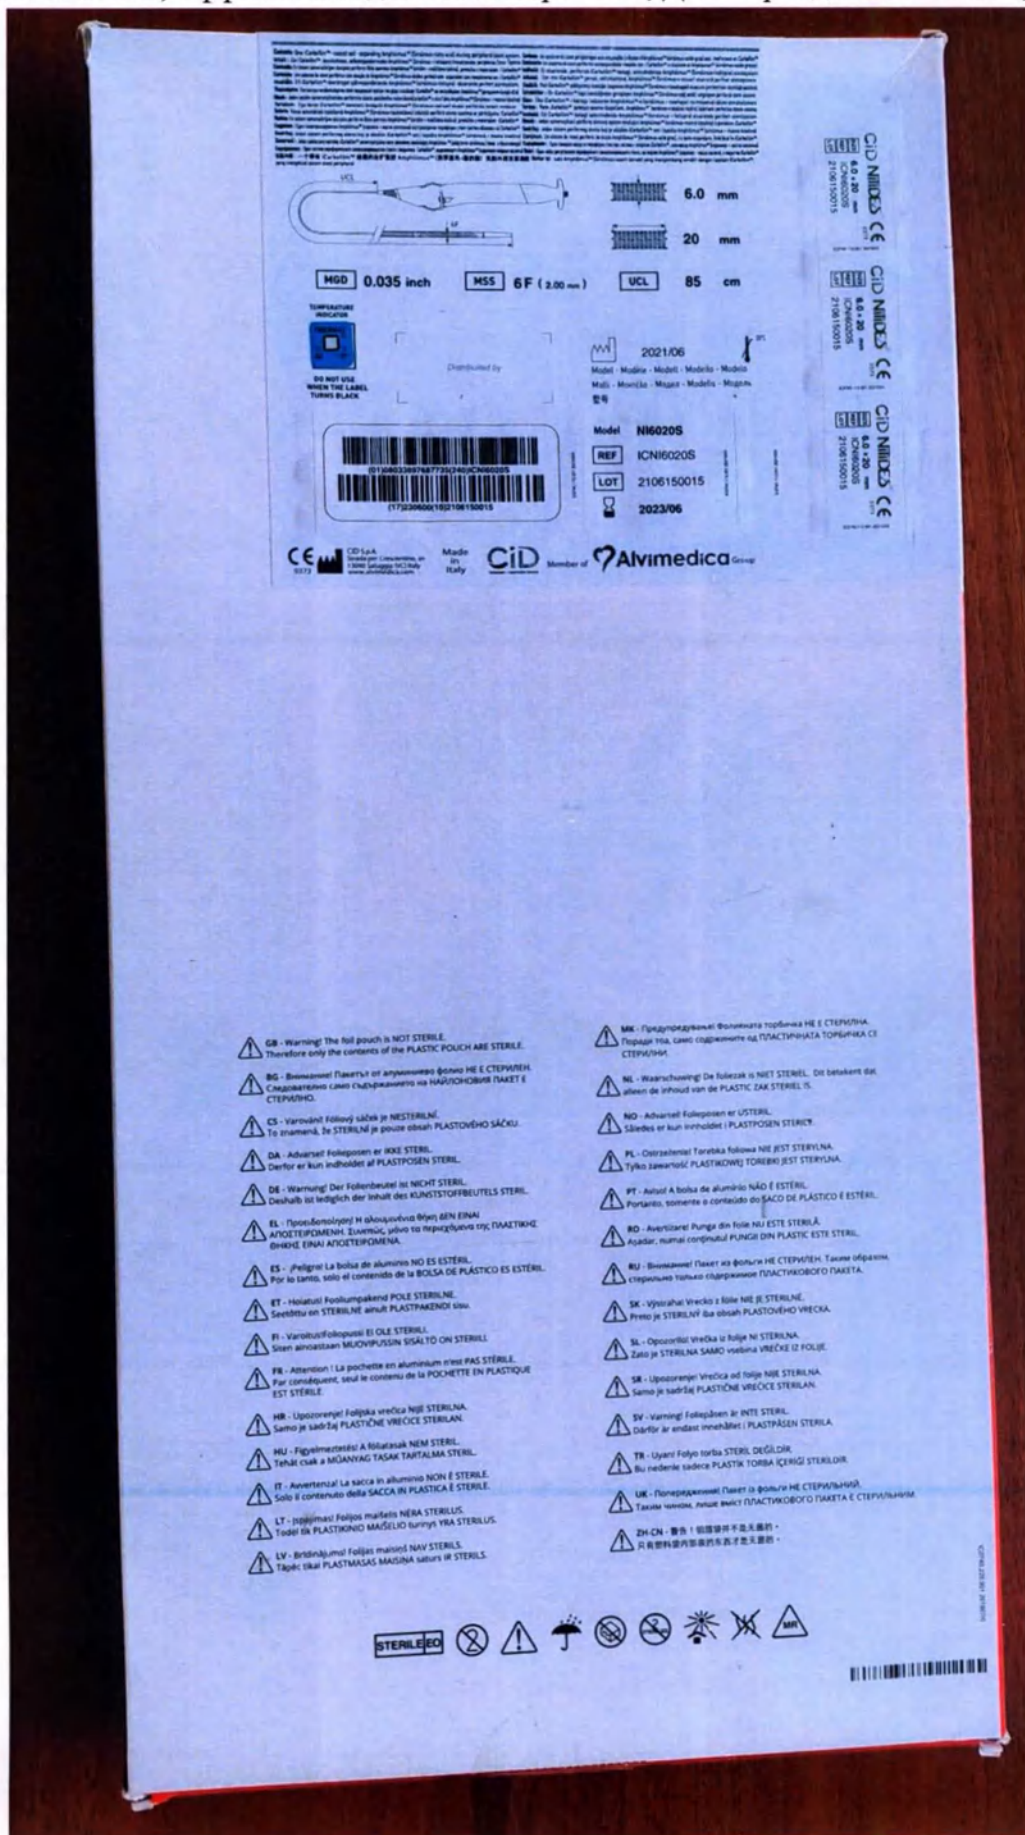

Вторичная упаковка – картонная коробка

[illegible]

UCL 85 cm



**DO NOT USE  
WHEN THE LABEL  
TURNS BLACK**



2021/06

Model - Modèle - Modell - Modello - Modelo  
Malli - Μοντέλο - Модел - Modelis - Модель  
模型




Model NI6020S

REF ICN16020S

LOT 2106150015

2023/06



CID S.p.A.  
Strada per Crescentino, sn  
13040 Saluggia (VC) Italy  
[www.alvimedica.com](http://www.alvimedica.com)

Made  
in  
Italy



Member of



**CID NIDES**  
 6.0 x 20 mm  
 ICN16020S  
 2106150015

CID N11DE3

|      |             |
|------|-------------|
| SIZE | 6.0 x 20 mm |
| REF  | ICN16020S   |
| LOT  | 2106150015  |

6.0 x 20 mm  
ICN16020S  
2106150015

 Por lo tanto, solo el contenido de la BOLSA DE PLÁSTICO ES ESTÉRIL.

 ET - Hoiatus! Foolumpakend POLE STERIILNE.  
Seetõttu on STERIILNE ainult PLASTPAKENDI sisu.

 FI - Varoitus! Foliopussi EI OLE STERIILI.  
Siten ainostaan MUOVIPUSSIN SISÄLTÖ ON STERIILI.

 **FR - Attention ! La pochette en aluminium n'est PAS STÉRILE.**  
Par conséquent, seul le contenu de la **POCHETTE EN PLASTIQUE**  
est STÉRILE.

 **HR - Upozorenje! Folijaska vrećica NIJE STERILNA.**  
Samo je sadržaj **PLASTIČNE VREĆICE STERILAN.**

**HU - Figyelmeztetés! A fóliátasak NEM STERIL.**  
Tehát csak a MŰANYAG TASAK TARTALMA STERIL.

 **IT - Avvertenza! La sacca in alluminio NON È STERILE. Solo il contenuto della SACCA IN PLASTICA È STERILE.**

LT - Įspėjimas! Folijos maišelis NĖRA STERILUS.  
Todėl tik PLASTIKINIO MAIŠELIO turinys YRA STERILUS.

 LV - Brīdinājums! Folijas maisiņš NAV STERILS.  
Tāpēc tikai PLASTMASAS MAISIŅA saturs IR STERILS.

 **RU - Внимание! Пакет из фольги НЕ СТЕРИЛЕН.** Таким образом, стерильно только содержимое **ПЛАСТИКОВОГО ПАКЕТА.**

 **SK - Výstraha! Vrečko z fólie NIE JE STERILNÉ.**  
Preto je STERILNÝ iba obsah PLASTOVÉHO VRECKA.

 SL - Opozorilo! Vrečka iz folije NI STERILNA.  
Zato je STERILNA SAMO vsebina VREČKE IZ FOLIJE

 SR - Upozorenje! Vrećica od folije NIJE STERILNA.  
Samo je sadržaj PLASTIČNE VREĆICE STERILAN.


**SV - Varning! Foliepåsen är INTE STERIL.**  
Därför är endast innehållet i PLASTPÅSEN STERILT.

 **TR - Uyarı Folyo torba STERİL DEĞİLDİR.**  
Bu nedenle sadece PLASTİK TORBA İÇERİĞİ STERİL DİR.

**UK - Попередження! Пакет із фольги НЕ СТЕРИЛЬНИЙ!**

 **ZH-CN - 警告！铝箔袋并不是无菌的。**

100




DOI: 10.1002/2010JG001711

0001-9081(200605)28:5;1-10

### Маркировка на картонной коробке

# Система саморасширяющегося периферического стента NiTiDES, выделяющего Сиролимус, с покрытием iCarbofilm

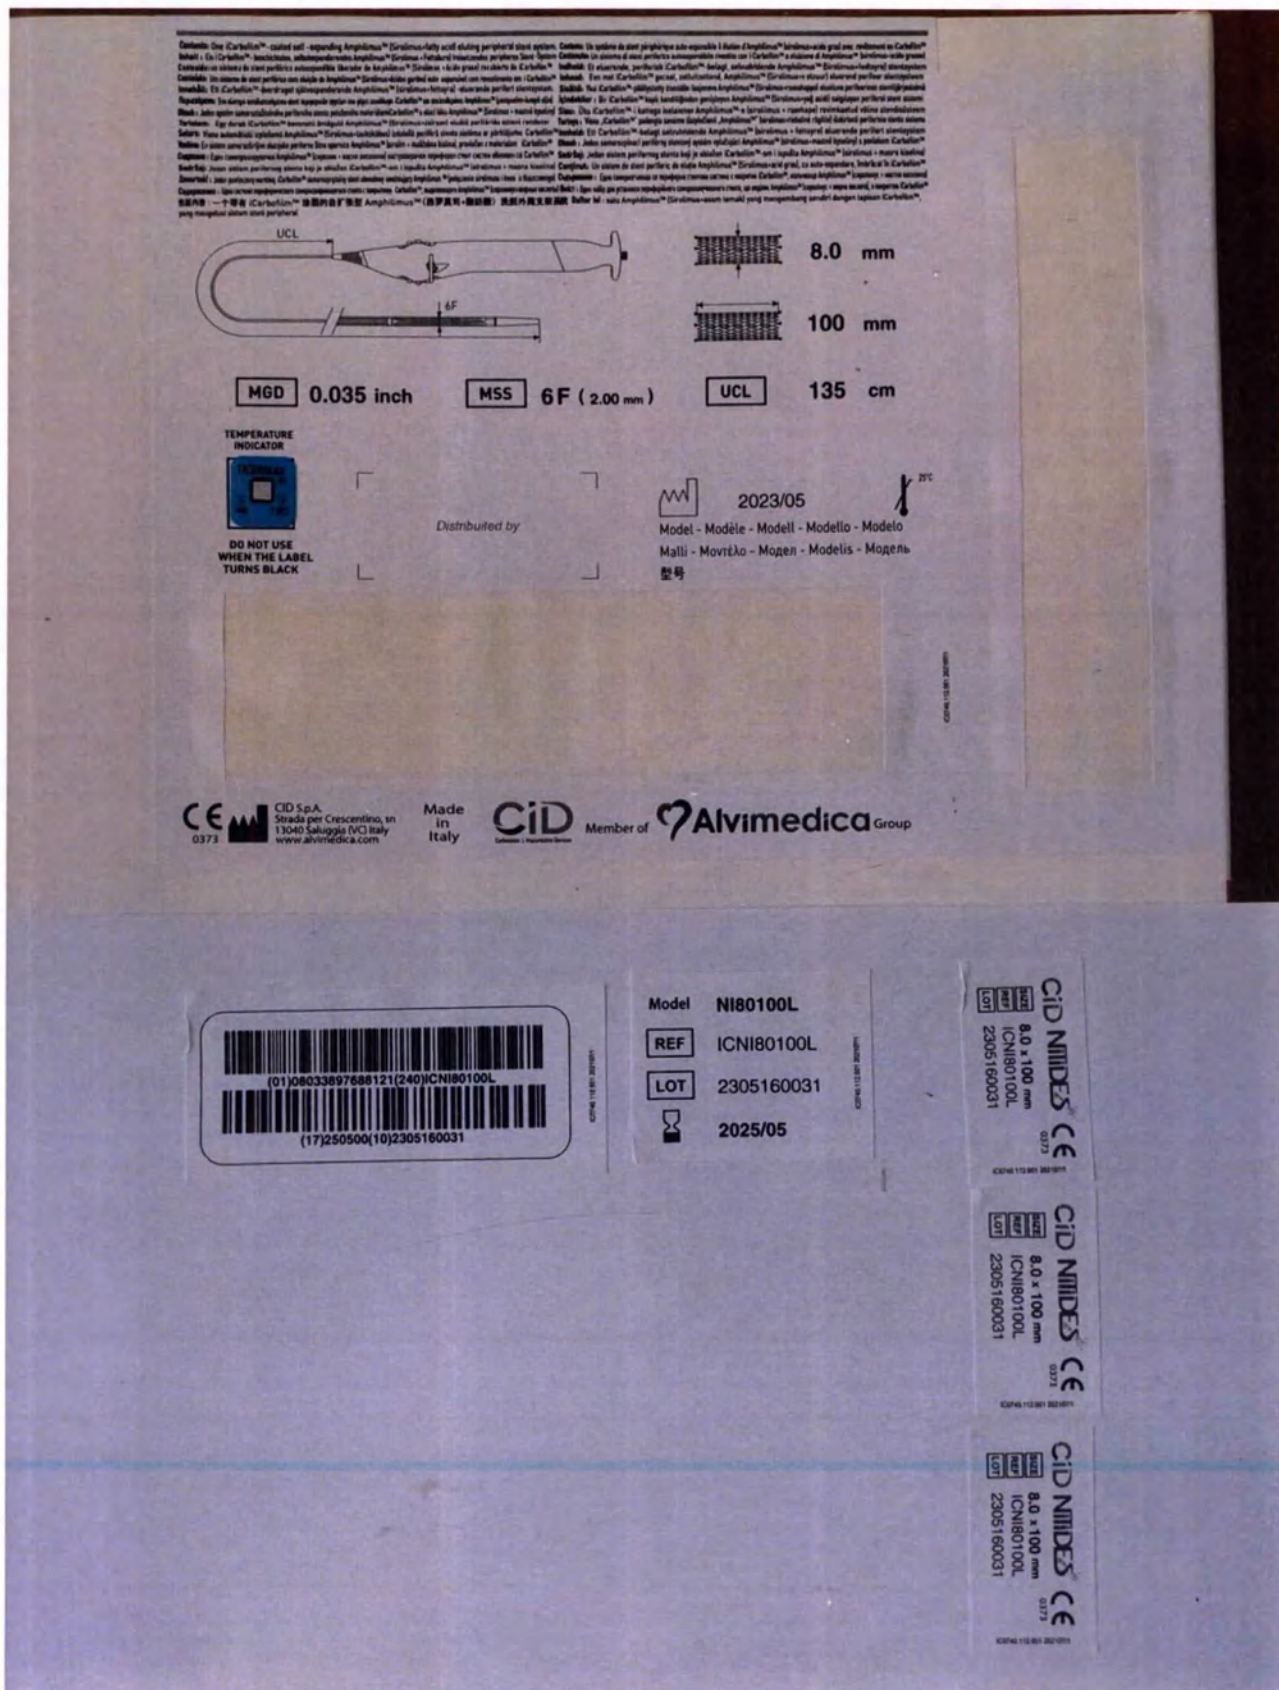

Клейкие этикетки учета и отслеживаемости изделия - стикеры. Данные стикеры изделия NiTiDES расположены на комбинированной этикетке изделия (картонная коробка) и свободно отклеиваются.

Система саморасширяющегося периферического стента NiTiDES, выделяющего Сиролимус, с покрытием iCarbofilm, Эффективная длина катетера 85см; Диаметр и длина стента: 6,0х20мм;



Первичная упаковка – Пакет из многослойного фольгированного материала


6

Система саморасширяющегося периферического стента NiTiDES, выделяющего Сиролимус, с покрытием iCarbofilm, Эффективная длина катетера 85см; Диаметр и длина стента: 6,0х20мм;



Первичная упаковка – Внутренний пакет (стерильный барьер)

Система саморасширяющегося периферического стента NiTiDES, выделяющего Сиролимус, с покрытием iCarbofilm, Эффективная длина катетера 85см; Диаметр и длина стента: 6,0x20мм;

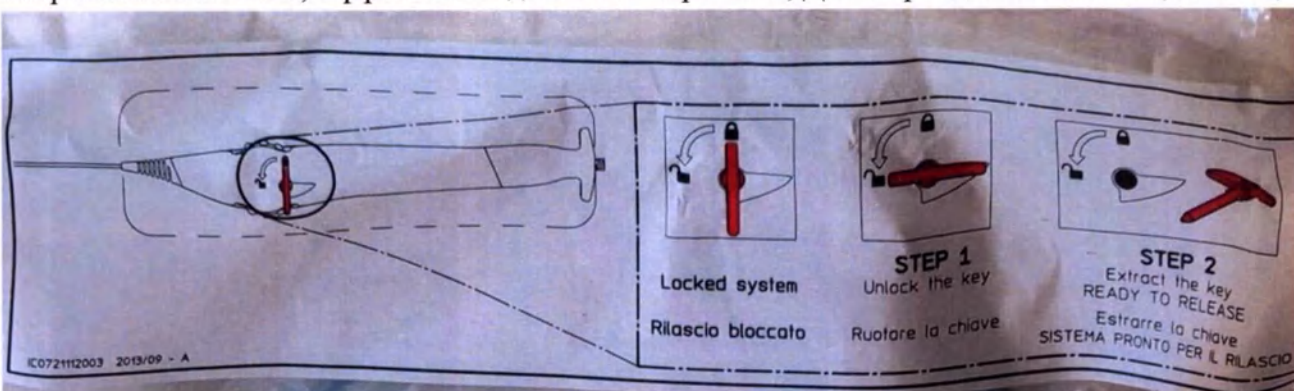

**NiTiDES**

6.0 mm 20 mm

UCL 85 cm REF ICNI6020S LOT 2106150015

2023/06

25°C

Contents: One Carbolon™ coated self-expanding Amphilimus™ (Sirolimus) alloy stent system. Contains the system to deliver the stent and the key to unlock the stent. The system is delivered in a sterile, sealed pouch. The key is used to unlock the stent. The stent is then deployed. The stent is made of a self-expanding alloy. The stent is coated with a biocompatible polymer. The stent is designed to expand to a diameter of 6.0 mm and a length of 20 mm. The stent is used to treat peripheral vascular disease. The stent is made of a self-expanding alloy. The stent is coated with a biocompatible polymer. The stent is designed to expand to a diameter of 6.0 mm and a length of 20 mm. The stent is used to treat peripheral vascular disease.

MGD 0.035 inch MSS 6F (2.00 mm) UCL 85 cm

**Warning! The foil pouch is NOT STERILE. Therefore only the contents of the PLASTIC POUCH ARE STERILE**

STERILE

2021/06

Model - Modèle - Modell - Modello - Modelo  
Malli - Movželo - Modeln - Modelis - Modelen  
型号

Model **NI6020S**  
REF **ICNI6020S**  
LOT **2106150015**  
2023/06

**CiD NiTiDES** CE 0373  
SIZE 6.0 x 20 mm  
REF ICNI6020S  
LOT 2106150015

**CiD NiTiDES** CE 0373  
SIZE 6.0 x 20 mm  
REF ICNI6020S  
LOT 2106150015

**CiD NiTiDES** CE 0373  
SIZE 6.0 x 20 mm  
REF ICNI6020S  
LOT 2106150015

**CiD** Member of **Alvimedica Group**


Маркировка на внутреннем пакете

Система саморасширяющегося периферического стента NiTiDES, выделяющего Сиролимус, с покрытием iCarbofilm



Клейкие этикетки учета и отслеживаемости изделия - стикеры. Данные стикеры изделия NiTiDES расположены на комбинированной этикетке изделия (стерильный пакет) и свободно отклеиваются.

Система саморасширяющегося периферического стента NiTiDES, выделяющего Сиролимус, с покрытием iCarbofilm, Эффективная длина катетера 85см; Диаметр и длина стента: 6,0х20мм;

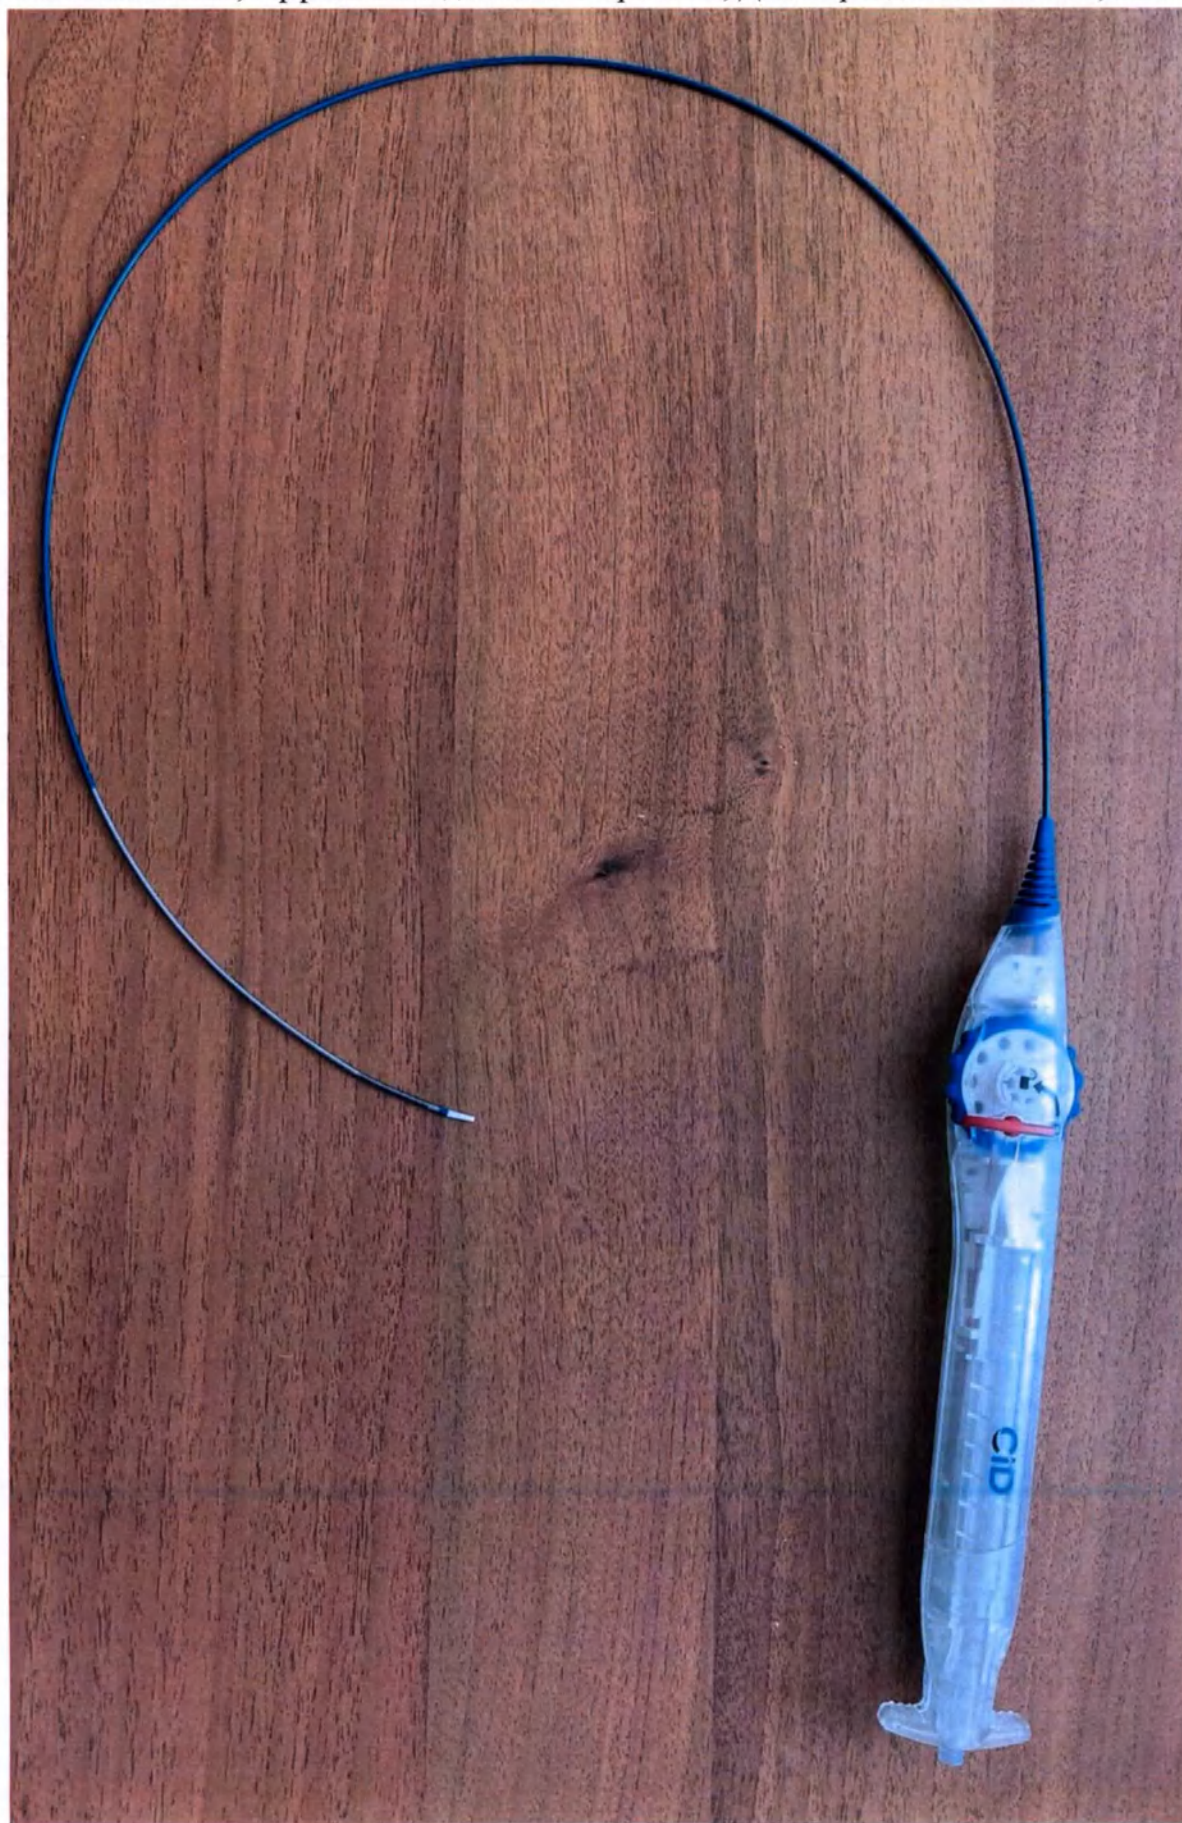

Общий вид изделия

**Система саморасширяющегося периферического стента NiTiDES,  
выделяющего Сиролимус, с покрытием iCarbofilm**

Изготовитель: «СИД С.п.А.», Италия

Импортер в РФ: ООО НПО «ДЕОСТ»

Стерильно. Для одноразового использования.

Хранить в сухом, темном месте при температуре от 15°C до 25°C,  
относительной влажности воздуха: 20-80% и атмосферном давлении: 630-  
800 мм рт. ст.

Регистрационное удостоверение № РЗН 20XX/XXXX от XX.XX.20XX г.

Год изготовления: указан на упаковке

Размер, тип и код: указан на упаковке

Годен до: указано на упаковке

Всего прошнуровано и скреплено печатью  
11 ( одиннадцать ) листа/ов

Генеральный директор  
ООО НПО «Деост»

Паклин Е. Л.

