

PHILIPS

Менеджер по нормативному
регулированию ООО "ФИЛИПС"




А.А. Град


«30» *ноября* 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ



«Система мониторинга пациента во время магнитно-резонансной томографии Expression с принадлежностями».

Система мониторинга пациента во время магнитно-резонансной томографии Expression с принадлежностями:
Варианты исполнения: Expression MR200, в составе:

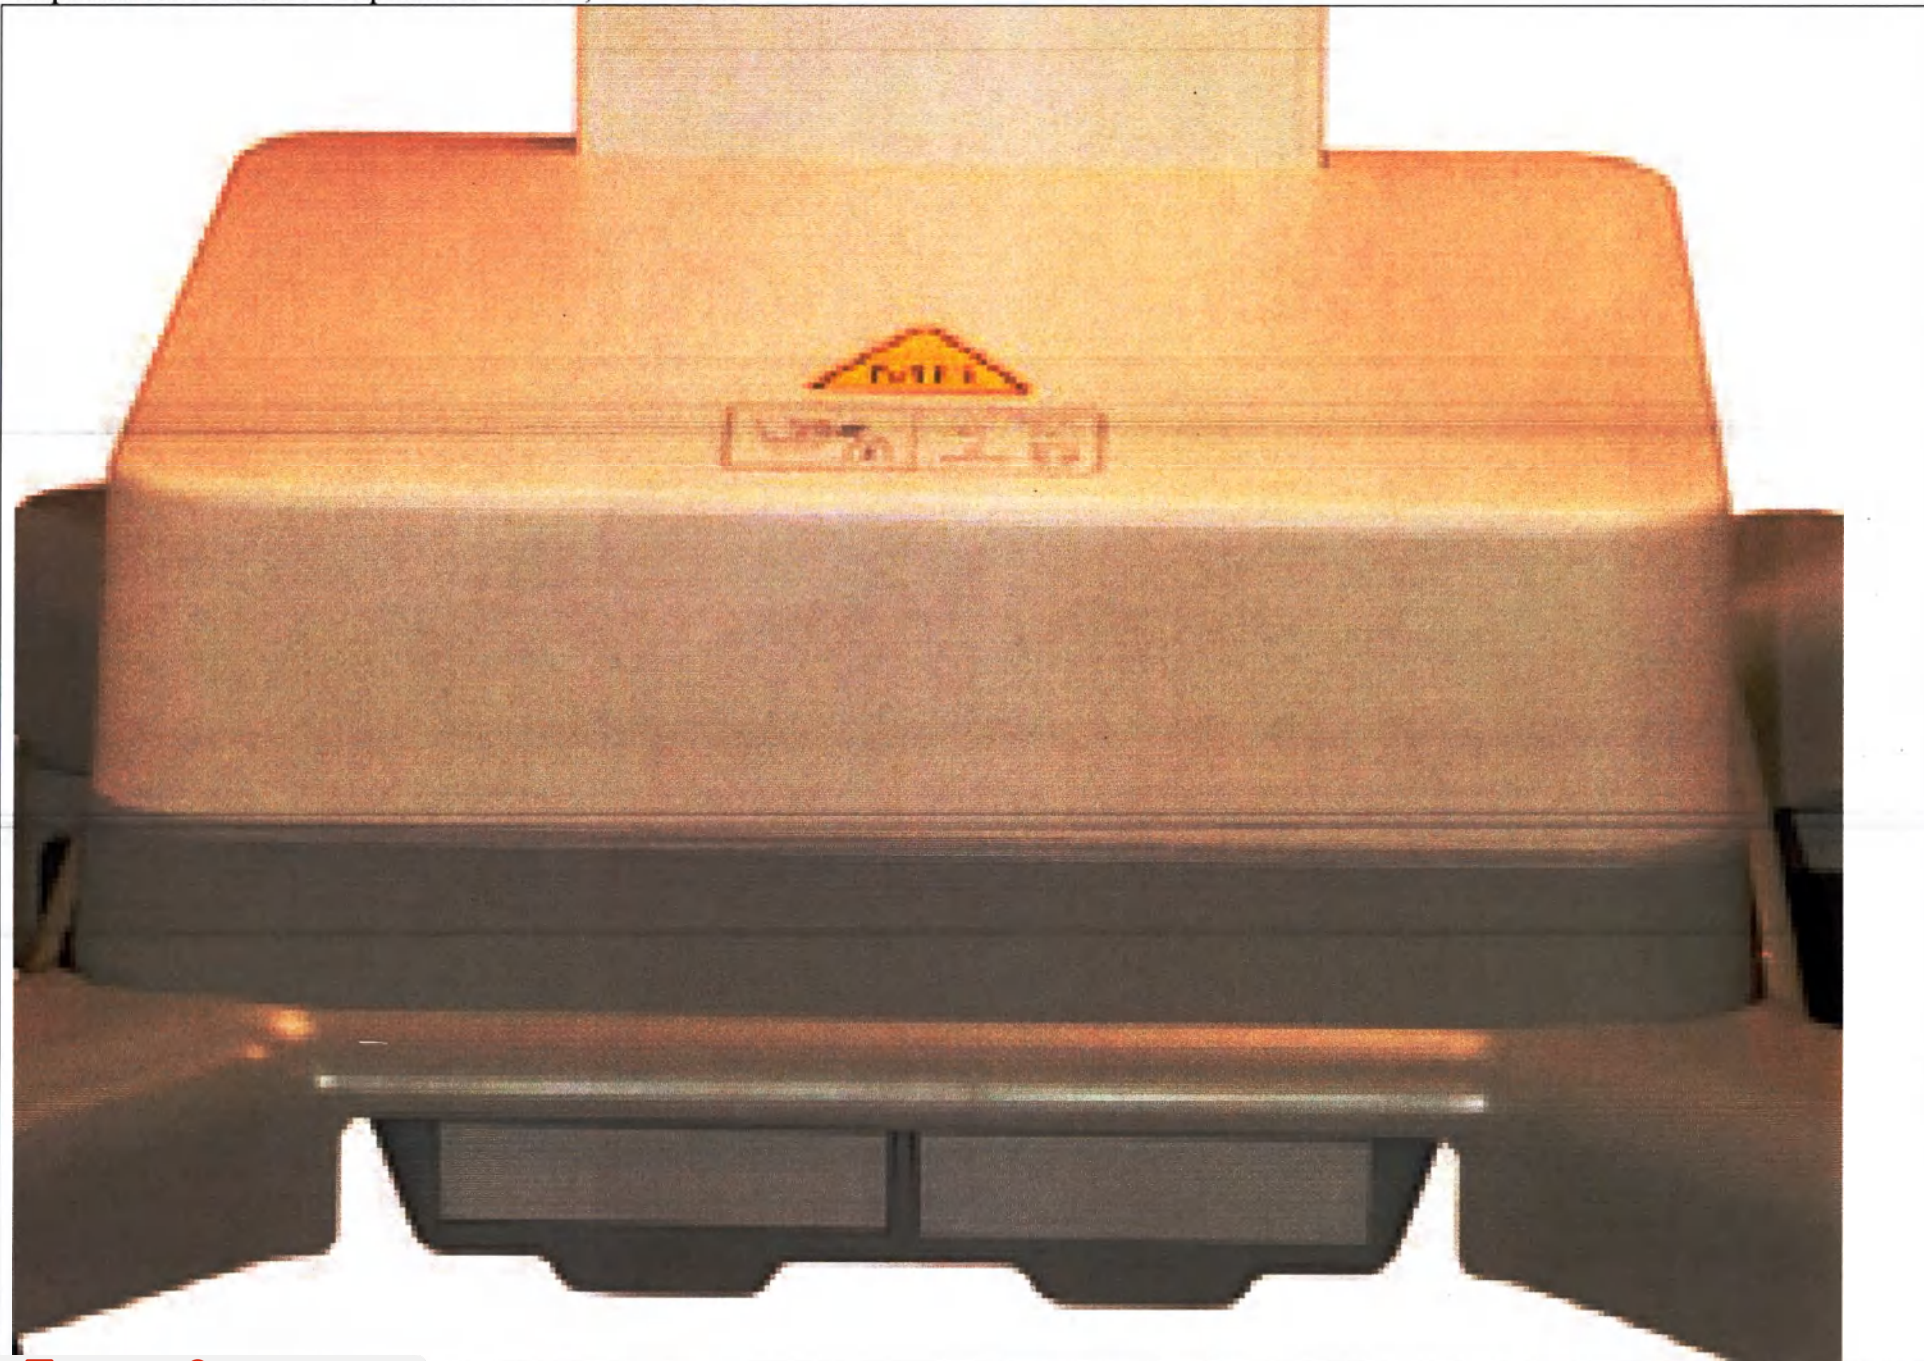


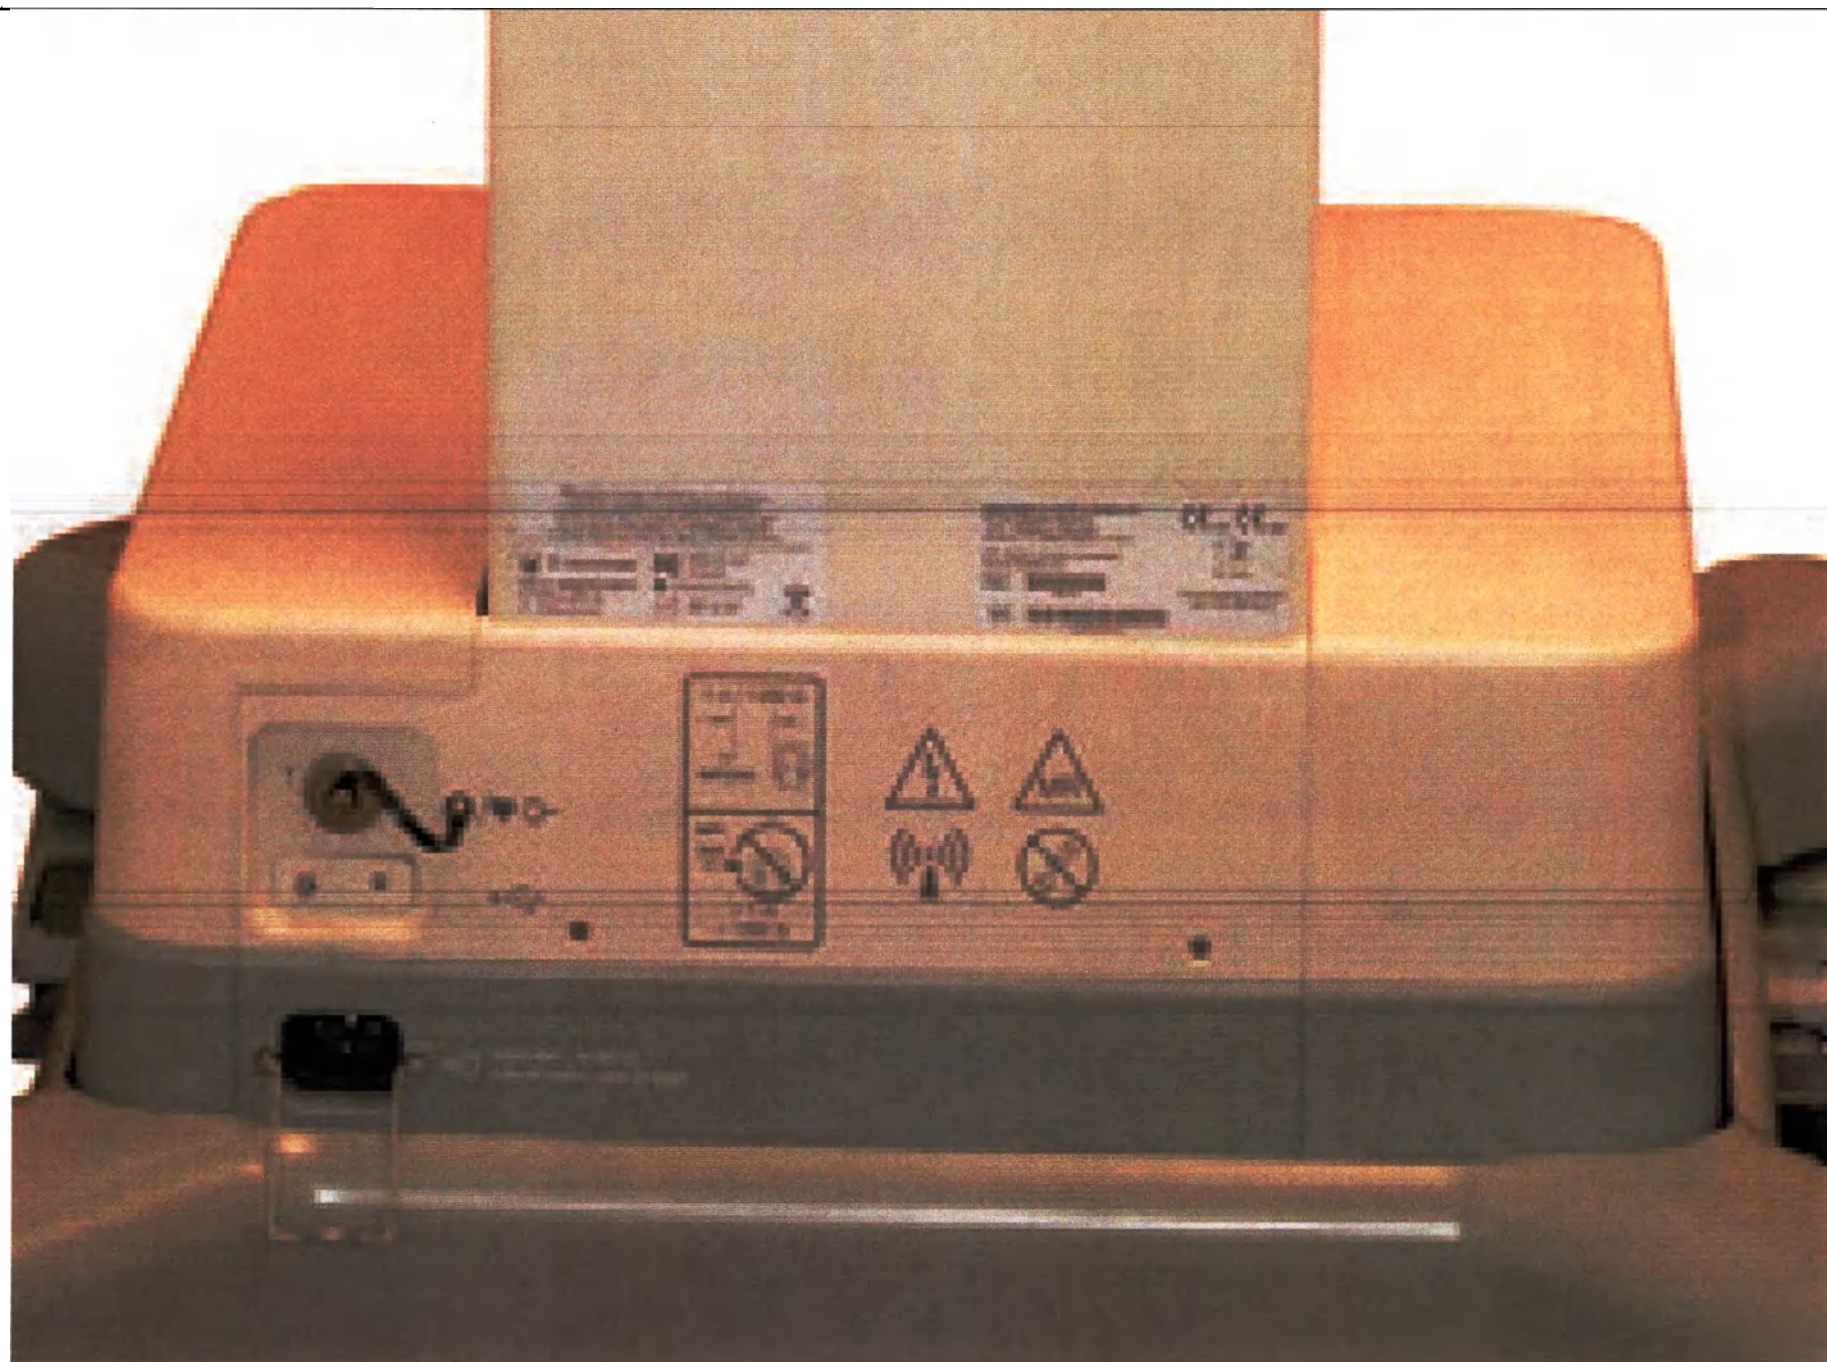


1.16 Блок аппарата базовый. Нижняя часть блока аппарата базового (вид сзади).

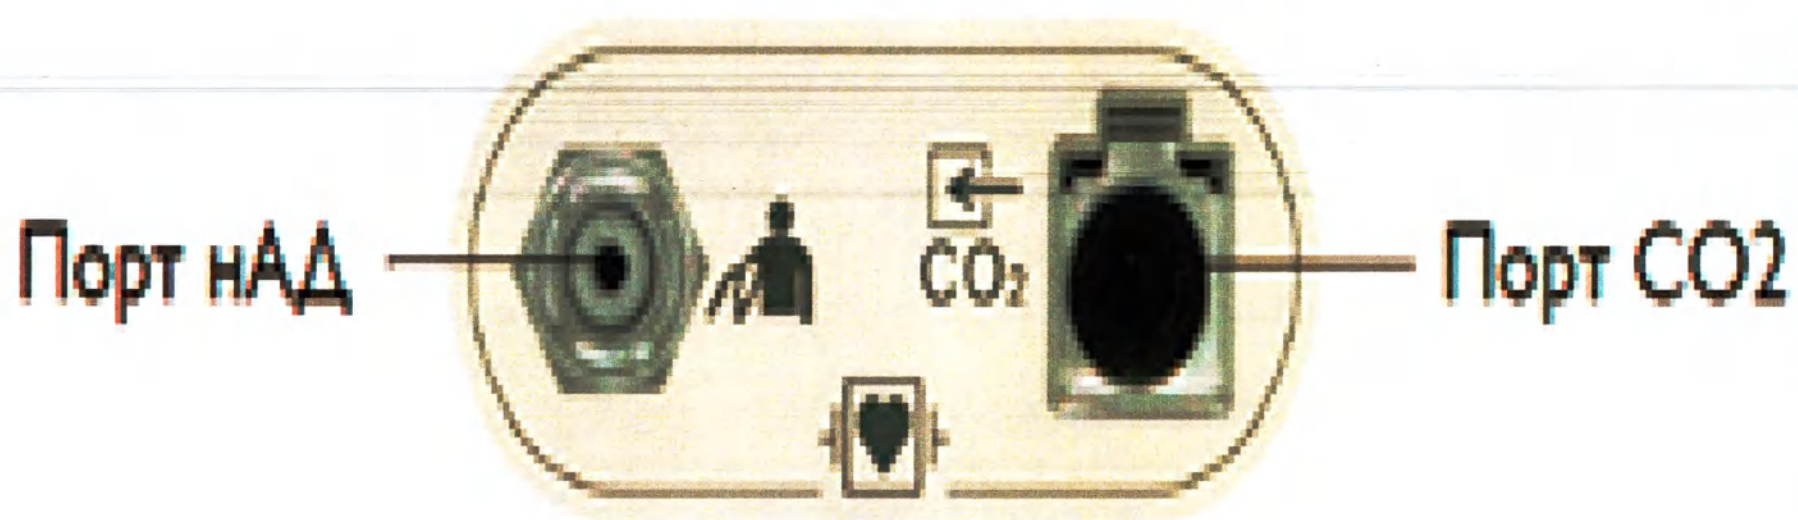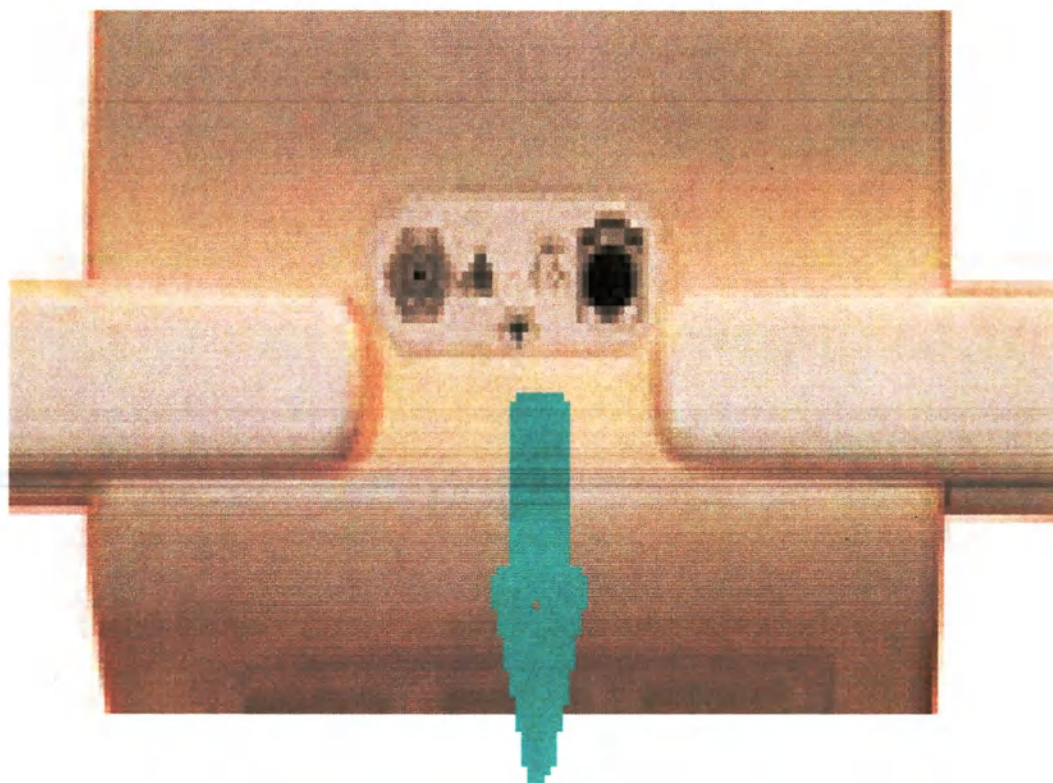

1.2. Блок управления подключением пациента .

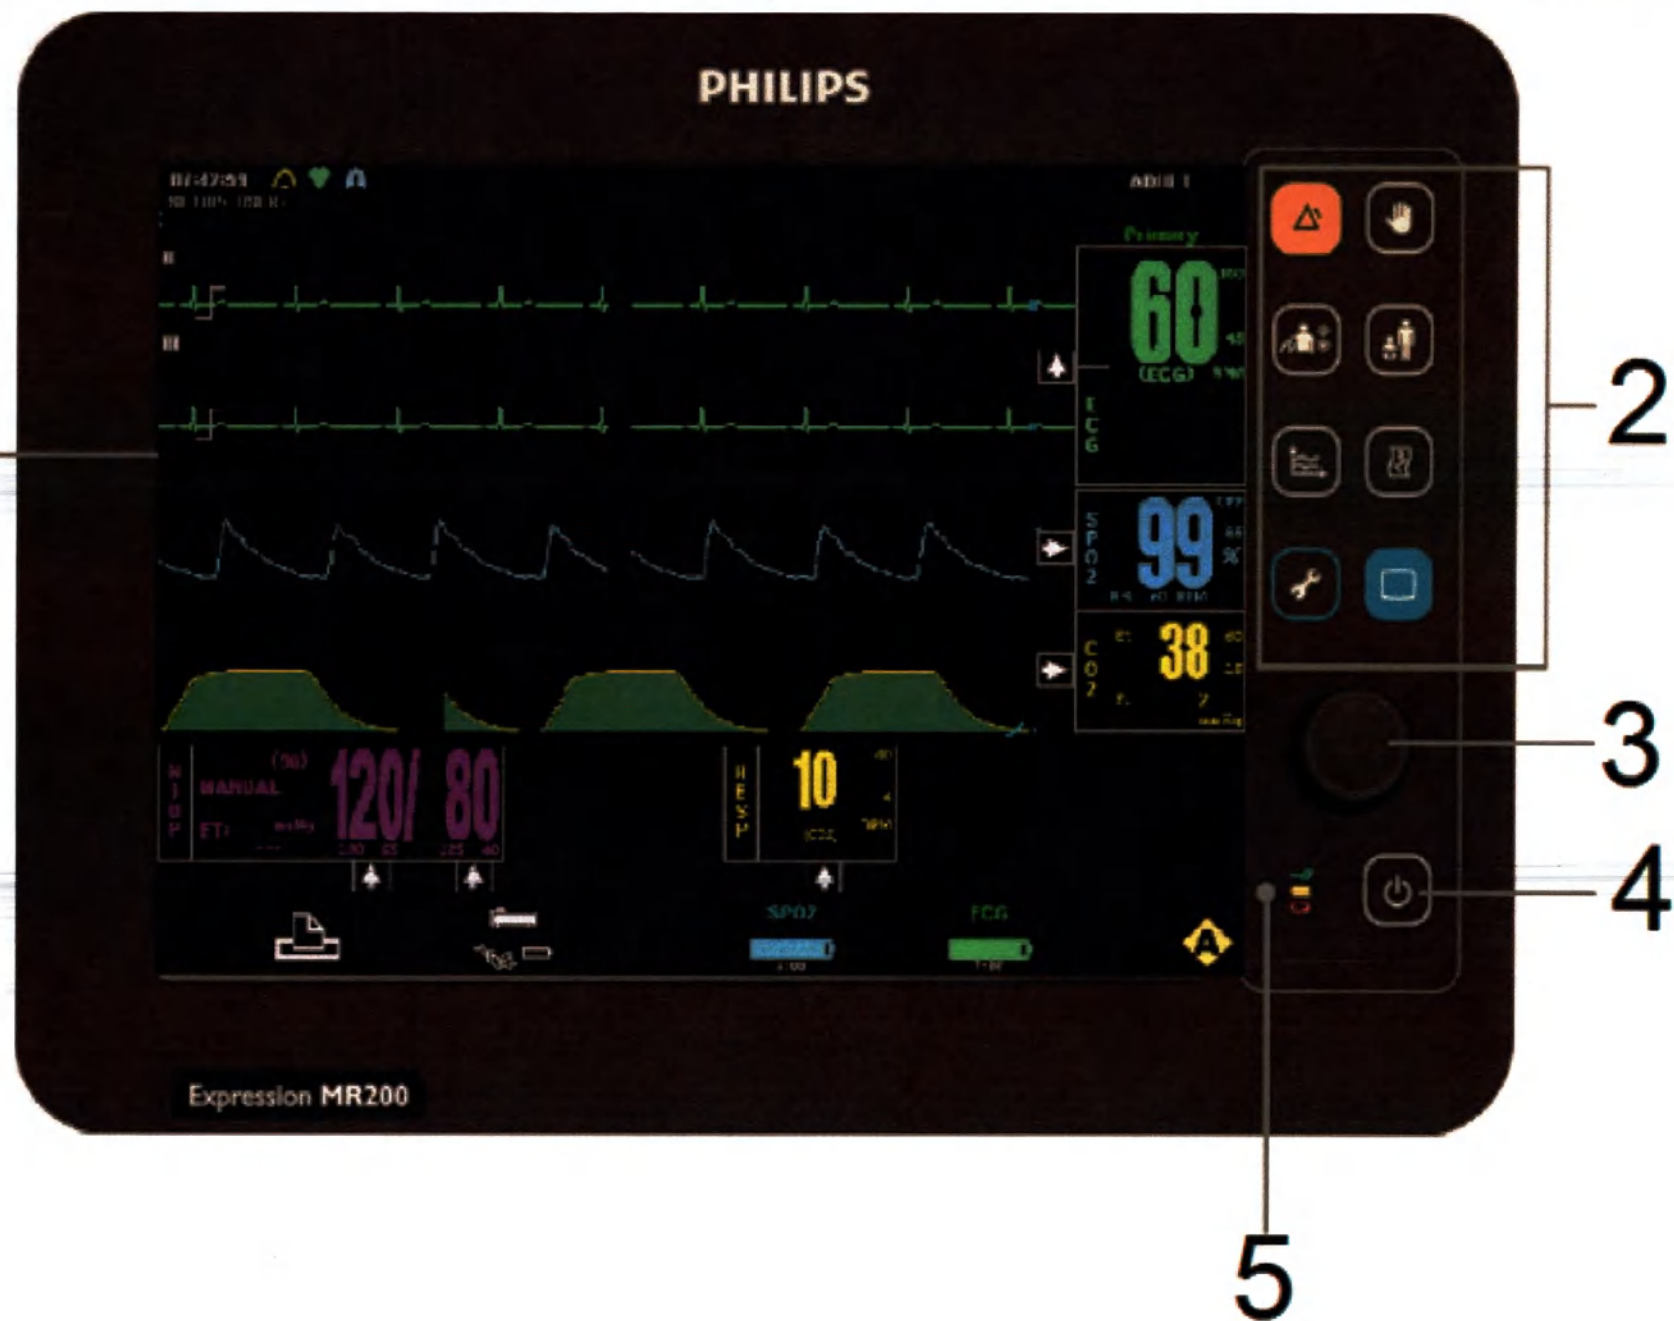


1.3.а. Дисплей (вид спереди).

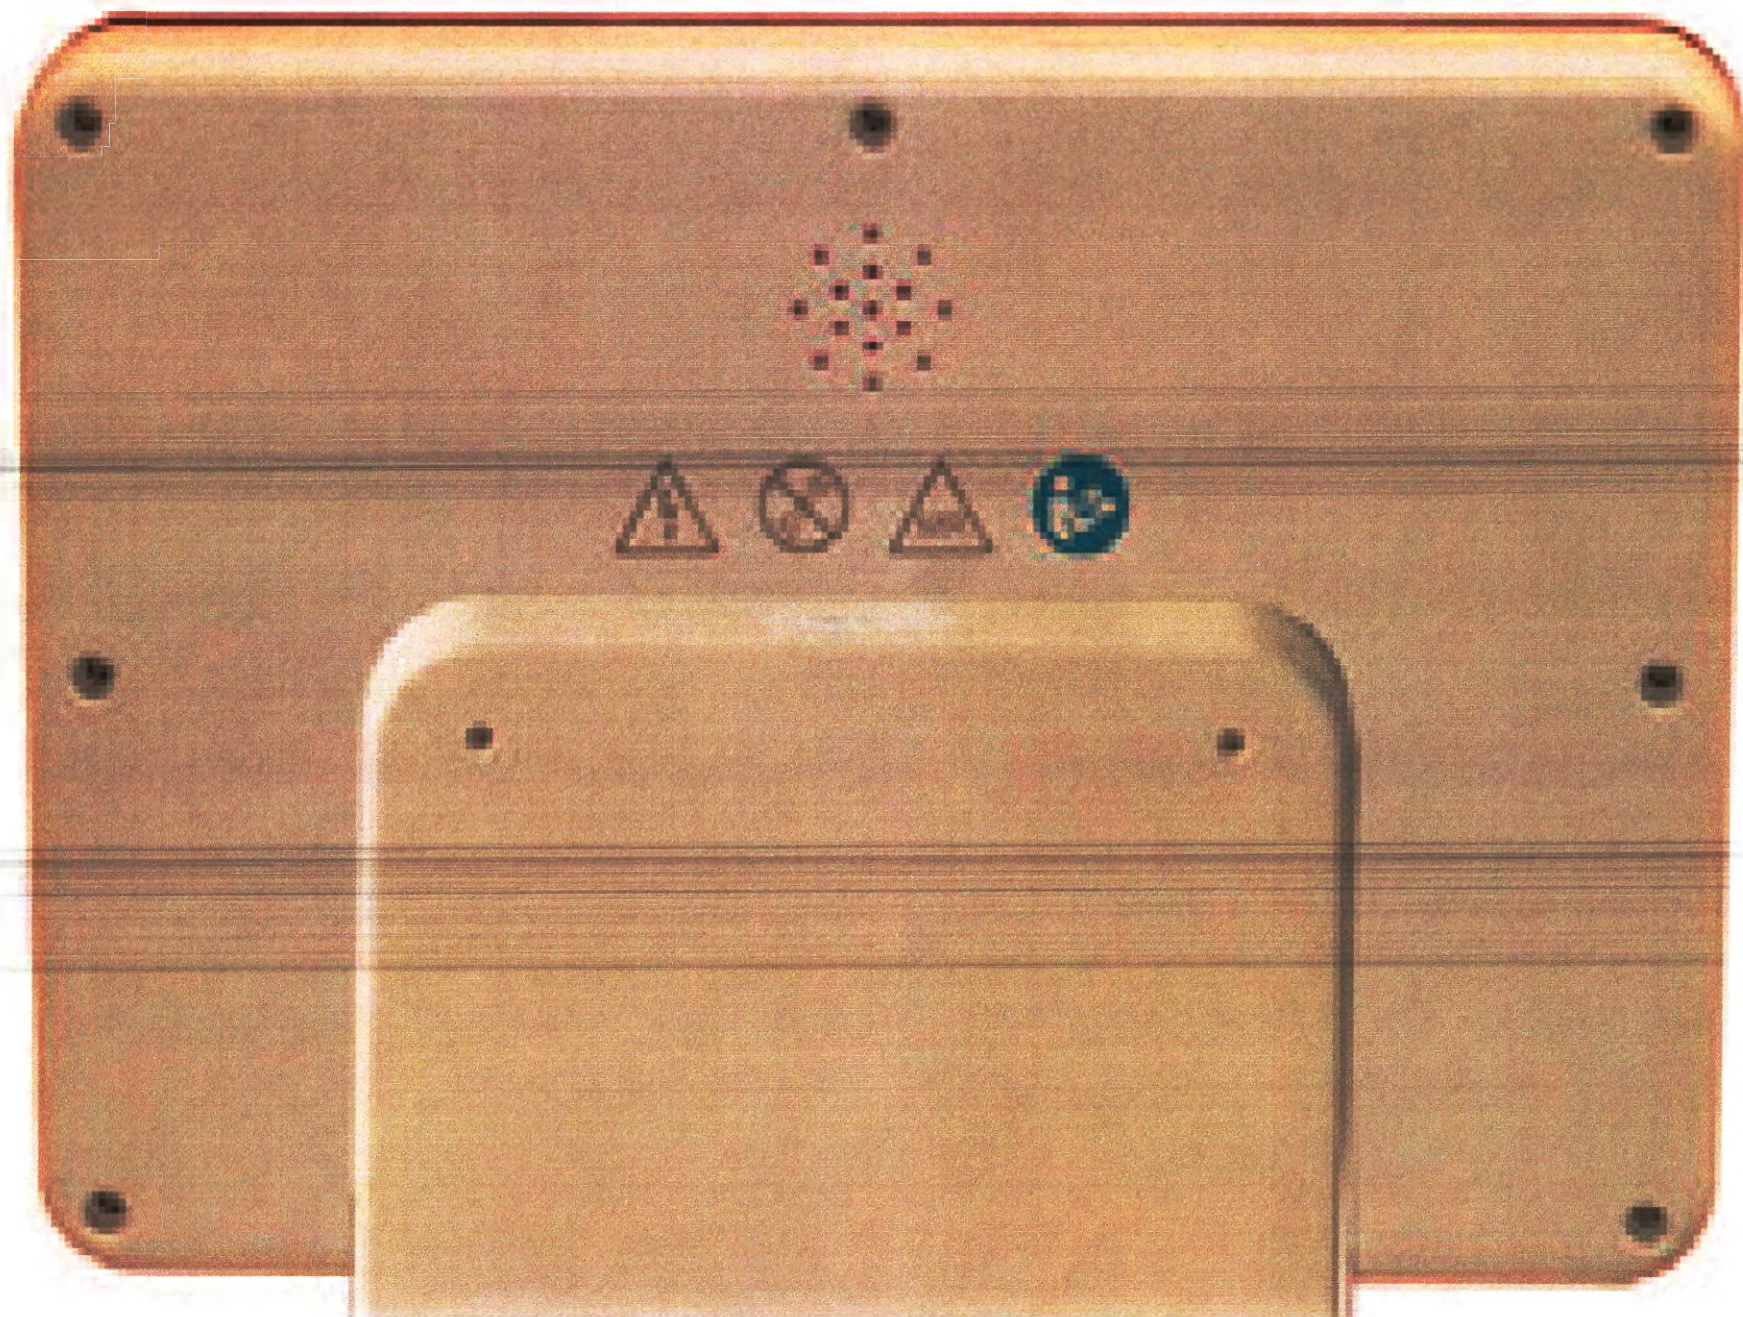


1.3.6. Лисплей (вид сзади).

Варианты исполнения: Expression MR400, в составе:

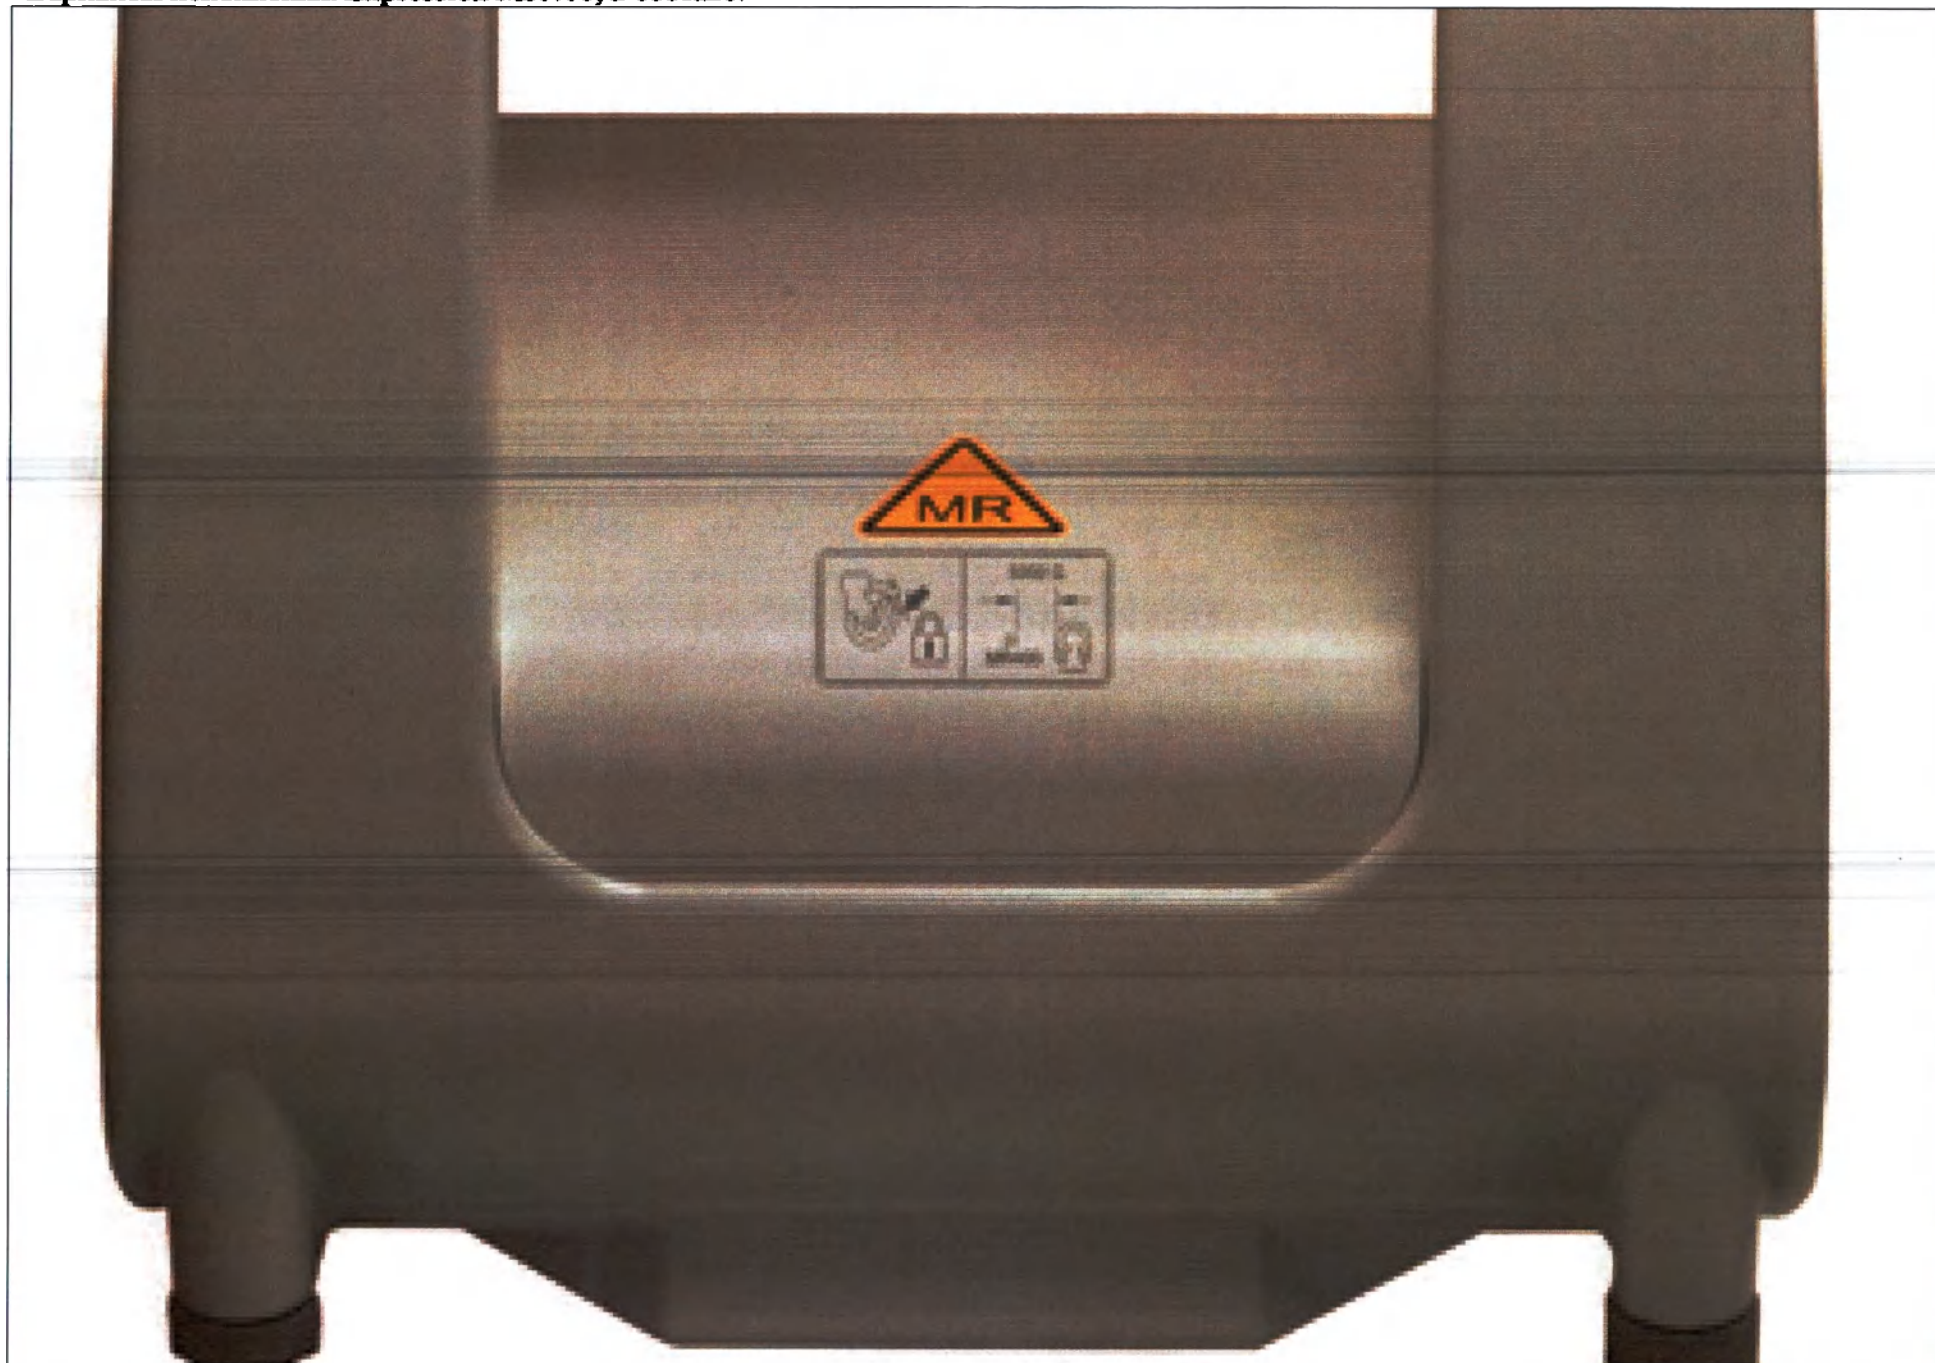





1.16 Блок аппарата базовый. Нижняя часть блока аппарата базового (вид сзади).

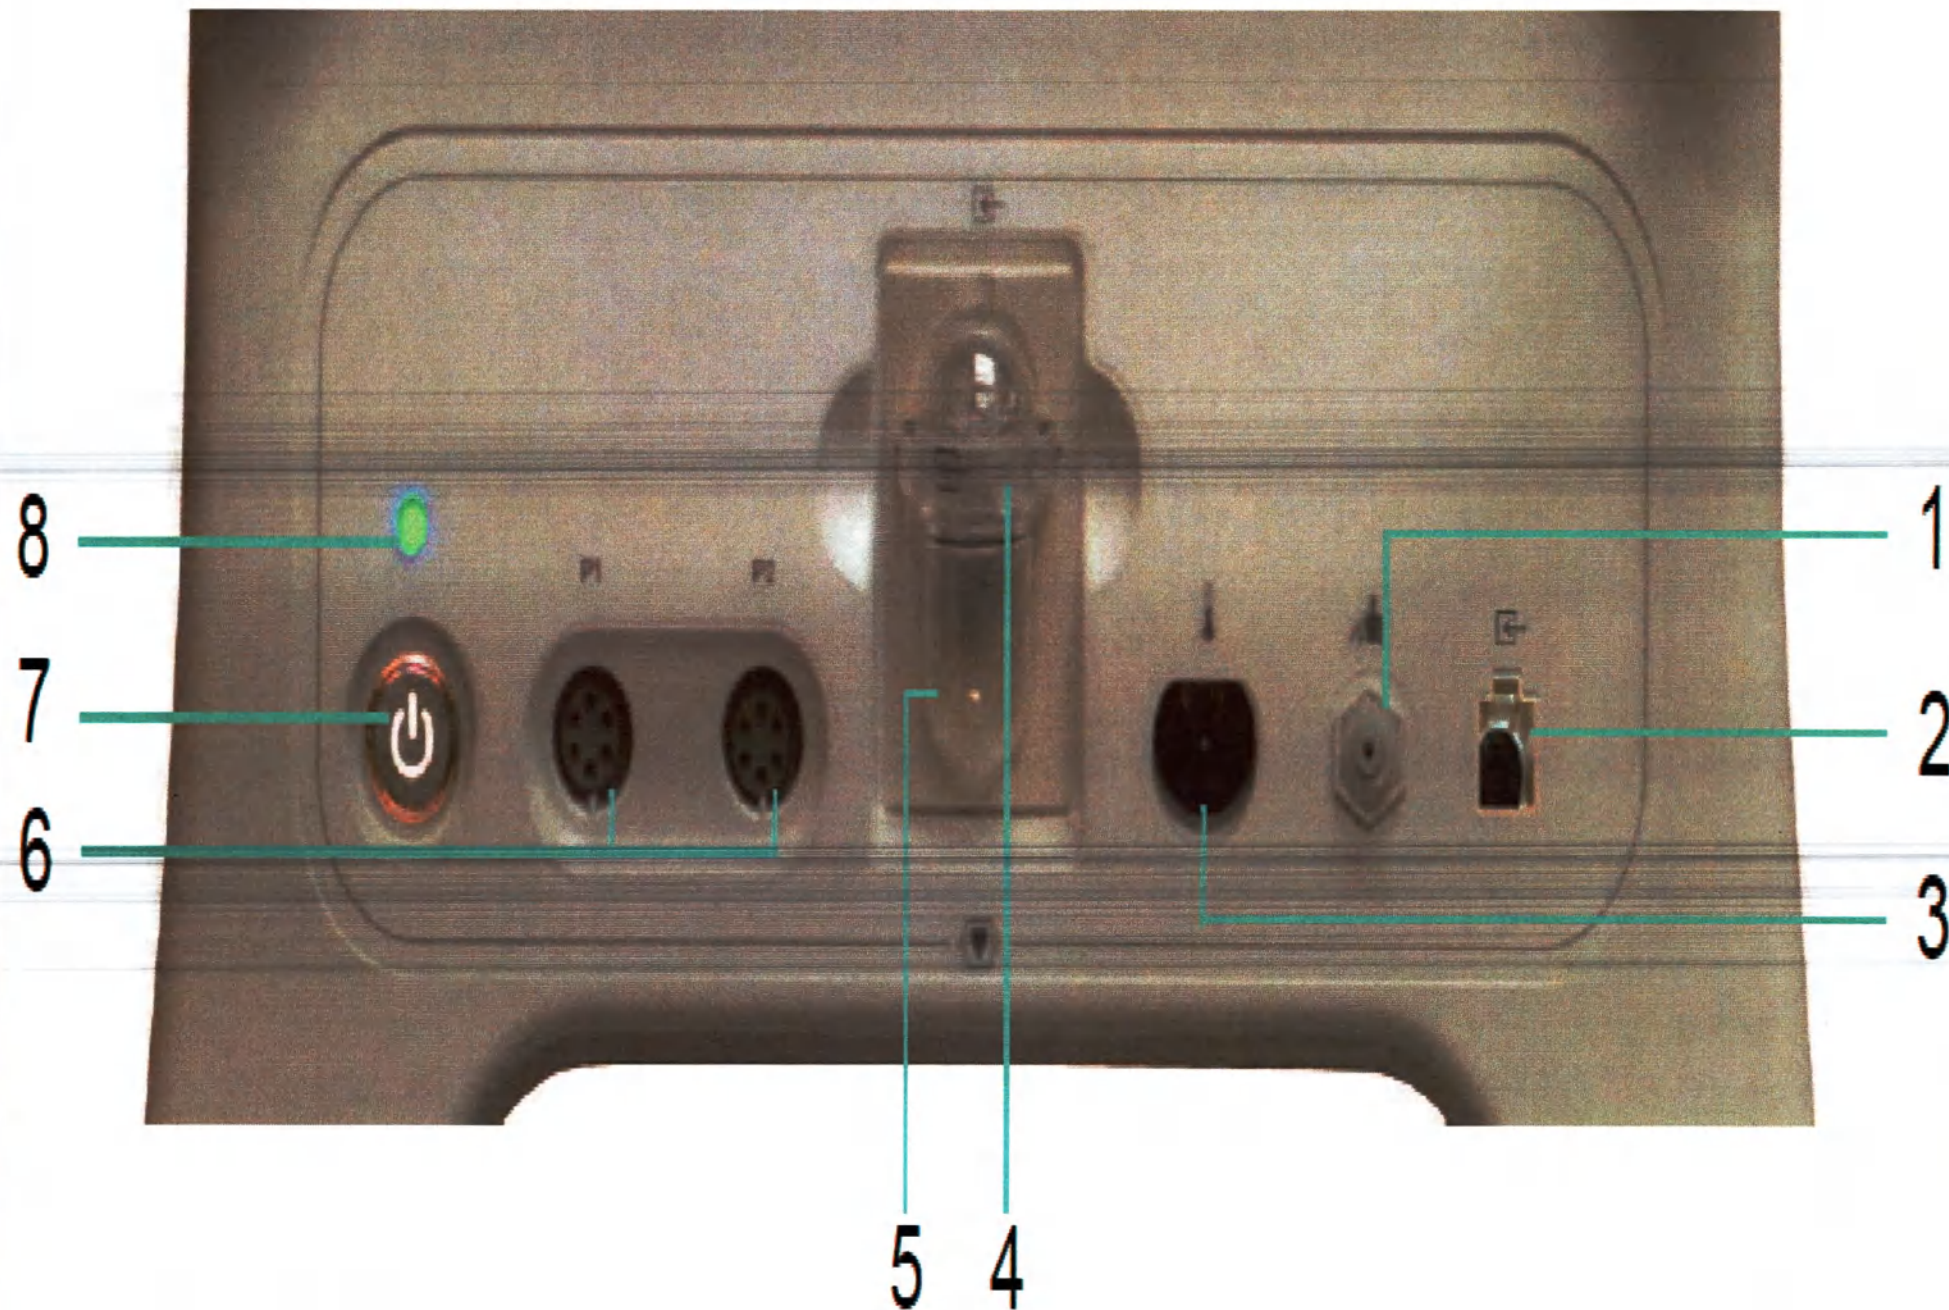

1.2 Блок управления подвешиванием пациента.

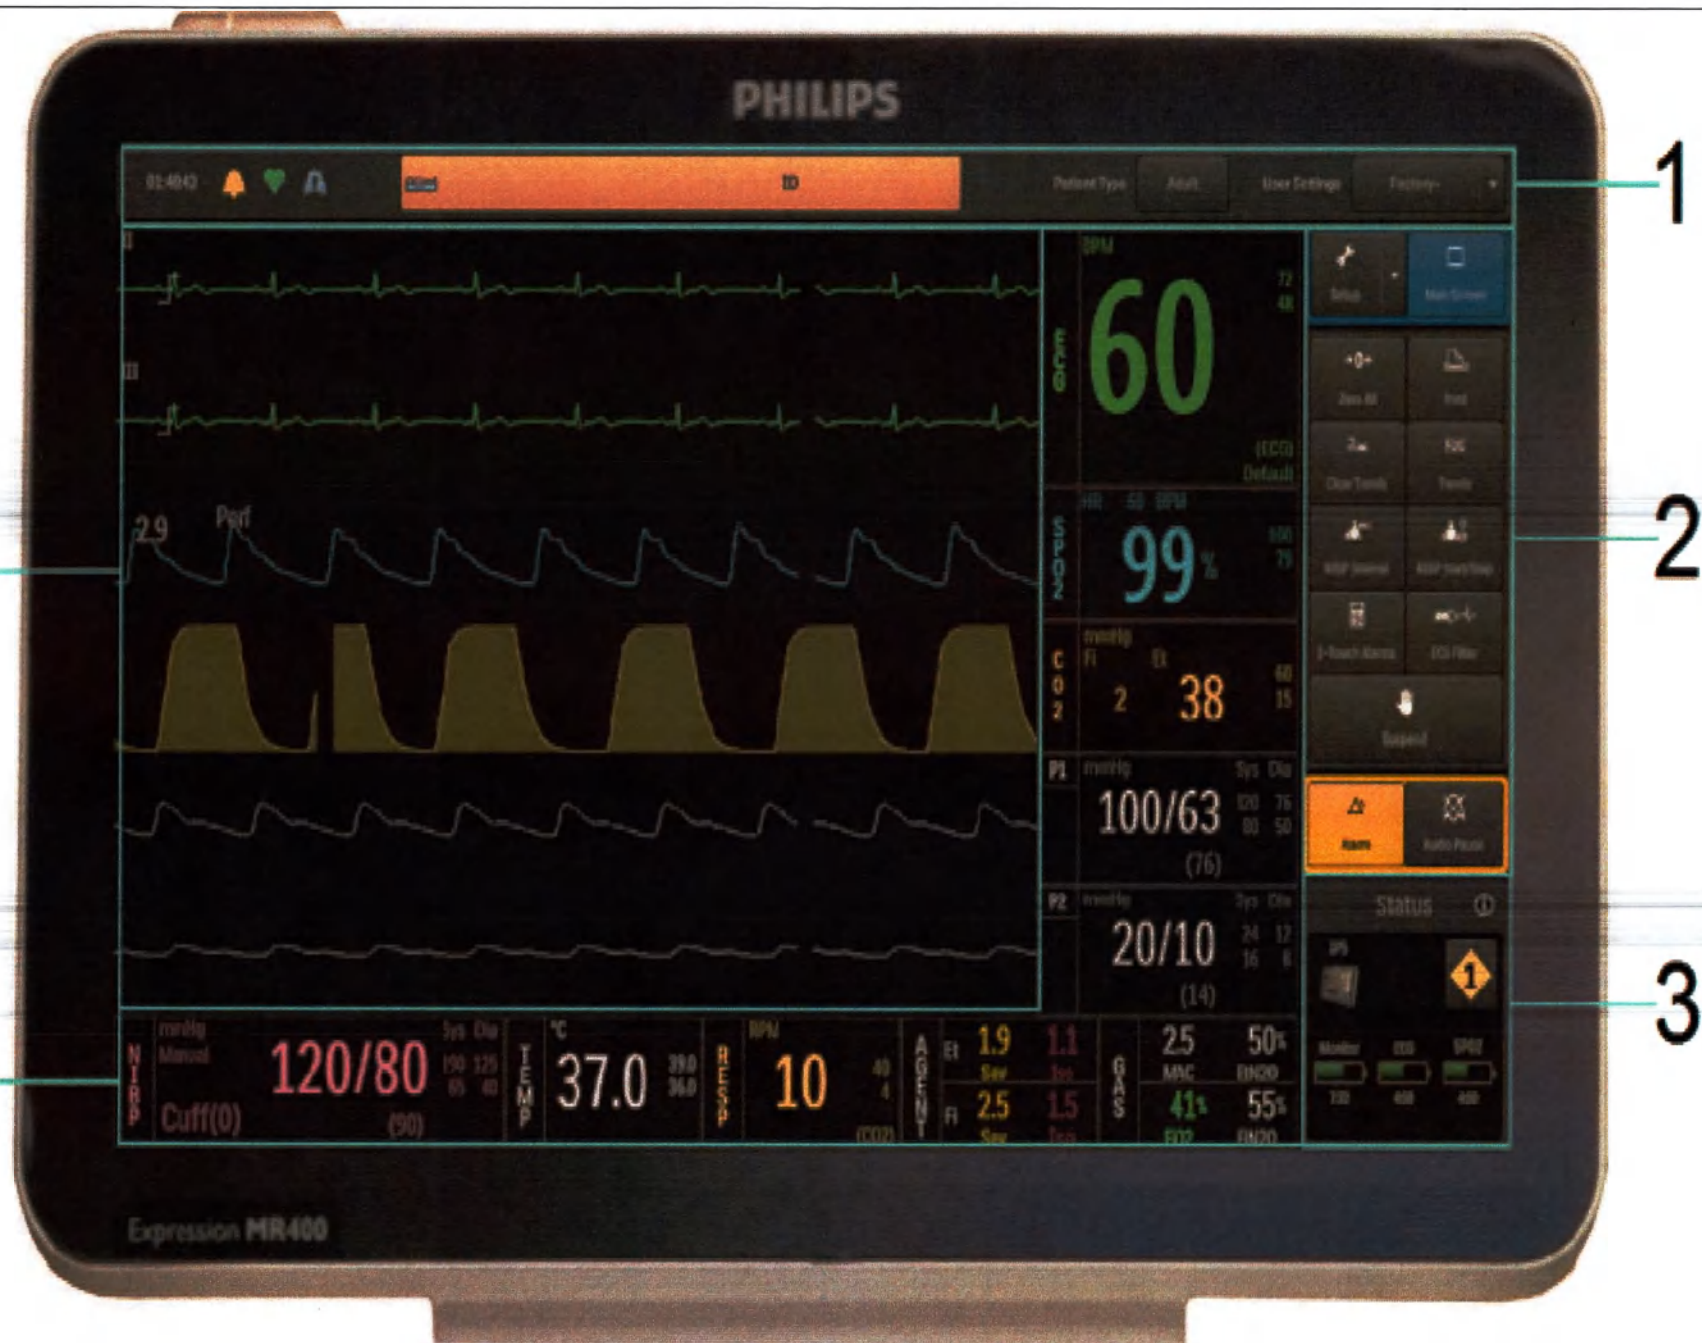


1.3.a. Дисплей (вид спереди).

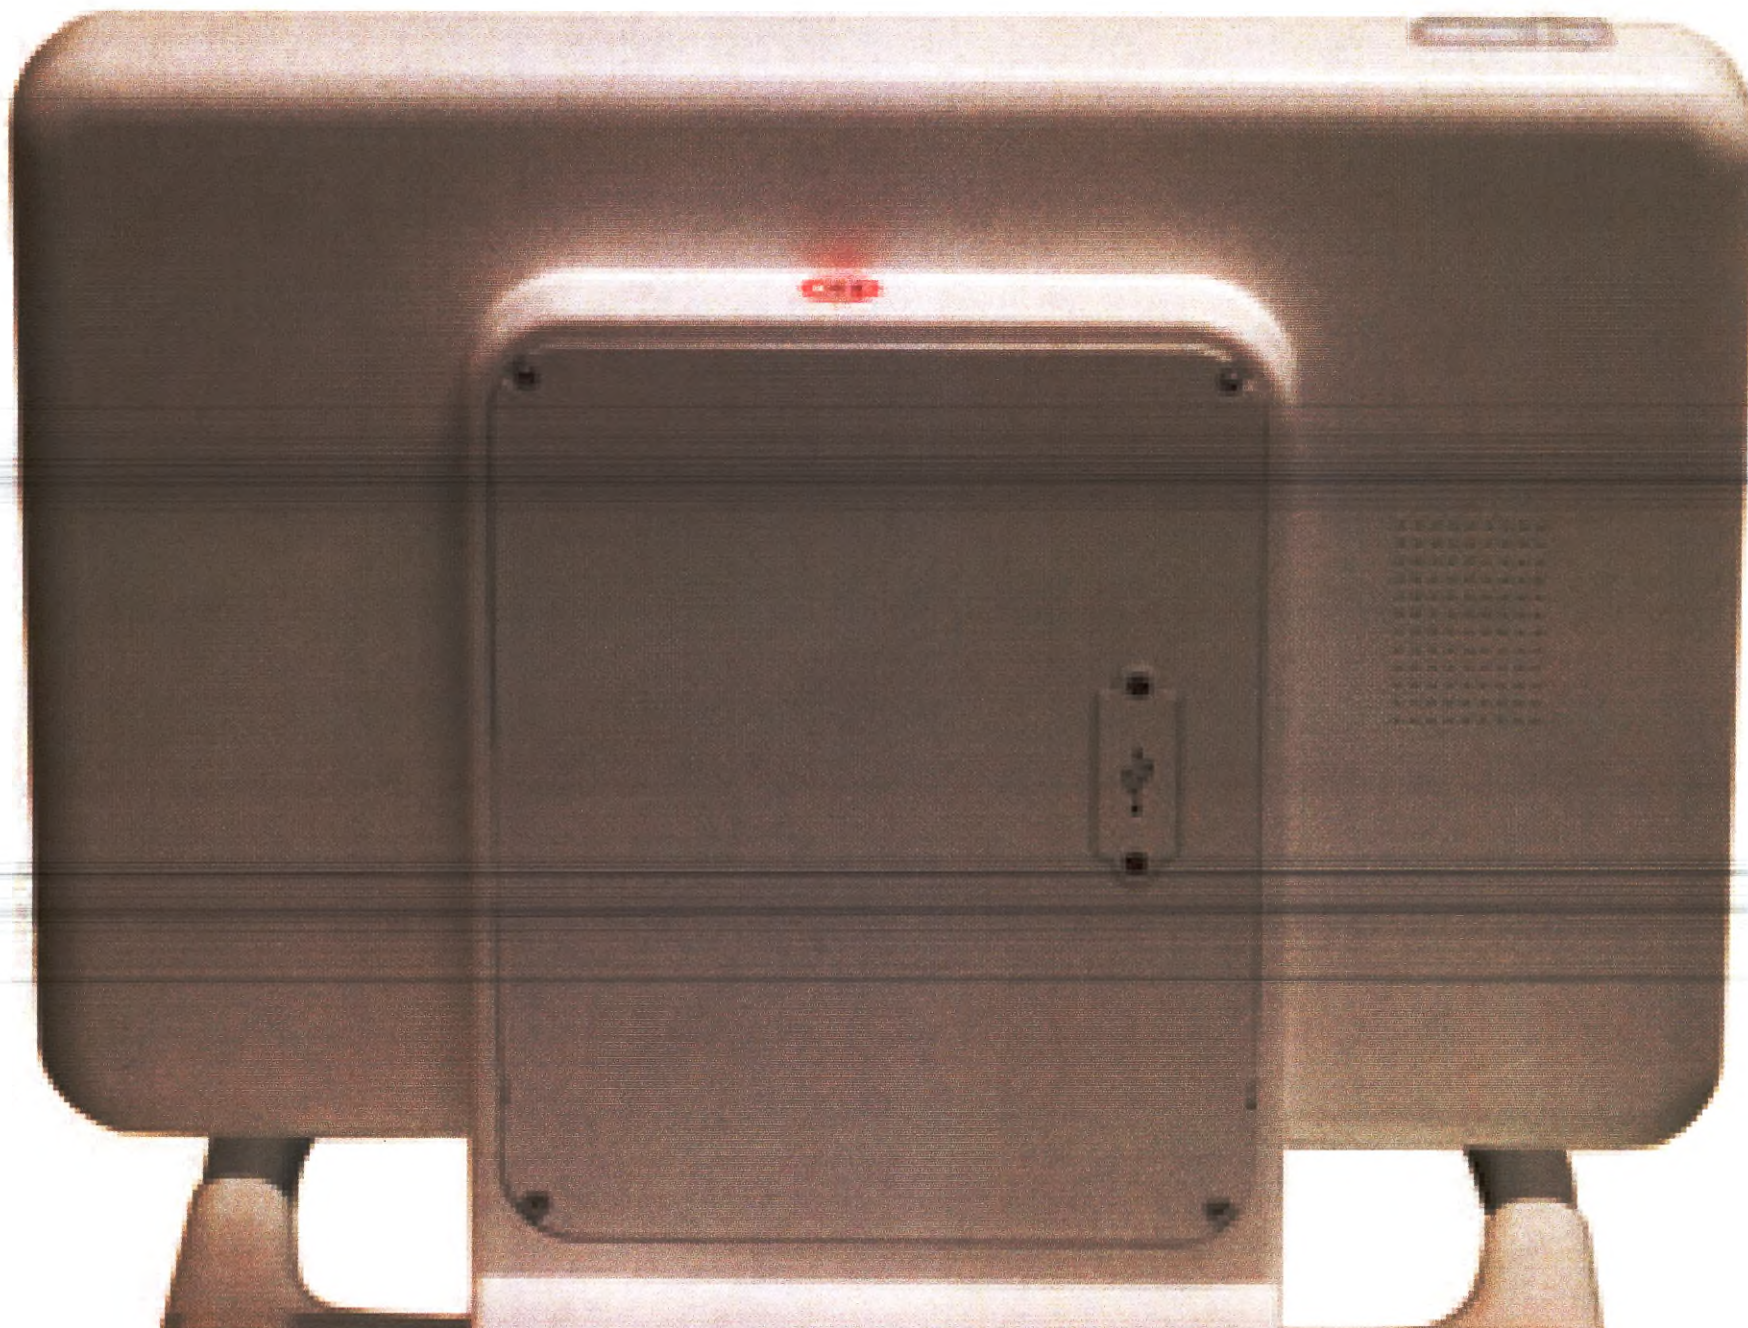

1.3.6. Лисплей (вид сзади).

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

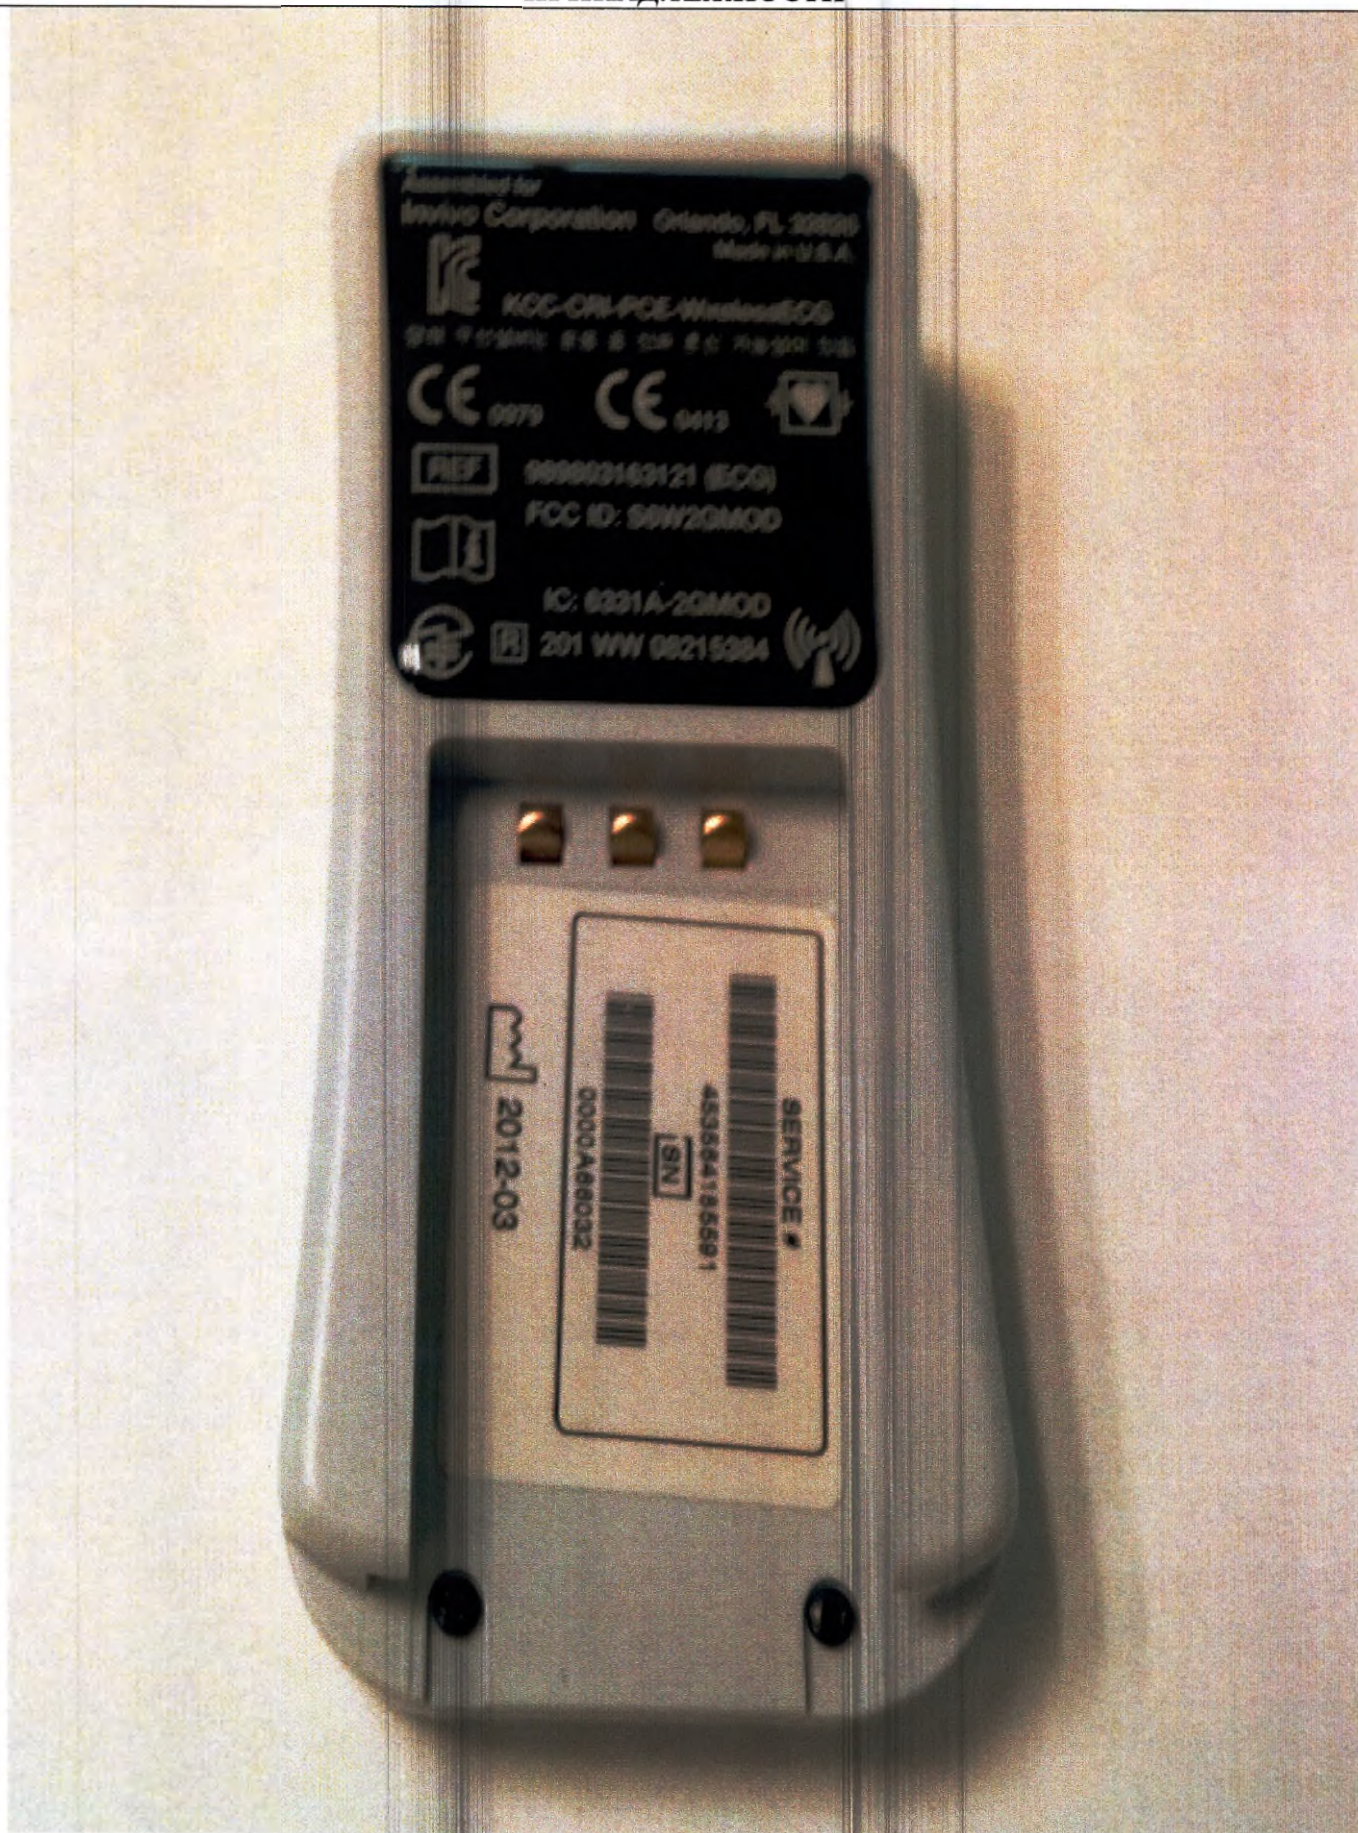

1а. Беспроводной модуль ЭКГ.



1.6. Беспроводной модуль ЭКГ.



1.в. Беспроводной модуль ЭКГ.

Expression MR

Assembled for Invivo, a division
of Philips Medical Systems
12151 Research Parkway
Orlando, FL 32826, USA
Assembled in Singapore

SERVICE #



9098003193761

REF



9098003193761

S/N



500E-01380



3518-04



IC-6331A-3GEOG
FCC ID: S6W3GEOG

CE 0978
0413



IP21



1.2. Беспроводной модуль ЭКГ.



2.а. Беспроводной модуль SpO2.



2012-03

0000A86117

SN

453664185681

SERVICE #


2.б. Беспроводной модуль SpO2.



2.в. Беспроводной модуль SpO2.



2.2. Беспроводной модуль SpO2.

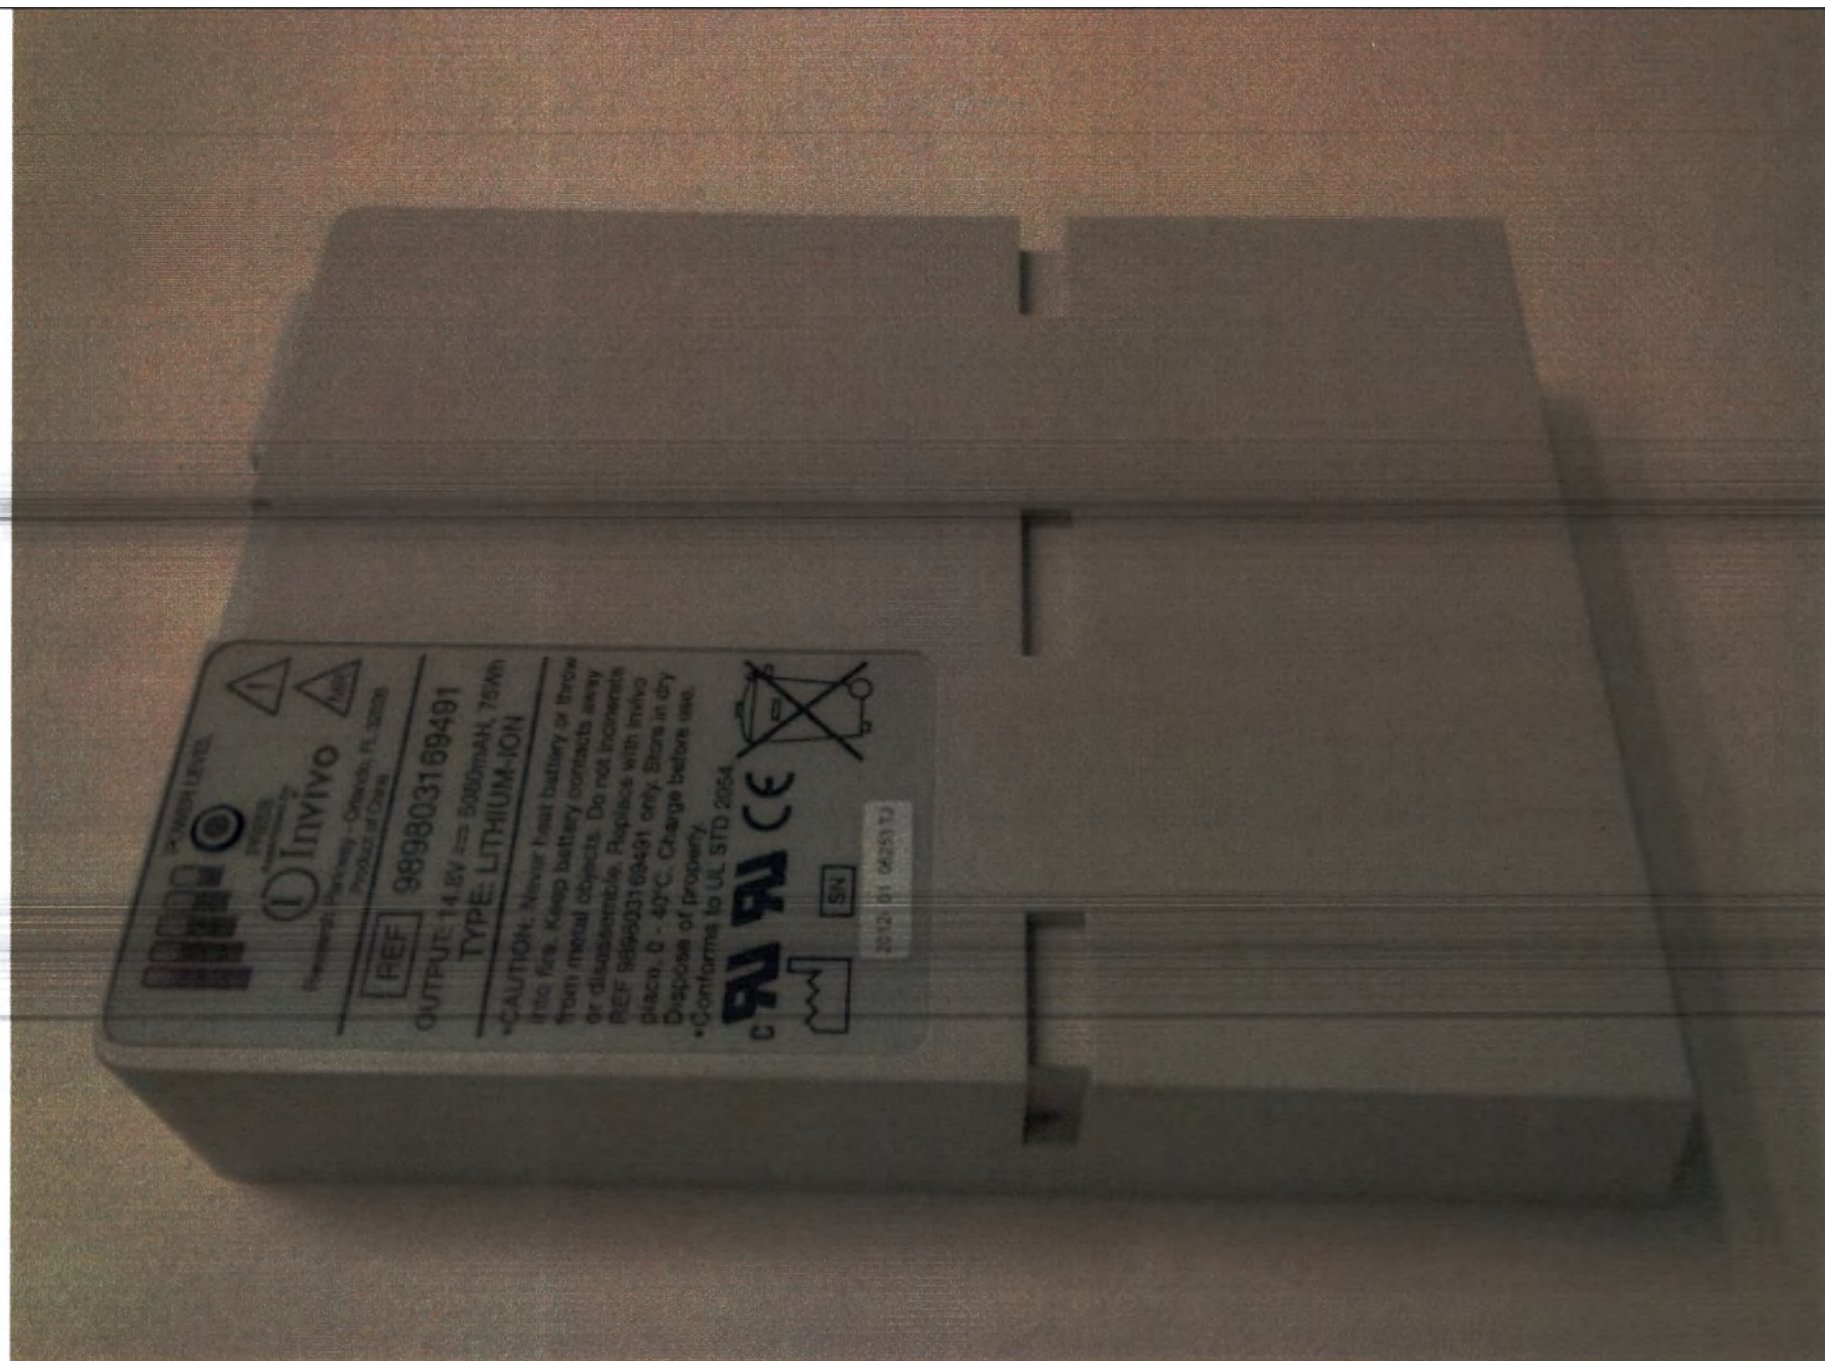

3.а. Батареи аккумуляторные (от 1 до 10 штук).



Invivo

Assembled for
12151 Research Parkway
Orlando, FL 32826 USA

UL US
NOM 48334

3.7V Rechargeable Li-Polymer

REF 9065

CAUTION:

DO NOT DISASSEMBLE

DO NOT PUT IN FIRE OR SHORT CIRCUIT

DISPOSE OF PROPERLY

DO NOT EXPOSE TO HIGH TEMPERATURES ABOVE 140° F/60° C

ONLY USE SPECIFIED MANUFACTURER'S CHARGER



Date: 3014

SN M-149538

1ICP5/35/61

Watt-hour rating 3.1Wh

Made in USA








4.а. Зарядные устройства для аккумуляторов (от 1 до 10 штук).



4.6. Зарядные устройства для аккумуляторов (от 1 до 10 штук).

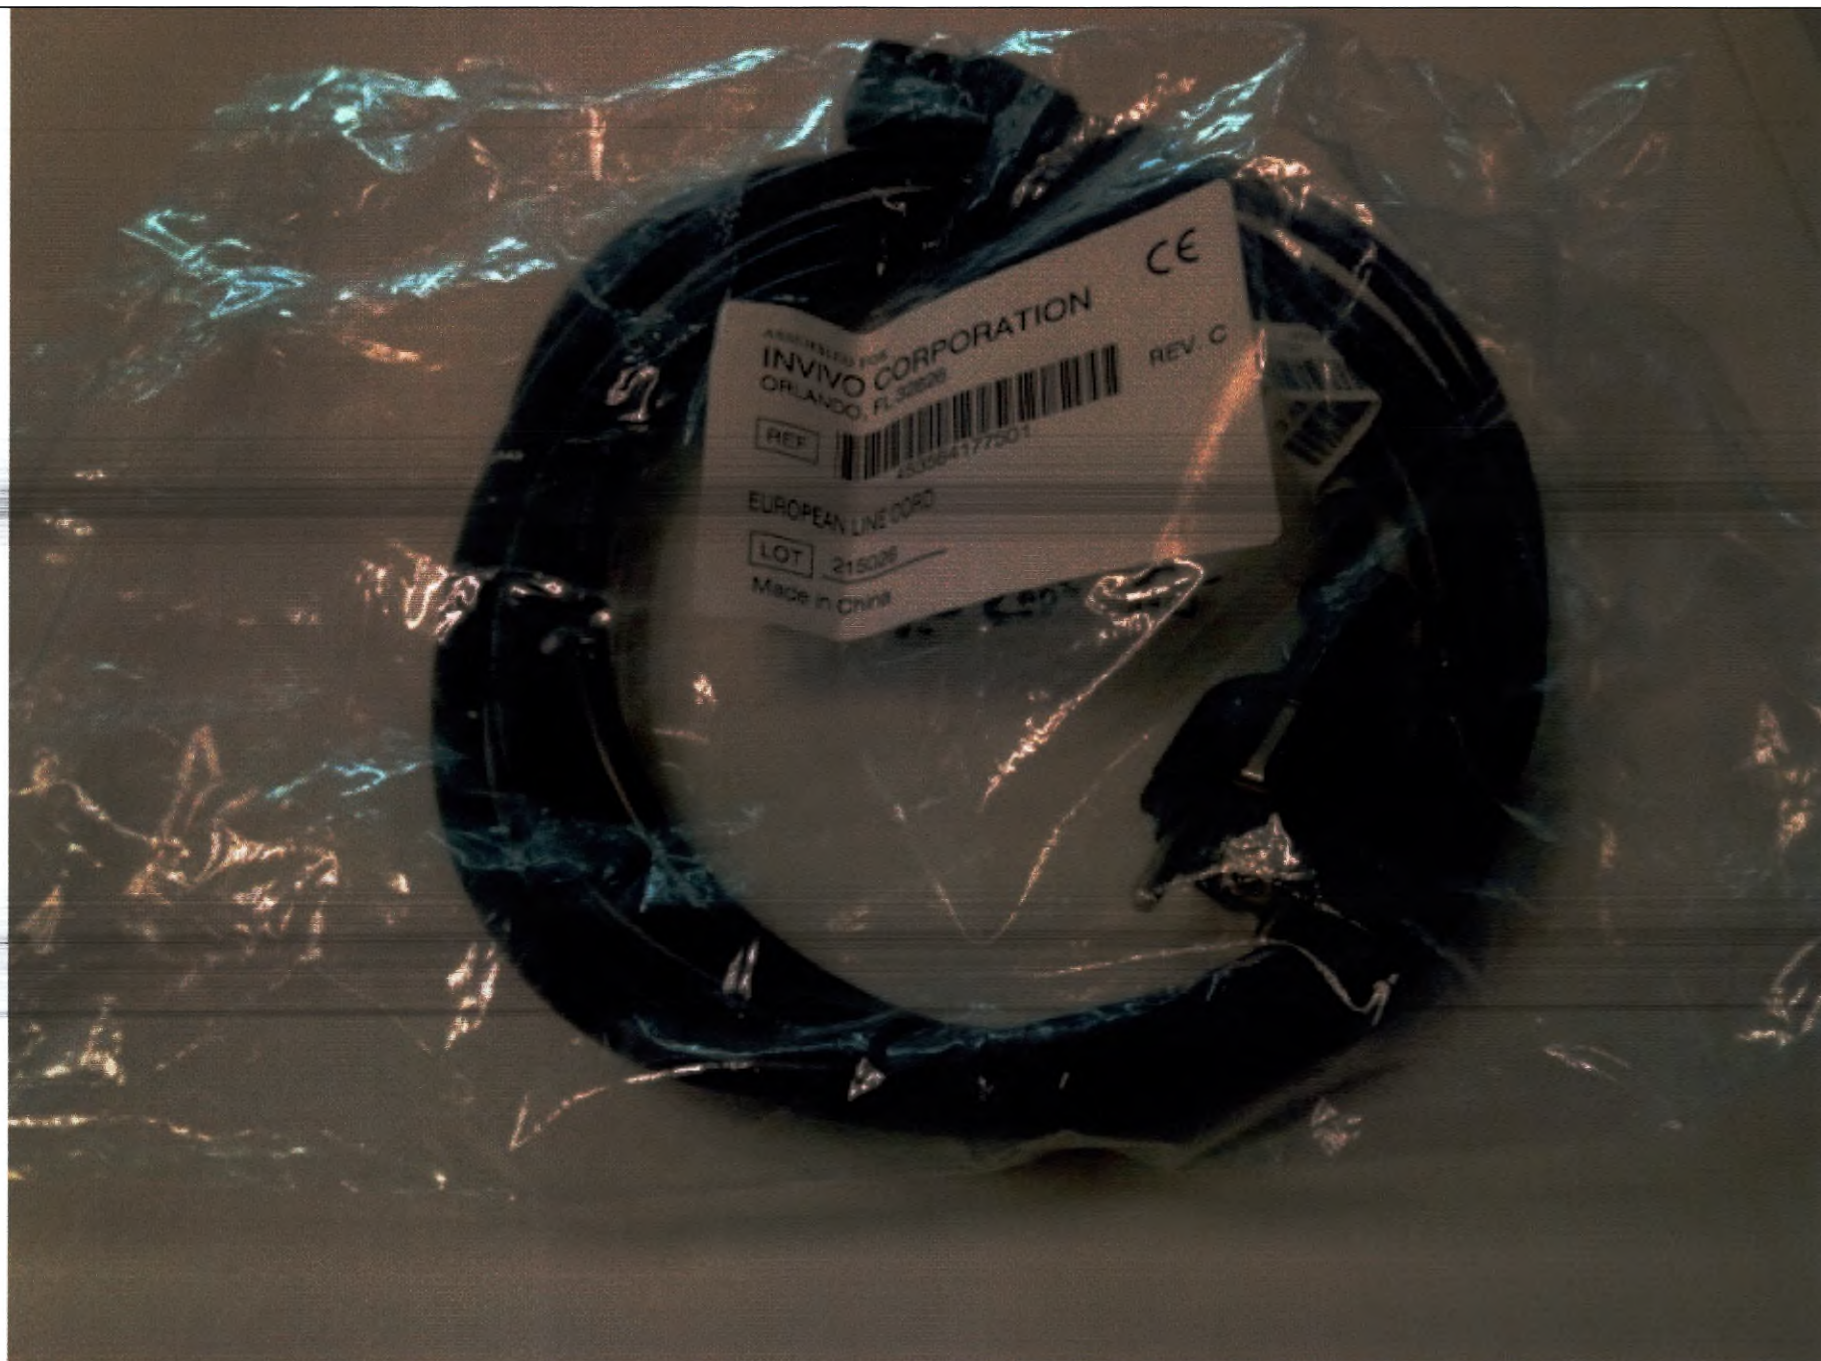

5.а. Кабели, шнуры питания (от 1 до 20 штук).



5.6. Кабели, шнуры питания (от 1 до 20 штук).




6.а. Клавиатура. мышь: клавиатура.




6.6. Клавиатура, мышь: мышь.




7. Принтер.

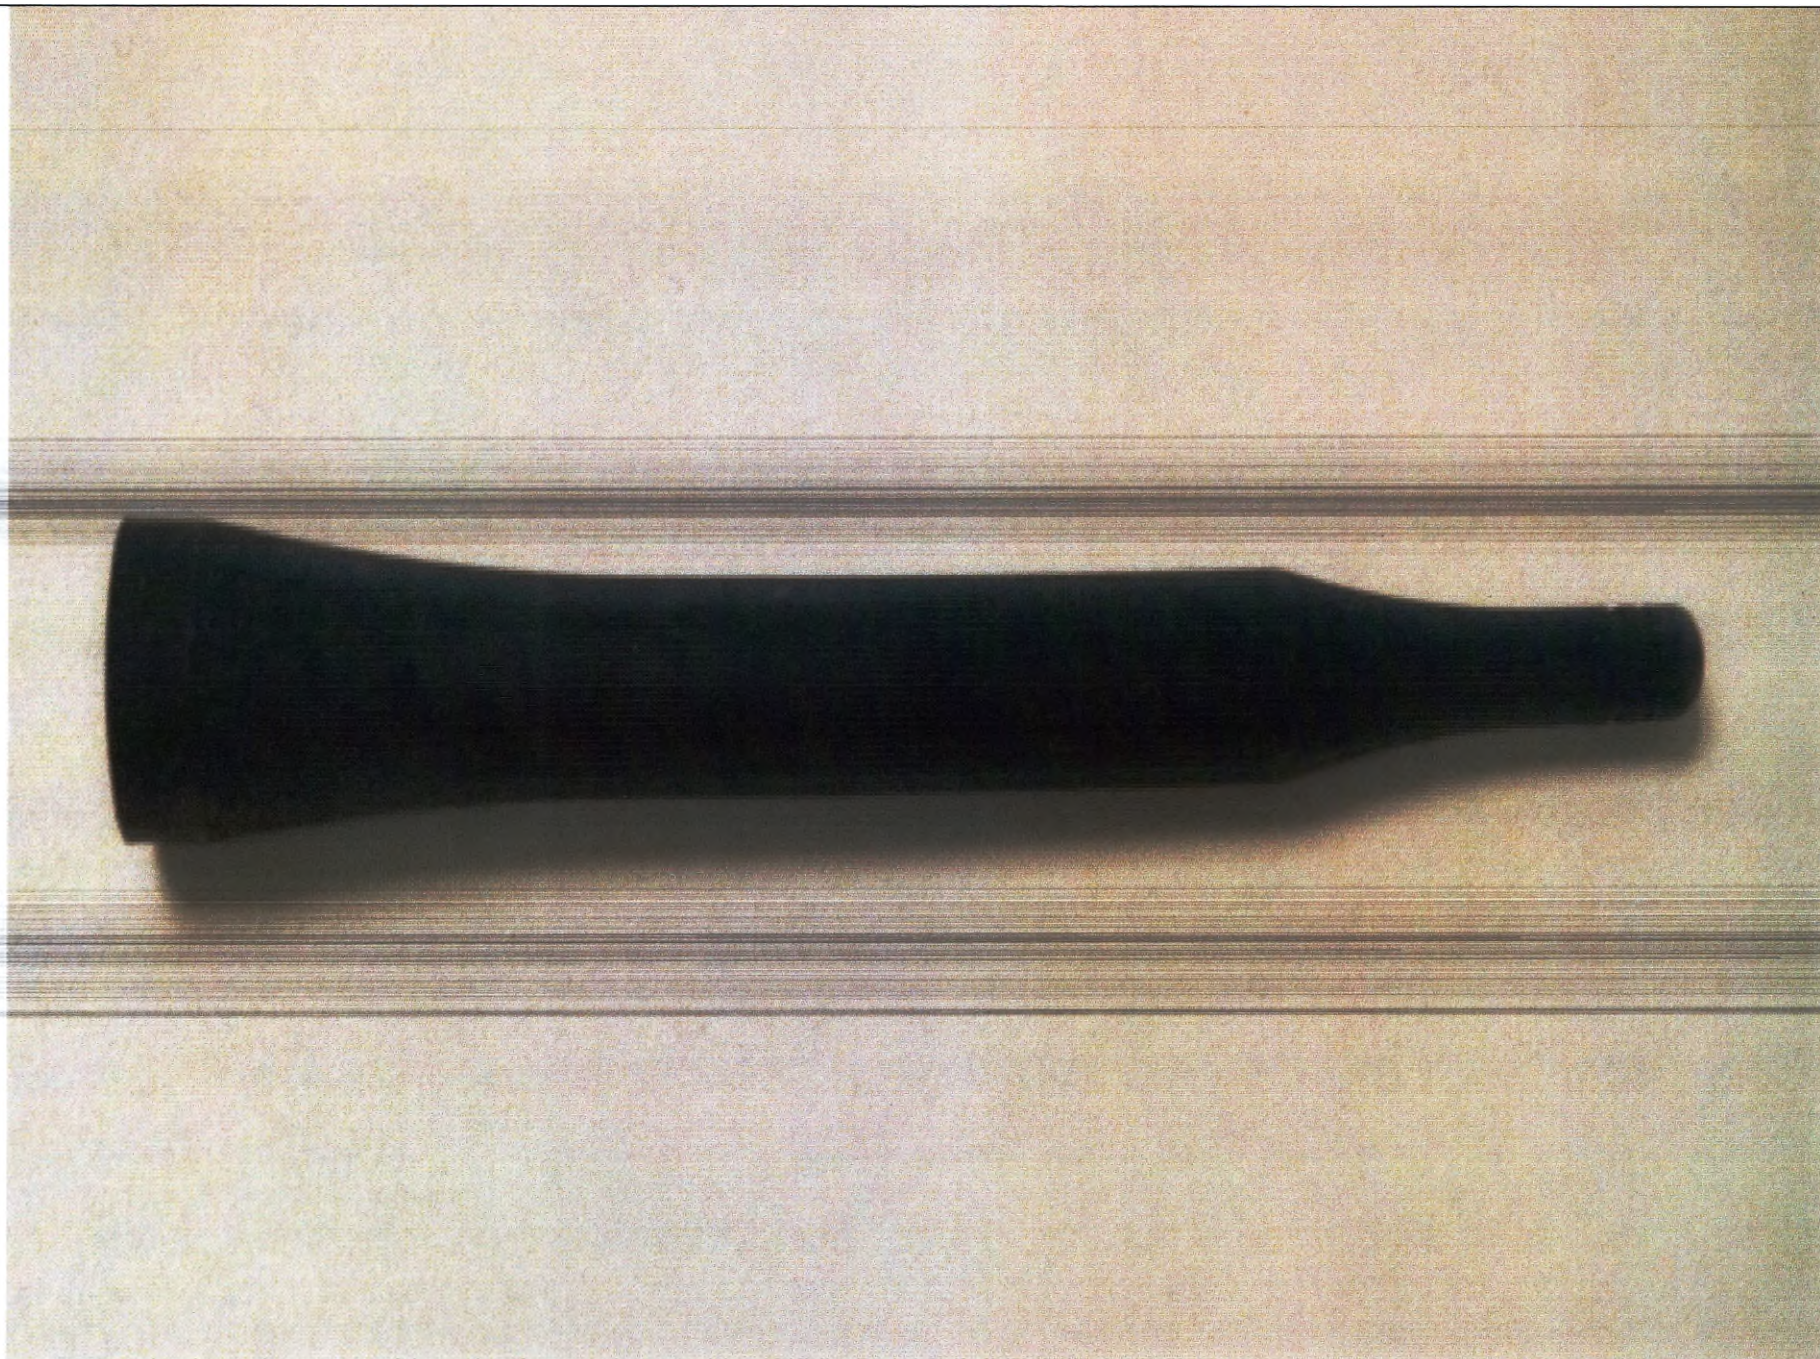


8.а. Устройства беспроводного мониторинга, антенны (от 1 до 50 штук).

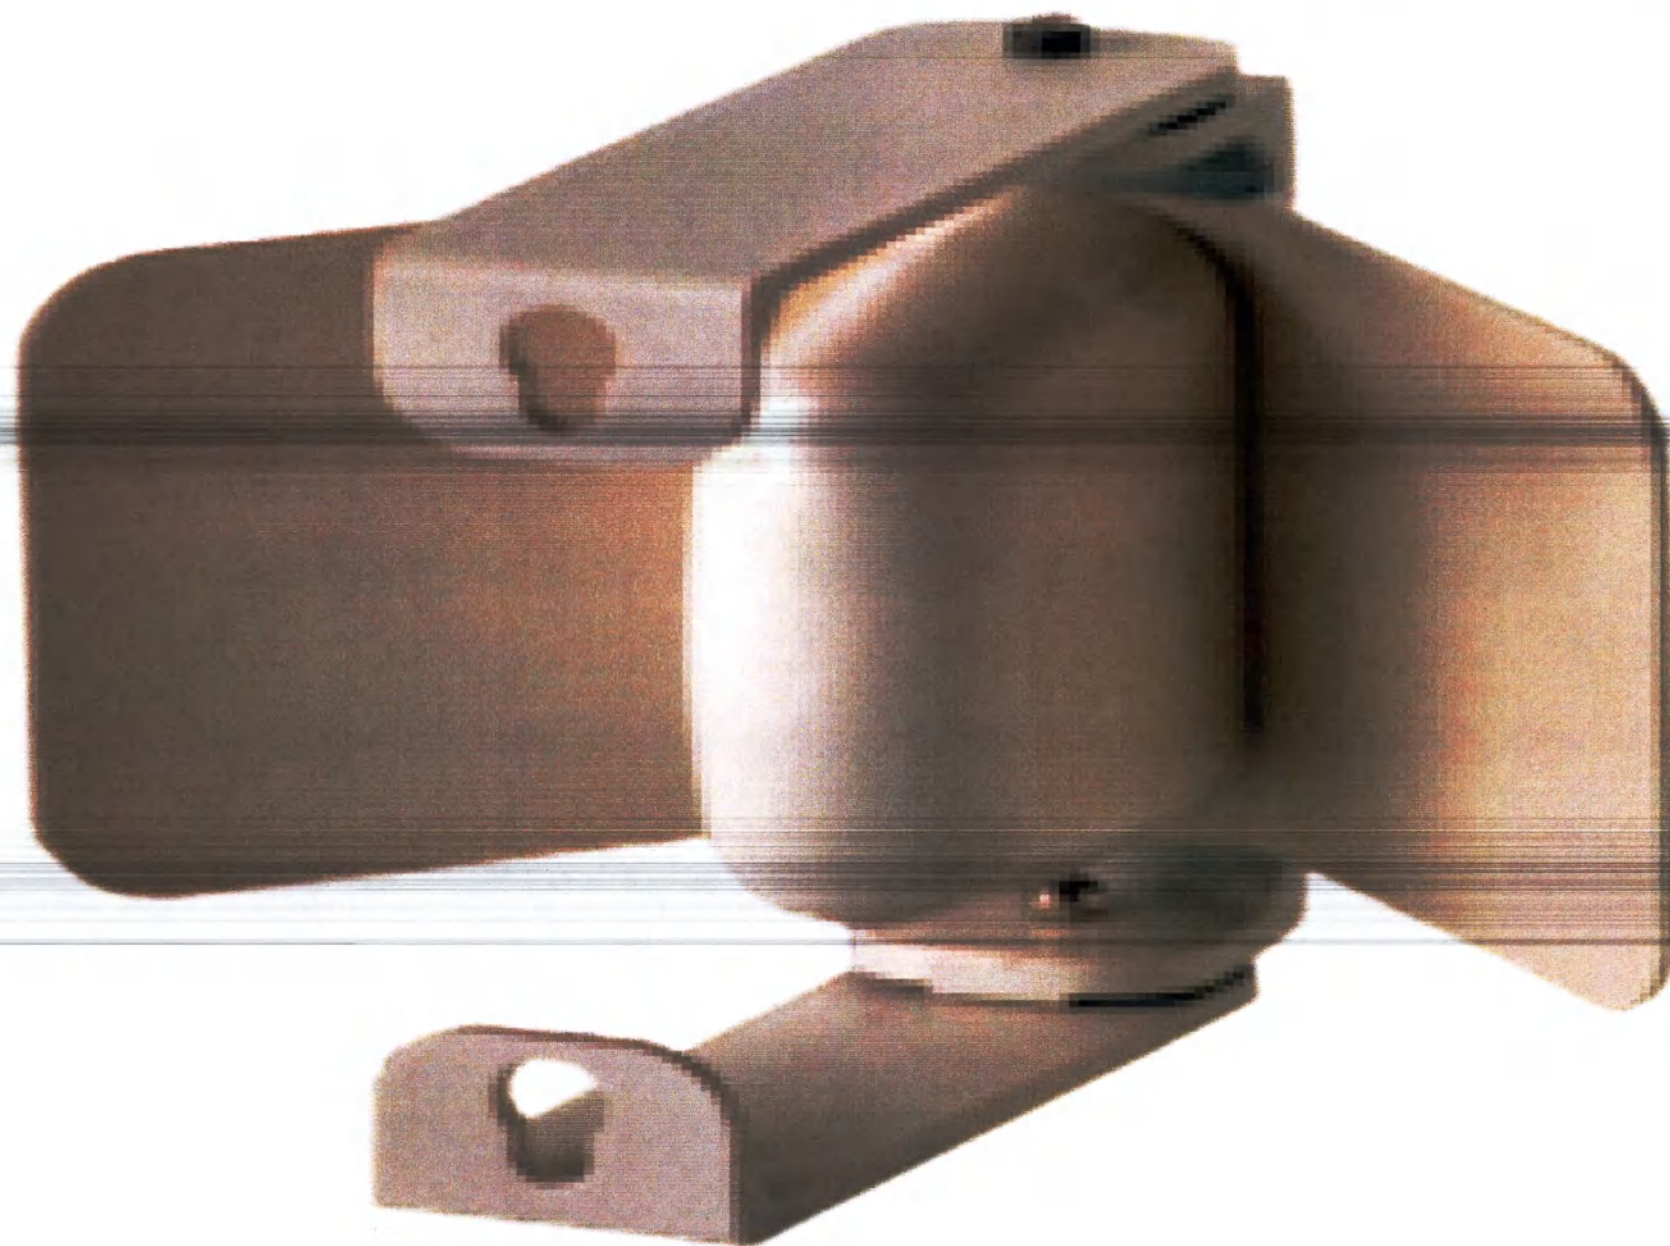


8.б. Устройства беспроводного мониторинга, антенны (от 1 до 50 штук).

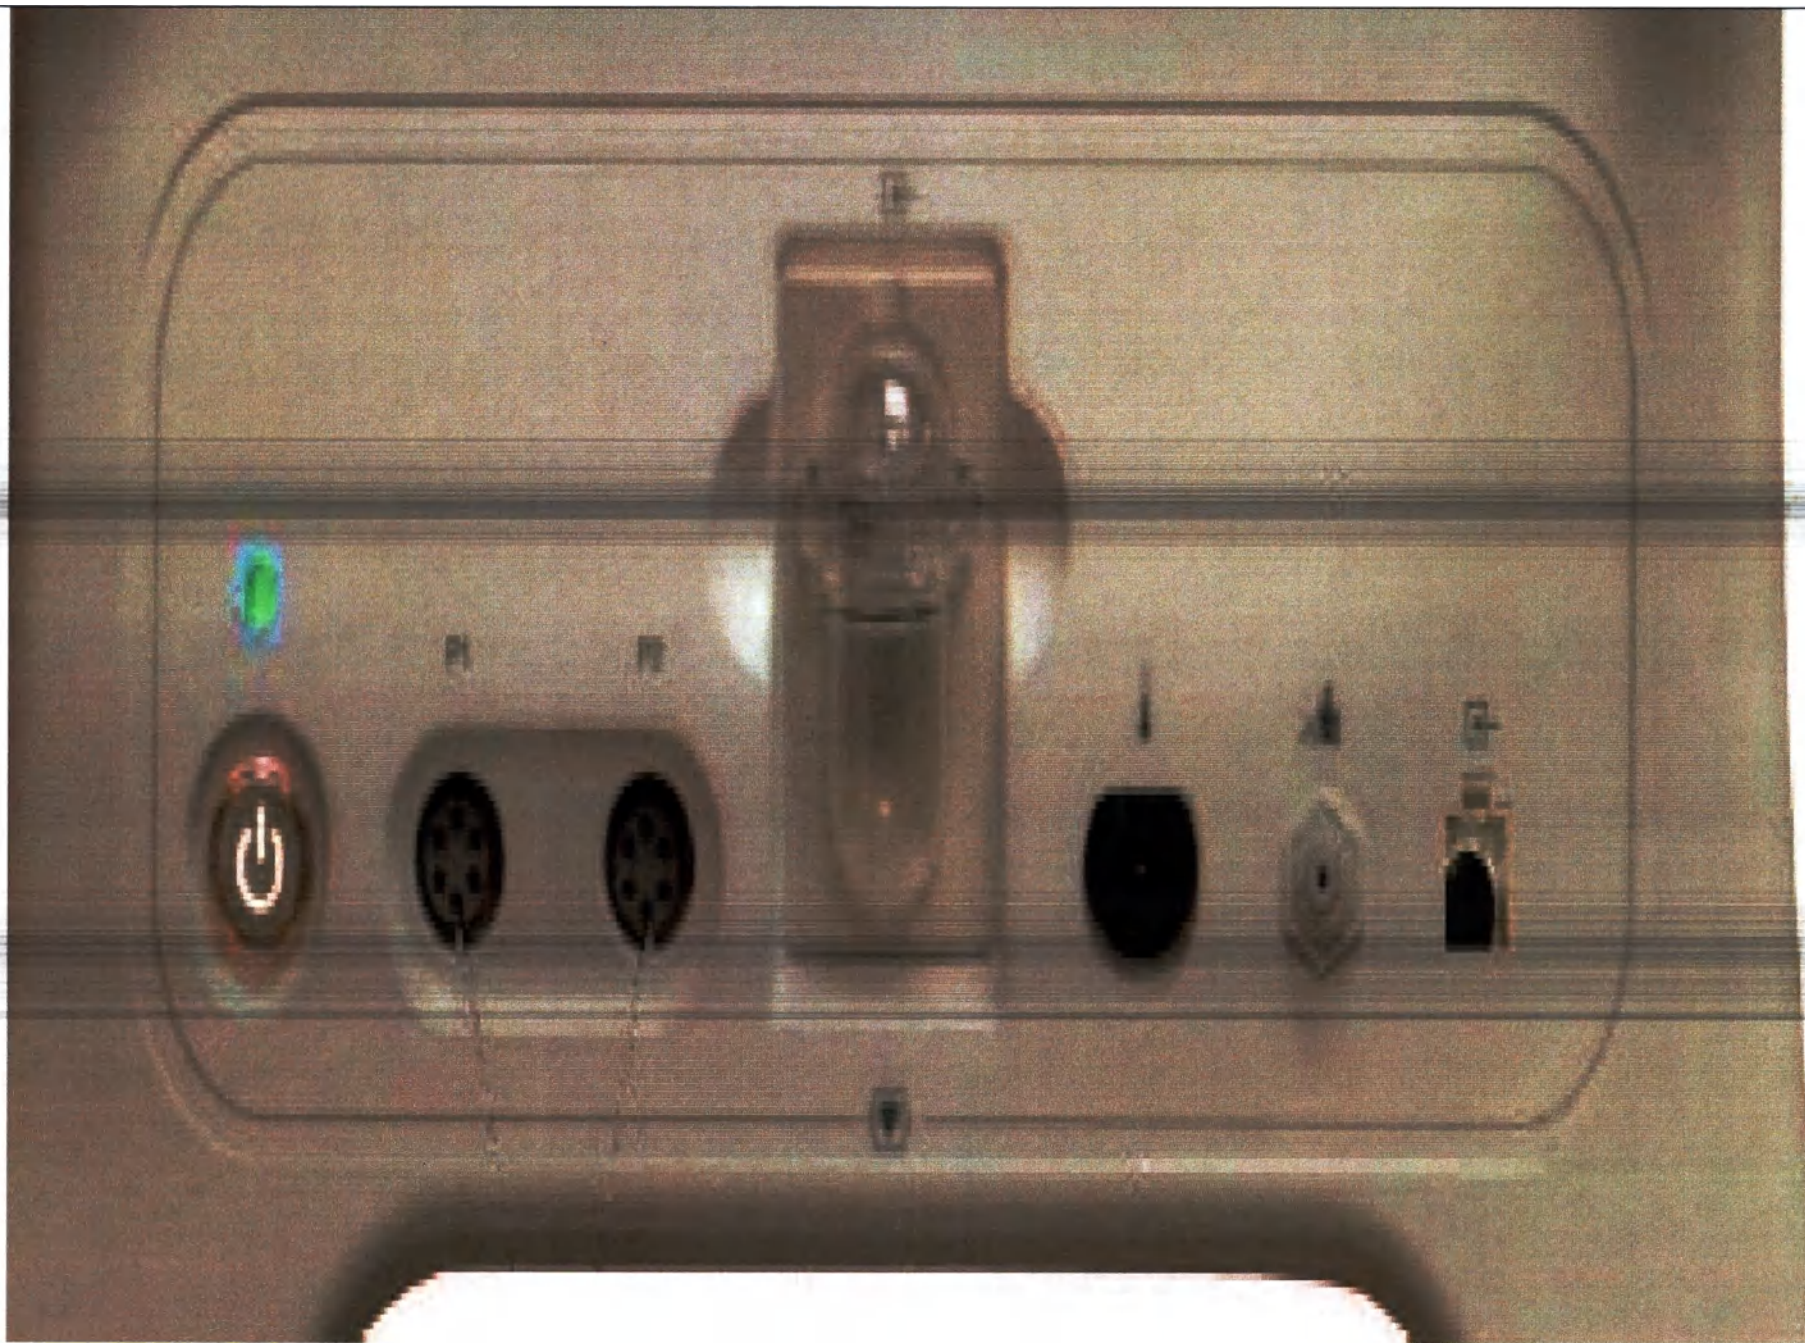


9.а. Платы: контрольные, интерфейсные, индикаторные распределительные, управляющие (от 1 до 100 штук).

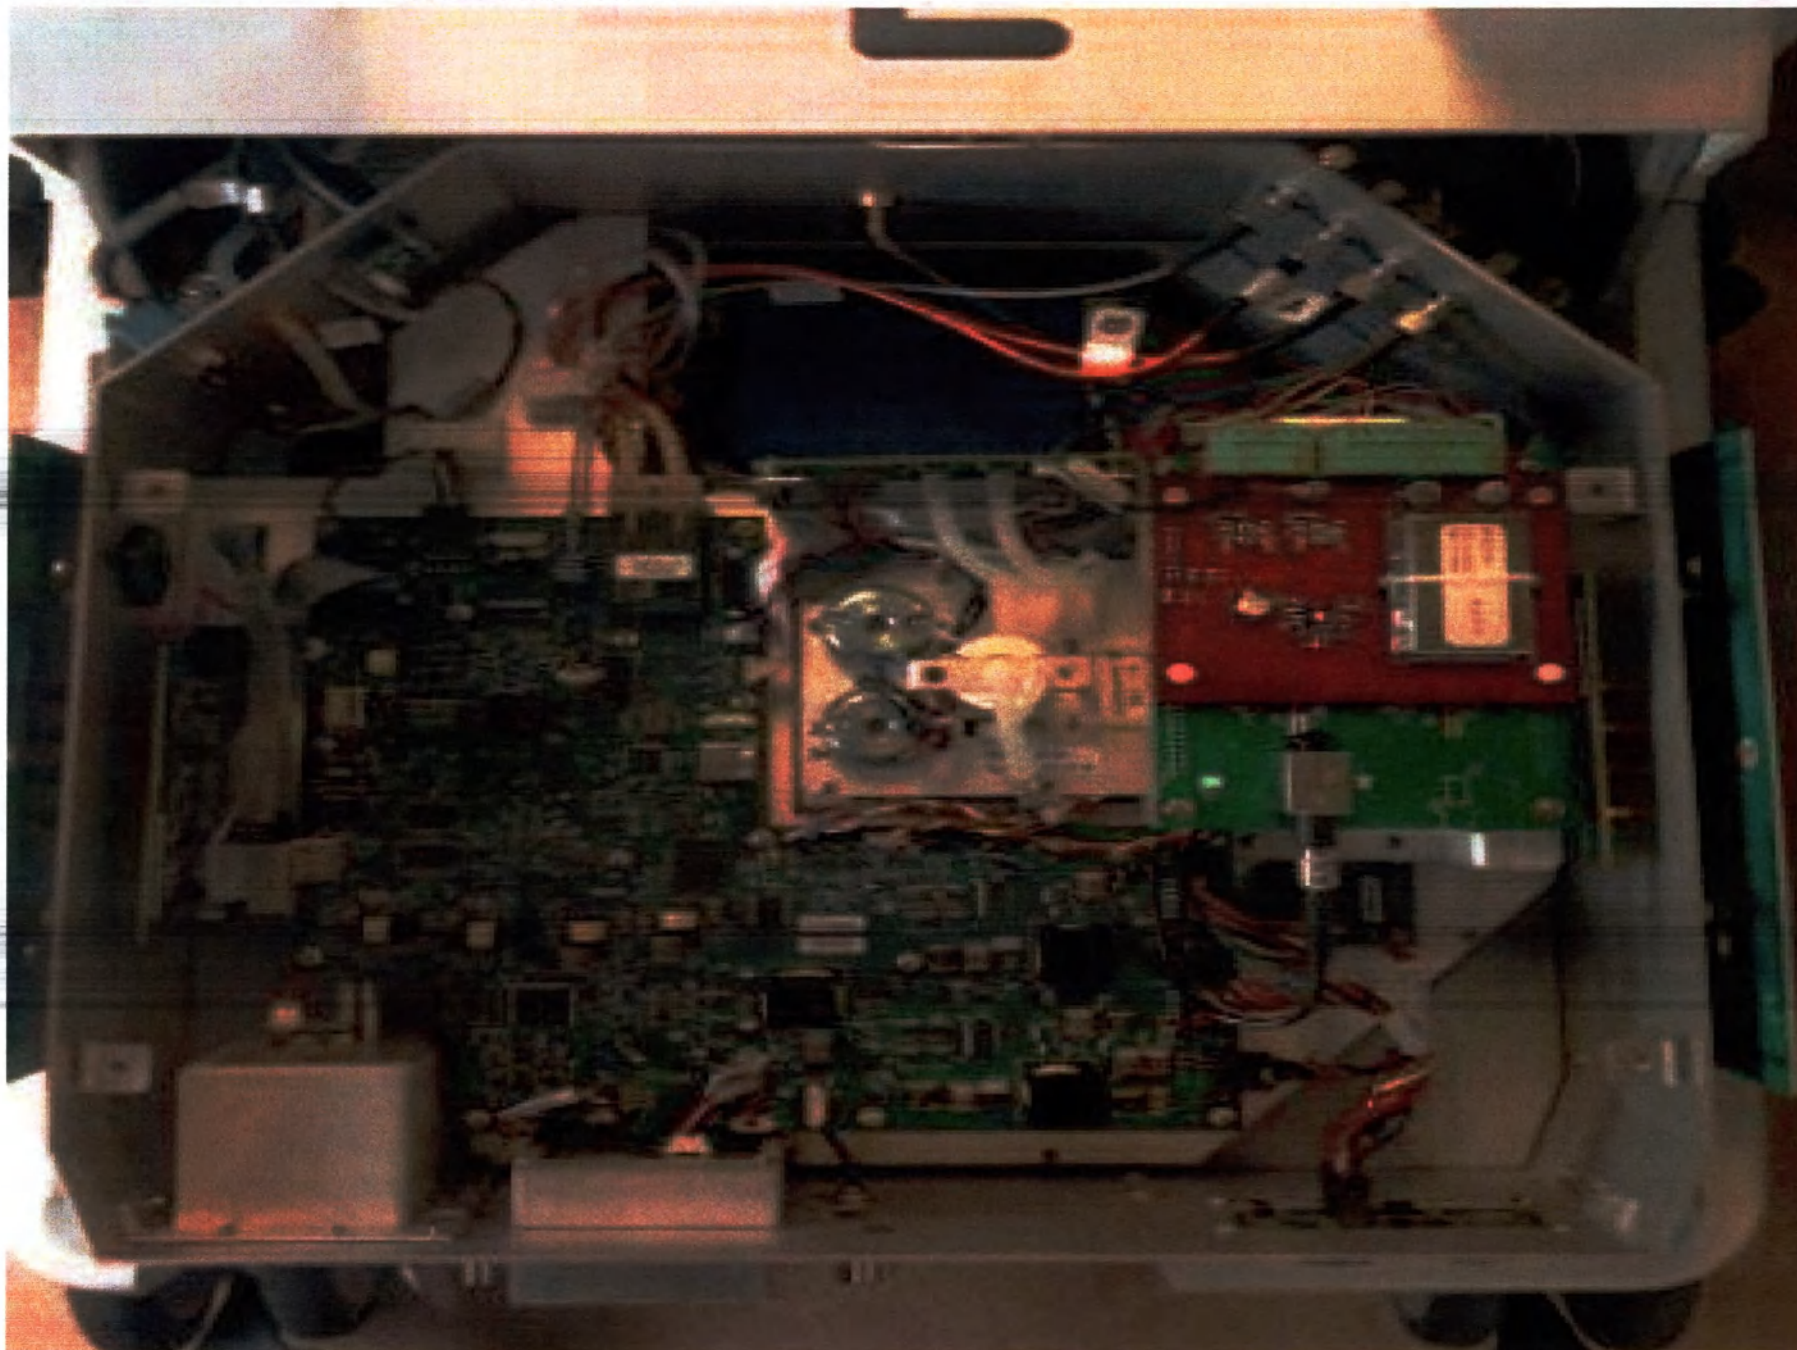

9.6. Платы: контрольные, интерфейсные, индикаторные распределительные, управляющие (от 1 до 100 штук).

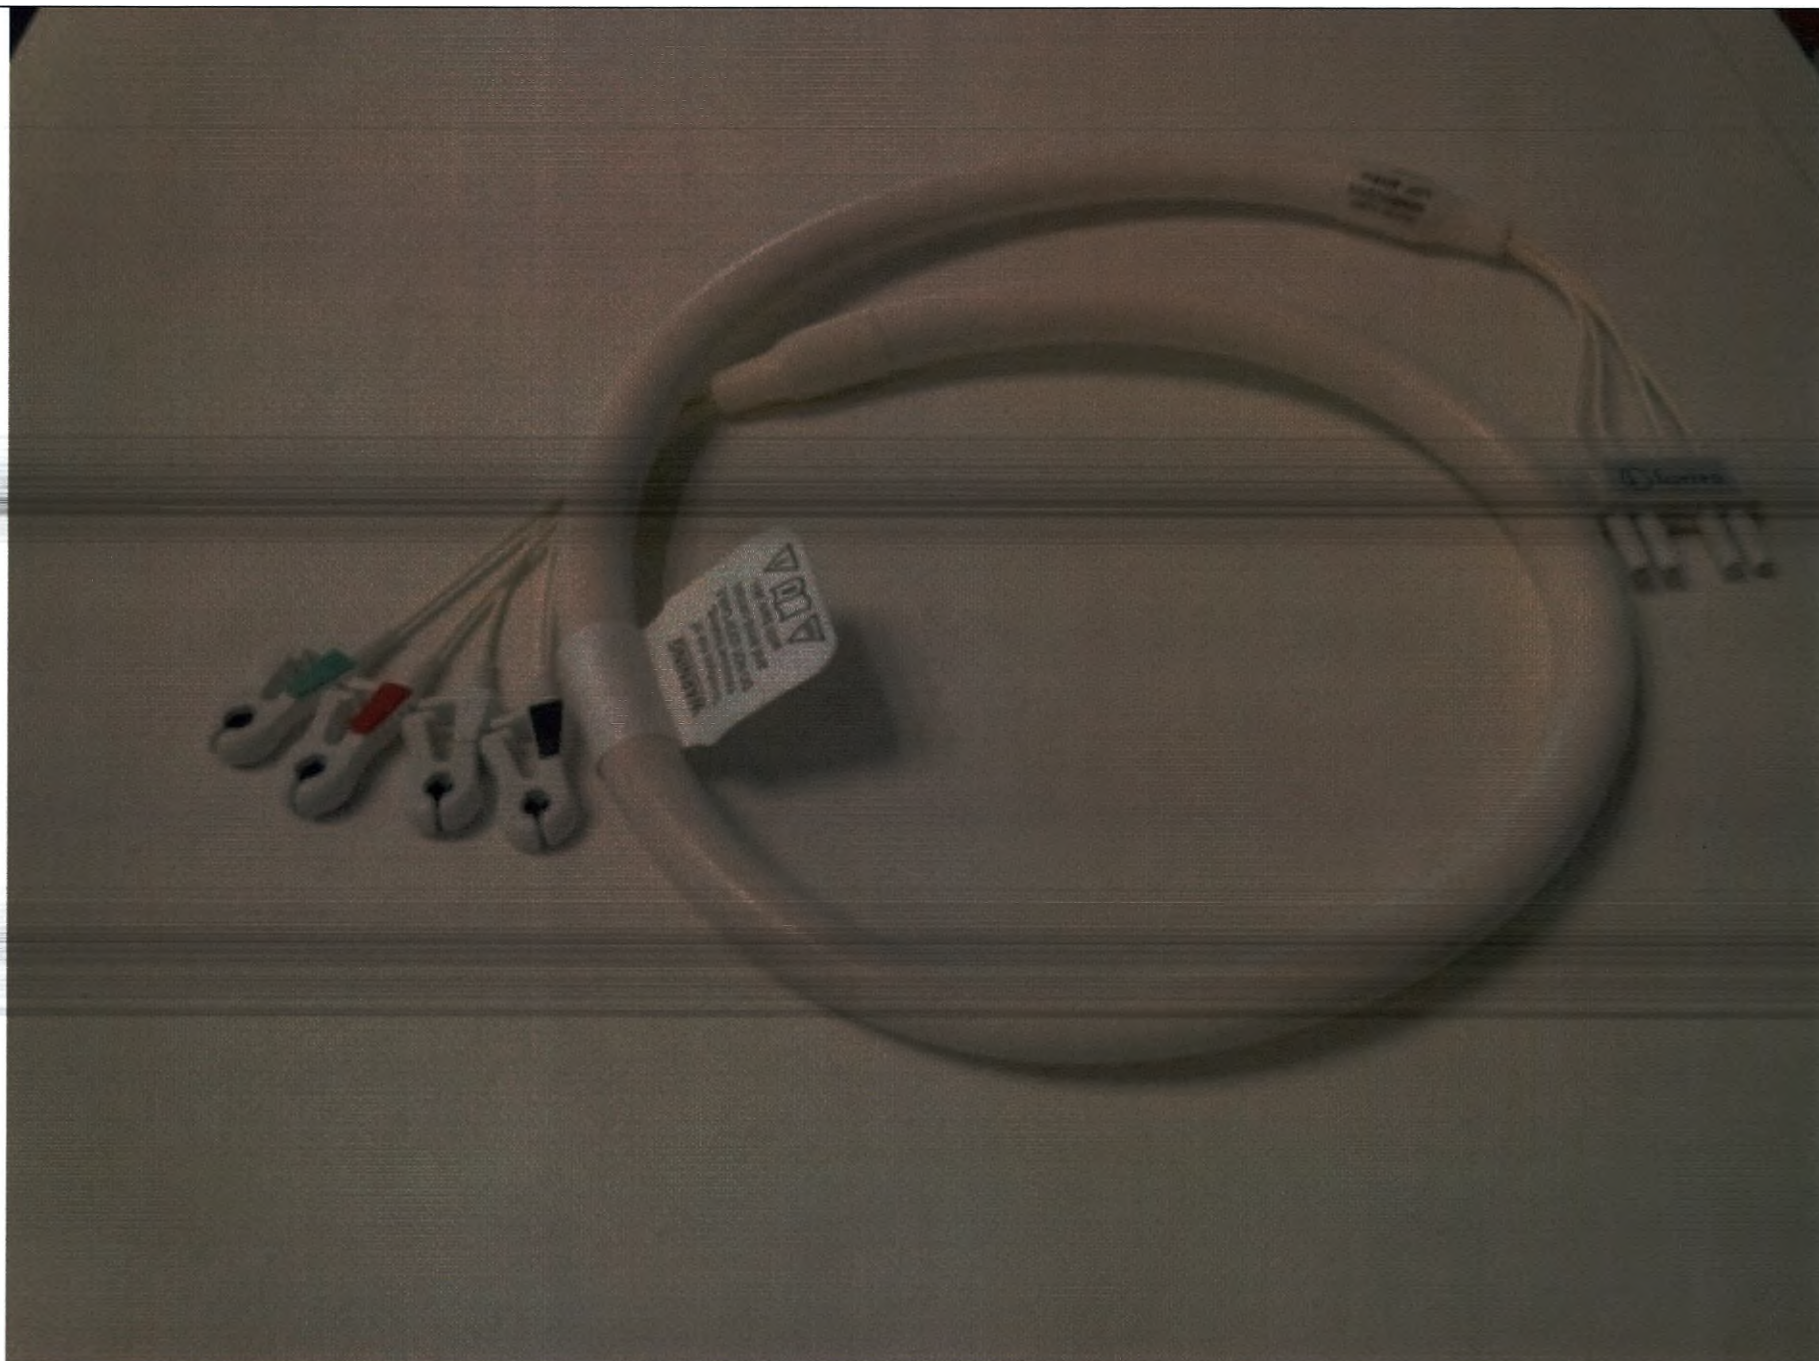

10.а. Кабели отведений ЭКГ (от 1 до 10 штук).

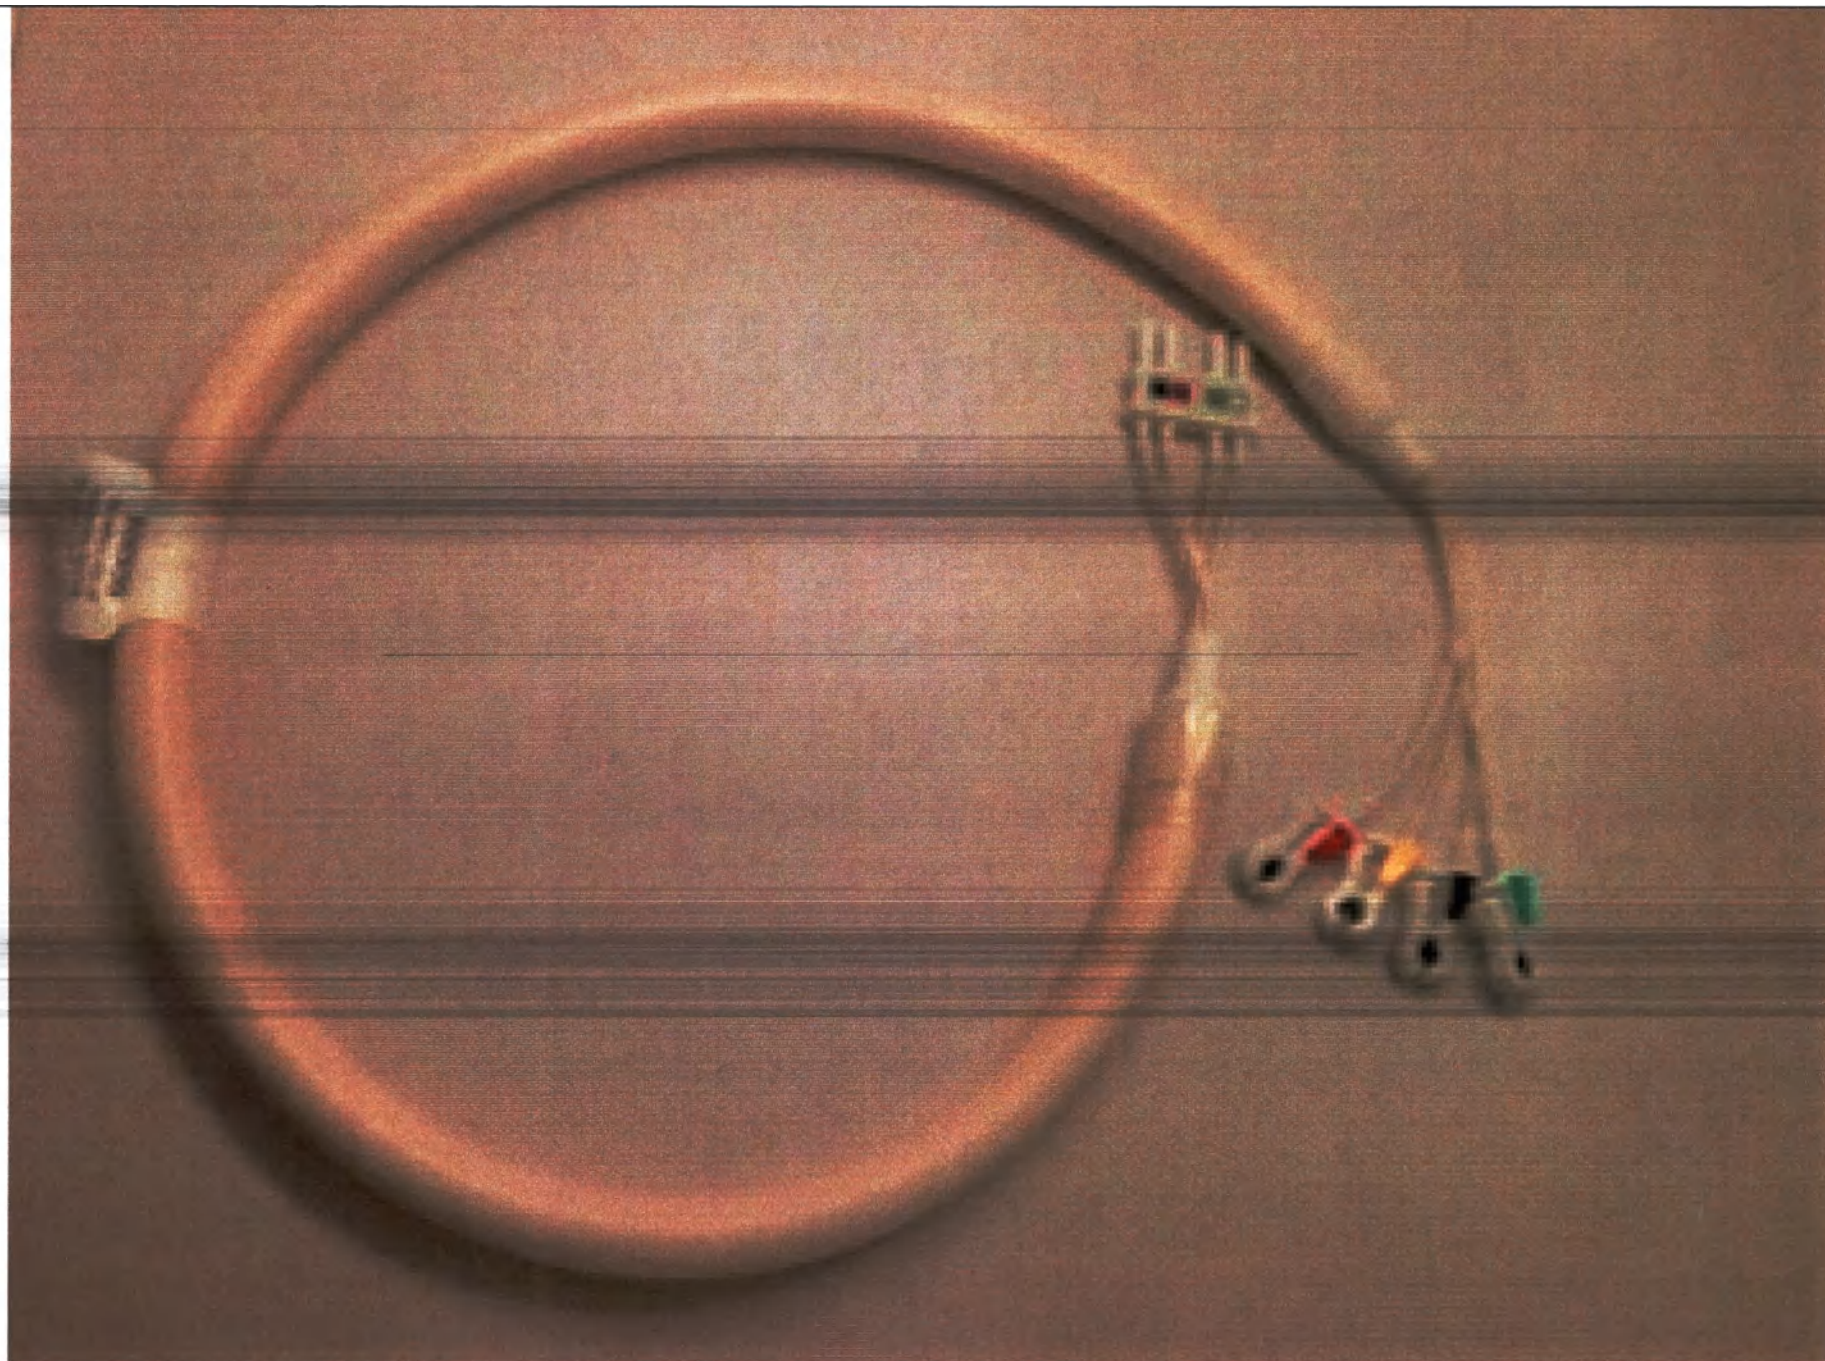

10.6. Кабели отведений ЭКГ (от 1 до 10 штук).



11. Электроды для измерения ЭКГ (от 1 до 10 упаковок).




12.а. Интерфейсные кабели для синхронизации (от 1 до 10 штук).



12.6. Интерфейсные кабели для синхронизации (от 1 до 10 штук).




13. Манжеты для измерения неинвазивного артериального давления (от 1 до 10 штук).

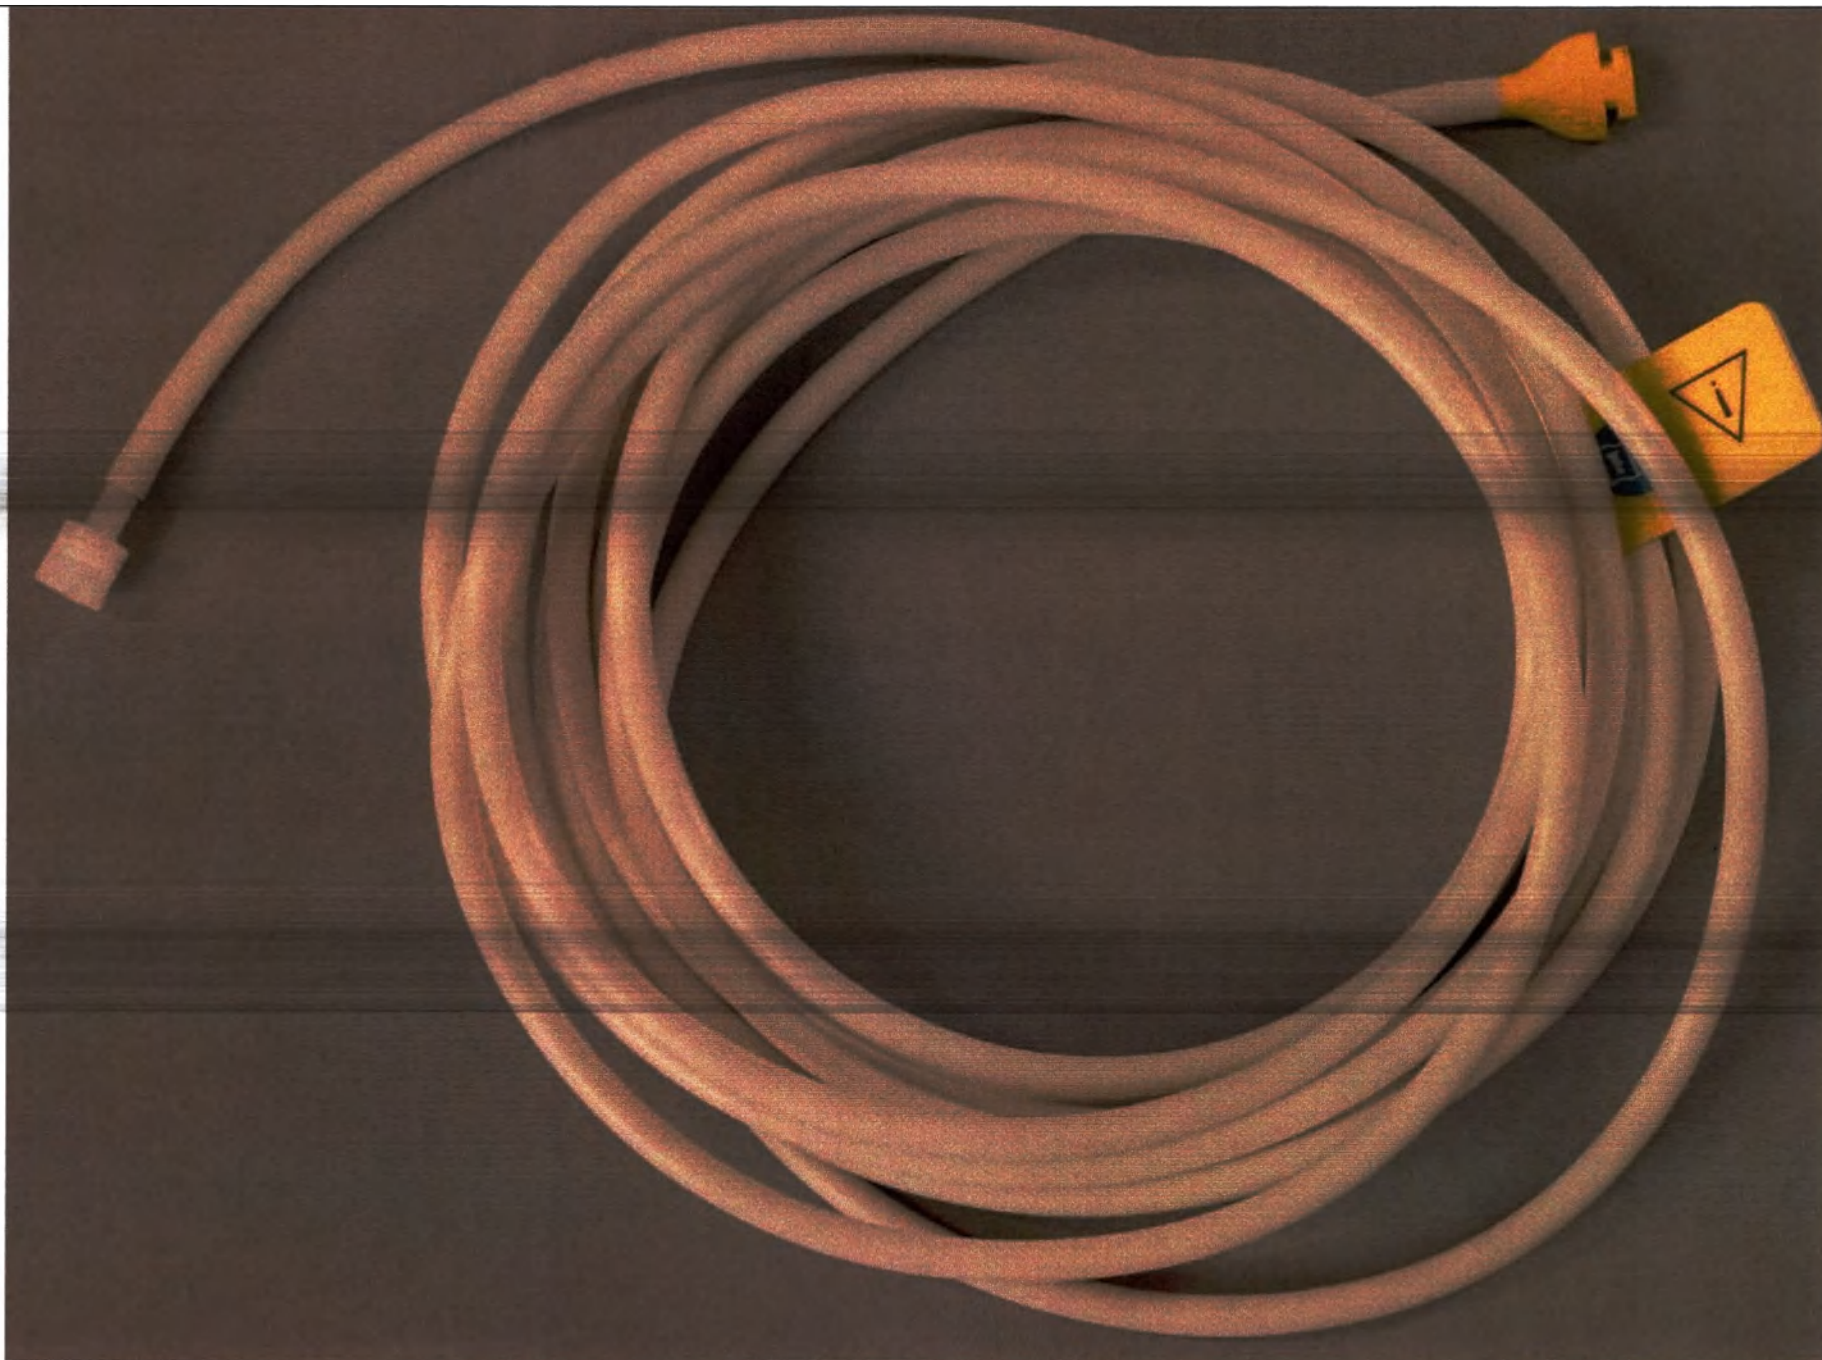


14. Шланги для измерения неинвазивного артериального давления (от 1 до 10 штук).




15.а. Сильфоны на грудную клетку (от 1 до 10 штук).

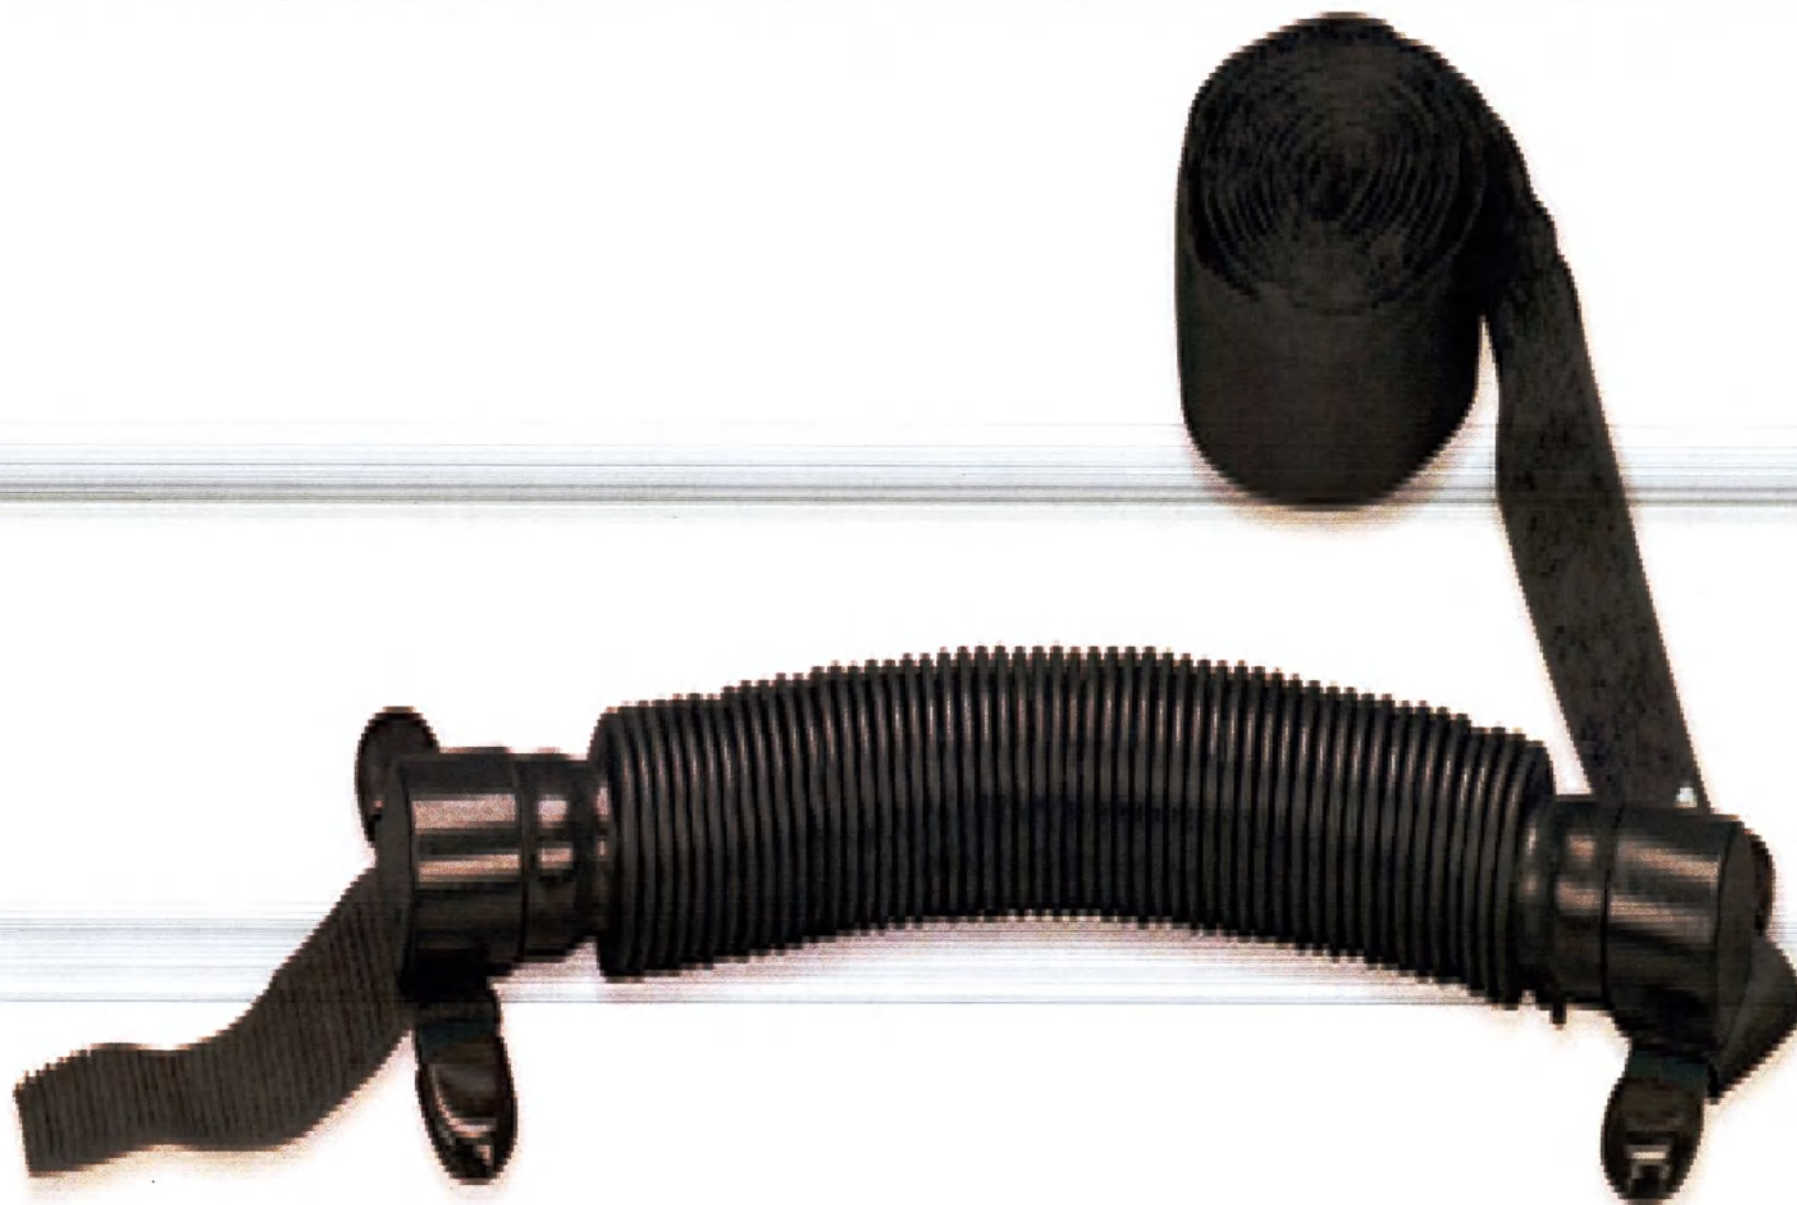


15.б. Сильфоны на грудную клетку (от 1 до 10 штук).

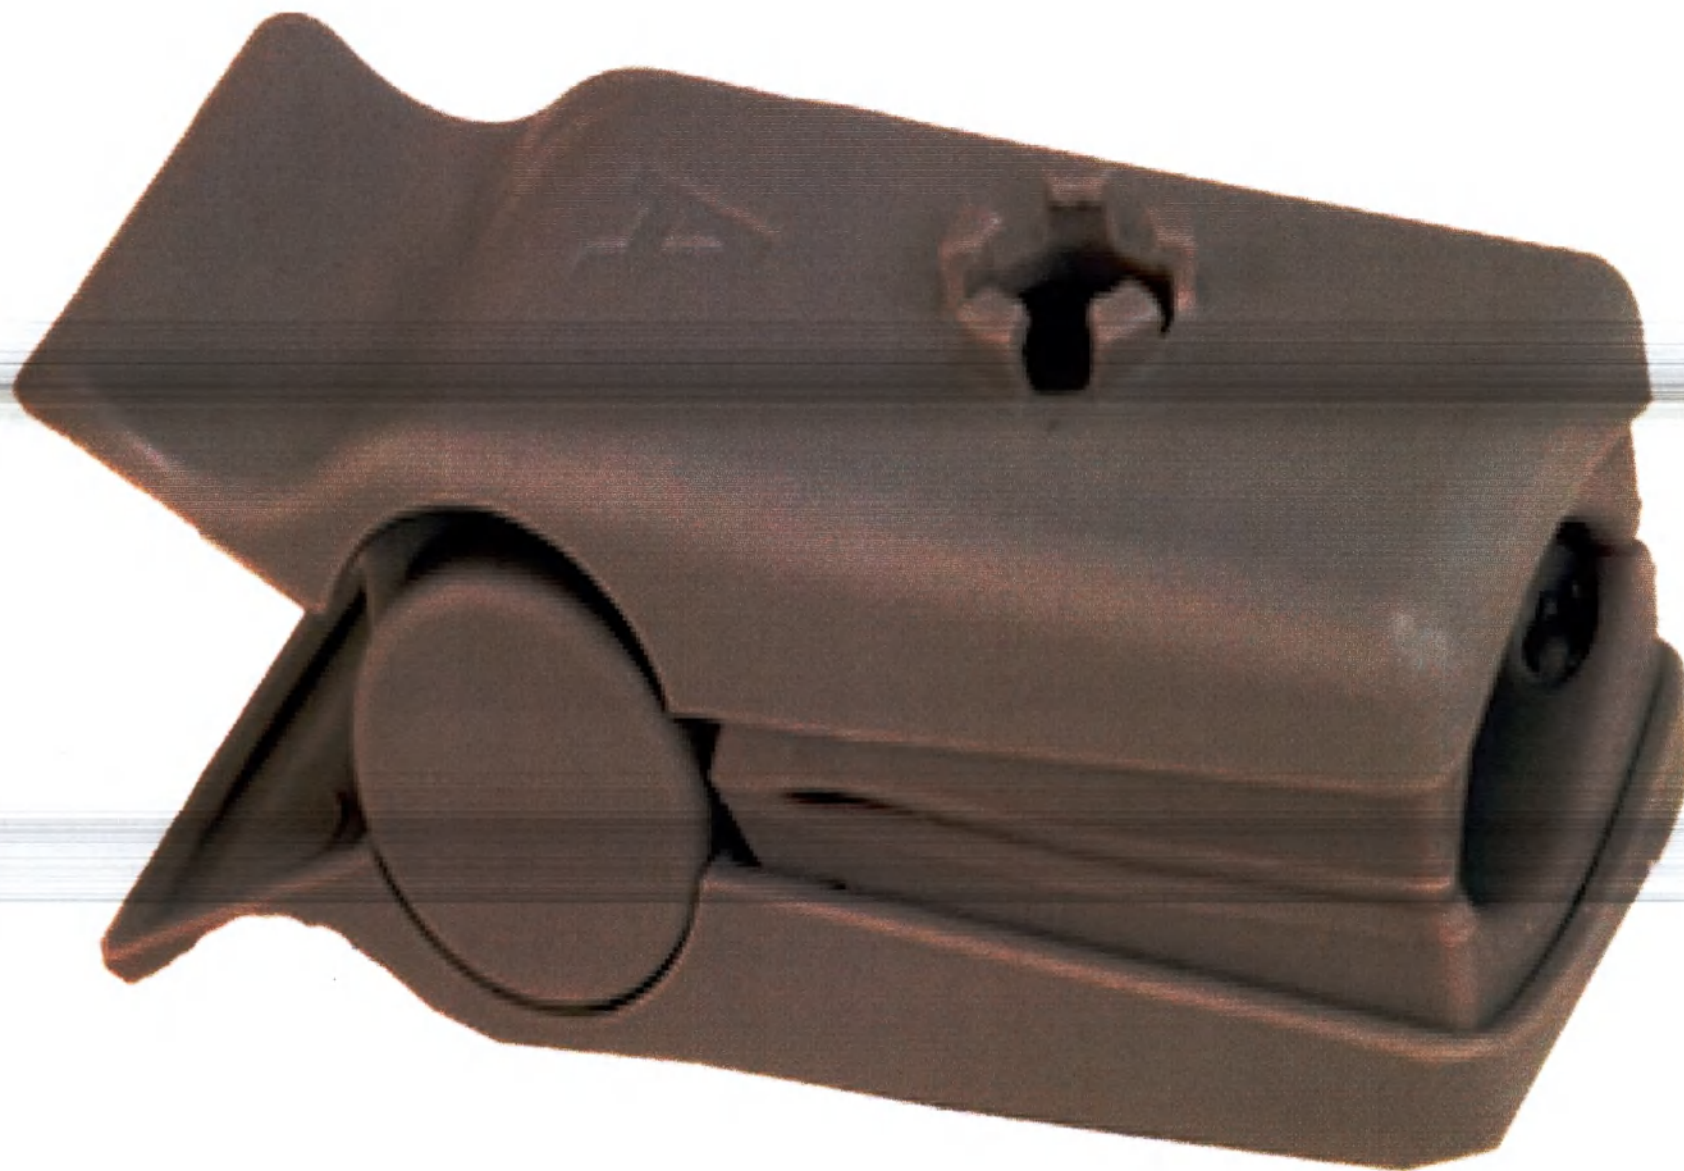


16.а. Датчики для измерения пульсоксиметрии (от 1 до 100 штук).

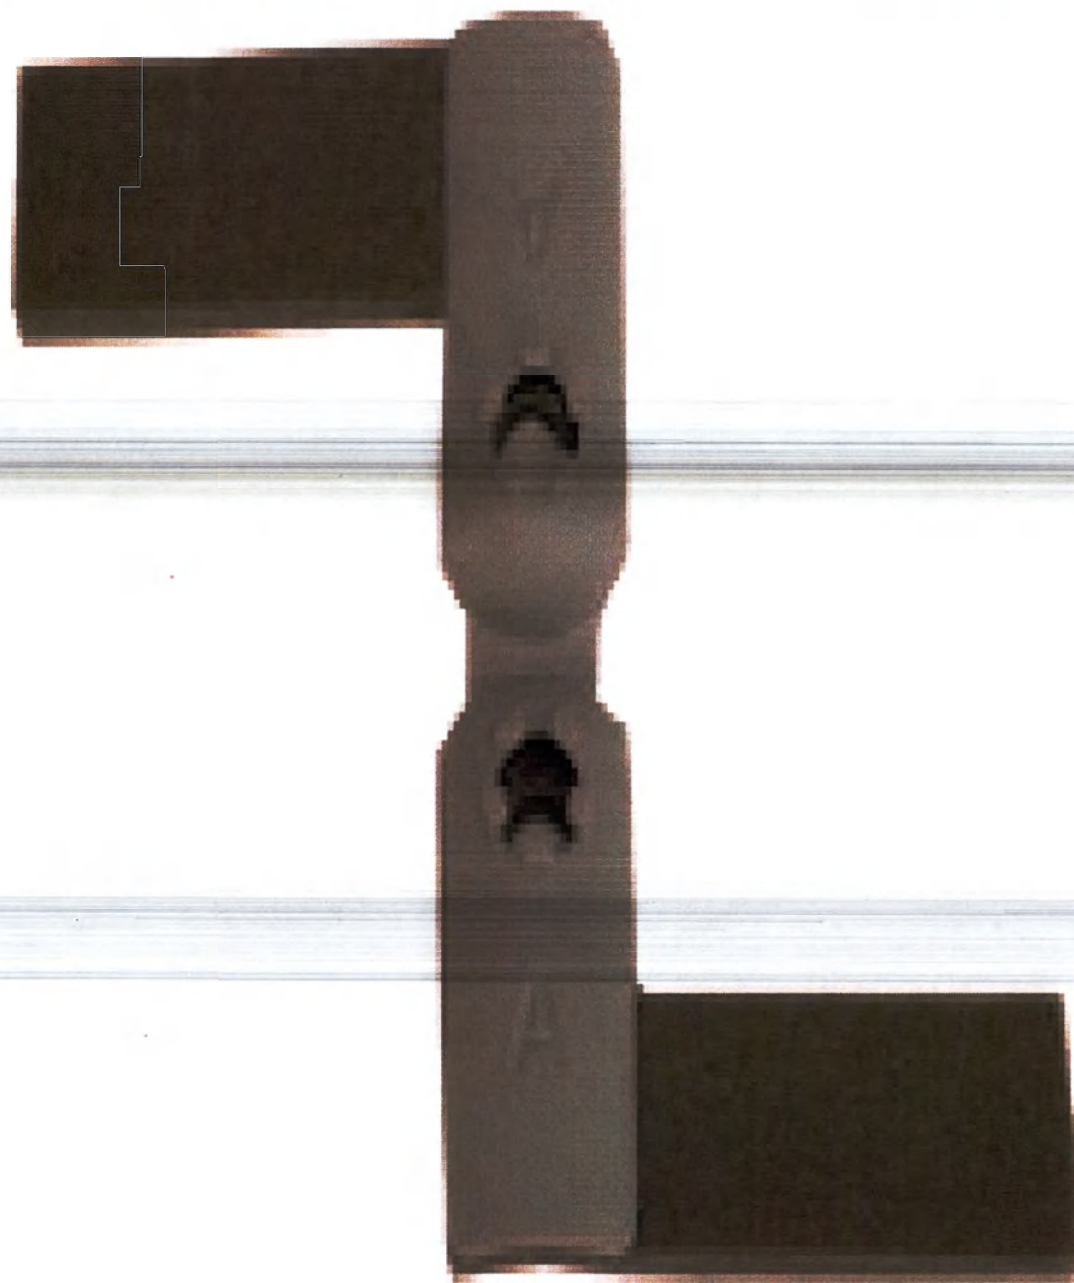


16.б. Датчики для измерения пульсоксиметрии (от 1 до 100 штук).

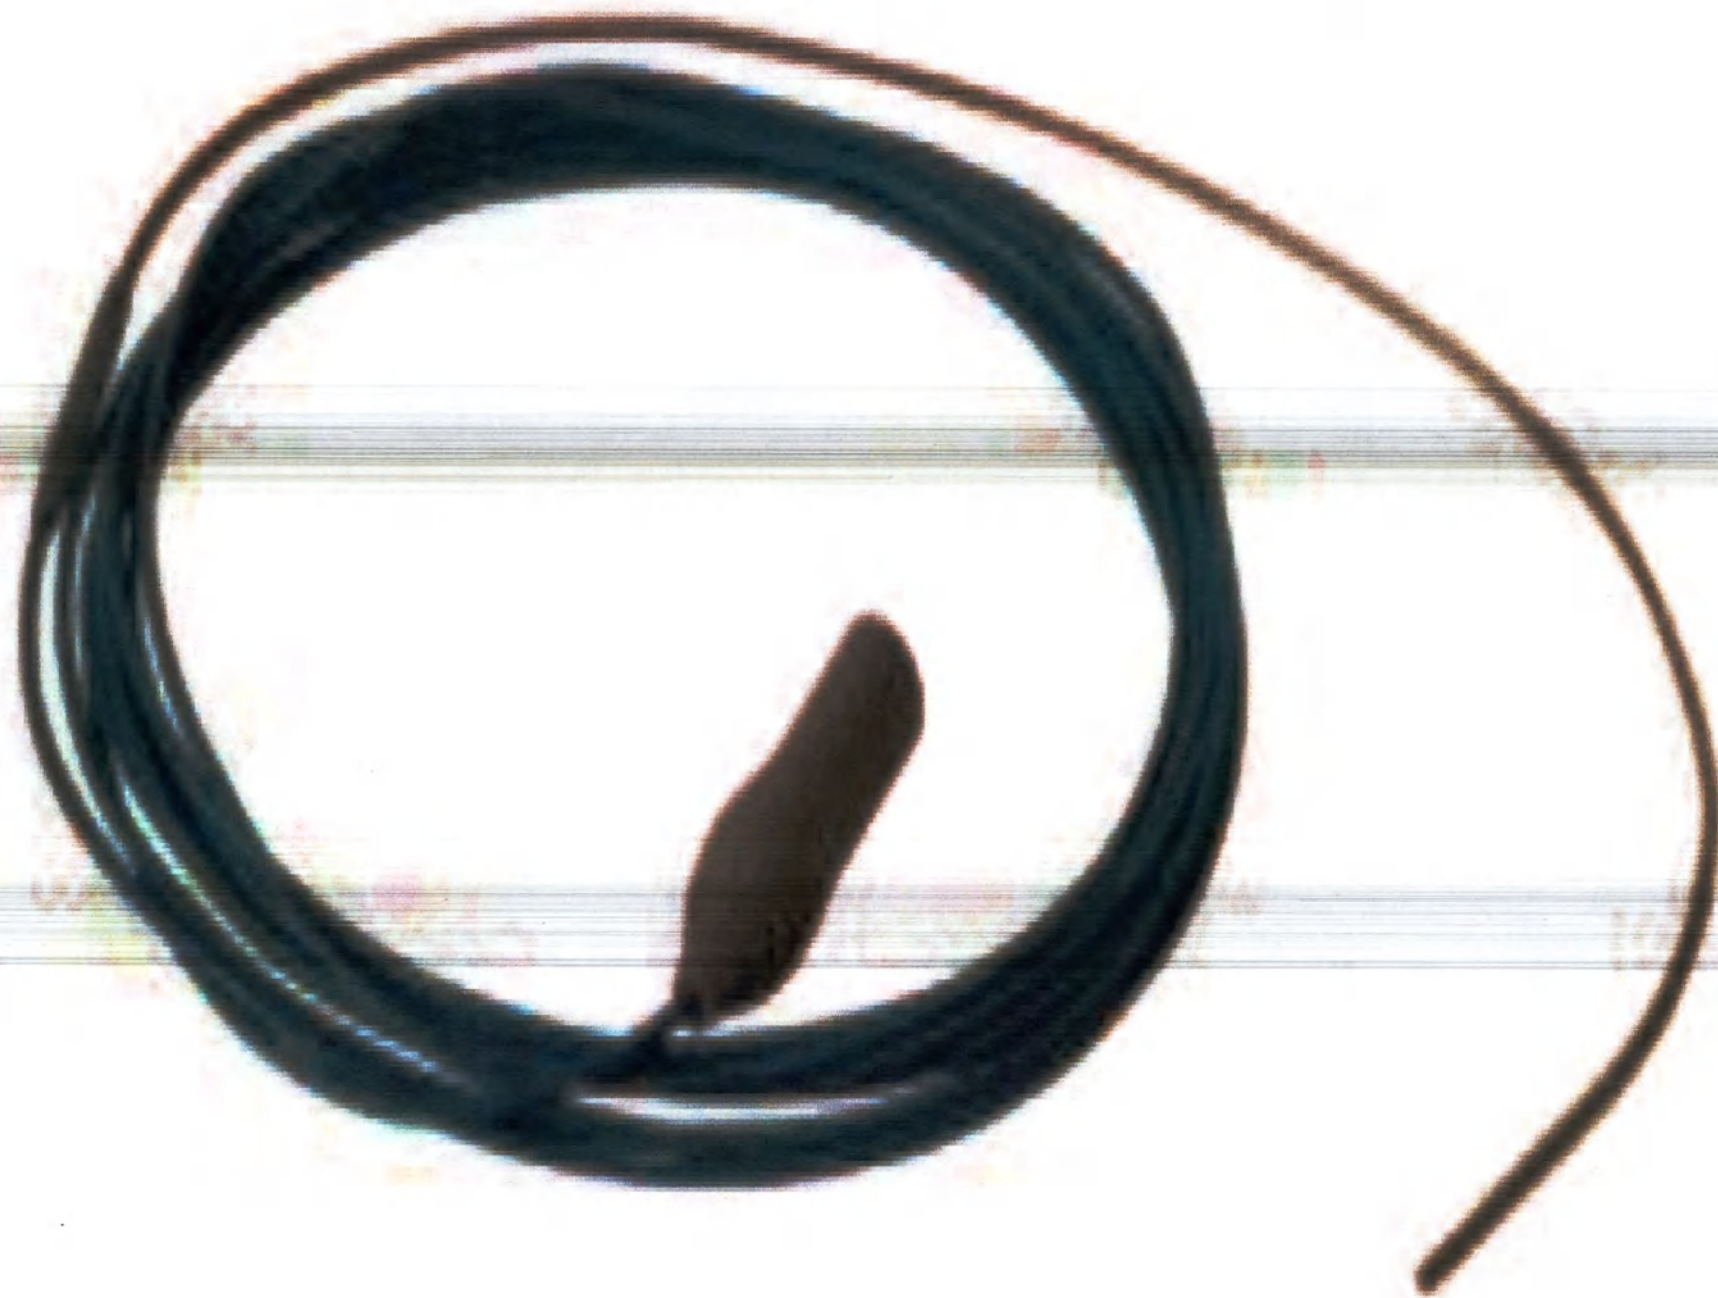

17. Датчики для измерения температуры (от 1 до 20 штук).

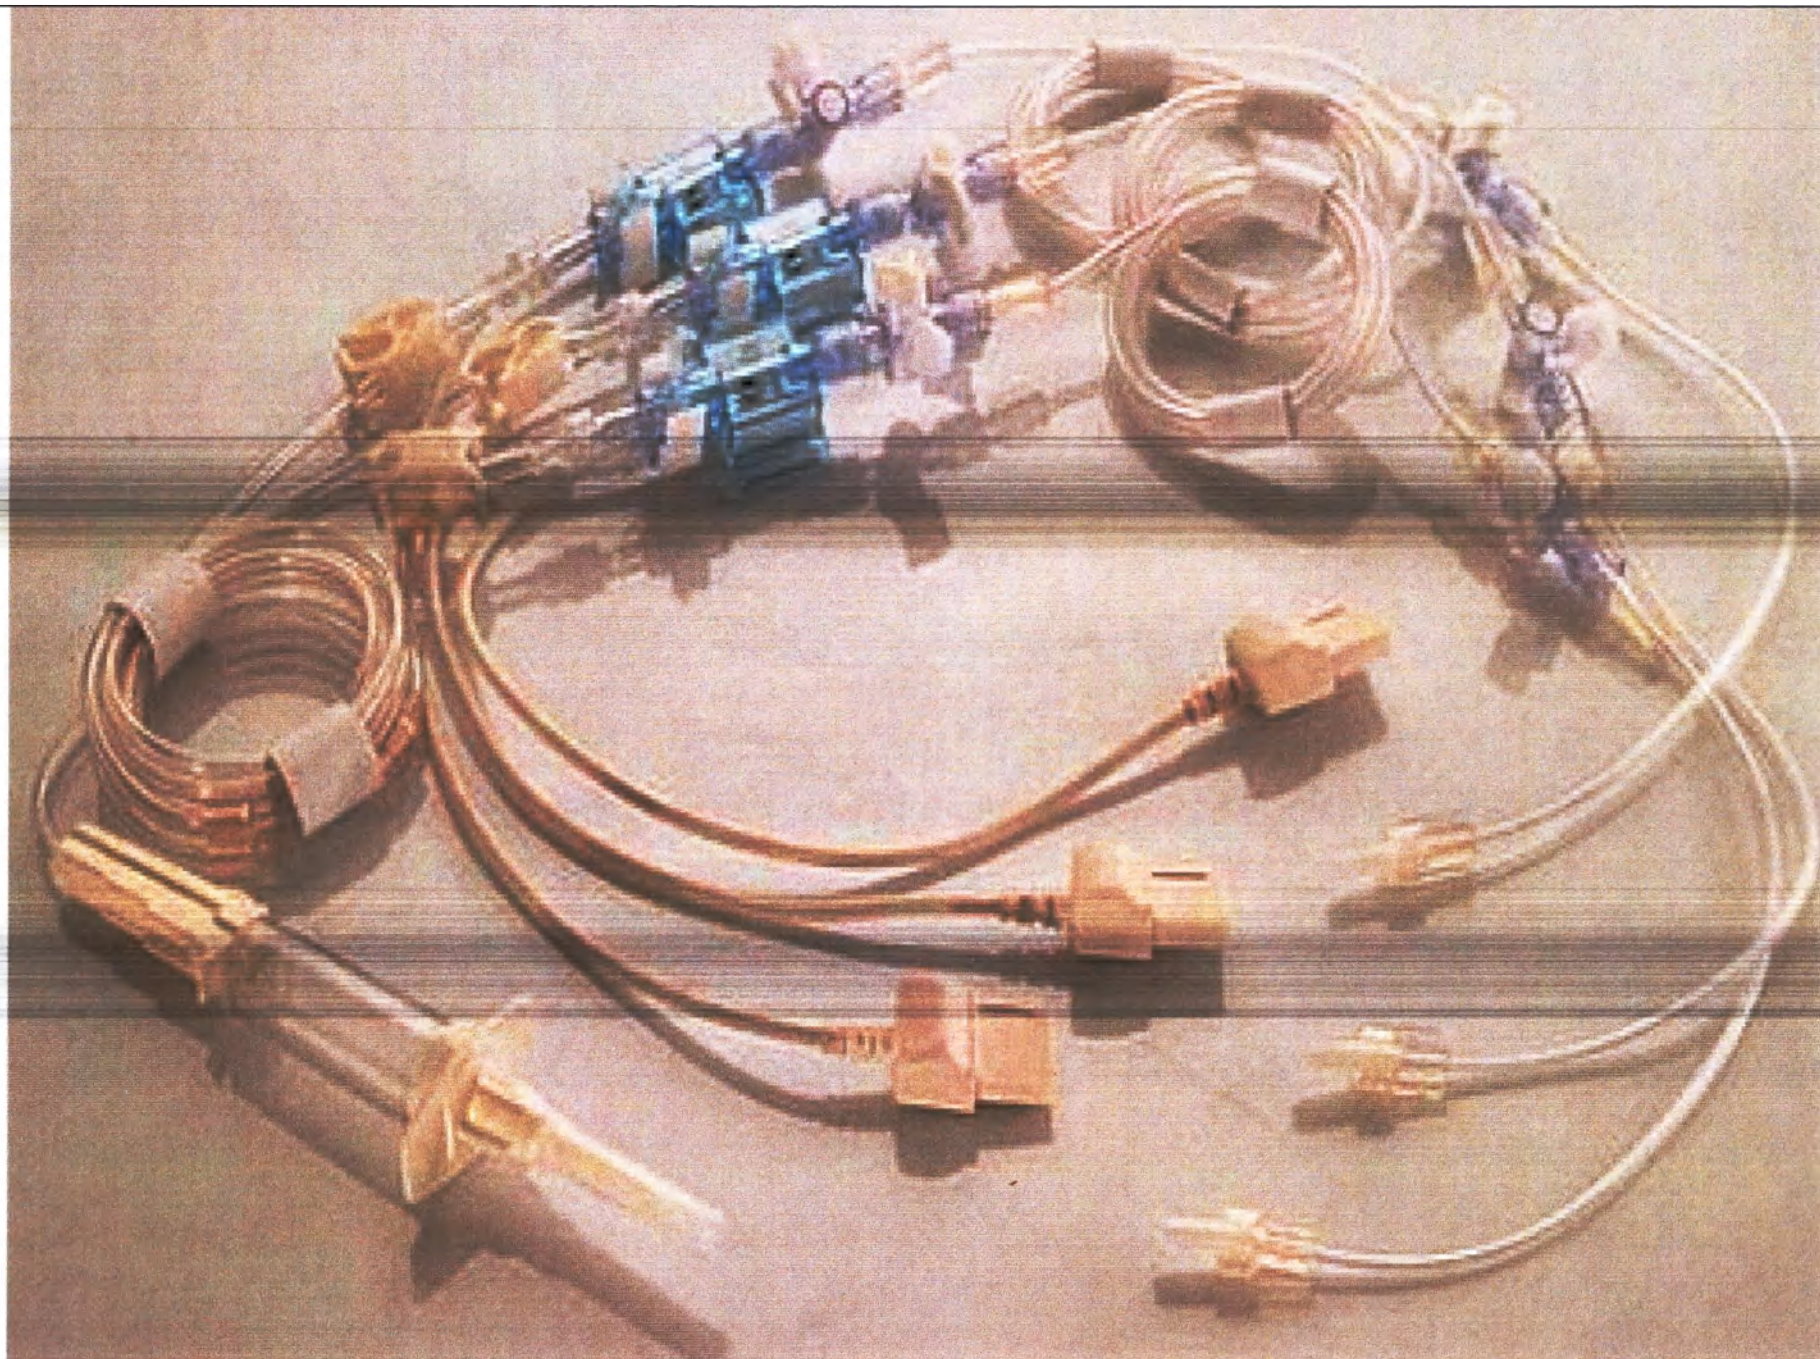


18. Датчики для измерения инвазивного давления (от 1 до 20 штук).

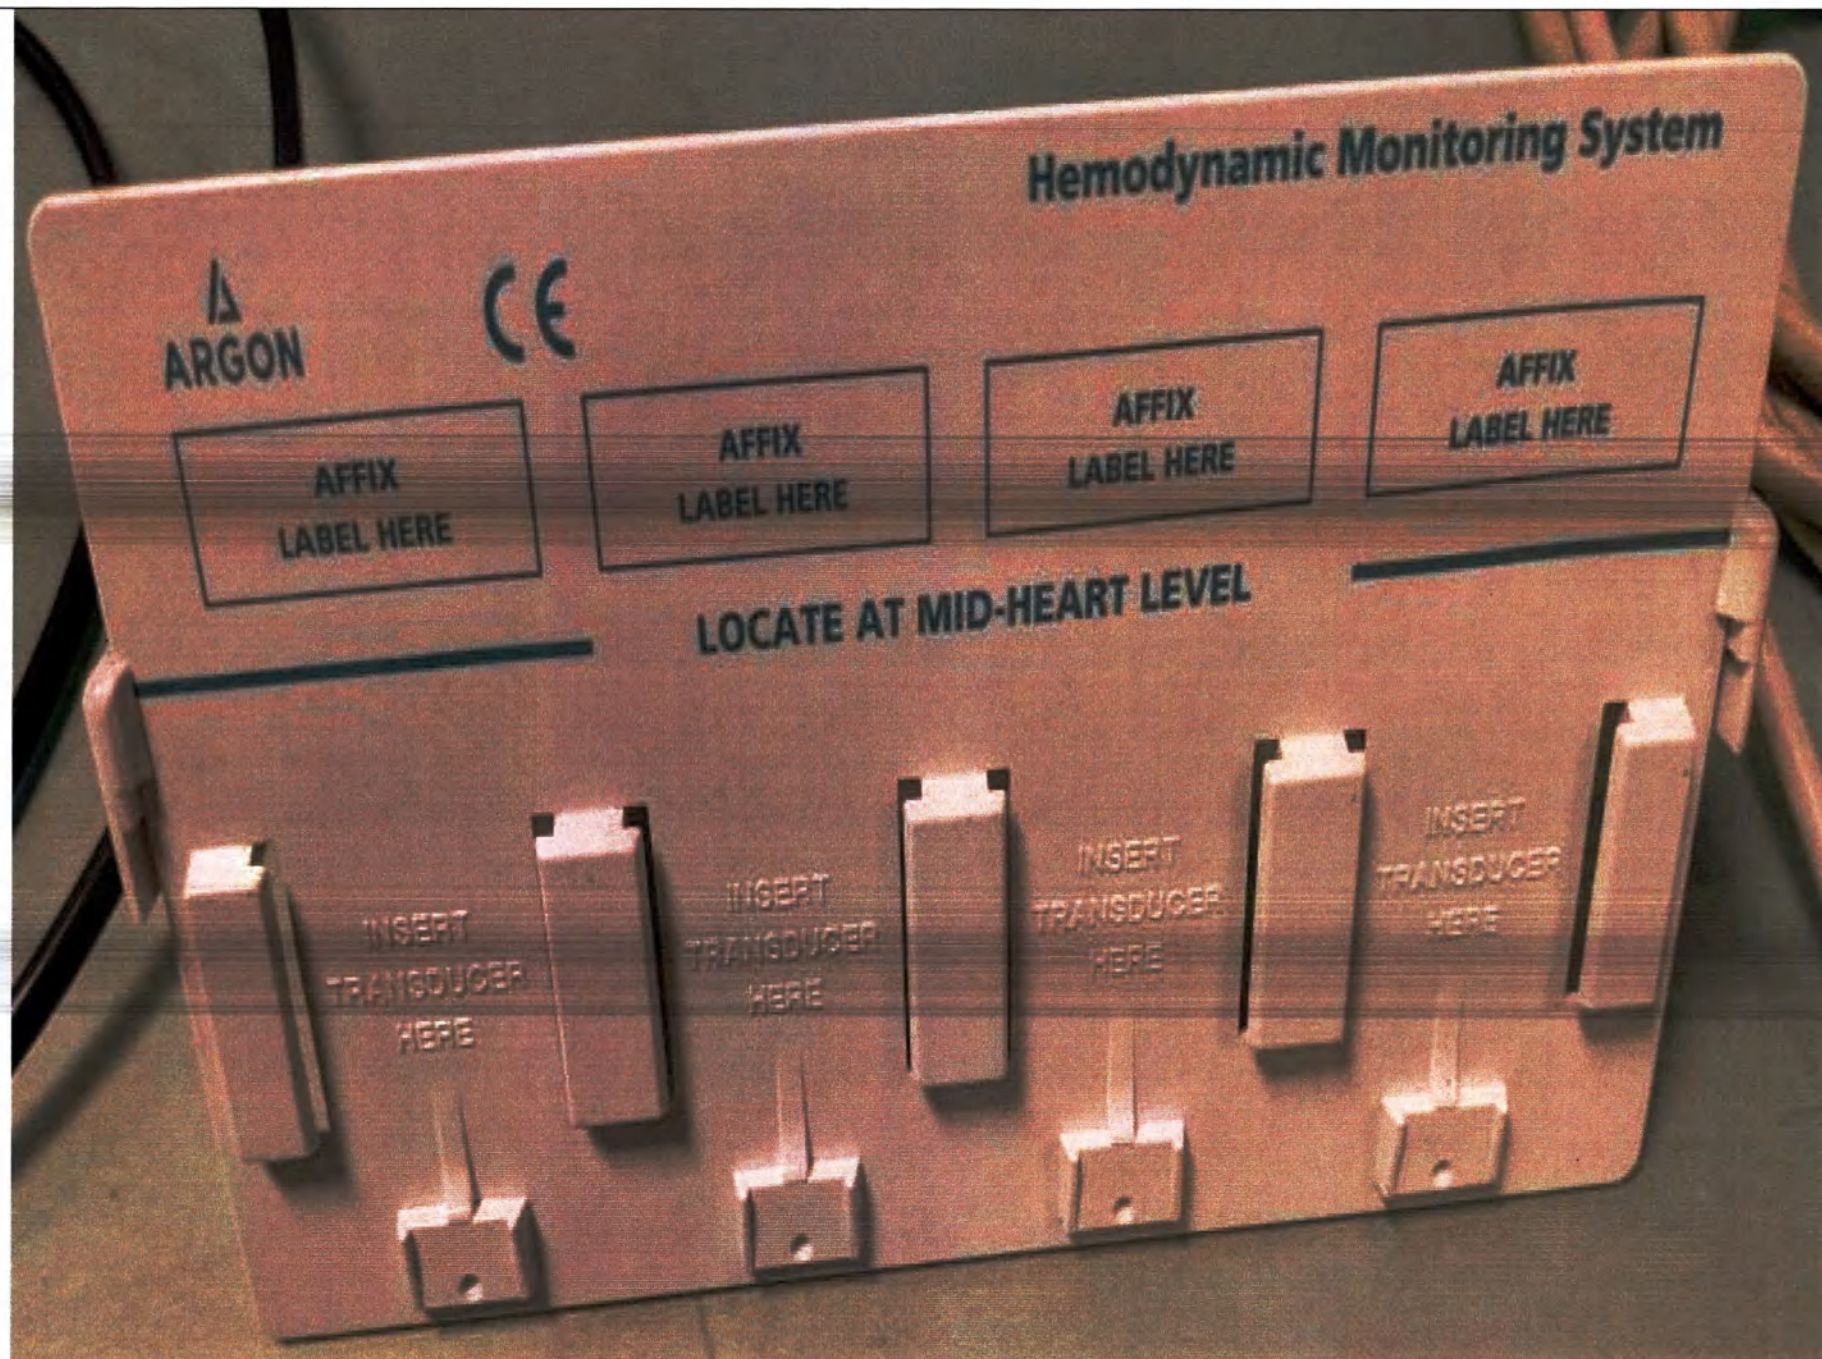

19. Держатели для измерения инвазивного давления (от 1 до 20 штук).




20. Кабели для измерения инвазивного давления (от 1 до 20 штук).

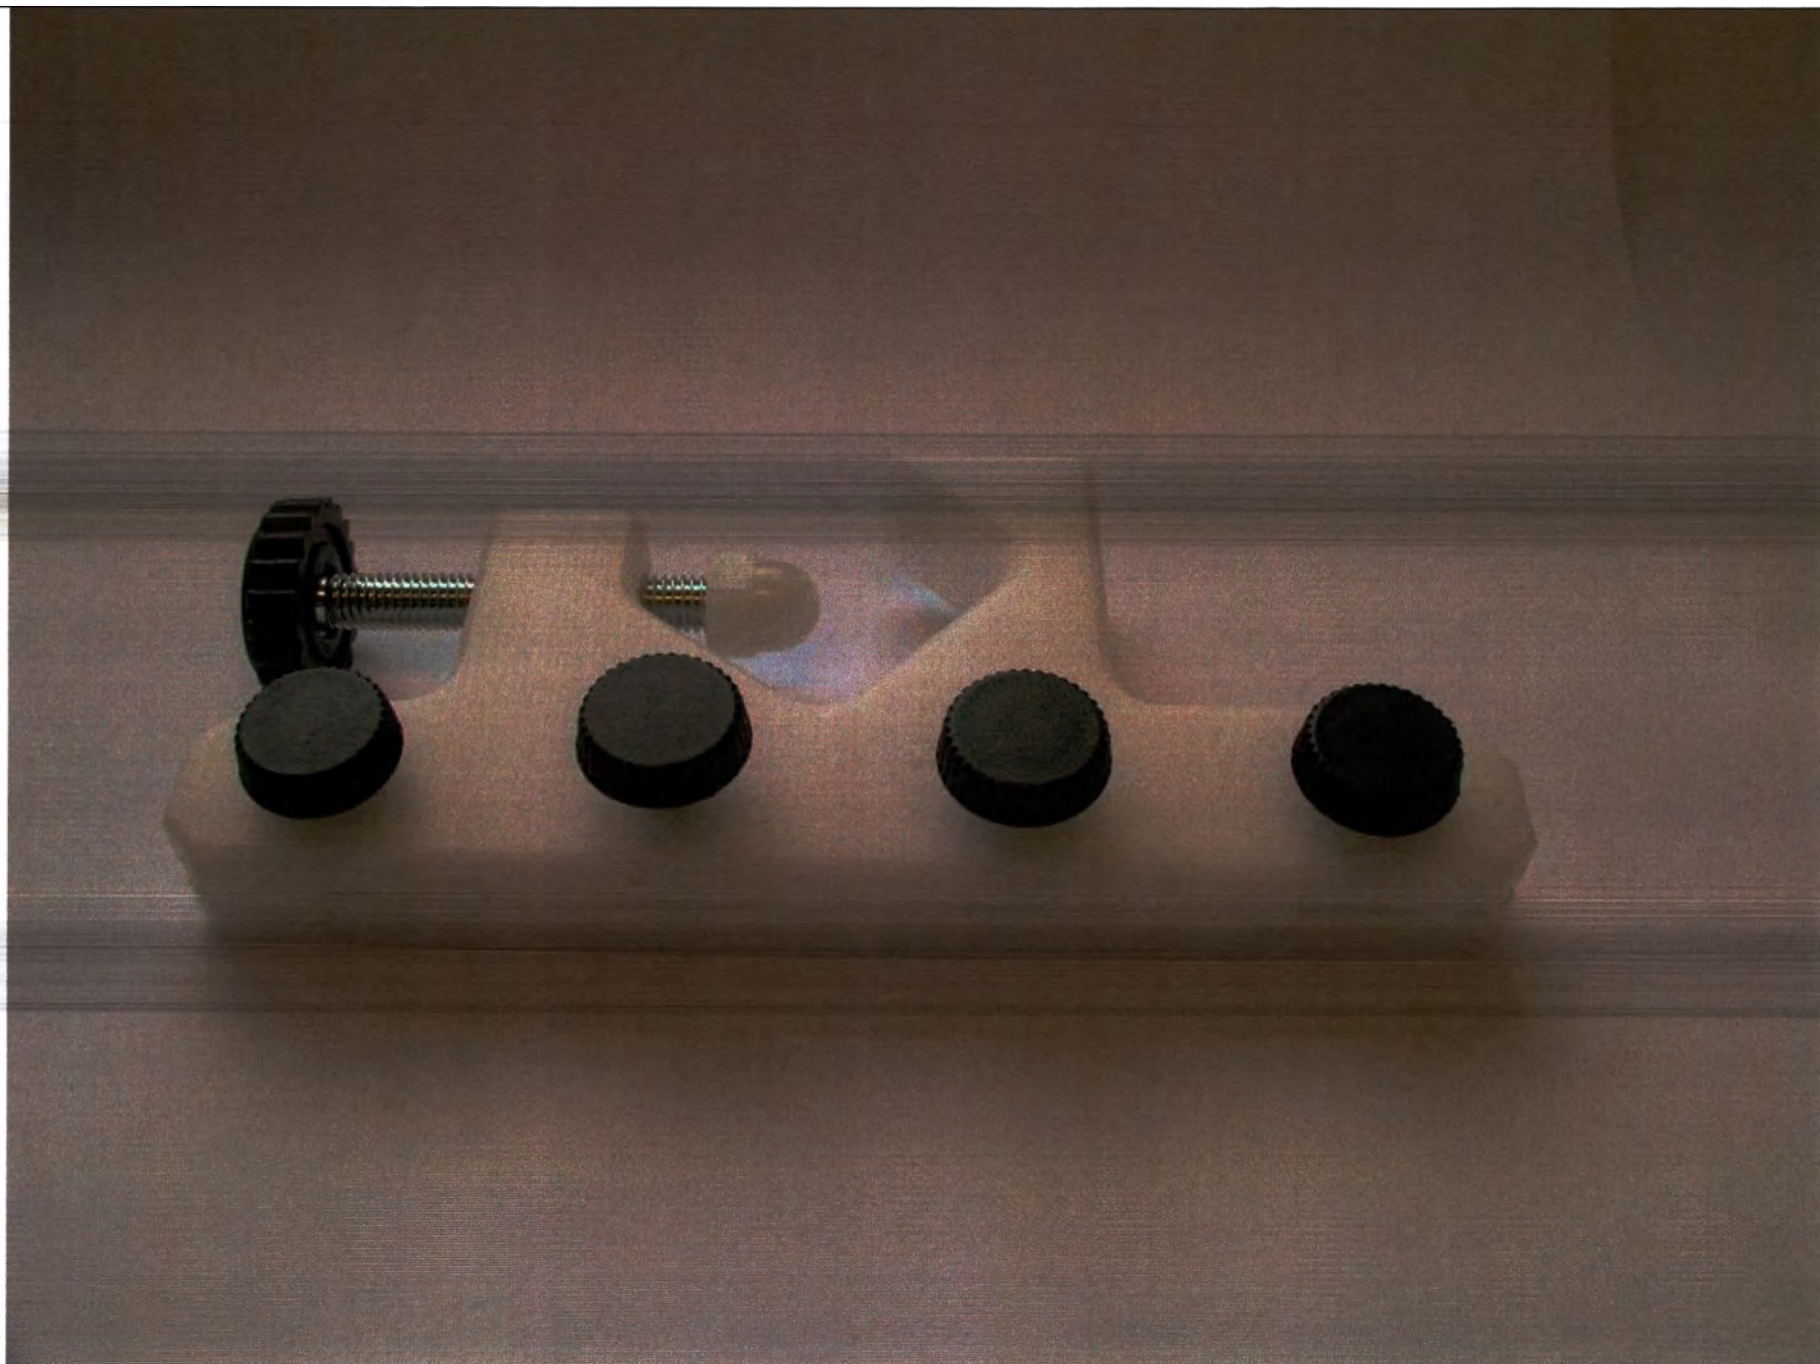

21. Адаптер измерения инвазивного давления




22. Канюли для капнографии (от 1 до 20 упаковок).

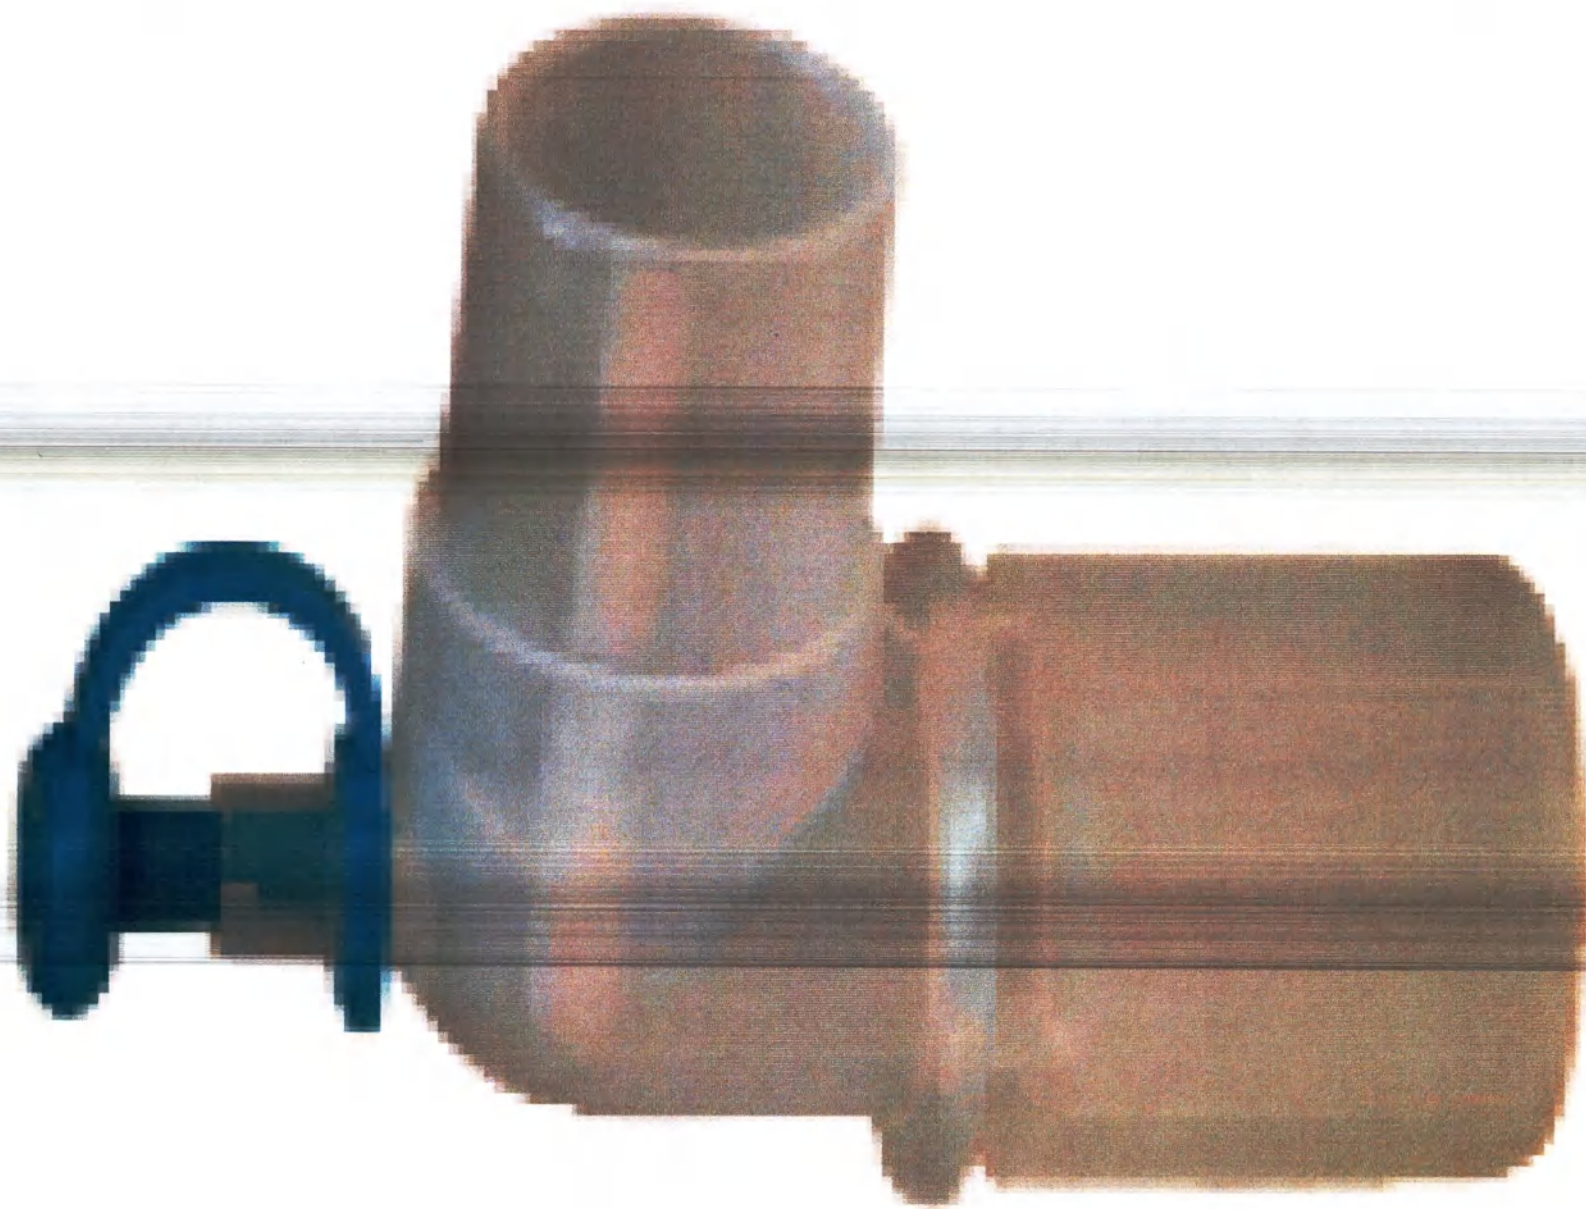

23. Адаптеры воздушных путей (от 1 до 10 упаковок).



24. Линии отбора образцов для капнографии (от 1 до 5 упаковок).

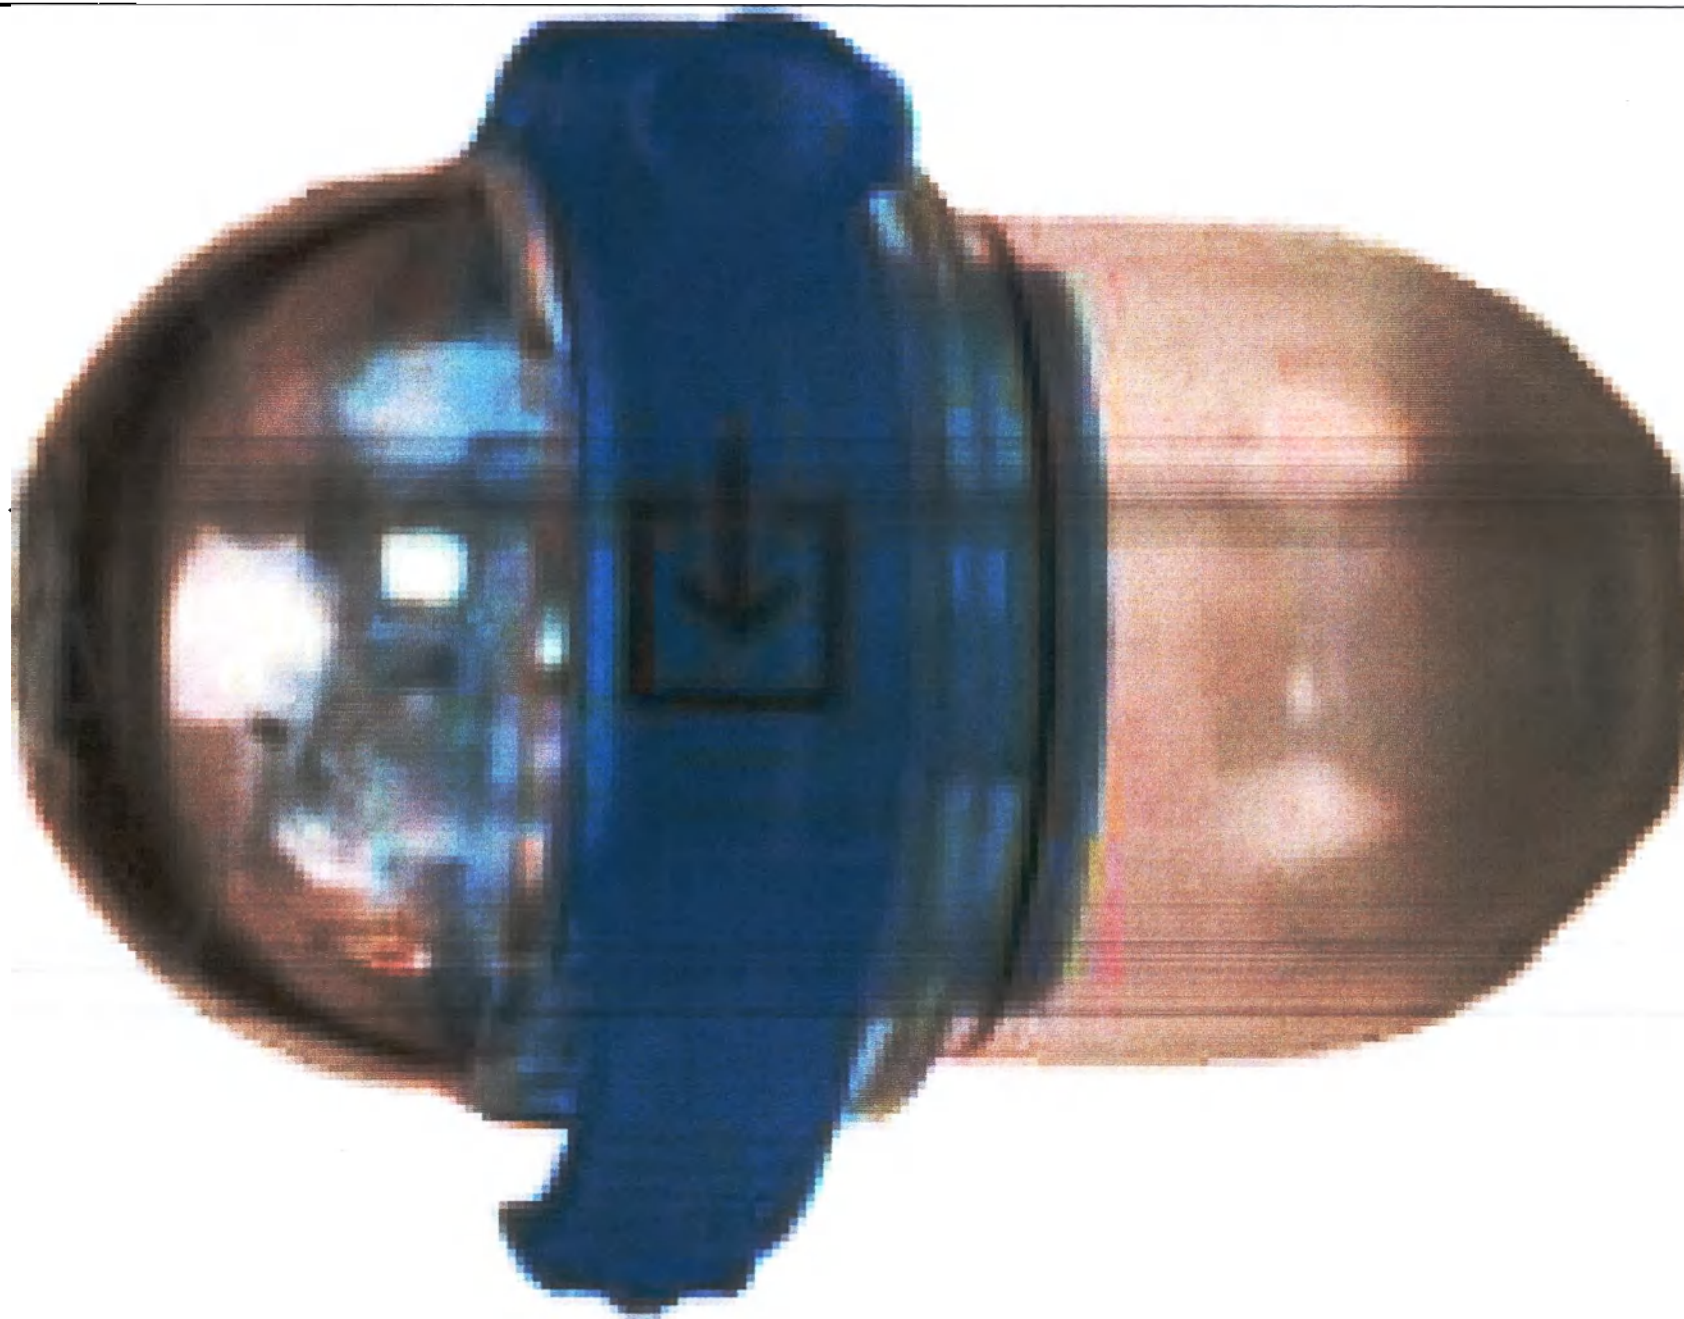


25. Водяные ловушки для капнографии (от 1 до 5 упаковок).



26. Линии для отбора образцов анестетиков (от 1 до .5 упаковок).



27. Водяные ловушки для анестетиков (от 1 до 5 упаковок).

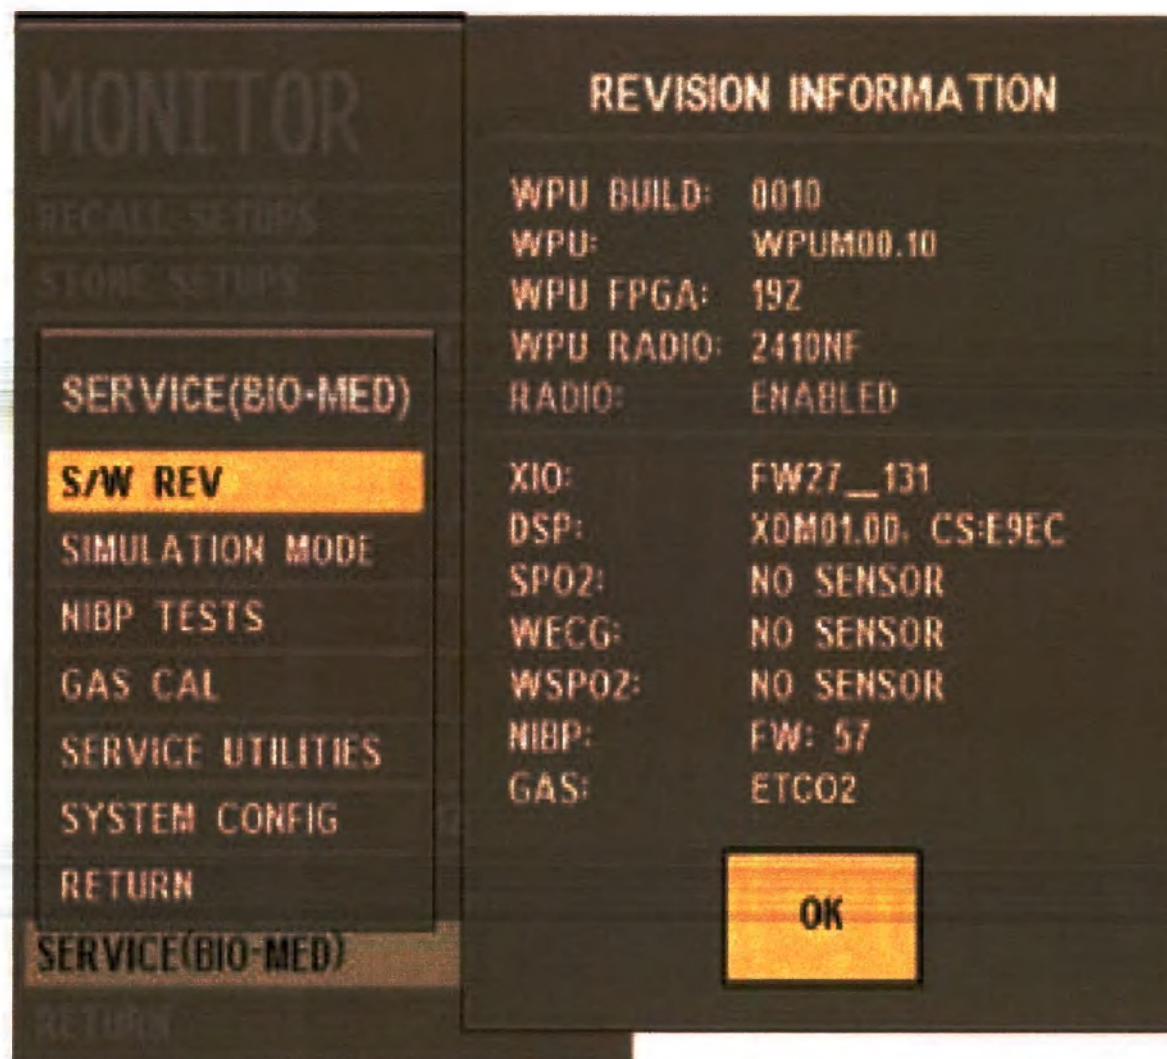


S/W REV



29. Запоминающие устройства на магнитных дисках, дискетах; ПЗУ; лазерных оптических дисках, флеш-картах (от 1 до 30



30.а. Гель для пациента (от 1 до 30 бутылок).

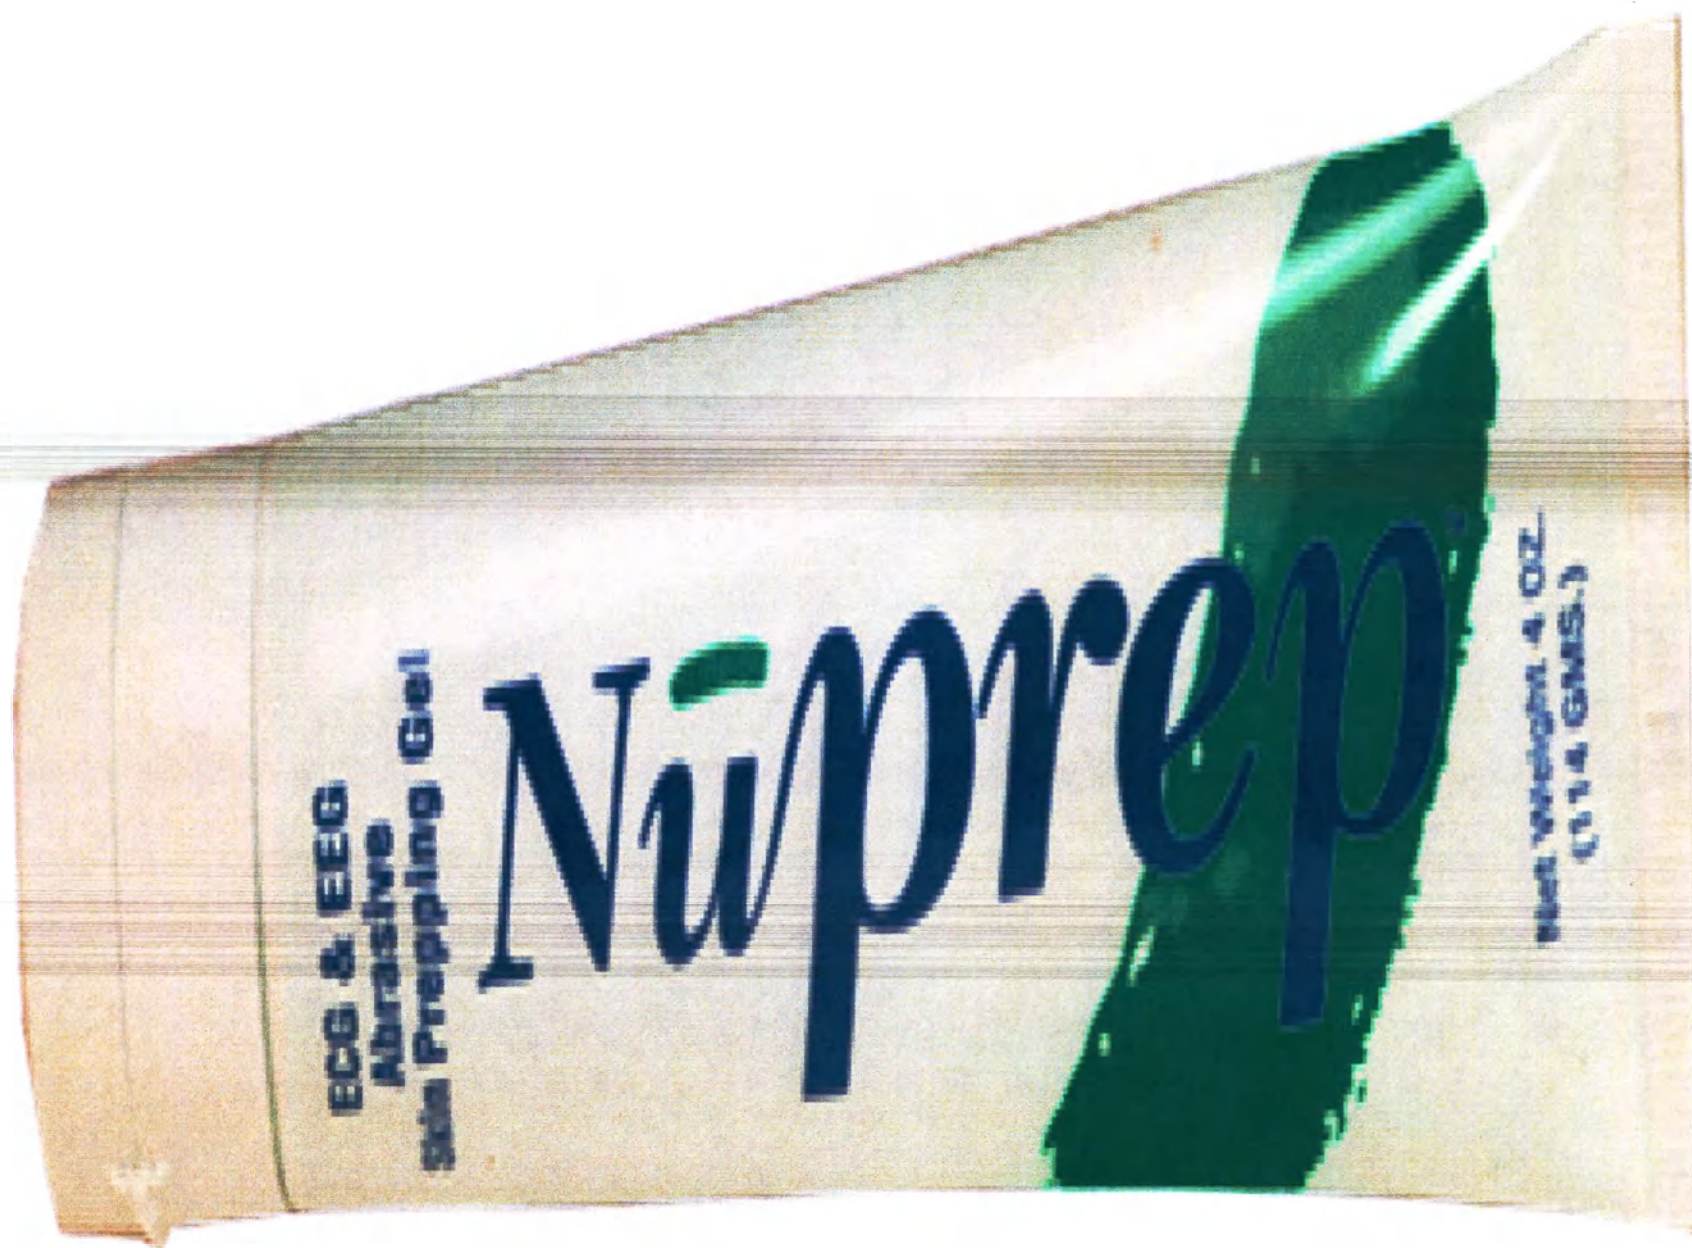

30.б. Гель для пациента (от 1 до 30 бутылок).


PHILIPS

Система мониторинга пациента во время МРТ Expression MR200

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Версия Е

На русском языке

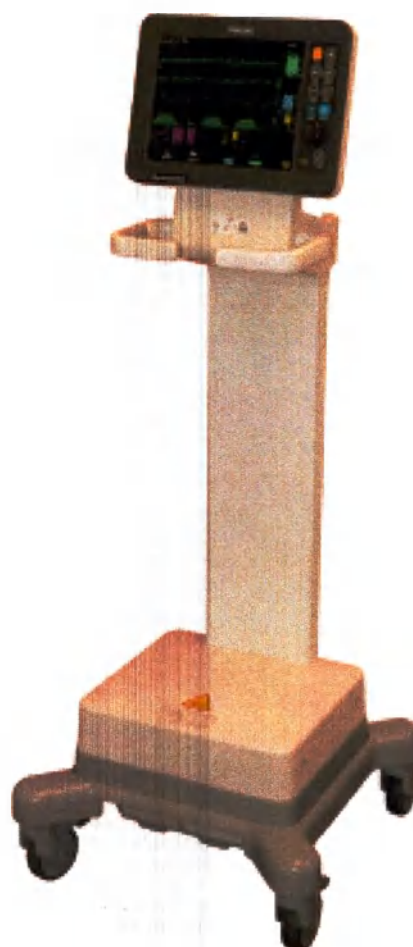

989403190951

31a. Инструкция для пользователя на электронных носителях.


Expression MR400

Система мониторинга пациента во время МРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Версия E

На русском языке

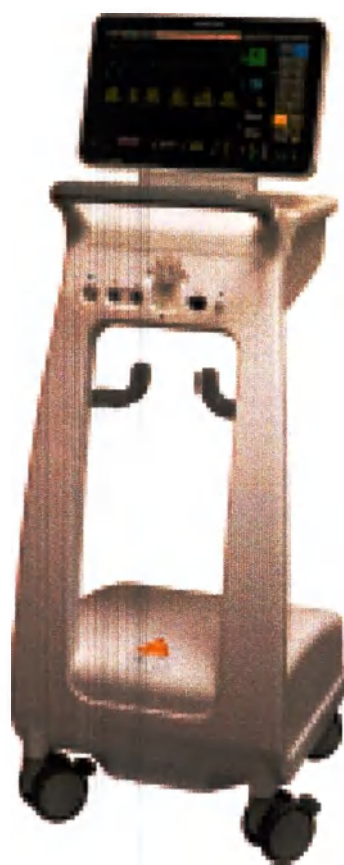

PHILIPS

316. Инструкция для пользователя на электронных носителях.


Expression MR

Assembled for Invivo
a division of Philips Medical Systems
12151 Research Parkway
Orlando, FL 32826 U.S.A.

REF 989803178181

FlexTEMP System, Jacket

To Reorder:
www.philips.com/healthcarestore



EC REP

Philips Medizin Systeme
Böblingen GmbH
Hewlett-Packard-Str.2
71034 Böblingen
Germany

Made in U.S.A.

STERILE

R


LOT

315901



2018-09-14


32. Защитные чехлы для датчика температуры (от 1 до 5 упаковок).

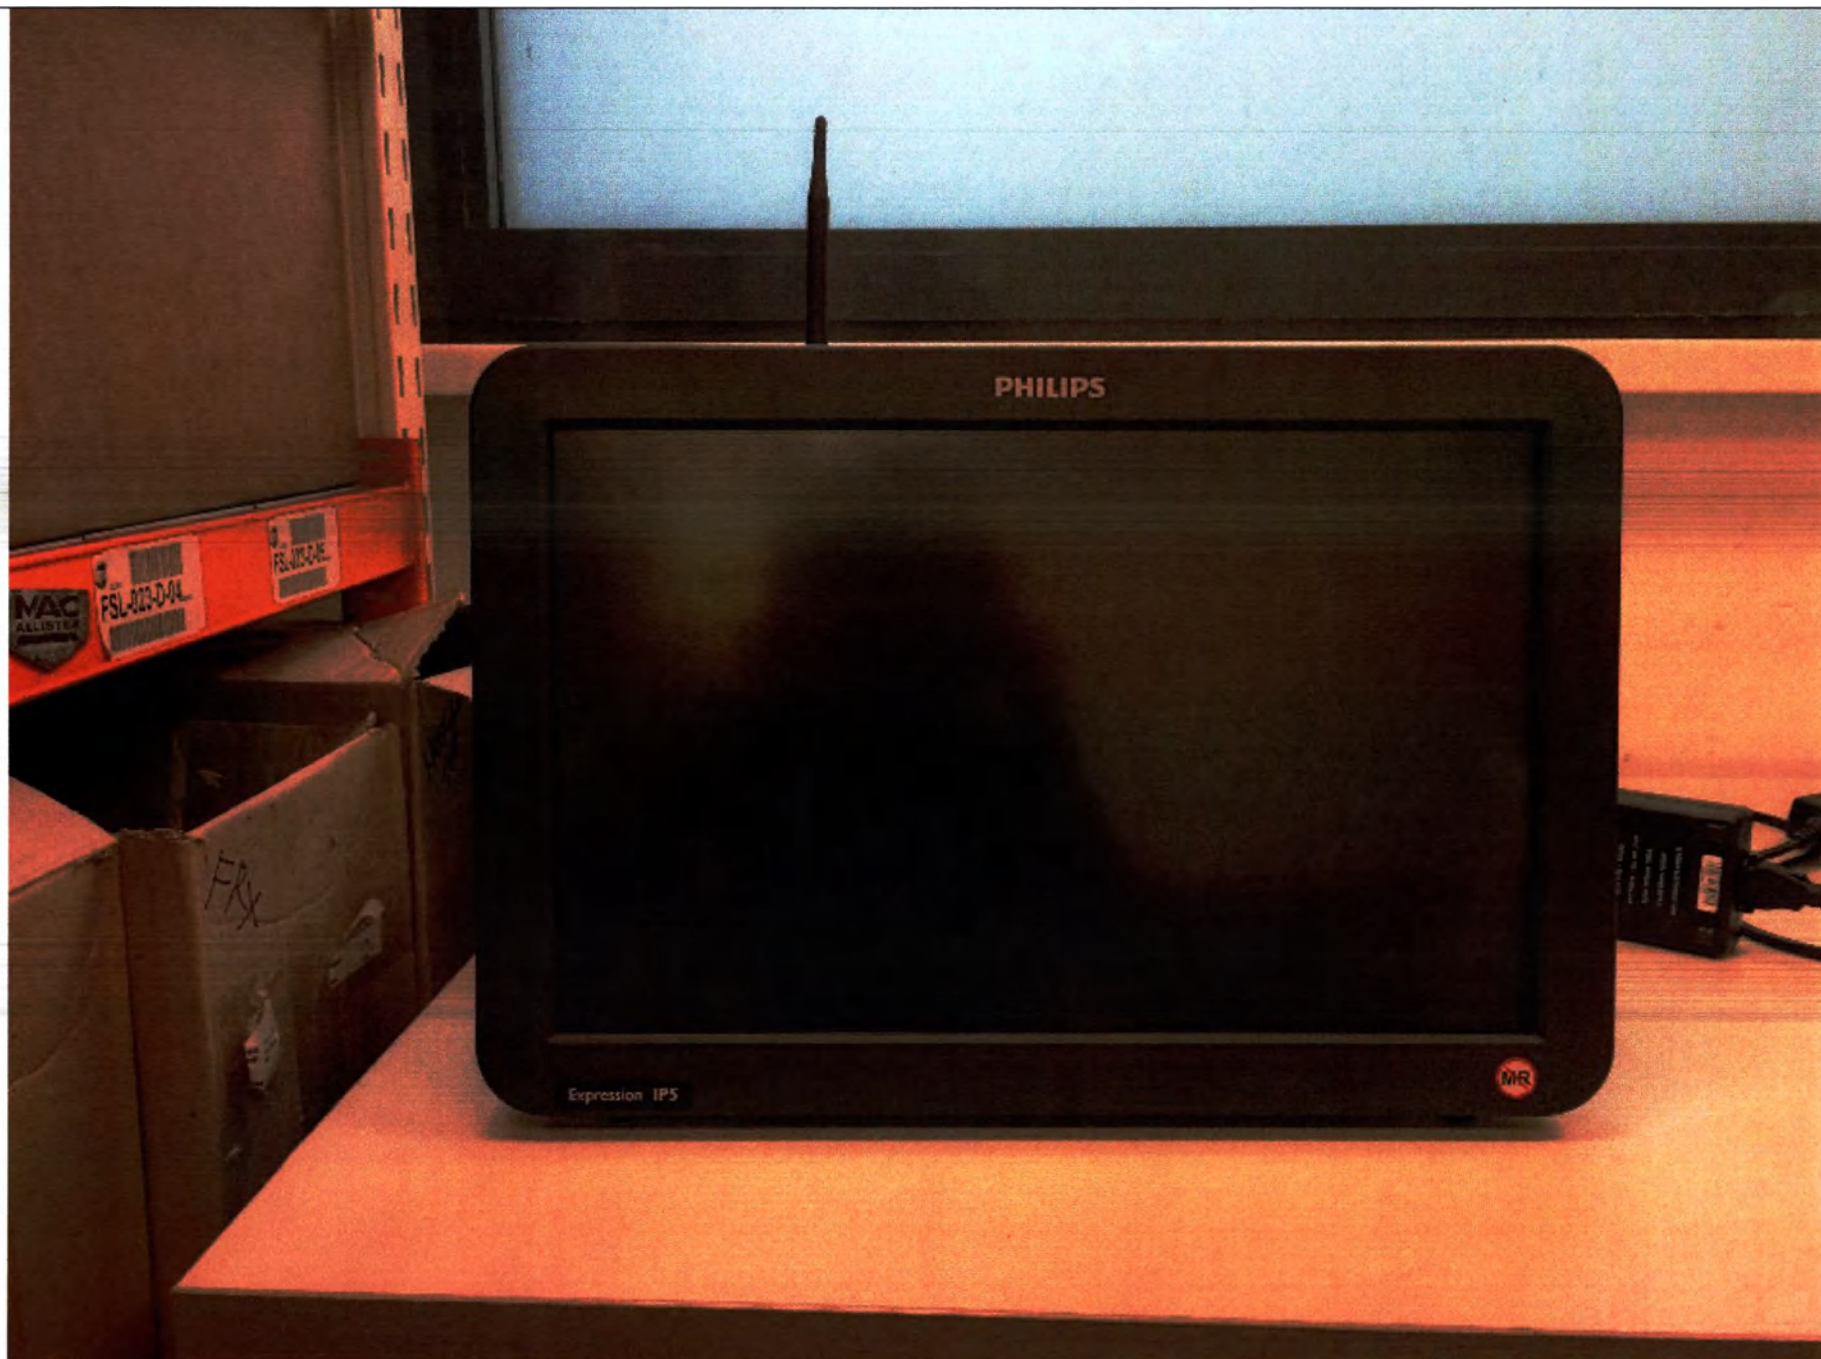

33.а. Информационный портал Expression IP5



33.6. Информационный портал Expression IP5

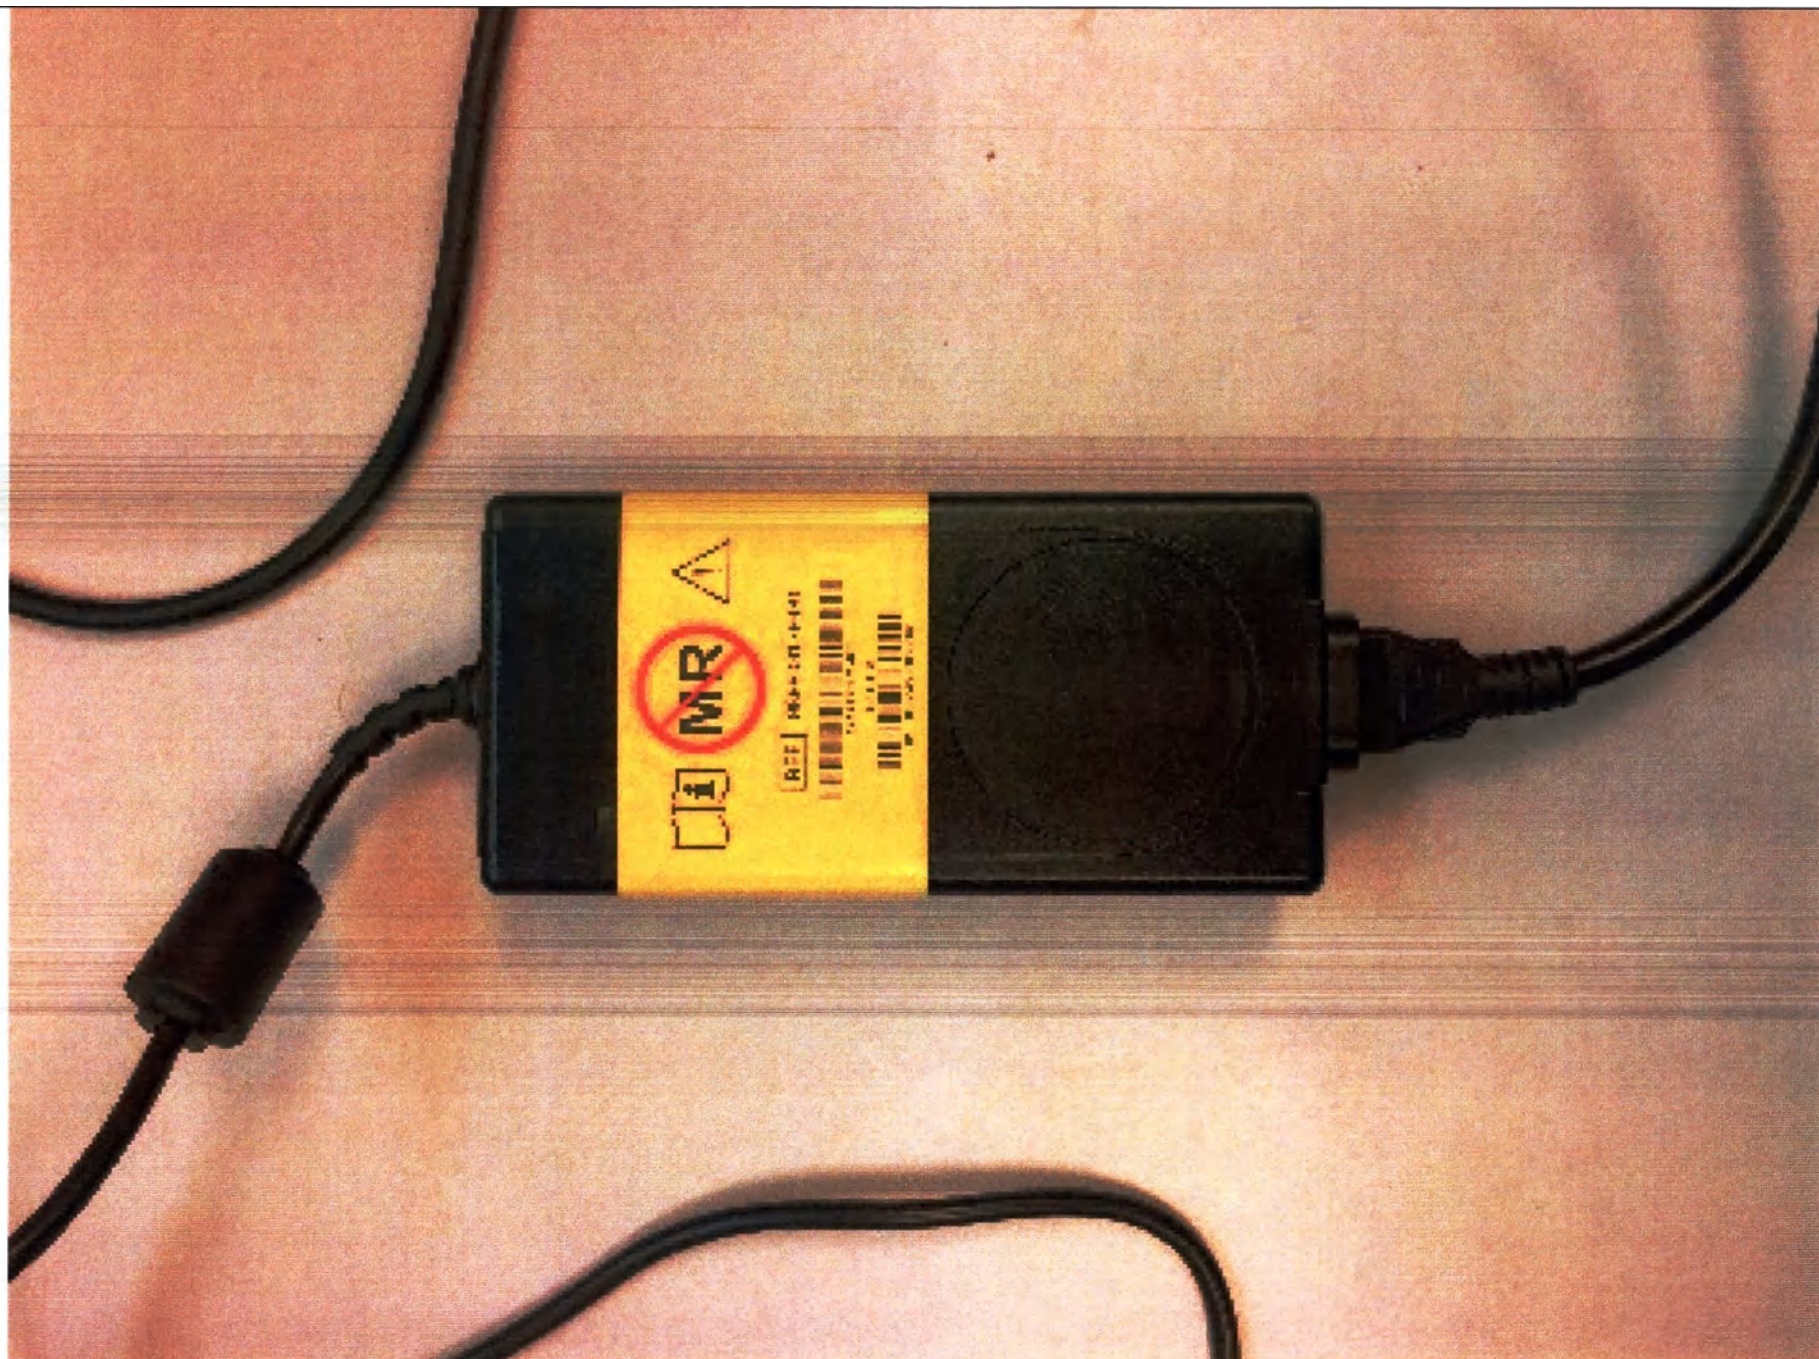

33.в. Информационный портал Expression IP5



34.а. Информационный портал MR Patient Care Portal 5000: настольный блок




34.б. Информационный портал MR Patient Care Portal 5000: сенсорный дисплей



34.в. Информационный портал MR Patient Care Portal 5000: радиомодуль



34.2. Информационный портал MR Patient Care Portal 5000: блок питания

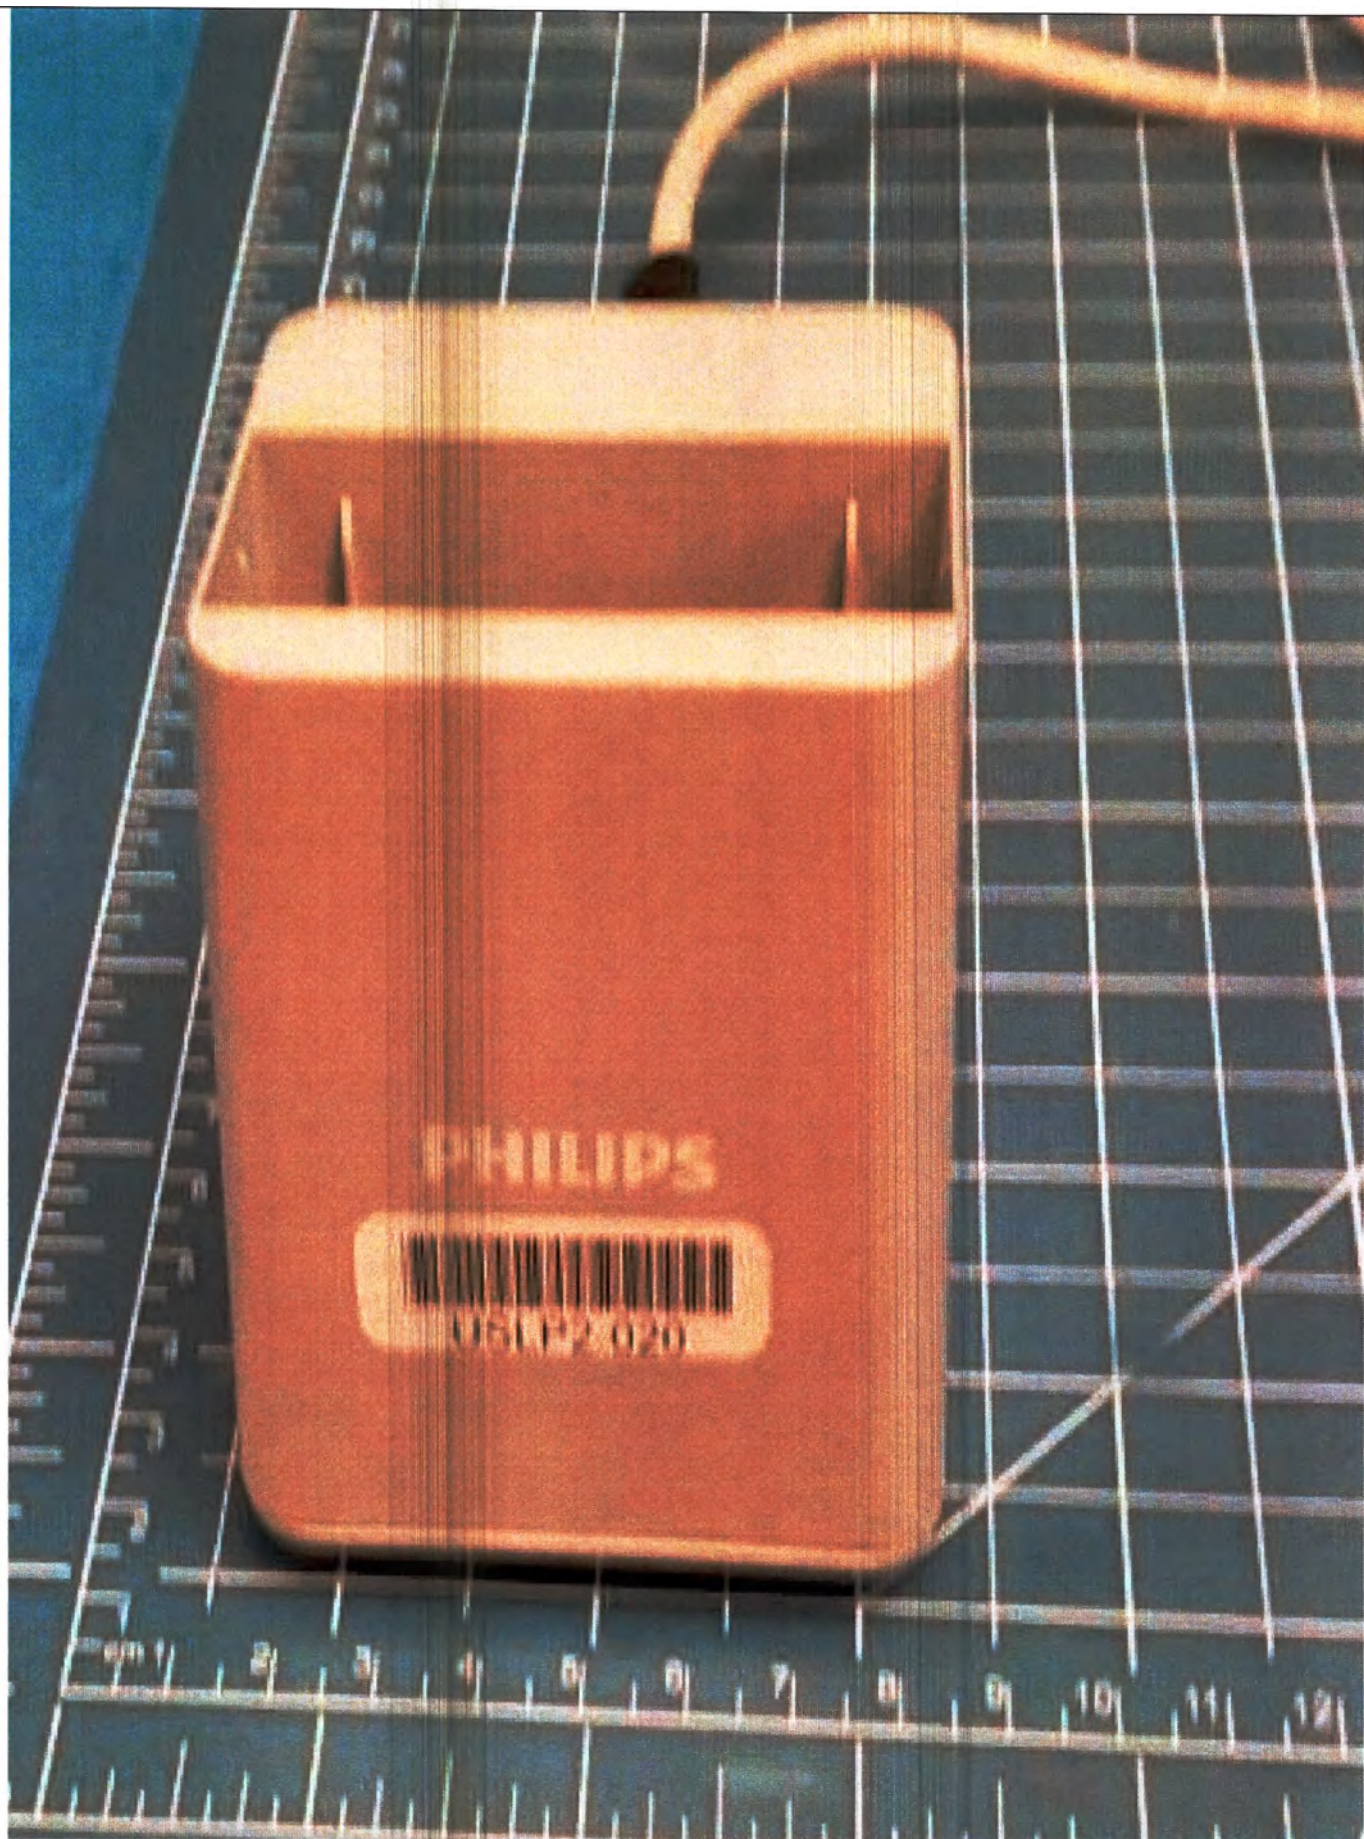

34.д. Информационный портал MR Patient Care Portal 5000: подставка для радиомодуля



35. Считыватель штрих-кода.



Assembled for Invivo,
a division of Philips Medical Systems
12151 Research Parkway, Orlando, FL 32826 USA

YYYY-MM-DD

Made in USA

Expression MR200

MRI Patient Monitoring System

REF



000000000000

SN



0000000000



CE 0413
0979

Rx Only
IPX1


Mass: 38.5 kg

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

CONTAINS FCC ID: HSW-2410NF
AND IC: 4492A-2410NF



005WWCA0080

007-AA0048

CE 0889

FCC ID: S6WDR3160BAS
IC: 6331A-DR3160



Philips Medizin Systeme
Böblingen GmbH
Hewlett-Packard-Str.2
71034 Böblingen, Germany

Система мониторинга пациента во время MRT Expression

Собрано для «Инвиво, подразделение Филипс Меликал Системс»

12151 Ресерч Парквэй, Орландо, Флорида 32826, США

Изготовлено в США

Модель: Expression MR400

Дата производства, серийный номер: см. маркировку изделия

Размеры, масса, номинальная мощность:



IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

EAC

PHILIPS



Assembled for Invivo, a division of Philips Medical Systems
12151 Research Parkway, Orlando, FL 32826 USA

Expression MR200

MRI Patient Monitoring System

Reorder number

REF 866120

GS1-128






(01) 00884838033764



0413

R_x only

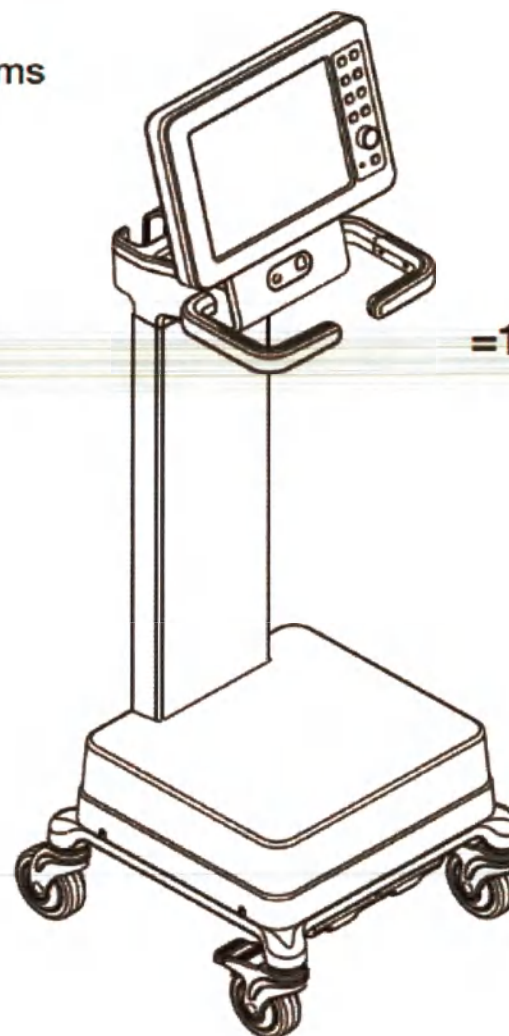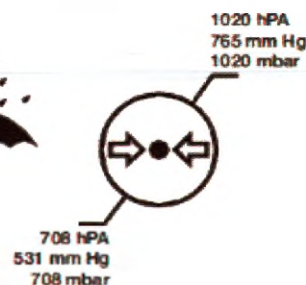


=1

To Order: US: (877) 468-4861

Made in USA

1.6. Маркировка на системе Expression MR200



Assembled for Invivo,
a division of Philips Medical Systems
12151 Research Parkway, Orlando, FL 32826 USA

YYYY-MM-DD Made in USA

Expression Model MR400
MRI Patient Monitoring System

REF



866185

SN



0000000000



E359677



CE 0413
0979

Rx Only
IP20

Mass: 50.2 kg

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Contains FCC ID:
and IC:

HSW-2410NF
4492A-2410NF

IC: 6331A-MR400

EC REP

CE 0889
Philips Medizin Systeme
Böblingen GmbH
Hewlett-Packard-Str.2
71034 Böblingen, Germany

FCC ID: S6WMR400

Система мониторинга пациента во время МРТ Expression

Собрано для «Инвиво, подразделение Филипс Меликал Системс»

12151 Ресерч Парквэй, Орландо, Флорида 32826, США

Изготовлено в США

Модель: Expression MR200

Дата производства, серийный номер: см. маркировку изделия

Размеры, масса, номинальная мощность: 

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

PHILIPS



Assembled for Invivo, a division of Philips Medical Systems
12151 Research Parkway, Orlando, FL 32826 USA

Expression Model **MR400** MRI Patient Monitoring System

Reorder number

REF 866185

GS1-128





(01) 00884838039131



0413

R_x only




15% NC



708 hPa
531 mm Hg
708 mbar



1020 hPa
765 mm Hg
1020 mbar

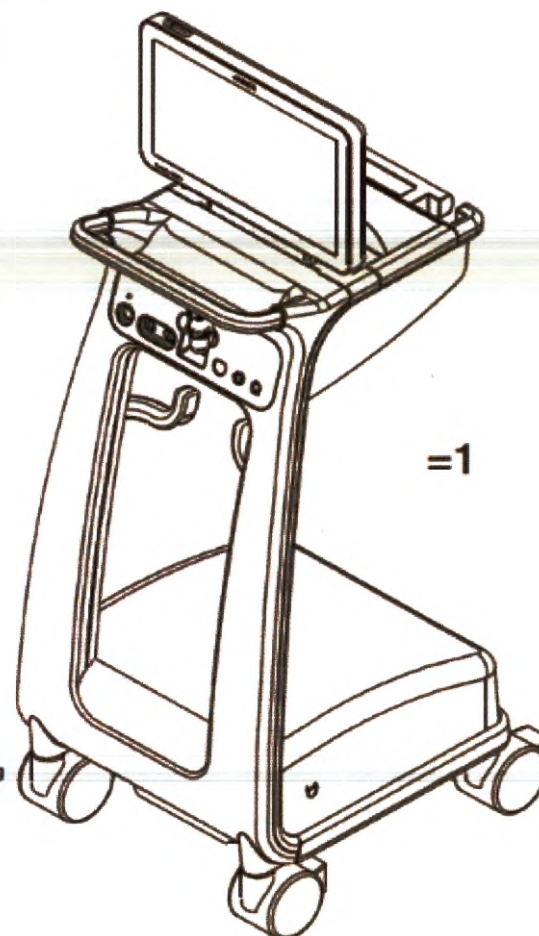

=1

To Order: US: (877) 468-4861

Made in USA

2.6. Маркировка на системе Expression MR400

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 79 листа (ов)

ООО «Филипс»

