



Фотографические изображения

Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube), в вариантах исполнения 50/1200 штук

Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube),
вариант исполнения 50 штук
(общий вид)

Roche Cell-Free DNA Collection Tube

 **50** (16x100mm)  **IVD**  15°C 25°C   **REF** (240) 07785666001  **GTIN** (01)07613336102411  **UDI** 

 **STERILE**  **Rx Only**

 **WARNING**
H315, H317, H318, H335,
P261, P284, P280,
P304 + P340 + P312,
P333 + P313, P337 + P313

 <http://sequencing.roche.com/dne-collection.html>  **EC REP**
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
Germany 

 **LOT** (10) A23063BG
 2024-11-30[®]
 2023-06-01


 **Roche** Manufactured for
Roche Molecular Systems, Inc.
1080 US Highway 202 South
Branchburg, NJ 08876 USA

09396900001-03

Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube),
вариант исполнения 50 штук
(общий вид)



Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube),
вариант исполнения 50 штук
(общий вид)

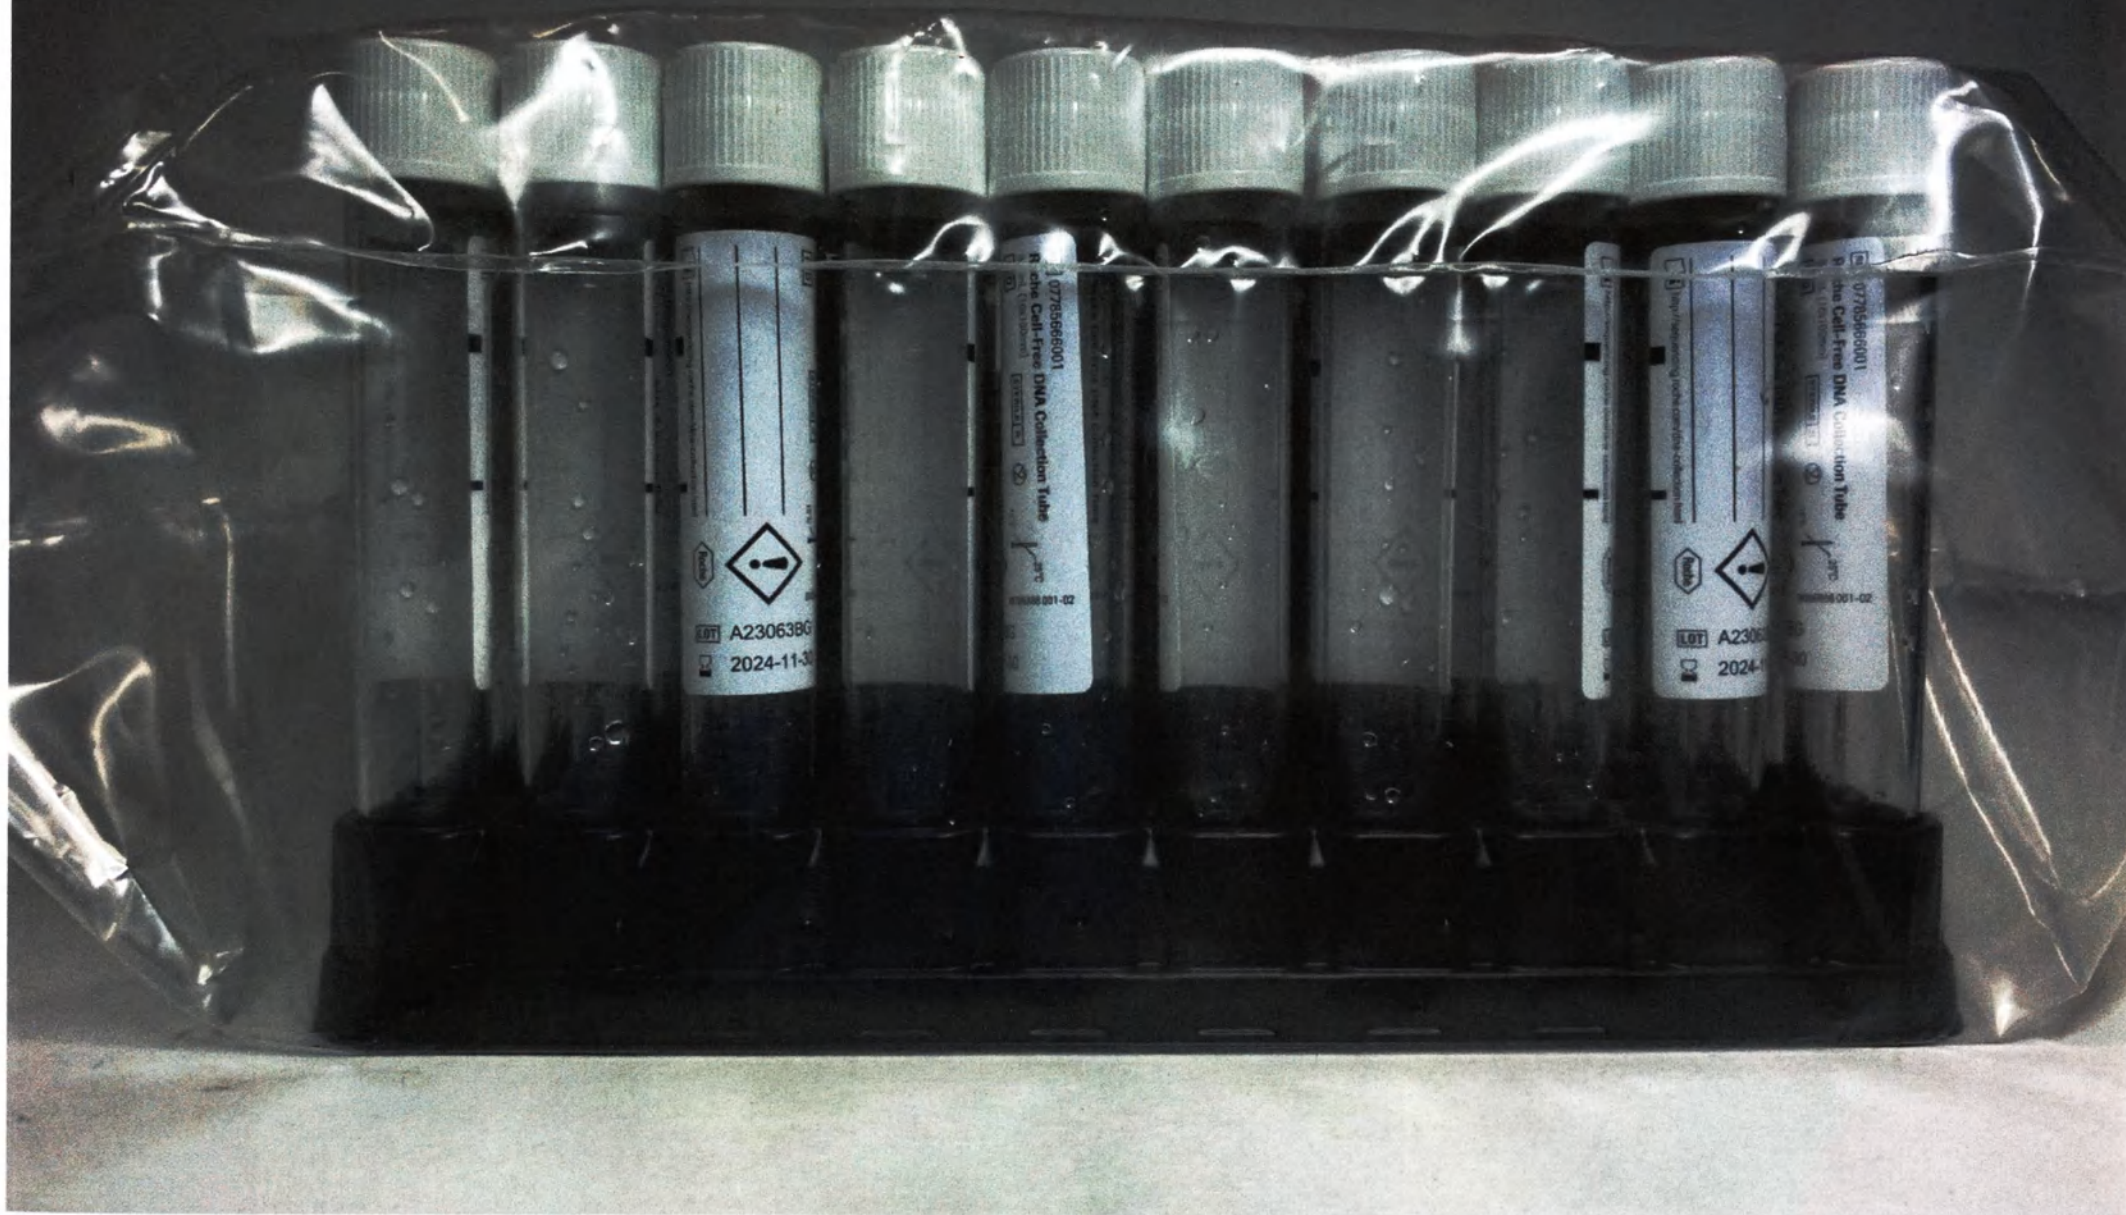

Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube),
вариант исполнения 50 штук
(общий вид)



**Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube),
вариант исполнения 50 штук
(общий вид)**



Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube),
вариант исполнения 50 штук
Макет маркировки на русском

Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной
ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube), вариант исполнения 50 штук

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7584 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Molecular Systems, Inc», 1080 US Highway 202 South,
Branchburg, NJ, 08876, United States


Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с
ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика
Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495
229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется
отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на
территории РФ, контакты см. выше).

Кат. номер 07785666001


Сборка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube), вариант исполнения 50 штук

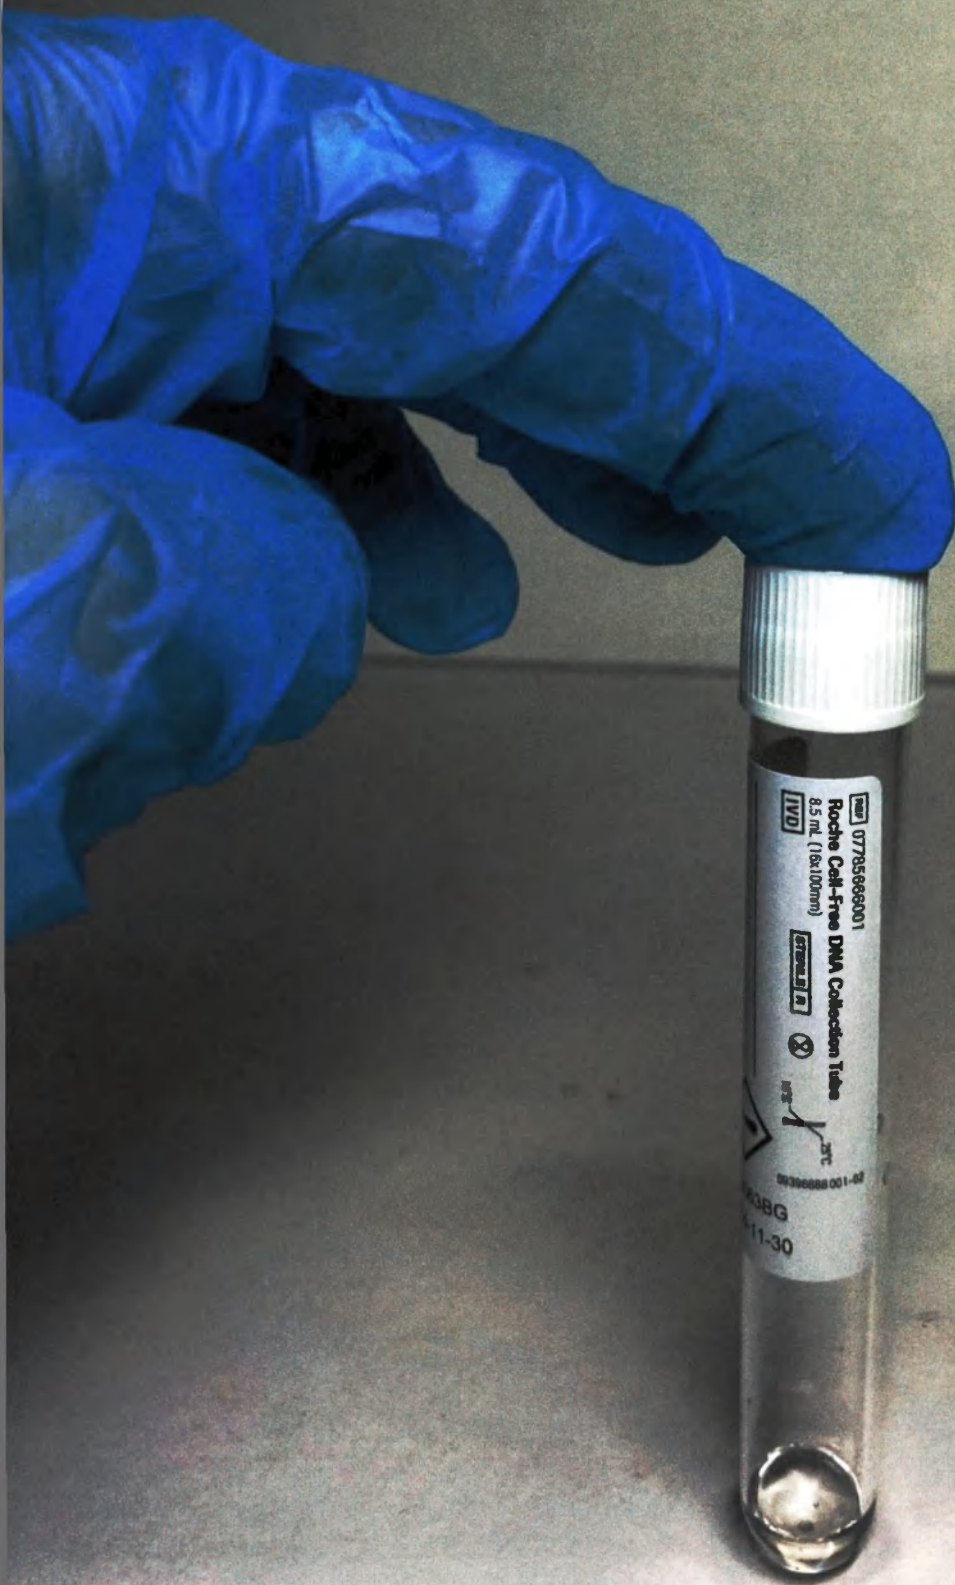

Сборка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Vacuette Cell-Free DNA Collection Tube), вариант исполнения 50 штук



Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube),
вариант исполнения 1200 штук
(общий вид)

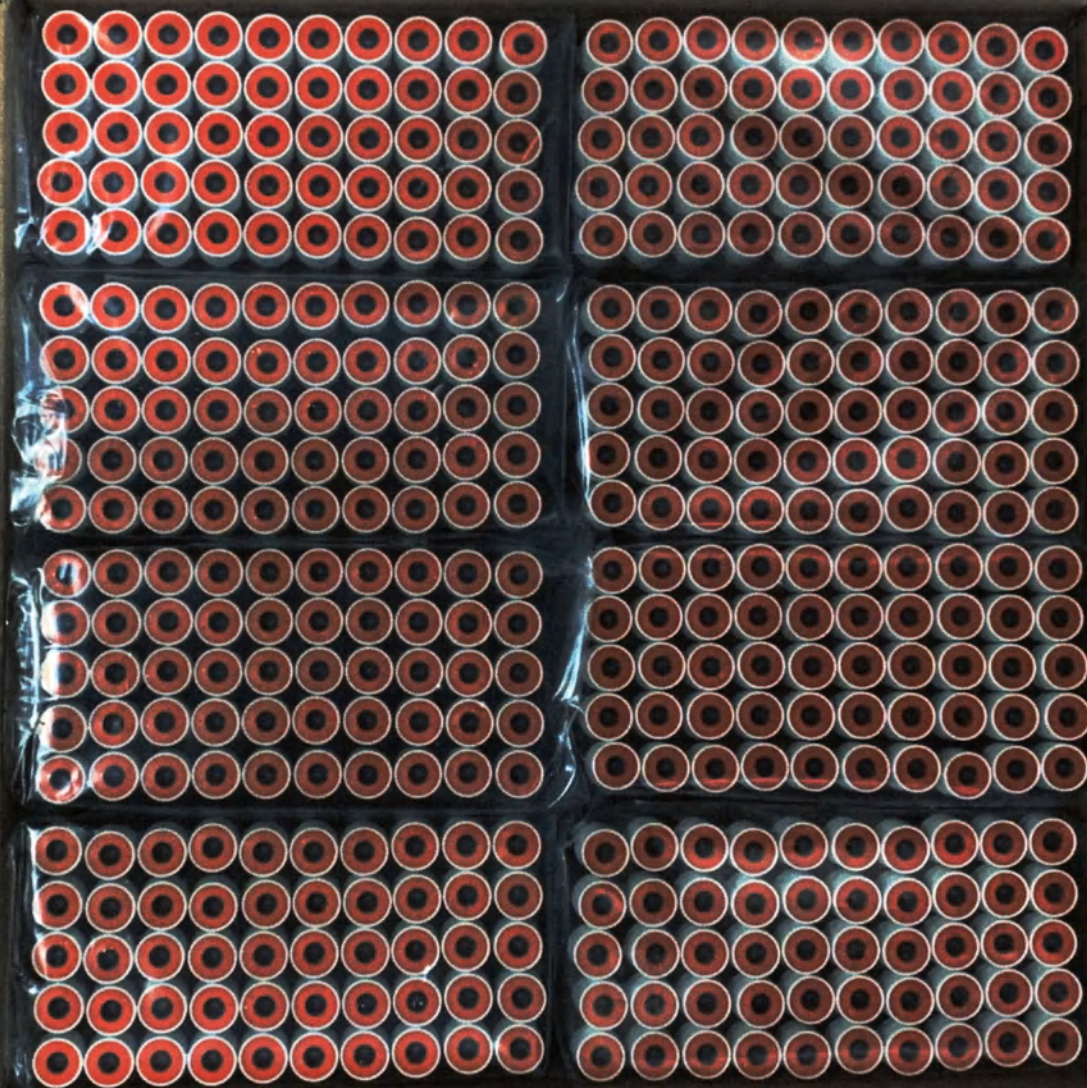

Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube),
вариант исполнения 1200 штук
(общий вид)

Roche Cell-Free DNA Collection Tube

 50 (16x100mm)

IVD

15°C 25°C



STERILE R

Rx Only

REF (240) 07785666001

GTIN (01)07613336102411

UDI



WARNING

H315, H317, H319, H335,
P281, P284, P280,
P304 + P340 + P312,
P333 + P313, P337 + P313



<http://sequencing.roche.com/dna-collection.html>



Manufactured for
Roche Molecular Systems, Inc.
1080 US Highway 202 South
Branchburg, NJ 08876 USA

EC REP

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
Germany



LOT (10) A2301398



2024-06-30




2023-01-01

08396900001-03


Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube),
вариант исполнения 1200 штук
(общий вид)



Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube),
вариант исполнения 1200 штук
(общий вид)

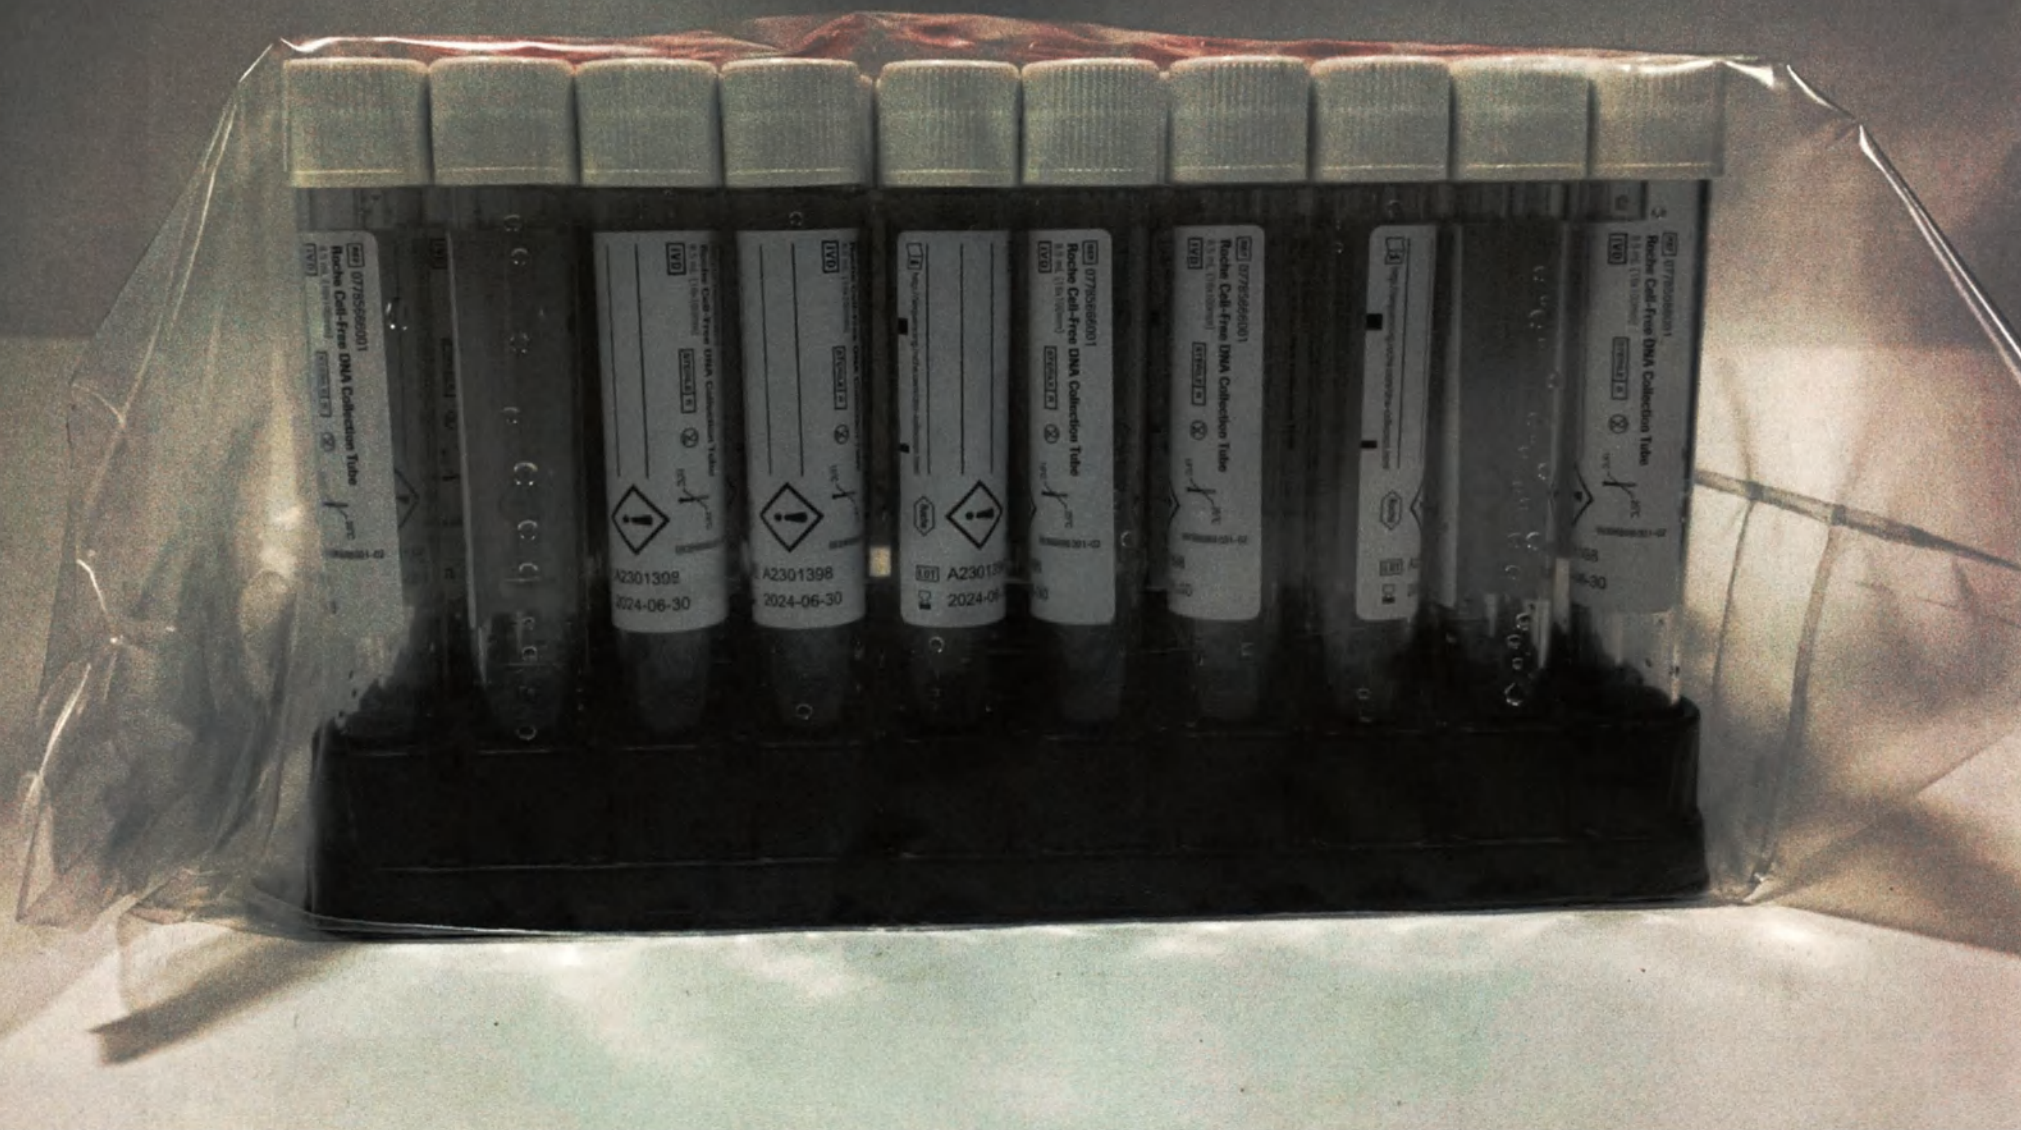

Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube),
вариант исполнения 1200 штук
(общий вид)

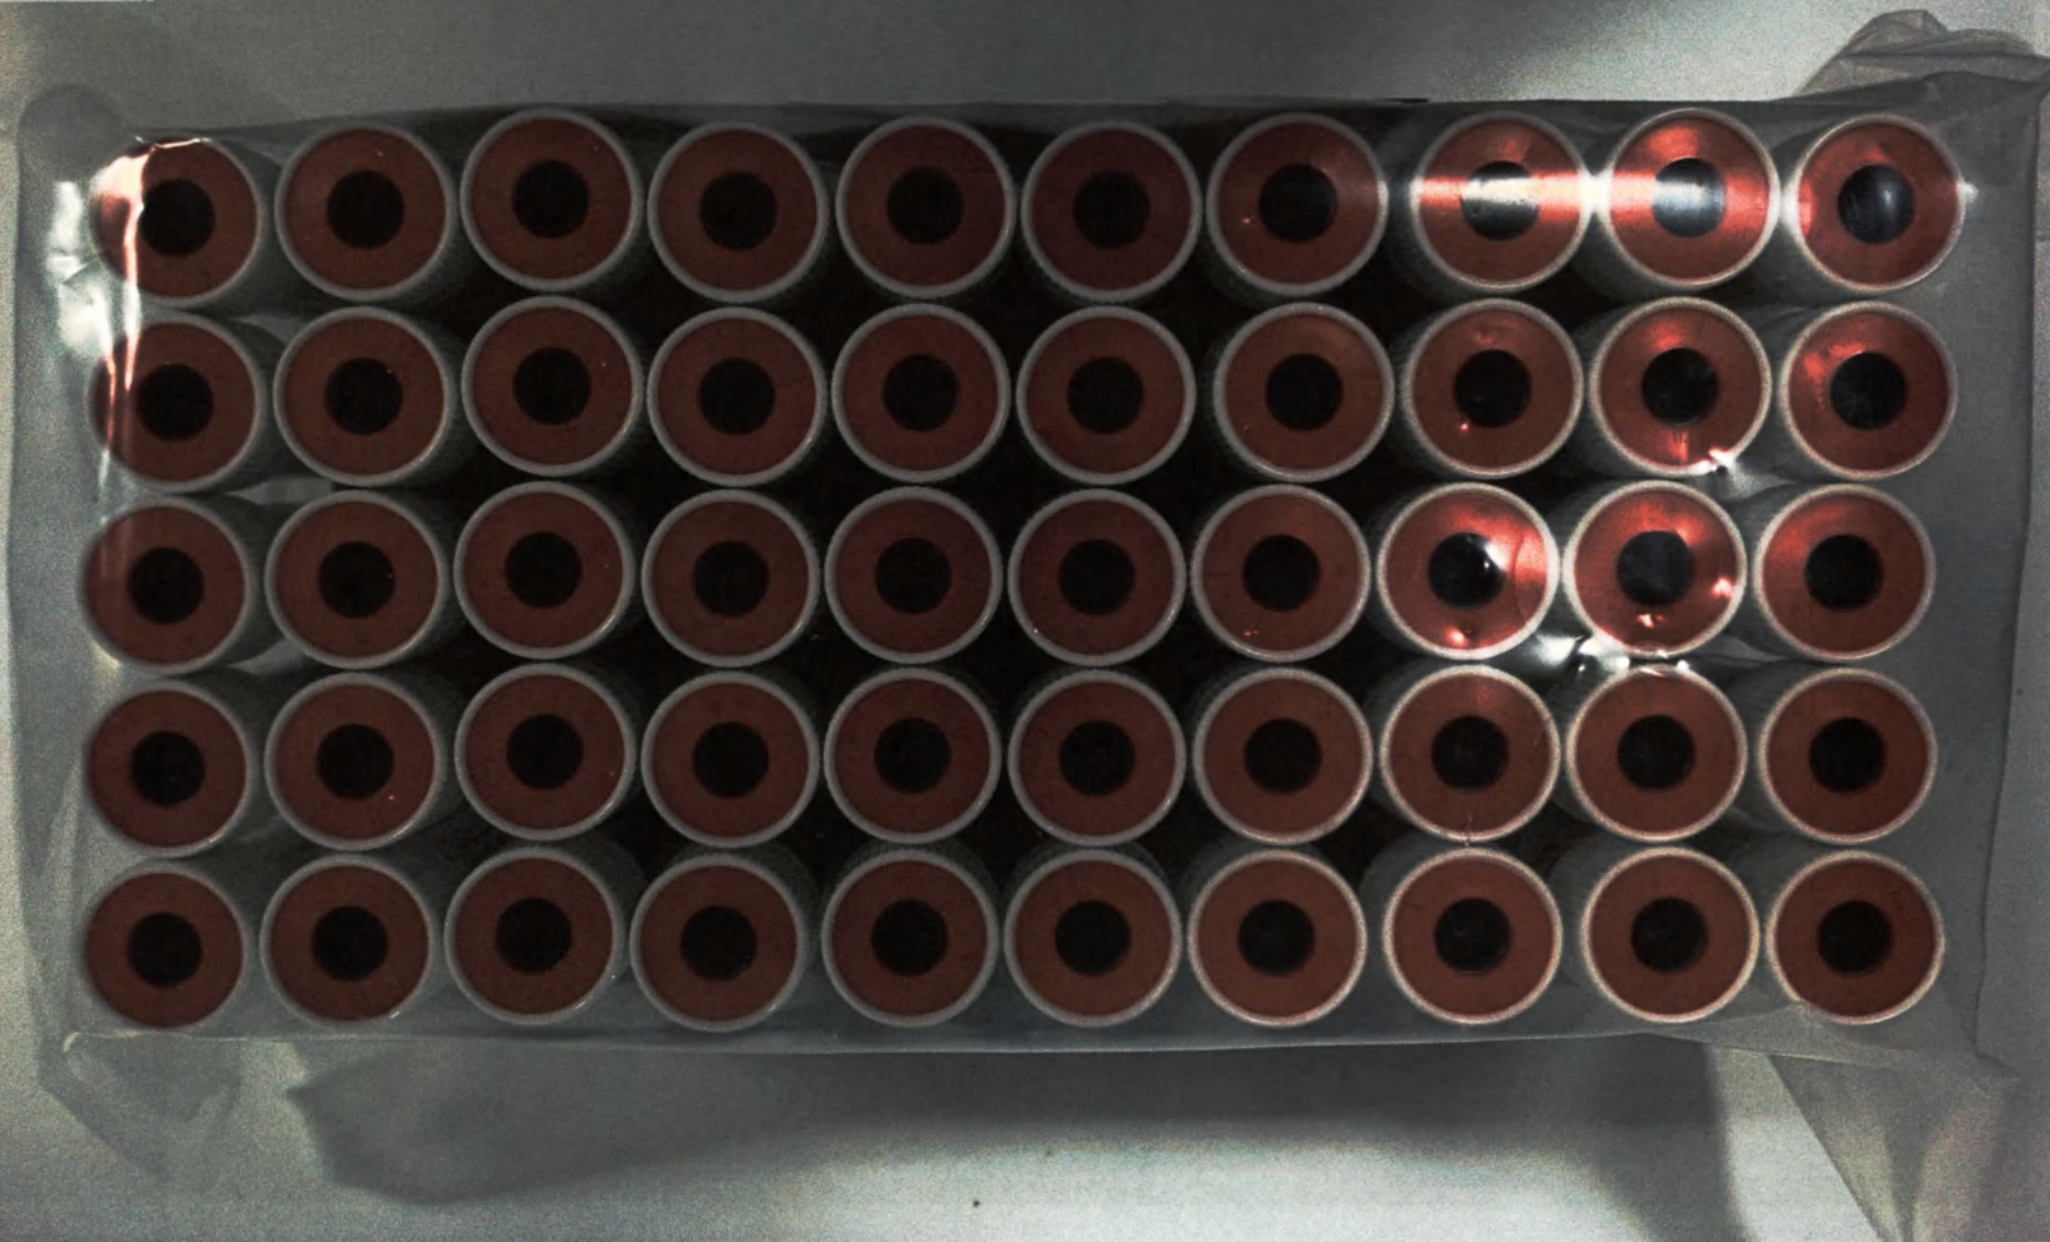

Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube),
вариант исполнения 1200 штук
Макет маркировки на русском

Пробирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной
ДНК (Roche Cell-Free DNA Collection Tube), вариант исполнения 1200 штук

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7584 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Molecular Systems, Inc», 1080 US Highway 202 South,
Branchburg, NJ, 08876, United States

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с
ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика
Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс +7 495
229-62-64 E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com


Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется
отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на
территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 07832359001

бирка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК
(the Cell-Free DNA Collection Tube), вариант исполнения 1200 штук



Трубка вакуумная стерильная для сбора образцов крови с целью анализа внеклеточной ДНК
(Cell-Free DNA Collection Tube), вариант исполнения 1200 штук

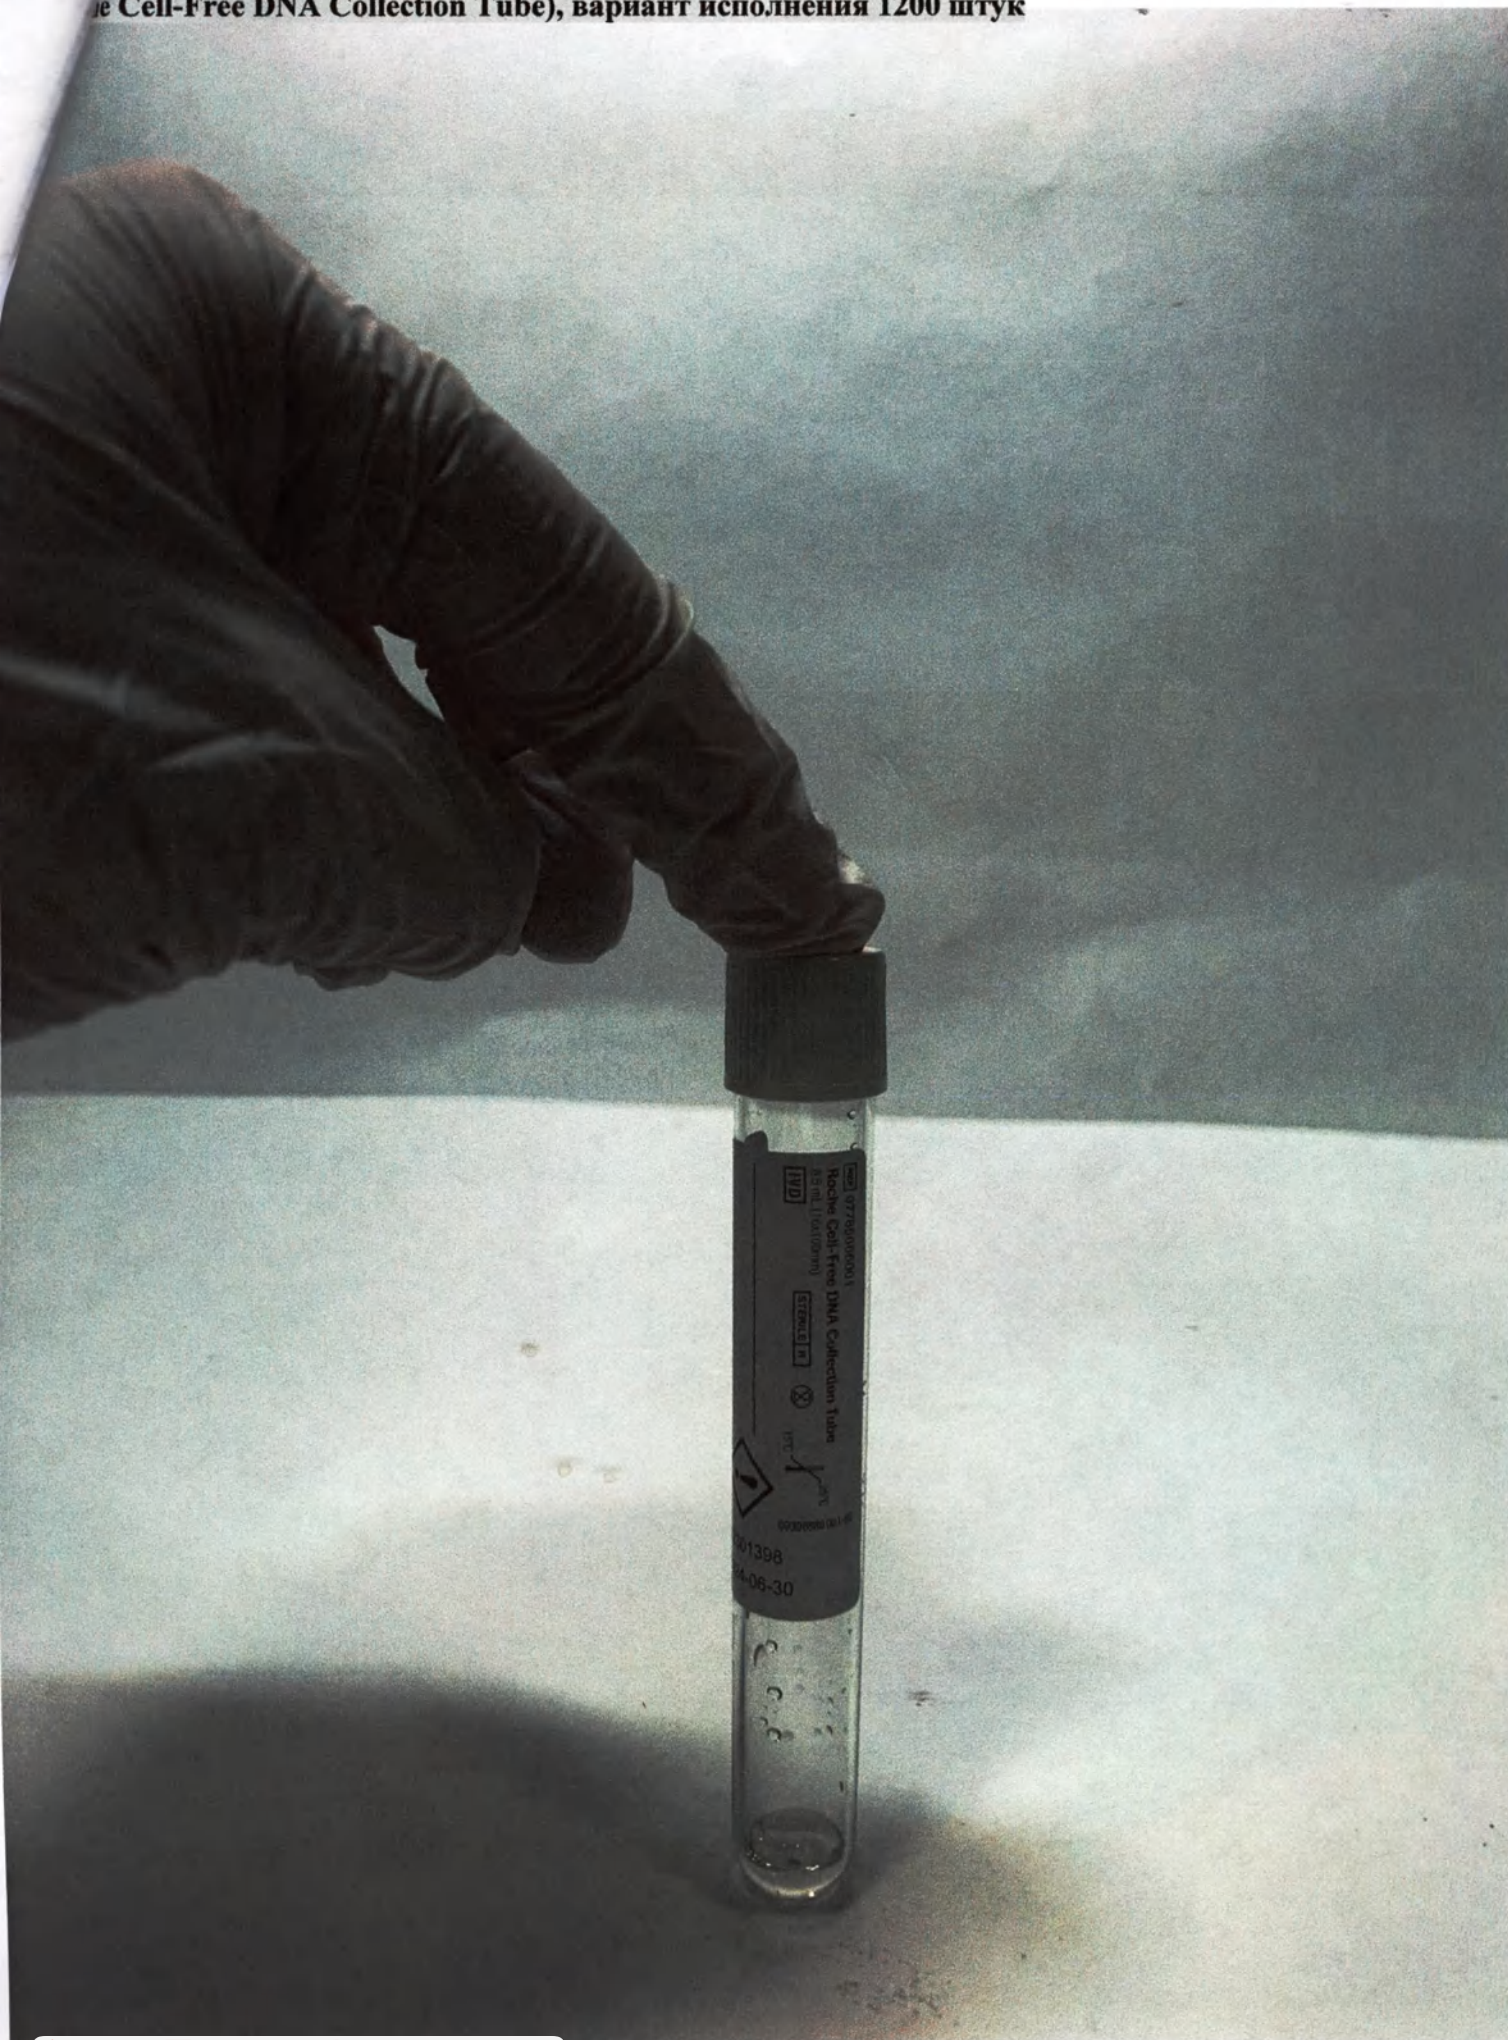

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
18 листа (ов)



по доверенности
от 30.01.2023 г.