

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сысоева Сюз Вэй.
«25» декабря 2023 г.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СЫСОЕВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

**Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики
in vitro**

Набор калибраторов для количественного определения фрагмента
цитокератина 19 (CYFRA 21-1) в клиническом образце человека
иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для
диагностики in vitro

Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»
129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,
пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А.
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39
ИНН 7705815069 КПП 770201001

mindray

CYFRA 21-1 CAL

UDI



(01)06944904091198 (97)105-005921-A0
(10)2023010111 (99)105-005921-00
(17)240205 (98)ALN202301011100031

CYFRA 21-1 Calibrators

Contents : C0: 1×2.0 mL, C1: 1×2.0 mL, C2: 1×2.0 mL



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R.China

Tel : +86-755-81888998 Fax : +86-755-26582680 www.mindray.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany


EC REP

IVD




0123

2°C



mindray

CYFRA 21-1 CAL



CYFRA 21-1 Calibrators

Калибраторы для определения CYFRA 21-1

Calibradores CYFRA 21-1

Calibradores CYFRA 21-1

Calibratori di CYFRA 21-1

CYFRA 21-1 Kalibratörleri

Calibrateurs de CYFRA 21-1



ALN202301011100031


REF 105-005921-00

LOT 2023010111



2024-02-05

047-039623-00(1.0)



IVD



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

Tel: +86-755-26582888 Fax: +86-755-26582680

Website: <http://www.mindray.com>






Визуал 4. Общий вид. Набор калибраторов для количественного определения фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21-1) в клиническом образце человека
 иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики *in vitro*



Рисунок 5. Калибратор (C0) – 1 фл. х 2,0 мл; калибратор (C1) – 1 фл. х 2,0 мл; калибратор (C2) – 1 фл. х 2,0 мл (вид 1)



Рисунок 6 Калибратор (C0) – 1 фл. х 2,0 мл; калибратор (C1) – 1 фл. х 2,0 мл; калибратор (C2) – 1 фл. х 2,0 мл (вид 2)



Рисунок 7. Калибратор (C0) – 1 фл. х 2,0 мл; калибратор (C1) – 1 фл. х 2,0 мл; калибратор (C2) – 1 фл. х 2,0 мл (вид 3)

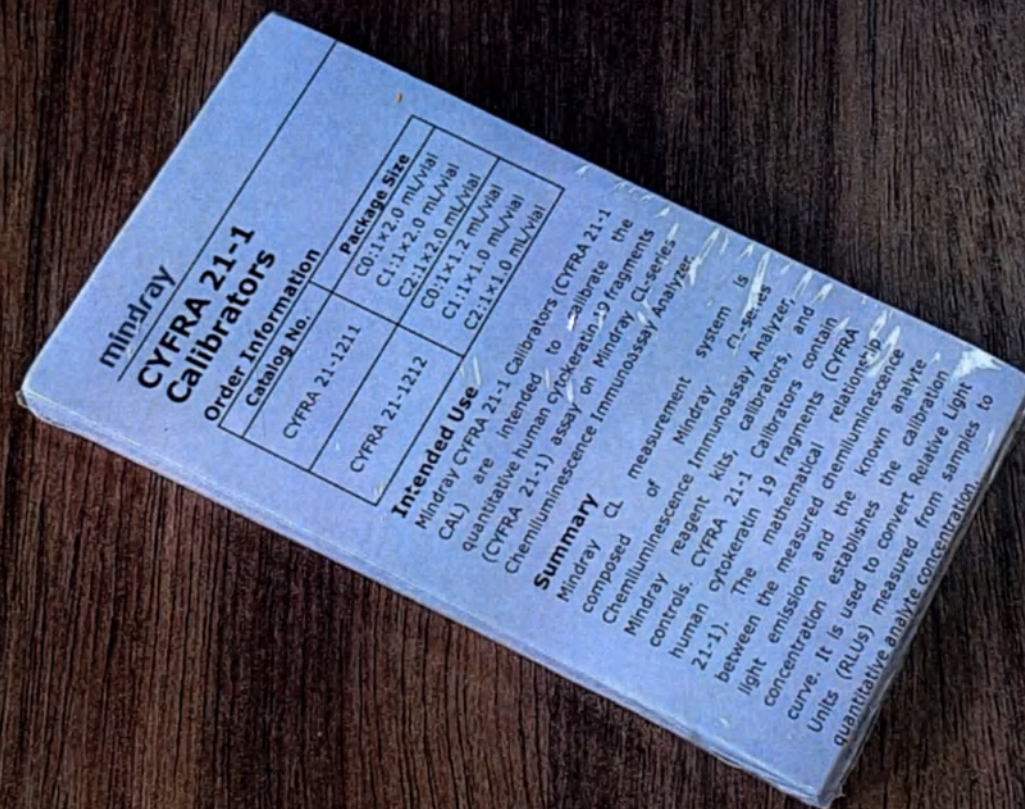


Рисунок 8. Инструкция по применению – 1 шт.

