

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный

директор

ЗАО «Медицинские системы»

А.В.Беляев



2023г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат транскраниальной доплерографии Dolphin/4D с принадлежностями

1. Основной блок Dolphin/4D – 1 шт.

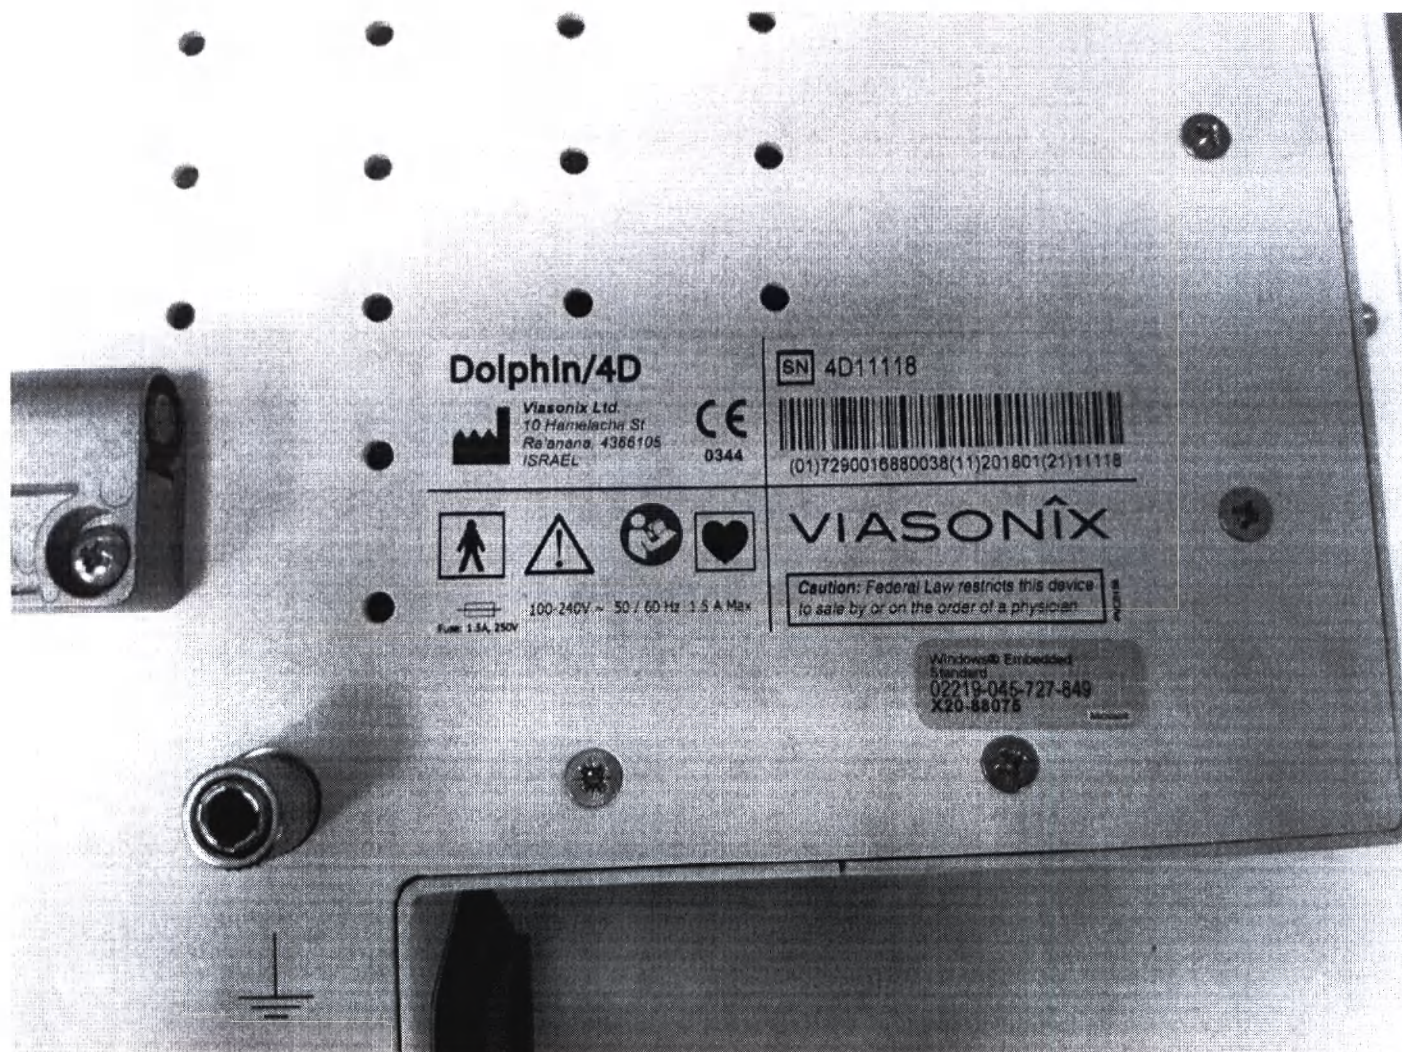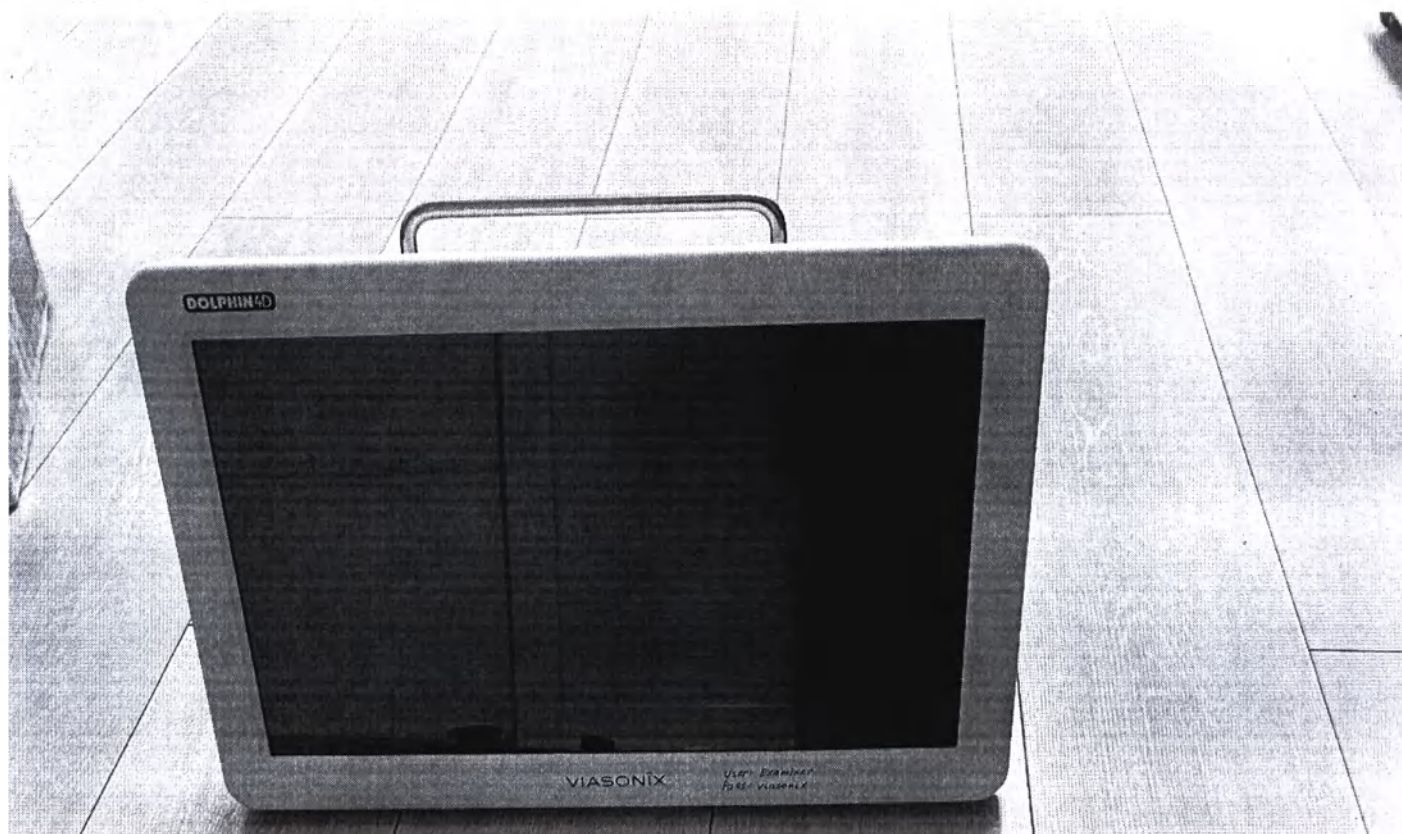

2. Доплеровские датчики мониторинговые, 2 МГц РЧ с зеленой меткой - 2 шт. (при необходимости).



3. Доплеровские датчики мониторинговые, 2 МГц РЧ с желтой меткой - 2 шт. (при необходимости).




4. Доплеровские датчики, 2 МГц РВ - 2 шт. (при необходимости).




5. Доплеровские датчики, 1,6 МГц РВ - 2 шт. (при необходимости).




6. Доплеровские датчики 4 МГц РW/CW - 2 шт. (при необходимости).

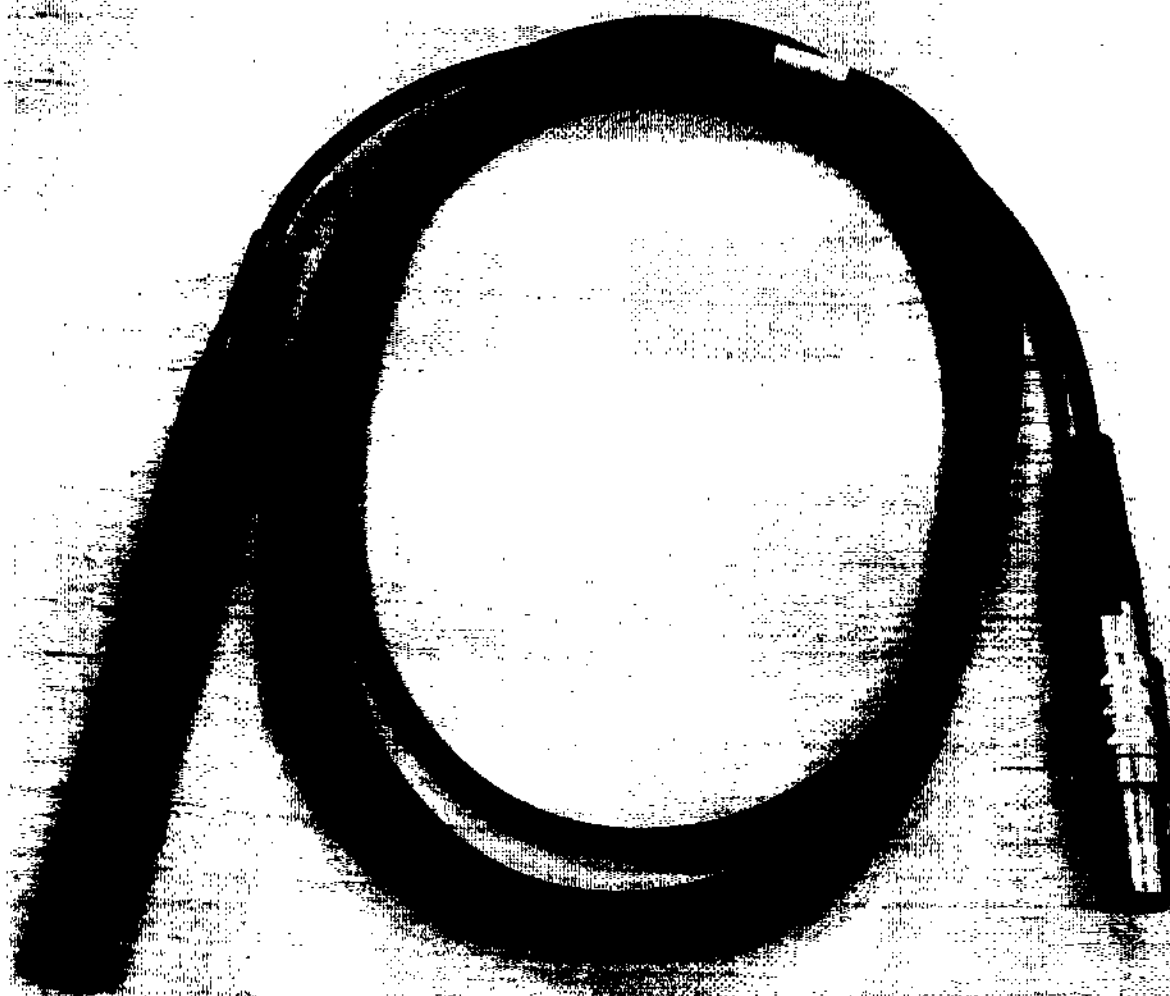


7. Доплеровские датчики 8 МГц РВ/СВ - 2 шт. (при необходимости).

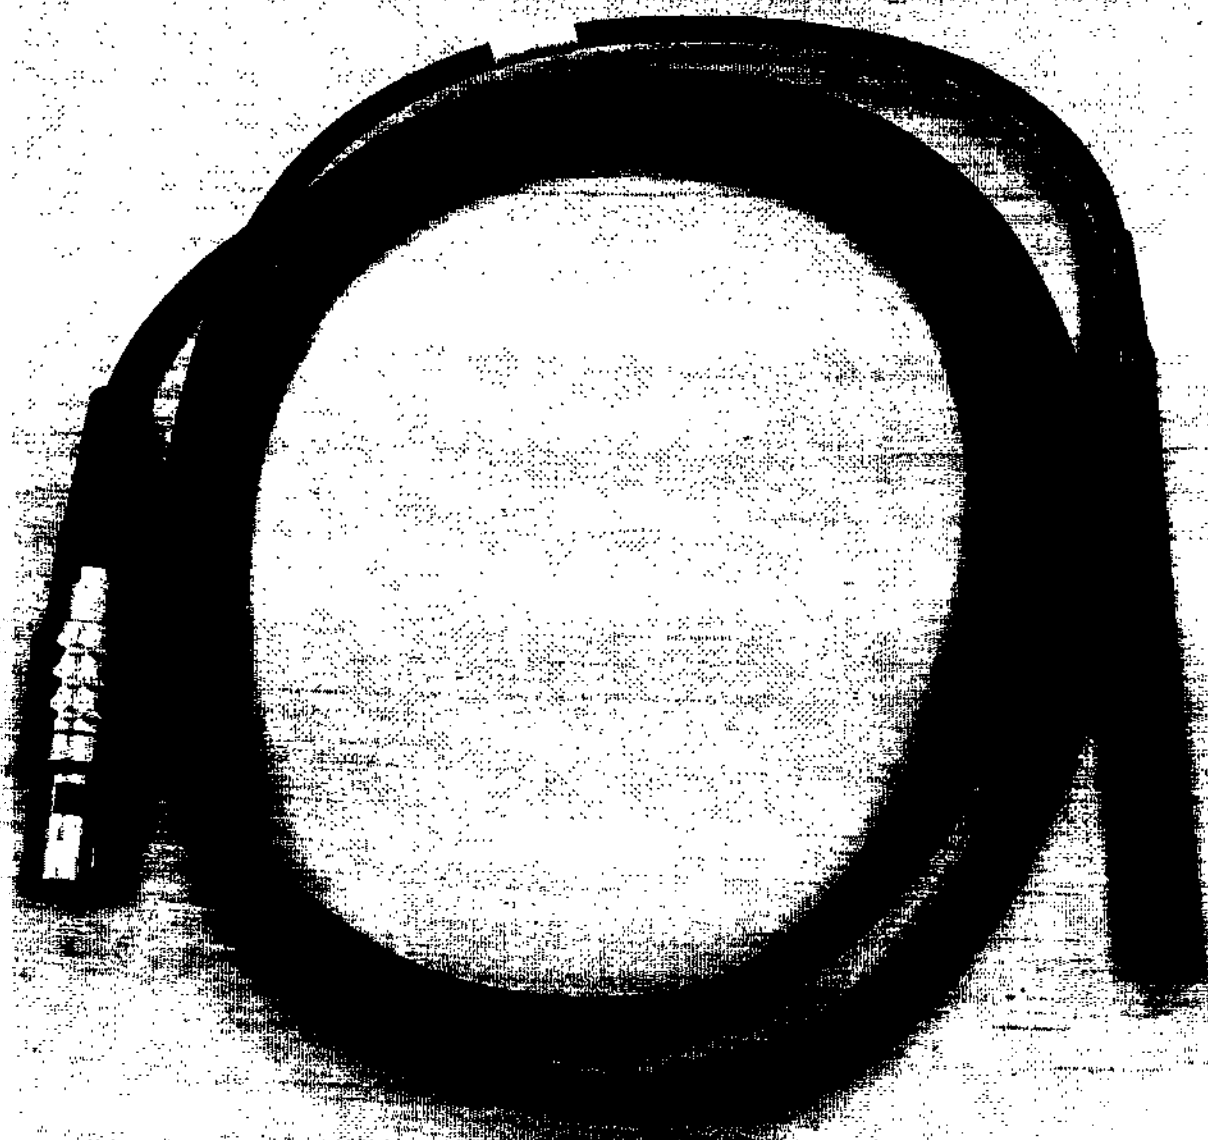


8. Доплеровские датчики 16 МГц РВ (стерильные, одноразовые) - 20 уп. (5 шт./уп.). (при необходимости).

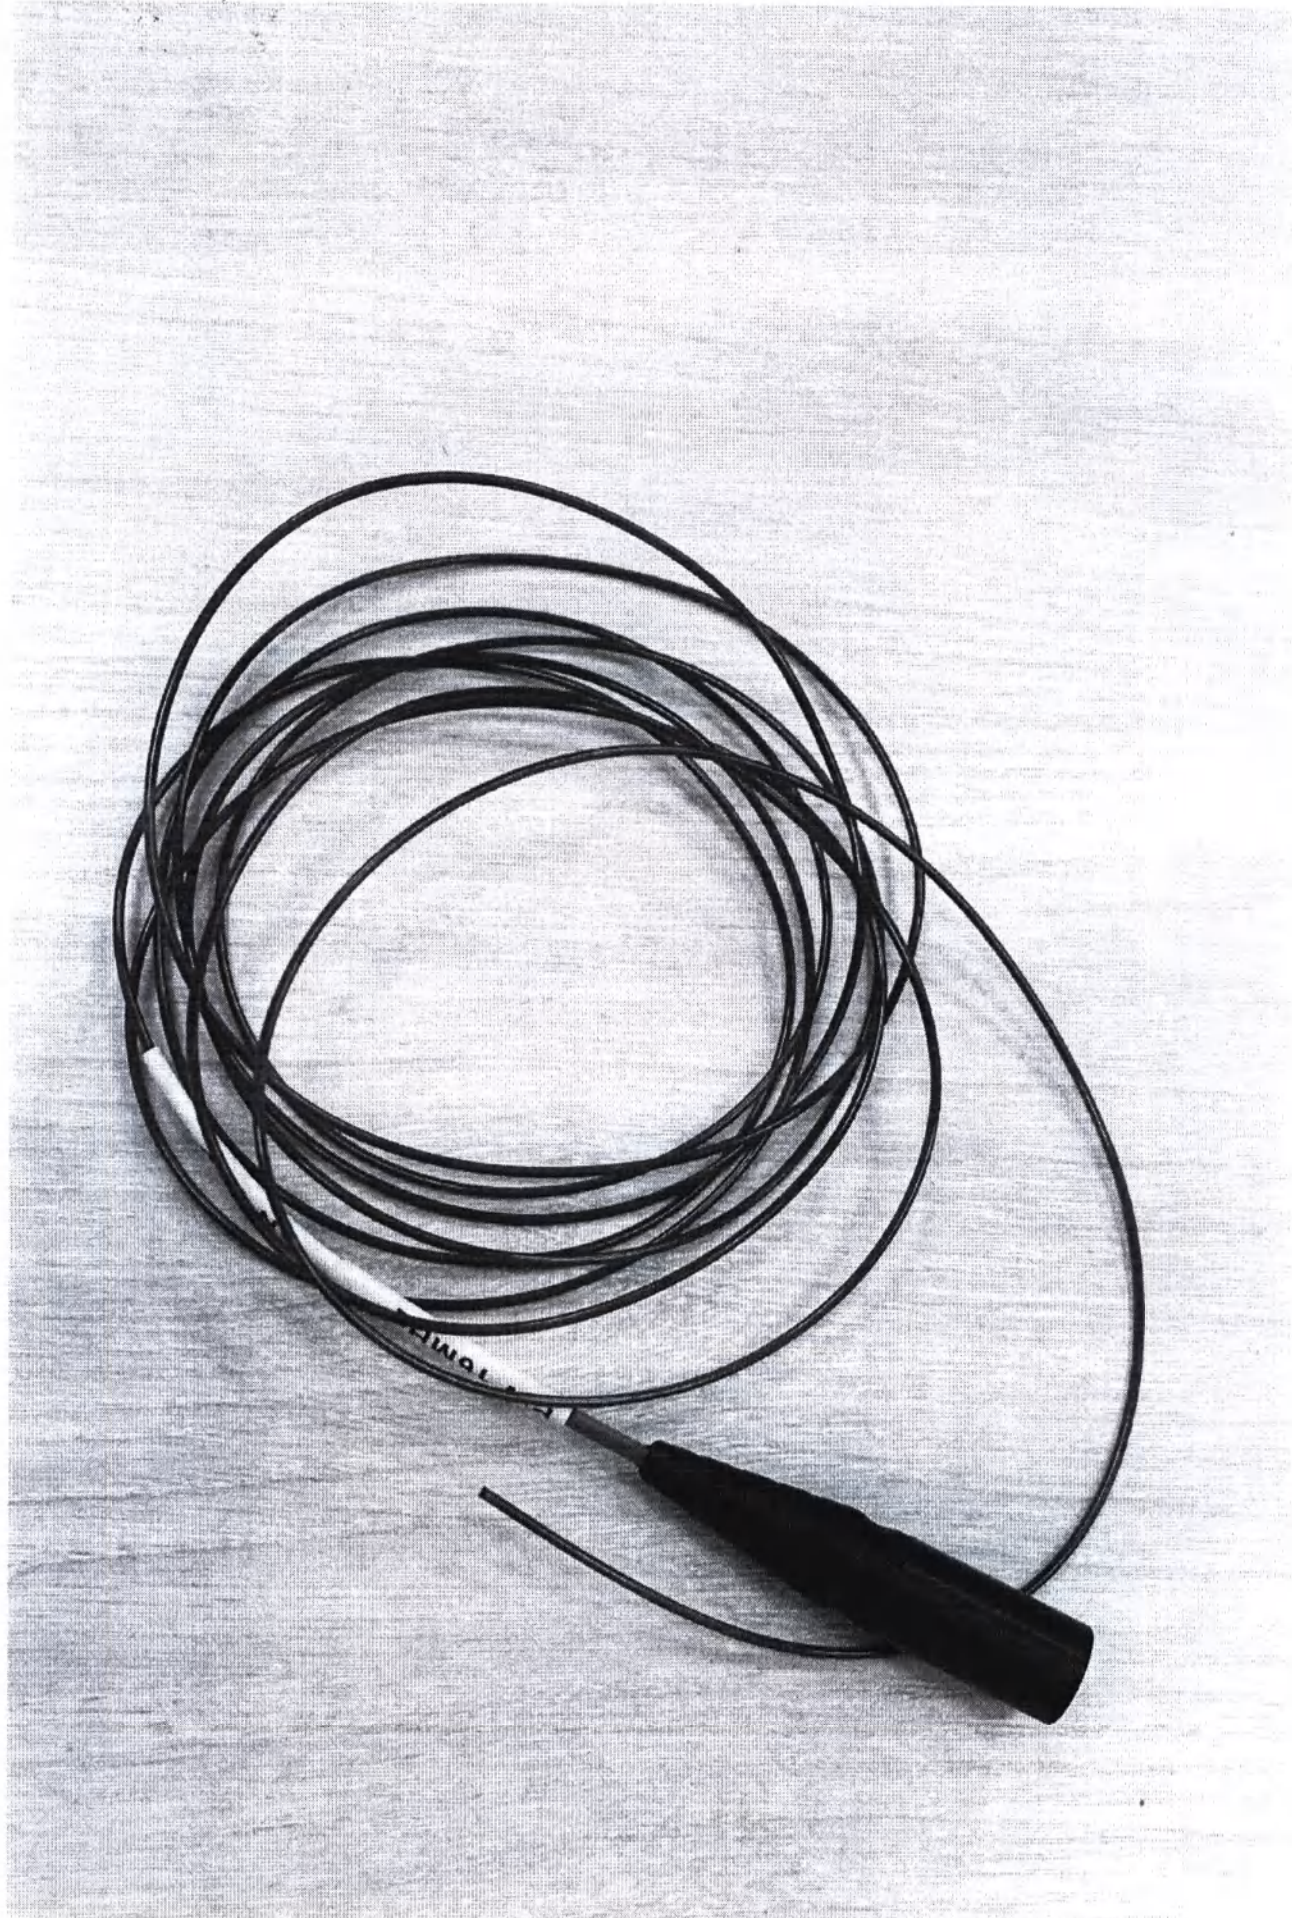

9. Адаптер для датчиков 16 МГц РВ (стерильных, одноразовых) - 1 шт. (при необходимости).

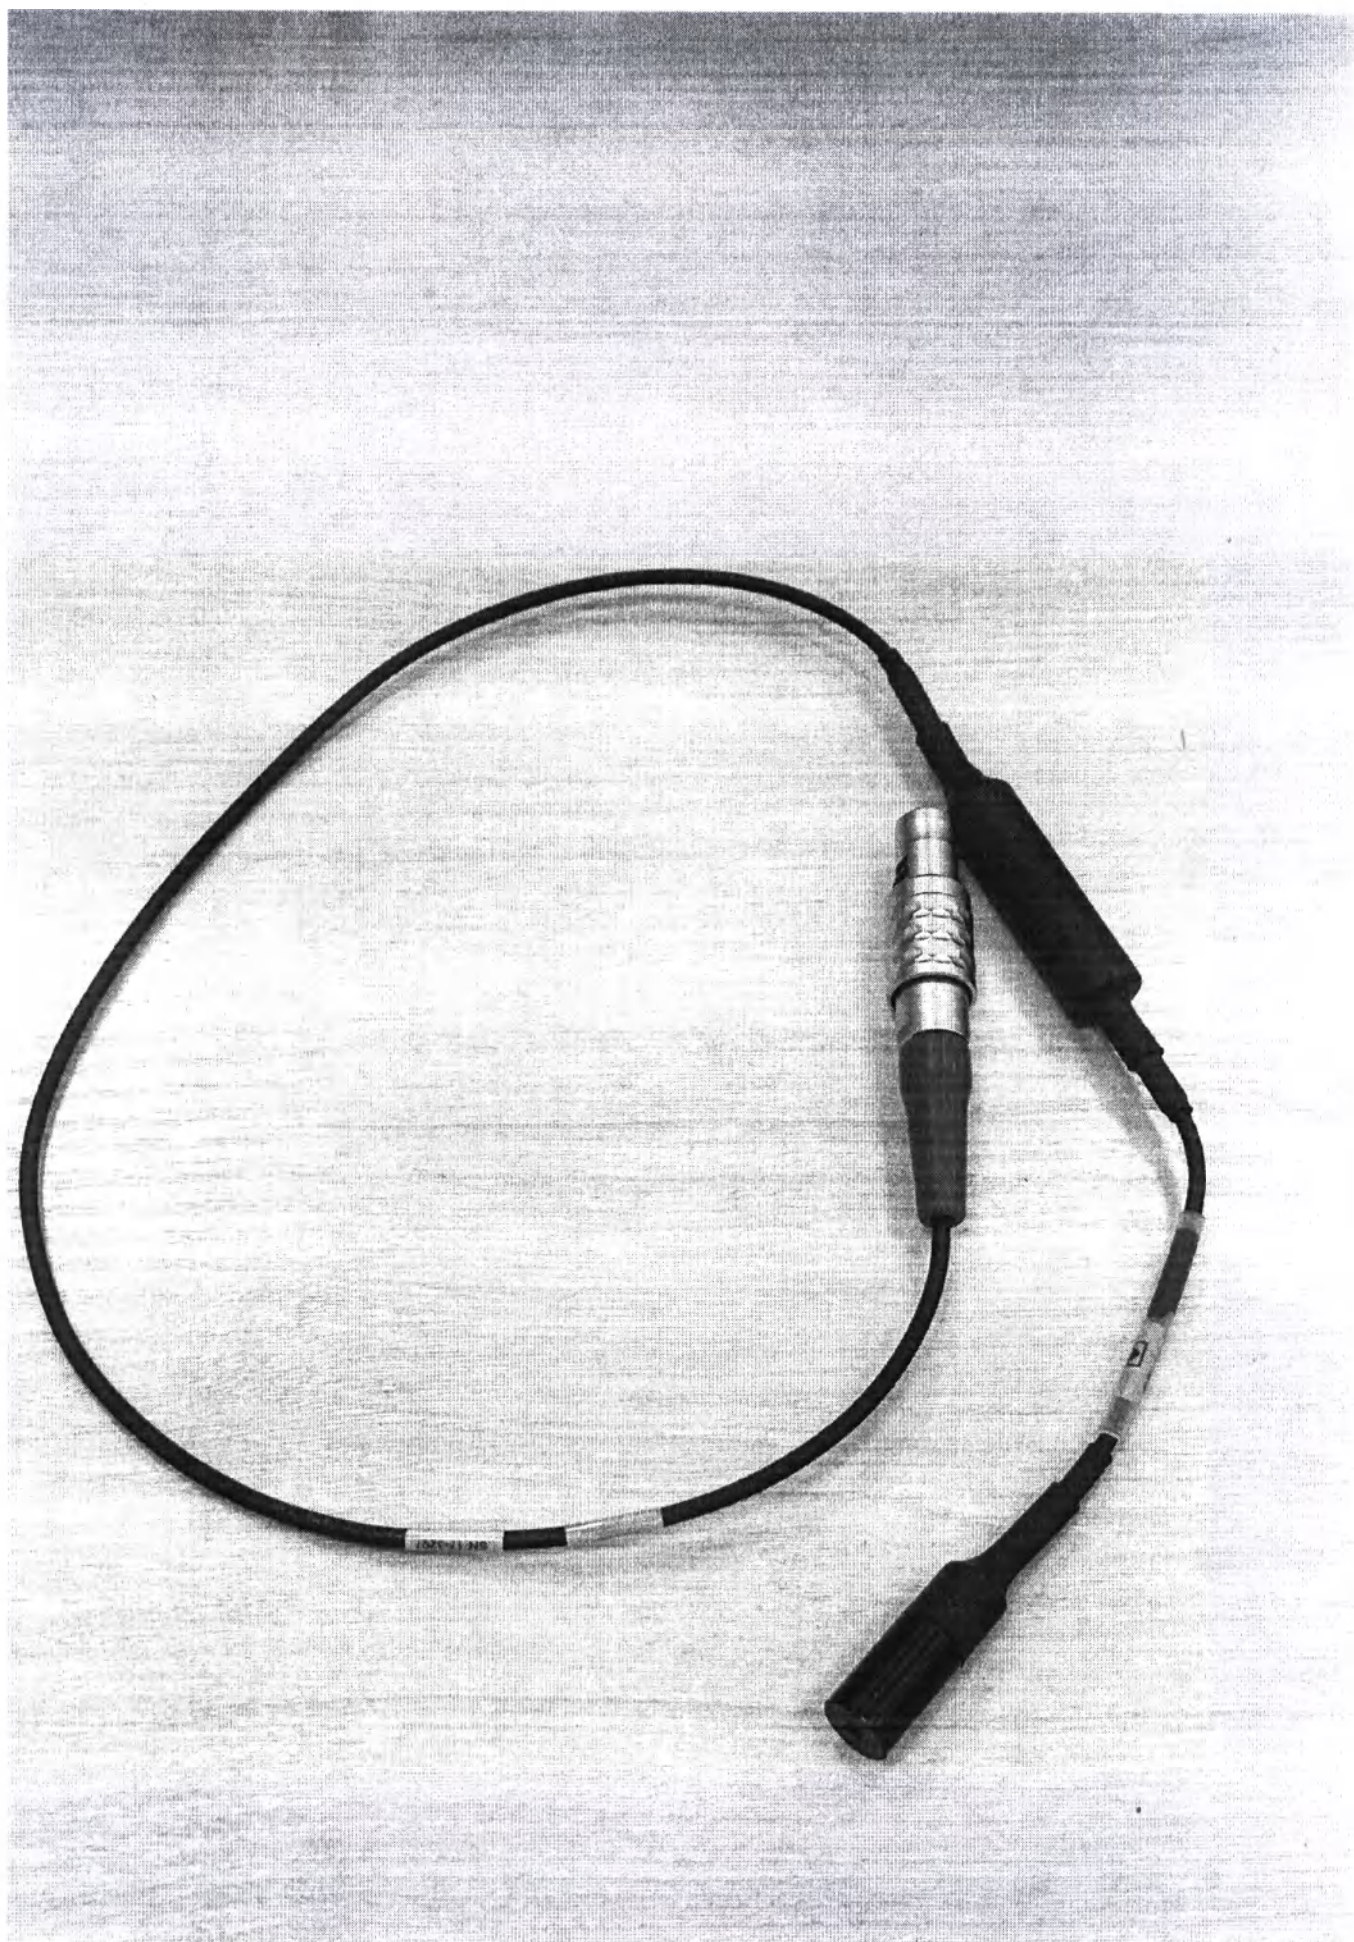

10. Шлем мониторинговый – 1 шт. (при необходимости).

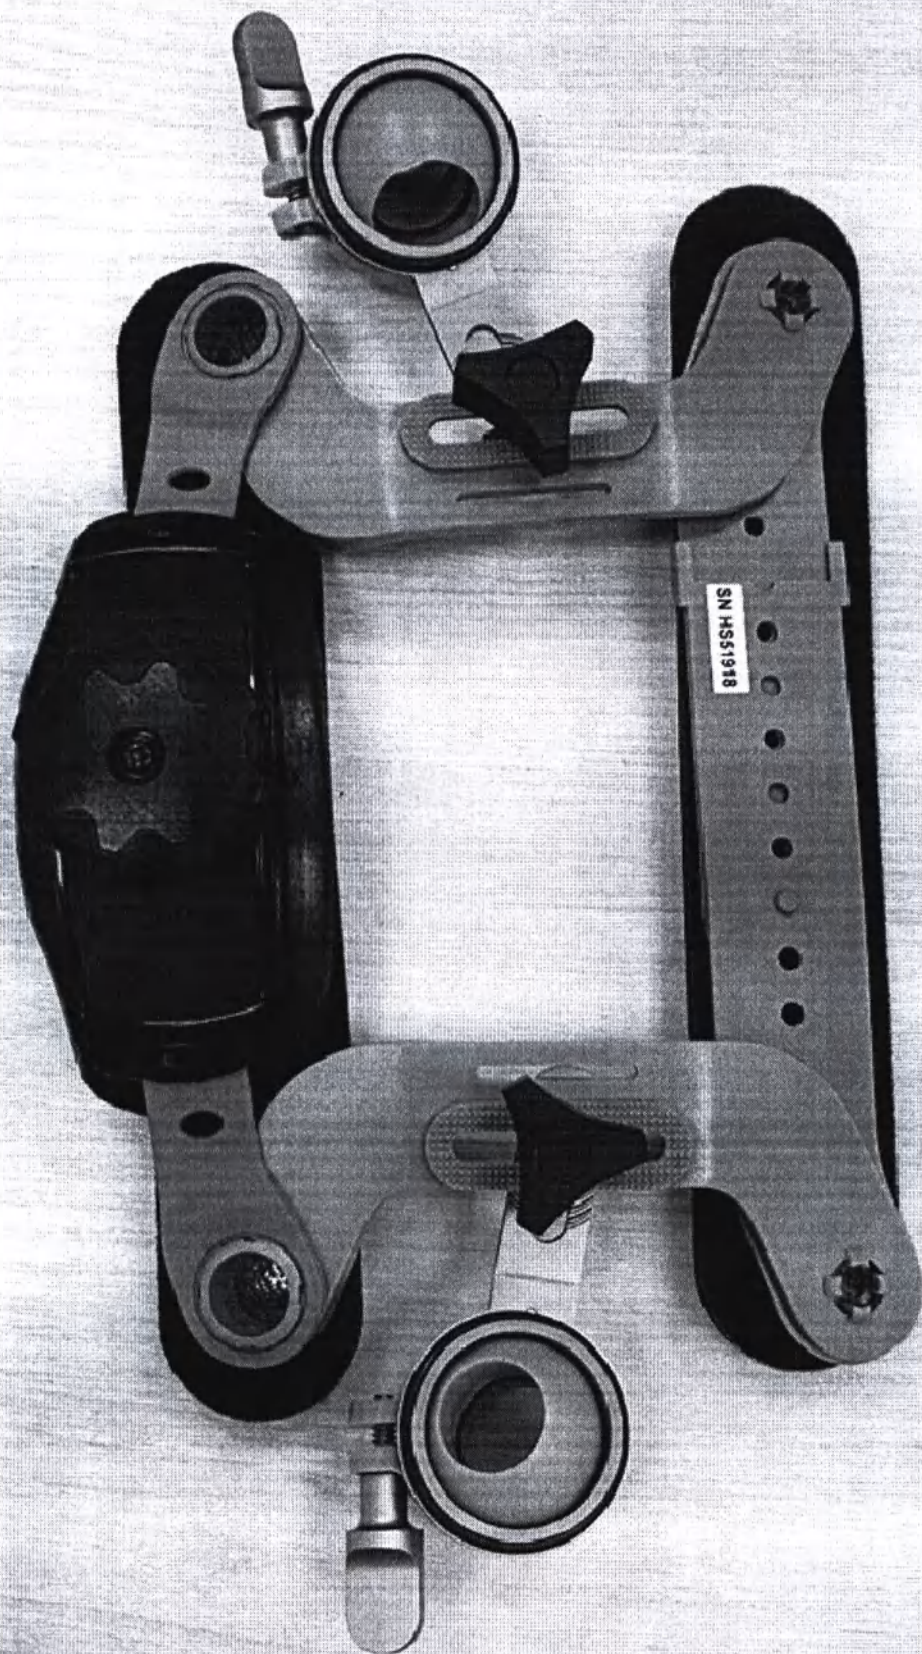

11. Программное обеспечение Dolphin на электронном и/или оптическом, и/или бумажном носителе, и/или посредством интернет ссылки – 1 шт.



Принадлежности:


1. Ножной переключатель ХК-3 – 1 шт.



2. Проводной пульт дистанционного управления Dolphin - 1 шт.




3. Инфракрасный беспроводной пульт дистанционного управления Dolphin - 1 шт.

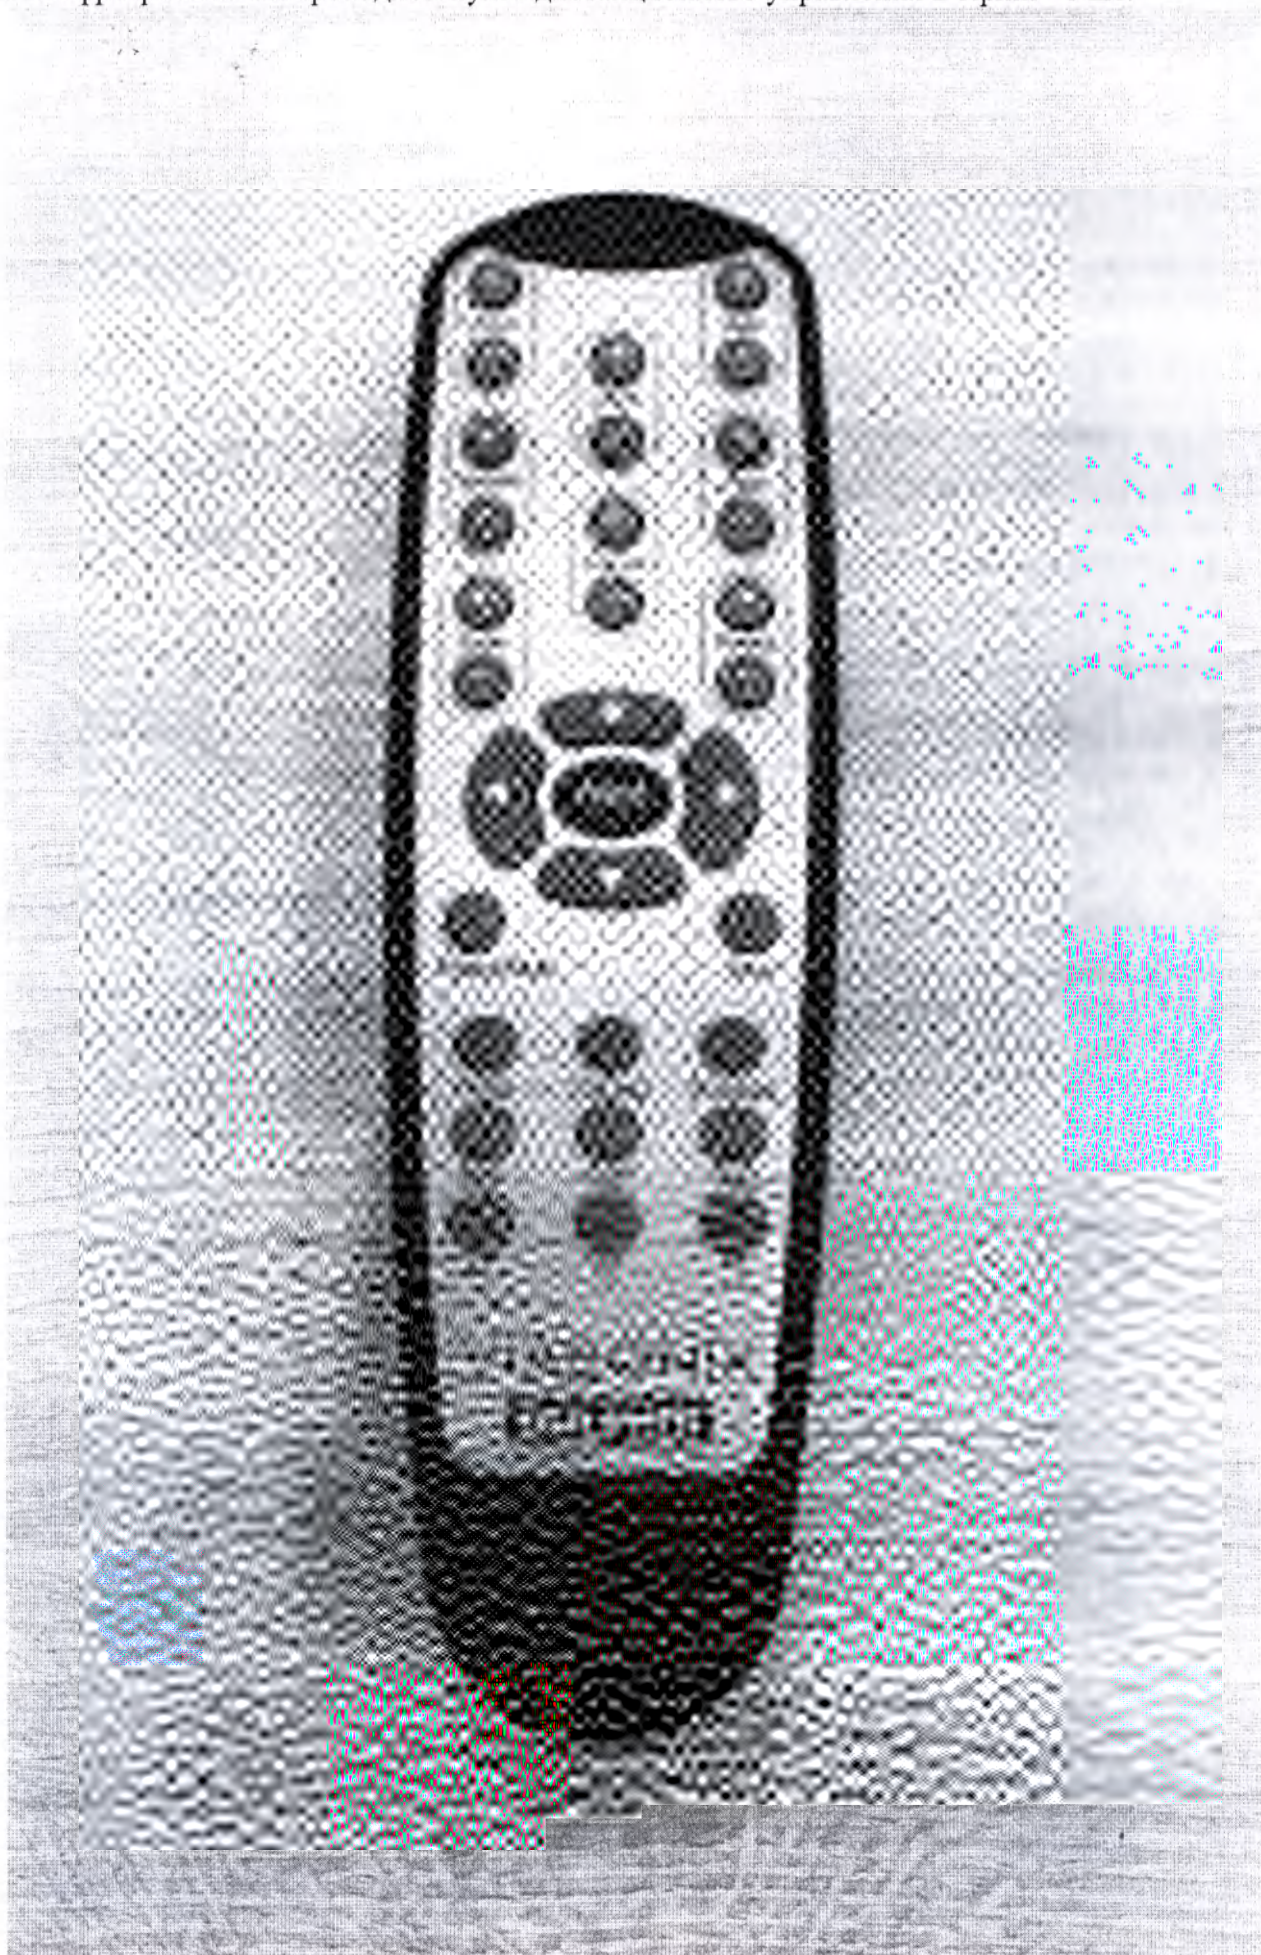

4. Беспроводной приемник дистанционного управления – 1 шт.



5. Подставка Ergotron – 1 шт.

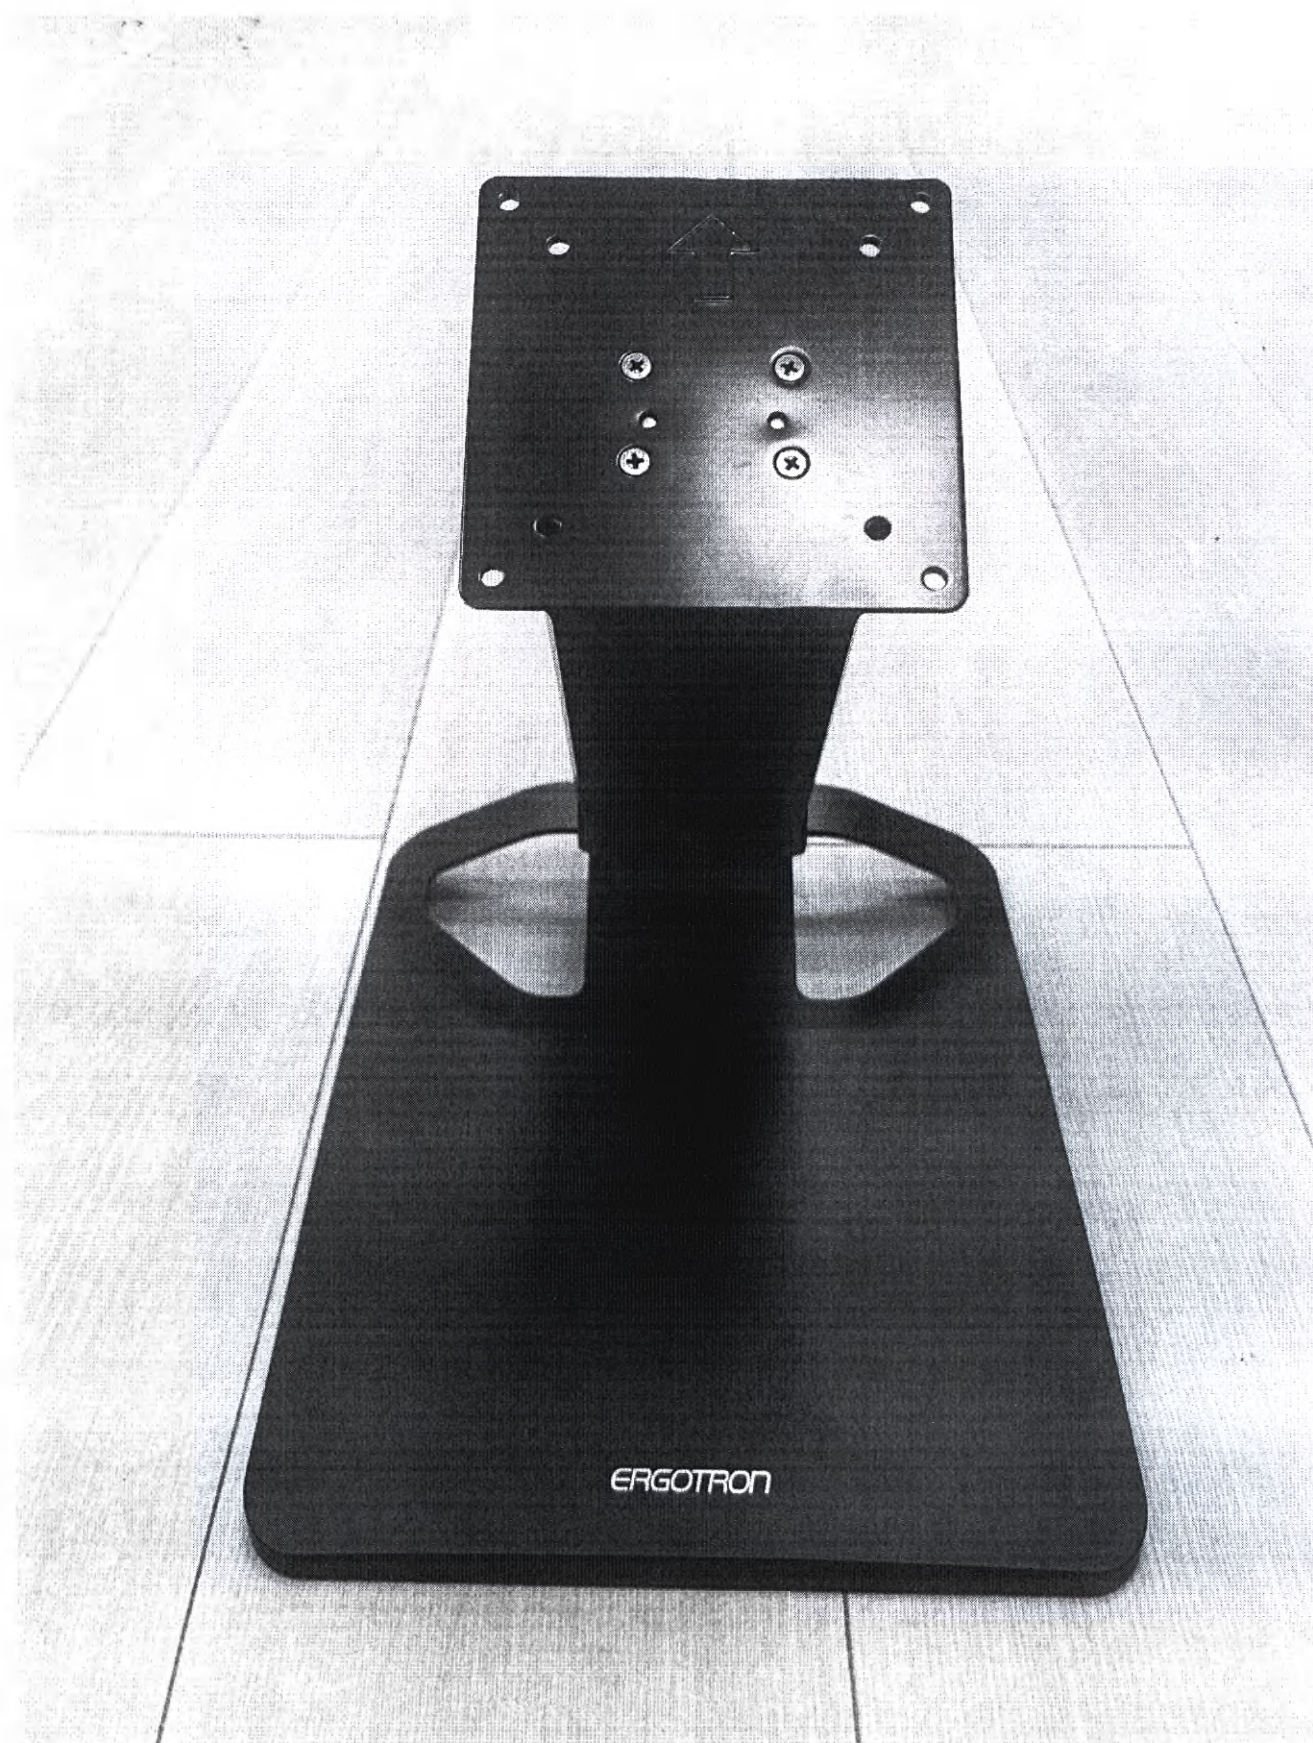

Прошито, пронумеровано
(17) лист (ов),
скреплено печатью



Башев А.В.