

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

_____ Т.А. Носова

« 07 / » марта 2024 г.




ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 3555614

КУСАЙЛО Р. В.


Фотографические изображения изделия:

Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro

«Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.»
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай

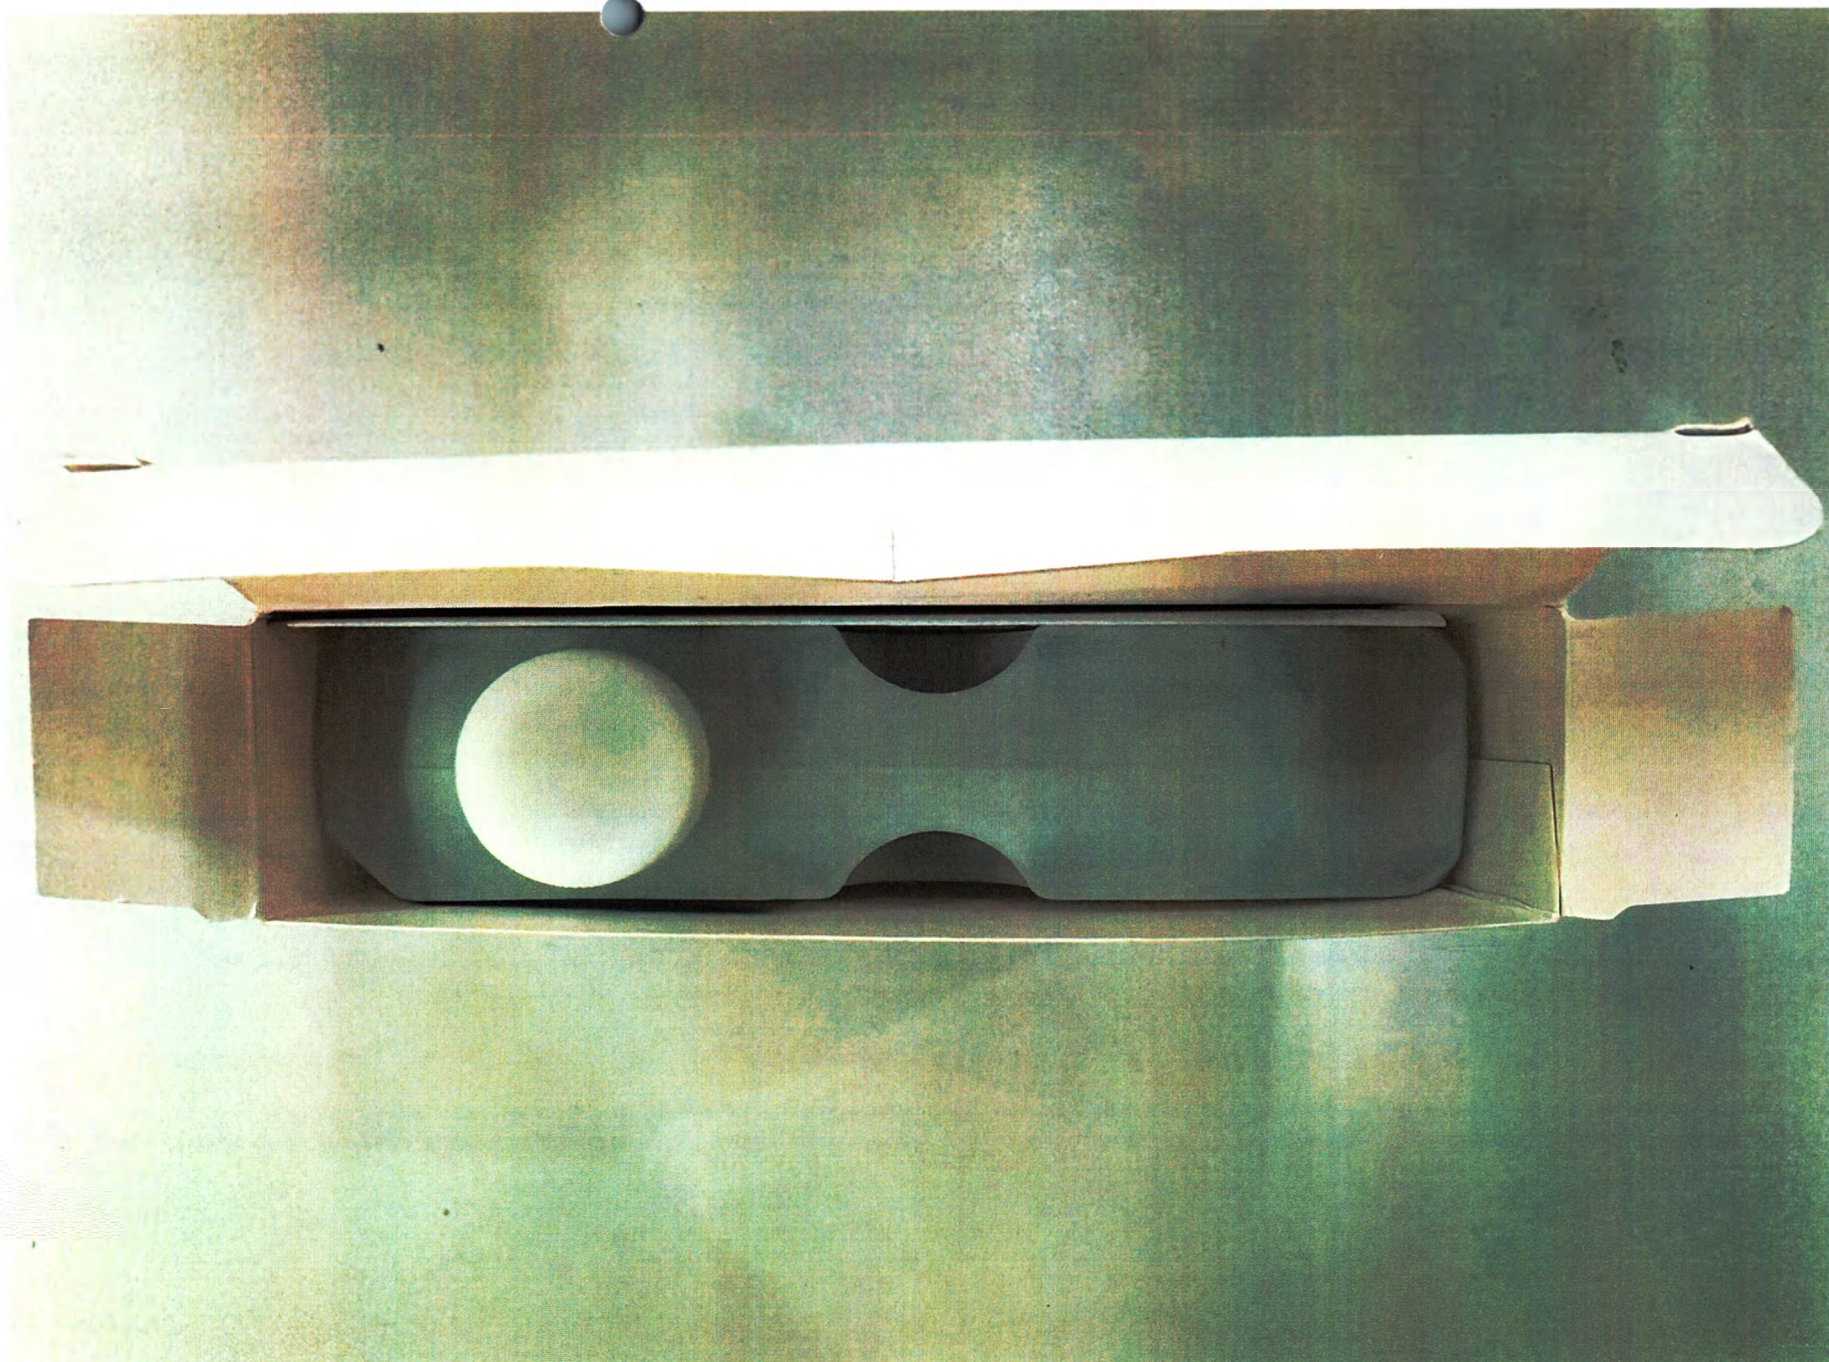

В упаковке - Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 1×480 мл

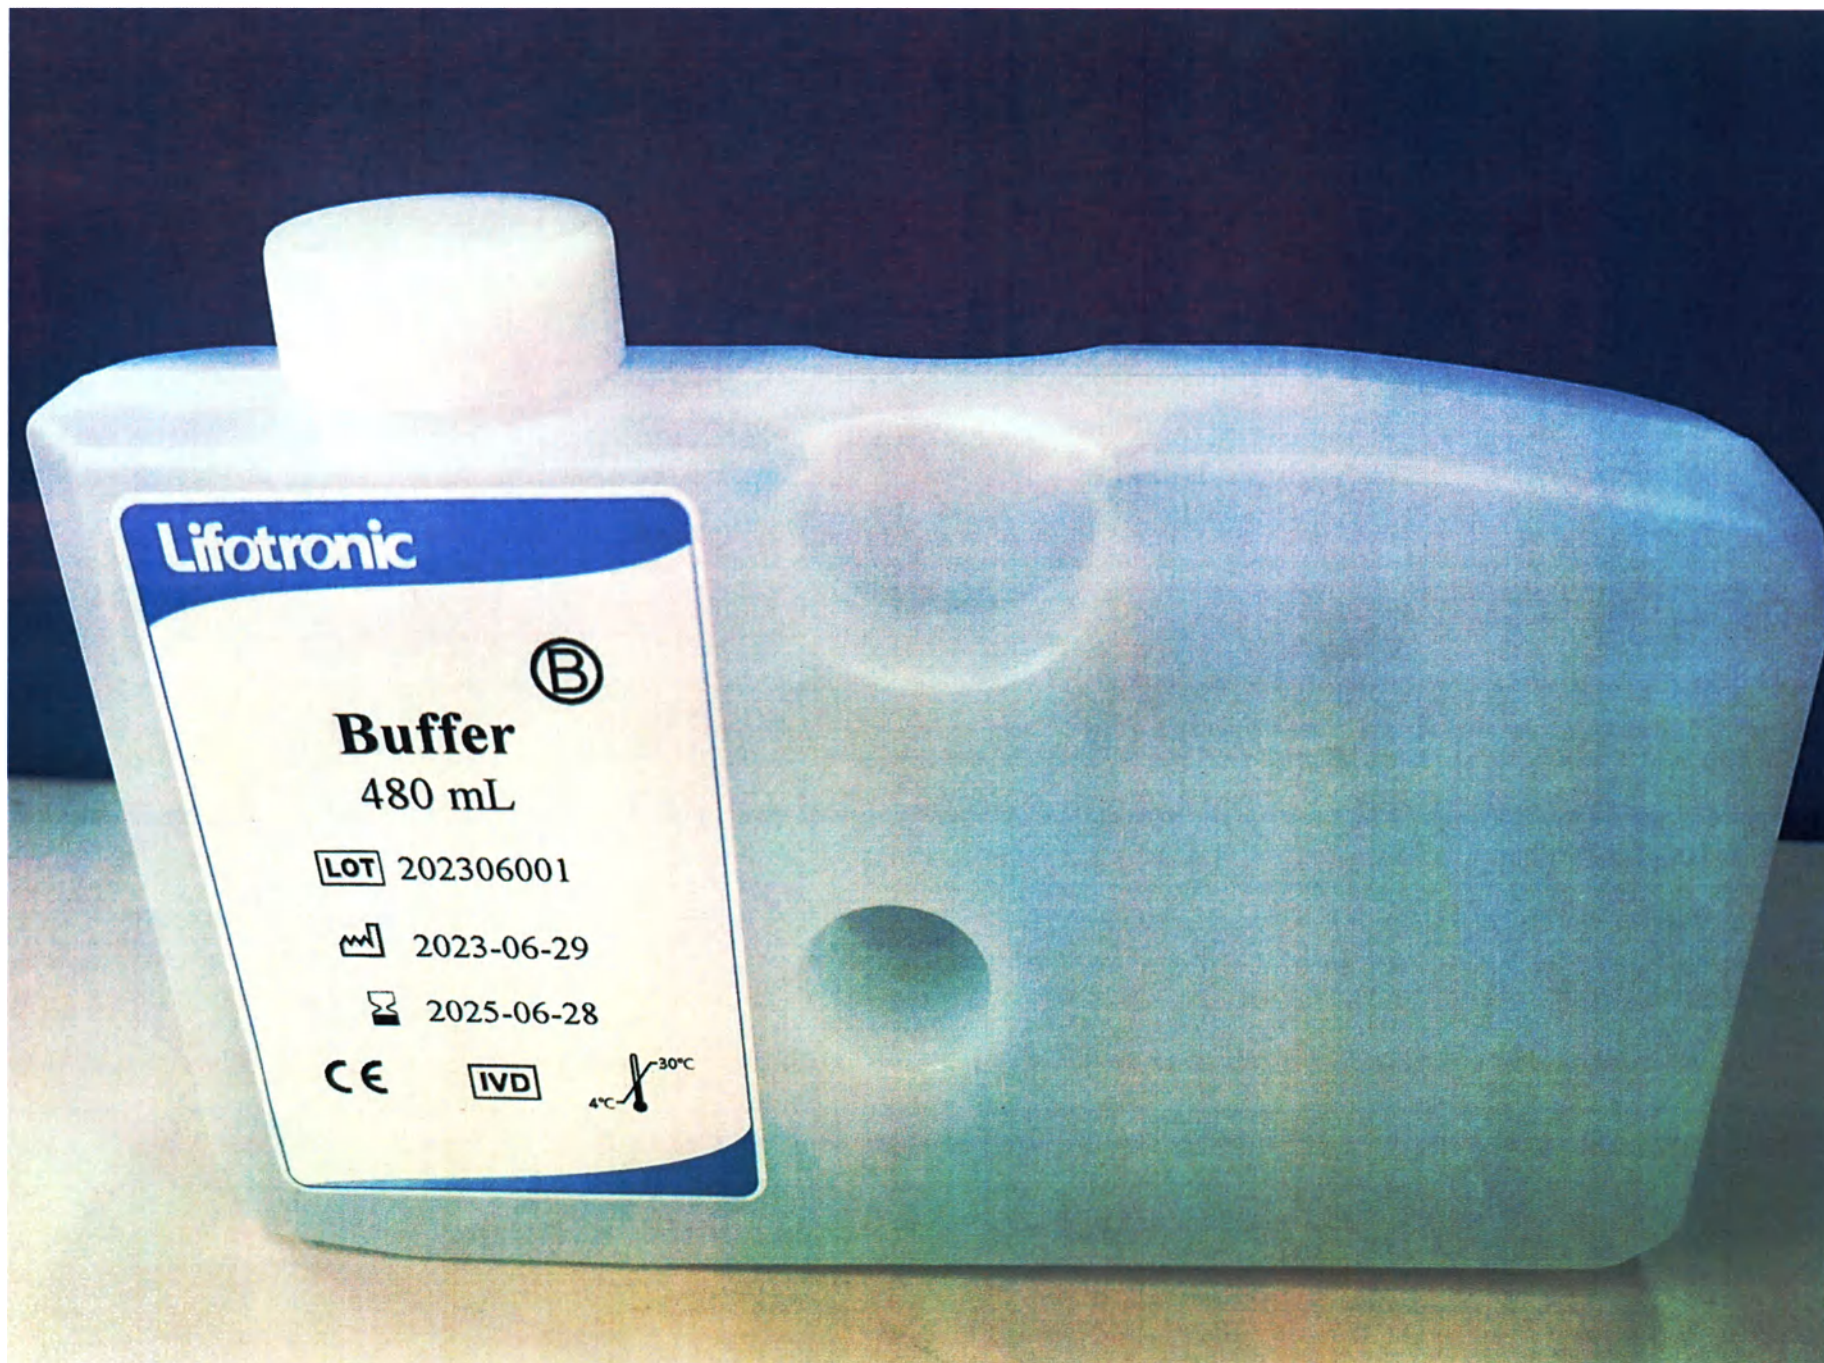

Буфер

Lifotronic

Instruction For Use

【Product Name】

Buffer

【Order Information】

REF NO.	Package Size
679007	480 mL
679006	6×480 mL
0320501901	2×2 L

【Intended Use】

Buffer is used to provide and maintain electrochemical reaction environment in ECL Immunoassay Analyzers.

The major functions of Buffer present as follows:

- Forming a stable surface structure on the electrode
- Transporting the reaction mixture
- Cleaning magnetic particles enveloped with immuno-complexes
- Generation electrochemiluminescent signal.

Buffer can be used with all reagent lots.

【Main Components】

Phosphate buffer 270 mmol/L, tripropylamine 162 mmol/L, detergent ≤0.1%, preservative; pH 7.0.

【Materials provided】

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL8000, eCL8000i, eCL8000p, eCL8000x:

- Buffer, 480 mL, 6×480 mL

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL9000, eCL9000i, eCL9600, eCL9900, eCL9900i:

- Buffer, 2×2 L

【Materials required (but not provided)】


Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL8000, eCL8000i, eCL8000p, eCL8000x:

- Auffer, 480 mL, 6×480 mL

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL9000, eCL9000i, eCL9600, eCL9900, eCL9900i:

- Auffer, 2×2 L
- PreClean, 2×2 L

【Storage and Shelf Life】

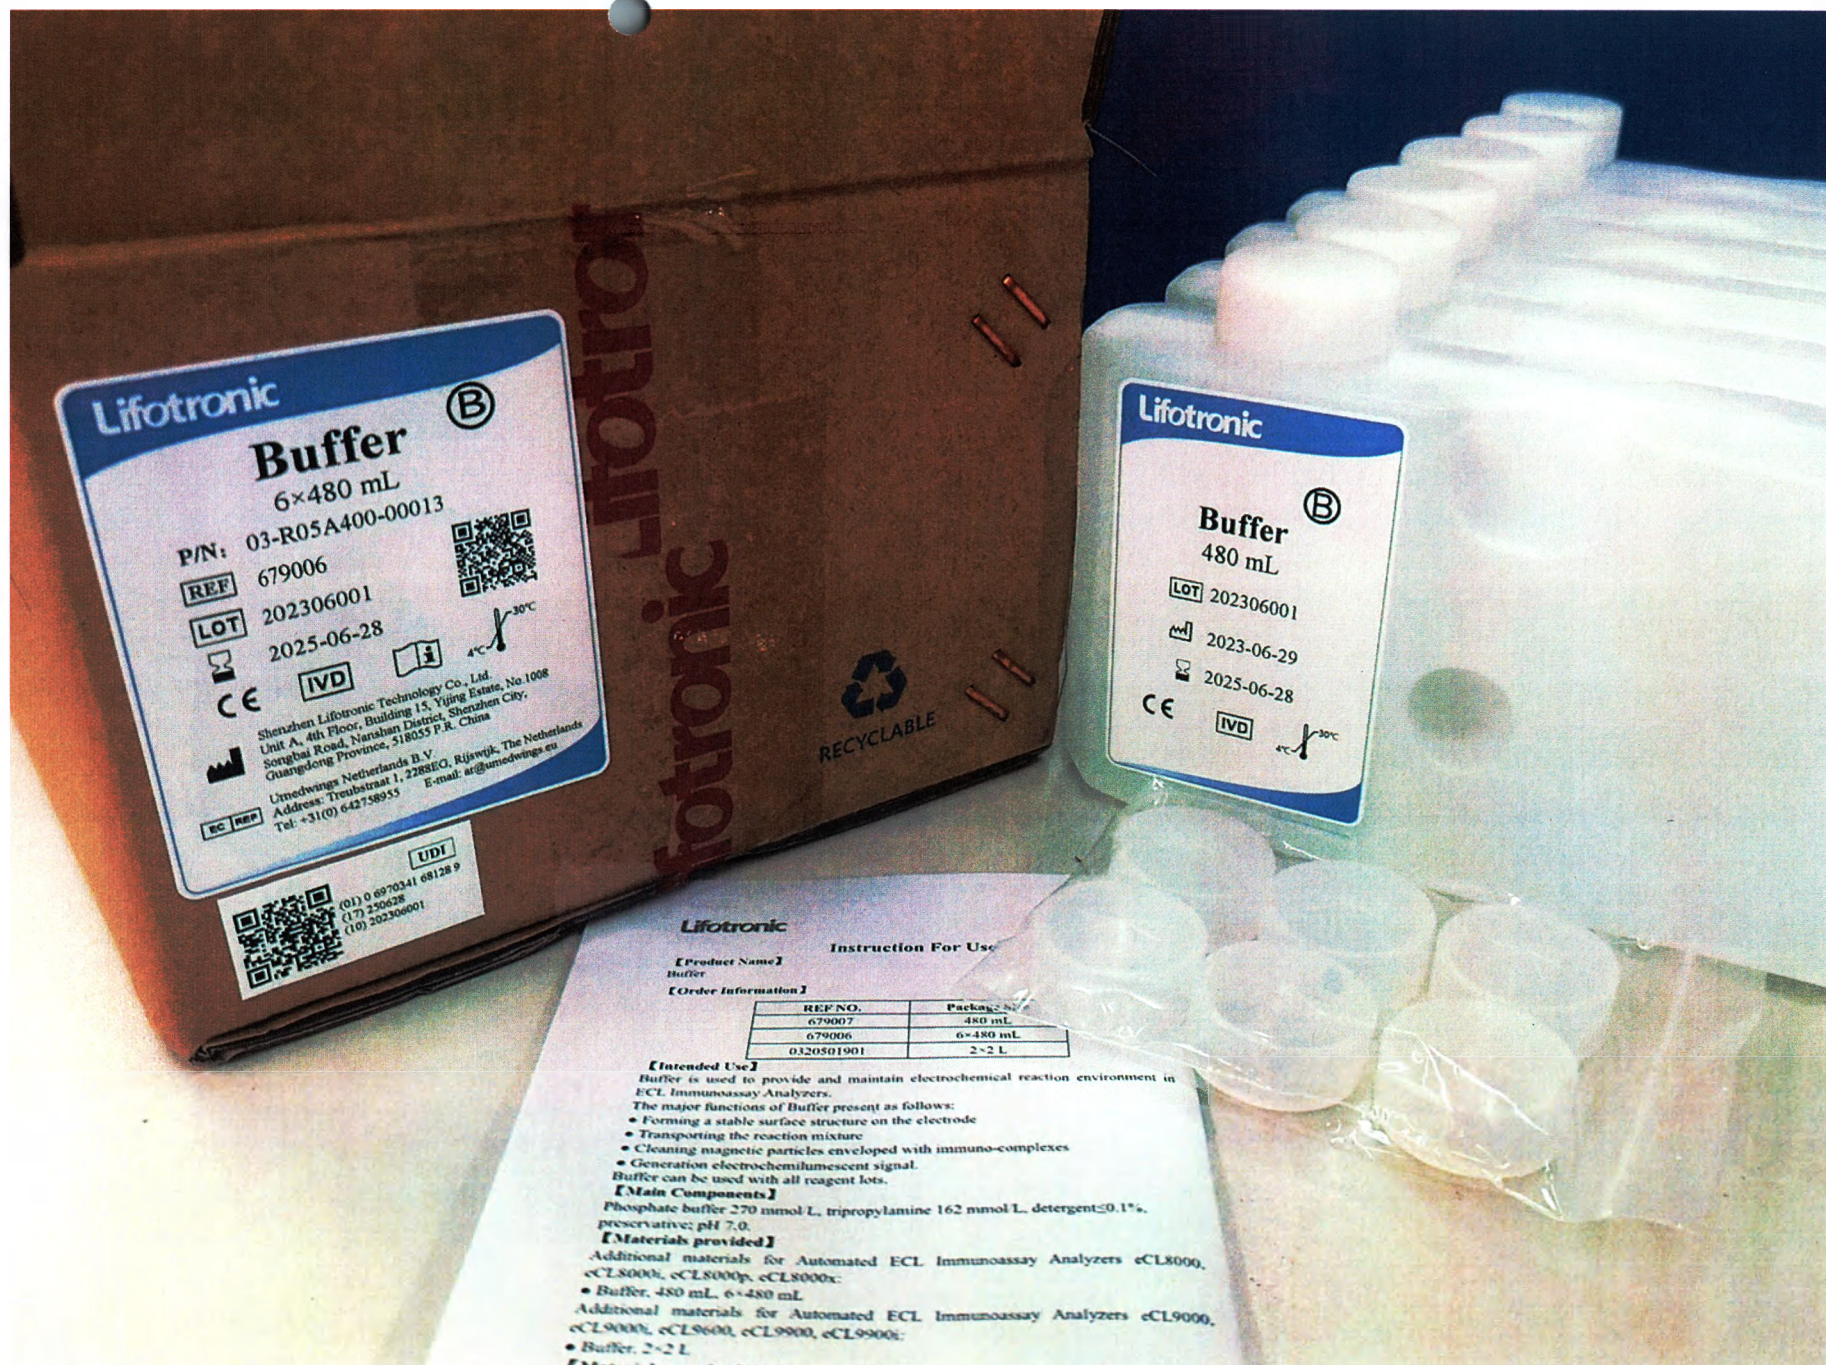

Общий вид - Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилумinesцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 6×480 мл



Lifetronic

Instruction For Use

Product Name

Buffer

Order Information

REF NO.	Package Size
679007	480 mL
679006	6x480 mL
0120501901	2x2 L

Intended Use

Buffer is used to provide and maintain electrochemical reaction environment in ECL Immunoassay Analyzers.

The major functions of Buffer present as follows:

- Forming a stable surface structure on the electrode
- Transporting the reaction mixture
- Cleaning magnetic particles enveloped with immuno-complexes
- Generation electrochemiluminescent signal.

Main Components

Phosphate buffer 270 mmol/L, tripropylamine 162 mmol/L, detergent 0.1%, preservative; pH 7.0.

Materials provided

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers of 1 min, eCL8000i, eCL8000p, eCL8000x:

- Buffer, 480 mL, 6x480 mL

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers of 1 min, eCL9000i, eCL9000, eCL9000, eCL9000i:

- Buffer, 2x2 L

Materials required (but not provided)

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers of 1 min, eCL8000i, eCL8000p, eCL8000x:

- Auffer, 480 mL, 6x480 mL

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers of 1 min, eCL9000i, eCL9000, eCL9000, eCL9000i:

- Auffer, 2x2 L

- PreClean, 2x2 L


Storage and Shelf Life

В упаковке - Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 6x480


мл



Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 6×480 мл

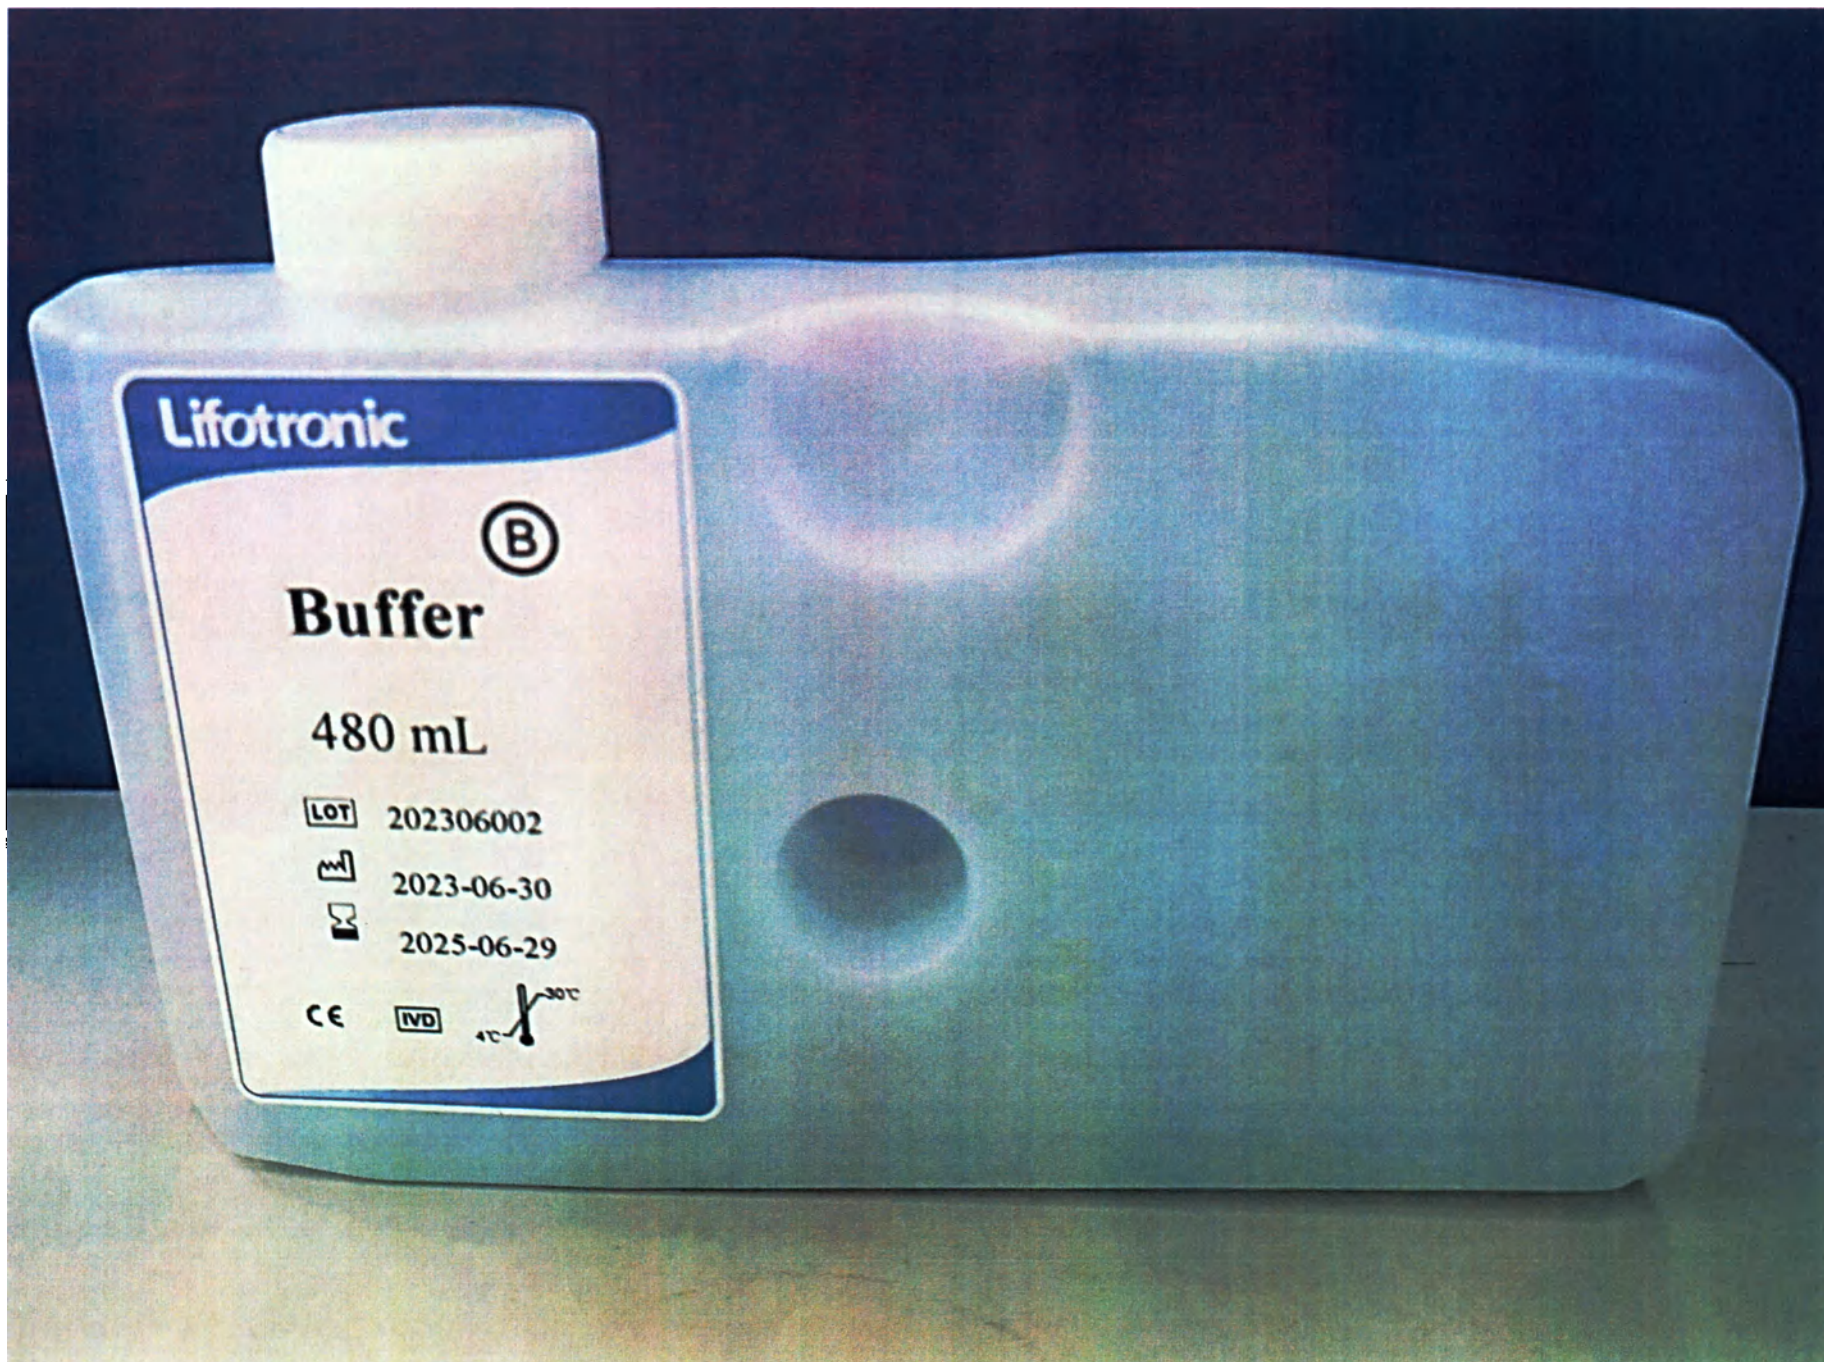

Буфер

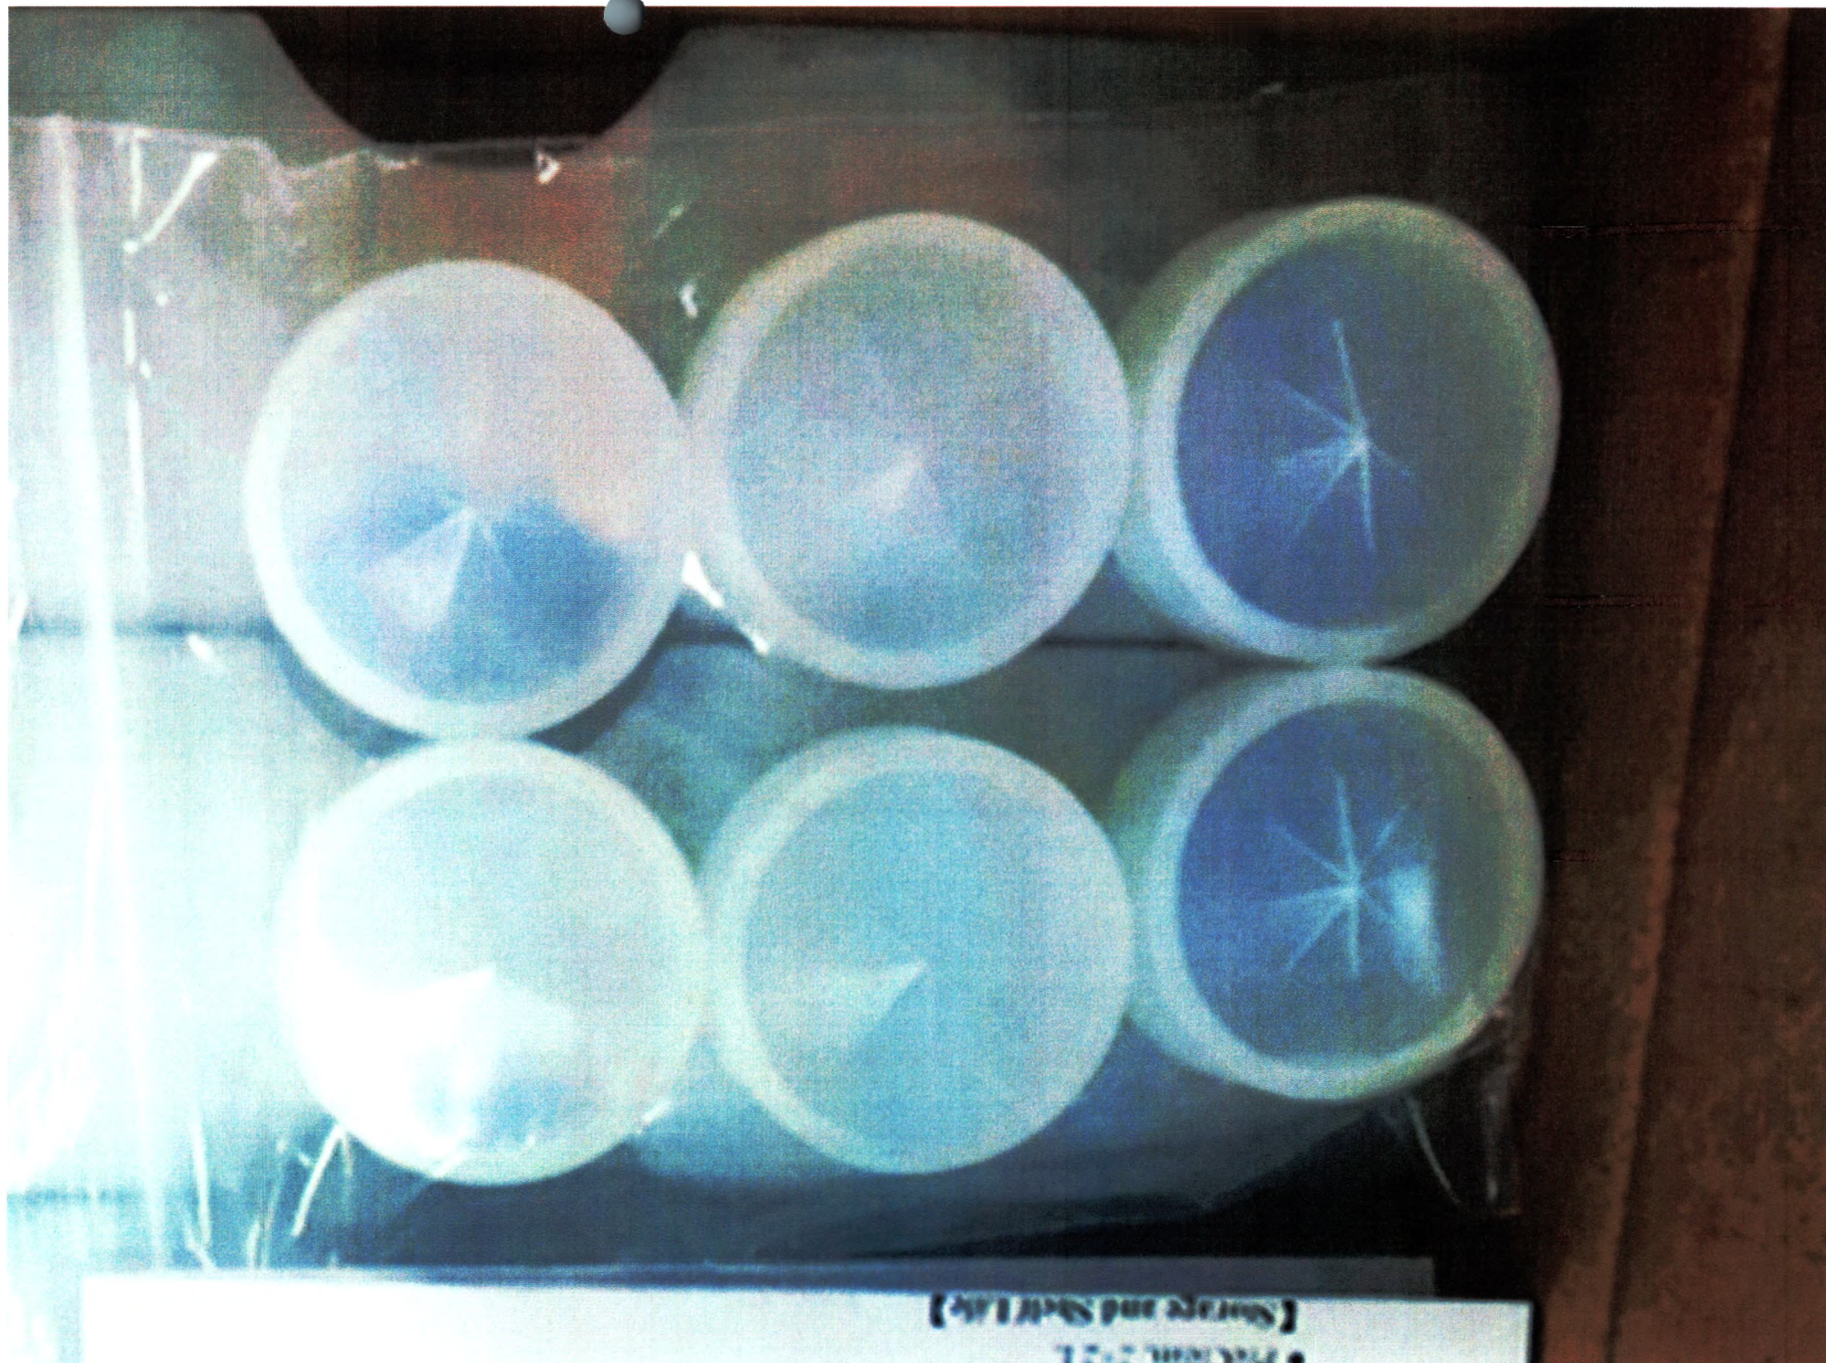

Силиконовая крышка

Lifotronic

Instruction For Use

【Product Name】

Buffer

【Order Information】

REF NO.	Package Size
679007	480 mL
679006	6×480 mL
0320501901	2×2 L

【Intended Use】

Buffer is used to provide and maintain electrochemical reaction environment in ECL Immunoassay Analyzers.

The major functions of Buffer present as follows:

- Forming a stable surface structure on the electrode
 - Transporting the reaction mixture
 - Cleaning magnetic particles enveloped with immuno-complexes
 - Generation electrochemiluminescent signal.
- Buffer can be used with all reagent lots.

【Main Components】

Phosphate buffer 270 mmol/L, tripropylamine 162 mmol/L, detergent ≤0.1%, preservative; pH 7.0.

【Materials provided】

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL8000, eCL8000i, eCL8000p, eCL8000x:

- Buffer, 480 mL, 6×480 mL

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL9000, eCL9000i, eCL9600, eCL9900, eCL9900i:

- Buffer, 2×2 L

【Materials required (but not provided)】

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL8000, eCL8000i, eCL8000p, eCL8000x:

- Buffer, 480 mL, 6×480 mL

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL9000, eCL9000i, eCL9600, eCL9900, eCL9900i:

- Buffer, 2×2 L
- PreClean, 2×2 L

【Storage and Shelf Life】

Lifotronic

Instruction For Use

【Product Name】

Buffer

【Order Information】

REF NO.	Package Size
679007	480 mL
679006	6×480 mL
0320501901	2×2 L

【Intended Use】

Buffer is used to provide and maintain electrochemical reaction environment in ECL Immunoassay Analyzers.

The major functions of Buffer present as follows:

- Forming a stable surface structure on the electrode
- Transporting the reaction mixture
- Cleaning magnetic particles enveloped with immuno-complexes
- Generation electrochemiluminescent signal.

Buffer can be used with all reagent lots.

【Main Components】

Phosphate buffer 270 mmol/L, tripropylamine 162 mmol/L, detergent≤0.1%, preservative; pH 7.0.

【Materials provided】

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL8000, eCL8000i, eCL8000p, eCL8000x:

- Buffer, 480 mL, 6×480 mL

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL9000, eCL9000i, eCL9600, eCL9900, eCL9900i:

- Buffer, 2×2 L

【Materials required (but not provided)】

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL8000, eCL8000i, eCL8000p, eCL8000x:

- Buffer, 480 mL, 6×480 mL

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL9000, eCL9000i, eCL9600, eCL9900, eCL9900i:

- Buffer, 2×2 L
- PreClean, 2×2 L

【Storage and Shelf Life】

В упаковке - Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 2×2 л



Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 2×2 л



Lifotronic

Instruction For Use

【Product Name】

Buffer

【Order Information】

REF NO.	Package Size
679007	480 mL
679006	6×480 mL
0320501901	2×2 L

【Intended Use】

Buffer is used to provide and maintain electrochemical reaction environment in ECL Immunoassay Analyzers.

The major functions of Buffer present as follows:

- Forming a stable surface structure on the electrode
- Transporting the reaction mixture
- Cleaning magnetic particles enveloped with immuno-complexes
- Generation electrochemiluminescent signal.

Buffer can be used with all reagent lots.

【Main Components】

Phosphate buffer 270 mmol/L, tripropylamine 162 mmol/L, detergent ≤0.1%, preservative; pH 7.0.

【Materials provided】

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL8000, eCL8000i, eCL8000p, eCL8000x:

- Buffer, 480 mL, 6×480 mL

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL9000, eCL9000i, eCL9600, eCL9900, eCL9900i:

- Buffer, 2×2 L

【Materials required (but not provided)】

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL8000, eCL8000i, eCL8000p, eCL8000x:

- Auffer, 480 mL, 6×480 mL

Additional materials for Automated ECL Immunoassay Analyzers eCL9000, eCL9000i, eCL9600, eCL9900, eCL9900i:

- Auffer, 2×2 L
- PreClean, 2×2 L

【Storage and Shelf Life】

Информацию на стикере считать приоритетной

Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro

Вариант исполнения:

Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 6×480 мл, в составе:

- Буфер – 6 × 480 мл;
- Силиконовая крышка – 6 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Только для диагностики in vitro · Для профессионального применения

Масса нетто потребительской упаковки: _____



202108004



30.08.2021

Габаритные размеры (ДхШхВ): _____



29.08.2023



Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.

(Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.), Китай

Unit A, 4th Floor, Building 15, Yijing Estate, No.1008 Songbai Road, Nanshan

District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518055, P.R.China

Остальную информацию и символы см. на оригинальной маркировке

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр 1, пом 17.

Тел.: (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com

Макет стикера на русском языке потребительской упаковки (транспортной тары) - Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 6×480 мл

Информацию на стикере считать приоритетной

Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro

Вариант исполнения:

Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 2×2 л, в составе:

- Буфер – 2×2 л;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Только для диагностики in vitro · Для профессионального применения

Масса нетто потребительской упаковки: _____



202306001



29.06.2023

Габаритные размеры (ДхШхВ): _____



28.06.2025



Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.

(Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.), Китай

Unit A, 4th Floor, Building 15, Yijing Estate, No.1008 Songbai Road, Nanshan

District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518055, P.R.China

Остальную информацию и символы см. на оригинальной маркировке

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр 1, пом 17.

Тел.: (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com

Макет стикера на русском языке потребительской упаковки (транспортной тары) - Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 2×2 л

Информацию на стикере считать приоритетной

Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro

Вариант исполнения:

Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 1×480 мл, в составе:

- Буфер – 1×480 мл;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение _____

Код партии, срок годности, условия хранения и остальные графические символы указаны на оригинальной маркировке

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения



Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.

(Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.), Китай

Unit A, 4th Floor, Building 15, Yijing Estate, No.1008 Songbai Road, Nanshan

District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518055, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «Компания «БиВи»

Адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, дом 101, стр 1, пом 17.

Тел.: (499) 281-67-68, E-mail: info@beawire.com



Макет стикера на русском языке потребительской упаковки - Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 1×480 мл

Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro

Вариант исполнения:

Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 1×480 мл

LOT

202103005



31.03.2021



30.03.2023




масса нетто _____
масса брутто _____
масса нетто потребительской упаковки _____
количество _____ шт.
габаритные размеры (ДхШхВ): _____

Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.

(Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.), Китай

**Unit A, 4th Floor, Building 15, Yijing Estate, No.1008 Songbai Road,
Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518055, P.R.China**



Макет стикера на русском языке транспортной тары - Реагент промывочный (Buffer) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro, в варианте исполнения 1×480 мл

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 20 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АД 3555614
КУСАНДОВ Р.В.

