

Общество с ограниченной ответственностью «Диаконт»

ИНН 7714792851, г. Москва, 125284, ул. Беговая дом 13, кв. 90,

Тел. +7(495)971-1944, e-mail: diacont@diacontru.com www.diacontru.com

Фотографические изображения медицинского изделия

***Система контроля уровня глюкозы в крови Спутник по ТУ
26.60.12-005-63752244-2023***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДИАКОНТ»



П.И.Шишко

2024г.

Общий вид медицинского изделия.



1. Глюкометр Спутник – 1шт.



2. Тест-полоски Спутник к системе контроля уровня глюкозы в крови по ТУ 21.20.23-006-63752244-2023 – 10 шт/уп.




3. Скарификатор Diacont в комплекте со стерильными ланцетами, производства OK Biotech Co. Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698 -1 шт.



4. Контрольный раствор нормальной концентрации– 1 шт.



6. Батарейка CR2032 - 1 шт.

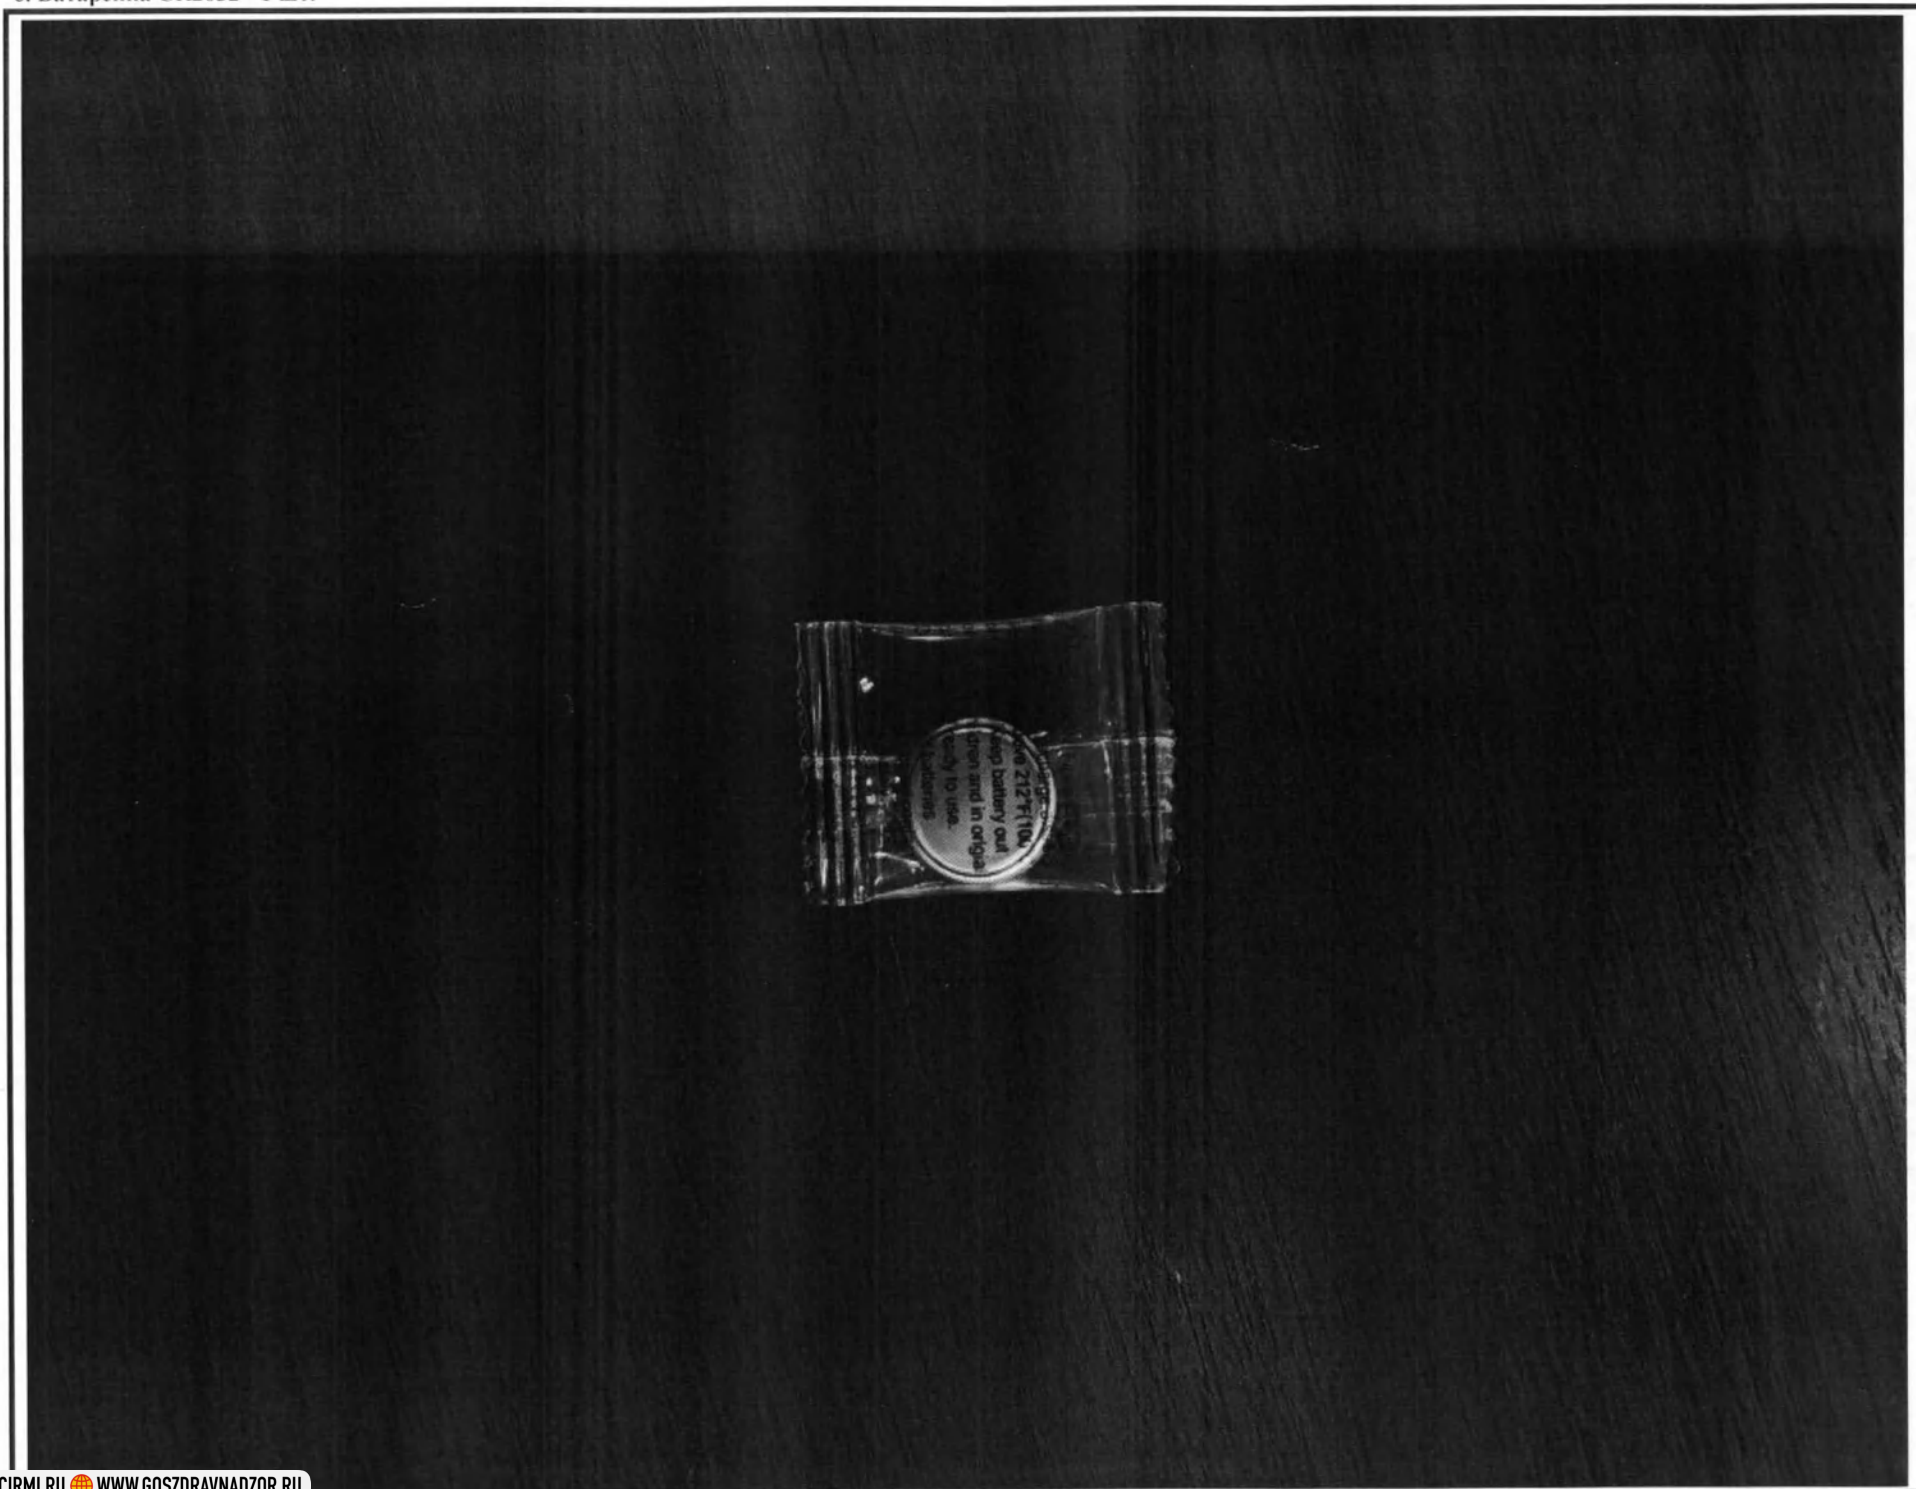

Система контроля уровня глюкозы в крови Спутник по ТУ 26.60.12-005-63752244-2023 (комплектация №1), в составе:

7. Футляр – 1 шт.



Общий вид медицинского изделия.



1. Глюкометр Спутник – 1 шт.



2. Тест-полоски Спутник к системе контроля уровня глюкозы в крови по ТУ 21.20.23-006-63752244-2023 – 10 шт/уп.




3. Скарификатор Diacont в комплекте со стерильными ланцетами, производства OK Biotech Co. Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698 -1 шт.



4. Контрольный раствор высокой концентрации – 1 шт.



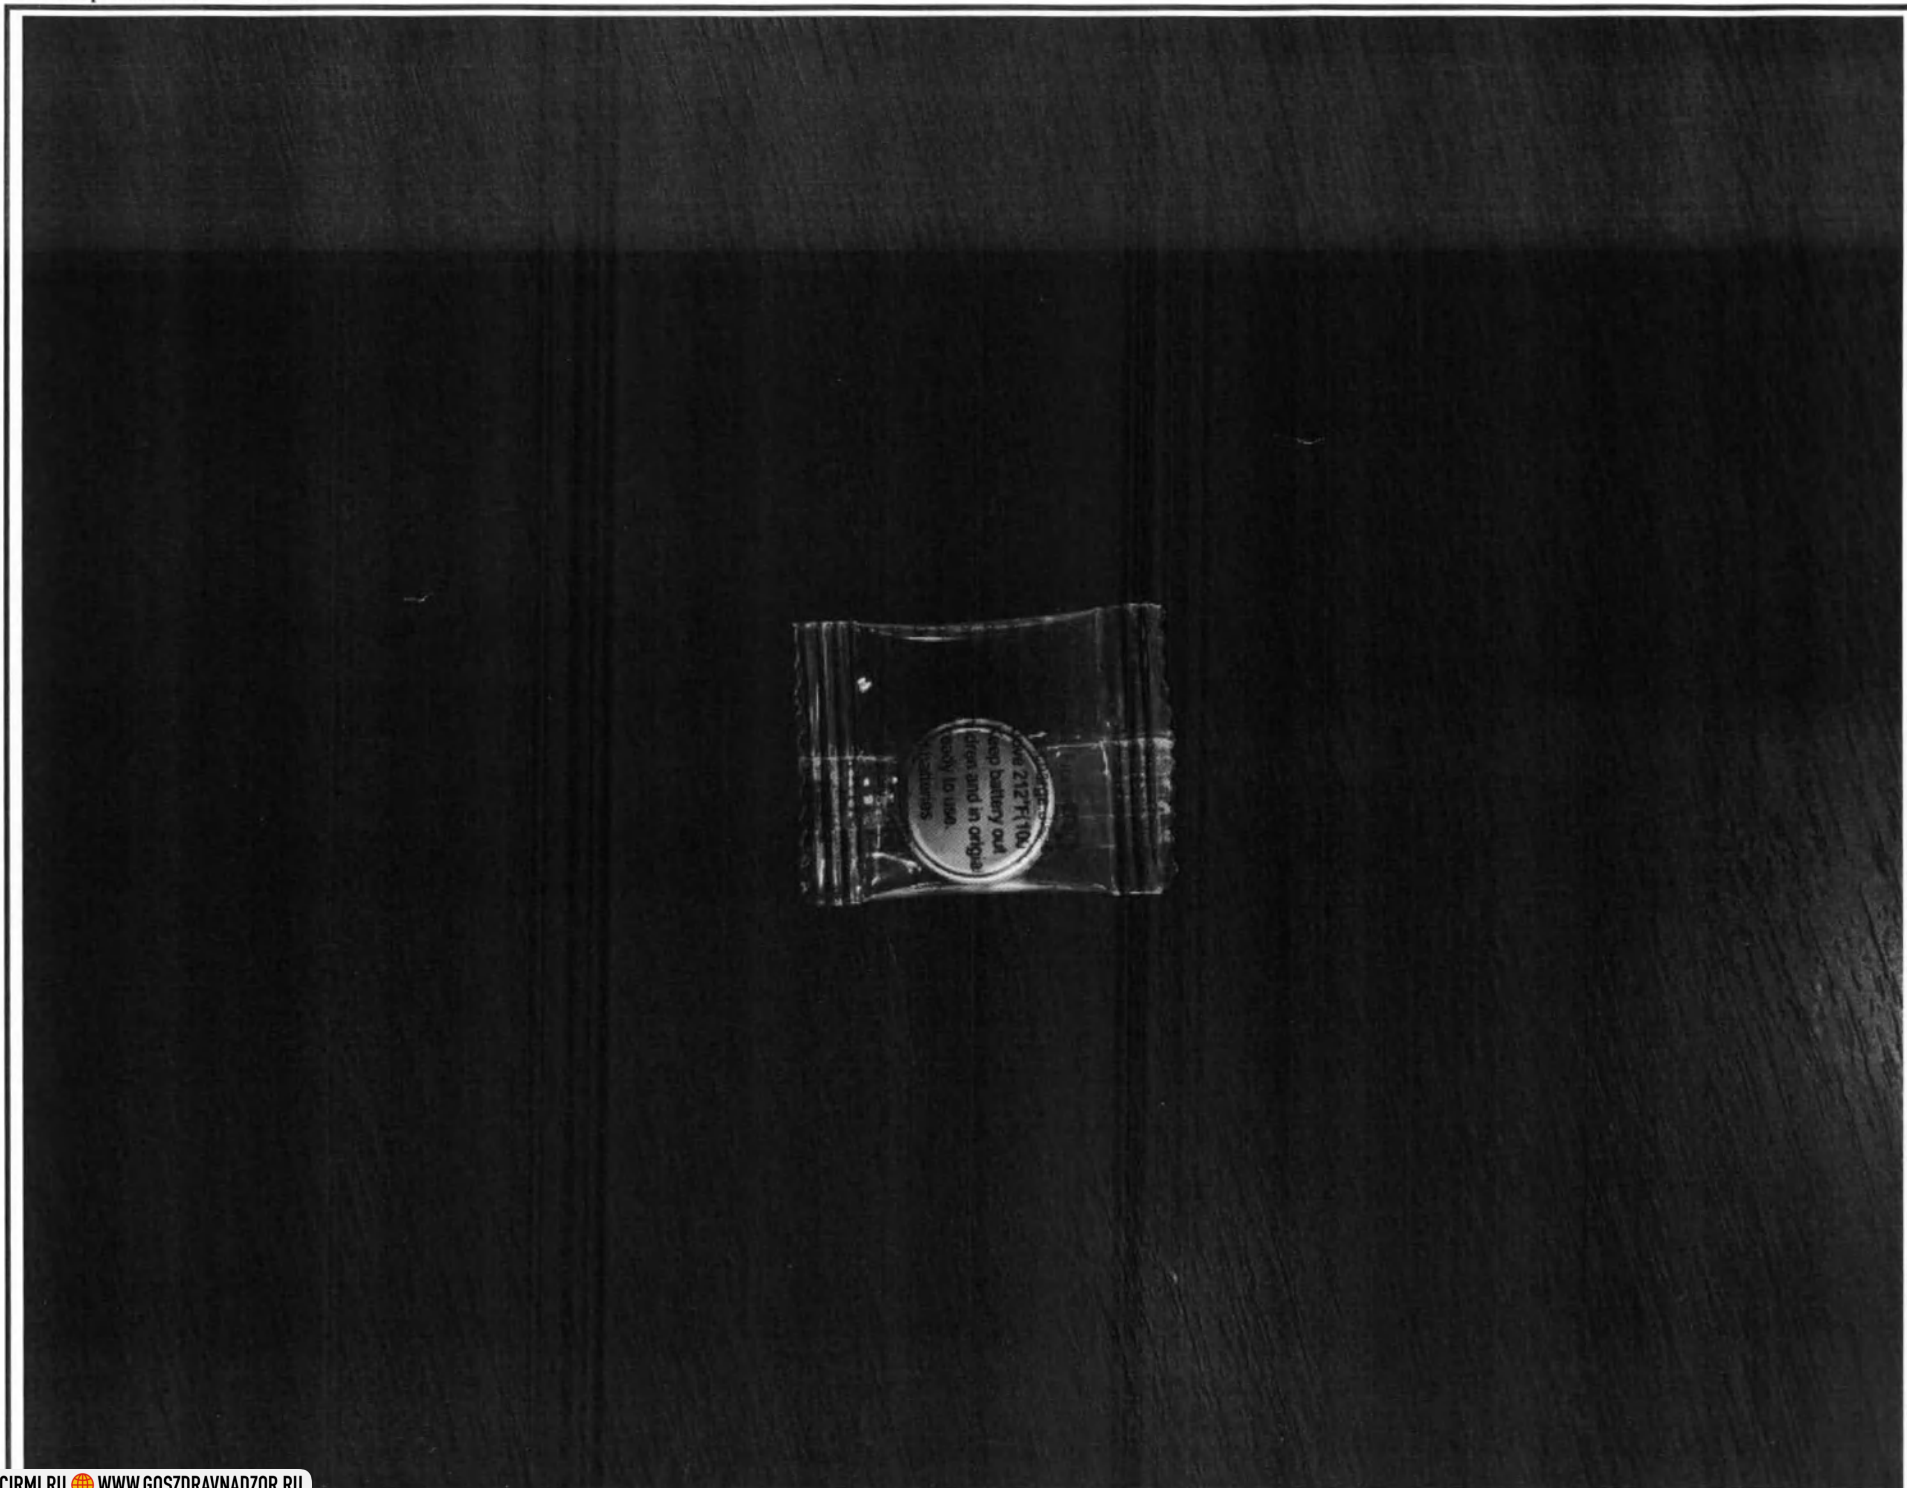

7. Футляр – 1 шт.



Макет маркировки потребительской упаковки (место производства ООО «КоролёвФарм», Россия)



Макет маркировки потребительской упаковки (место производства ОК Biotech Co., Ltd., Тайвань)





Макет маркировки потребительской упаковки (место производства ОК Biotech Co., Ltd., Тайвань)



**Система контроля уровня глюкозы в крови Спутник по ТУ
26.60.12-005-63752244-2023 (комплектация №1), в составе:**

1. Глюкометр Спутник – 1 шт.

SN



2. Тест-полоски Спутник к системе контроля уровня глюкозы
по ТУ 21.20.23-006-63752244-2023 – 10 шт./уп.

LOT



3. Скарификатор Diacont в комплекте со стерильными ланцетами,
производства OK Biotech Co. Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698 – 1 шт.

LOT



4. Контрольный раствор нормальной концентрации – 1 шт.

LOT



5. Батарейка CR2032 – 1 шт.

6. Футляр – 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

**Система контроля уровня глюкозы в крови Спутник по ТУ
26.60.12-005-63752244-2023 (комплектация №2), в составе:**

1. Глюкометр Спутник – 1 шт.

SN



2. Тест-полоски Спутник к системе контроля уровня глюкозы
по ТУ 21.20.23-006-63752244-2023 – 10 шт./уп.

LOT



годен
до:



3. Скарификатор Diacont в комплекте со стерильными ланцетами,
производства OK Biotech Co. Ltd., РУ № ФСЗ 2010/06698 – 1 шт.

LOT



годен
до:



4. Контрольный раствор высокой концентрации – 1 шт.

LOT



годен
до:




5. Батарейка CR2032 – 1 шт.

6. Футляр – 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Макет маркировки транспортной упаковки (место производства ООО «КоролёвФарм», Россия)

Система контроля уровня глюкозы в крови Спутник по ТУ 26.60.12-005-63752244-2023

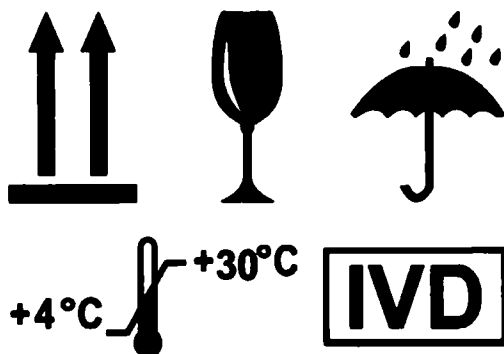

REF 30-20-7731-1025 RUS

КОЛИЧЕСТВО


 **Производитель:** ООО «Диаконт»,
Россия, 125284, г. Москва, ул. Беговая,
д. 13, кв. 90

Место производства:
ООО «КоролёвФарм», Россия,
141074, Московская область,
г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4

Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____ г.

**Год и месяц
упаковывания**

Система контроля уровня глюкозы в крови Спутник по ТУ 26.60.12-005-63752244-2023

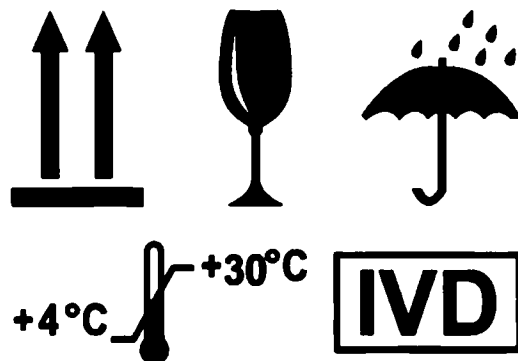

REF 30-20-7731-1025 TWN

КОЛИЧЕСТВО


 Производитель: ООО «Диаконт»,
Россия, 125284, г. Москва, ул. Беговая,
д. 13, кв. 90

Место производства:
OK Biotech Co., Ltd.
No. 91, Sec. 2, Gongdao 5th Road,
30070, Hsinchu City, Taiwan, (Тайвань)

Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____ г.

**Год и месяц
упаковывания**

Система контроля уровня глюкозы в крови Спутник по ТУ 26.60.12-005-63752244-2023

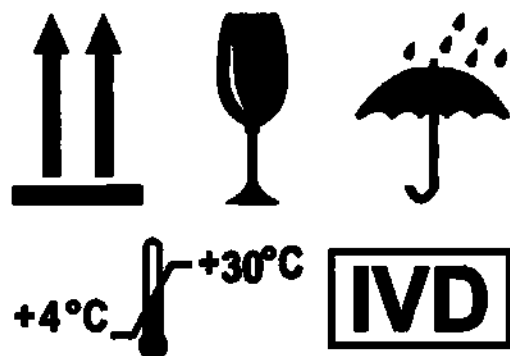

REF 30-20-7731-1026 RUS

КОЛИЧЕСТВО


 **Производитель:** ООО «Диаконт»,
Россия, 125284, г. Москва, ул. Беговая,
д. 13, кв. 90

Место производства:
ООО «КоролёвФарм», Россия,
141074, Московская область,
г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4

Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____ г.

**Год и месяц
упаковывания**

Система контроля уровня глюкозы в крови Спутник по ТУ 26.60.12-005-63752244-2023

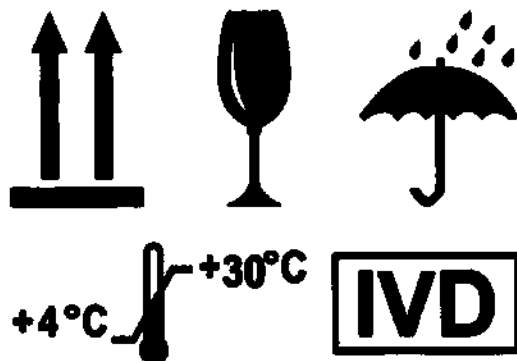

 Производитель: ООО «Диаконт»,
Россия, 125284, г. Москва, ул. Беговая,
д. 13, кв. 90

Место производства:
OK Biotech Co., Ltd.
No. 91, Sec. 2, Gongdao 5th Road,
30070, Hsinchu City, Taiwan, (Тайвань)

REF 30-20-7731-1026 TWN

Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____ г.

КОЛИЧЕСТВО

Год и месяц
упаковывания



ПРОШТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЮ 26.11.

