

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор
ООО «Нейропроджект»

Д.М. Чебурашкин



МАКЕТЫ РУССКОЯЗЫЧНЫХ МАРКИРОВОК НА МЕДИЦИНСКОЕ
ИЗДЕЛИЕ:

Система дренирования спинномозговой жидкости

*Производства Веллонг Инструментс Ко., Лтд. (Wellong Instruments Co., Ltd.), Тайвань,
Китайская Республика*

**Система дренирования спинномозговой
жидкости вентрикулярная EDMS**

РУ: № _____

Дата производства: _____

Использовать до: _____

Артикул: 06128

Код партии: _____

Кол-во: 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Вентрикулярный катетер малый ВМІ

РУ: № _____

Дата производства: _____

Использовать до: _____

Артикул: 06118

Код партии: _____

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

катетер вентрикулярный малый (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт);
троакар (1 шт); стилет (1 шт); инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Вентрикулярный катетер большой ВМІ

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 06118S

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

катетер вентрикулярный большой (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакар (1 шт); стилет (1 шт); инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173

**Вентрикулярный катетер антибактериальный**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 26118

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

катетер вентрикулярный антибактериальный (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакар (1 шт); стилет (1 шт); инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.


Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173

**Резервуар**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04112

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

катетер вентрикулярный со стилетом (1 шт), резервуар (1 шт), игла (1 шт); инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



**Система дренирования спинномозговой
жидкости люмбальная Tuohi**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 06126+06124+06418

Код партии: __+__+__

Кол-во: 1 уп.

Состав упаковки:

1. Линия пациента – 1 шт.

2. Мешок для сбора ликвора – 1 шт

3. Катетер люмбальный малый, в составе: катетер люмбальный малый (1 шт); игла Туохи (1 шт); игла-стилет (1 шт); коннектор Luer (1 шт); фиксатор (2 шт) – 1 шт; инструкция по применению (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Вентрикулярный люмбальный большой,
с открытым концом**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 06419

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

катетер люмбальный большой с открытым концом (1 шт); игла Туохи (1 шт); игла-стилет (1 шт); коннектор Luer (1 шт); фиксатор (2 шт); инструкция (1 шт)

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Система дренирования спинномозговой
жидкости люмбальная**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 06418

Код партии:

Кол-во: 1 уп.

Состав упаковки:

1. Катетер люмбальный малый – 1 шт.
2. Игла Туохи – 1 шт
3. Игла-стиллет – 1 шт
4. Коннектор Luer – 1 шт
5. Фиксатор – 2 шт
6. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Резервуар люмбальный

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 04115

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Система дренирования спинномозговой
жидкости люмбальная, с катетером люмбальным
большим, с открытым концом**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 06419

Код партии:

Кол-во: 1 уп.

Состав упаковки:

1. Катетер люмбальный большой, с открытым концом – 1 шт.
2. Игла Туохи – 1 шт
3. Игла-стиллет – 1 шт
4. Коннектор Luer – 1 шт
5. Фиксатор – 2 шт
6. Инструкция по применению – 1 шт.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Система дренирования спинномозговой жидкости
люмбальная малая, с Т-образным катетером**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 06421Т

Код партии:

Кол-во: 1 уп.

Состав упаковки:

1. Т-образный катетер, малый – 1 шт
2. Коннектор – 1 шт
3. Фиксатор – 2 шт
4. Инструкция по применению – 1 шт

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,

Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Система дренирования спинномозговой жидкости
люмбальная большая, с Т-образным катетером**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 06422Т

Код партии:

Кол-во: 1 уп.

Состав упаковки:

1. Т-образный катетер, большой – 1 шт

2. Коннектор – 1 шт

3. Фиксатор – 2 шт

4. Инструкция по применению – 1 шт

Стерильно. Апирогенно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Система дренирования спинномозговой
и других жидкостей с похожими физическими
характеристиками**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 06648-3 + 06648-2

Код партии:

Кол-во: 1 уп.

Состав упаковки:

1. Резервуар для сбора жидкости – 1 шт.

2. Катетер дренажный с круглой оболочкой – 1 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт

Стерильно. Апирогенно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



**Система дренирования спинномозговой
и других жидкостей с похожими физическими
характеристиками**

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 06648-3 + 06648-4

Код партии:

Кол-во: 1 уп.

Состав упаковки:

1. Резервуар для сбора жидкости – 1 шт.

2. Катетер дренажный с плоской оболочкой, 10 мм – 1 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



Катетер дренажный с плоской оболочкой, 7 мм

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 06648-1

Код партии:

Кол-во: 1 шт.


Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173

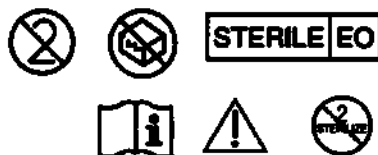

Мешок для сбора спинномозговой жидкости

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 06124

Код партии:

Кол-во: 1 уп.

Стерильно. Апиrogenно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



Линия пациента

РУ: № _____

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 06126

Код партии:

Кол-во: 1 уп.

Стерильно. Апирогенно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел.+7 495 6608173



STERILE EO



Пример русскоязычной маркировки вторичной упаковки, в случае заказа совместно с изделиями «при необходимости»:

Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS	  
РУ: № _____	  
Дата производства:	
Использовать до:	
Артикул: 06128+06118+06118S+26118+04112	
Код партии: _+_+_+_+	
Кол-во: 1 уп.	
Состав упаковки:	
1. Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS – 1 шт.	
2. Вентрикулярный катетер малый BMI, в составе: катетер вентрикулярный малый (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакары (1 шт); стилет (1 шт).	
3. Вентрикулярный катетер большой BMI, в составе: катетер вентрикулярный большой (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакары (1 шт); стилет (1 шт).	
4. Вентрикулярный катетер антибактериальный, в составе: катетер вентрикулярный антибактериальный (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакары (1 шт); стилет (1 шт).	
5. Резервуар, в составе: катетер вентрикулярный со стилетом (1 шт), резервуар (1 шт), игла (1 шт).	
6. Инструкция по применению – 1 шт.	
Стерильно. Апиrogenно.	
Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.	
Производитель: «Веллонг Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика	
Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика	
Эксклюзивный дистрибутор на территории РФ: ООО «Нейропроджект», Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101, Тел.+7 495 6608173	

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

10 (десять) лист 06

Директор _____ /Чебурашкин Д.М.)



«УТВЕРЖДЕНО»

Директор

ООО «Нейропроджект»




Д.М. Чебурашкин

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Система дренирования спинномозговой жидкости


*Производства Веллонг Инструментс Ко., Лтд. (Wellong Instruments Co., Ltd.), Тайвань,
Китайская Республика*

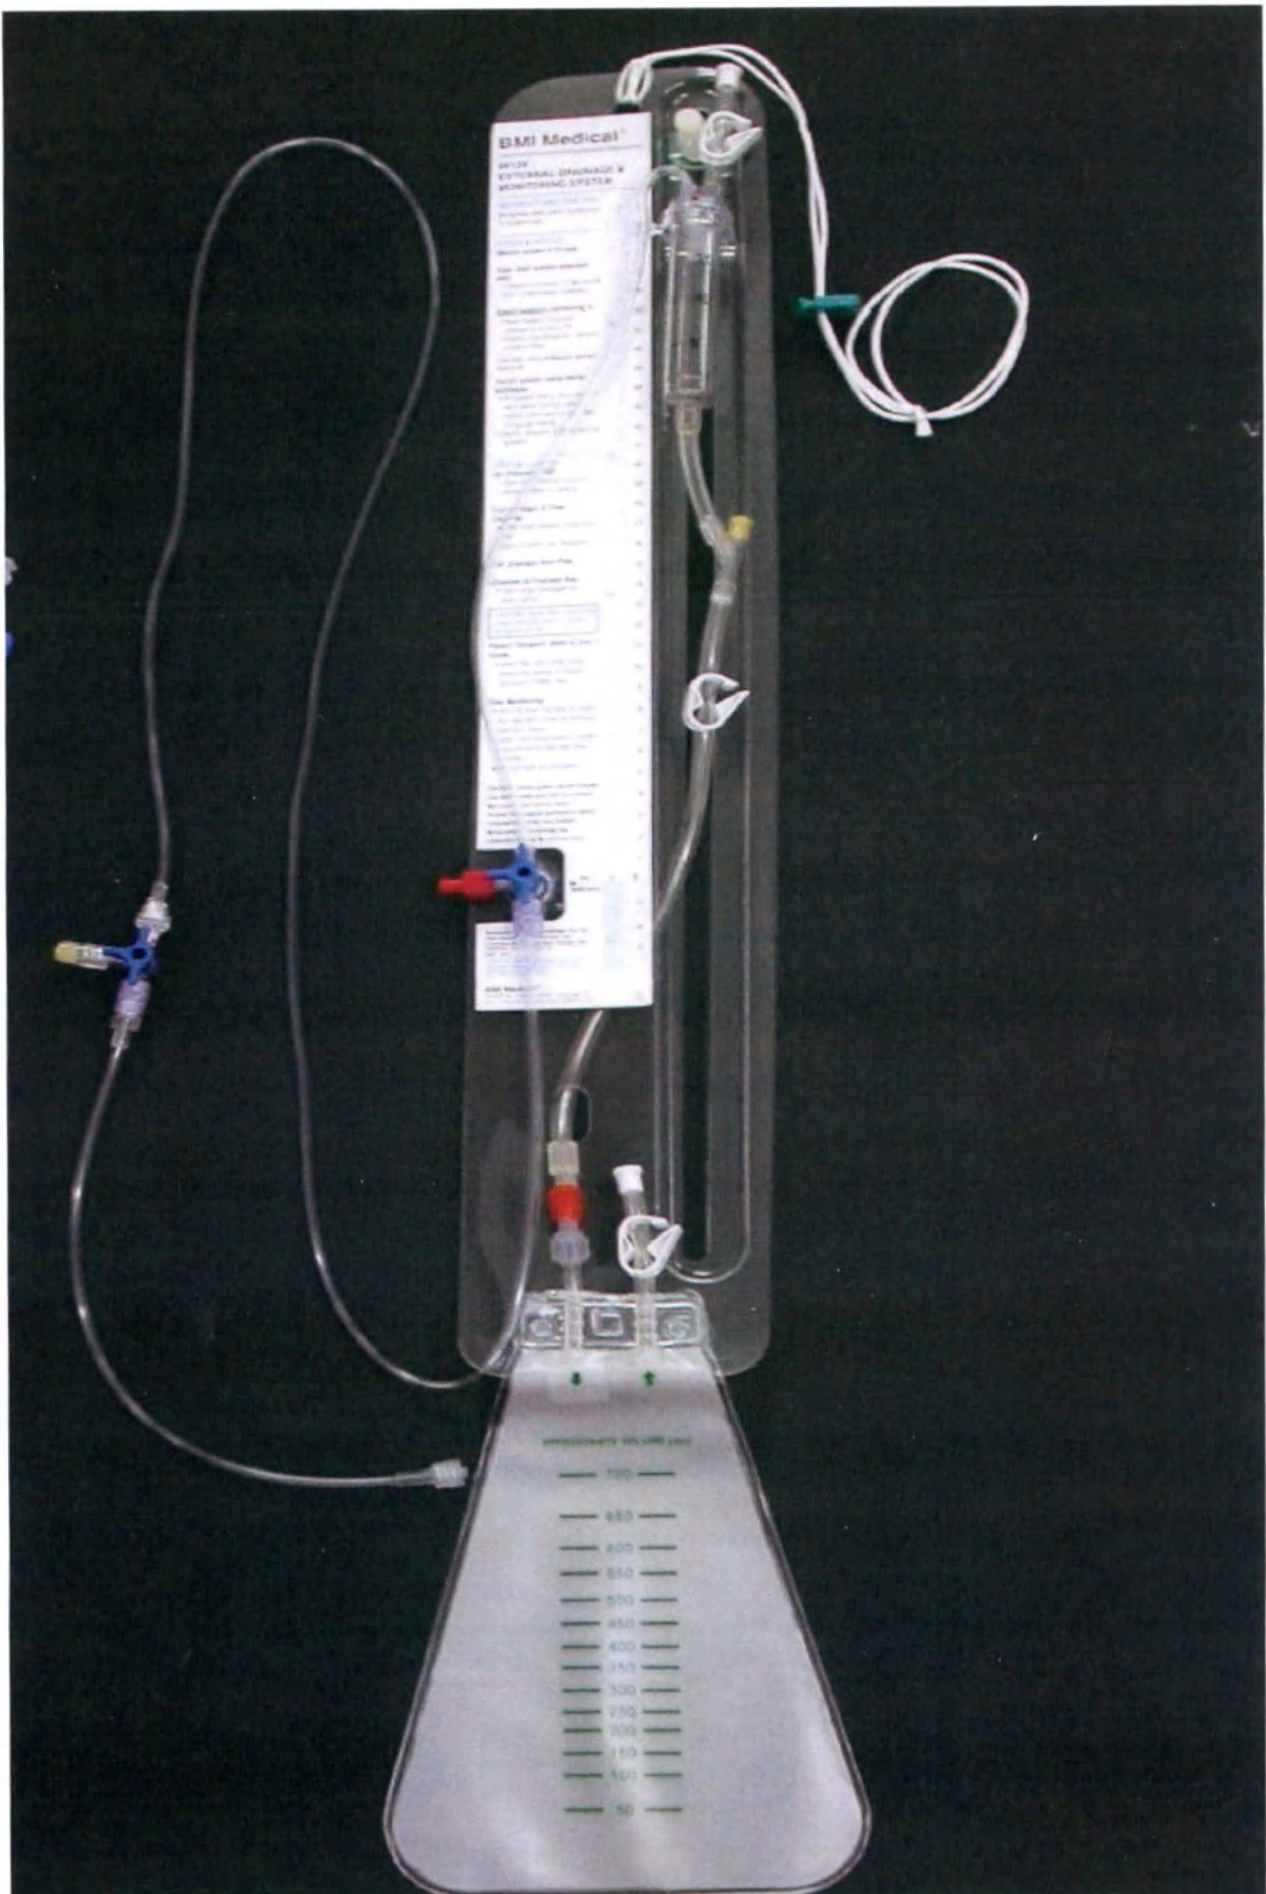


Изделие «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе».



Первичная упаковка изделия «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

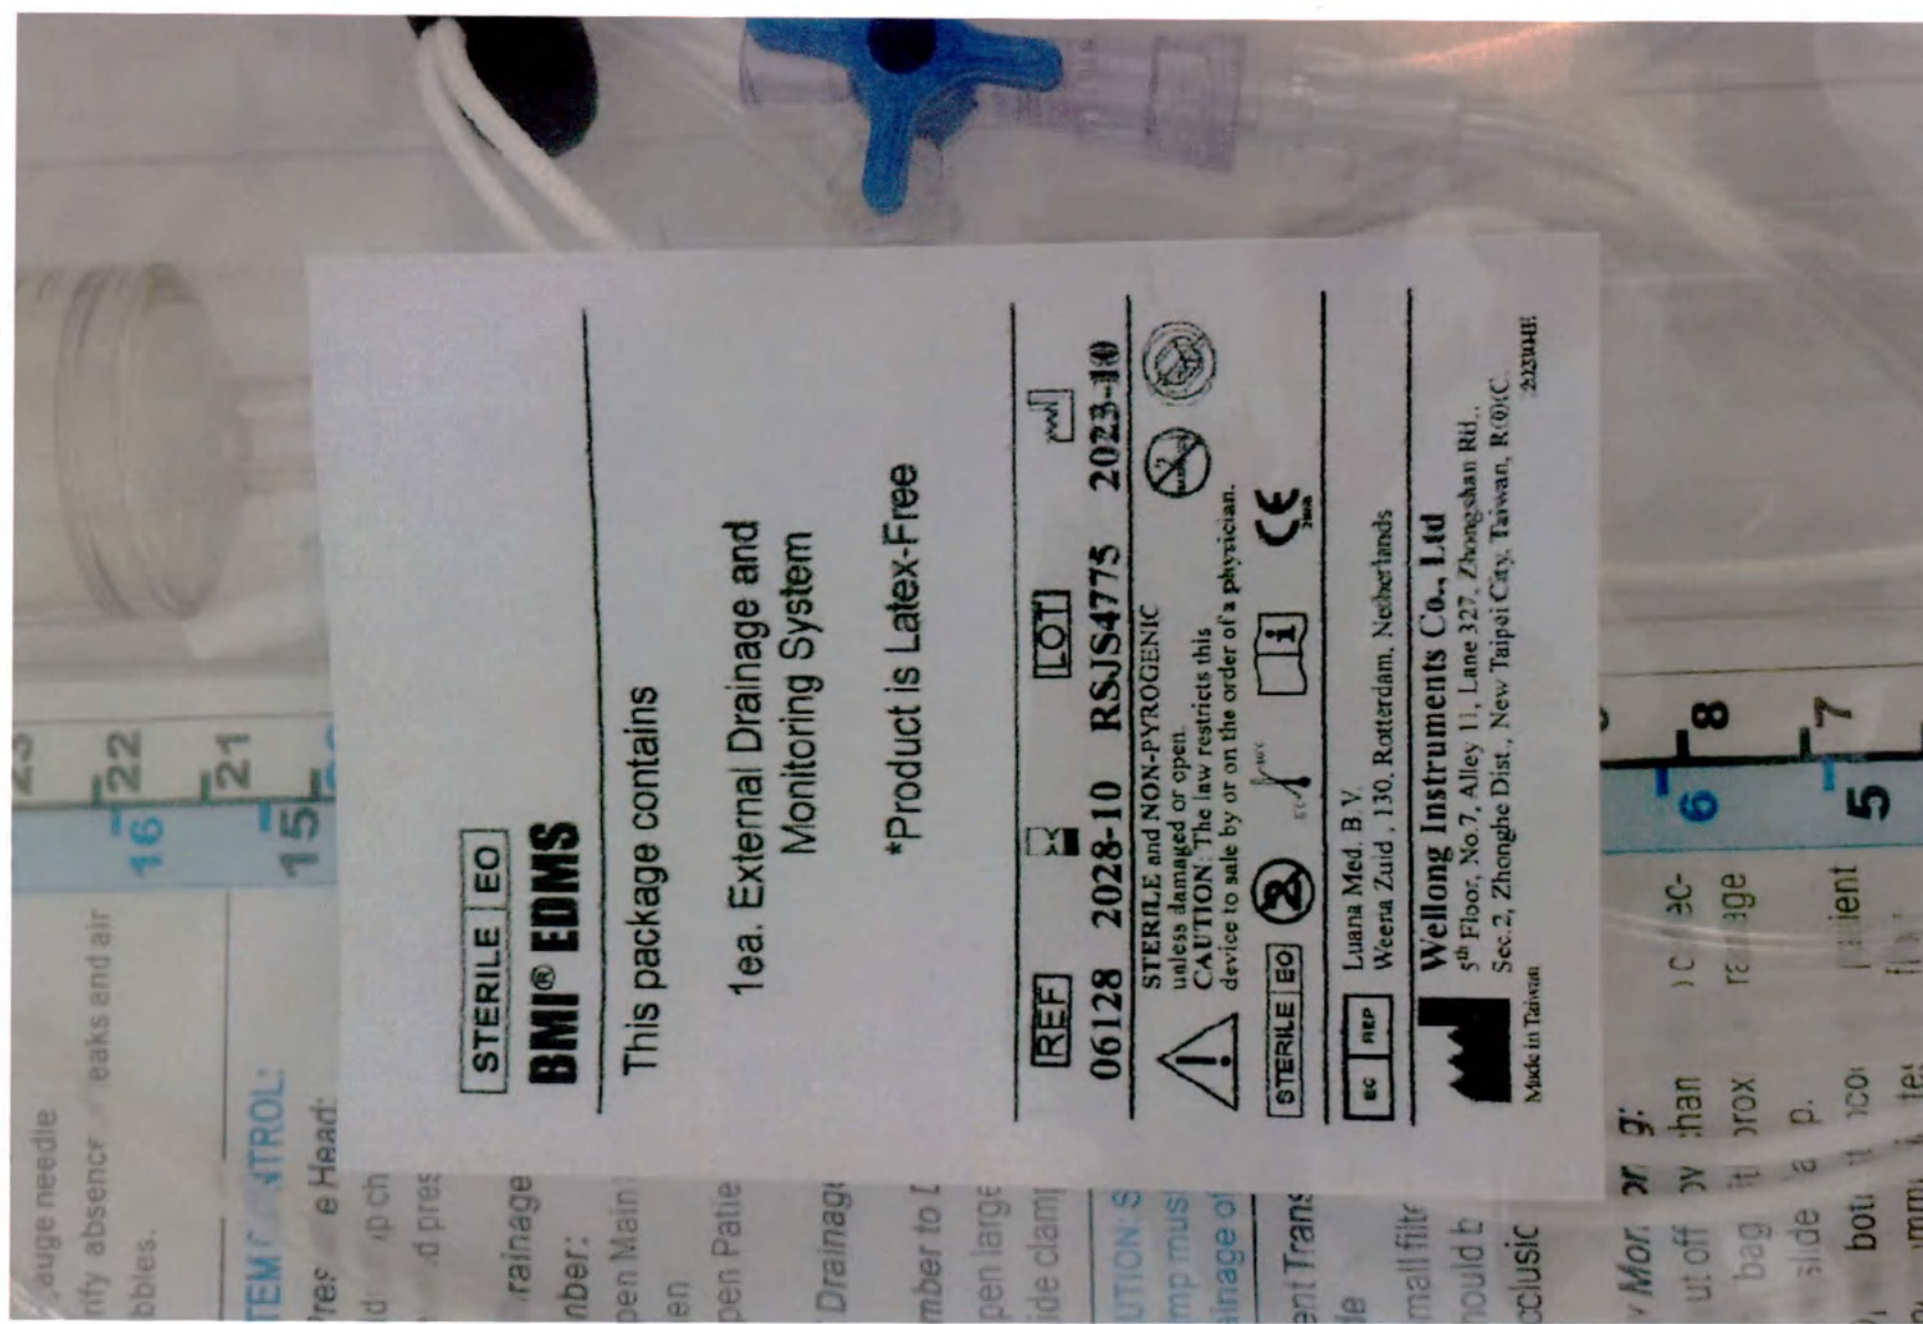

Маркировка производителя на первичной упаковке изделия «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

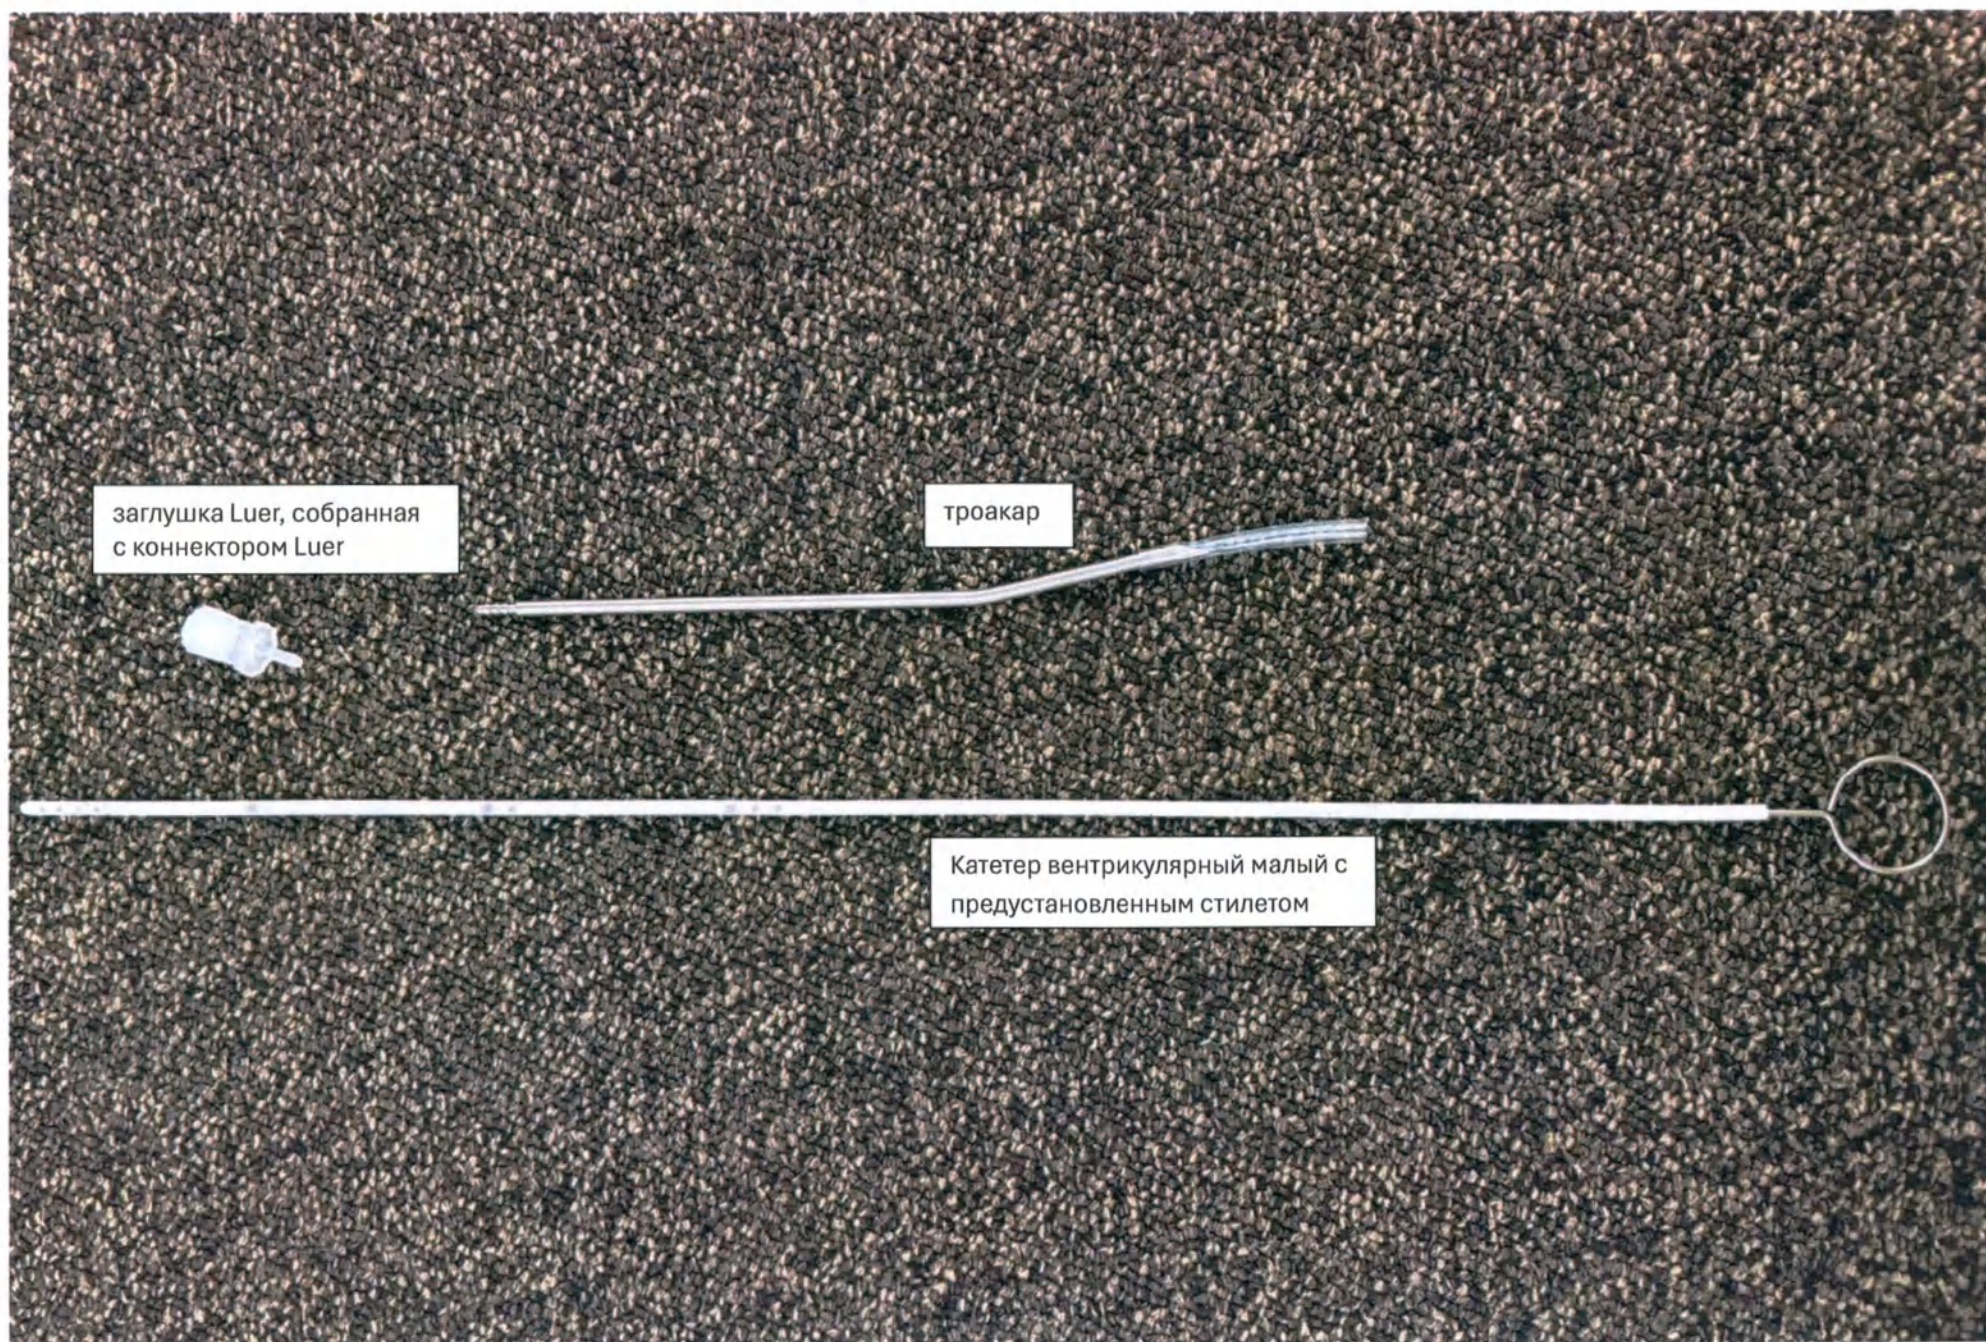


заглушка Luer, собранная
с коннектором Luer

троакар

Катетер вентрикулярный малый с
предустановленным стилетом

Изделие «Вентрикулярный катетер малый ВМІ, в составе: катетер вентрикулярный малый (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакар (1 шт); стилет (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

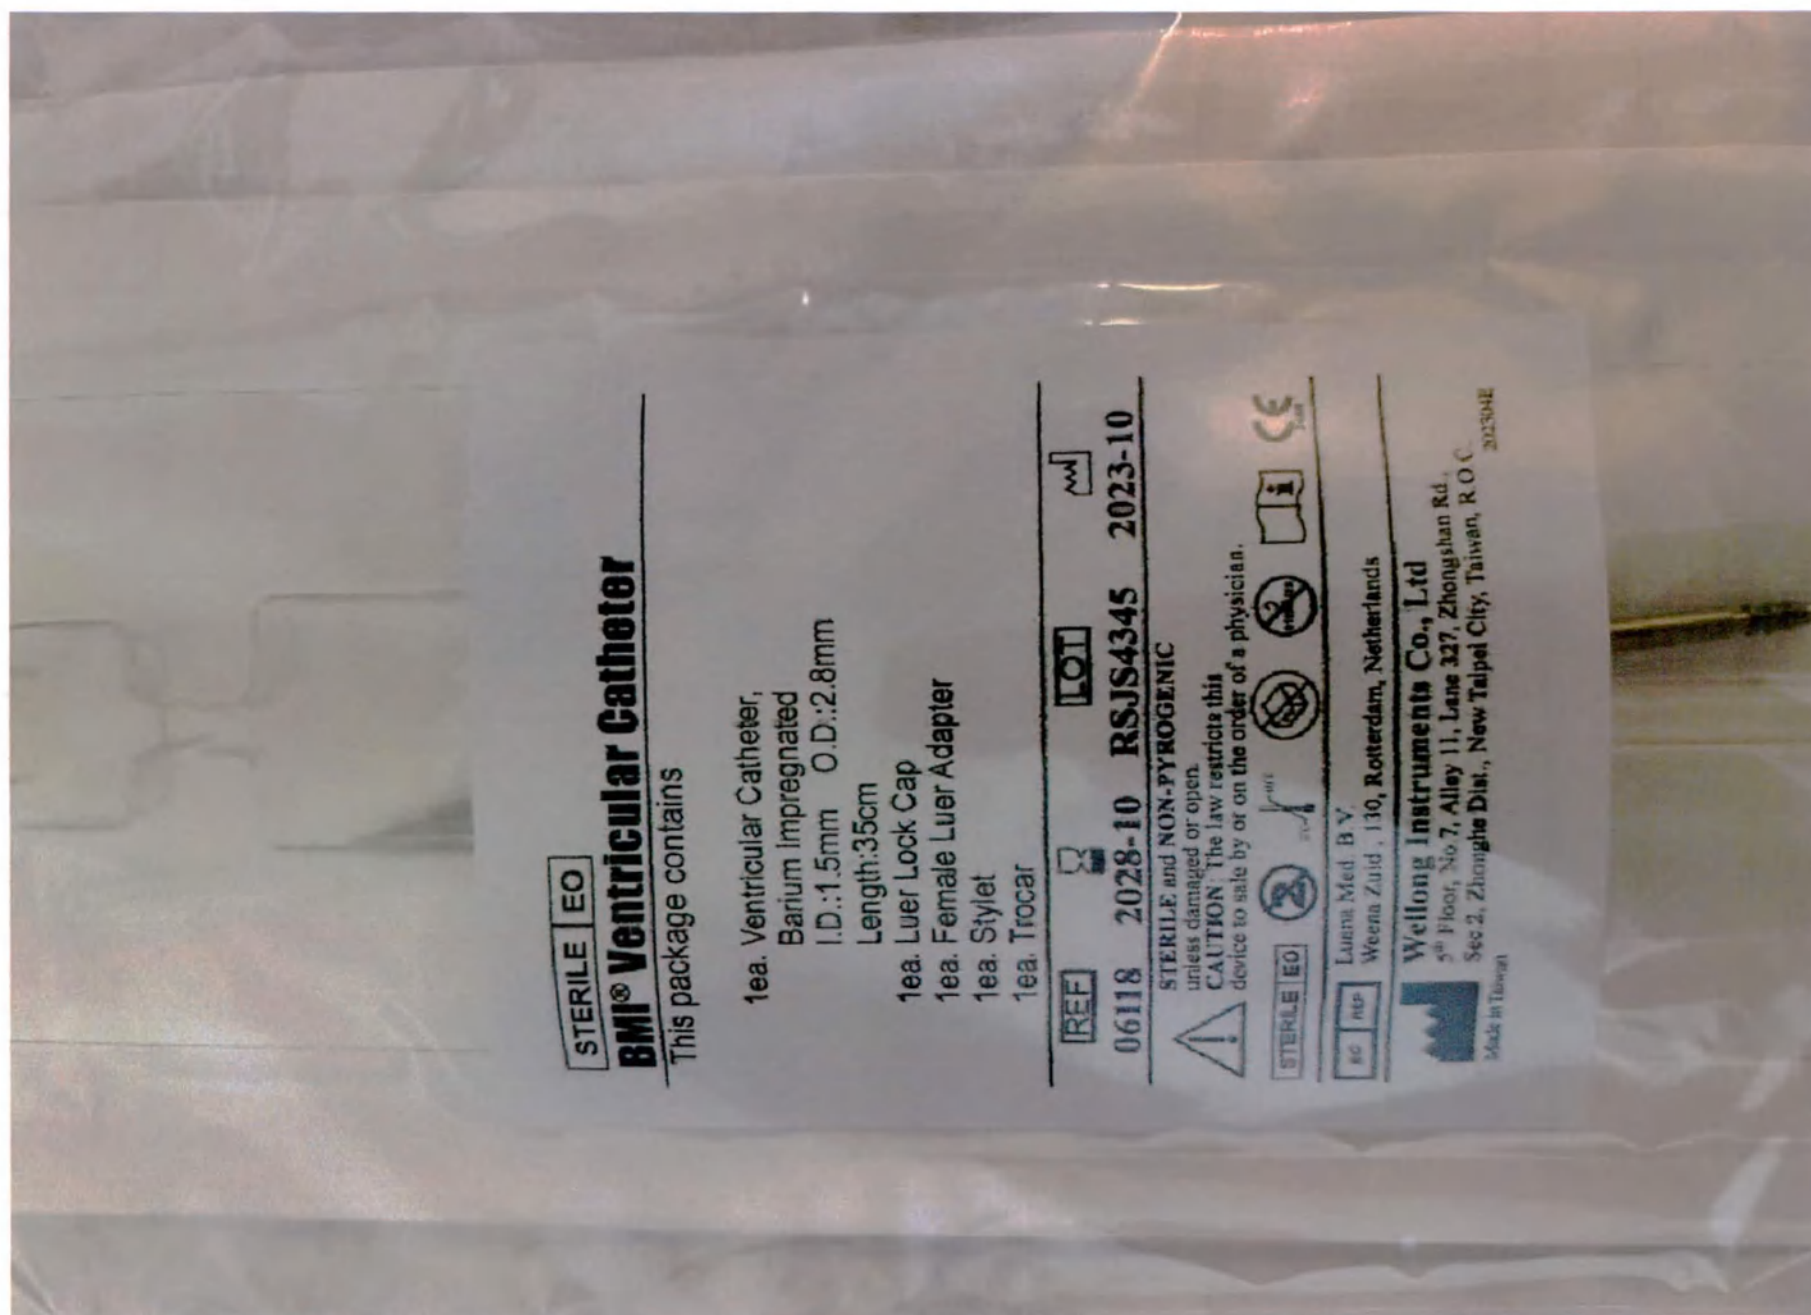

Маркировка производителя на первичной упаковке: изделие «Вентрикулярный катетер малый BMI, в составе: катетер вентрикулярный малый (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакар (1 шт); стилет (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

STERILE EO

BMI® Ventricular Catheter

This package contains

1ea. Ventricular Catheter,
Barium Impregnated
I.D.:1.5mm O.D.:2.8mm
Length:35cm
1ea. Luer Lock Cap
1ea. Female Luer Adapter
1ea. Stylet
1ea. Trocar

REF LOT
06118 2028-10 RSJS4345 2023-10



STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



STERILE EO



EC REP
Luana Med. B. V.
Weena Zuid , 130, Rotterdam, Netherlands

Wellong Instruments Co., Ltd


5th Floor, No 7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,

Sec 2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202304E

Маркировка производителя на вторичной упаковке: изделие «Вентрикулярный катетер малый BMI, в составе: катетер вентрикулярный малый (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакар (1 шт); стилет (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

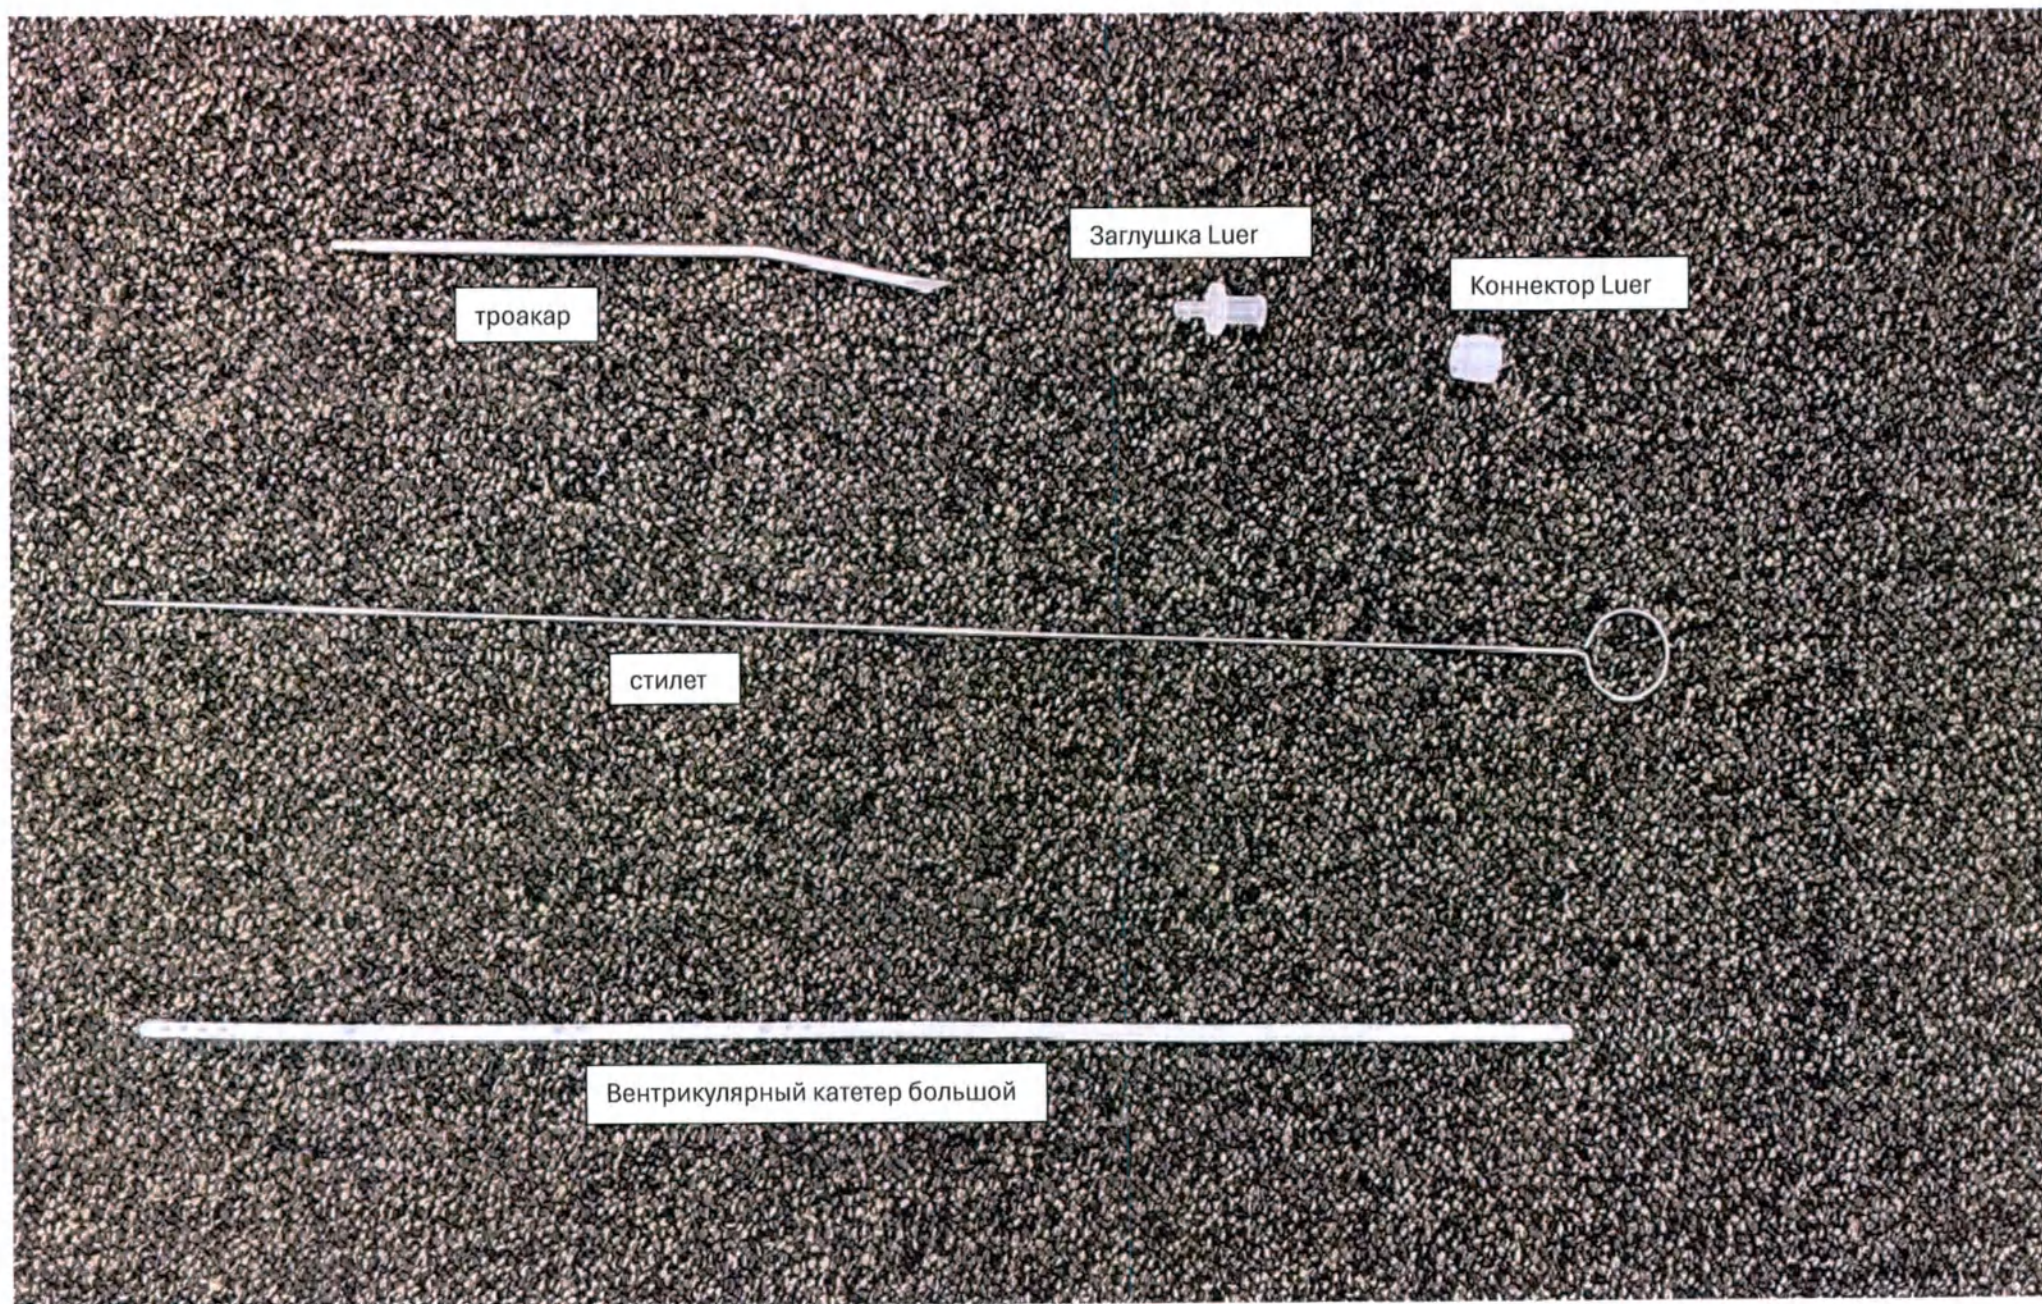

Изделие «Вентрикулярный катетер большой ВМІ, в составе: катетер вентрикулярный большой (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакар (1 шт); стилет (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»



Первичная упаковка изделия «Вентрикулярный катетер большой ВМІ, в составе: катетер вентрикулярный большой (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакар (1 шт); стилет (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

Маркировка производителя на первичной упаковке: изделие «Вентрикулярный катетер большой BMI, в составе: катетер вентрикулярный большой (1 шт); заглушка Луер (1 шт); коннектор Луер (1 шт); трокар (1 шт); стилет (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

STERILE EO

BMI® Ventricular Catheter

This package contains

- 1ea. Ventricular Catheter,
Barium Impregnated
I.D.:2.1mm O.D.:3.5mm
Length:35cm
- 1ea. Luer Lock Cap
- 1ea. Female Luer Adapter
- 1ea. Stylet
- 1ea. Trocar

REF



LOT




06118S

2028-03

RSSS4409

2023-03



STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.


STERILE EO



EC REP

Surgilab S.A.S.

Immeuble ARY FRONTON Place du jeu de PAUME 64240
HASPARREN FRANCE



Wellong Instruments Co., Ltd


5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202104D



Изделие «Вентрикулярный катетер антибактериальный, в составе: катетер вентрикулярный антибактериальный (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакар (1 шт); стилет (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

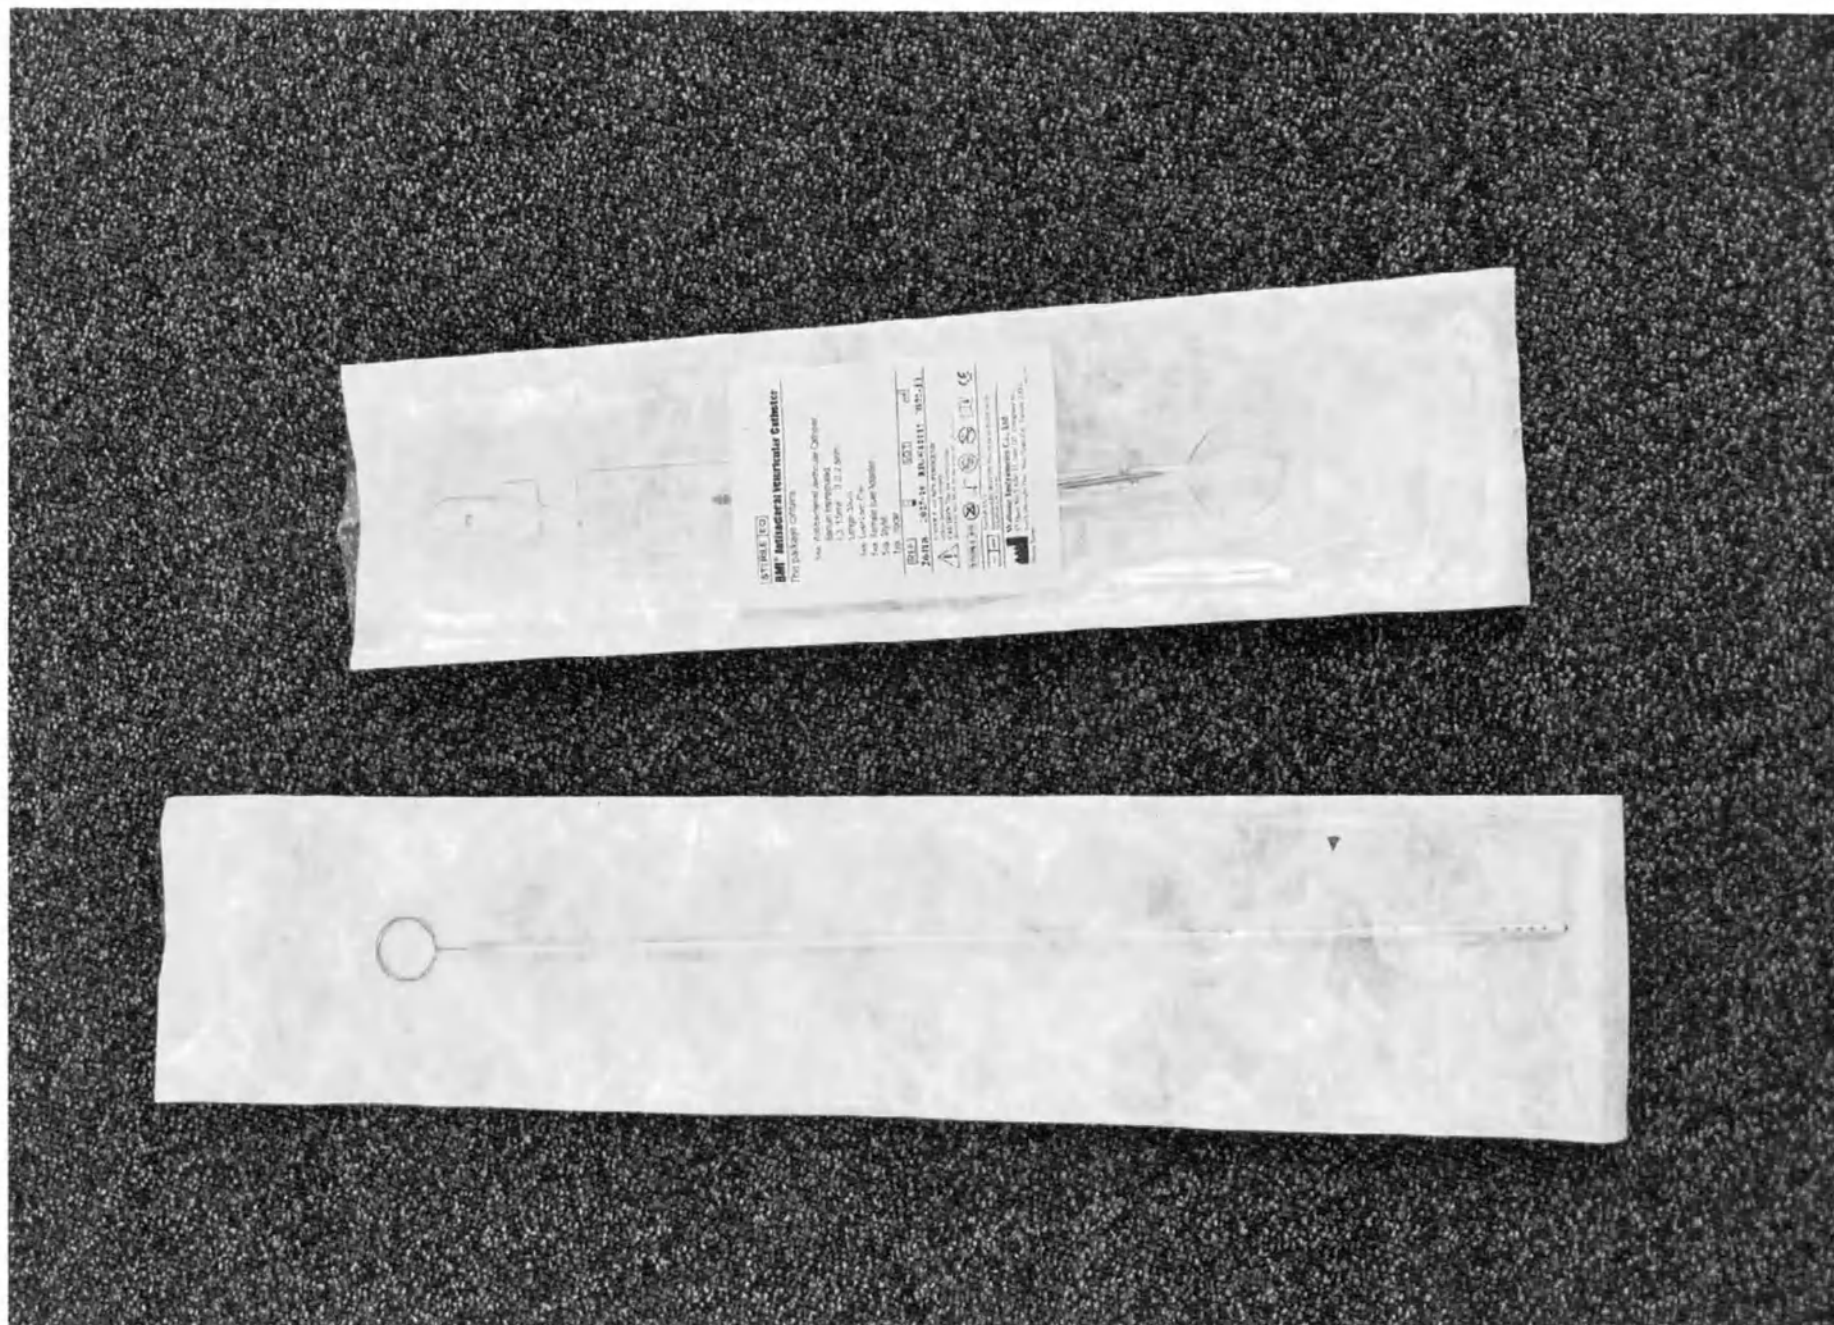

Первичная упаковка изделия «Вентрикулярный катетер антибактериальный, в составе: катетер вентрикулярный антибактериальный (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакар (1 шт); стилет (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

Маркировка производителя на первичной упаковке изделия «Вентрикулярный катетер антибактериальный, в составе: катетер вентрикулярный антибактериальный (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакар (1 шт); стилет (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

STERILE EO

BMI® Antibacterial Ventricular Catheter

This package contains

- 1ea. Antibacterial Ventricular Catheter,
Barium Impregnated
I.D.:1.5mm O.D.:2.8mm
Length:35cm
- 1ea. Luer Lock Cap
- 1ea. Female Luer Adapter
- 1ea. Stylet
- 1ea. Trocar

REF



LOT



26118 2027-10 RRJS12112 2022-10



STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REP

Surgilab S.A.S.

Immeuble ARY FRONTON Place du jeu de PAUME 64240
HASPARREN FRANCE



Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202104D



Вторичная упаковка изделия «Вентрикулярный катетер антибактериальный, в составе: катетер вентрикулярный антибактериальный (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакар (1 шт); стилет (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

STERILE EO

BMI® Antibacterial Ventricular Catheter

This package contains

1ea. Antibacterial Ventricular Catheter,

Barium Impregnated

I.D.:1.5mm O.D.:2.8mm

Length:35cm

1ea. Luer Lock Cap

1ea. Female Luer Adapter

1ea. Stylet

1ea. Trocar

REF 26118 LOT RRJS12112

2027-10 2022-10

STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



STERILE EO



SurgeLab S.A.S.

Innovative ARV FRONTON Place du Jeu de PAUMIE 64240
HASPARREN FRANCE

EO REP


Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec 2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

302104D

Маркировка производителя на вторичной упаковке изделия «Вентрикулярный катетер антибактериальный, в составе: катетер вентрикулярный антибактериальный (1 шт); заглушка Luer (1 шт); коннектор Luer (1 шт); троакар (1 шт); стилет (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

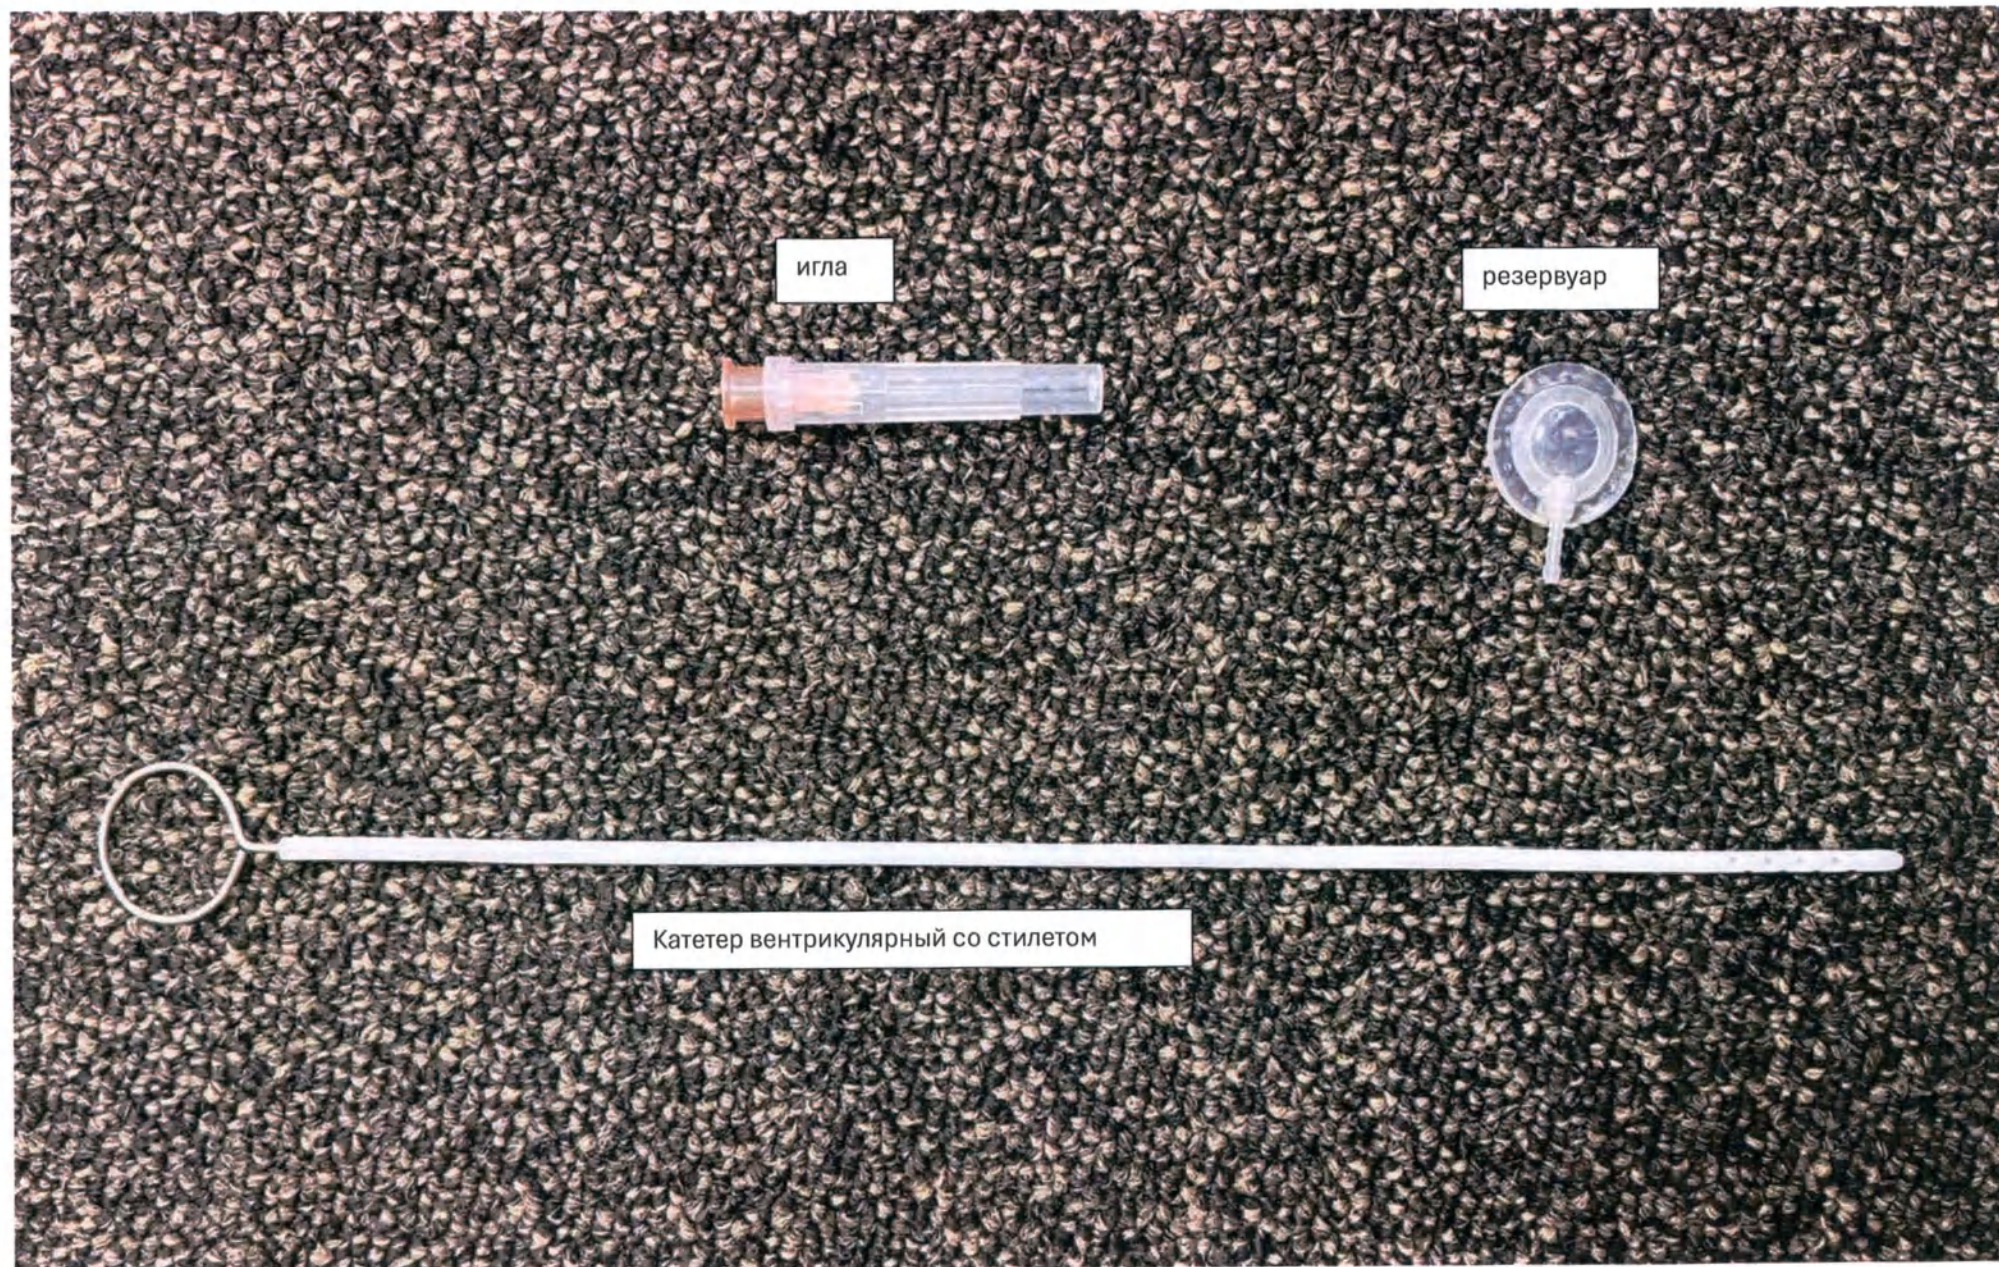

Изделие «Резервуар, в составе: катетер вентрикулярный со стилетом (1 шт), резервуар (1 шт), игла (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

Маркировка производителя на первичной упаковке изделия «Резервуар, в составе: катетер вентрикулярный со стилетом (1 шт), резервуар (1 шт), игла (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

STERILE EO

BMI® Ventricular Reservoir

This package contains one:

- 1ea. CSF-Ventricular Reservoir, OMMAYA
Burr Hole
Dia.: 12mm
- 1ea. Hypodermic Needle, 27G
- 1ea. Ventricular Catheter
Barium Impregnated,
I.D.: 1.3mm O.D.: 2.5mm
Length: 20cm

REF



LOT



04112 2027-11 RRNS7603 2022-11



STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REP

Surgilab S.A.S.
Immeuble ARY FRONTON Place du Jeu de PAUME 64240
HASPARREN FRANCE



Wellong Instruments Co., Ltd
5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan 3rd
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan

Made in Taiwan



Вторичная упаковка изделия «Резервуар, в составе: катетер вентрикулярный со стилетом (1 шт), резервуар (1 шт), игла (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

STERILE EO

BMI® Ventricular Reservoir

This package contains one:

- 1ea. CSF-Ventricular Reservoir, OMMAYA
Burr Hole
Dia.: 12mm
- 1ea. Hypodermic Needle, 27G
- 1ea. Ventricular Catheter
Barium Impregnated,
I.D.: 1.3mm O.D.: 2.5mm
Length: 20cm

REF



LOT



04112 2027-11 RRNS7603 2022-11



STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REP

Surgilab S.A.S.

Immeuble ARY FRONTON Place du jeu de PAUME 64240

HASPARREN FRANCE



Wellong Instruments Co., Ltd


5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,

Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202104D

Маркировка производителя на вторичной упаковке изделия «Резервуар, в составе: катетер вентрикулярный со стилетом (1 шт), резервуар (1 шт), игла (1 шт)» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости вентрикулярная EDMS, в составе»

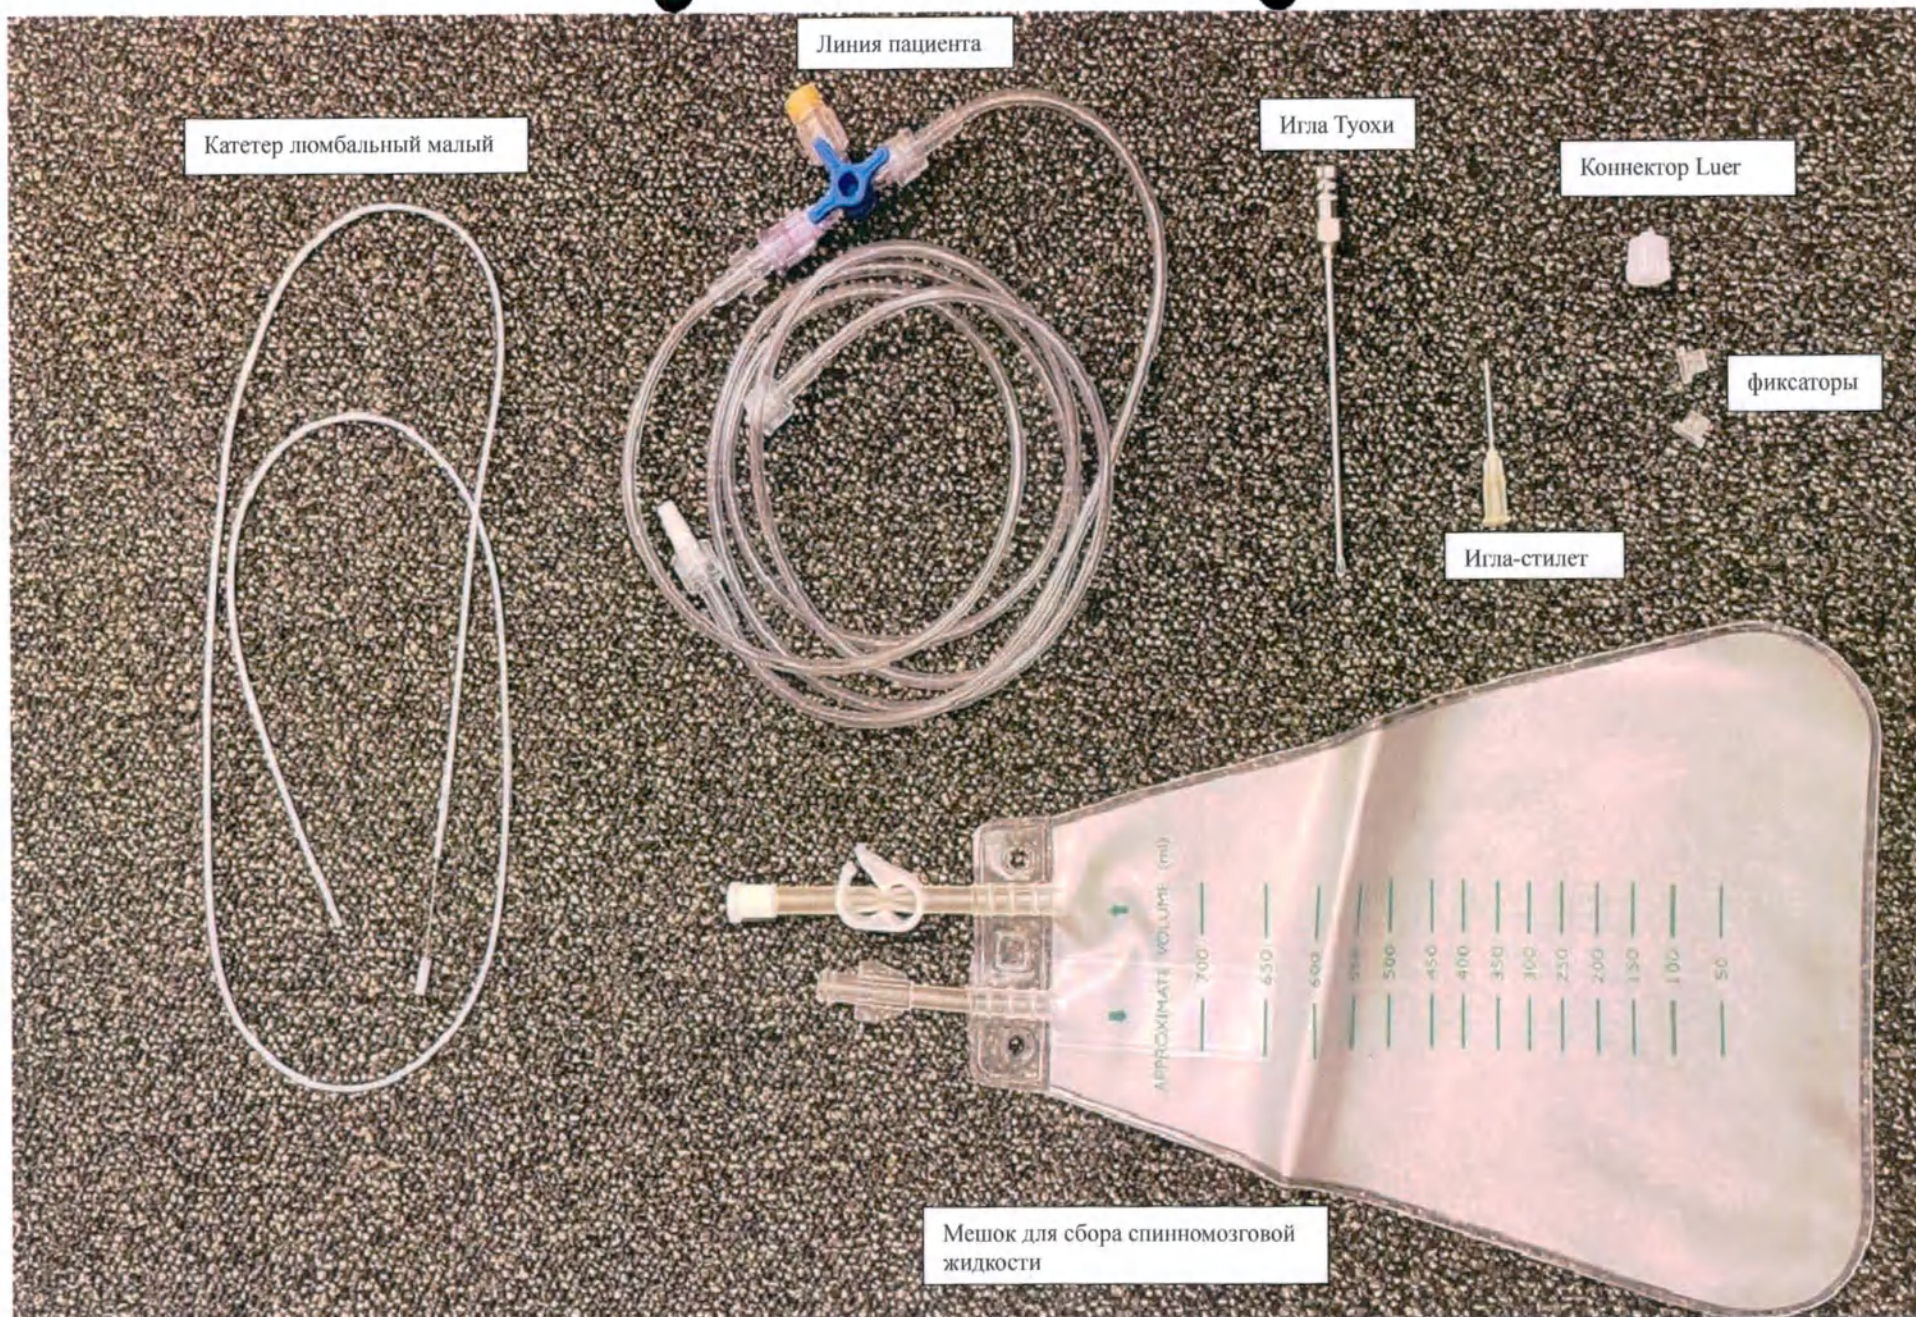

Обязательный комплект поставки варианта исполнения Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная Tuohi, в составе: Линия пациента – 1 шт (артикул 06126). Мешок для сбора спинномозговой жидкости – 1 шт. Катетер люмбальный малый, в составе: катетер люмбальный малый (1 шт); игла Туохи (1 шт); игла-стилет (1 шт); коннектор Luer (1 шт); фиксатор (2 шт) – 1 шт (артикул 06418).



Первичная упаковка изделия «Катетер люмбальный малый, в составе: катетер люмбальный малый (1 шт); игла Туохи (1 шт); игла-стилет (1 шт); коннектор Luer (1 шт); фиксатор (2 шт) – 1 шт» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная Tuohi, в составе»

STERILE EO

BMI® Lumbar Part

This package contains one:

- 1 ea. Lumbar Part, Barium Impregnated
I.D.: 0.7mm O.D.: 1.5mm Length: 80cm
- 1 ea. Tuohy Needle, 14-gauge
- 1 ea. Stainless Steel Stylet
- 1 ea. Female Luer Adapter
- 2 ea. Fixation Tab

REF

06418 2028-11 RSNS5211 2023-11



LOT



STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REP

Lusma Med B V

Weens Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands

Wellong Instruments Co., Ltd


5th Floor, No. 7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,

Sec. 2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

1023ME

Маркировка производителя на первичной упаковке изделия «Катетер люмбальный малый, в составе: катетер люмбальный малый (1 шт); игла Туохи (1 шт); игла-стилет (1 шт); коннектор Luer (1 шт); фиксатор (2 шт) – 1 шт» из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная Tuohi, в составе»

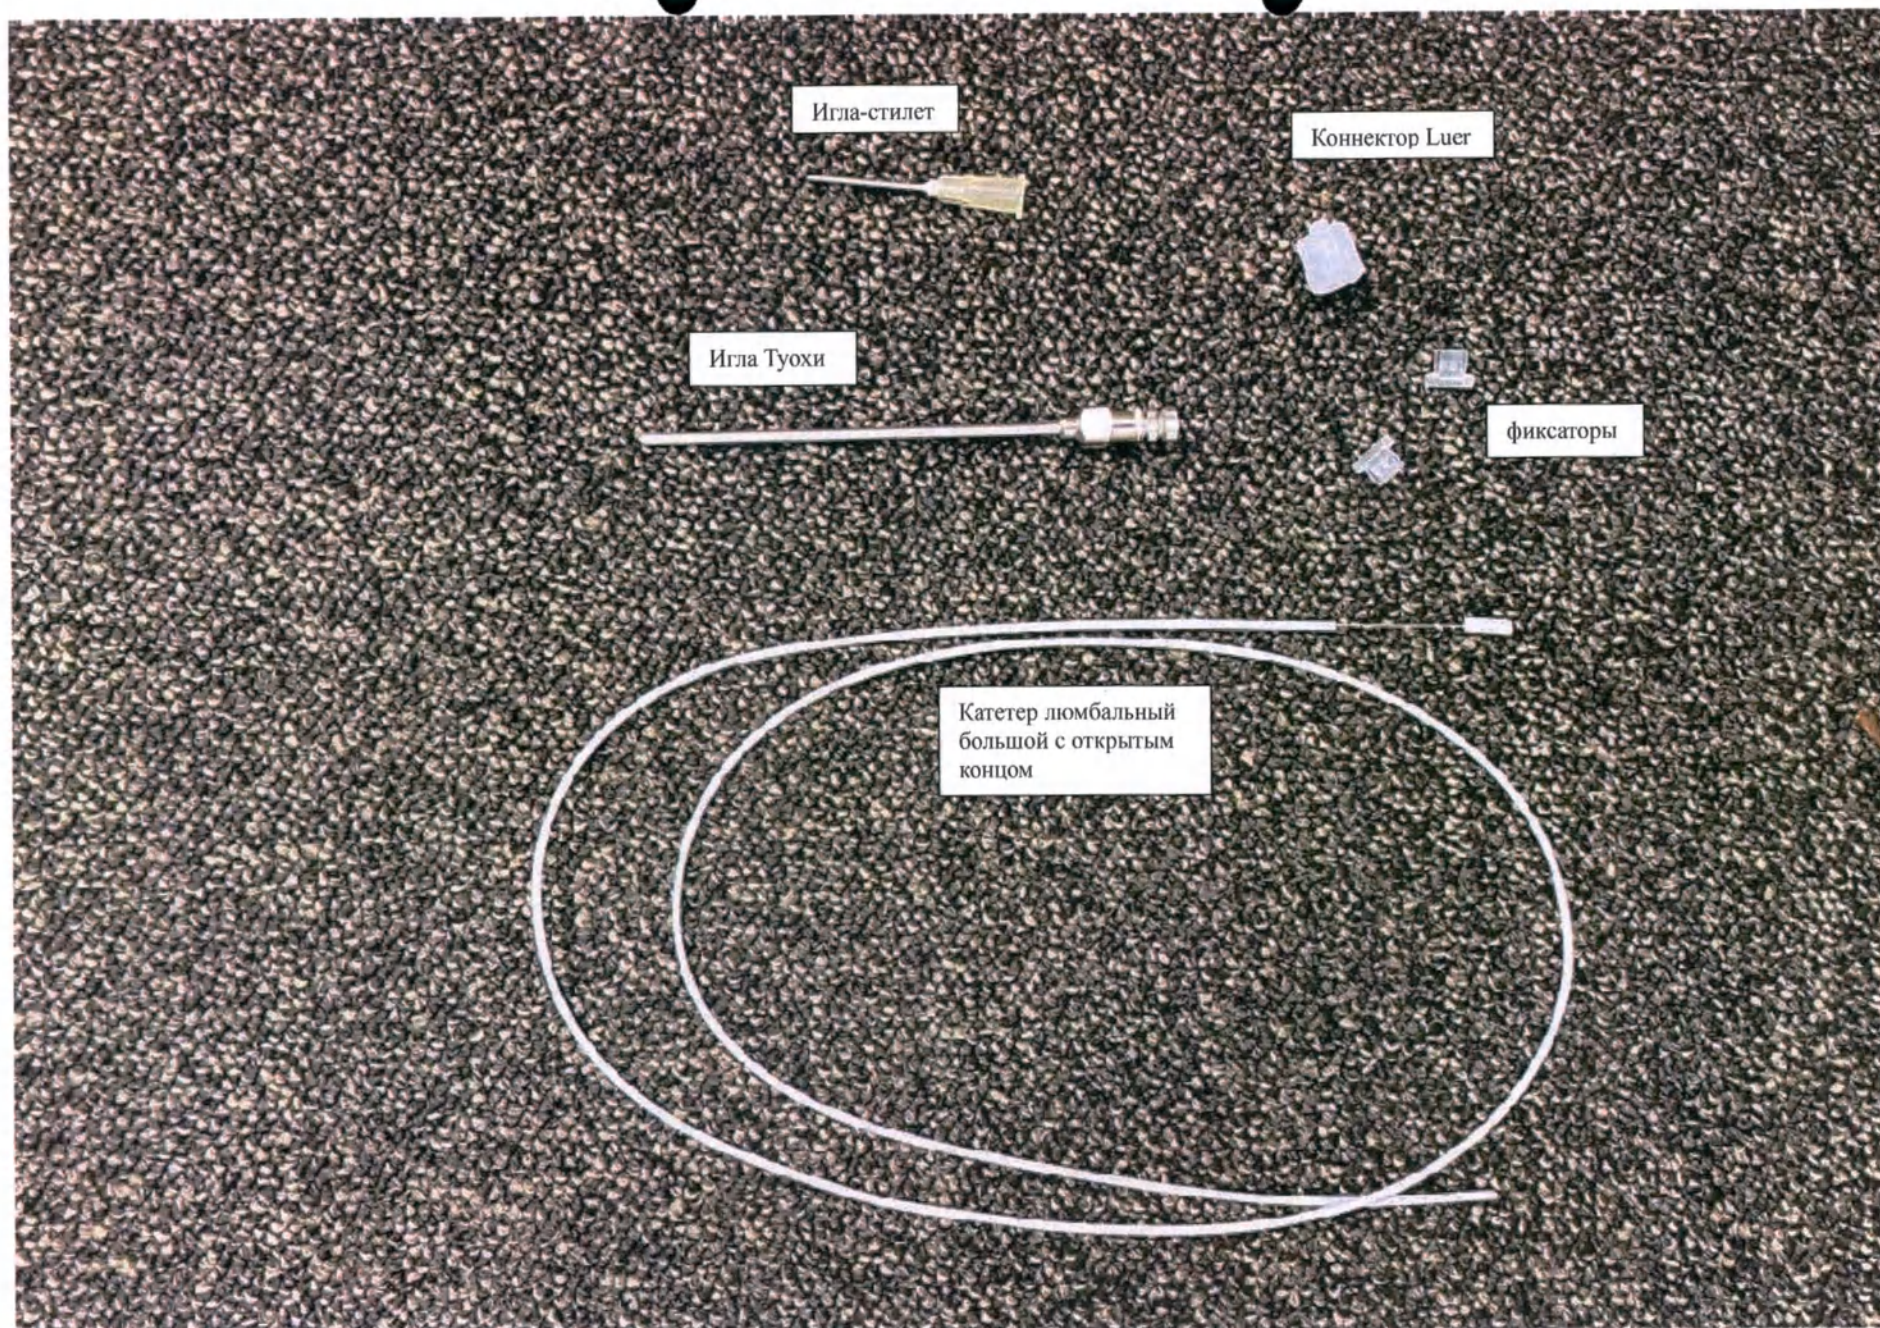

Изделие «Катетер люмбальный большой, с открытым концом в составе: катетер люмбальный большой с открытым концом (1 шт); игла Туохи (1 шт); игла-стилет (1 шт); коннектор Luer (1 шт); фиксатор (2 шт)», поставляющееся «по необходимости» к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная Tuohi, в составе» и в качестве обязательной поставки к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом в составе»



Первичная упаковка изделия «Катетер люмбальный большой, с открытым концом в составе: катетер люмбальный большой с открытым концом (1 шт); игла Туохи (1 шт); игла-стилет (1 шт); коннектор Luer (1 шт); фиксатор (2 шт)», поставляющееся «по необходимости» к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная Туохи, в составе» и в качестве обязательной поставки к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе»

STERILE EO

BMI® Lumbar Part

This package contains one:

- 1ea. Lumbar Part, Barium Impregnated
I.D.:0.7mm O.D.:1.5mm Length:84cm
- 1ea. Tuohy Needle, 14-gauge
- 1ea. Stainless Steel Stylet
- 1ea. Female Luer Adapter
- 2ea. Fixation Tab

REF




LOT



06419

2027-05 RRWS5303 2022-05



STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REP

Surgilab S.A.S.
Immeuble ARY FRONTON Place du jeu de PAUME 64240
HASPARREN FRANCE



Made in Taiwan

Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

202104D

Маркировка производителя на первичной упаковке изделия «Катетер люмбальный большой, с открытым концом в составе: катетер люмбальный большой с открытым концом (1 шт); игла Туохи (1 шт); игла-стилет (1 шт); коннектор Luer (1 шт); фиксатор (2 шт)», поставляющееся «по необходимости» к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная Tuohi, в составе» и в качестве обязательной поставки к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе»

STERILE EO

BMI® Tuohy Needle Set

This package contains one:

- 06418 1ea. Tuohy Needle Set, Barium Impregnated
I.D.:0.7mm O.D.:1.5mm Length:80cm
- 1ea. Tuohy Needle, 14-gauge
1ea. Stainless Steel Stylet
1ea. Female Luer Adapter
2ea. Fixation Tab
1ea. Patient Connection Line
- 06126
- 06124 1ea. EDMS Drainage Bag 700ml

REF		LOT	
06418	2028-06	RSLS5205	2023-06
06126	2028-11	RSNS4605	2023-11
06124	2028-11	RSNS4546	2023-11

STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



STERILE EO



Luana Med. B.V.

Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands

Wellong Instruments Co., Ltd


5th Floor, No. 7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,

Sec 2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202304E

Маркировка производителя вторичной упаковки обязательного комплекта поставки варианта исполнения Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная Tuohi, в составе: Линия пациента – 1 шт, Мешок для сбора спинномозговой жидкости – 1 шт, Катетер люмбальный малый, в составе: катетер люмбальный малый (1 шт); игла Туохи (1 шт); игла стилет (1 шт); коннектор Luer (1 шт); фиксатор (2 шт) – 1 шт.

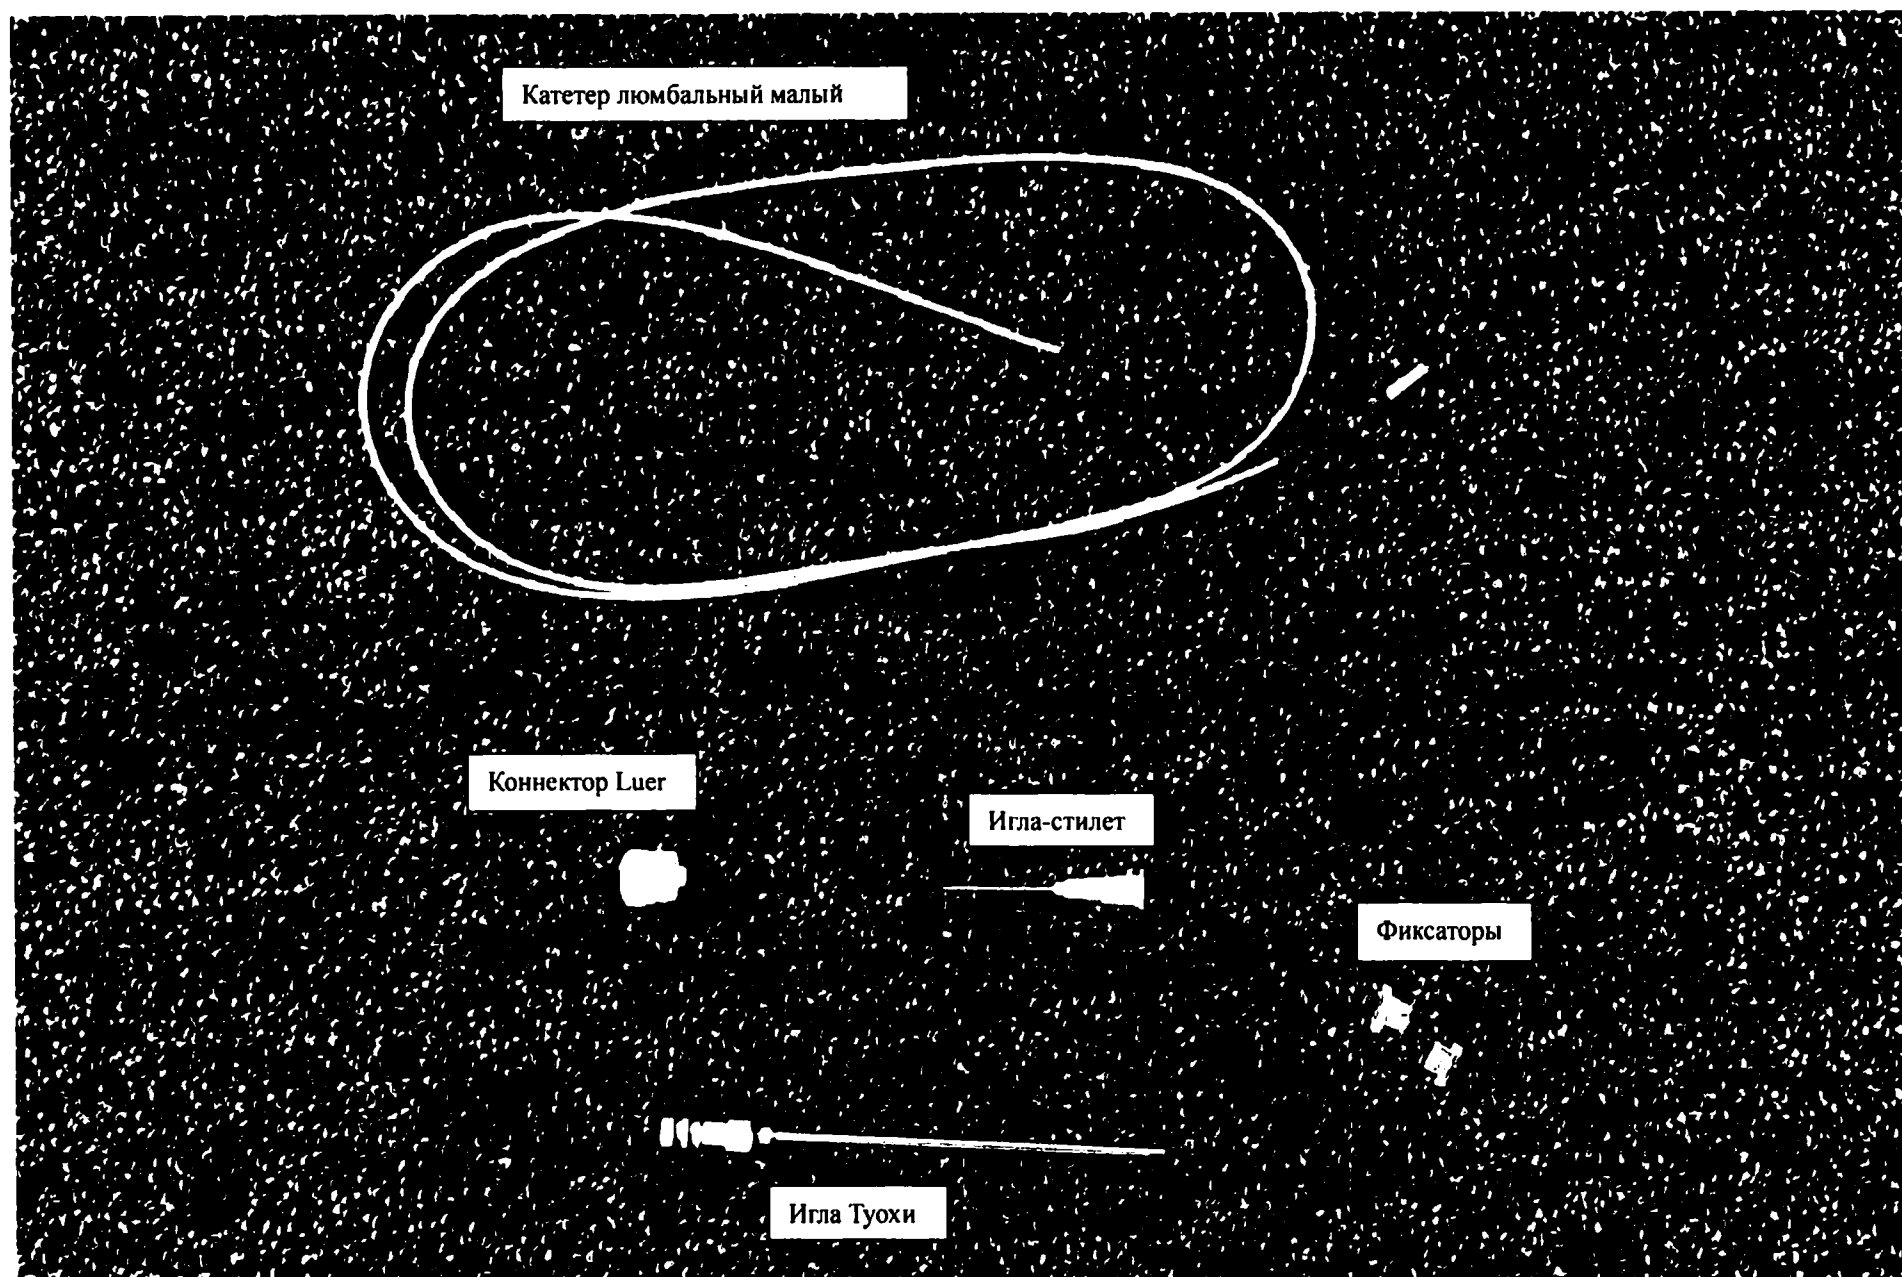

Катетер люмбальный малый - 1 шт.; Игла Туохи - 1 шт.; Игла-стиллет - 1 шт.; Коннектор Luer - 1 шт.; Фиксатор - 2 шт., из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, в составе».



Первичная упаковка изделия «Катетер люмбальный малый – 1 шт.; Игла Туохи – 1 шт.; Игла-стиллет – 1 шт.; Коннектор Луер – 1 шт.; Фиксатор – 2 шт.», из состава варианта

STERILE EO

BMI® Lumbar Part

This package contains one:

- 1ea. Lumbar Part, Barium Impregnated
I.D.:0.7mm O.D.:1.5mm Length:80cm
- 1ea. Tuohy Needle, 14-gauge
- 1ea. Stainless Steel Stylet
- 1ea. Female Luer Adapter
- 2ea. Fixation Tab

REF

06418



LOT

2028-11 RSNS5211 2023-11

STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.



STERILE EO



EC REP

Luana Med. B.V.

Weens Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands

Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec 2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

2023/04E

Маркировка производителя на первичной упаковке изделия «Катетер люмбальный малый – 1 шт.; Игла Туохи – 1 шт; Игла-стиллет – 1 шт; Коннектор Luer – 1 шт; Фиксатор – 2 шт.», из состава варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, в составе».



Изделие «Резервуар люмбальный», поставляющийся «по необходимости» к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, в составе» и «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе».



Первичная упаковка изделия «Резервуар люмбальный», поставляющегося «по необходимости» к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, в составе» и «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе».

STERILE EO

BMI® Lumboperitoneal Reservoir

This package contains one:

1ea. Lumboperitoneal Reservoir

Thick : 6mm

Length : 24mm

REF



LOT



04115 2028-02 RSR8601 2023-02

STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open

CAUTION: The law restricts this

device to sale by or on the order of a physician.



STERILE EO



Surgilab S.A.S

Immeuble ARY FRONTON Place du jeu de PAUME 64240

HASPARREN FRANCE

Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,

Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

2021040



Made in Taiwan

Маркировка производителя на первичной упаковке изделия «Резервуар люмбальный», поставляющегося «по необходимости» к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, в составе» и «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом,

в составе».



Единая вторичная упаковка варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, в составе: Катетер люмбальный малый – 1 шт., Игла Туохи – 1 шт, Игла-стиллет – 1 шт, Коннектор Luer – 1 шт, Фиксатор – 2 шт, Резервуар люмбальный – 1 шт».

STERILE EO

BMI® Lumbar Part

This package contains one:

- 06418 1ea. Lumbar Part, Barium Impregnated
I.D.:0.7mm O.D.:1.5mm Length:80cm
1ea. Tuohy Needle, 14-gauge
1ea. Stainless Steel Stylet
1ea. Female Luer Adapter
2ea. Fixation Tab
- 04115 1ea. Reservoir, Thick:3mm Length:24mm

REF



LOT



06418	2028-11	RSNS5211	2028-11
04115	2028-02	RSRS8601	2023-02

STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



STERILE EO



EC REP

Luana Med. B.V.

Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands


Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.


Made in Taiwan

202304E

Маркировка производителя на единой вторичной упаковке варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, в составе: Катетер люмбальный малый – 1 шт., Игла Туохи – 1 шт, Игла-стилет – 1 шт, Коннектор Luer – 1 шт, Фиксатор – 2 шт, Резервуар люмбальный – 1 шт».

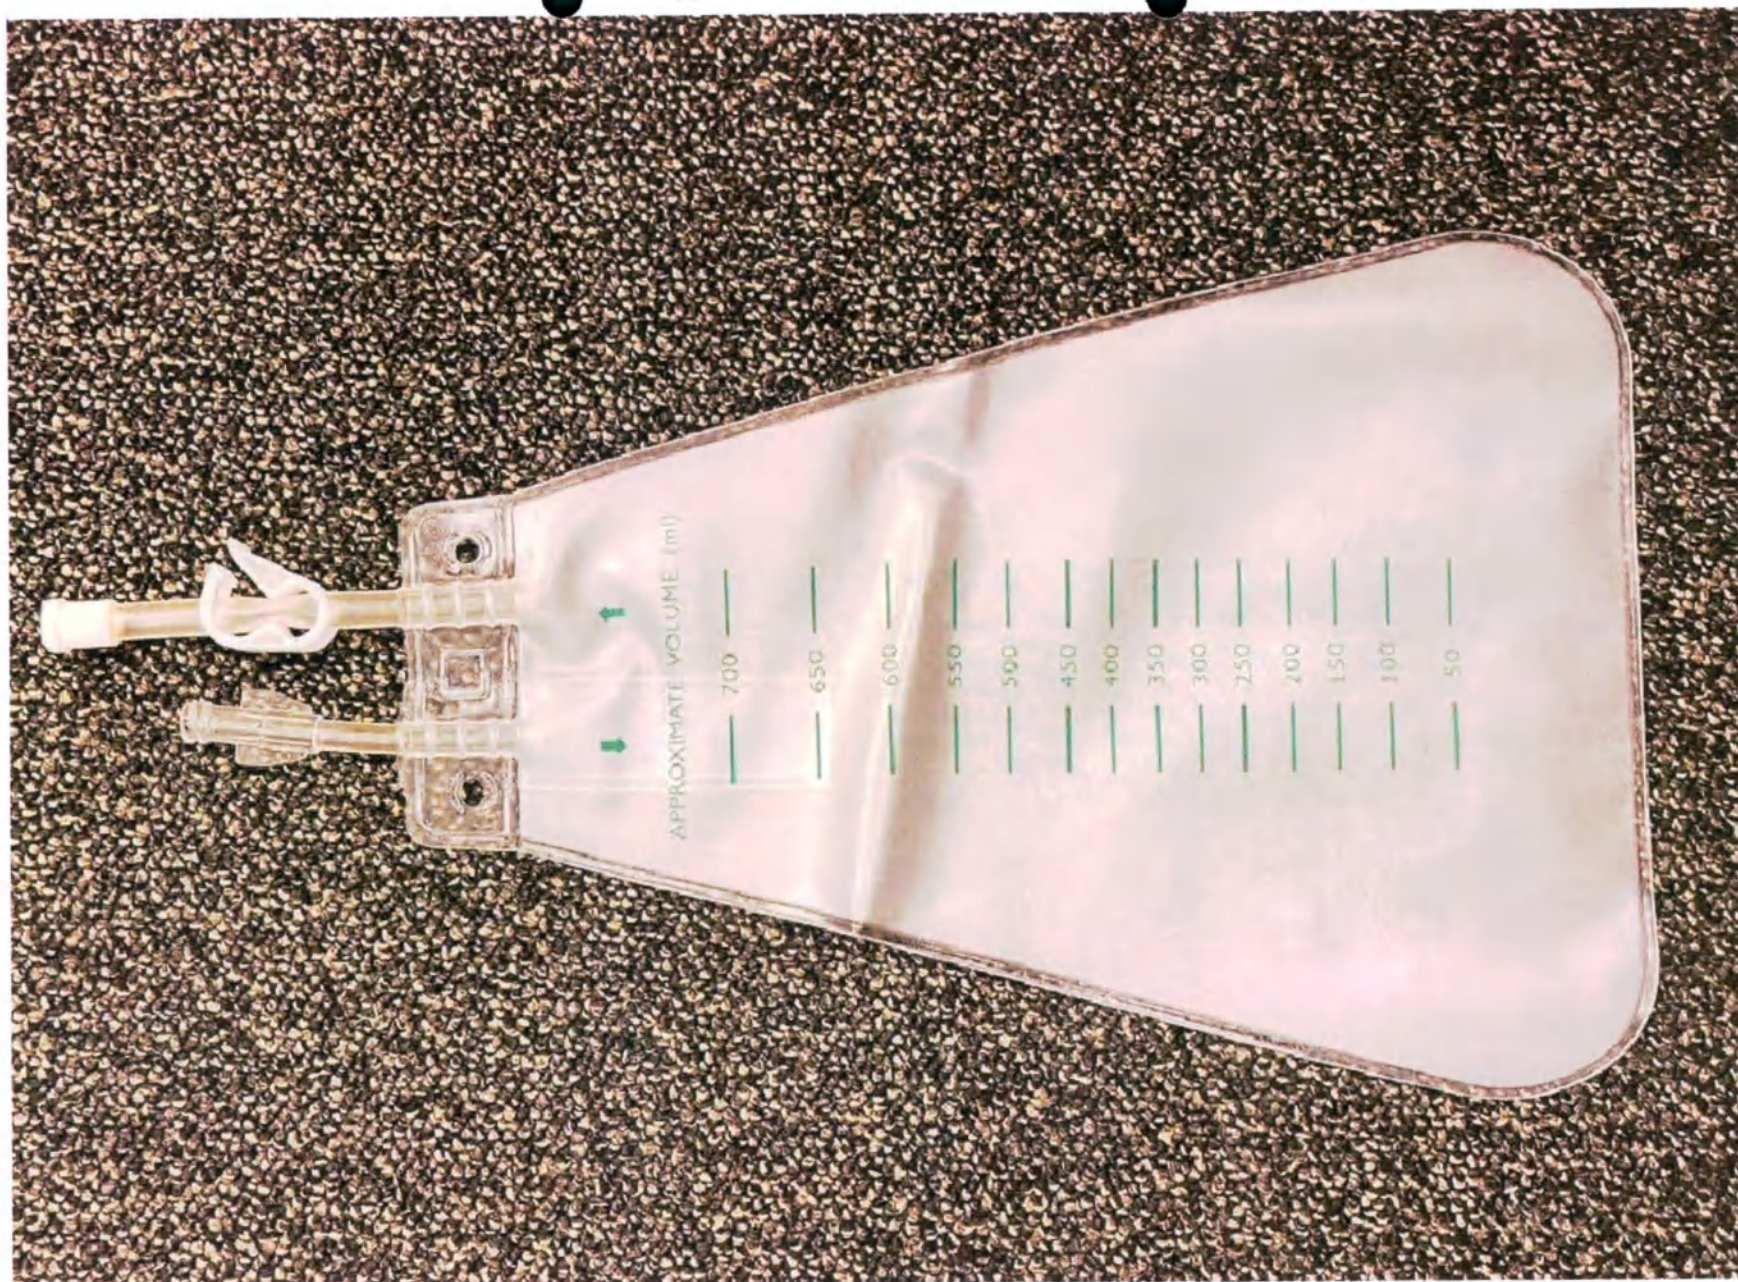

Изделие «Мешок для сбора спинномозговой жидкости», поставляющееся «по необходимости» к вариантам исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная малая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости и других жидкостей с похожими физическими характеристиками, в составе».

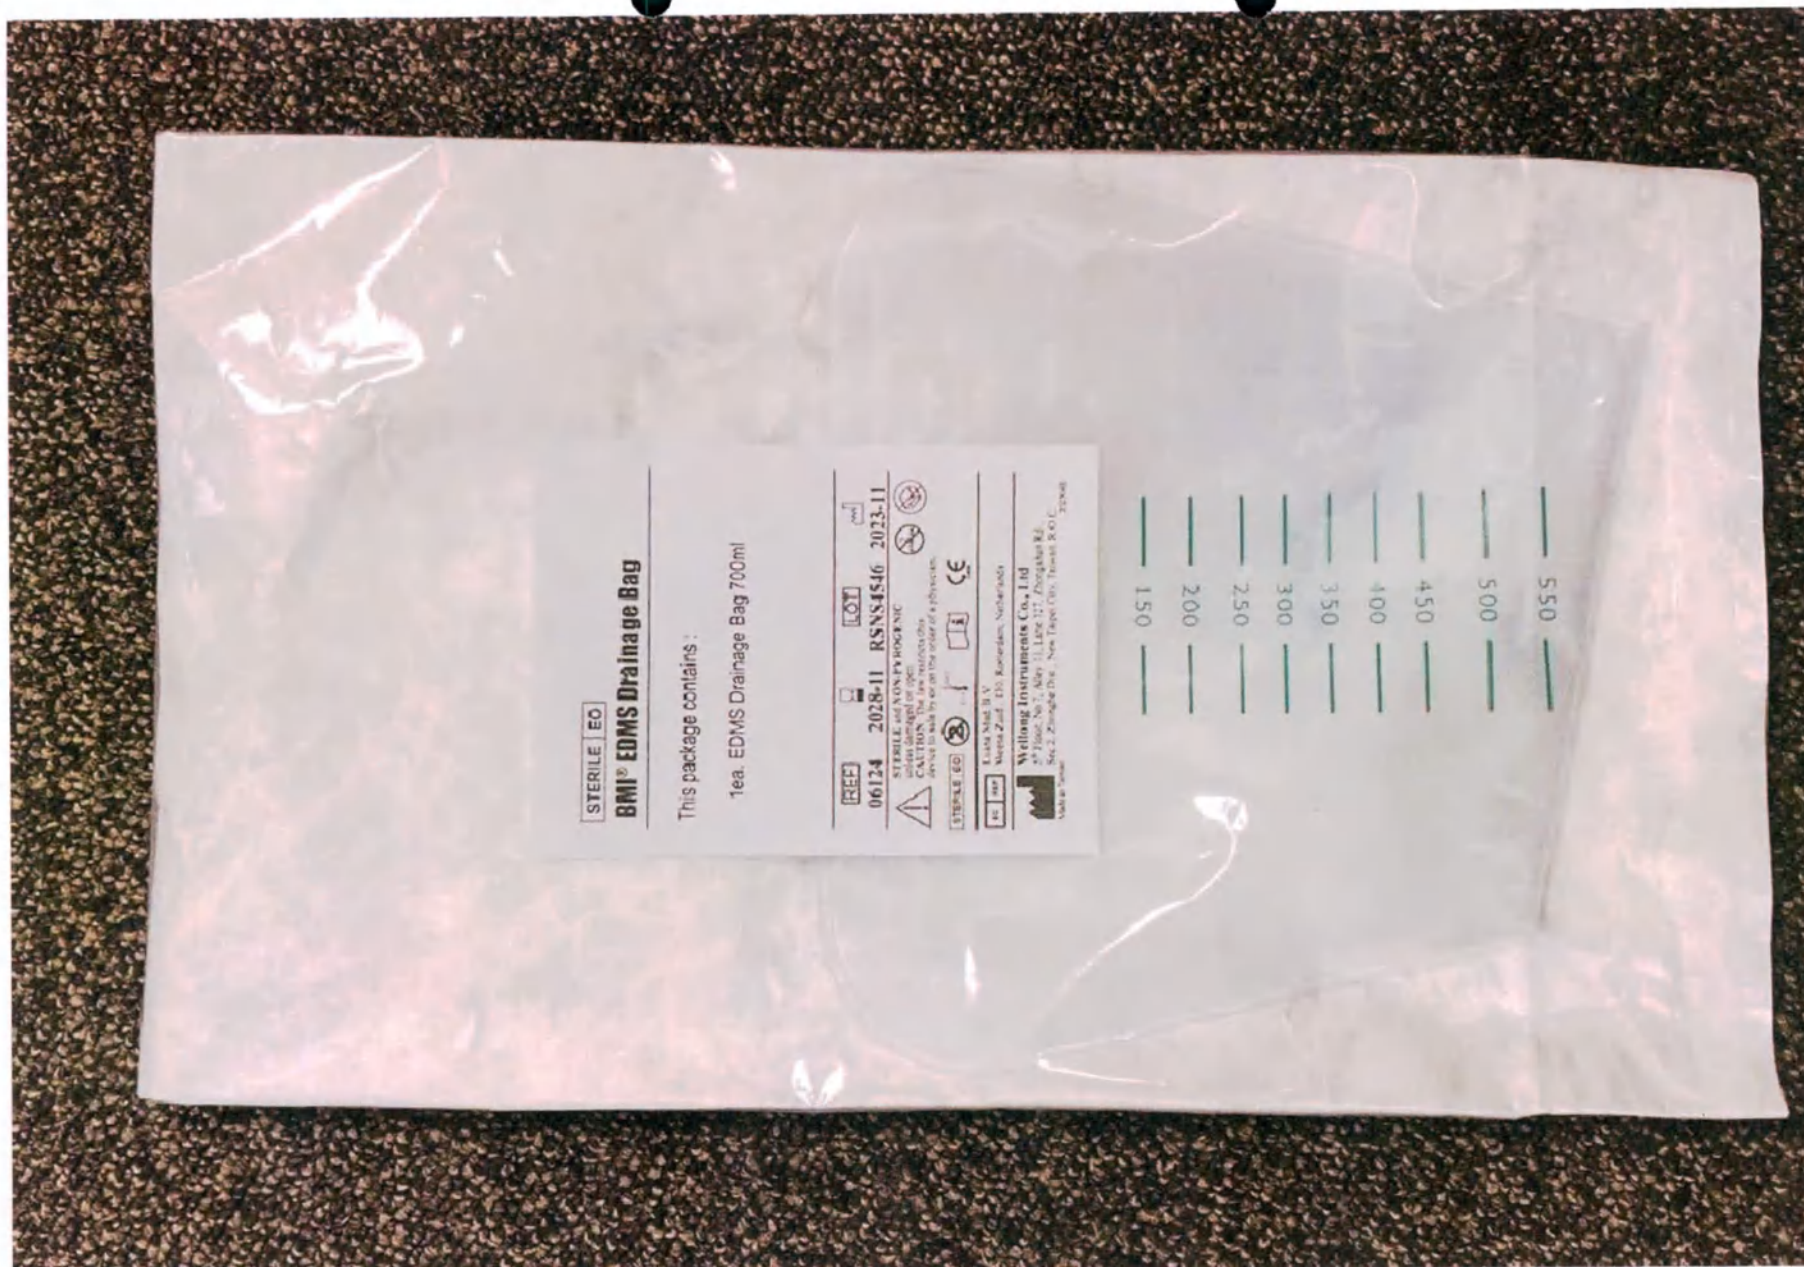

Первичная упаковка изделия «Мешок для сбора спинномозговой жидкости», поставляющееся «по необходимости» к вариантам исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная малая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости и других жидкостей с похожими физическими характеристиками, в составе».

STERILE EO

BMI® EDMS Drainage Bag

This package contains :

1ea. EDMS Drainage Bag 700ml


REF



LOT




06124 2028-11 RSNS4546 2023-11





STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.




STERILE EO



EC REP

Luana Med. B.V.
Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands




Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202304E

Маркировка первичной упаковки изделия «Мешок для сбора спинномозговой жидкости», поставляющееся «по необходимости» к вариантам исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная малая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости и других жидкостей с похожими физическими характеристиками, в составе».

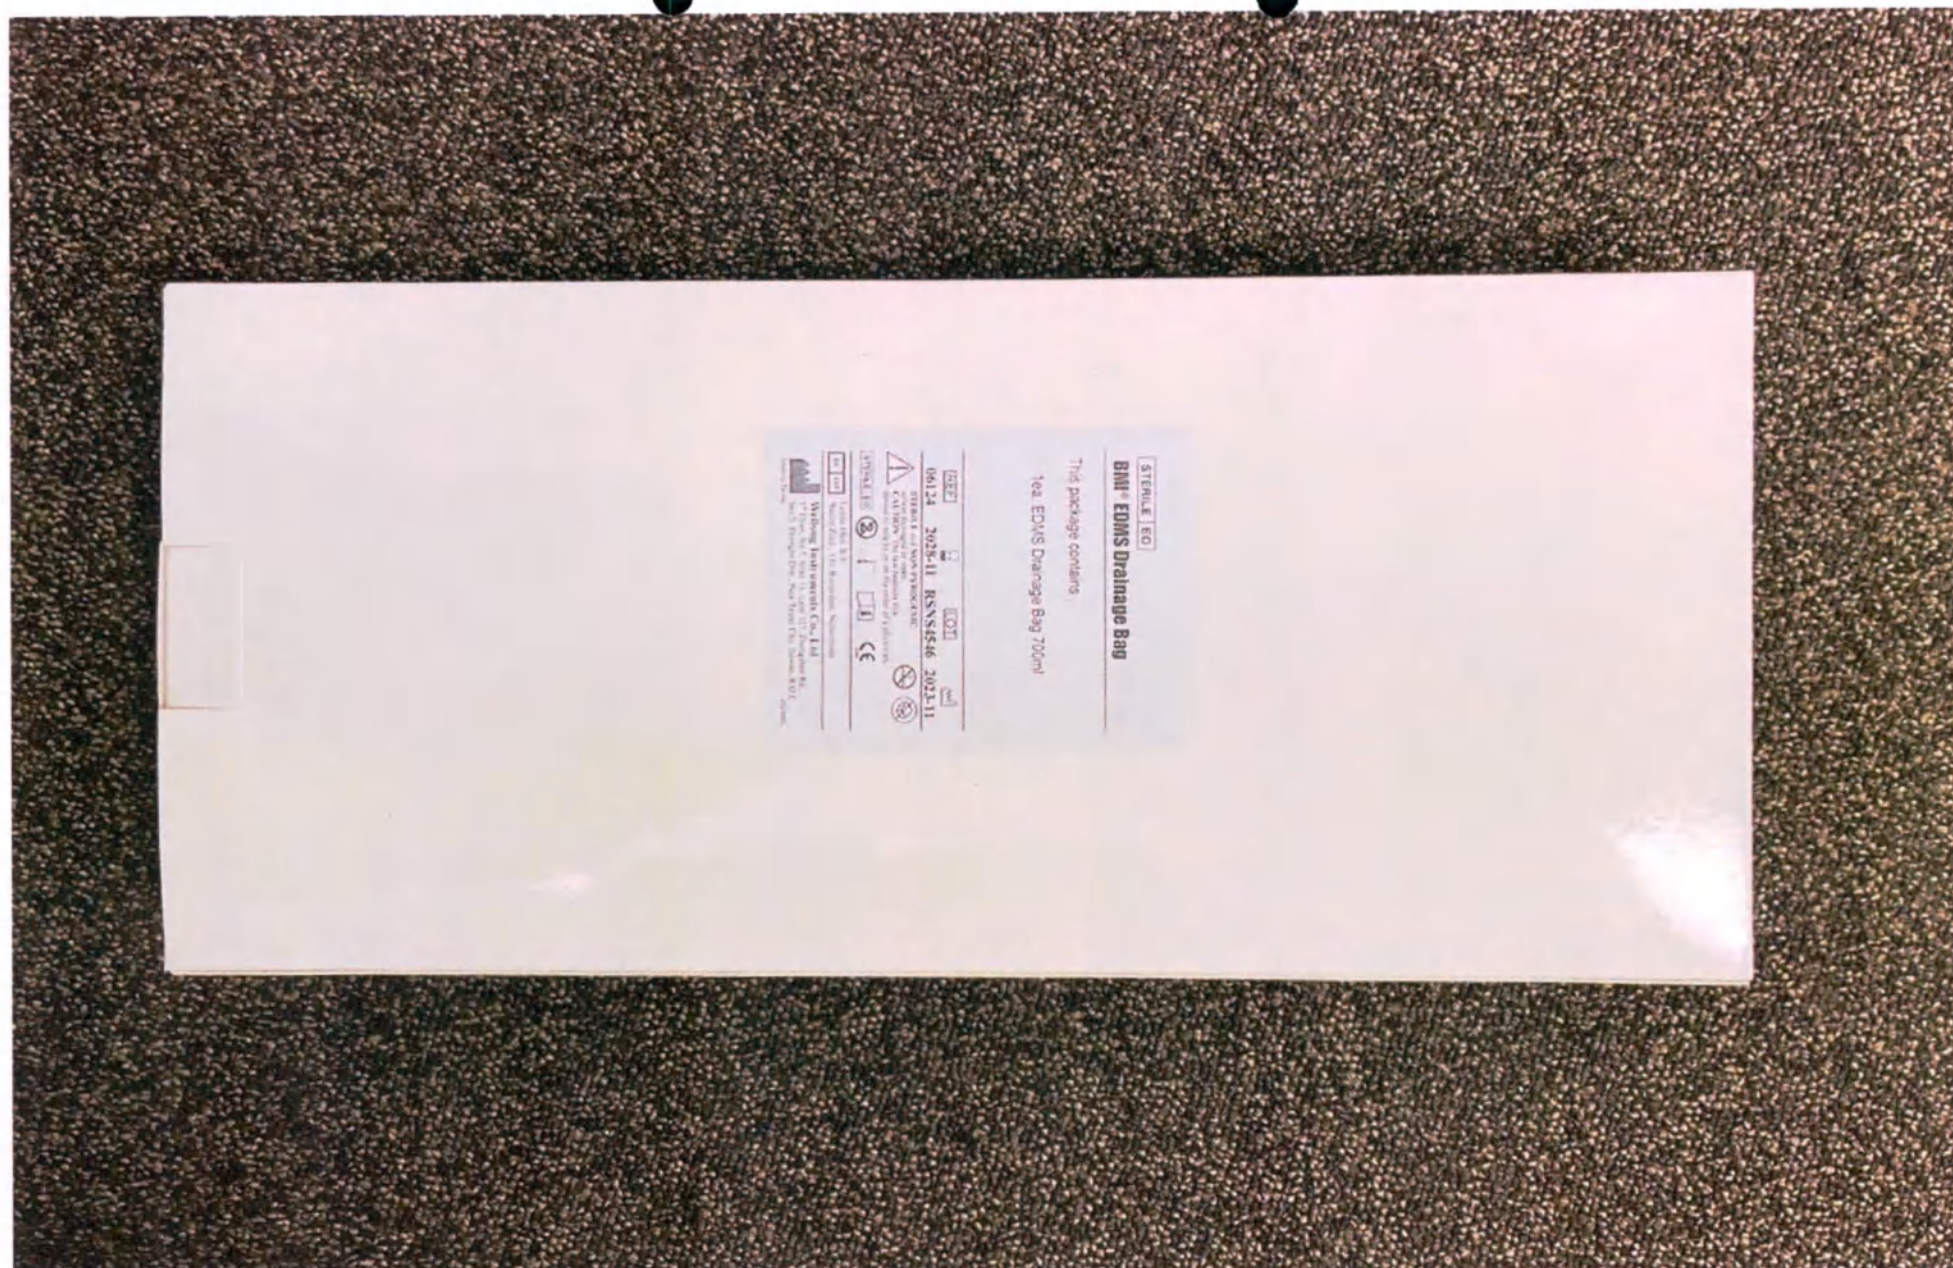

Вторичная упаковка изделия «Мешок для сбора спинномозговой жидкости», поставляющееся «по необходимости» к вариантам исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная малая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости и других жидкостей с похожими физическими характеристиками, в составе».

STERILE EO

BMI® EDMS Drainage Bag

This package contains :

1ea. EDMS Drainage Bag 700ml

REF



LOT



06124

2028-11

RSNS4546

2023-11

STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this device to sale by or on the order of a physician.




STERILE EO



EC REP

Luana Med. B.V.
Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands

Wellong Instruments Co., Ltd




5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.


Made in Taiwan

202304E

Маркировка вторичной упаковки изделия «Мешок для сбора спинномозговой жидкости», поставляющееся «по необходимости» к вариантам исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная малая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости и других жидкостей с похожими физическими характеристиками, в составе».

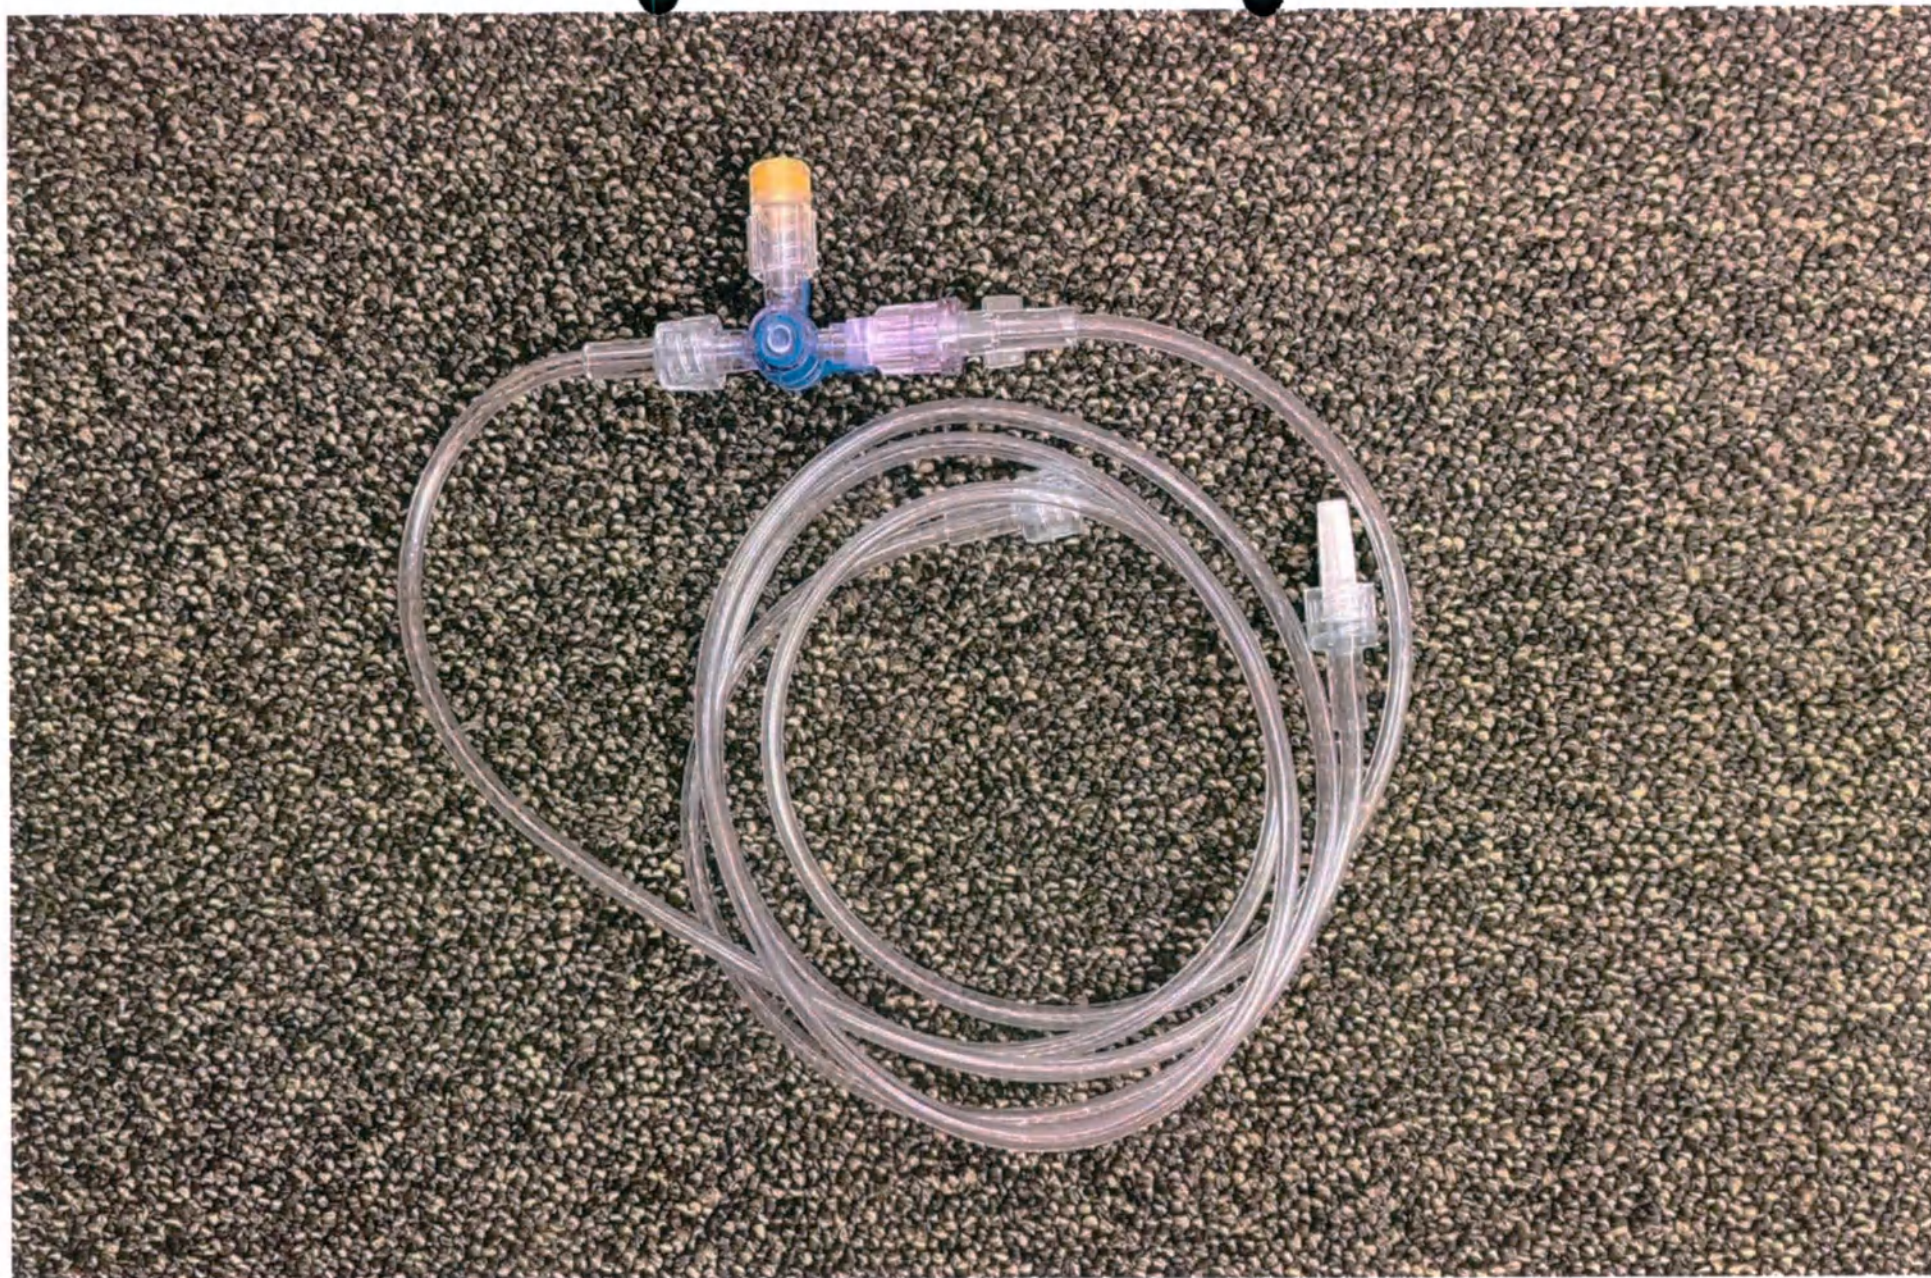

Изделие «Линия пациента», поставляющееся «по необходимости» к вариантам исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная малая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости и других жидкостей с похожими физическими характеристиками, в составе».

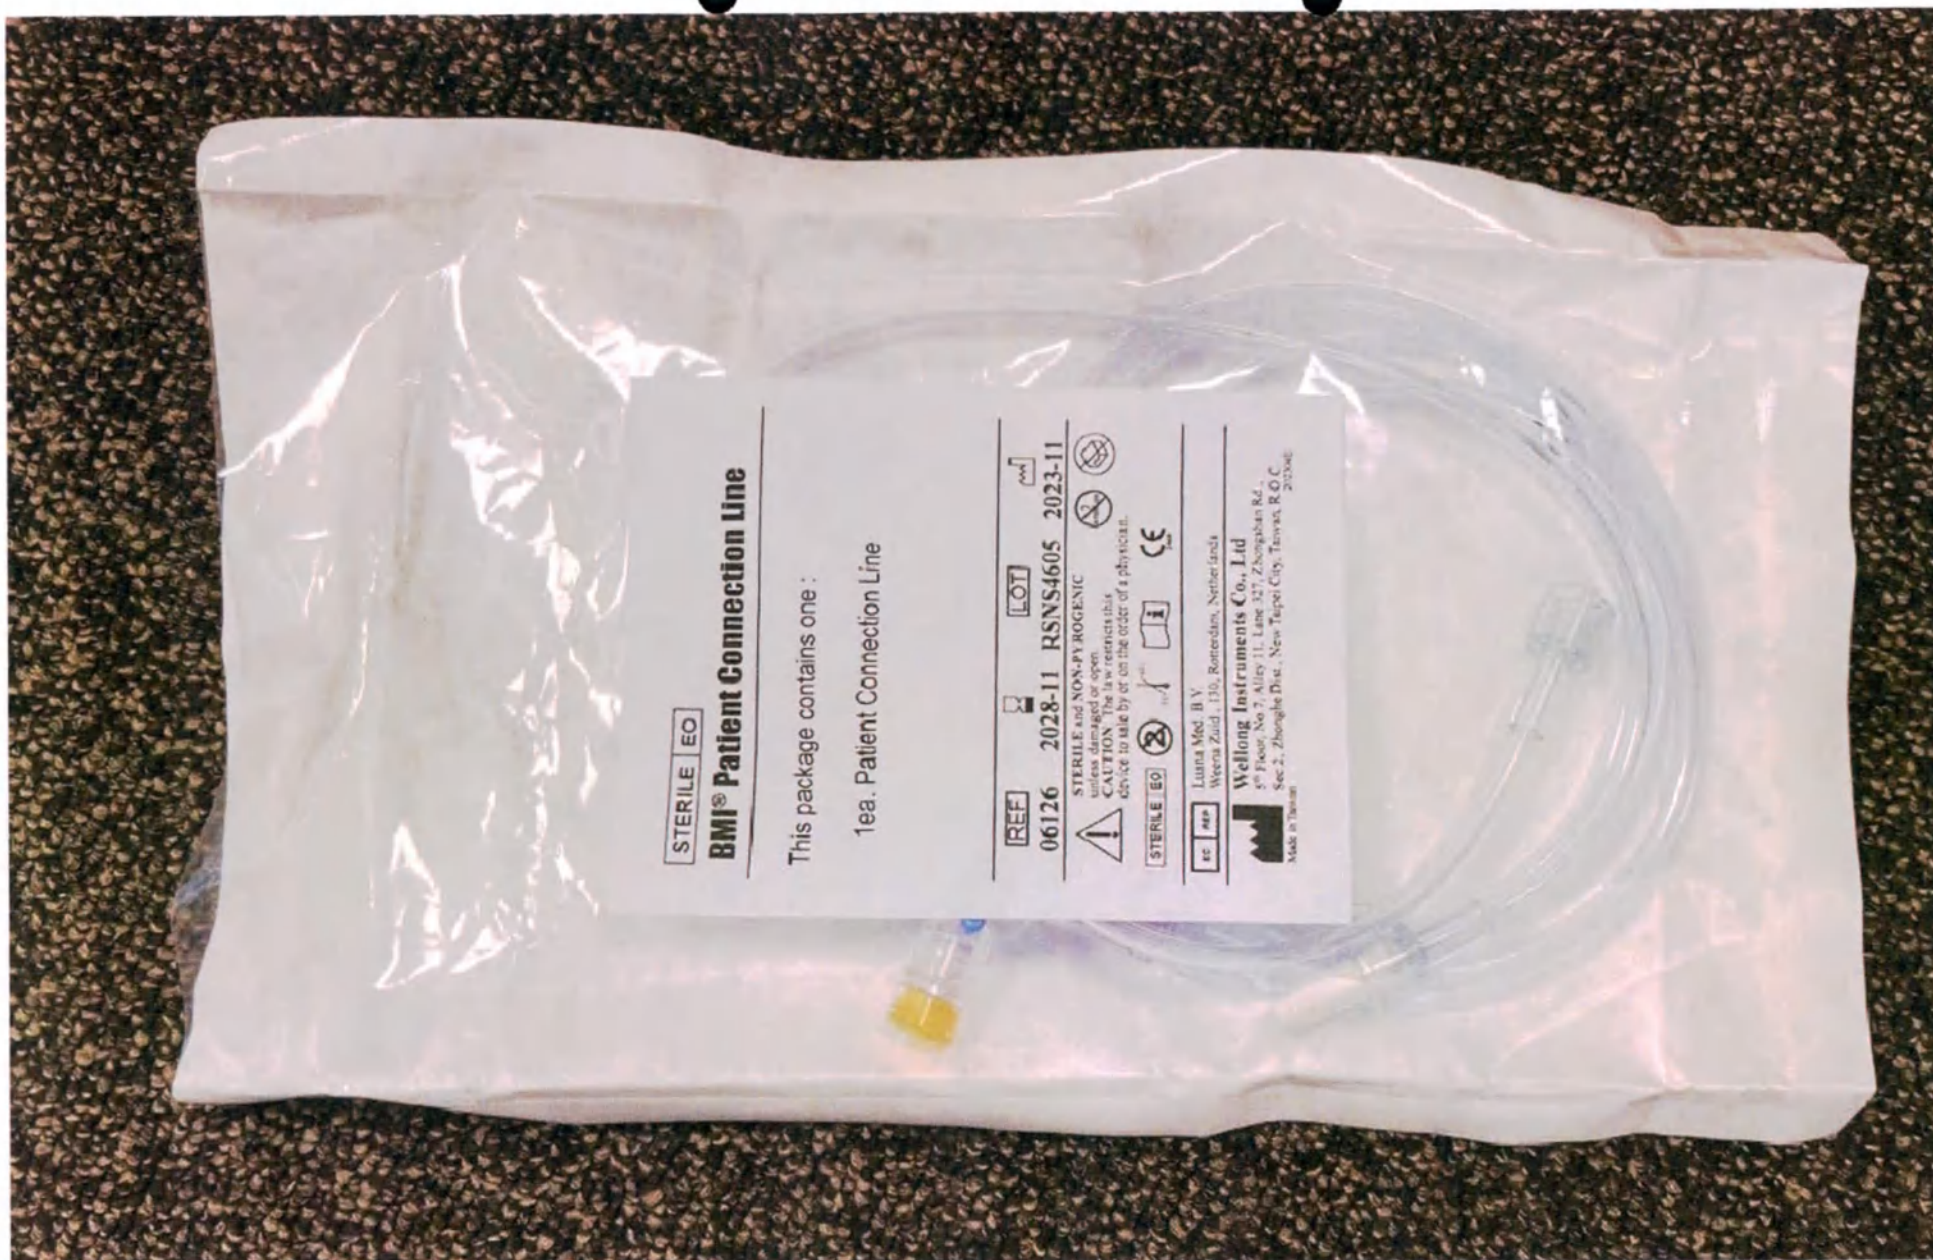

Первичная упаковка изделия «Линия пациента», поставляющееся «по необходимости» к вариантам исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная малая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости и других жидкостей с похожими физическими характеристиками, в составе».

STERILE EO

BMI® Patient Connection Line

This package contains one :

1ea. Patient Connection Line


REF

06126





LOT

2028-11 RSNS4605 2023-11



STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.




STERILE EO



EC REP

Luana Med. B.V.

Weena Zuid , 130, Rotterdam, Netherlands



Wellong Instruments Co., Ltd


5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,

Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202304E

Маркировка первичной упаковки изделия «Линия пациента», поставляющееся «по необходимости» к вариантам исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная малая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости и других жидкостей с похожими физическими характеристиками, в составе».

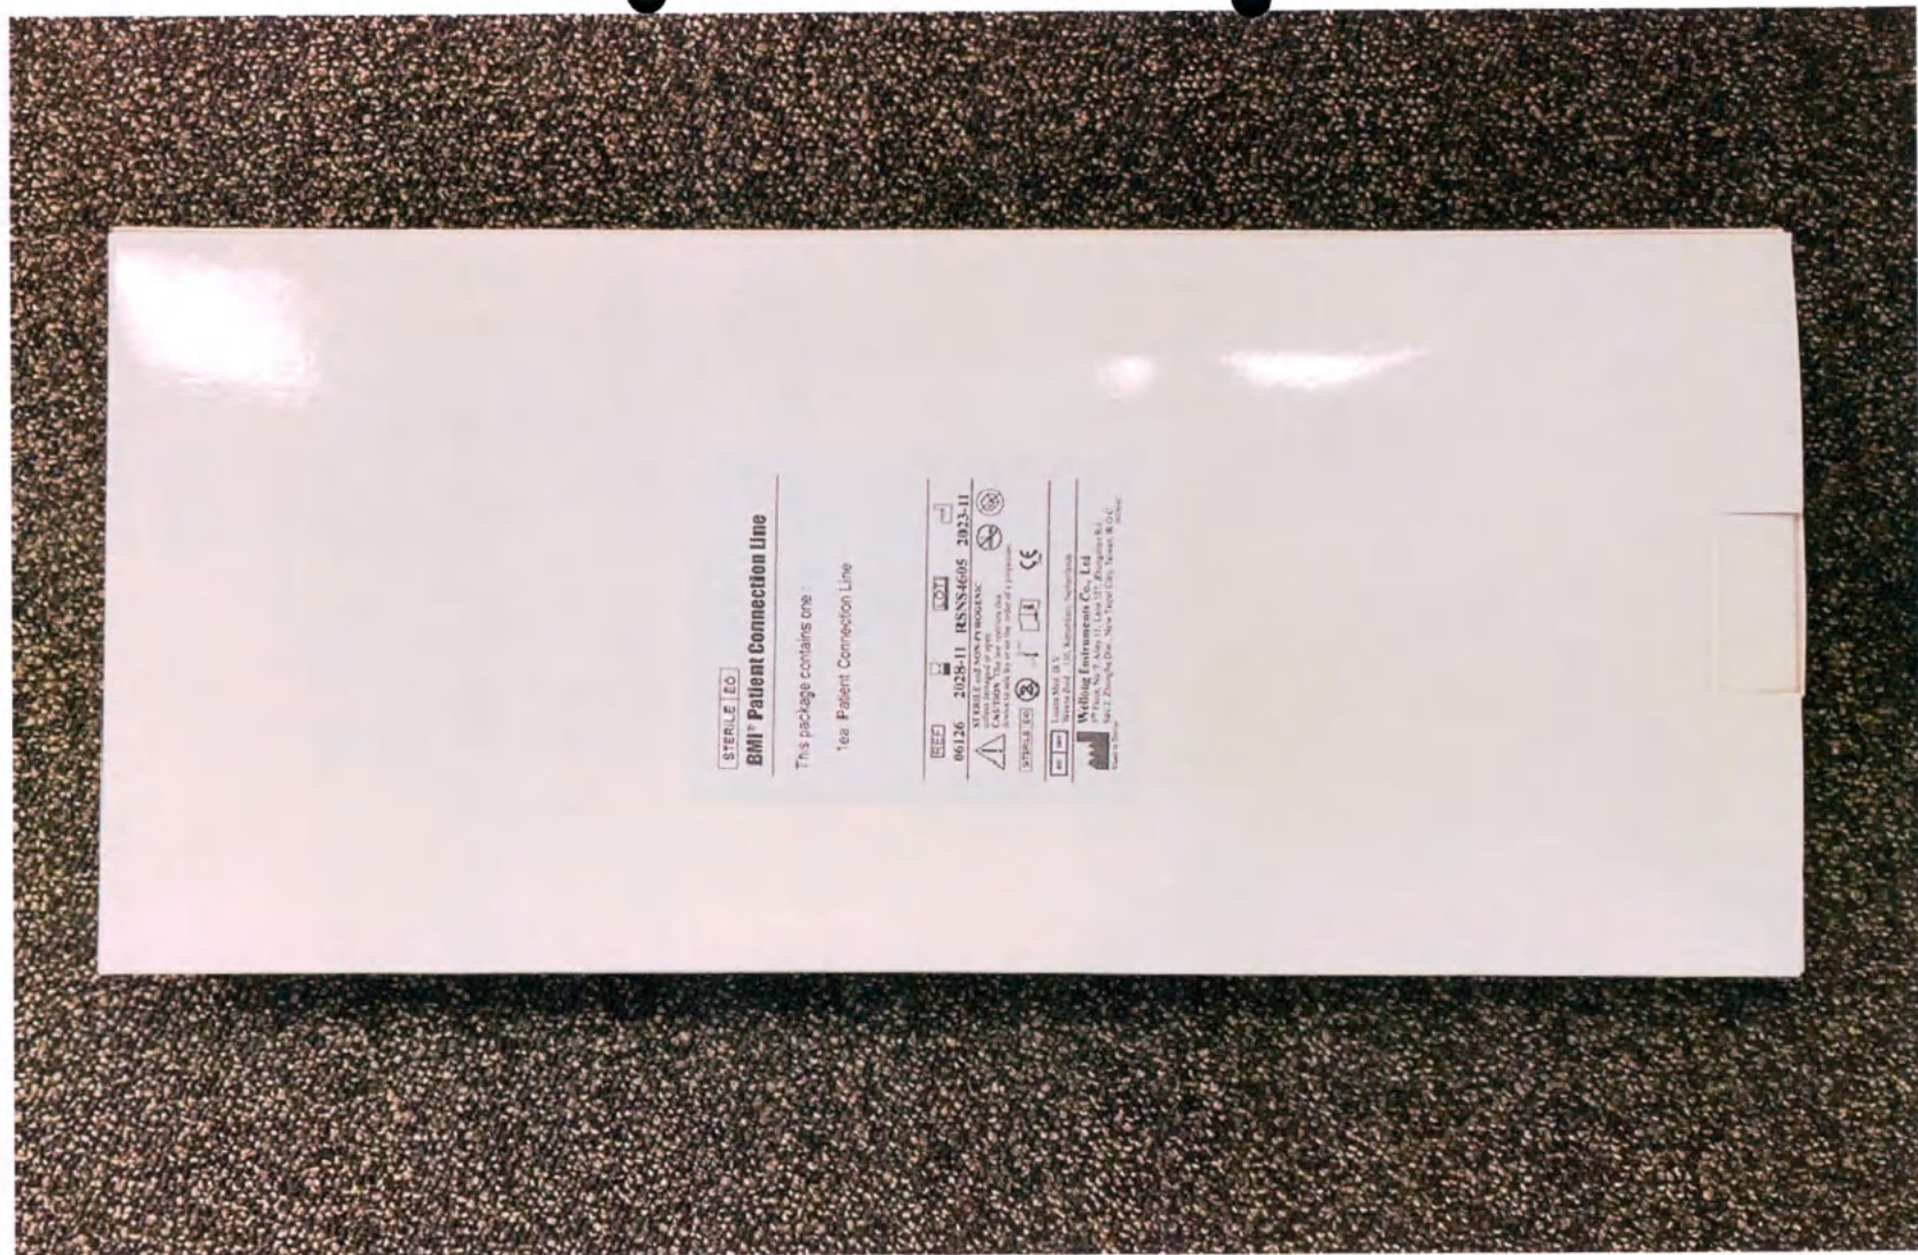

Вторичная упаковка изделия «Линия пациента», поставляющееся «по необходимости» к вариантам исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная малая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости и других жидкостей с похожими физическими характеристиками, в составе».

STERILE EO

BMI® Patient Connection Line

This package contains one :

1ea. Patient Connection Line

REF

06126




LOT

2028-11 RSNS4605 2023-11




STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.



STERILE EO



EC REP

Luana Med. B.V.

Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands

Wellong Instruments Co., Ltd


5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,

Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202304E

Маркировка вторичной упаковки изделия «Линия пациента», поставляющееся «по необходимости» к вариантам исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная малая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе», «Система дренирования спинномозговой жидкости и других жидкостей с похожими физическими характеристиками, в составе».

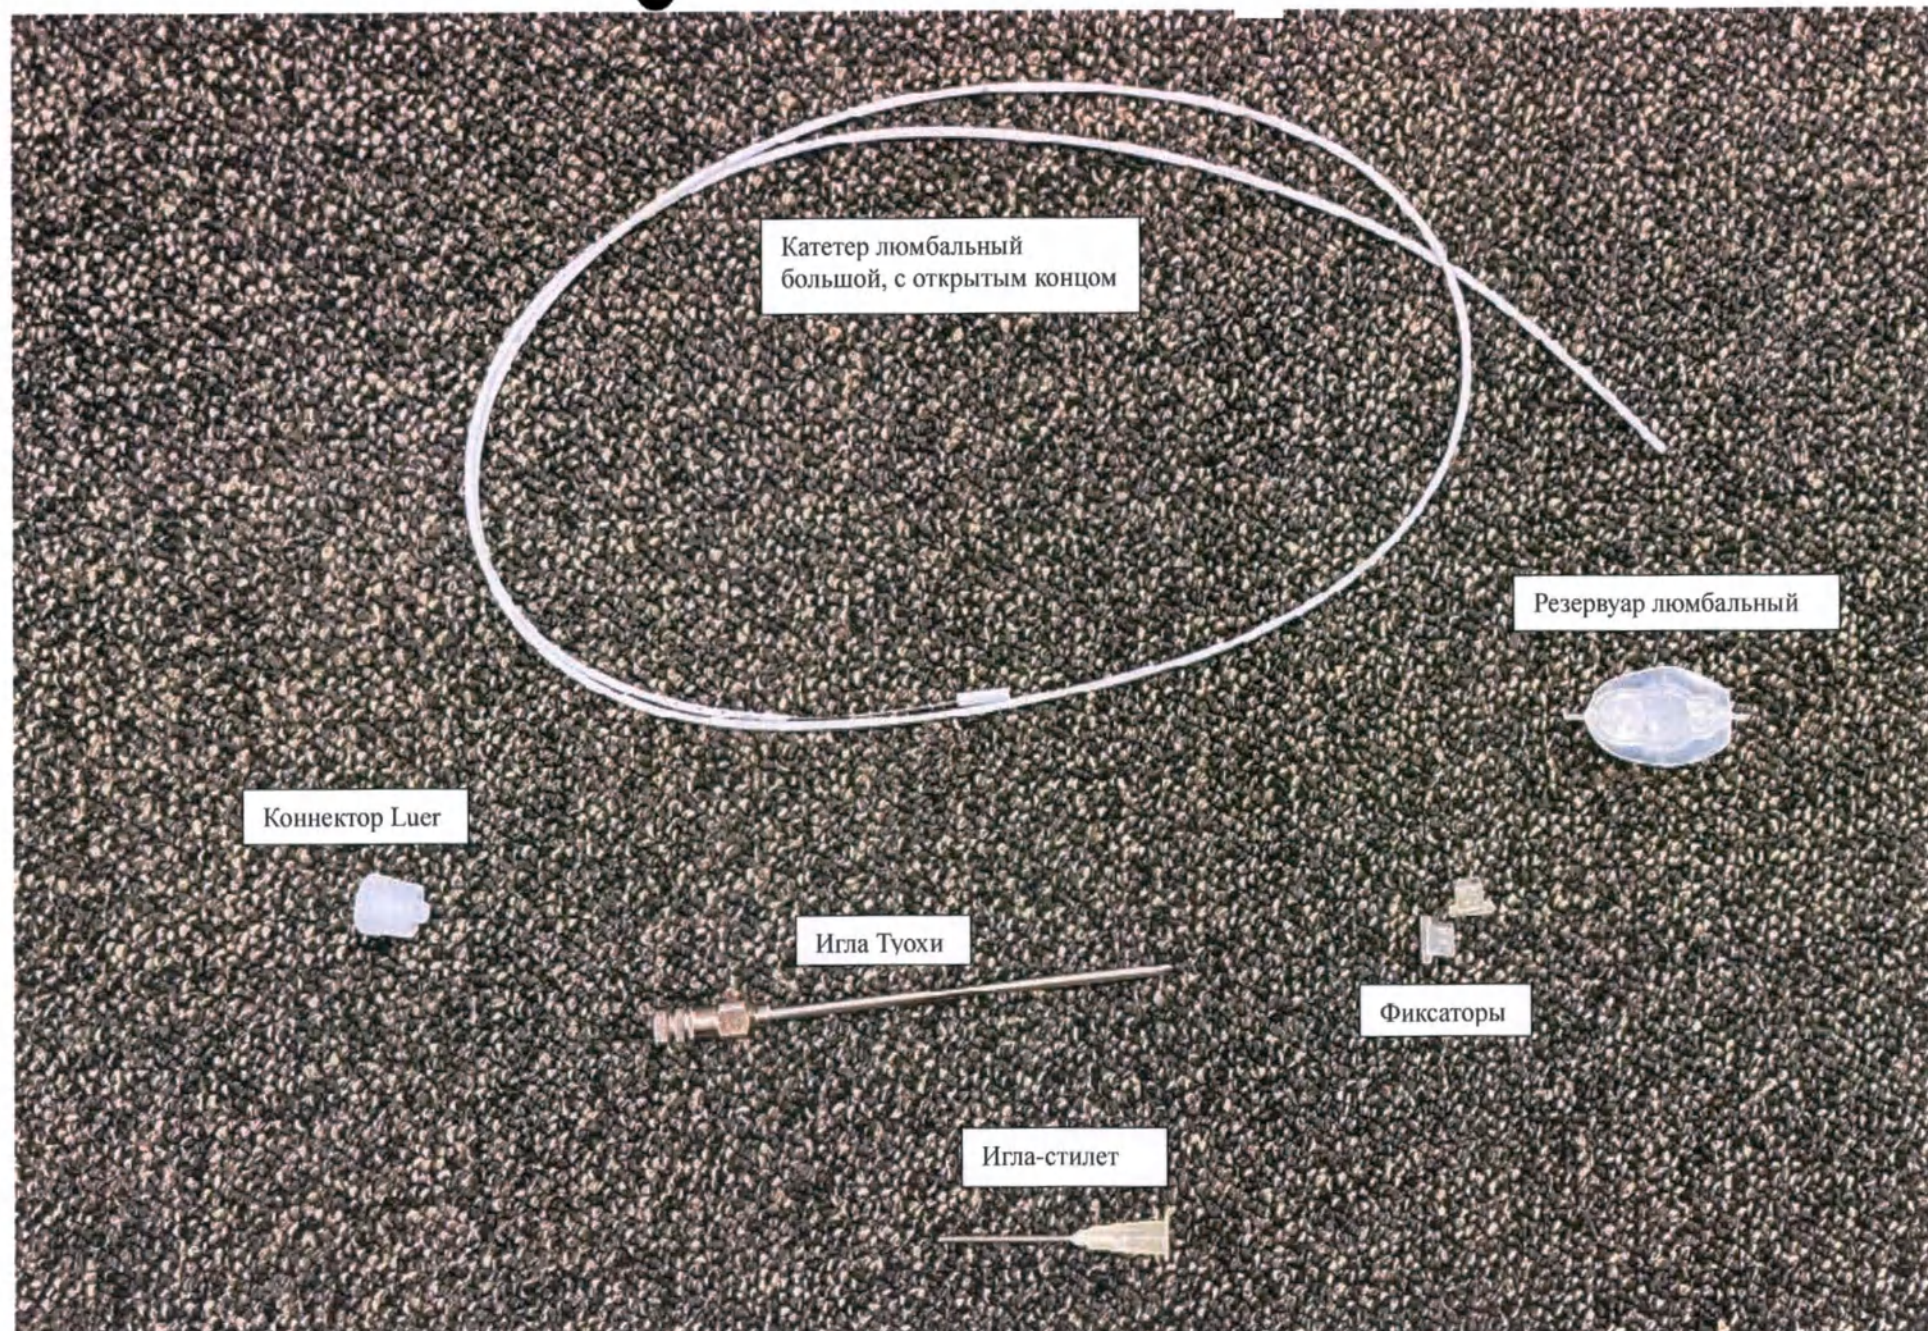

«Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе: Катетер люмбальный большой, с открытым концом – 1 шт.; Игла Туохи – 1 шт; Игла-стилет – 1 шт; Коннектор Luer – 1 шт; Фиксатор – 2 шт; Резервуар люмбальный – 1 шт.»



Первичная упаковка изделия «Катетер люмбальный большой, с открытым концом в составе: катетер люмбальный большой с открытым концом (1 шт); игла Туохи (1 шт); игла-стилет (1 шт); коннектор Luer (1 шт); фиксатор (2 шт)», поставляющееся «по необходимости» к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная Туохи, в составе» и в качестве обязательной поставки к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе»

STERILE EO

BMI® Lumbar Part

This package contains one:

- 1ea. Lumbar Part, Barium Impregnated
I.D.:0.7mm O.D.:1.5mm Length:84cm
- 1ea. Tuohy Needle, 14-gauge
- 1ea. Stainless Steel Stylet
- 1ea. Female Luer Adapter
- 2ea. Fixation Tab

REF




LOT



06419


2027-05 RRWS5303 2022-05



STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REP

Surgilab S.A.S.
Immeuble ARY FRONTON Place du jeu de PAUME 64240
HASPARREN FRANCE



Made in Taiwan

Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

202104D

Маркировка производителя на первичной упаковке изделия «Катетер люмбальный большой, с открытым концом в составе: катетер люмбальный большой с открытым концом (1 шт); игла Туохи (1 шт); игла-стиллет (1 шт); коннектор Luer (1 шт); фиксатор (2 шт)», поставляющееся «по необходимости» к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная Tuohi, в составе» и в качестве обязательной поставки к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе»



Изделие «Резервуар люмбальный», поставляющийся «по необходимости» к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, в составе» и «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе».



Первичная упаковка изделия «Резервуар люмбальный», поставляющегося «по необходимости» к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, в составе» и «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе».

STERILE EO

BMI® Lumboperitoneal Reservoir

This package contains one:

1ea. Lumboperitoneal Reservoir

Thick : 6mm

Length : 24mm

REF



LOT



04115 2028-02 RSR8601 2023-02

STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open

CAUTION: The law restricts this

device to sale by or on the order of a physician.



STERILE EO



Surgilab S.A.S

Immeuble ARY FRANTON Place du jeu de PAUME 64240

HASPARREN FRANCE



Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,

Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.



2021040

Маркировка производителя на первичной упаковке изделия «Резервуар люмбальный», поставляющегося «по необходимости» к варианту исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, в составе» и «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе».



Единая вторичная упаковка изделия ««Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе: Катетер люмбальный большой, с открытым концом – 1 шт.; Игла Туохи – 1 шт.; Игла-стиллет – 1 шт.; Коннектор Luer – 1 шт.; Фиксатор – 2 шт.; Резервуар люмбальный – 1 шт.»

STERILE EO

BMI® Lumbar Part

This package contains one:

06419 1ea. Lumbar Part, Barium Impregnated
I.D.:0.7mm O.D.:1.5mm Length:84cm

1ea. Tuohy Needle, 14-gauge

1ea. Stainless Steel Stylet

1ea. Female Luer Adapter

2ea. Fixation Tab



04115 1ea. Reservoir, Thick:6mm Length:24mm

REF		LOT	
06419	2027-05	RRWS5303	2022-05
04115	2028-02	RSRS8601	2023-02

STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open.

CAUTION The law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



Luana Med. B.V.
Weena Zuid, 110, Rotterdam, Netherlands


Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202304E

Маркировка производителя единой вторичной упаковки изделия «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная, с катетером люмбальным большим, с открытым концом, в составе: Катетер люмбальный большой, с открытым концом – 1 шт.; Игла Туохи – 1 шт.; Игла-стиллет – 1 шт.; Коннектор Luer – 1 шт.; Фиксатор – 2 шт.; Резервуар люмбальный – 1 шт.»

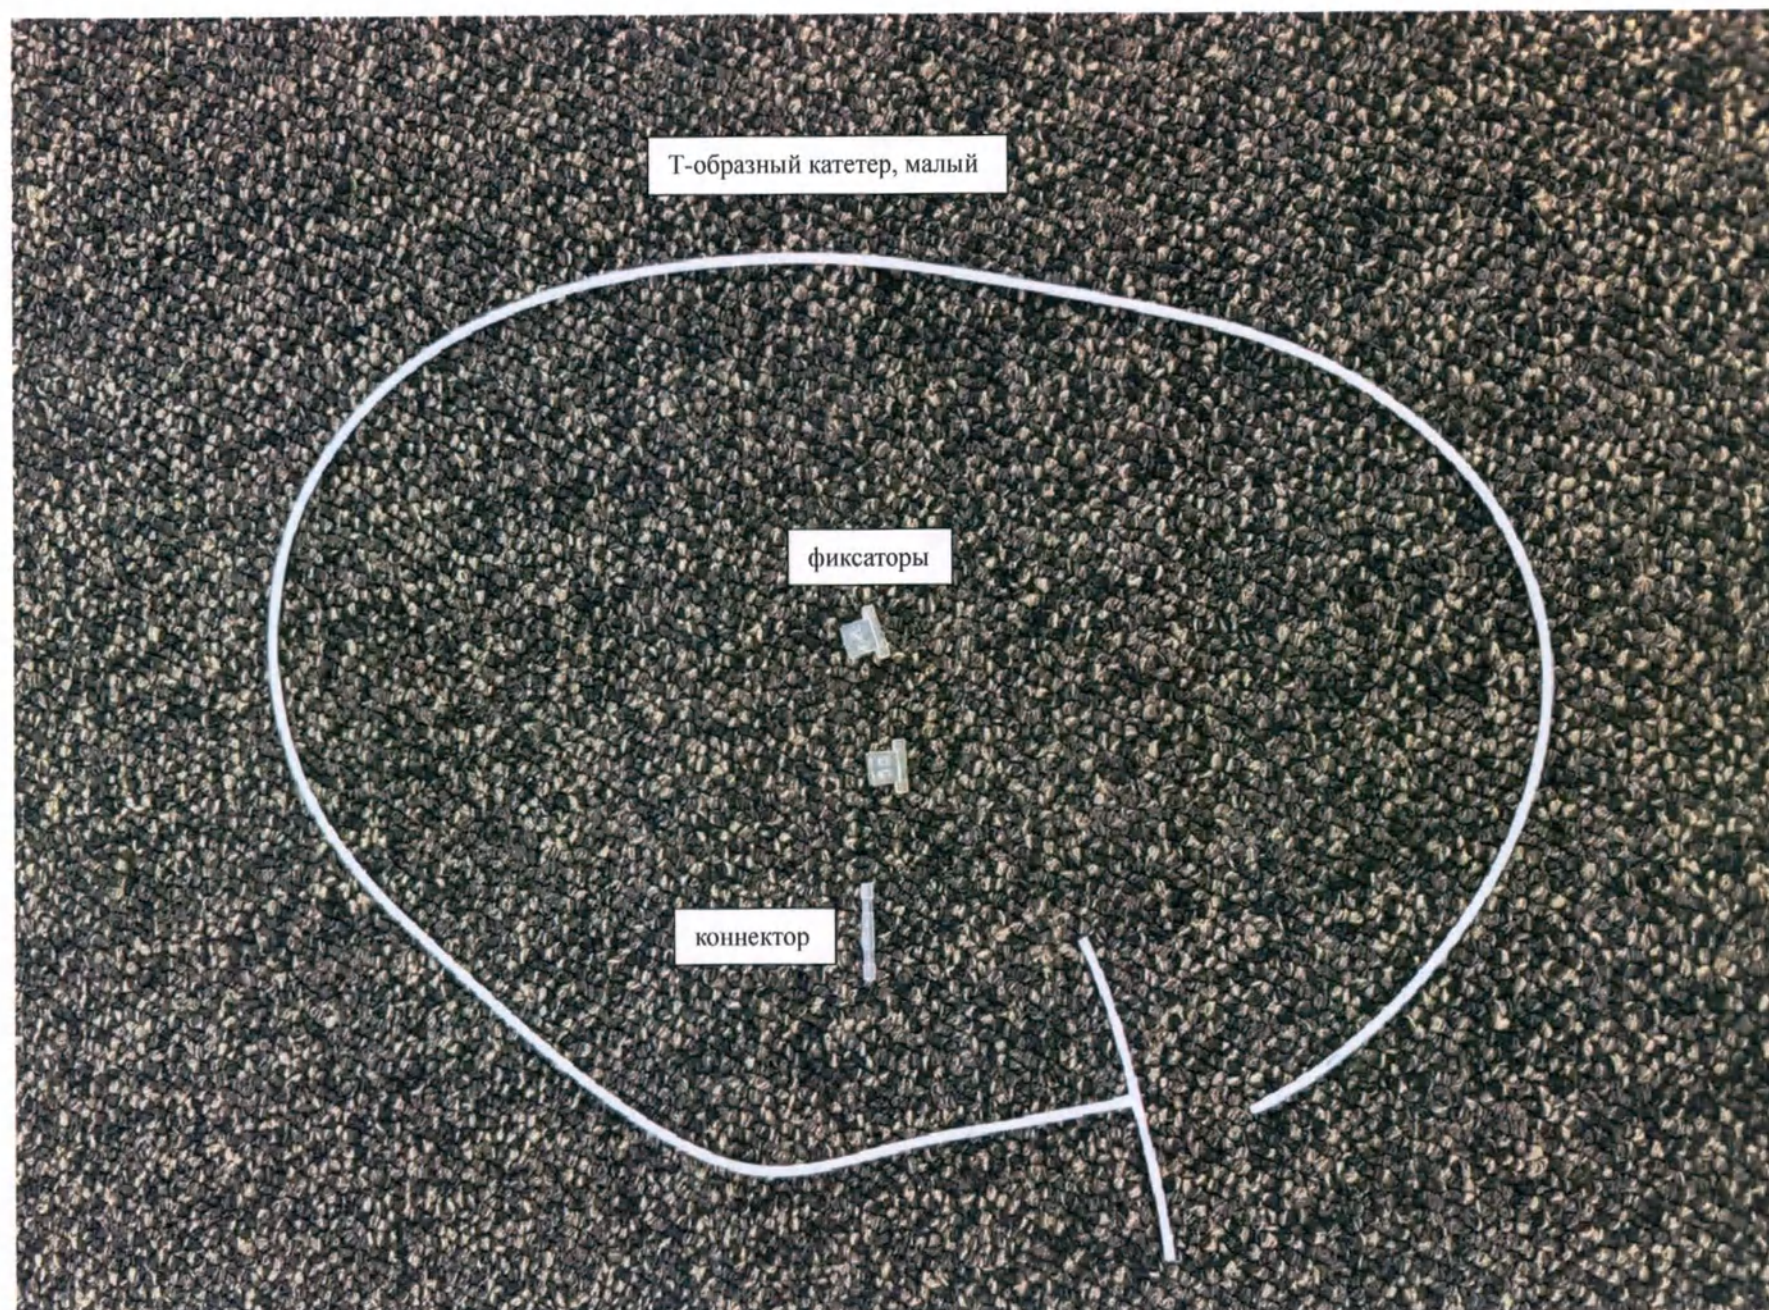

«Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная малая, с Т-образным катетером, в составе: Т-образный катетер, малый – 1 шт, Коннектор – 1 шт, Фиксатор – 2 шт»



Первичная упаковка изделия «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная малая, с Т-образным катетером, в составе: Т-образный катетер, малый – 1 шт, Коннектор – 1 шт, Фиксатор – 2 шт»

Маркировка производителя первичной упаковки изделия «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная малая, с T-образным катетером, в составе: T-образный катетер, малый – 1 шт, Коннектор – 1 шт, Фиксатор – 2 шт»

STERILE EO

BMI® Lumbar Part, child

This package contains

1ea .Lumbar Part, Length : 5cm / 55cm

I.D : 0.7mm,O.D : 1.5mm

1ea.Connector

2ea. Fixation Tab

REF



LOT



06421T 2027-10 RRJS9302 2022-10



STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO




EC

REP

Surgilab S.A.S.

Immeuble ARY FRONTON Place du jeu de PAUME 64240

HASPARREN FRANCE



Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,

Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202104D

STERILE EO

BMI® Lumber Part, child

This package contains

1ea .Lumber Part, Length : 5cm / 55cm

I.D : 0.7mm,O.D : 1.5mm

1ea.Connector

2ea. Fixation Tab

REF



LOT



06421T 2027-10 RRJS9302 2022-10



STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REP


Surgilab S.A.S.
Immeuble ARY FRONTON Place du jeu de PAUME 64240
HASPARREN FRANCE



Wellong Instruments Co., Ltd
5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan


202104D

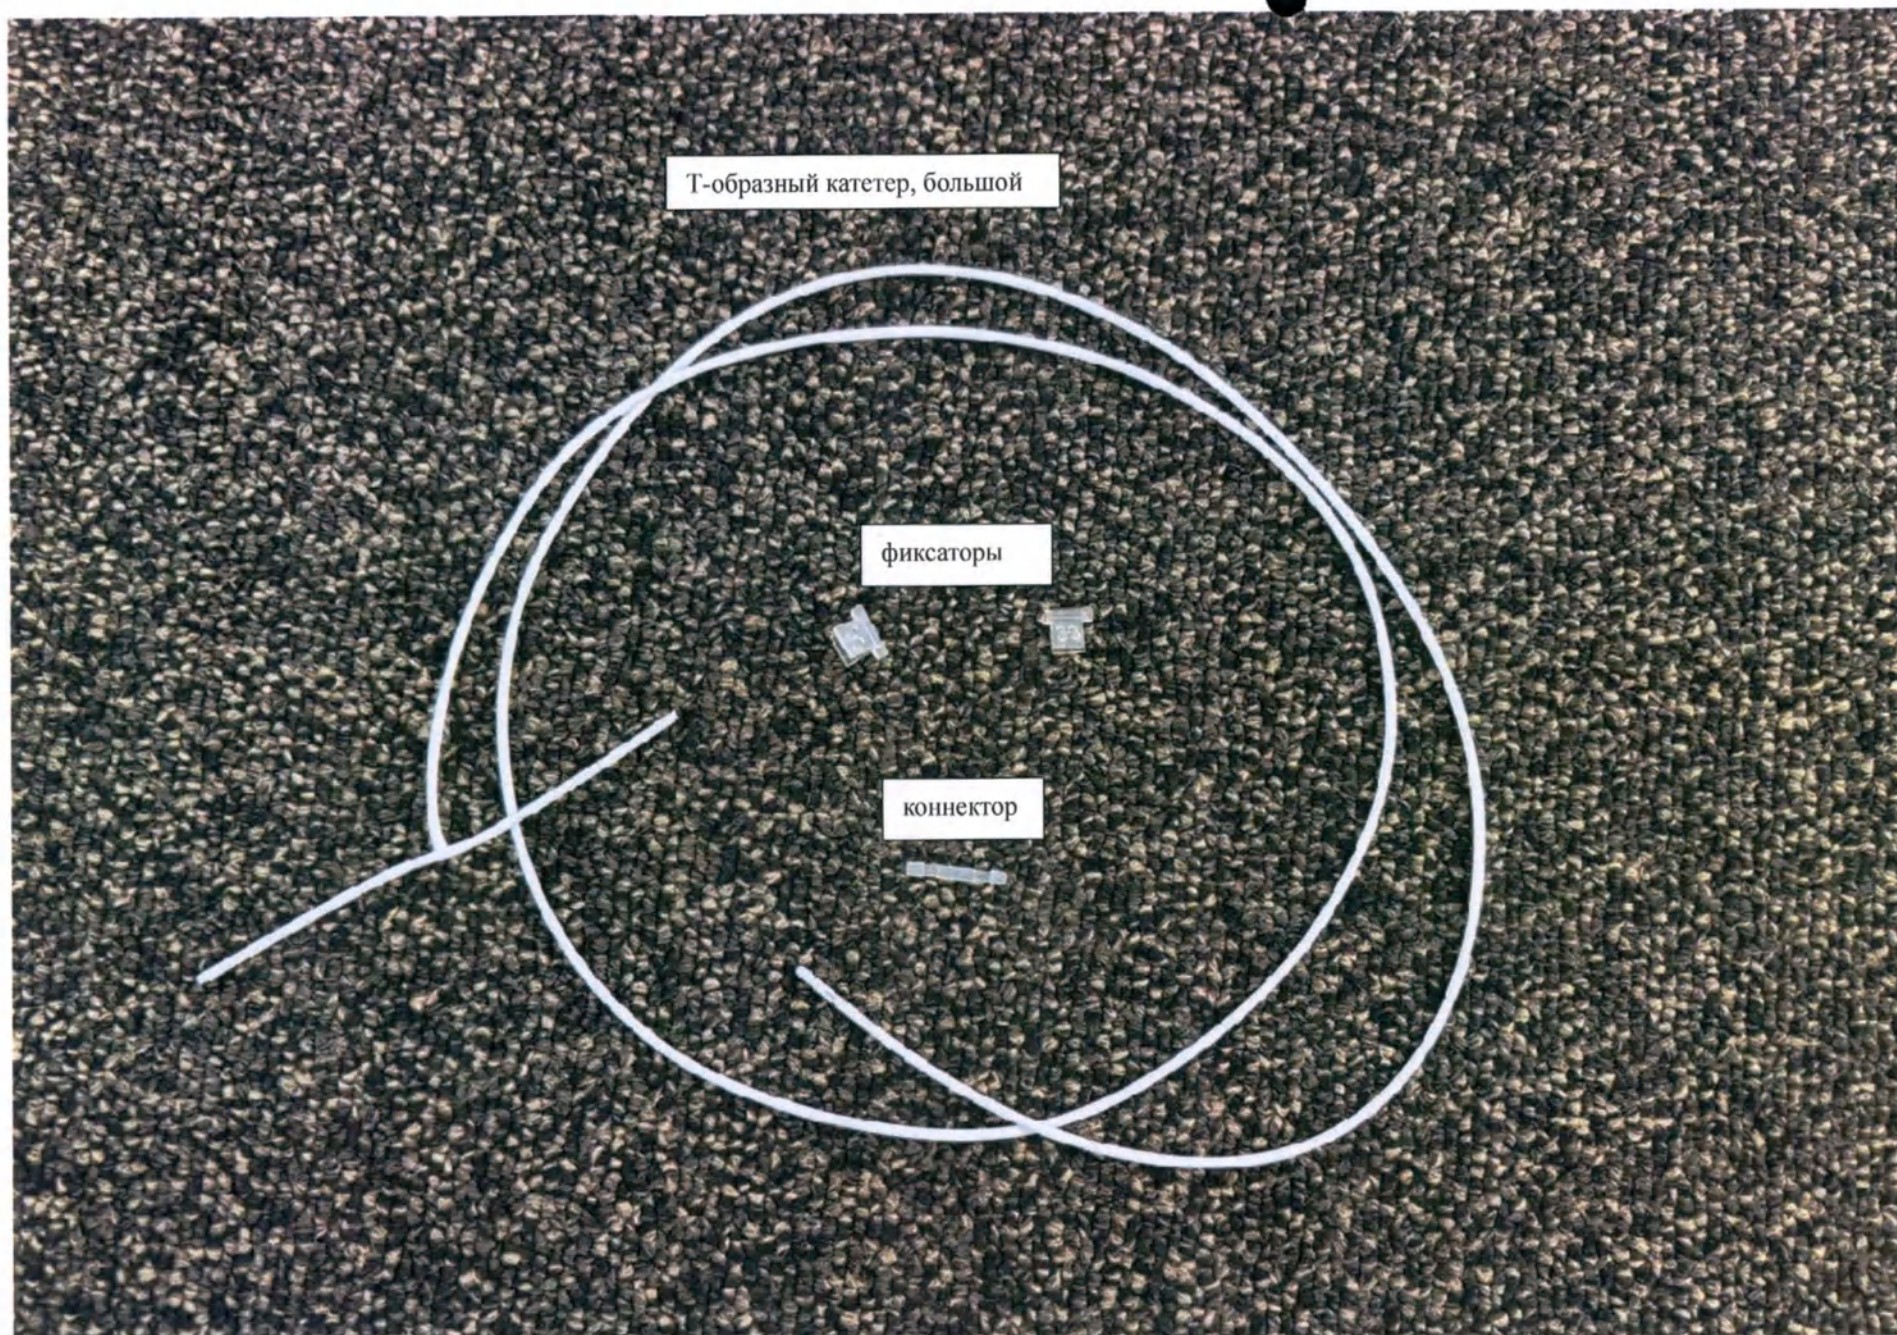

«Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе: Т-образный катетер, большой – 1 шт, Коннектор – 1 шт, Фиксатор – 2 шт»



Первичная упаковка изделия «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе: Т-образный катетер, большой – 1 шт, Коннектор – 1 шт, Фиксатор – 2 шт»

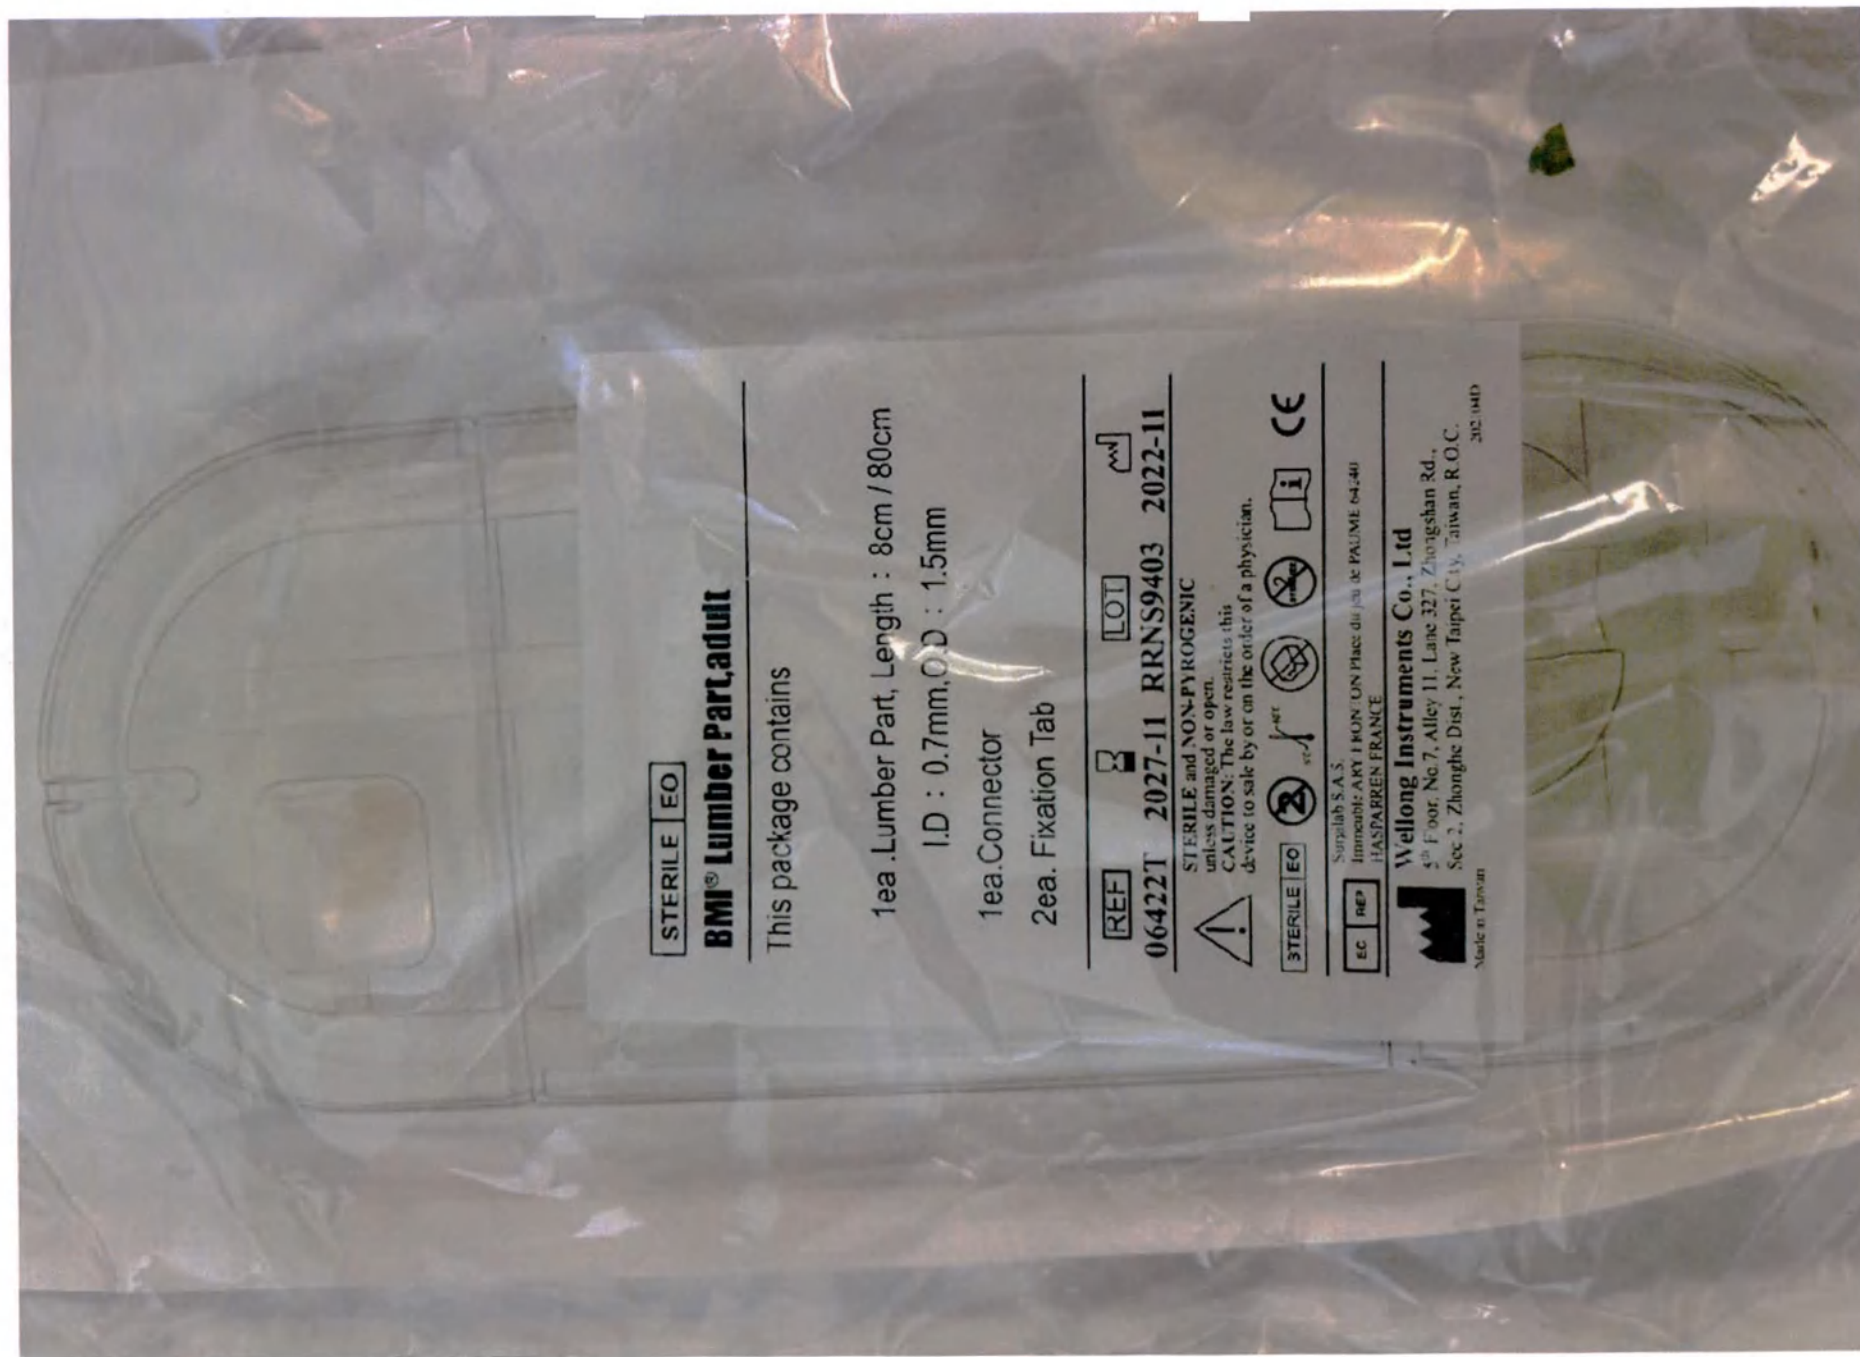

STERILE EO

BMI® Lumber Part, adult

This package contains

1ea. Lumber Part, Length : 8cm / 80cm

I.D : 0.7mm, O.D : 1.5mm

1ea. Connector

2ea. Fixation Tab

REF

3

LOT

W

06422T 2027-11 RRNS9403 2022-11

STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



STERILE EO

2

set

2

2

2

CE

Surpallab S.A.S.

Immeuble ARY FROM'UN Place du Jeu de PAUME 64240 HASPARREN FRANCE

EC

REP



Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd., Sec 2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202 (MD)

Маркировка производителя на первичной упаковке изделия «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе: Т-образный катетер, большой – 1 шт, Коннектор – 1 шт, Фиксатор – 2 шт»



Вторичная упаковка изделия «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе: Т-образный катетер, большой – 1 шт, Коннектор – 1 шт, Фиксатор – 2 шт»

Маркировка производителя на вторичной упаковке изделия «Система дренирования спинномозговой жидкости люмбальная большая, с Т-образным катетером, в составе: Т-образный катетер, большой – 1 шт, Коннектор – 1 шт, Фиксатор – 2 шт»

STERILE EO

BMI® Lumber Part, adult

This package contains

1ea. Lumber Part, Length : 8cm / 80cm

I.D : 0.7mm, O.D : 1.5mm

1ea. Connector

2ea. Fixation Tab

REF



LOT



06422T 2027-11 RRNS9403 2022-11



STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REP

Surgilab S.A.S.

Immeuble ARY FRONTON Place du jeu de PAUME 64340

HA SPAREN FRANCE




Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,

Sec.2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202104D

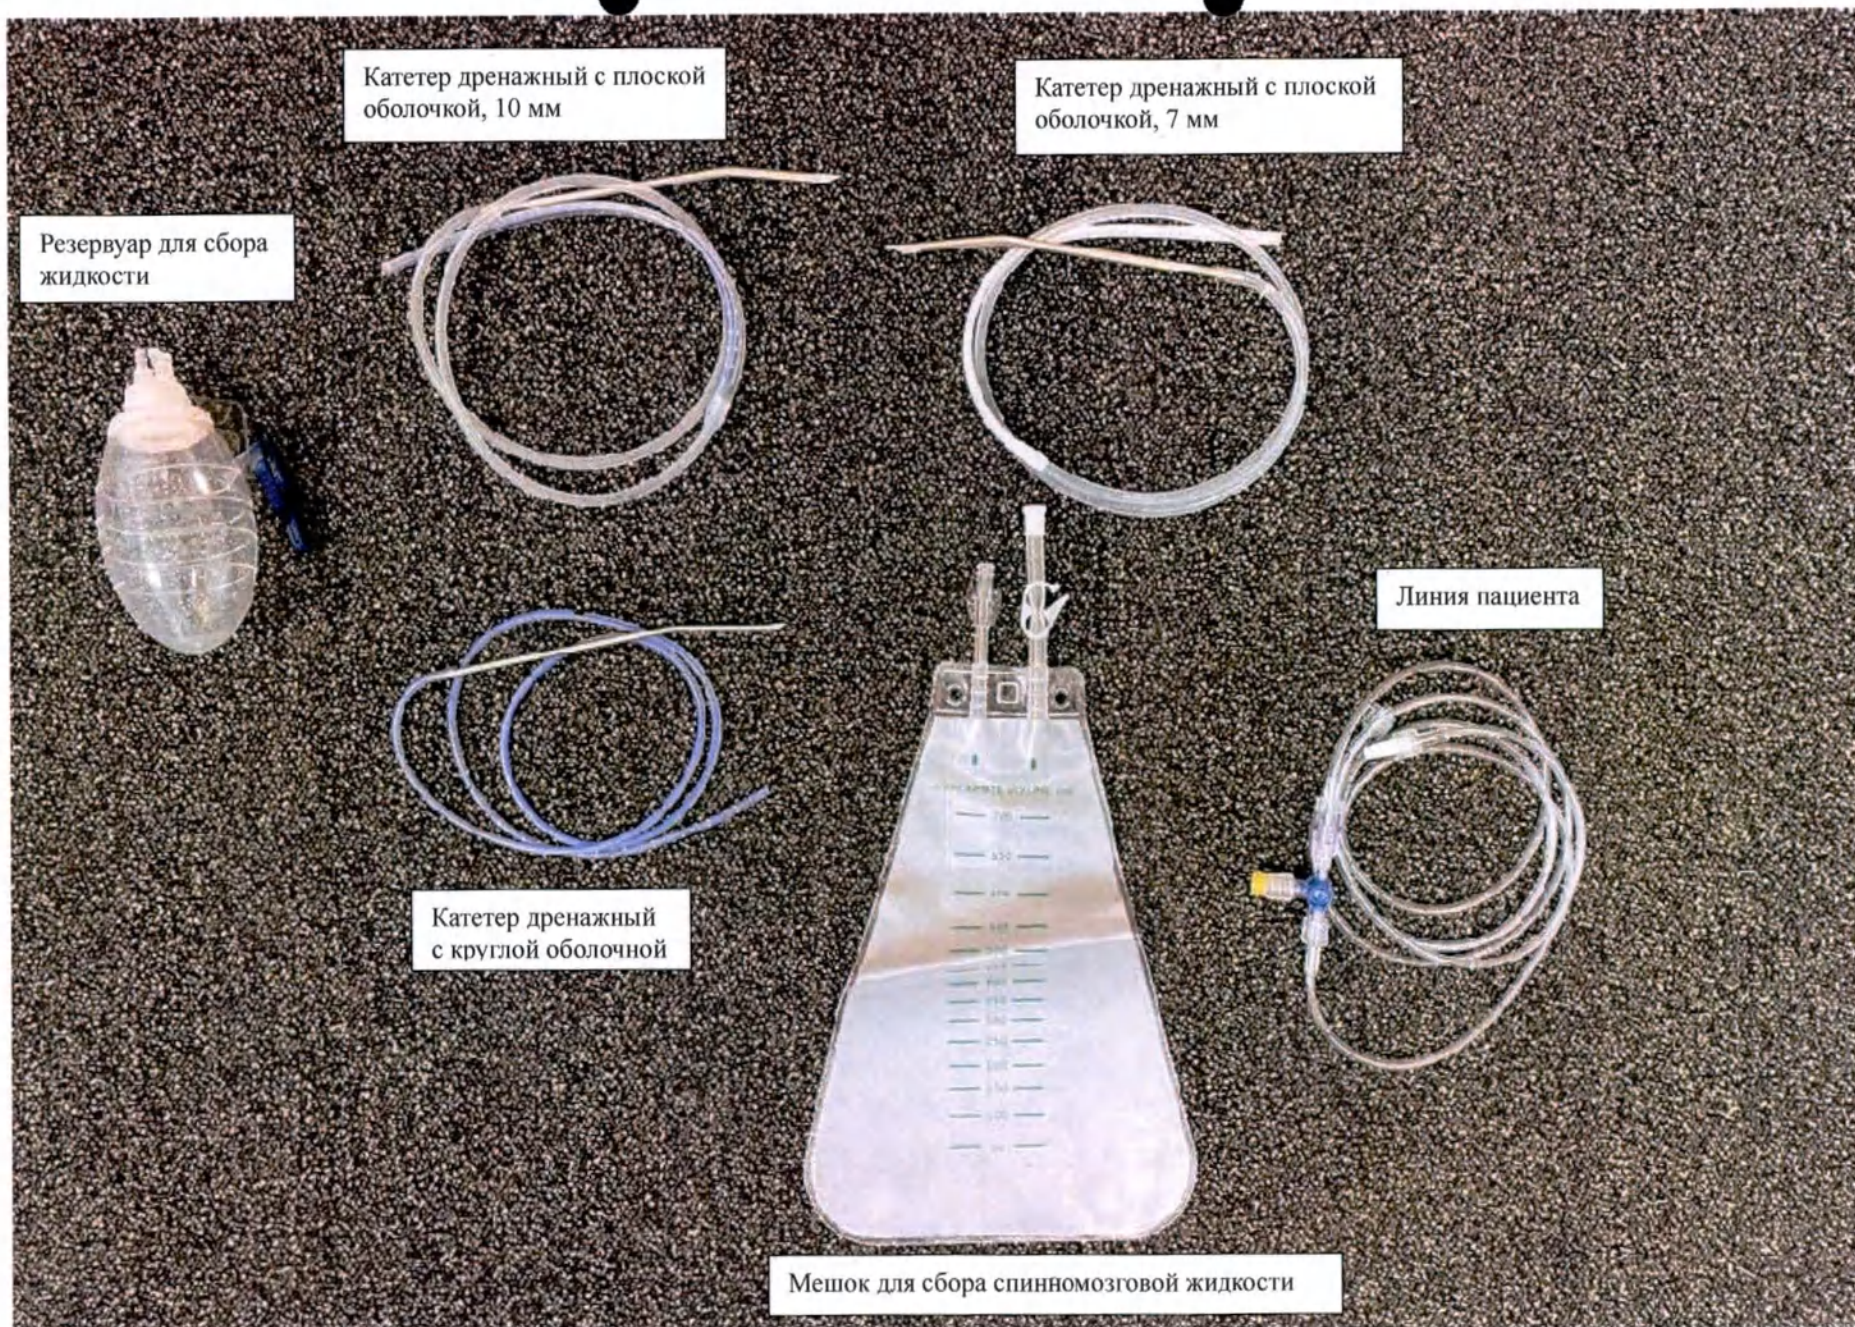

«Система дренирования спинномозговой жидкости и других жидкостей с похожими физическими характеристиками, в составе: Резервуар для сбора жидкости – 1 шт.; Катетер дренажный с круглой оболочкой – 1 шт; Катетер дренажный с плоской оболочкой, 10 мм – 1 шт; Катетер дренажный с плоской оболочкой, 7 мм – 1 шт; Мешок для сбора спинномозговой жидкости – 1 шт.; Линия пациента – 1 шт»



BMI® Bulb Drainage System

STERILE EO

Bulb Drainage Catheter

This package contains:

1 ea. Bulb Drainage Catheter 7mm (Flat)
I.D.: 2.8mm O.D.: 4.8mm
Length 76cm

REF: 06648-1 LOT: RSN51208 2023-11

STERILE AND NON-PYROGENIC

See instructions for use.

CAUTION: The law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO

Lotus Med B.V.
Weern Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands

Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No 7, Alley 11, Lane 227, Zhongshan Rd.,
Sec 2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.
205046

Made in Taiwan

Первичная упаковка изделия «Катетер дренажный с плоской оболочкой, 7 мм»

BMI® Bulb Drainage System

STERILE EO

Bulb Drainage Catheter

This package contains:

1 ea. Bulb Drainage Catheter 7mm (Flat)

I.D.:2.8mm O.D.:4.8mm

Length:75cm

REF



LOT



06648-1 2028-11 RSNS1208 2023-11



STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REP

Luana Med B.V.
Weena Zuid , 130, Rotterdam, Netherlands



Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec 2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.
202304E

Made in Taiwan

Маркировка производителя на первичной упаковке изделия «Катетер дренажный с плоской оболочкой, 7 мм»



BMI® Bulb Drainage System

STERILE EO

Bulb Drainage Catheter

This package contains:

1 ea. Bulb Drainage Catheter 10Fr. (Round)

I.D.:1.5mm O.D.:3.3mm

Length:75cm

REF 06648-2 LOT 2028-11 RSNS1317 2023-11

STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.
CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO

Luara Med B.V.
Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands

Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No 7, Alley 11, Lane 127, Zhongshan Rd.,
Sec 2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

Первичная упаковка изделия «Катетер дренажный с круглой оболочной»

BMI® Bulb Drainage System

STERILE EO

Bulb Drainage Catheter

This package contains:

1 ea. Bulb Drainage Catheter 10Fr. [Round]
I.D.:1.5mm O.D.:3.3mm
Length:75cm


REF



LOT



06648-2 2028-11 RSNS1317 2023-11




STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.
CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.

STERILE EO



EC REP

Luana Med. B.V.
Weena Zuid , 130, Rotterdam, Netherlands



Made in Taiwan

Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,
Sec 2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

202304E



Первичная упаковка изделия «Резервуар для сбора жидкости»

BMI® Bulb Drainage System

STERILE EO

Bulb Reservoir

This package contains:

1 ea. Bulb Reservoir 100c.c.

REF



LOT




06648-3 2028-11 RSNS1416 2023-11

STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open

CAUTION: The law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



STERILE EO



cc

ml

Luna Med. B.V.

Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands

Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No. 7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,

Sec 2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202304E

Маркировка производителя на первичной упаковке изделия «Резервуар для сбора жидкости»

BMI® Bulb Drainage System

STERILE EO

Bulb Drainage Catheter

This package contains:

1ea. Bulb Drainage Catheter 10mm (Flat)

I.D.: 2.8mm O.D.: 4.8mm

Length: 75cm

REF



LOT



06648-4 2028-11 RSNS6607 2023-11

STERILE and NON-PYROGENIC

unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this

device to sale by or on the order of a physician.



STERILE EO



REF



Luana Med B.V.
Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands

REF



Wellong Instruments Co., Ltd

5th Floor, No 7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,

Sec 2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202006

Первичная упаковка изделия «Катетер дренажный с плоской оболочкой, 10 мм»

BMI® Bulb Drainage System

STERILE EO

Bulb Drainage Catheter

This package contains:

1 ea. Bulb Drainage Catheter 10mm [Flat]

I.D.: 2.8mm O.D.: 4.8mm

Length: 75cm

REF



LOT



06648-4 2028-11 RSNS6607 2023-11

STERILE and NON-PYROGENIC
unless damaged or open.

CAUTION: The law restricts this
device to sale by or on the order of a physician.



STERILE EO



EC REP

Luana Med. B.V.

Weena Zuid, 130, Rotterdam, Netherlands



Wellong Instruments Co., Ltd


5th Floor, No.7, Alley 11, Lane 327, Zhongshan Rd.,

Sec 2, Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Made in Taiwan

202304E

Маркировка производителя на первичной упаковке изделия «Катетер дренажный с плоской оболочкой, 10 мм»

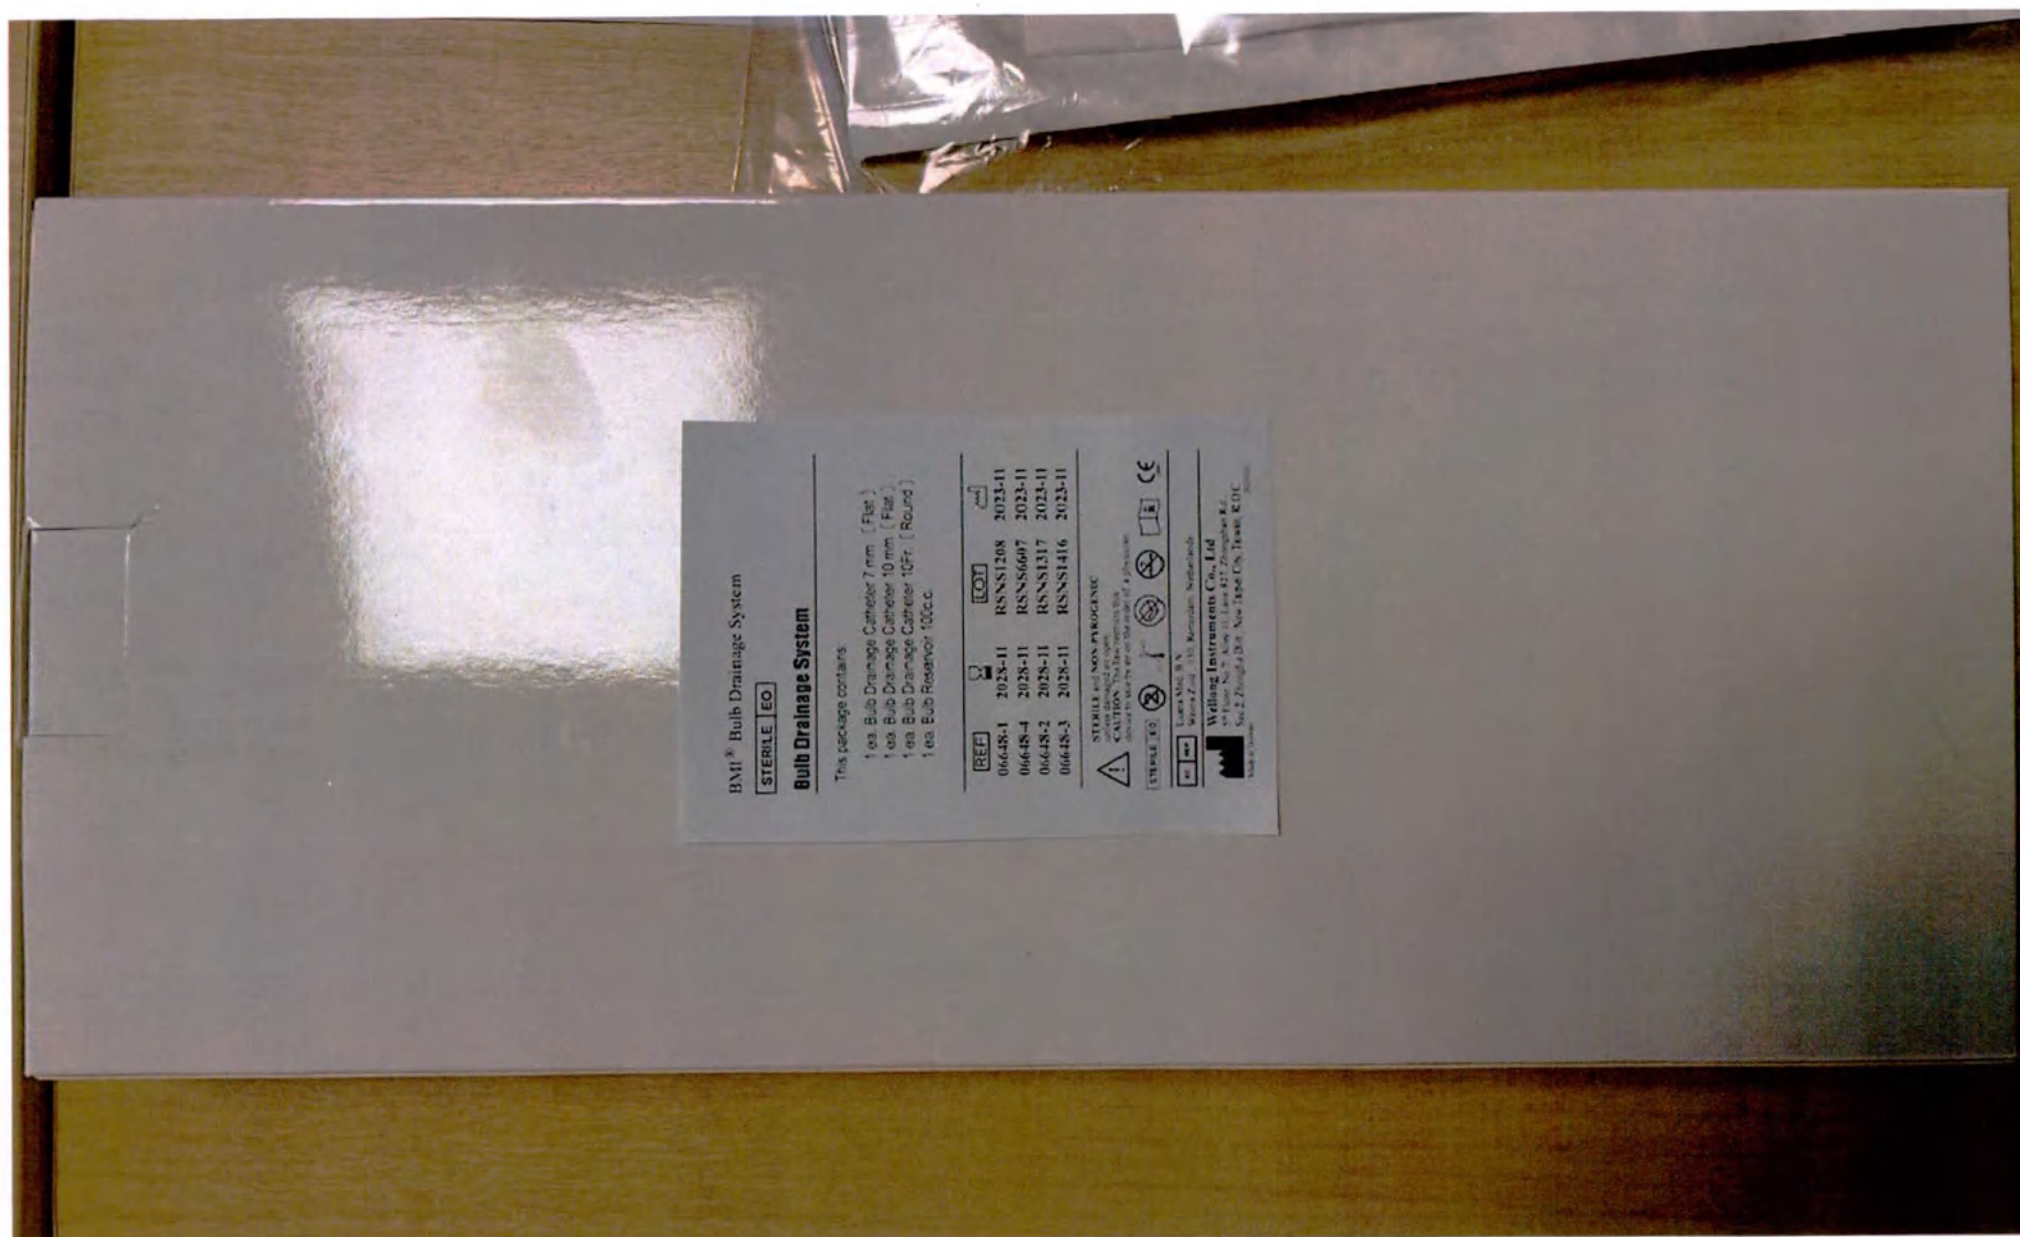

Единая вторичная упаковка варианта исполнения «Система дренирования спинномозговой жидкости и других жидкостей с похожими физическими характеристиками, в составе: Резервуар для сбора жидкости – 1 шт.; Катетер дренажный с круглой оболочкой – 1 шт; Катетер дренажный с плоской оболочкой, 10 мм – 1 шт; Катетер дренажный с плоской оболочкой, 7 мм – 1 шт»

STERILE	EO
---------	----

This package contains:

- 1 ea. Bulb Drainage Catheter 7 mm [Flat]
1 ea. Bulb Drainage Catheter 10 mm [Flat]
1 ea. Bulb Drainage Catheter 10Fr. [Round]
1 ea. Bulb Reservoir 100cc.

REF		LOT	
06648-1	2028-11	RSNS1208	2023-11
06648-4	2028-11	RSNS6607	2023-11
06648-2	2028-11	RSNS1317	2023-11
06648-3	2028-11	RSNS1416	2023-11

STERILE and NON-PYROGENIC

STERILE and NON-PYROGENIC
units demanded or coded.

CAUTION: The law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

STEARNS CO.

1

Luma Mod BV

Luna Mol BV
Lagoon Land, 110, Rotterdam, Netherlands

Wellong Instruments Co., Ltd

Wellong Instruments Co., Ltd

9th floor, No. 7, Alley 11, Lane 127, Thompson Rd.

See: *Demetrius* Dost, New Taipei City, Taiwan, R.O.C.See L. Thompson Dorr, New York City, *National*.

—

U.S. Dept. of Justice

Вентрикулярный катетер большой ВМ1

ПУ: №

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 061188

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

катетер вентрикулярный большой (1 шт); заглушка Luet (1 шт); коннектор Luet (1 шт); тросик (1 шт); стилет (1 шт); инструкция (1 шт)

Стерильно. Ампотерно.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Велдон Инструментс Ко., Лтд», Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибутор на территории РФ: ООО «Исбронпродукт», Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101.

Тел +7 495 6608173



Пример русскоязычной маркировки изделия

Система артериального давления
ру: №

Дата производства:

Использовать до:

Артикул: 06418

Код партии:

Кол-во: 1 шт.

Состав упаковки:

1. Катетер тонкобаллонный мягкий - 1 шт.

2. Игла Тухи - 1 шт.

3. Игла-стilet - 1 шт.

4. Коннектор Luer - 1 шт.

5. Фиксатор - 2 шт.

6. Инструкция по применению - 1 шт.

Стерильно. Асептично.

Транспортировать и хранить при температуре от 5°C до 40°C.

Производитель: «Зелен» Инструментс Ко., Лтд., Тайвань, Китайская Республика

Страна изготовления: Тайвань, Китайская Республика

Эксклюзивный дистрибутор на территории РФ: ООО «Нирокродект»,

Россия, 127486, г. Москва, Каренинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,

Тел: +7 495 6648113



STERILE EU

Пример русскоязычной маркировки изделия

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью



(Александр Заварин) лист об

/Чебурашкин Д.М.)