

**ПОДТВЕРЖДАЮ**



Генеральный директор  
ООО «Миндрей Медикал Рус»  
Сюнь Вэй.  
«22» декабря 2023 г.

по доверенности от 30.11.22г  
СЫСЬОЕВА Н.В.  
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА  
РЕГИСТРАЦИИ

## **Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro**

Набор реагентов для диагностики in vitro для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в сыворотке крови человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL

Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»  
129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,  
пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А.  
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39  
ИНН 7705815069 КПП 770201001

**mindray**

**TRAb**

UDI



(01)06903053028097 (97)105-010975-A0

(10)2022090212 (99)105-010975-00

(17)240420 (98)2F3202209021200102

## Anti-Thyrotropin Receptor Antibody(CLIA)

**2×50 tests**

**Contents :** Ra: 2×3.8 mL, Rb: 2×3.5 mL Rc: Empty cavity, Rd: 2×3.5 mL  
PTR: Add 4.0 mL PTB, PTB: 2×5.0 mL



**SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.**


Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel : +86-755-81888998 Fax : +86-755-26582680 [www.mindray.com](http://www.mindray.com)

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

IVD



0123 2°C




Рисунок 1 Внешняя упаковка. Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в сыворотке крови человека иммунохемилуминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2x50 тестов (вид 1)

**mindray**

**TRAb**



Anti-Thyrotropin Receptor Antibody (CLIA)  
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (ХЛИА)  
Anticorpo antirreceptor de tireotropina (CLIA)  
Anticuerpo antireceptor de tirotropina (CLIA)  
Anticorpo anti-recettore della tireotropina (CLIA)  
Anti-Tirotropin Reseptör Antikoru (CLIA)  
Anticorps anti-récepteur de thyrotropine (CLIA)



2F3202209021200102

**2x50 tests**

**REF** 105-010975-00

**LOT** 2022090212



2024-04-20

047-039621-00(1.0)

Рисунок 2. Внешняя упаковка Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона



IVD



**SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.**

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,  
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680

Website: <http://www.mindray.com>

Рисунок 3. Внешняя упаковка Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона

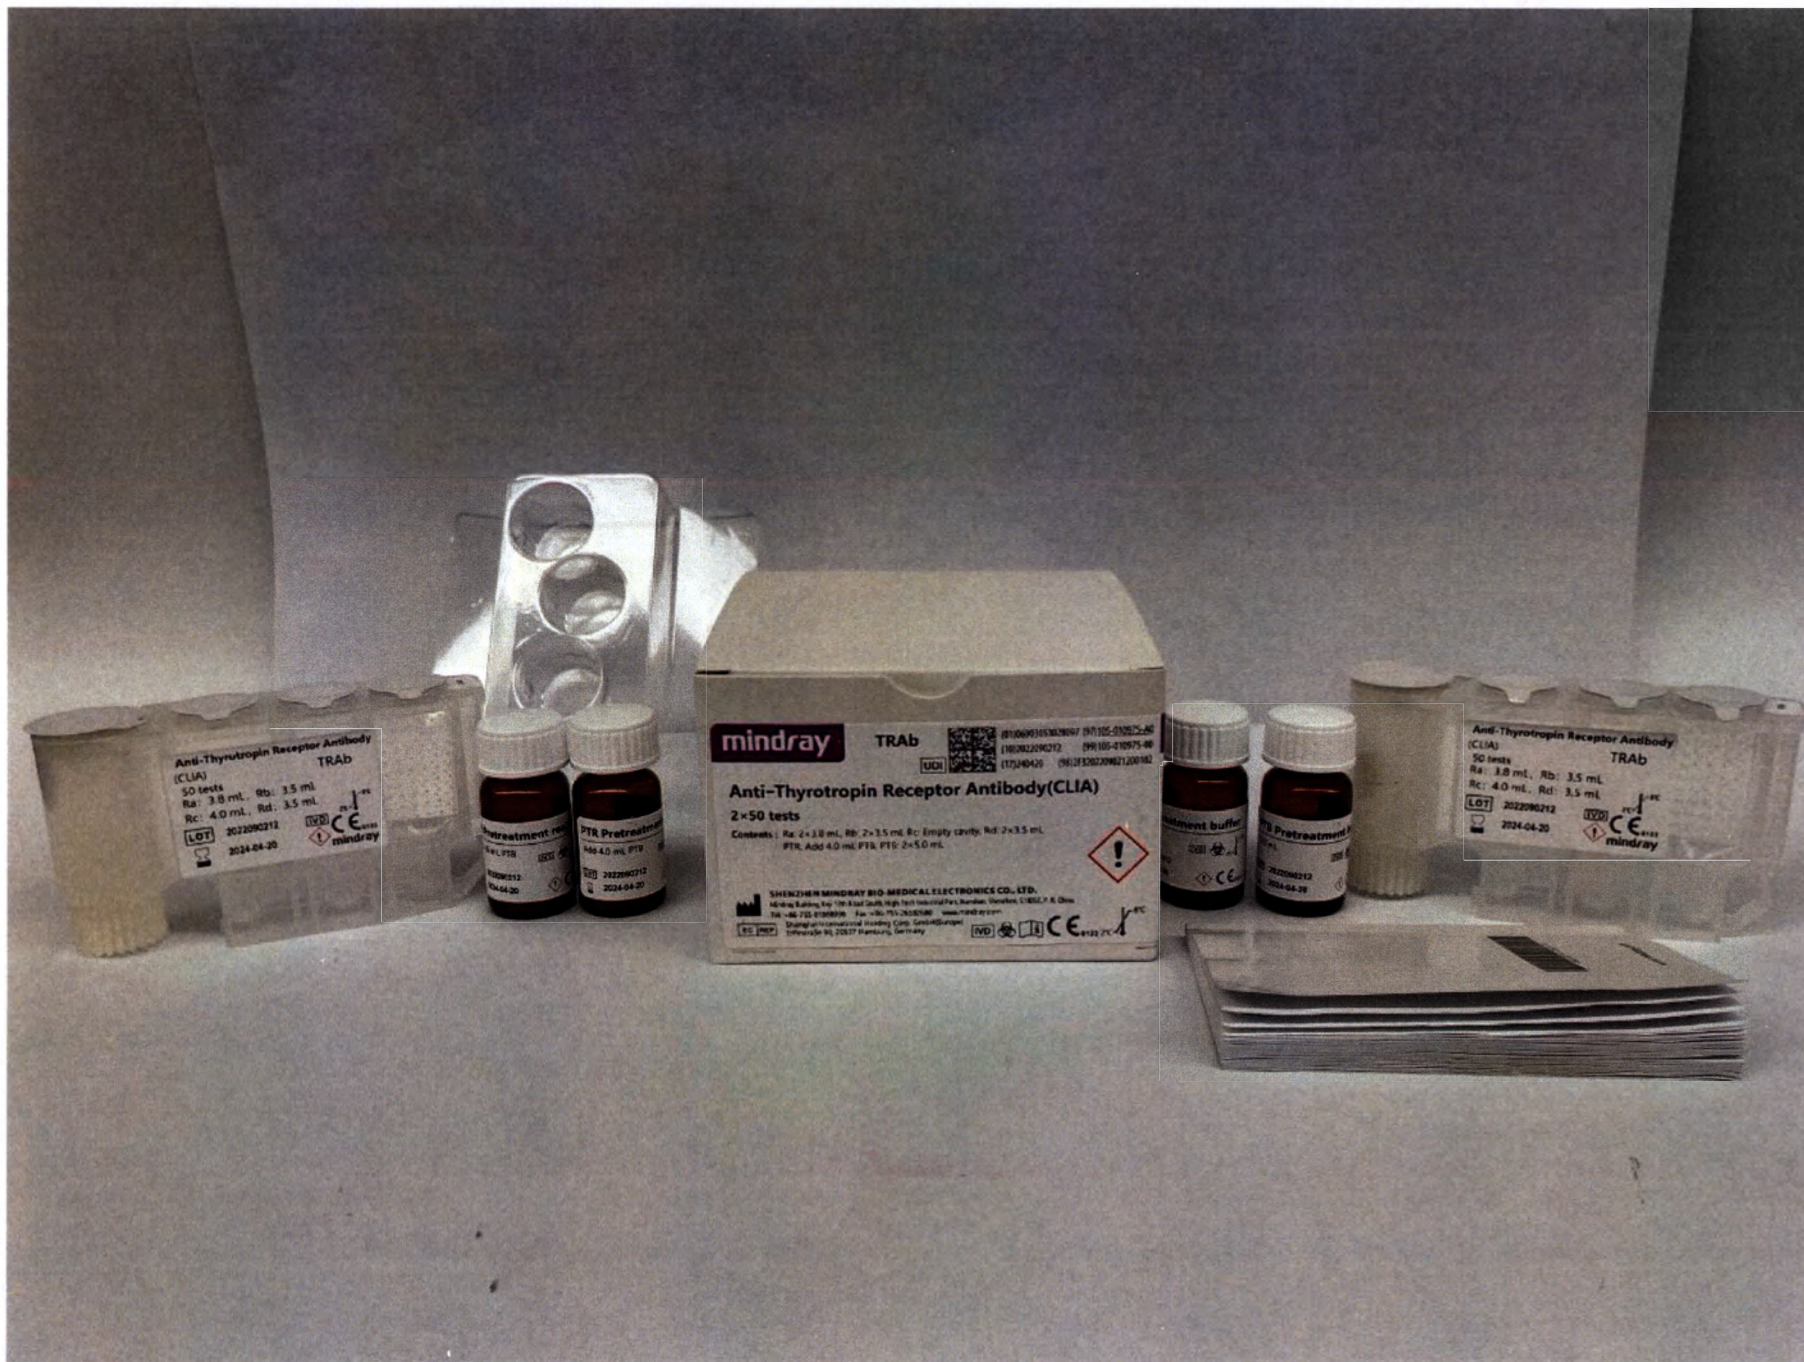


Рисунок 4. Общий вид Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb)

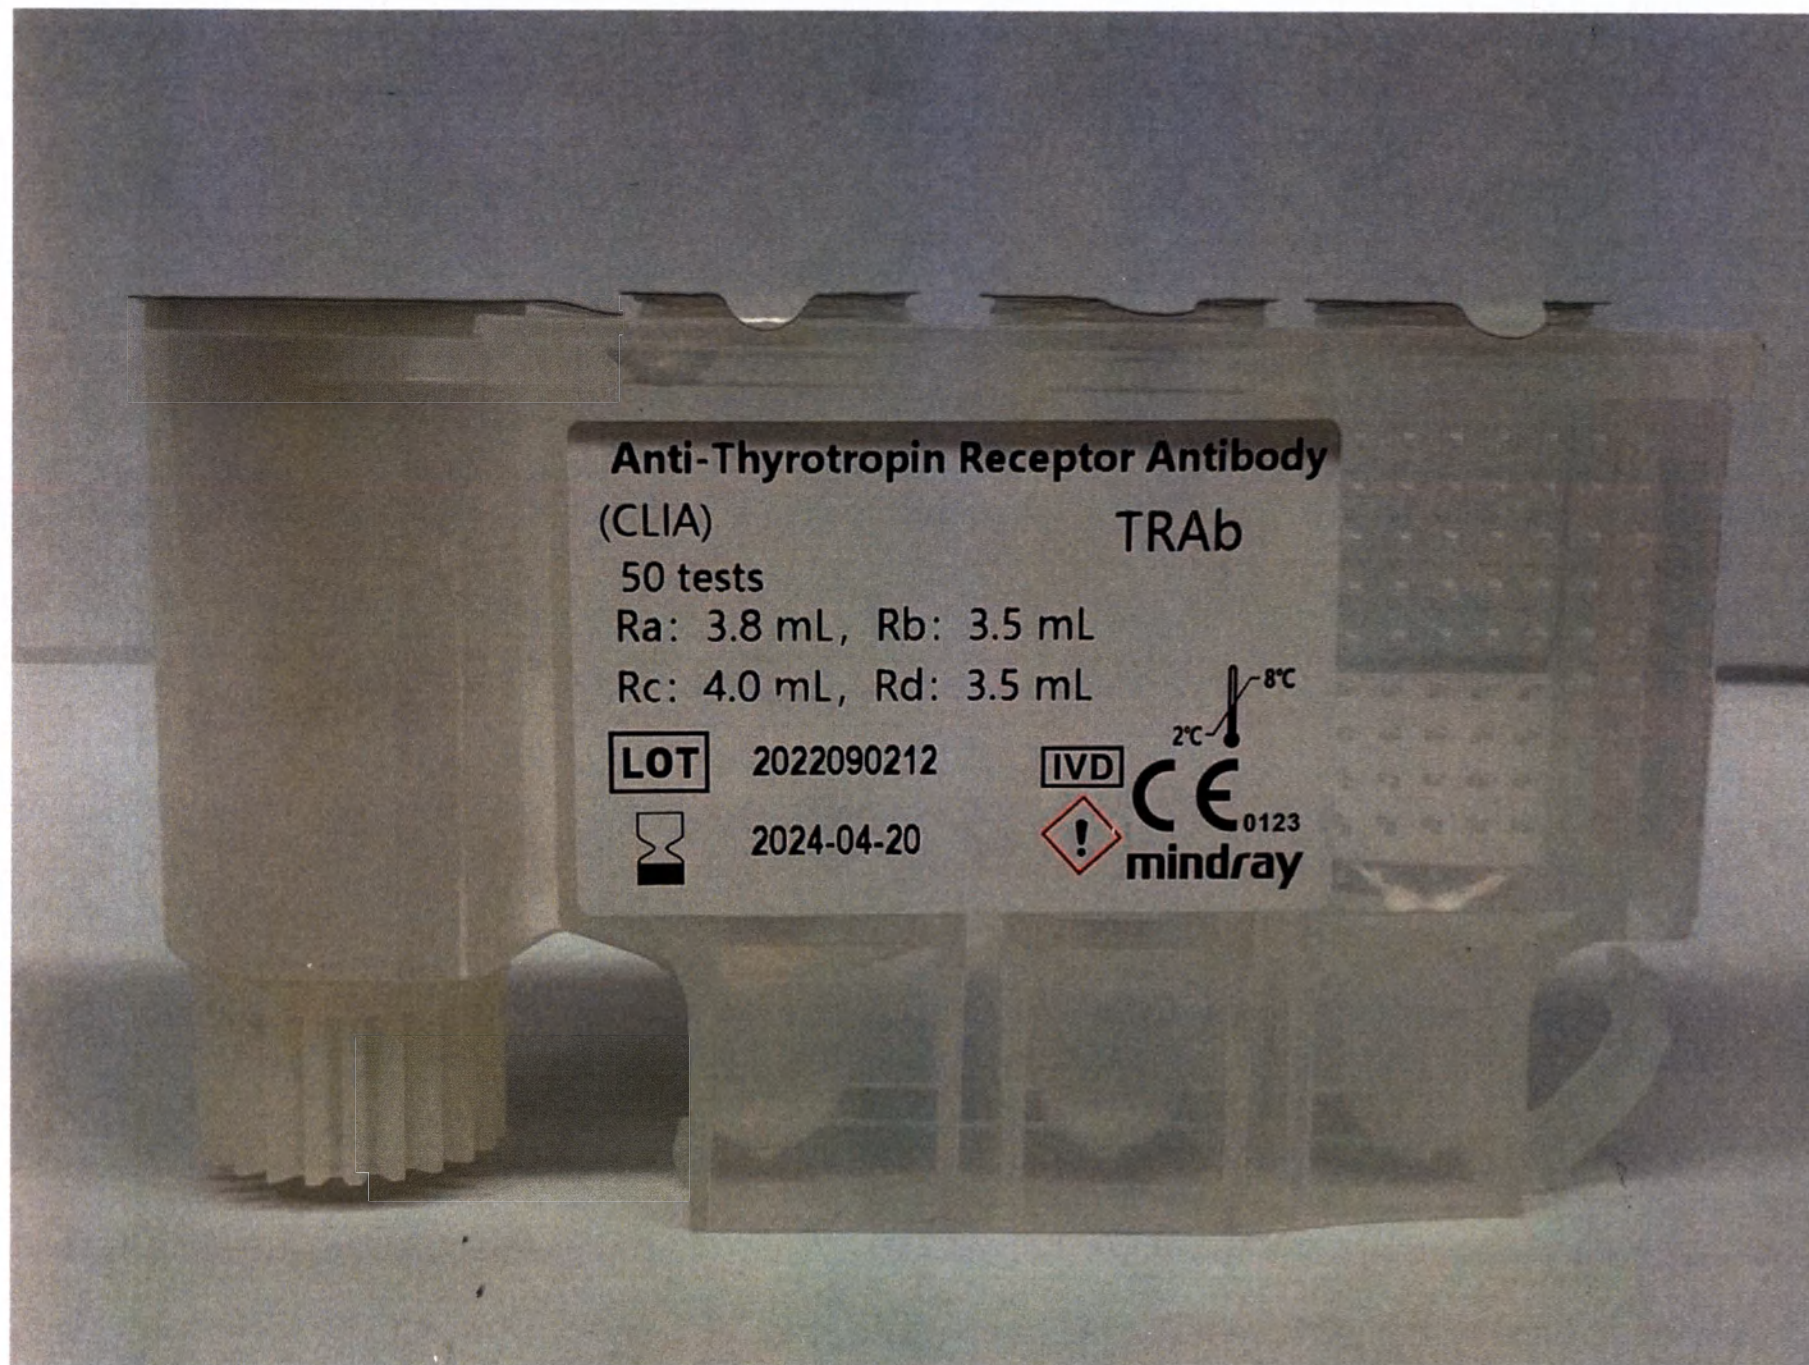


Рисунок 5. Кассета с реагентами - 2 шт. (вид 1)

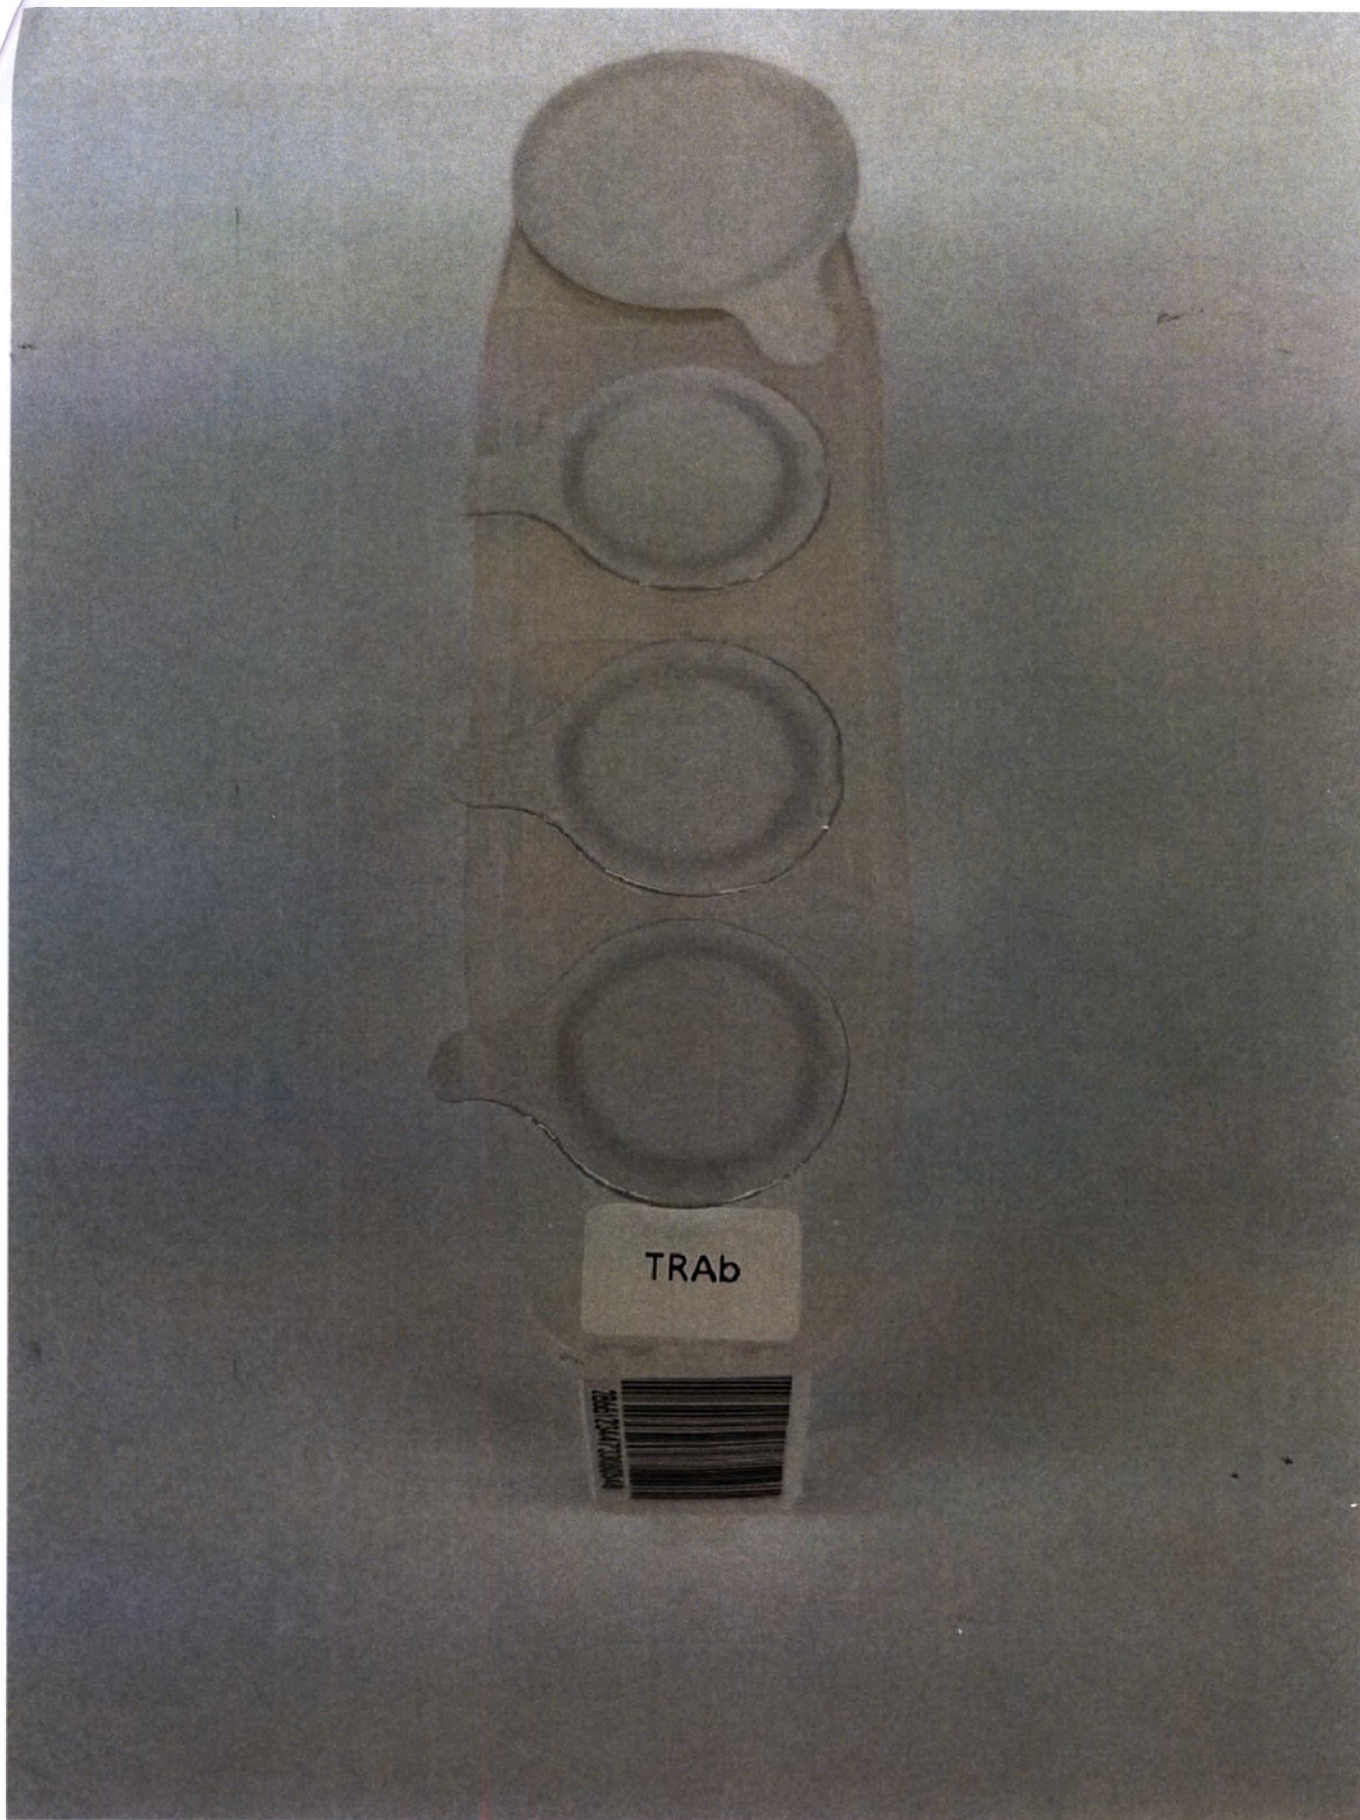


Рисунок 5. Кассета с реагентами - 2 шт. (вид 2)

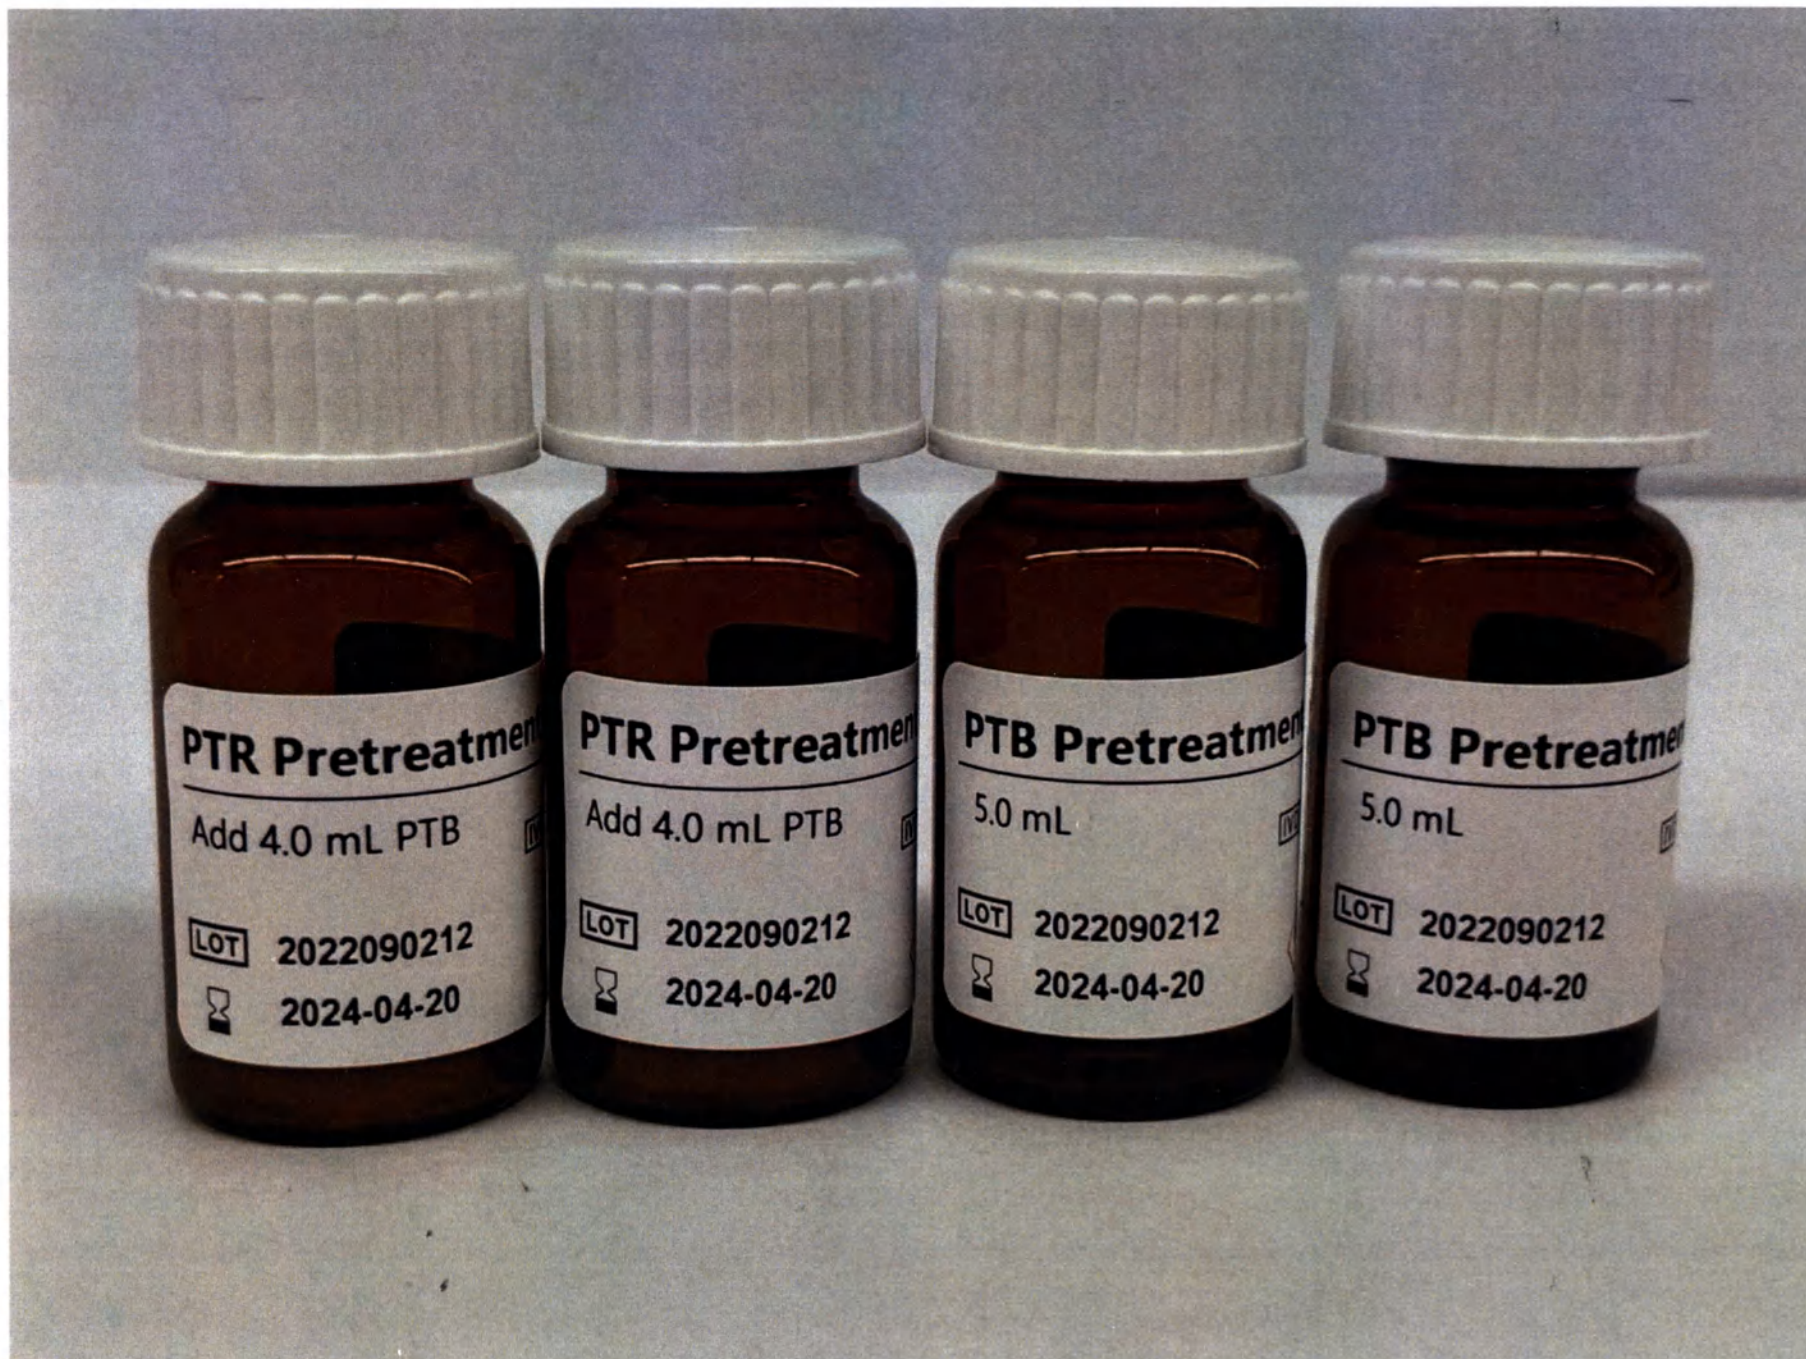


Рисунок 7. Реагент для обработки образца (PTR) – 2шт. и буферный раствор для приготовления раствора для обработки образца (PTB) – 2шт. (вид

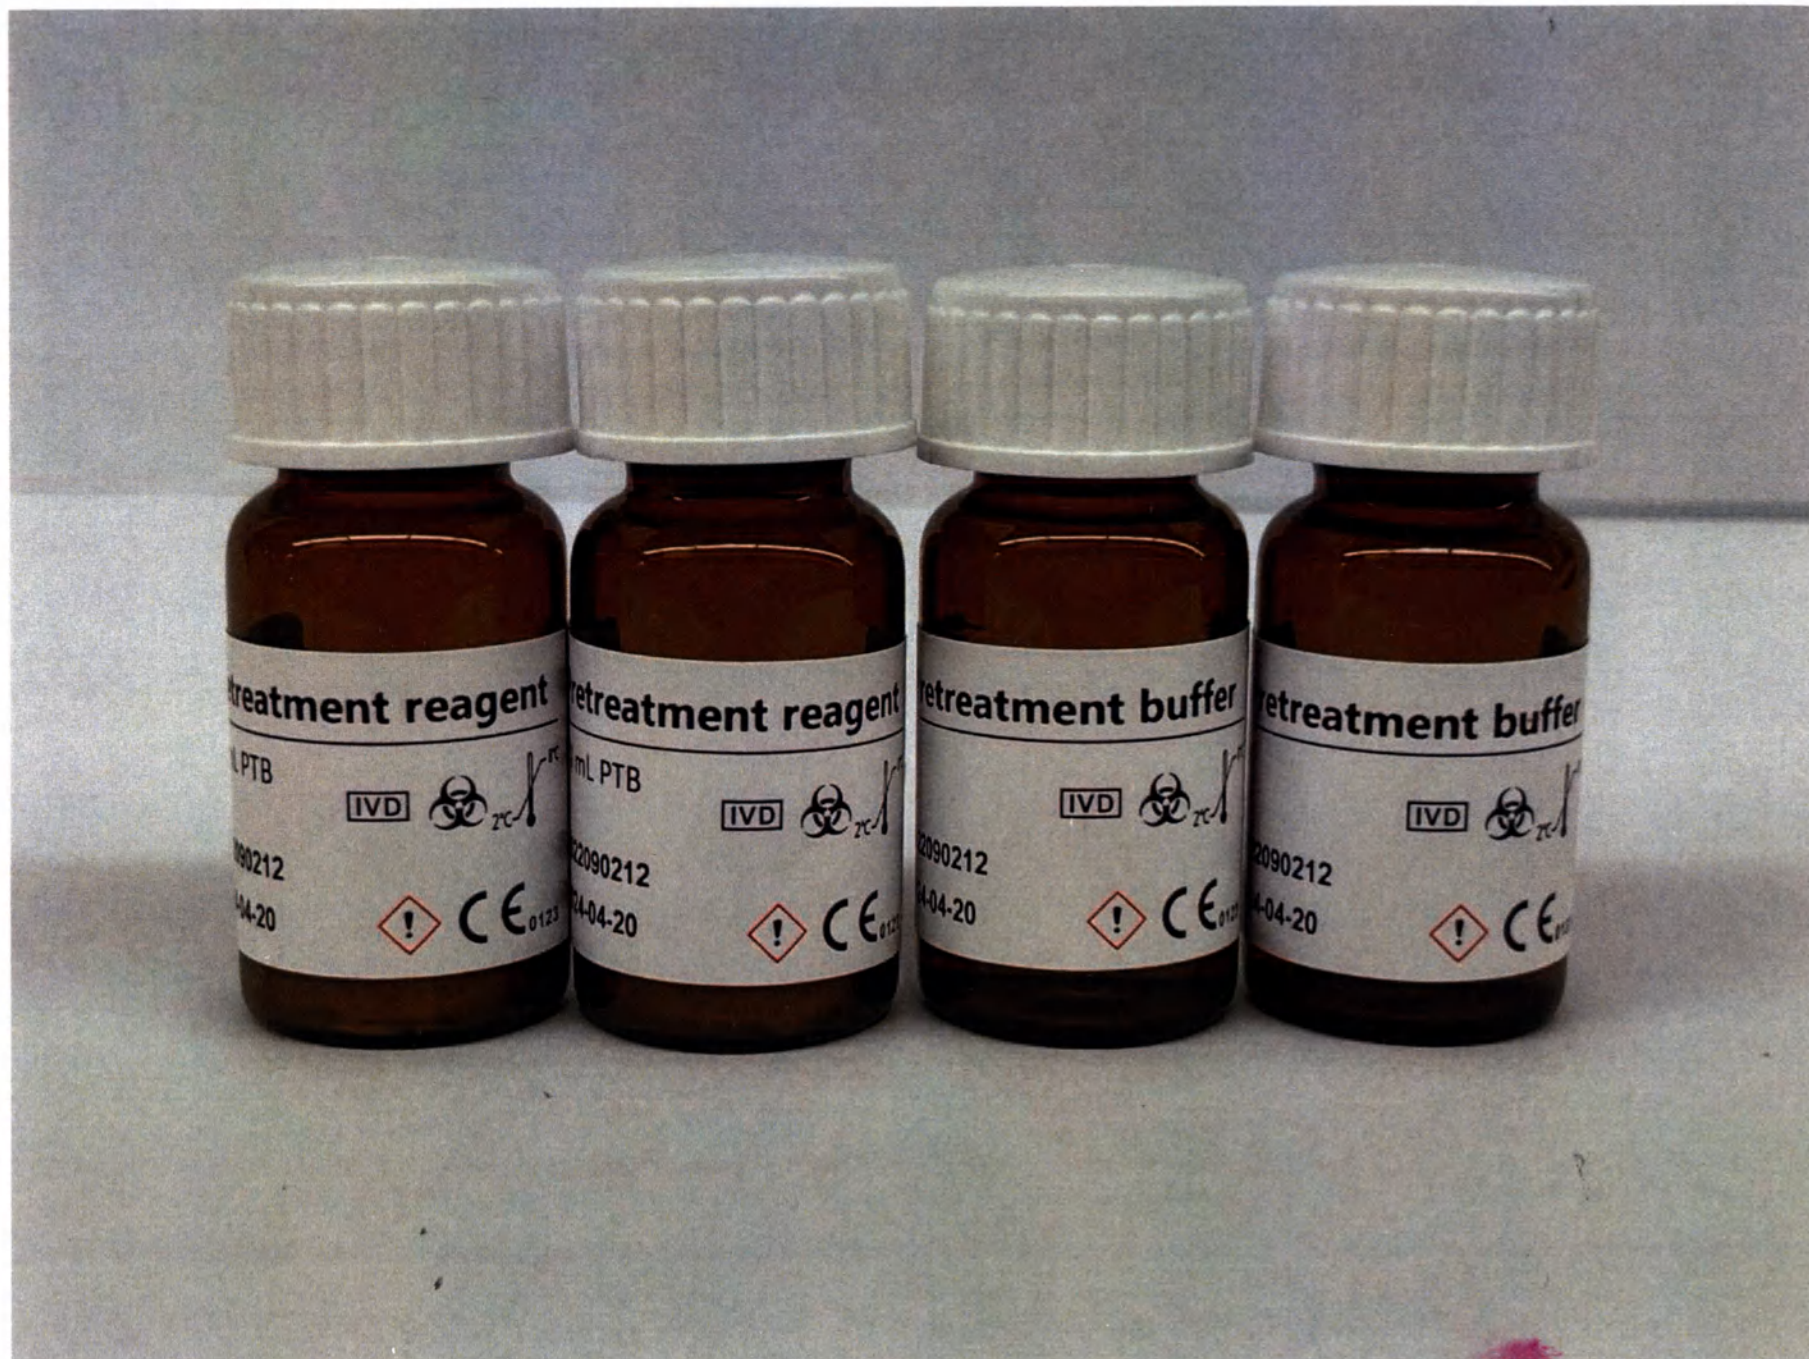


Рисунок 8. Реагент для обработки образца (PTR) – 2шт. и буферный раствор для приготовления раствора для обработки образца (PTB) – 2шт. (вид

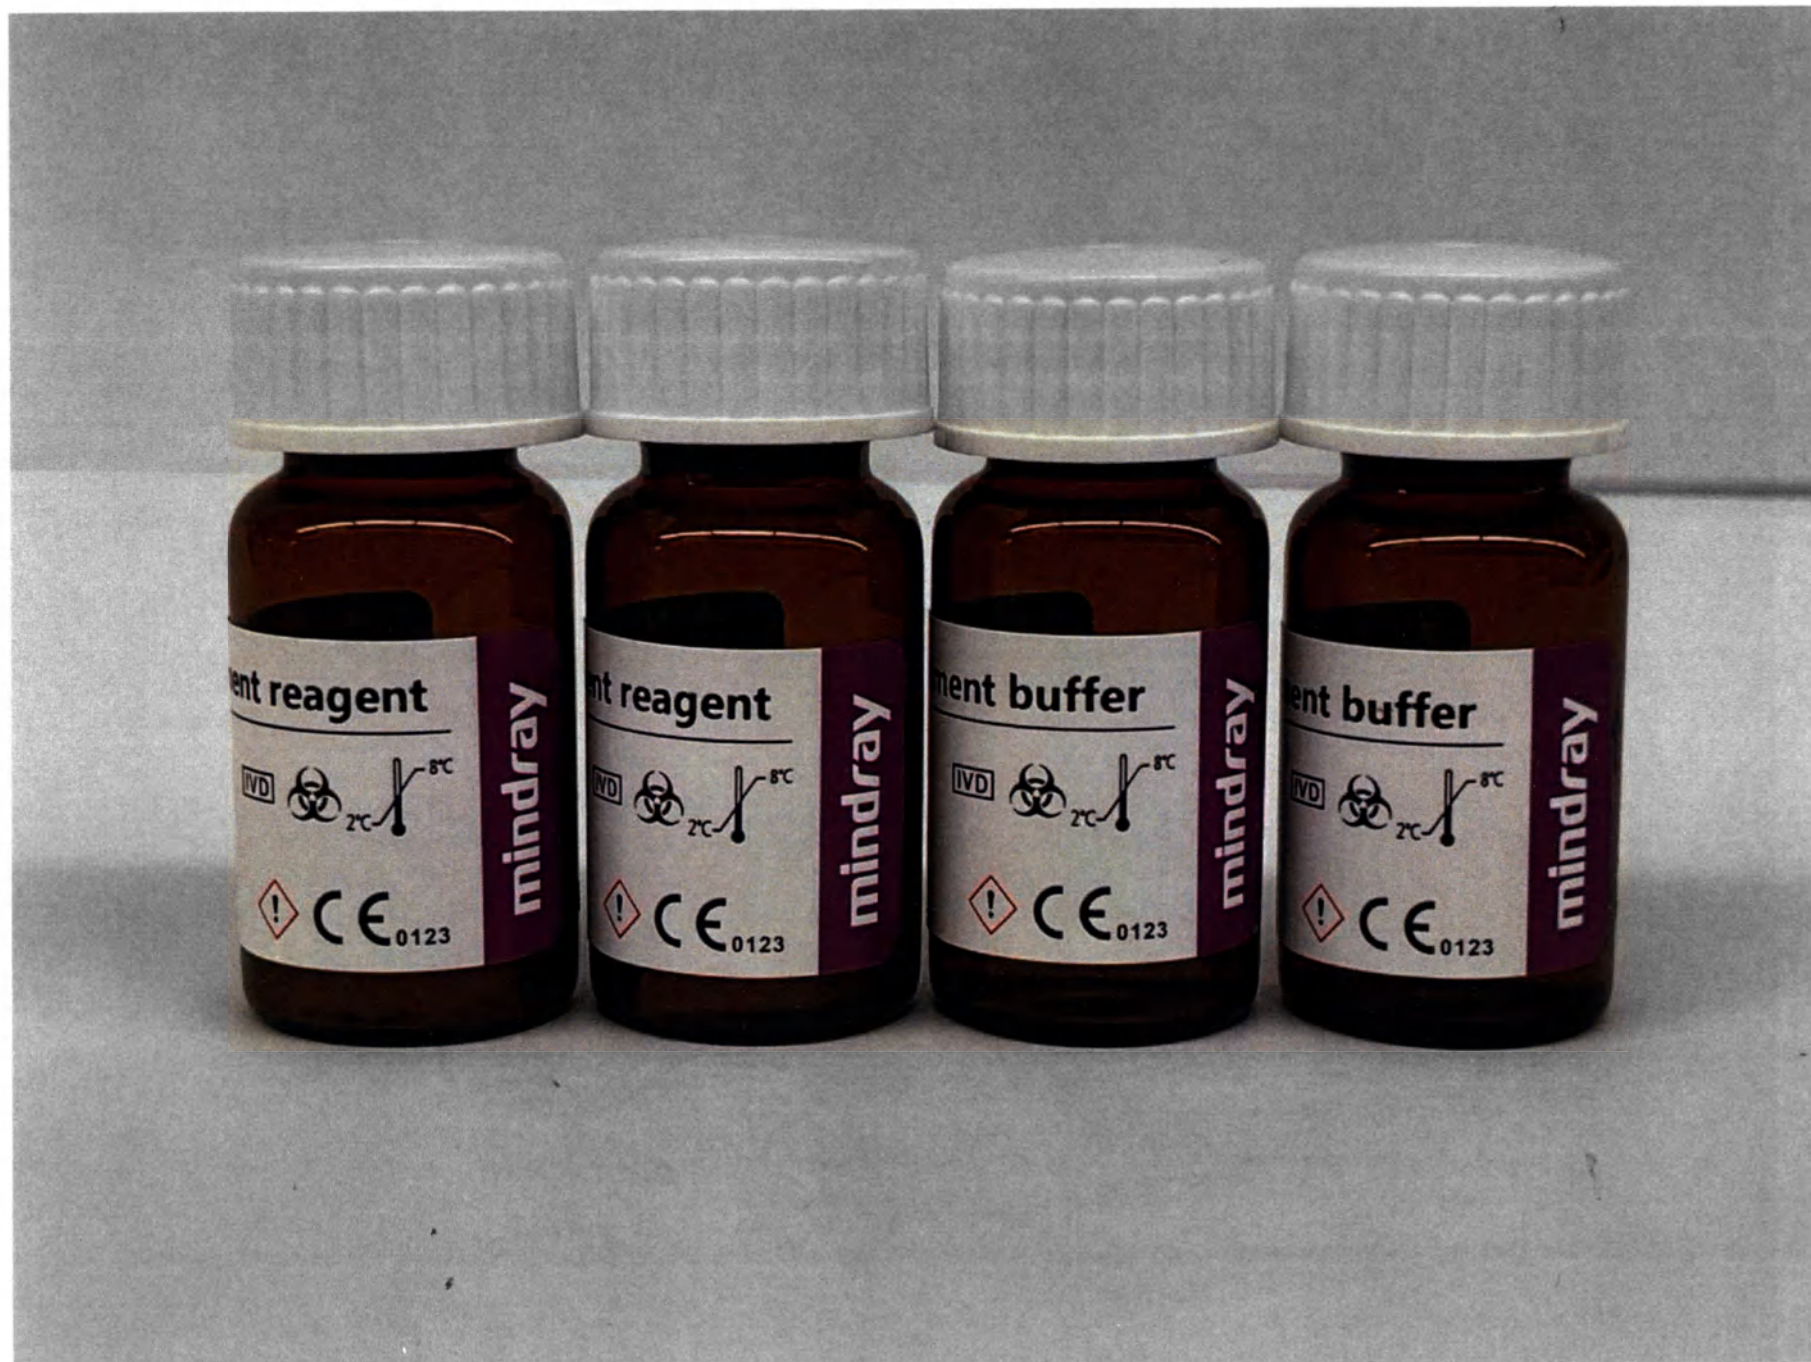


Рисунок 9. Реагент для обработки образца (PTR) – 2шт. и буферный раствор для приготовления раствора для обработки образца (PTB) – 2шт. (вид

**mindray**

**TRAb**

UDI



(01)06903053028110 (97)105-010976-A0  
(10)2022090111 (99)105-010976-00  
(17)240327 (98)2F4202209011100004

## Anti-Thyrotropin Receptor Antibody(CLIA)

**2×100 tests**

**Contents :** Ra: 2×6.6 mL, Rb: 2×6.3 mL Rc: Empty cavity, Rd: 2×6.3 mL  
PTR: Add 7.0 mL PTB, PTB: 2×8.0 mL



**SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.**

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China  
Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680 www.mindray.com

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

IVD



CE

0123 2°C




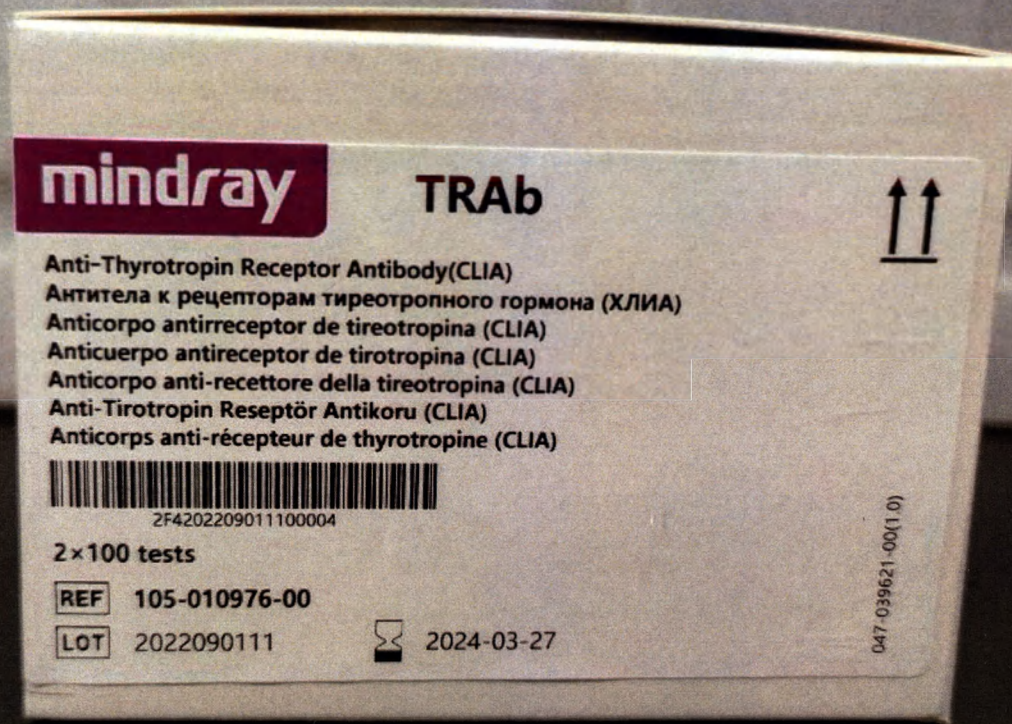


Рисунок 11 Внешняя упаковка. Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (ХЛИА) в соответствии с требованиями стандарта иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2x100 тестов (вид 2)



IVD



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.  
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,  
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China  
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680  
Website: <http://www.mindray.com>

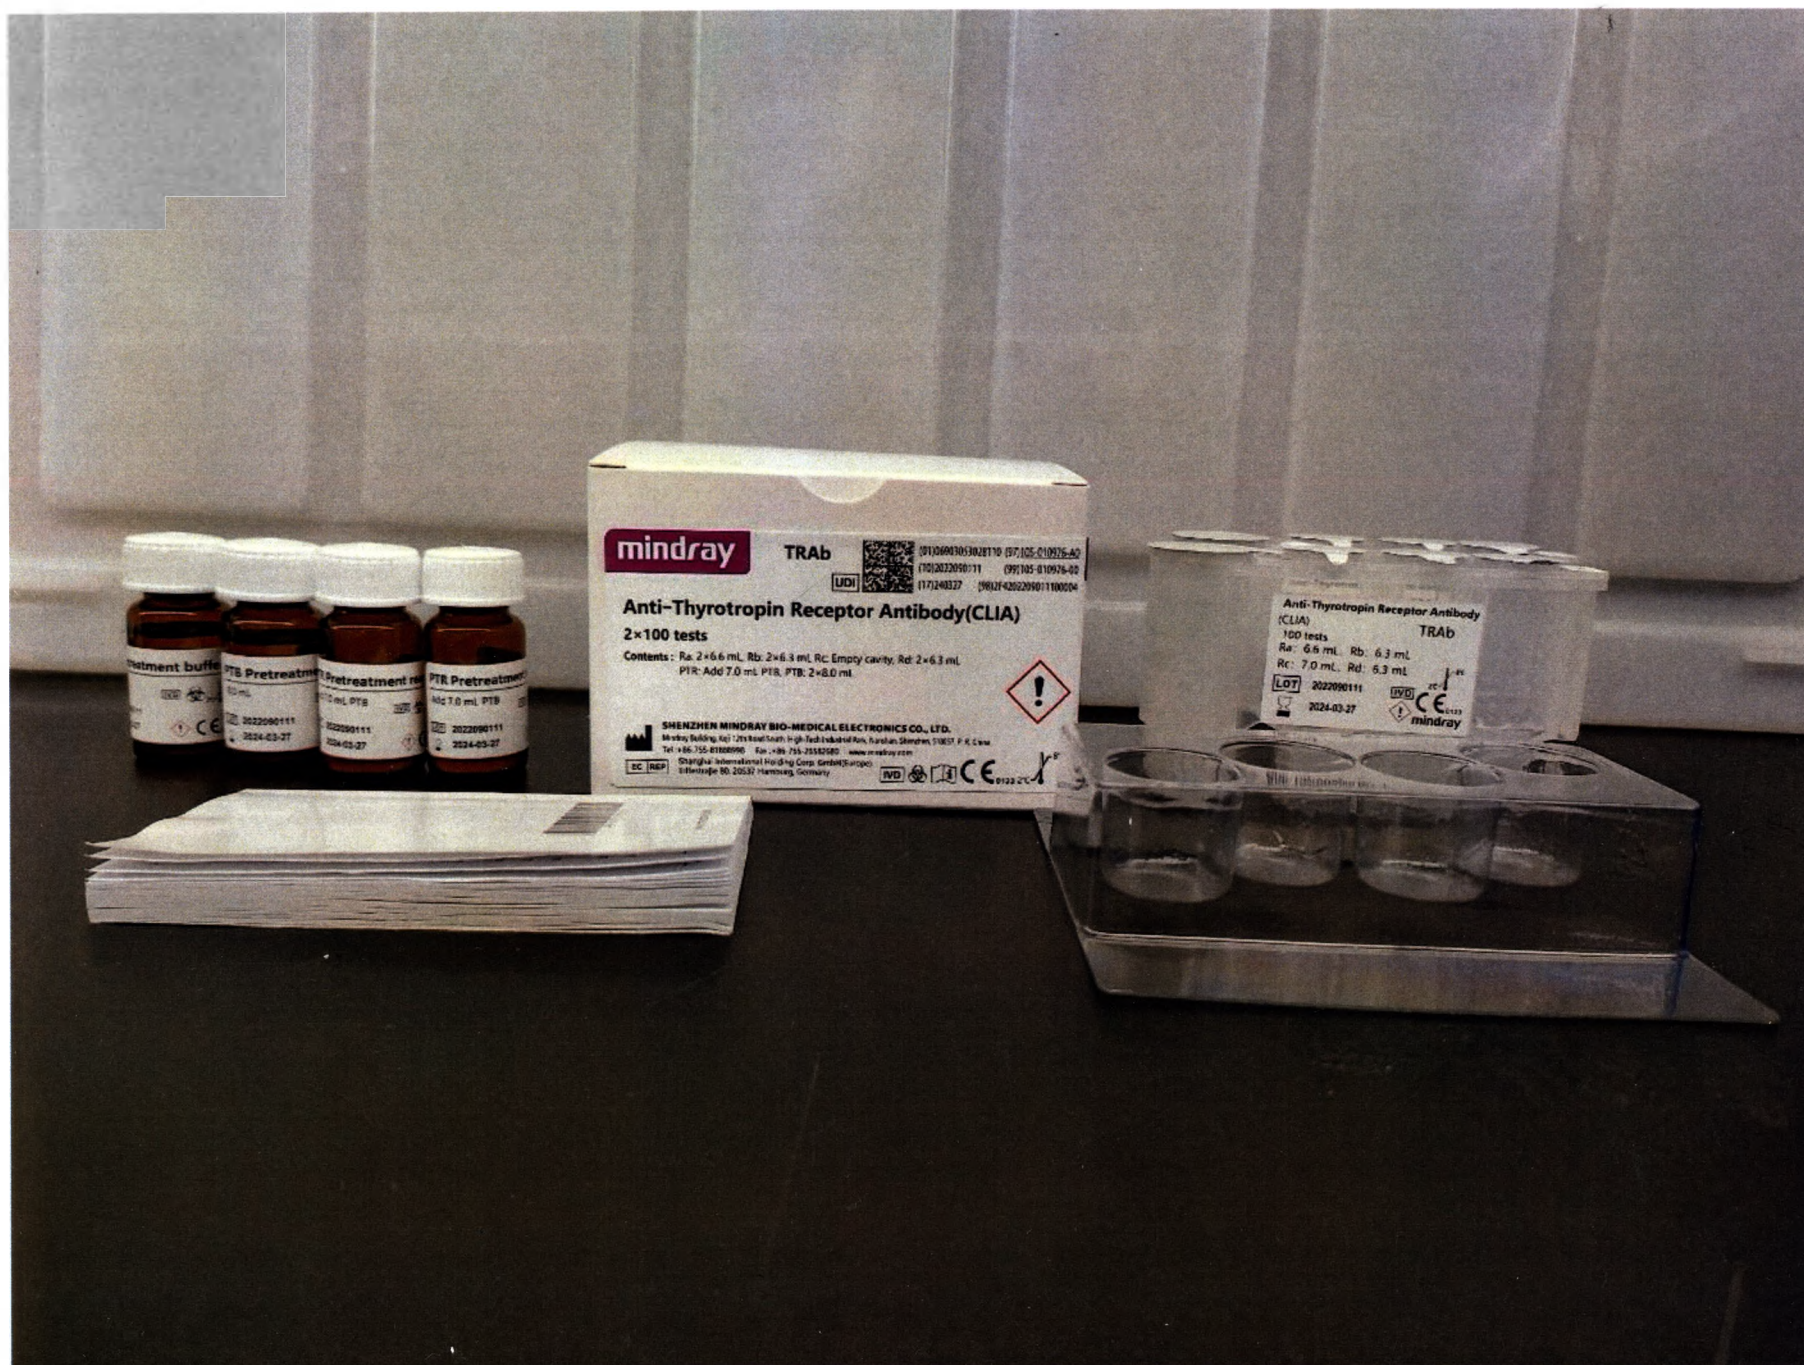


Рисунок 13. Общий вид. Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) с использованием флуоресцентным методом на анализаторах серии CL, 2x100 тестов



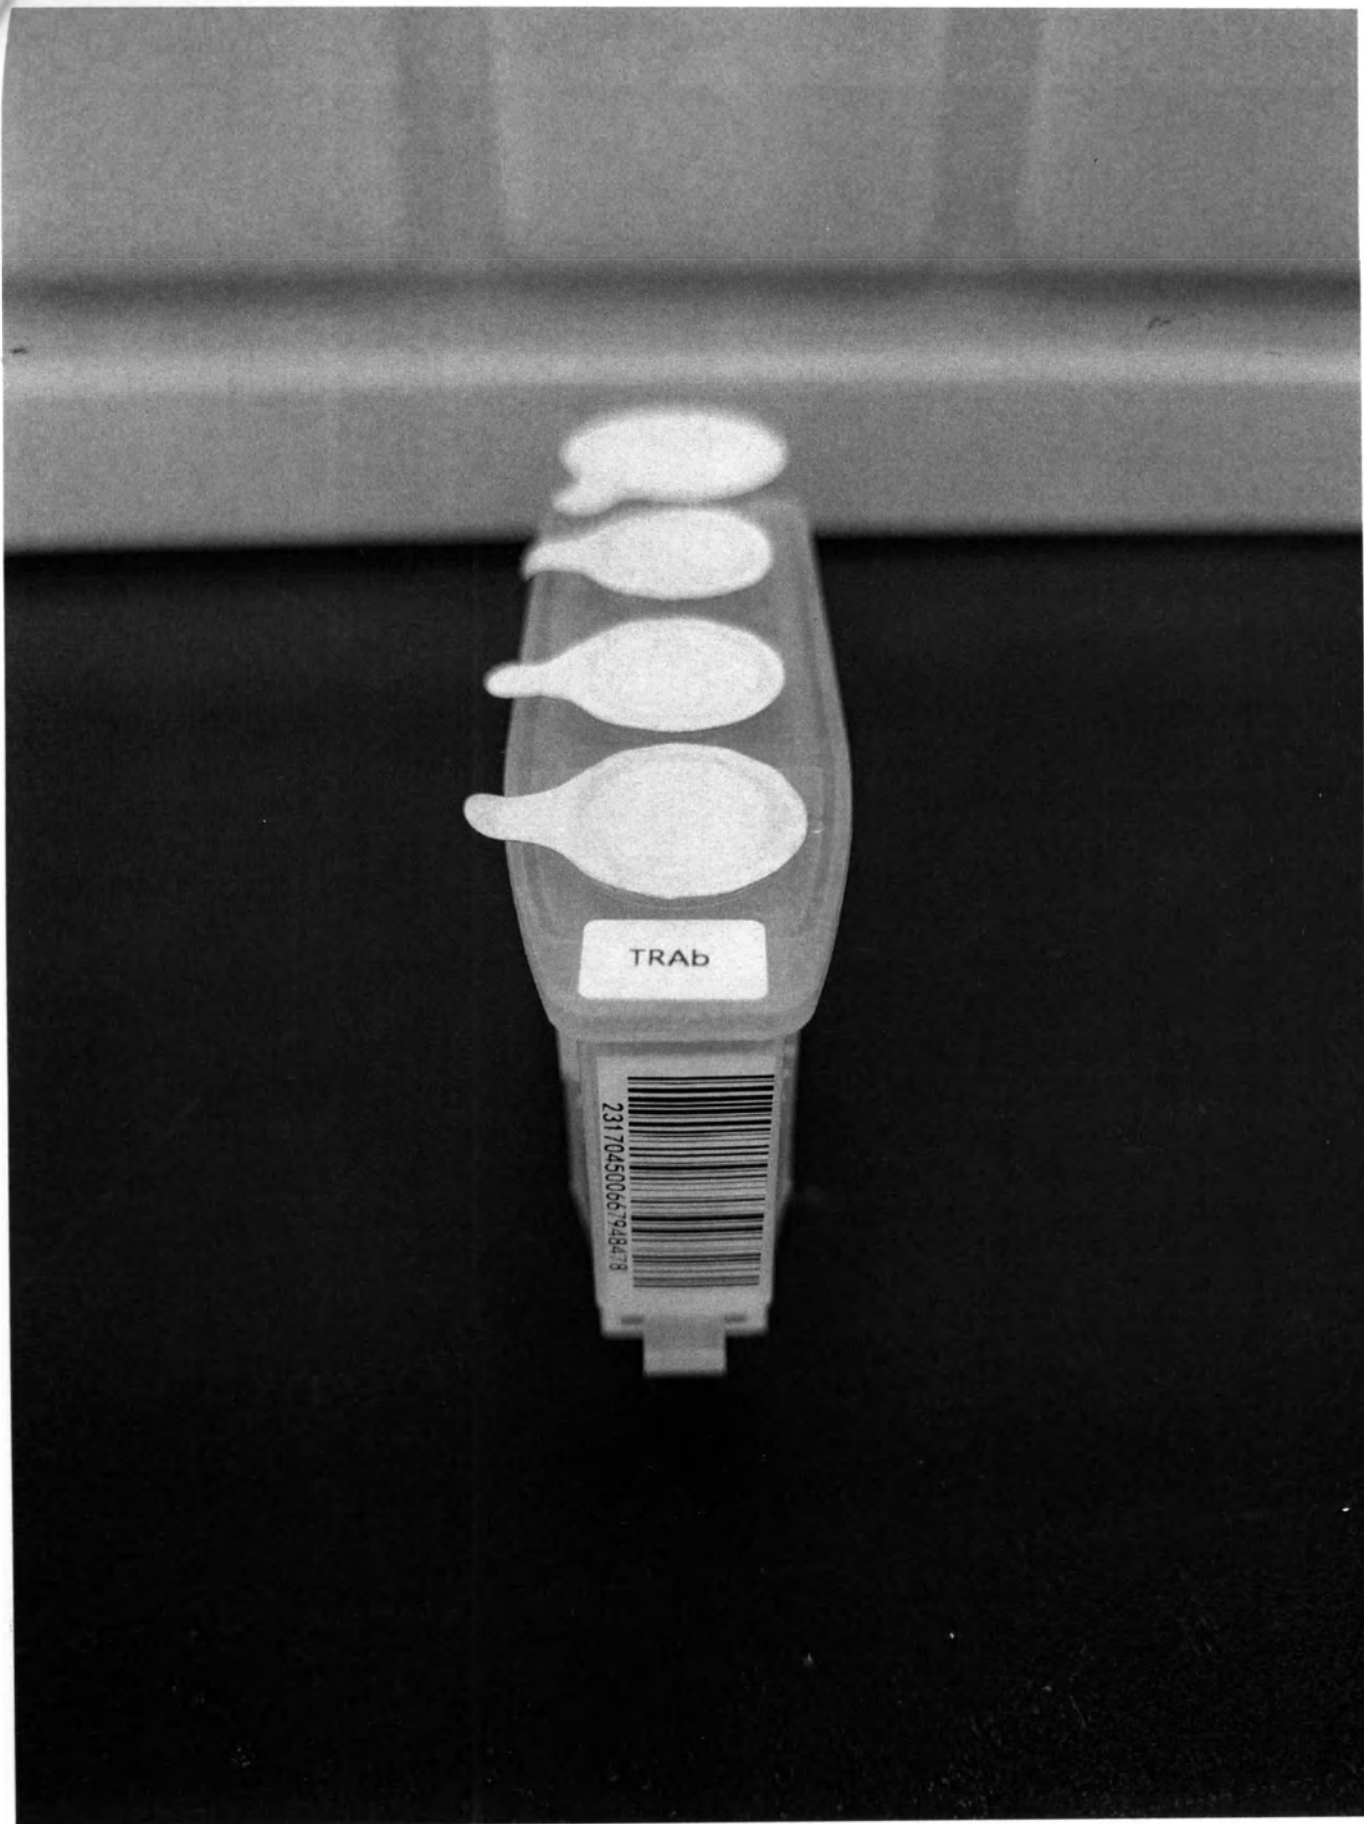


Рисунок 15. Кассета с реагентами - 2 шт. (вид 2)

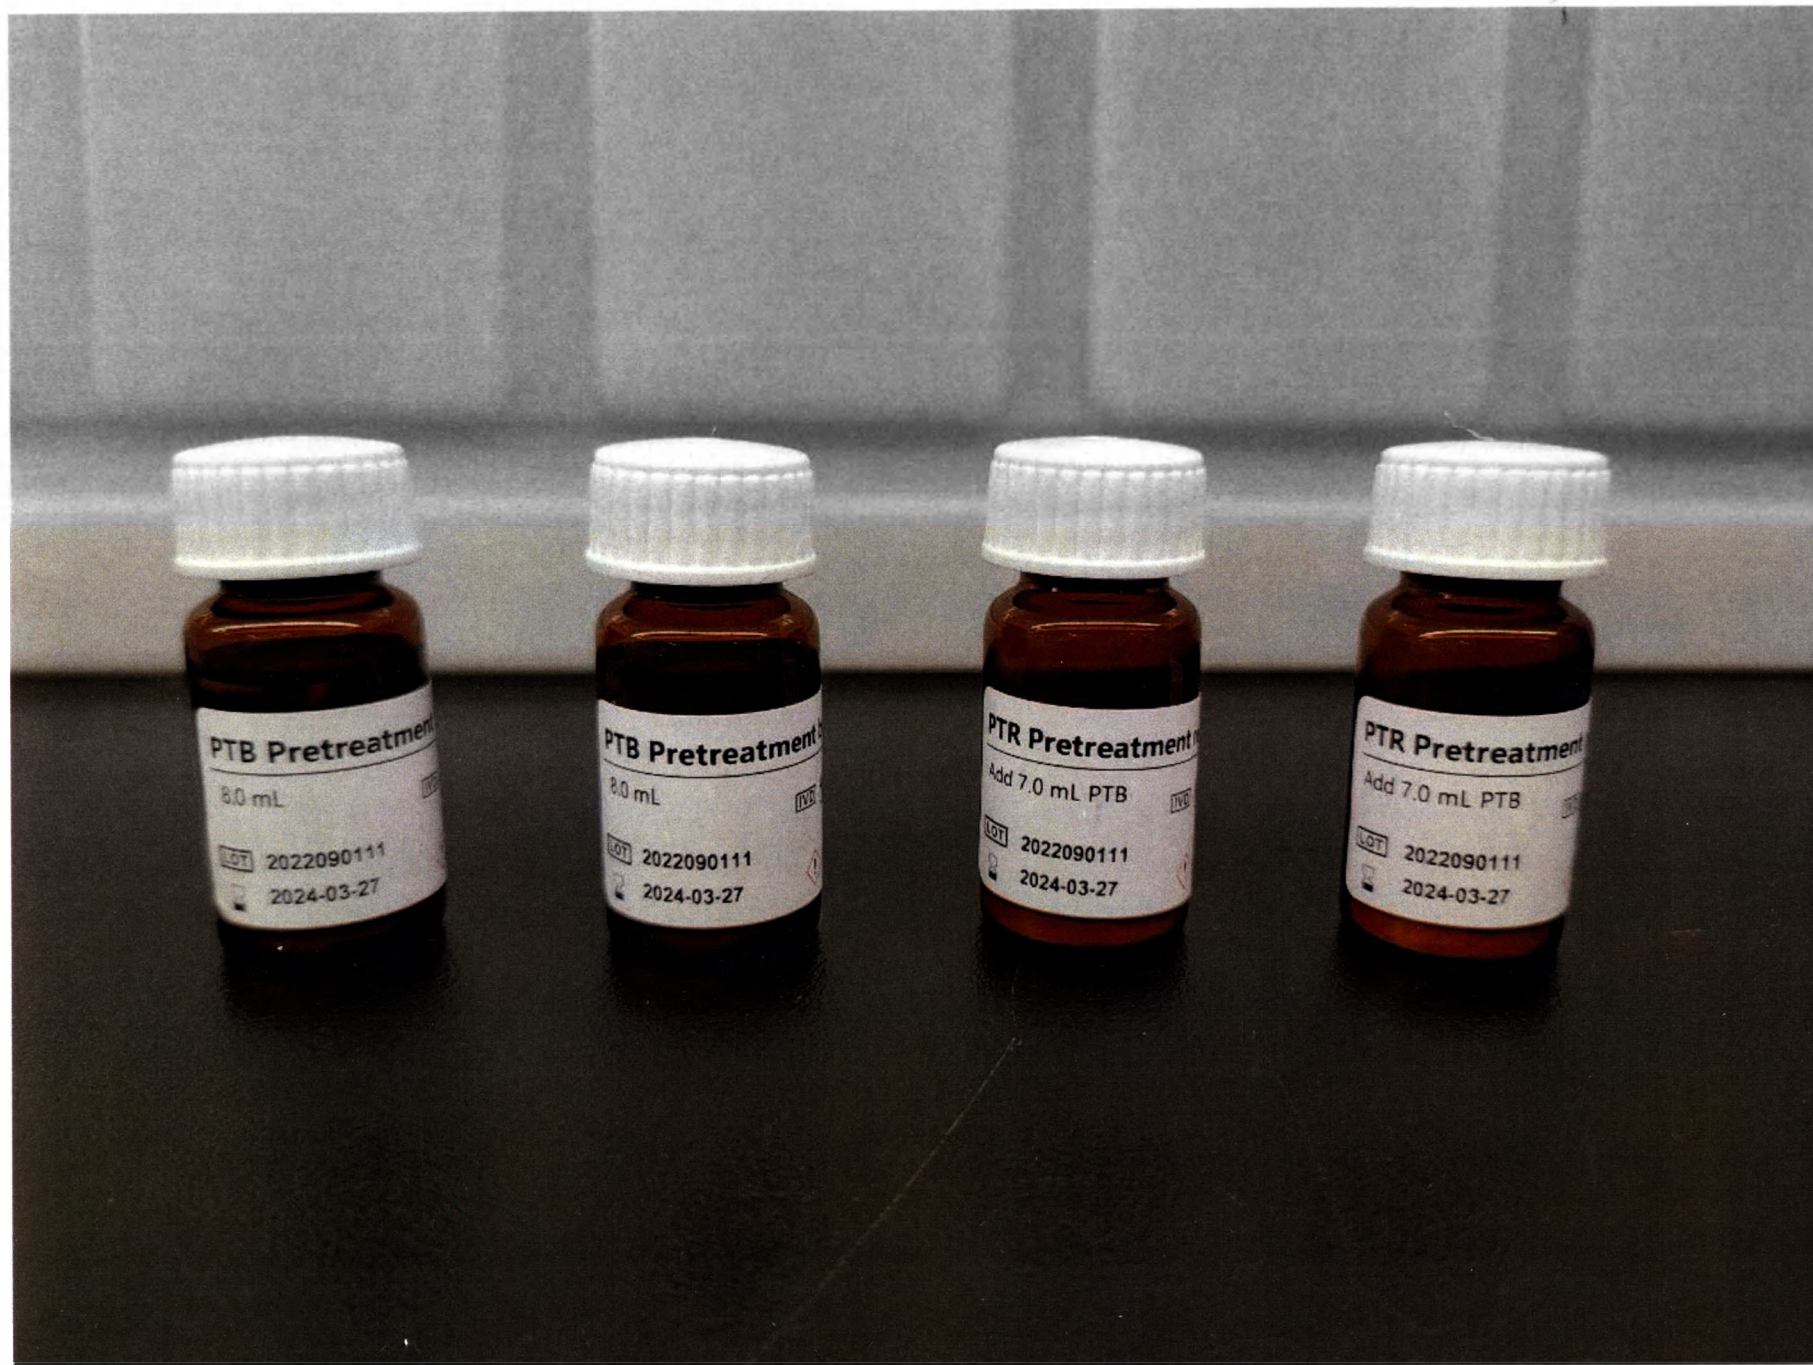


Рисунок 16. Реагент для обработки образца (PTR) – 2шт. и буферный раствор для приготовления раствора для обработки образца (PTB) – 2шт.


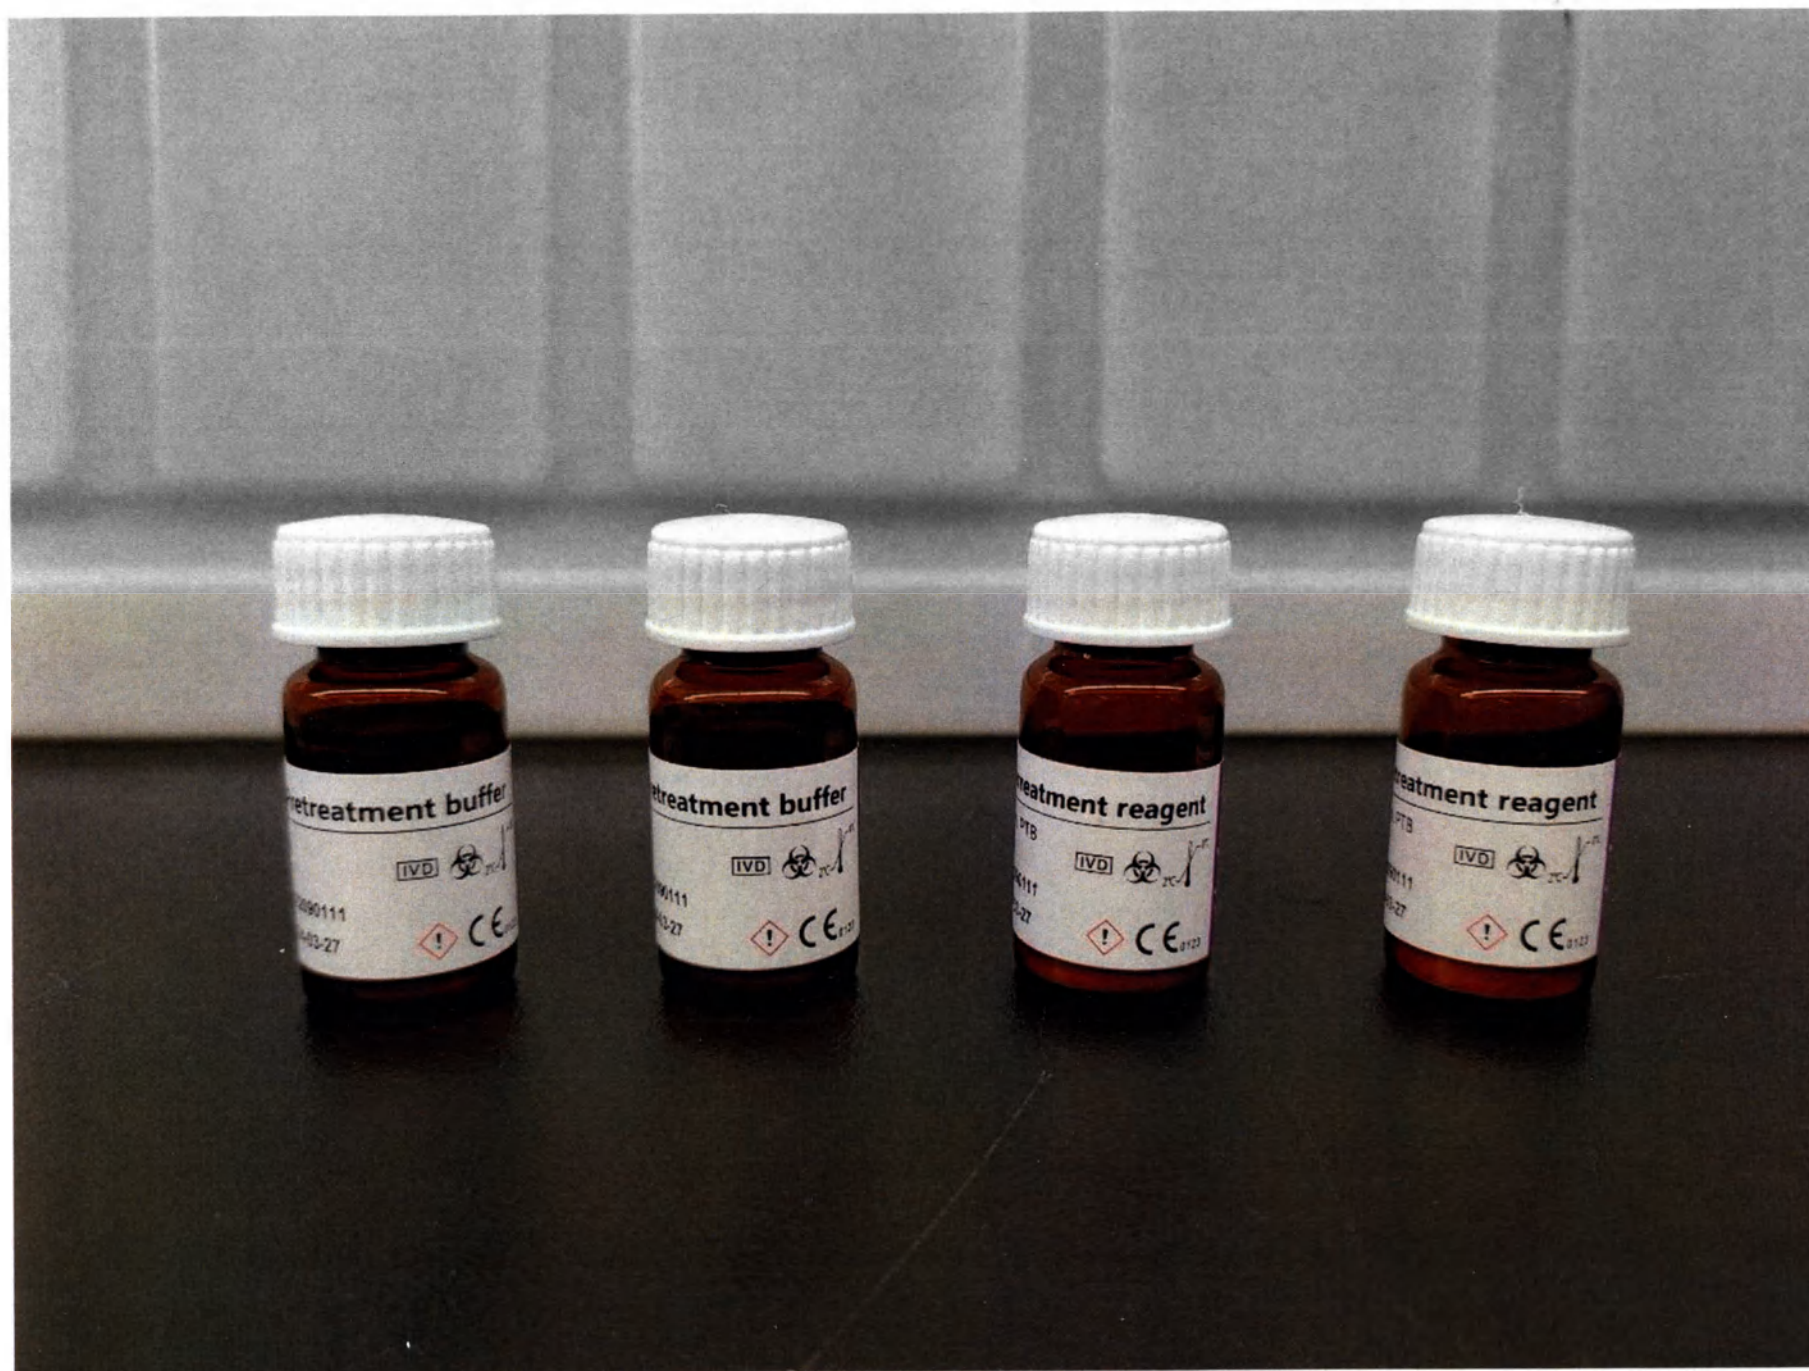


Рисунок 17. Реагент для обработки образца (PTR) – 2шт. и буферный раствор для приготовления раствора для обработки образца (PTB) – 2шт.



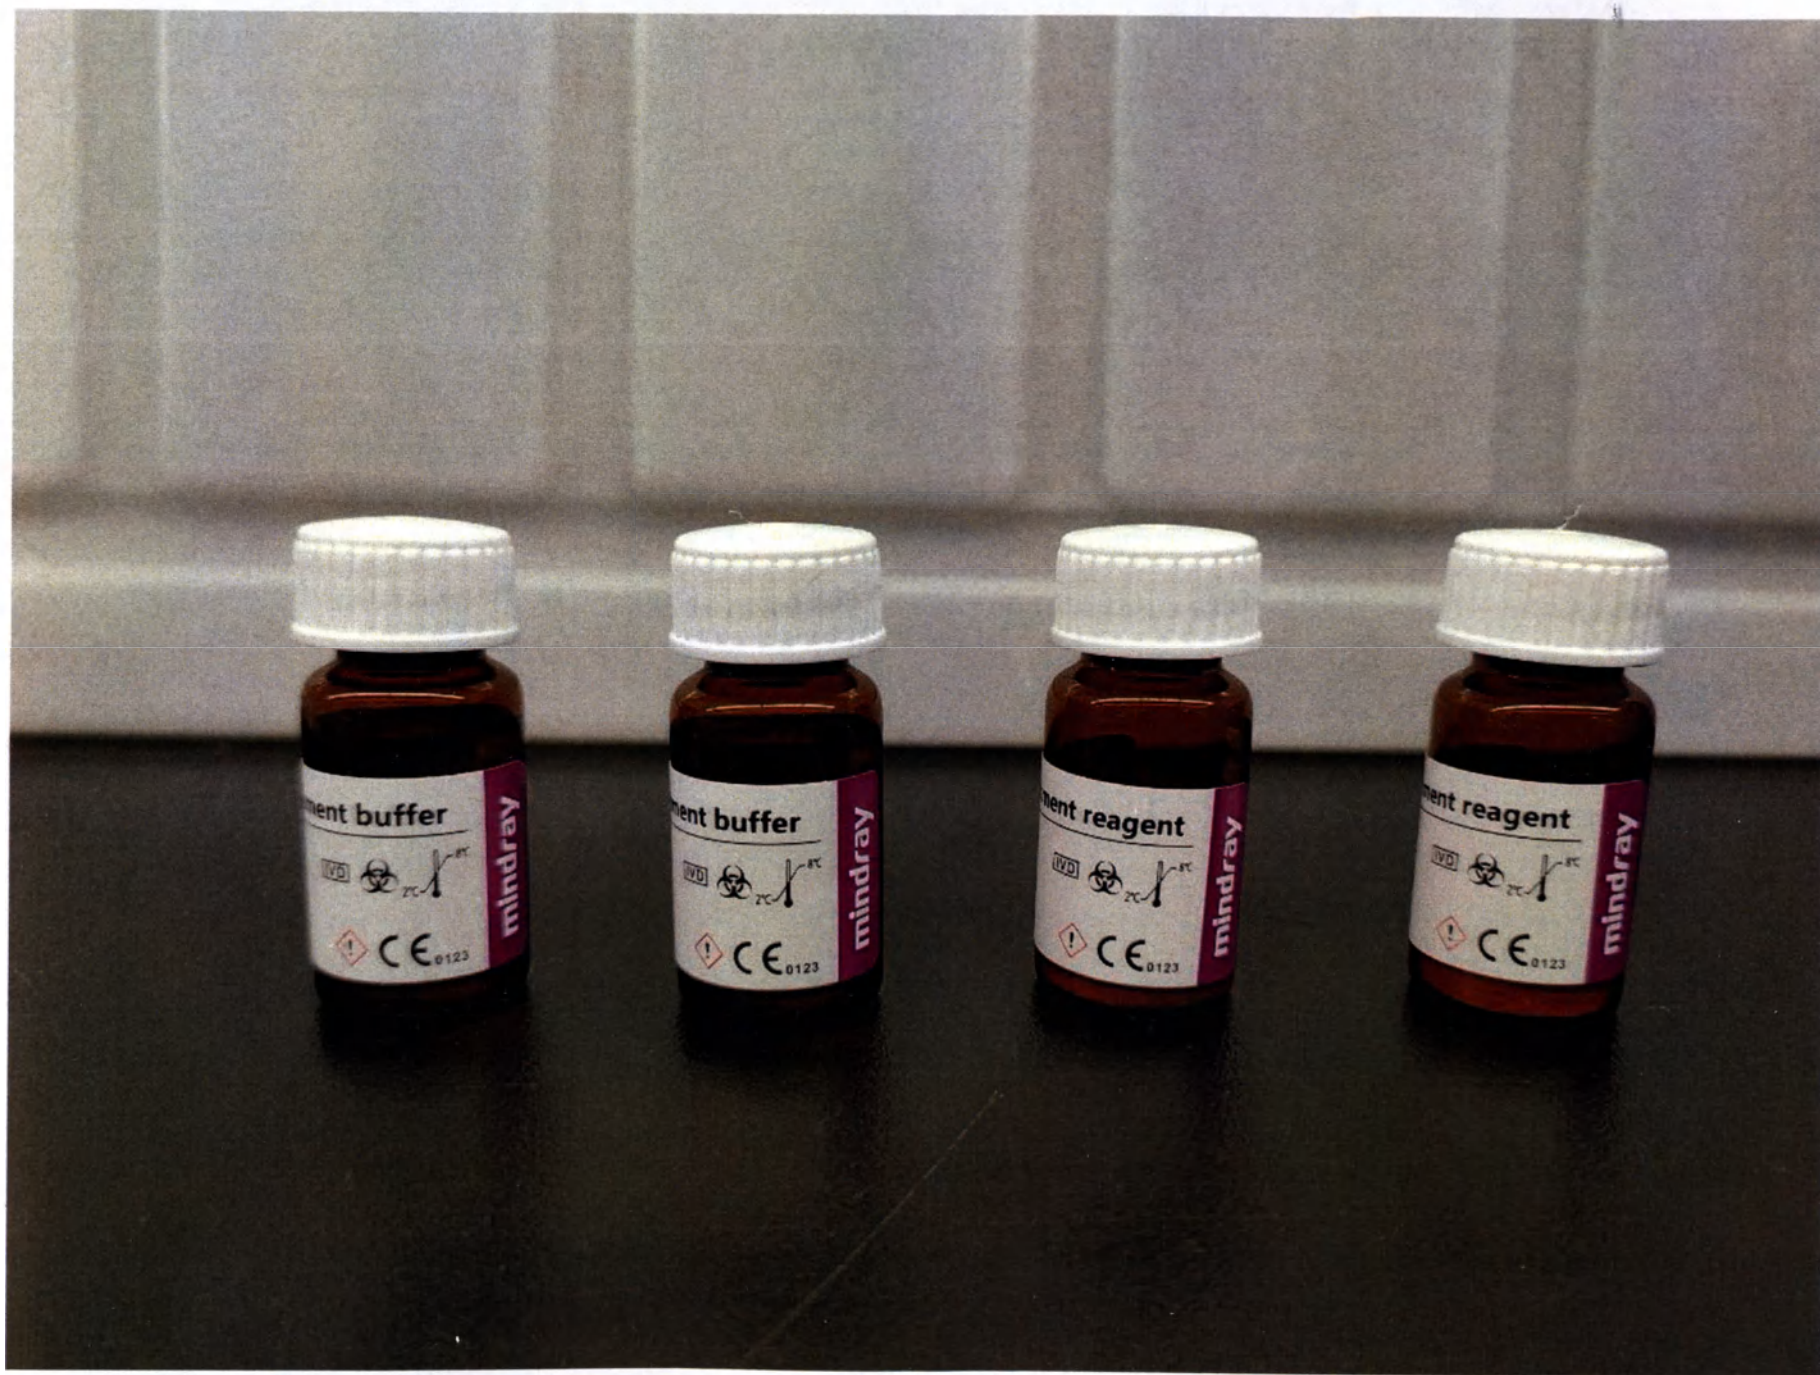

ПРОШИТО И  
СКРЕПЛЕНО  
ПЕЧАТЬЮ  
19 ЛИСТ

ПОДПИСАНО ОТ 30.11.22Г  
СМИРОВА Н.В.  
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА  
РЕГИСТРАЦИИ